



Общество с ограниченной ответственностью
«Азиямедконсалт»
Россия, 109004, Москва, ул. А. Солженицына, д. 27
Тел.: +7 495 988 47 44
ОГРН: 1137746433879
ИНН: 7709929540

ПОДТВЕРЖДАЮ

Директор по развитию
ООО «АМК»





Перцева Н. Н.

«06» сентября 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для количественного определения N-концевого пропептида натрийуретического гормона (В-типа) в сыворотке и плазме крови человека (NT-proBNP CLIA Microparticles (NT-proBNP)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

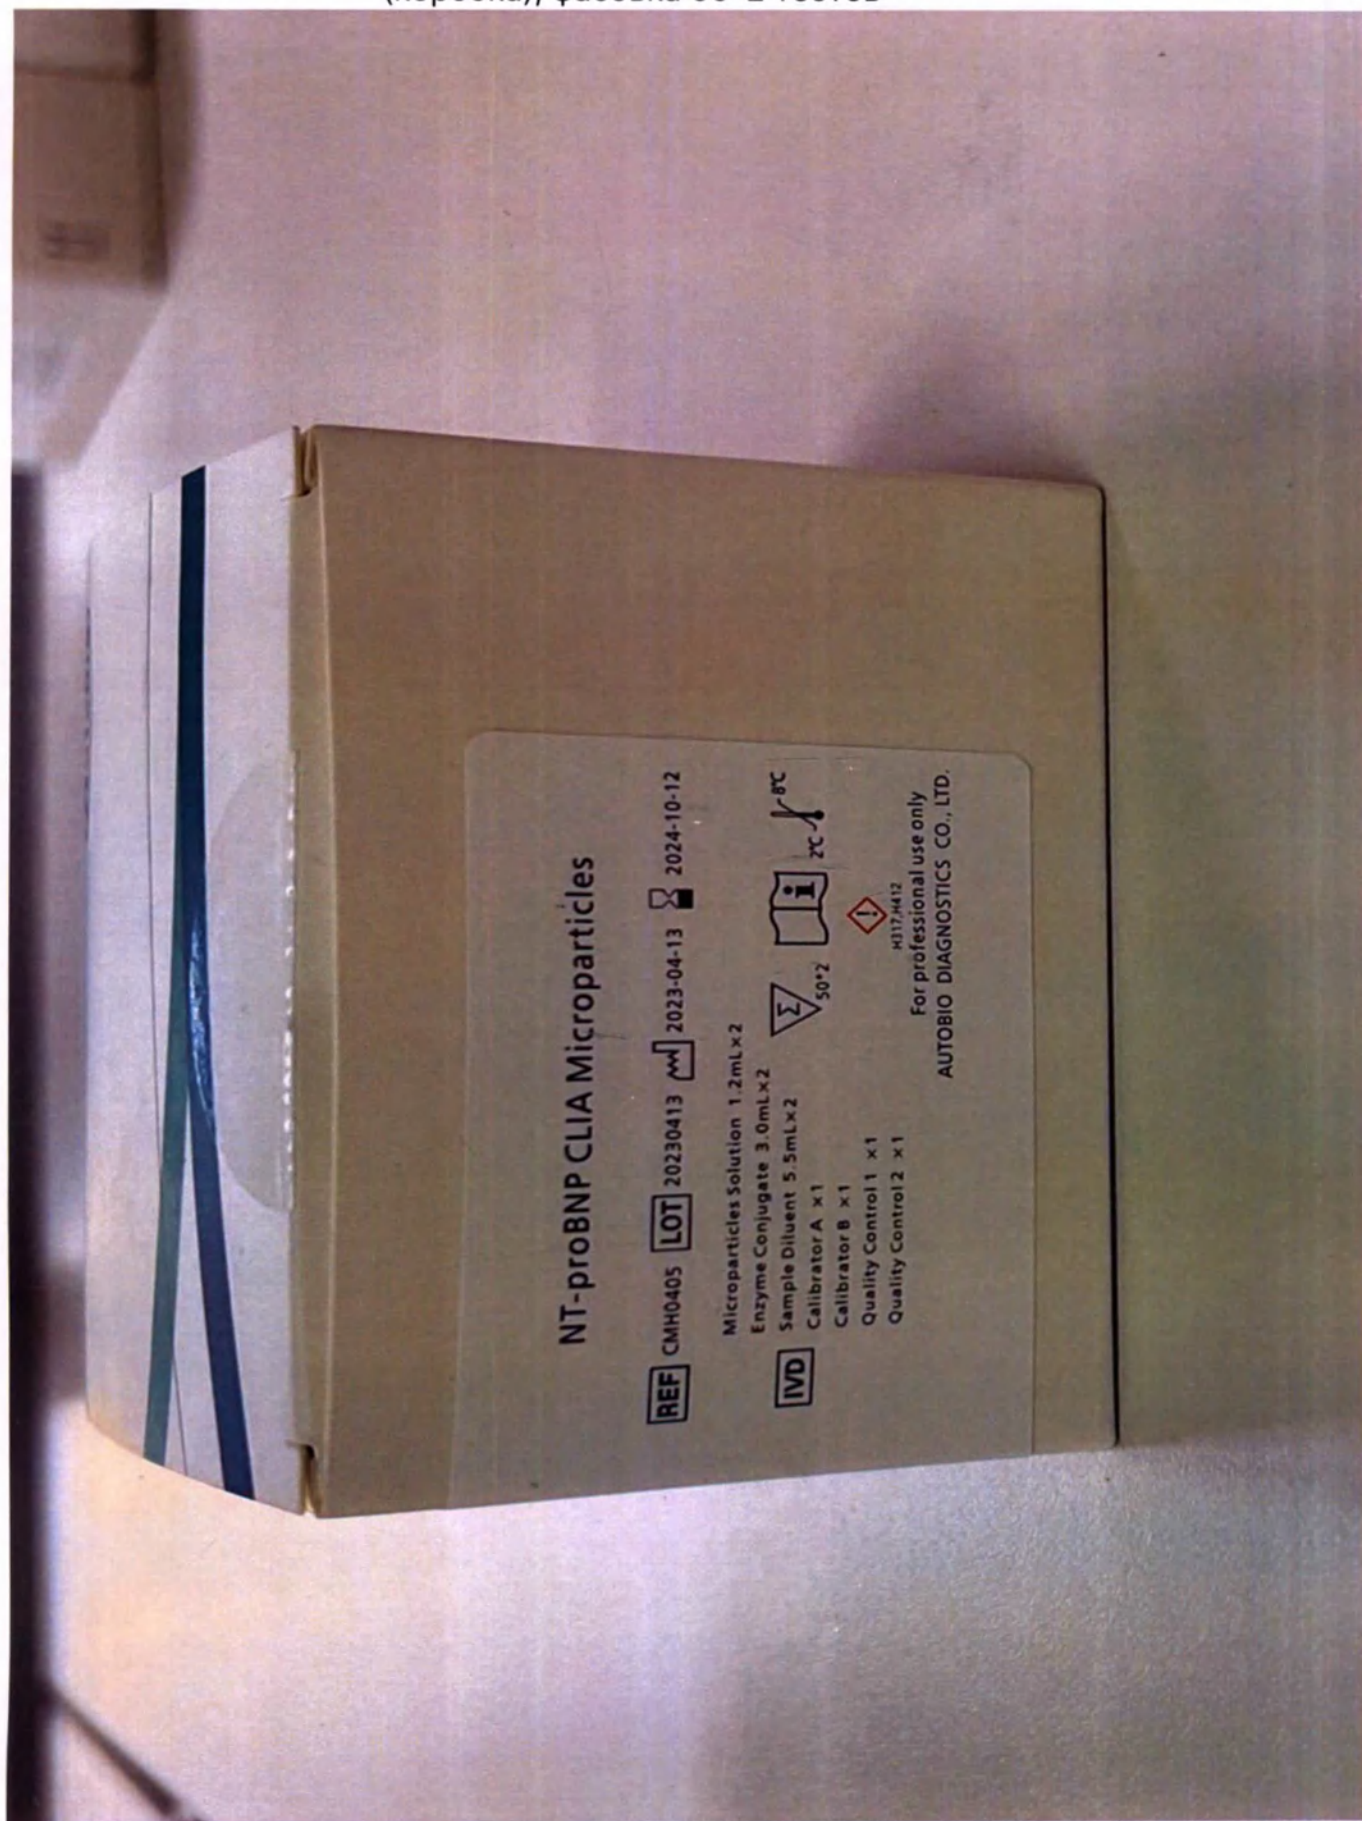

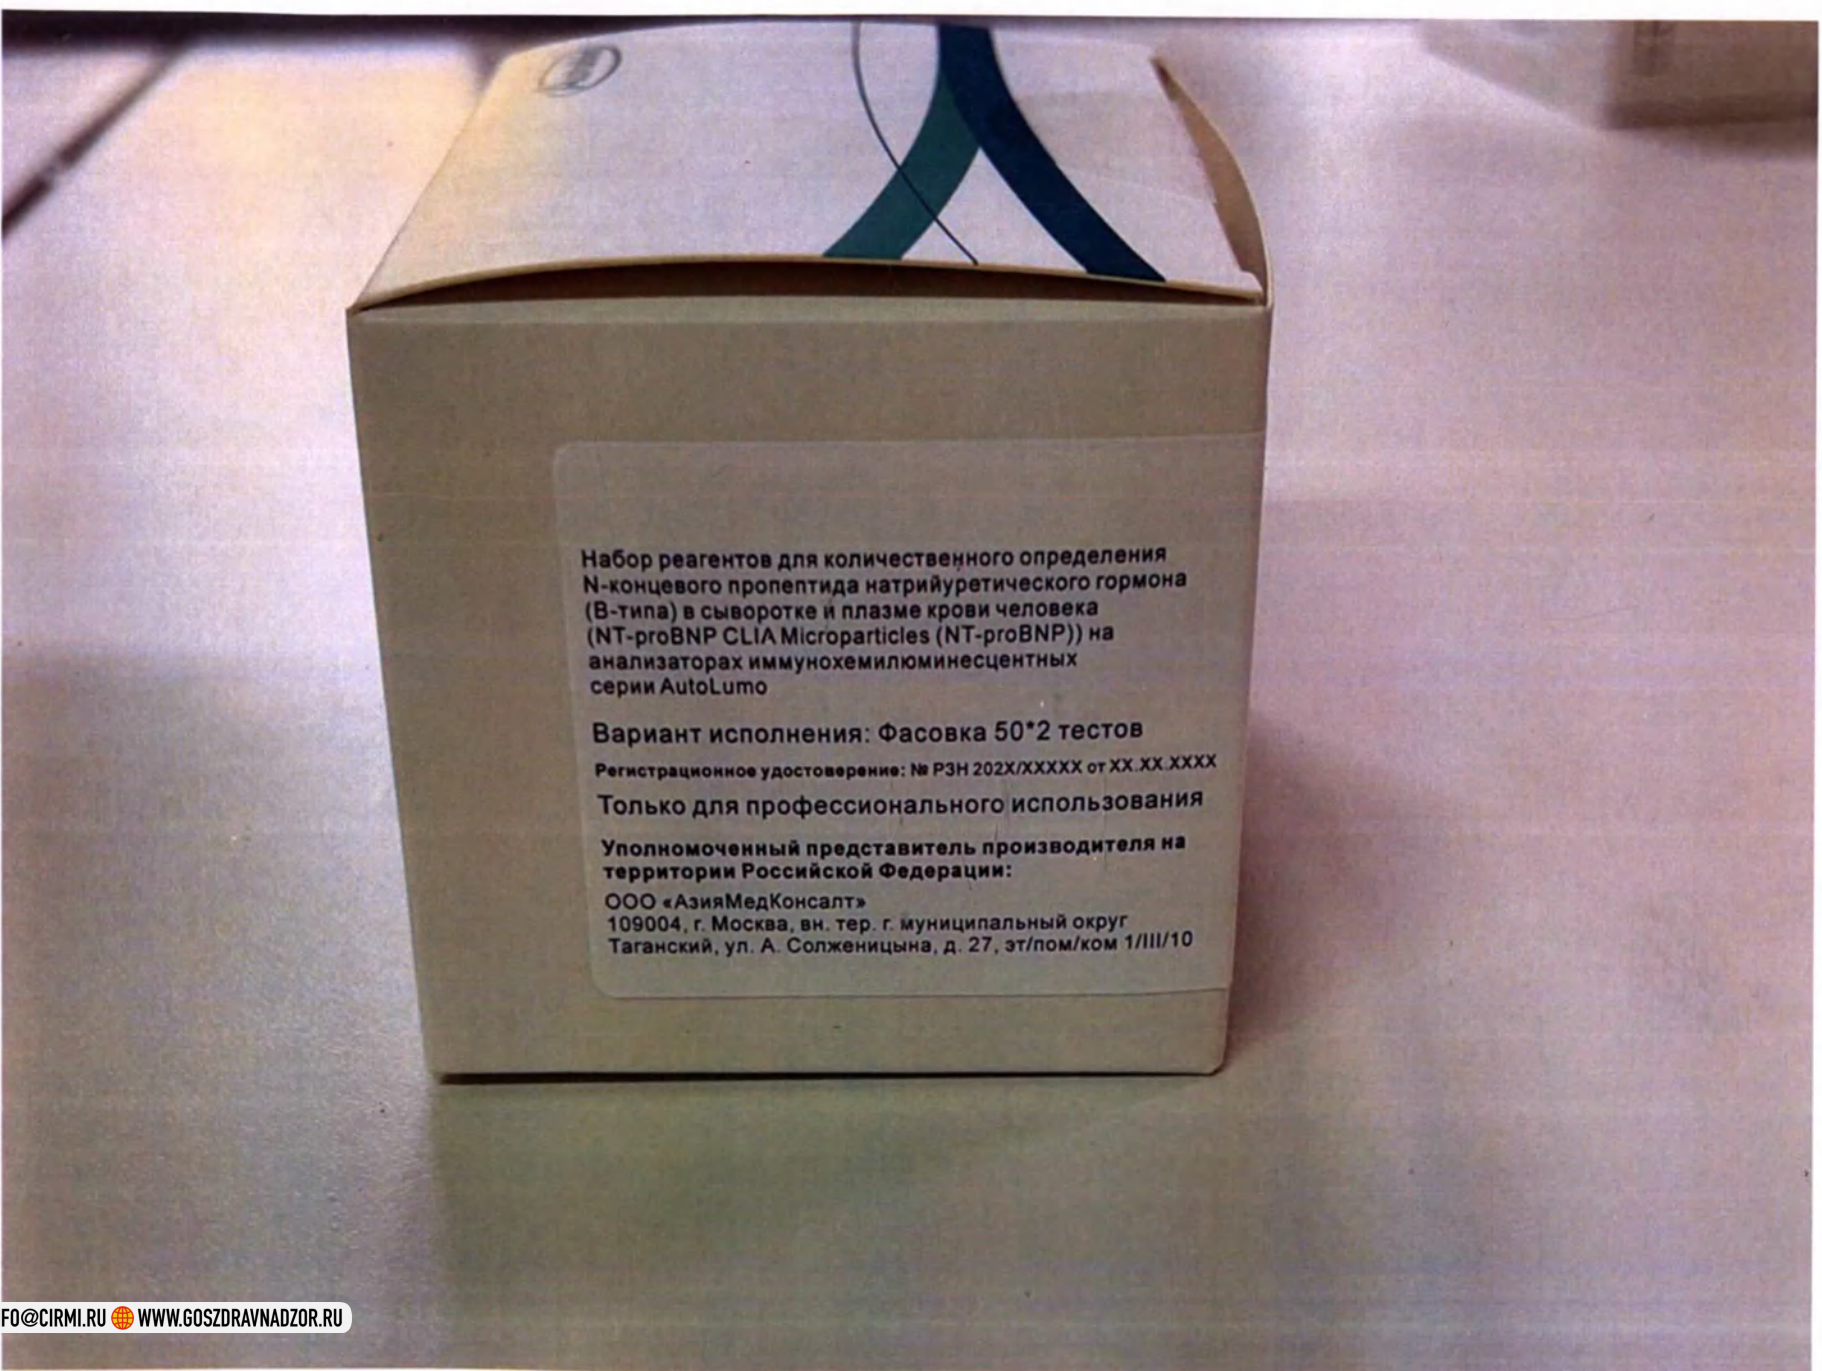

Набор реагентов для количественного определения
N-концевого пропептида натрийуретического гормона
(В-типа) в сыворотке и плазме крови человека
(NT-proBNP CLIA Microparticles (NT-proBNP)) на
анализаторах иммунохемилюминесцентных
серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования


Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10


Фотографическое изображение набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов




Фотографическое изображение набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов

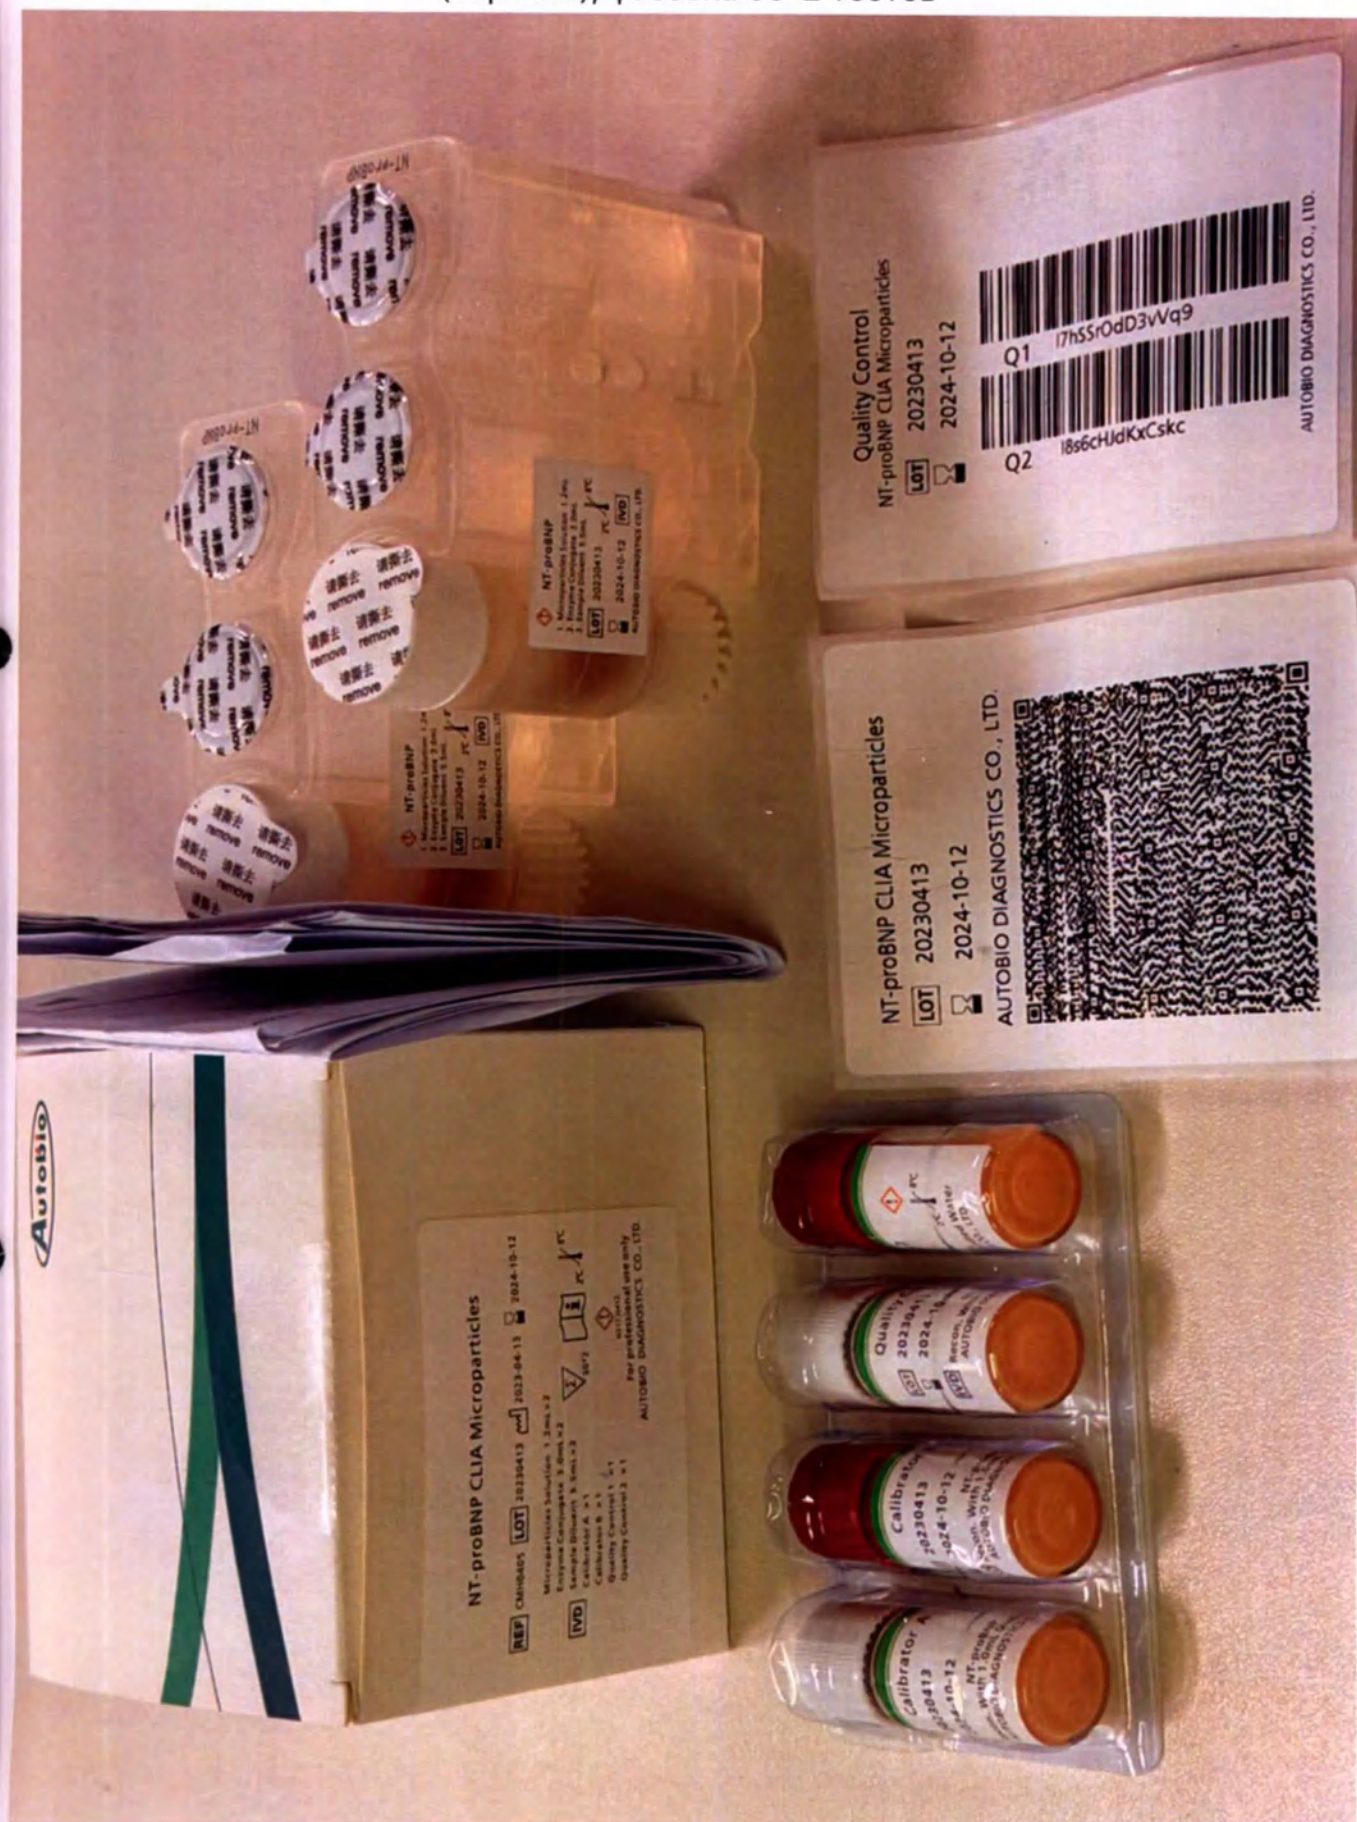

Фотографическое изображение набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов

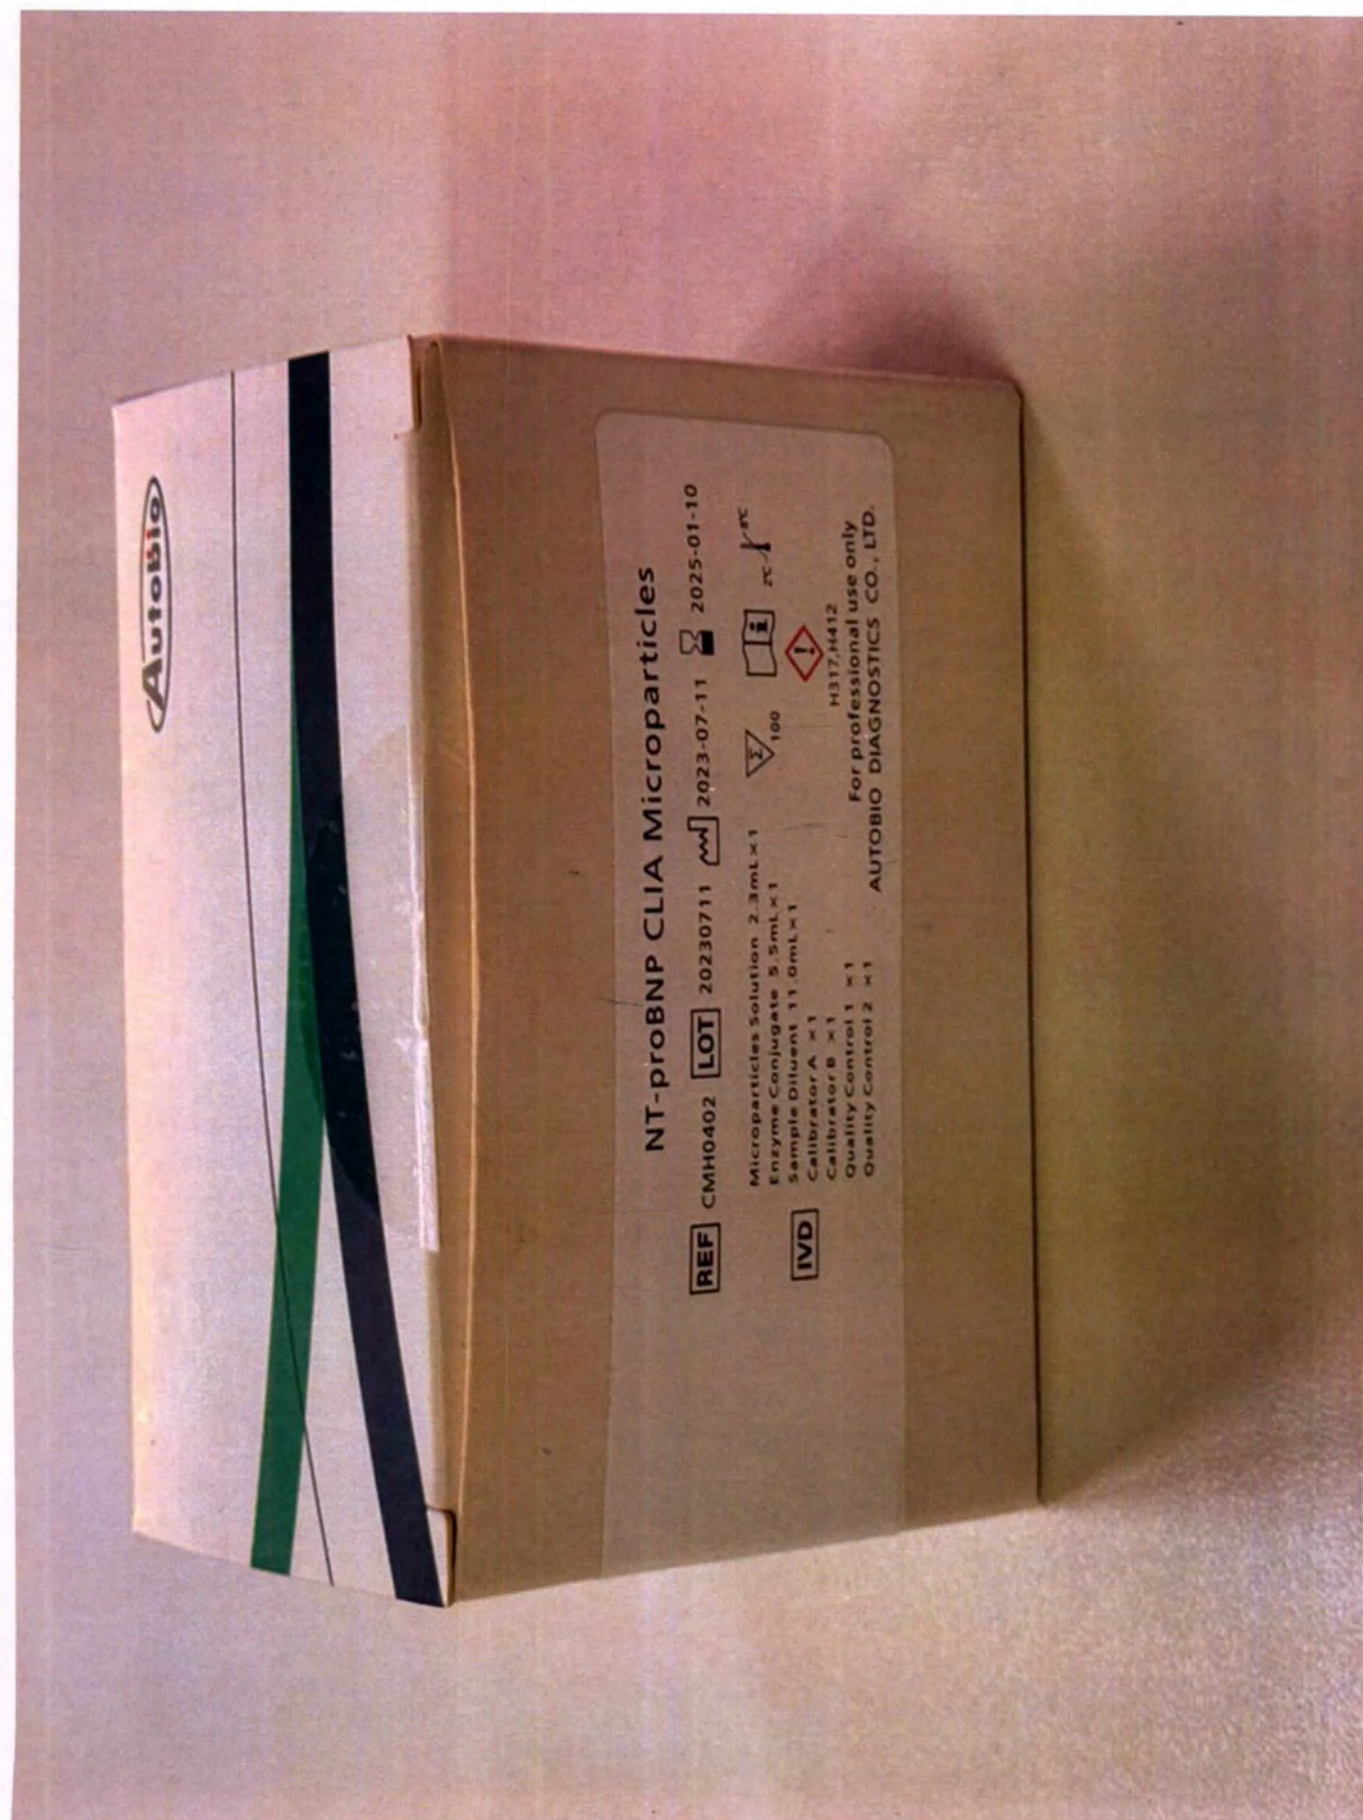

Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов

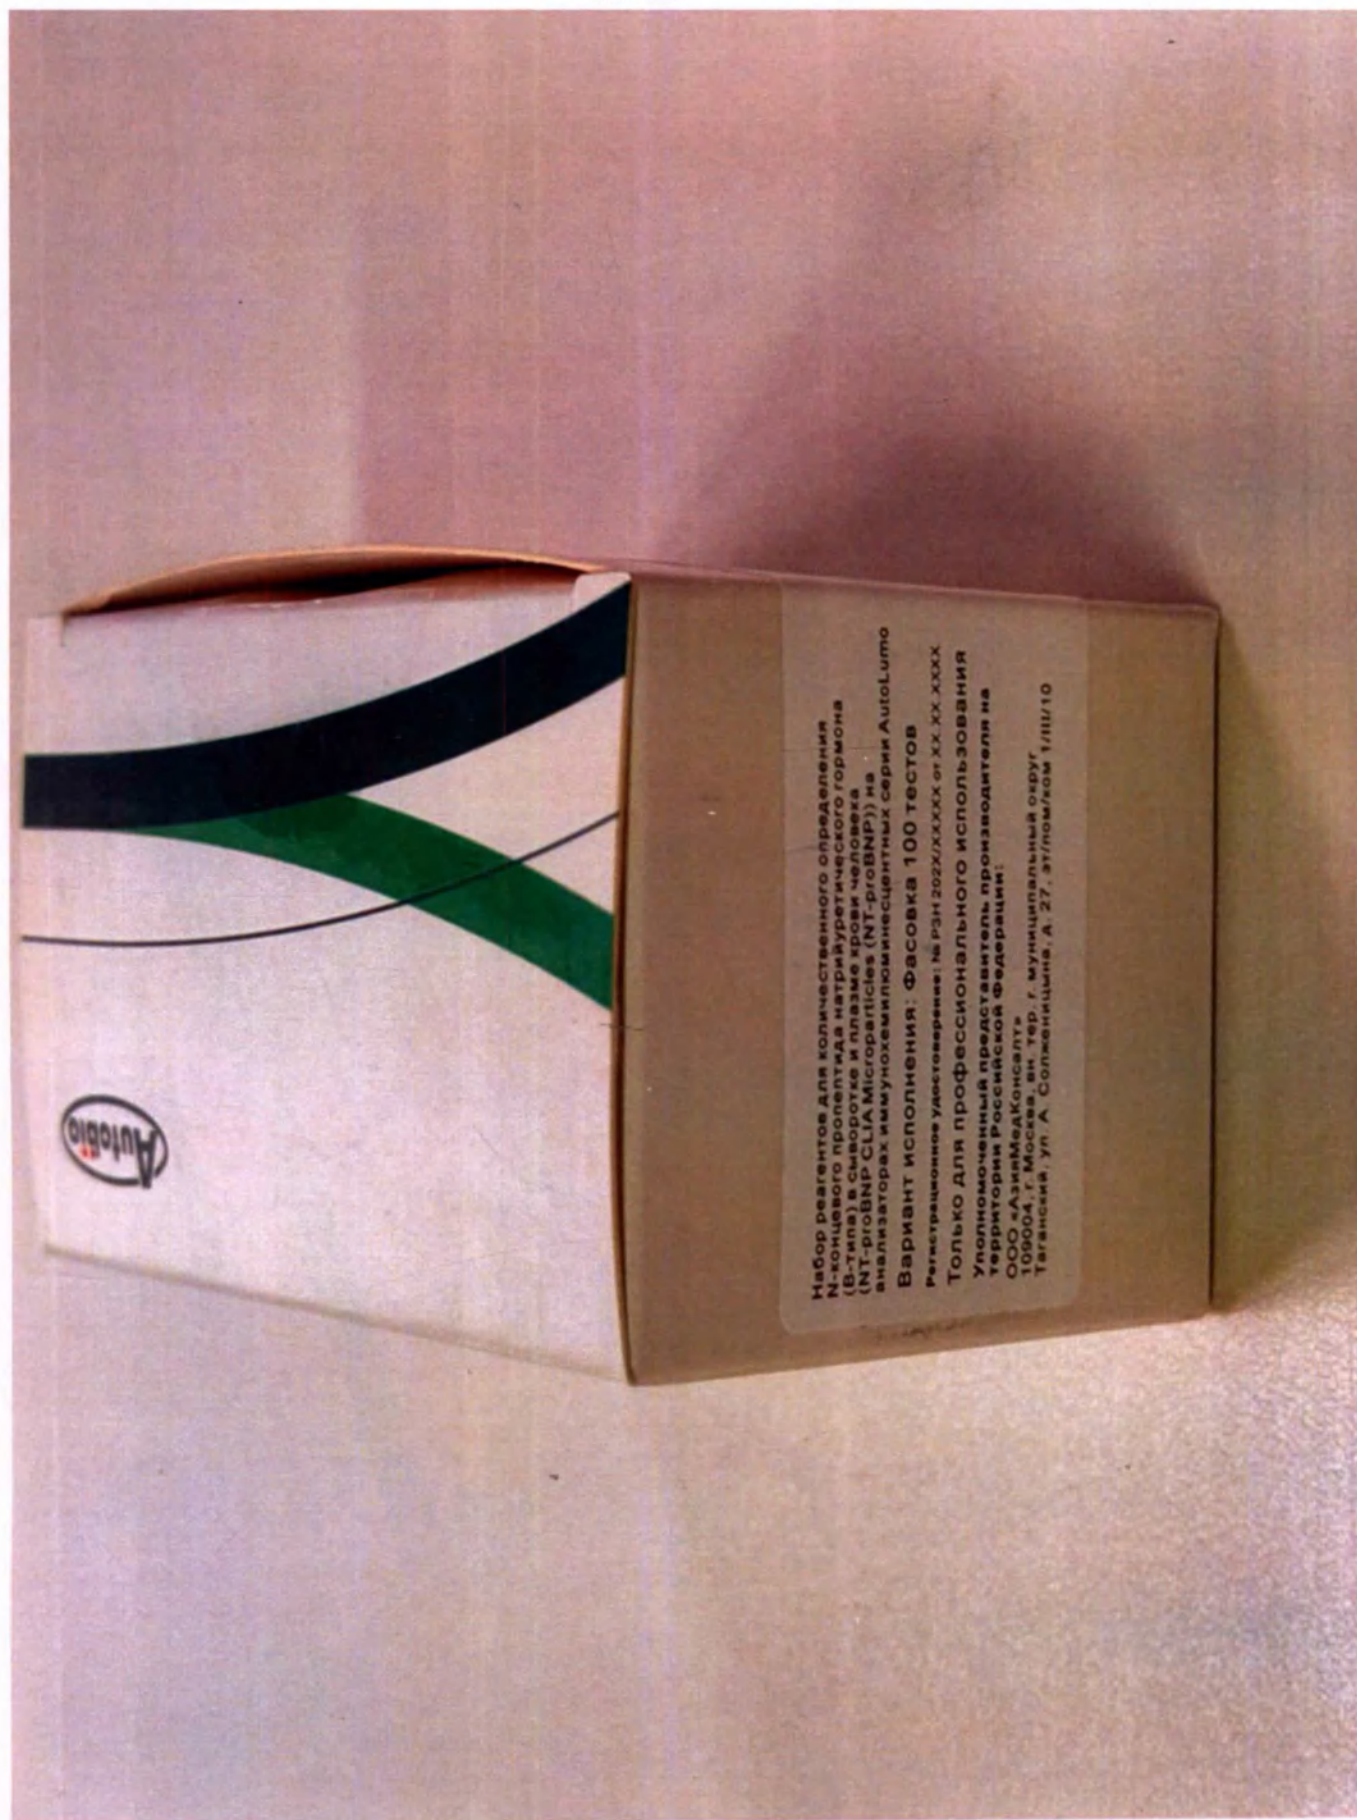


Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов



Фотографическое изображение набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов




Фотографическое изображение калибраторов: Калибратор А (Calibrator A) и Калибратор В (Calibrator B)

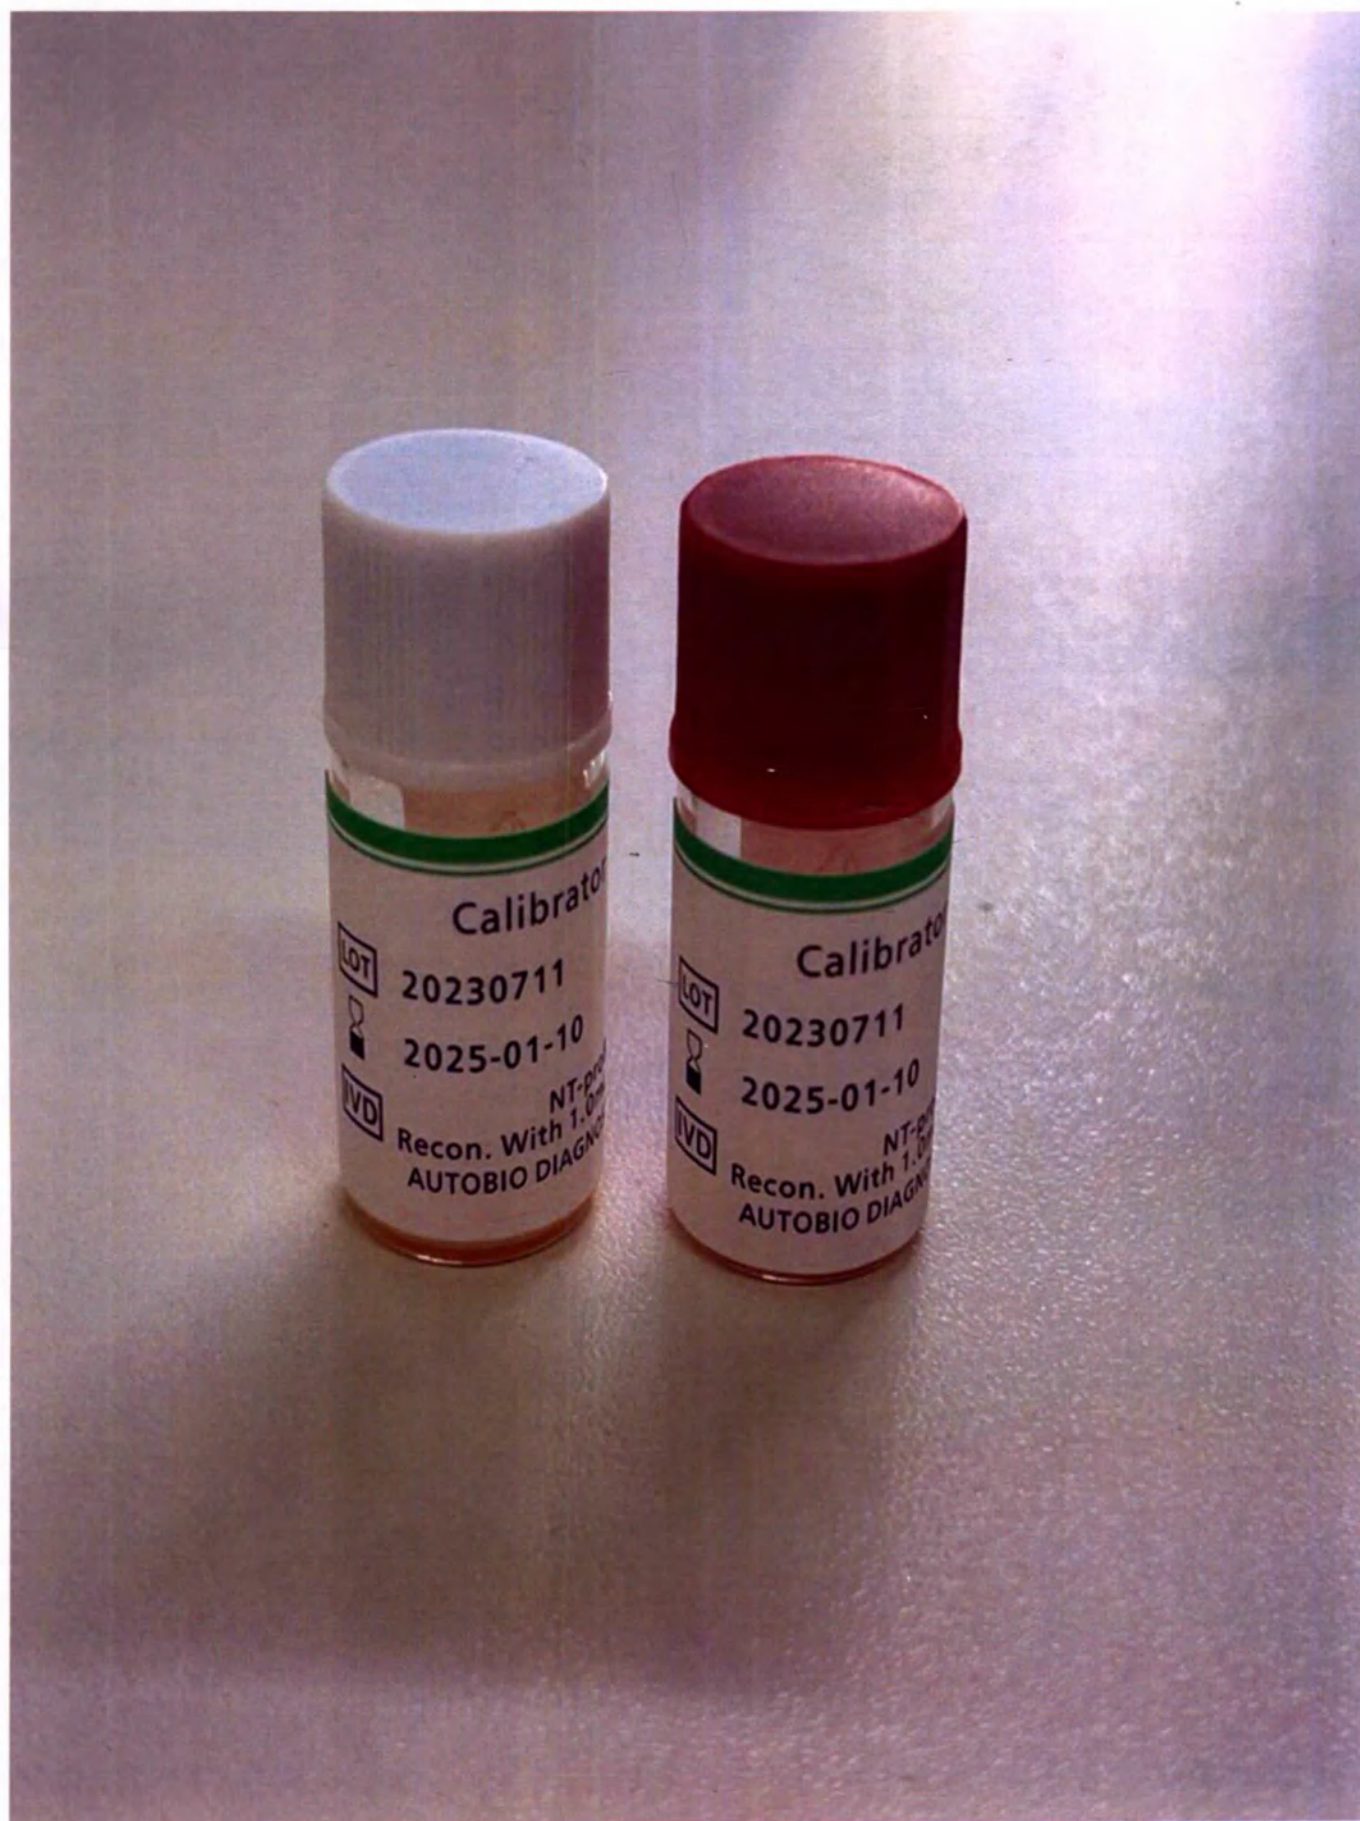

Фотографическое изображение калибраторов: Калибратор А (Calibrator A) и Калибратор В (Calibrator B)




Фотографическое изображение калибраторов: Калибратор А (Calibrator A) и Калибратор В (Calibrator B)

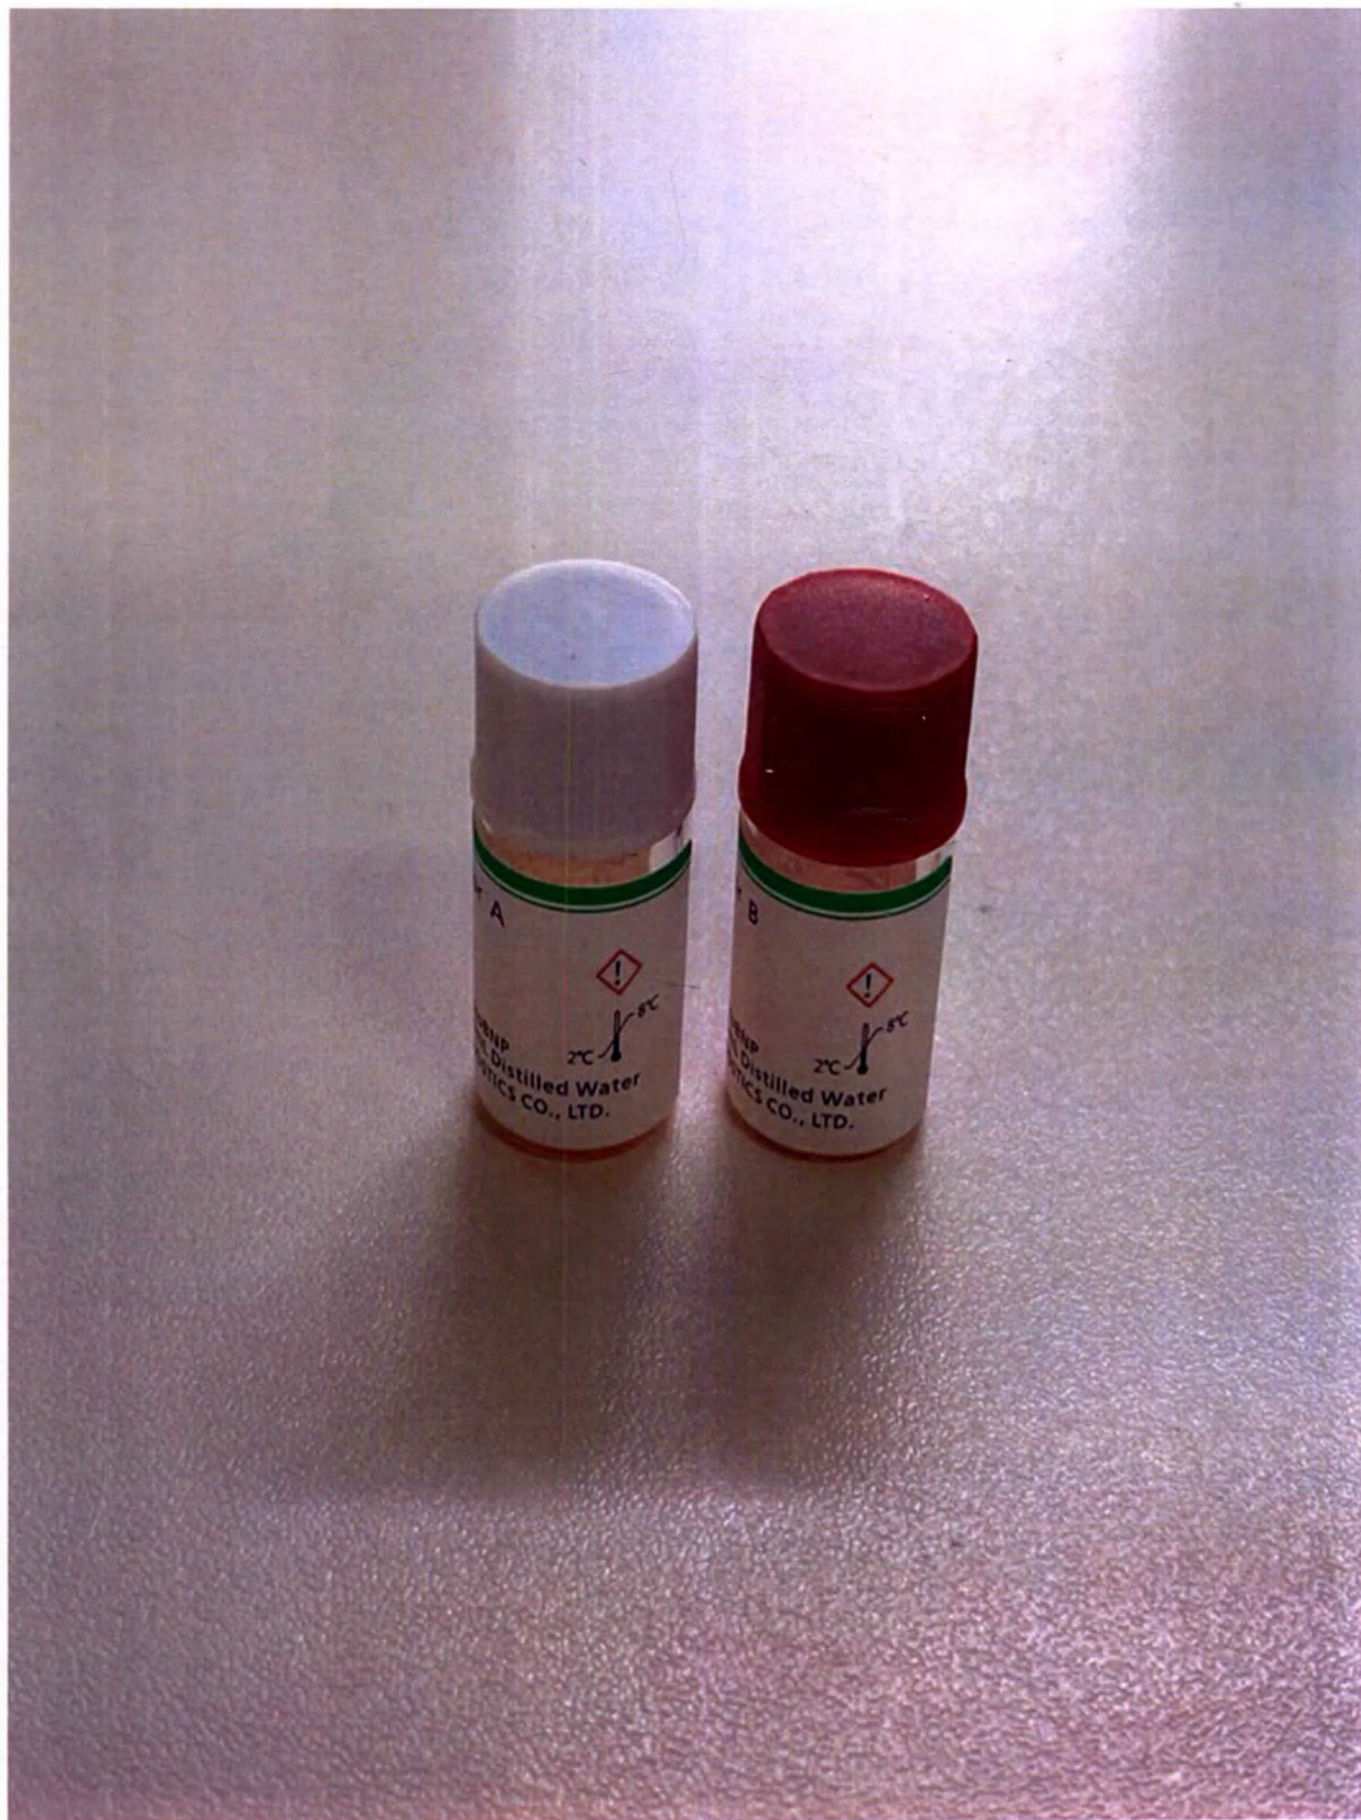

Фотографическое изображение контролей низкого уровня (Quality control 1) и высокого уровня (Quality control 2)




Фотографическое изображение контролей низкого уровня (Quality control 1) и высокого уровня (Quality control 2)

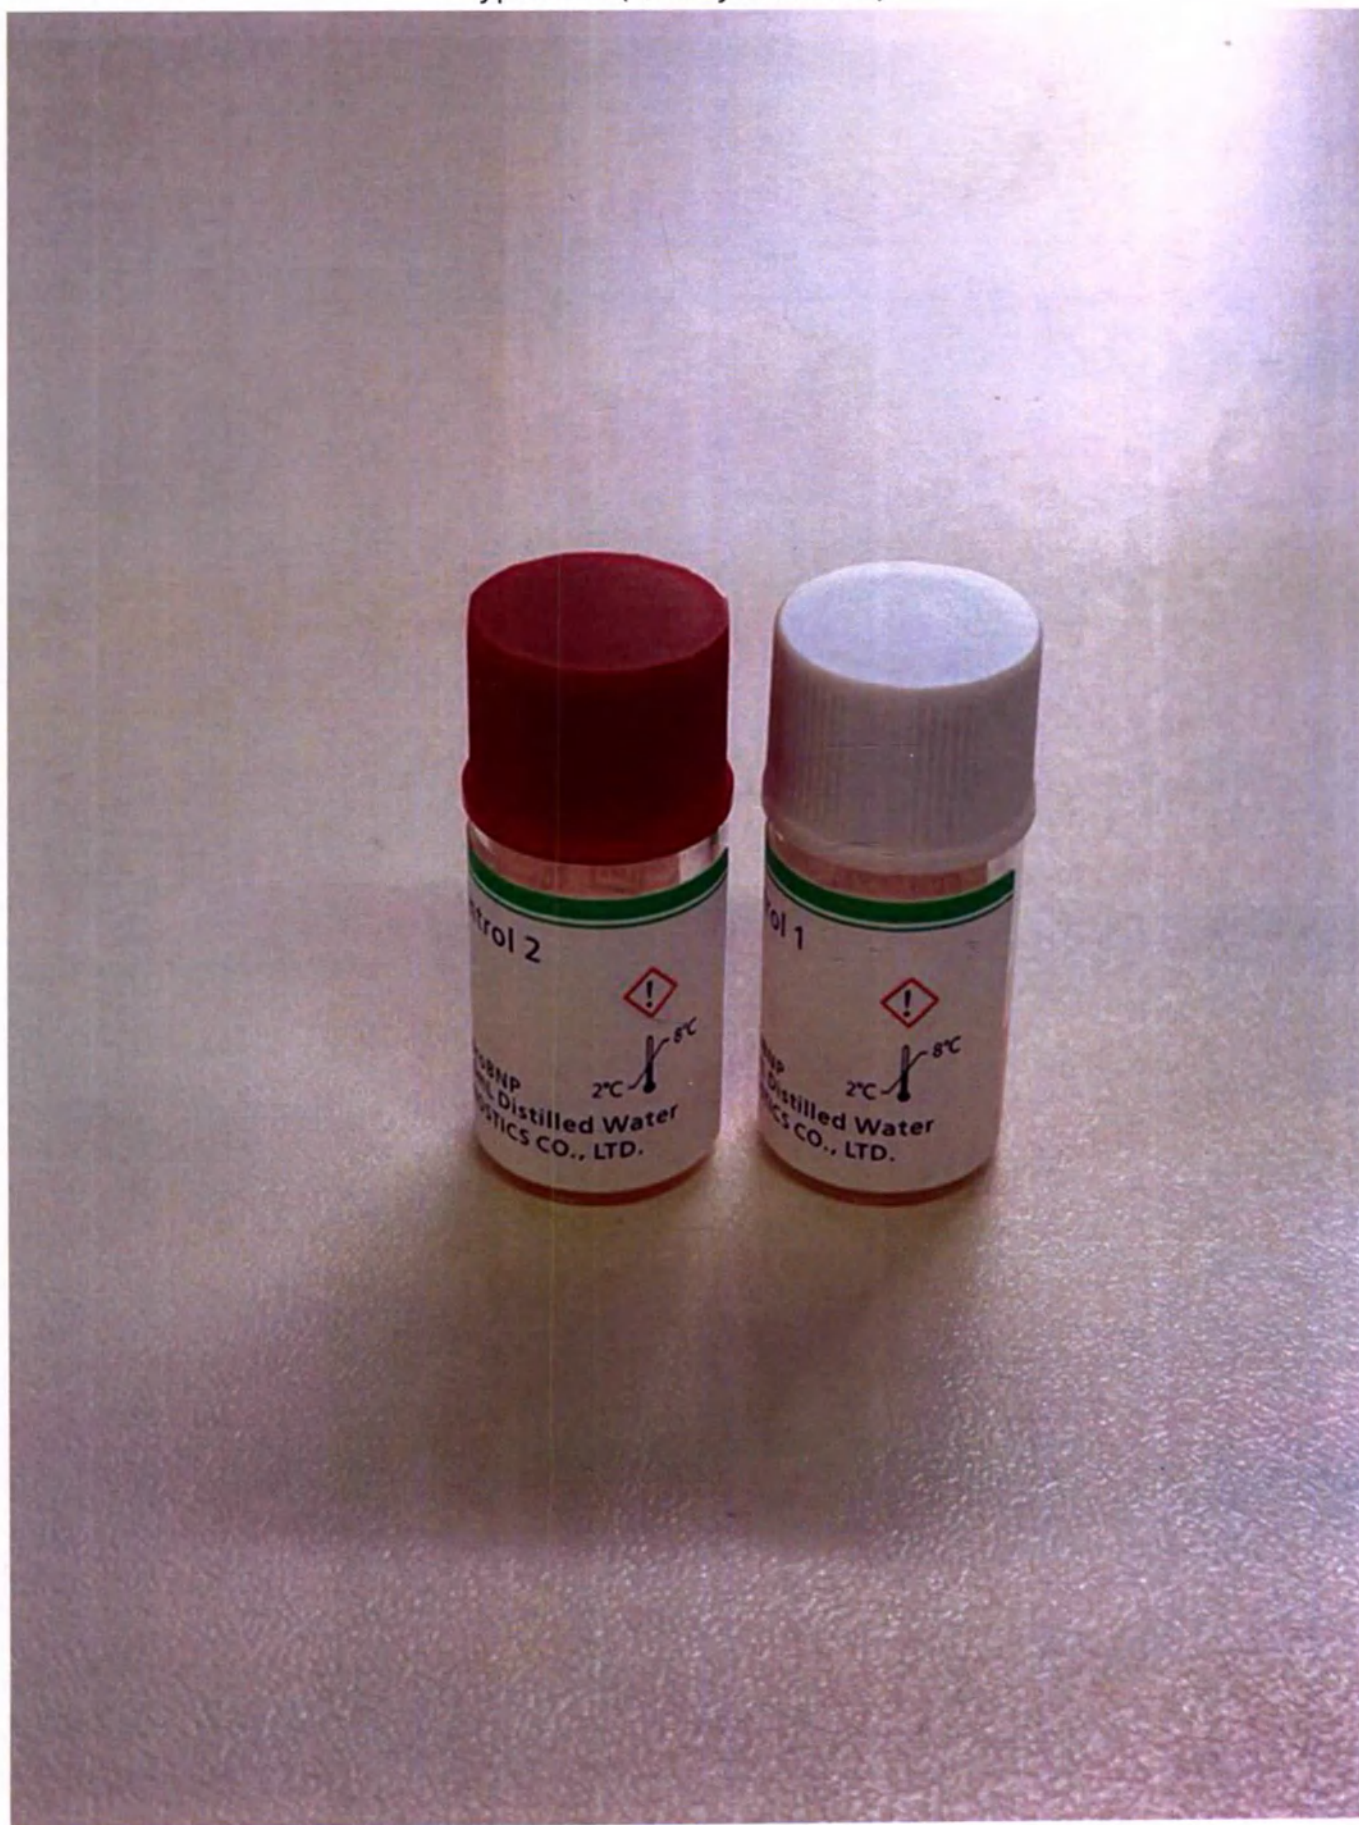

Фотографическое изображение картриджей
Вариант картриджа № 1



Фотографическое изображение картриджей
Вариант картриджа № 2

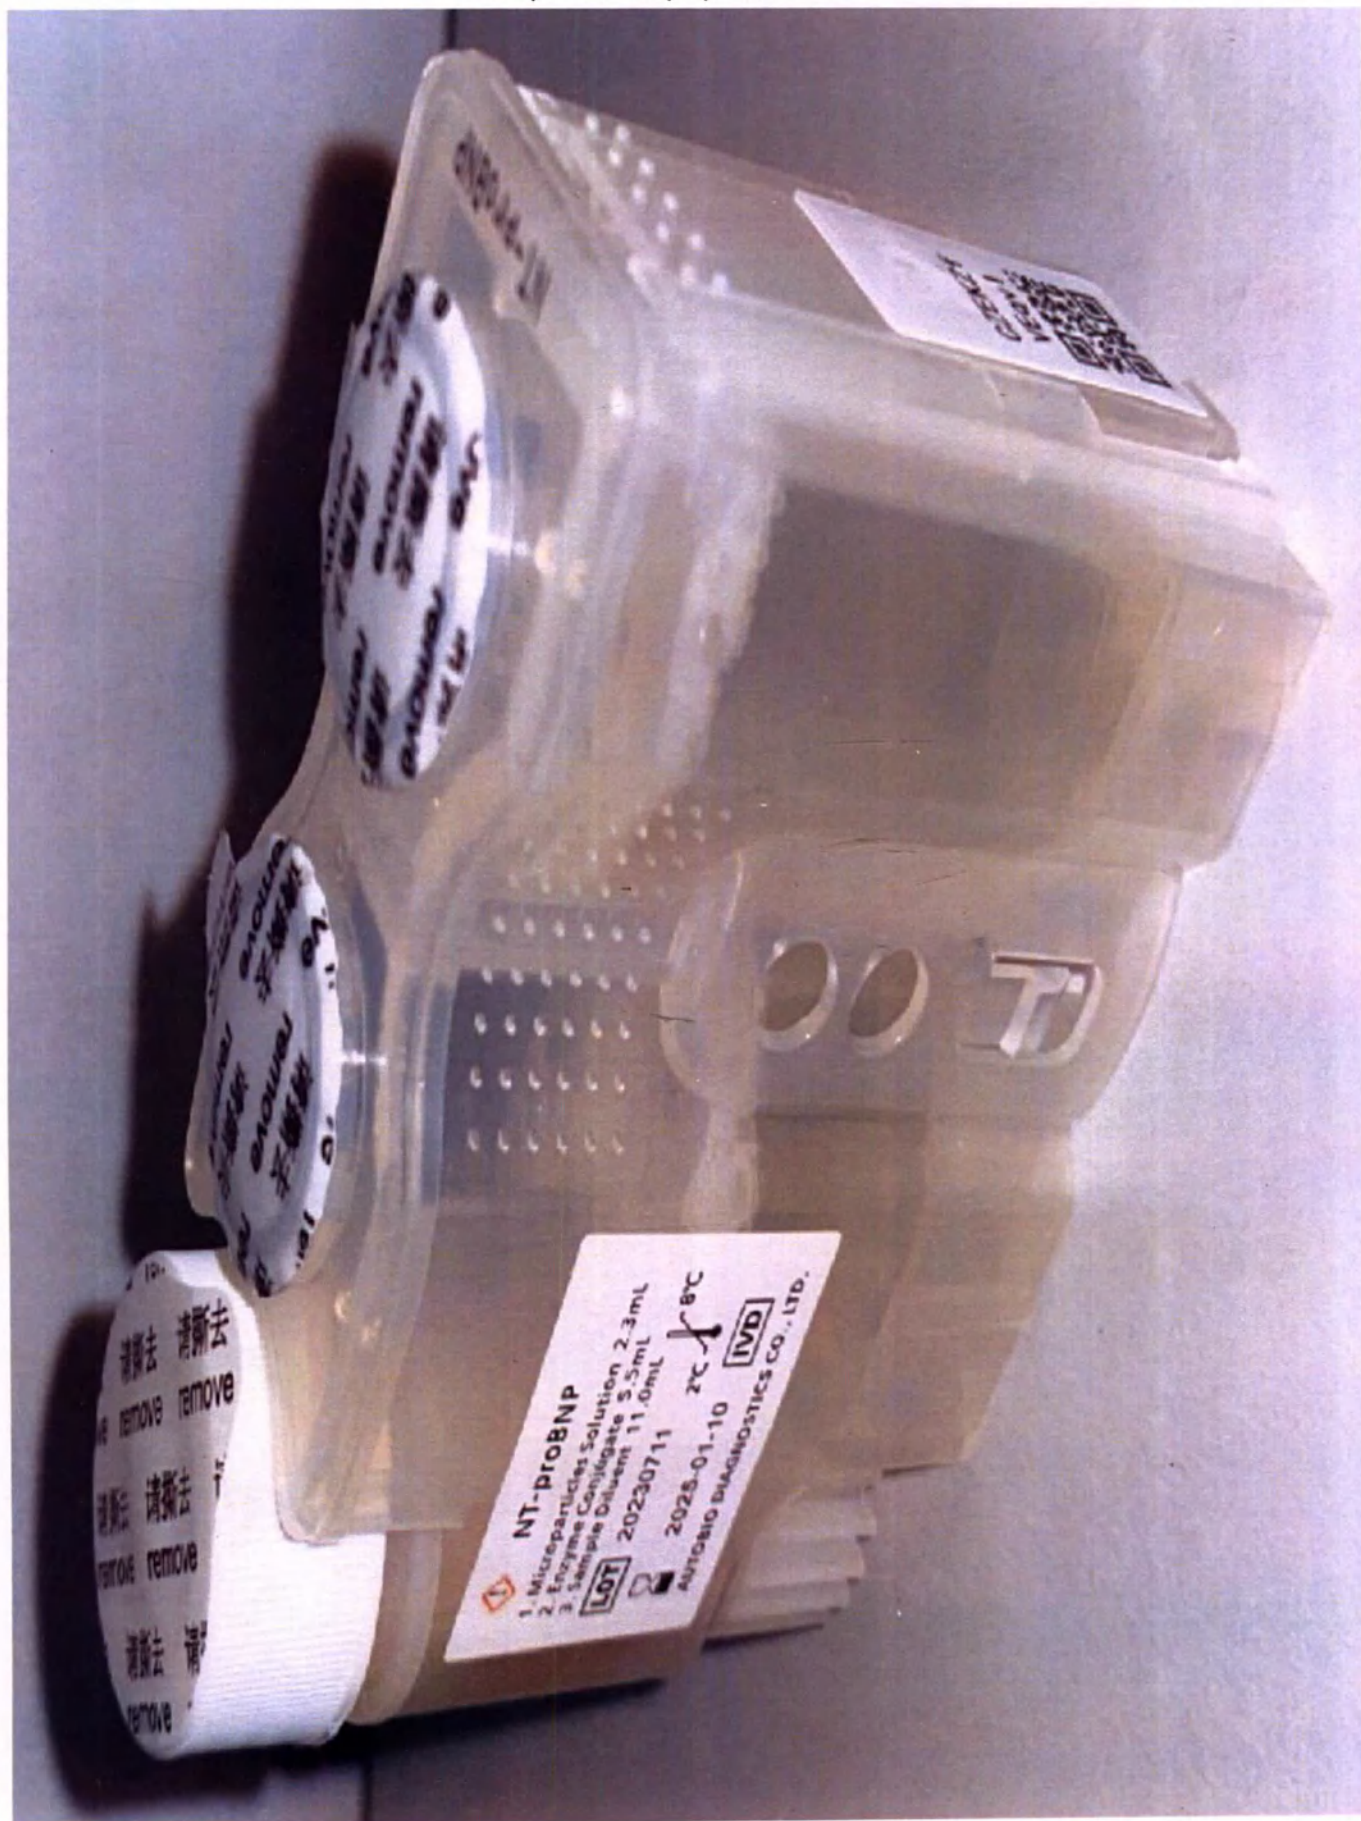

Фотографическое изображение примера транспортной упаковки медицинского изделия:



Набор реагентов для количественного определения N-концевого пропептида натрийуретического гормона (В-типа) в сыворотке и плазме крови человека (NT-proBNP CLIA Microparticles (NT-proBNP)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

NT-proBNP CLIA Microparticles

REF CMH0402

LOT



Microparticles Solution 2.3mL×1
Enzyme Conjugate 5.5mL×1
Sample Diluent 11.0mL×1

IVD

Calibrator A ×1
Calibrator B ×1
Quality Control 1 ×1
Quality Control 2 ×1



H317,H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Набор реагентов для количественного определения N-концевого пропептида натрийуретического гормона (В-типа) в сыворотке и плазме крови человека (NT-proBNP CLIA Microparticles (NT-proBNP)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

NT-proBNP CLIA Microparticles

REF CMH0405


LOT



Microparticles Solution 1.2mL×2
Enzyme Conjugate 3.0mL×2
Sample Diluent 5.5mL×2



IVD

Calibrator A ×1
Calibrator B ×1
Quality Control 1 ×1
Quality Control 2 ×1



H317,H412

For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

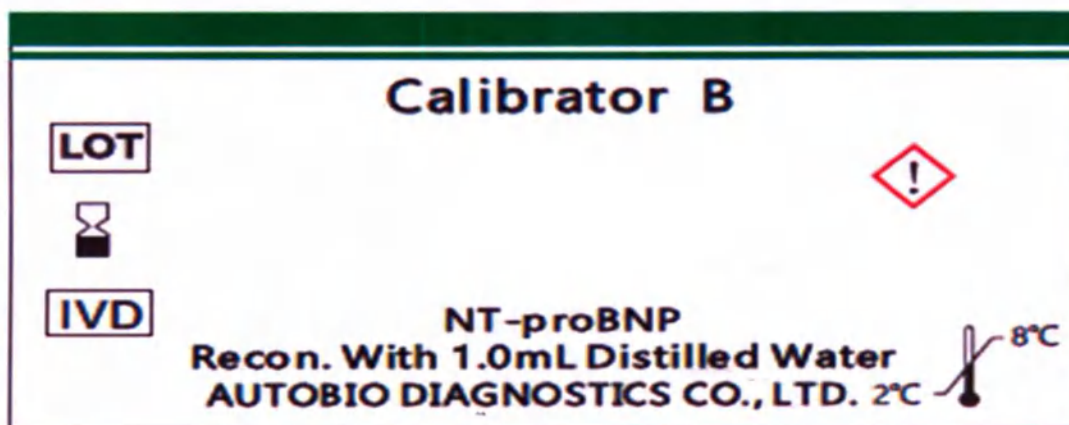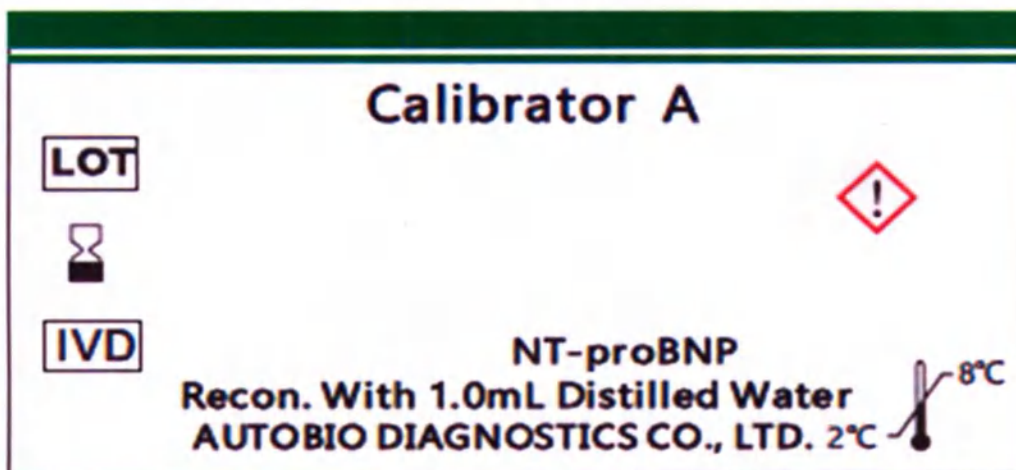



NT-proBNP

1. Microparticles Solution 1.2mL
2. Enzyme Conjugate 3.0mL
3. Sample Diluent 5.5mL

LOT





IVD

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.




NT-proBNP

1. Microparticles Solution 2.3mL
2. Enzyme Conjugate 5.5mL
3. Sample Diluent 11.0mL

LOT





IVD

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

(двадцати)

листах

