

ПОДТВЕРЖДАЮ



Директор по развитию
ООО «АМК»

Н.Н. Перцева


«11» сентября 2024

Фотографические изображения медицинского изделия

Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный AutoLumo A1860 с принадлежностями



1.Блок анализатора автоматического иммунохемилюминесцентного AutoLumo A1860

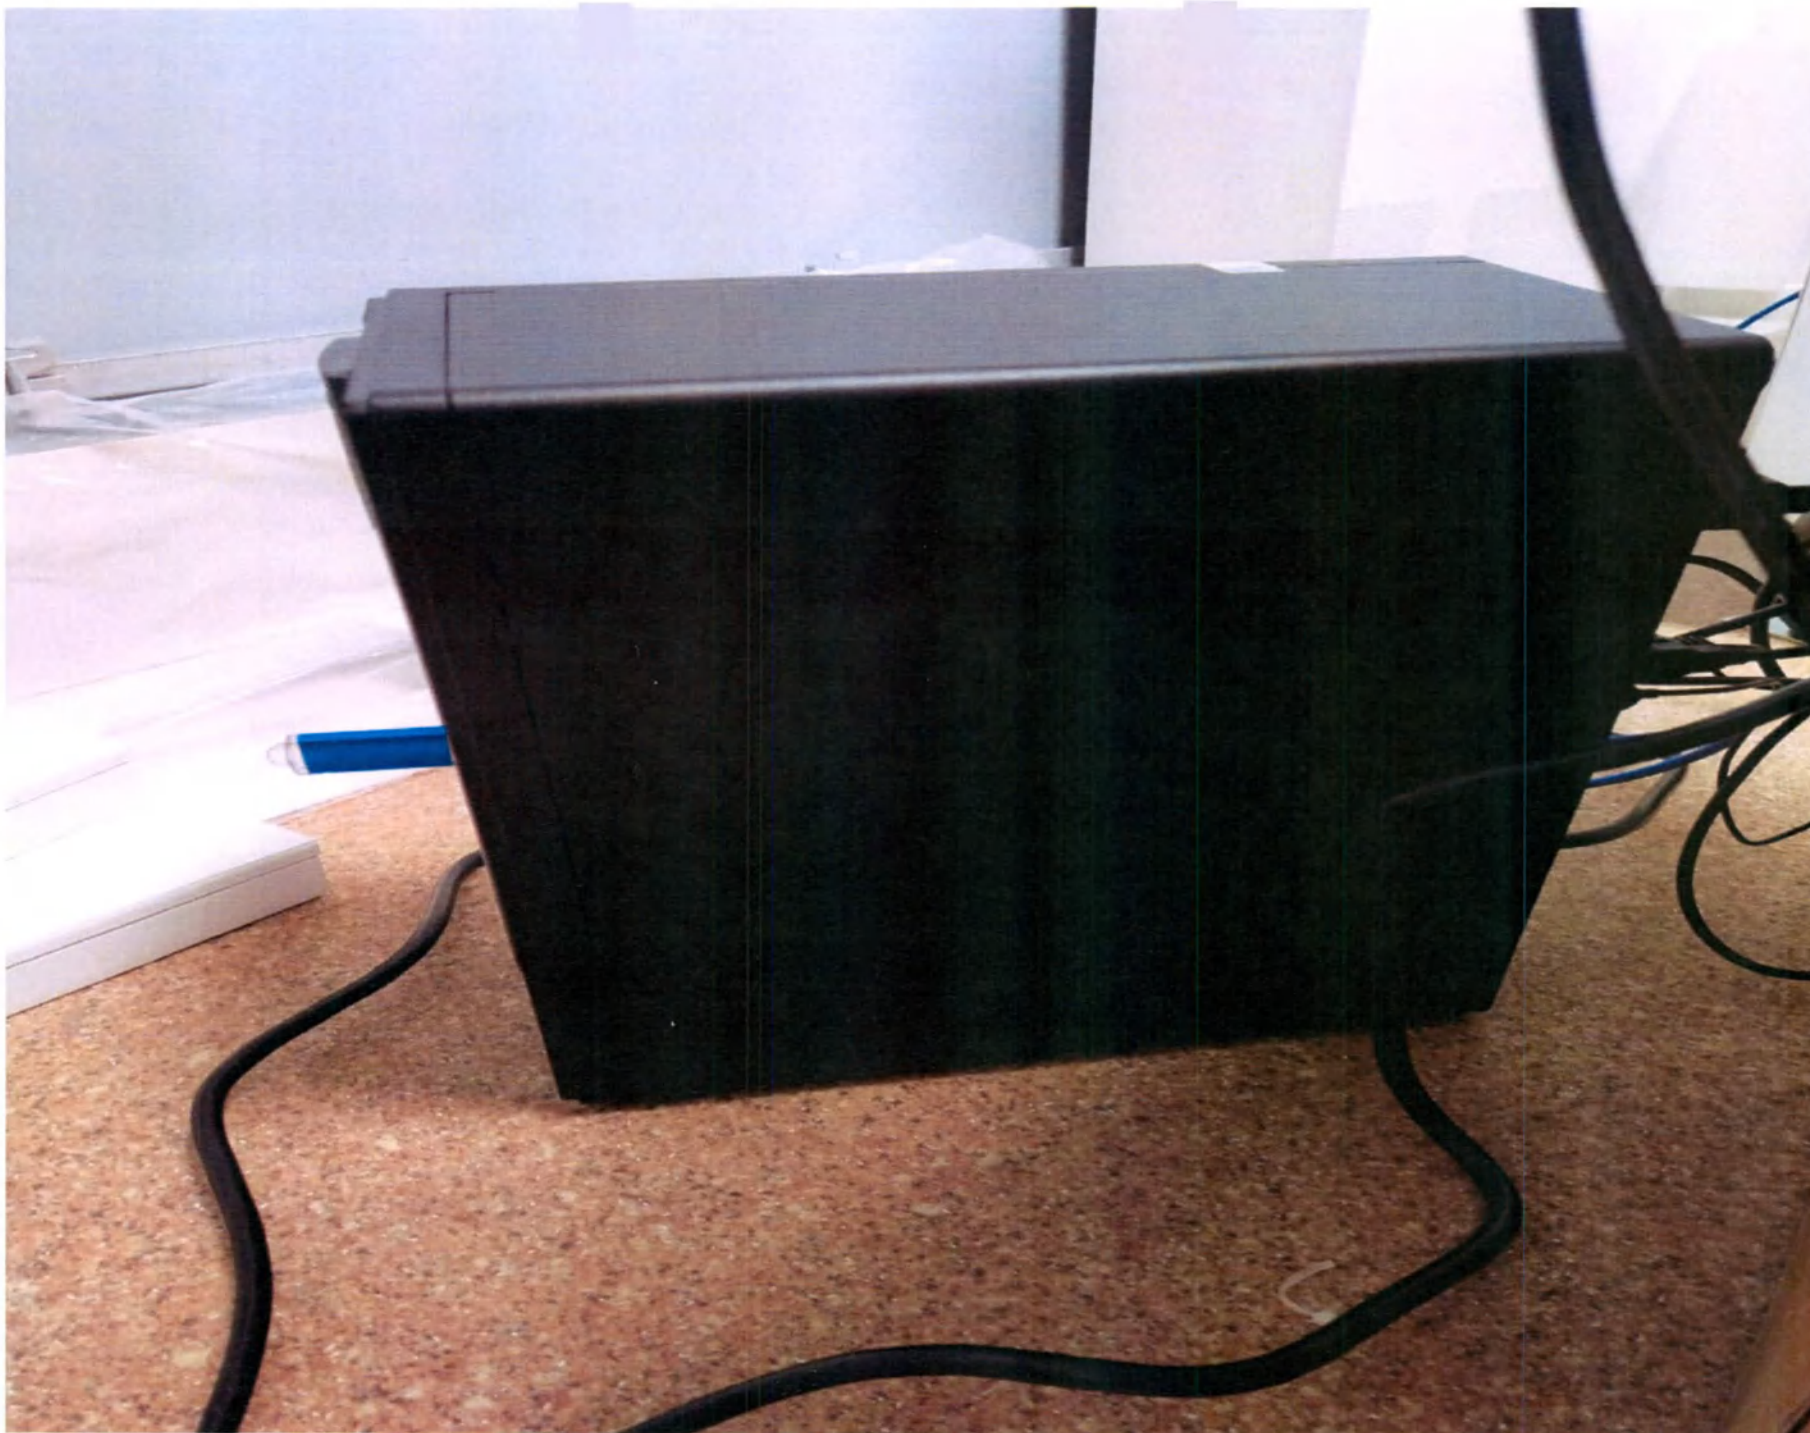


2.Блок управления и обработки данных (при необходимости)




3.Монитор (при необходимости)



4.Клавиатура (при необходимости)

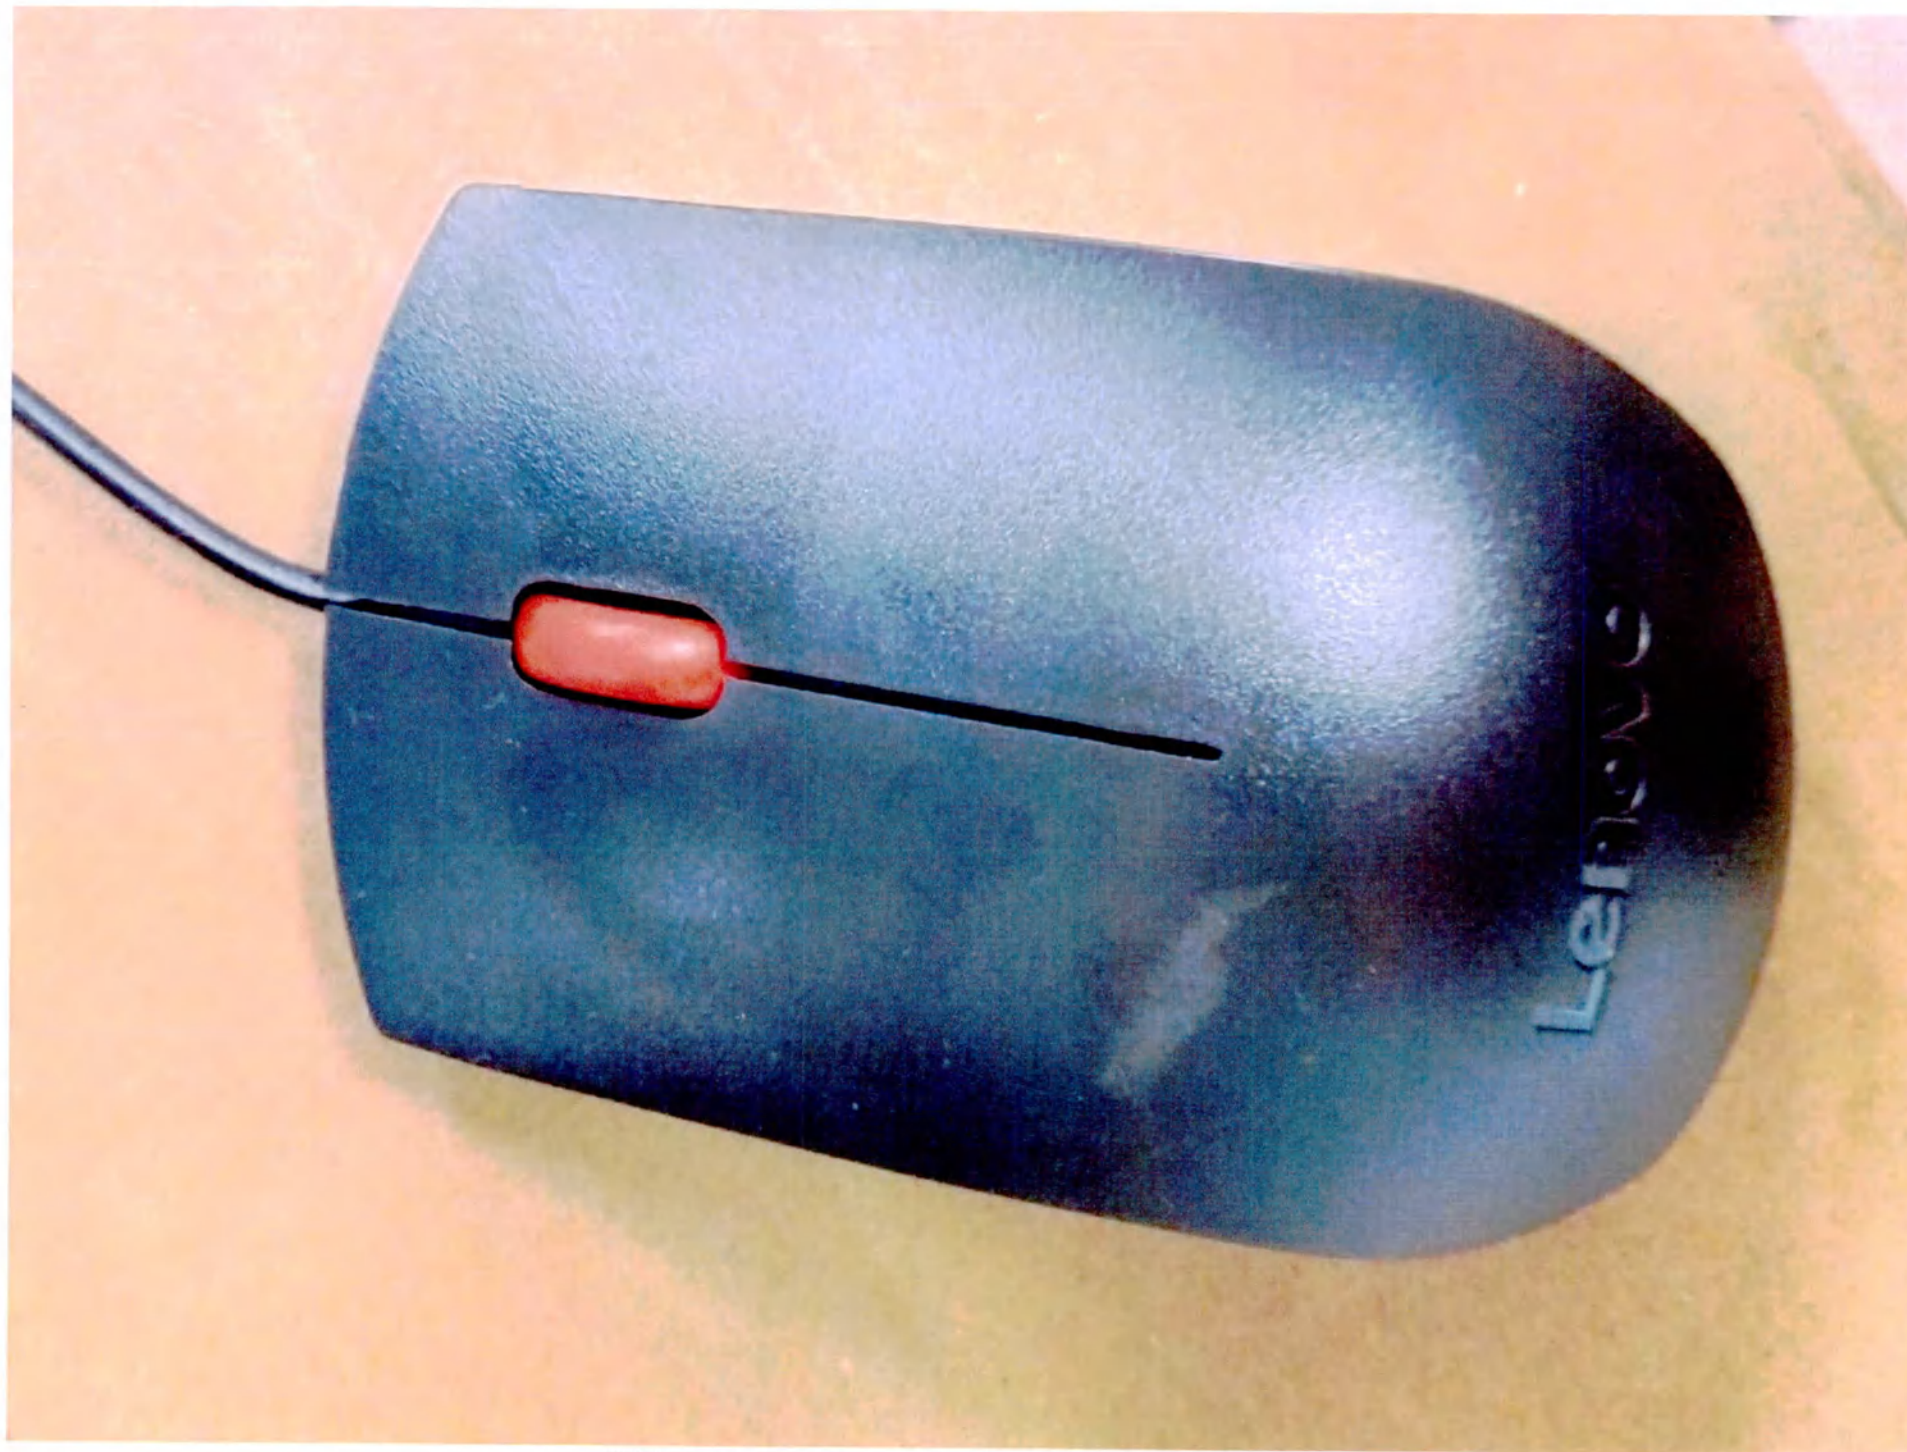

5.Мышь компьютерная (при необходимости)

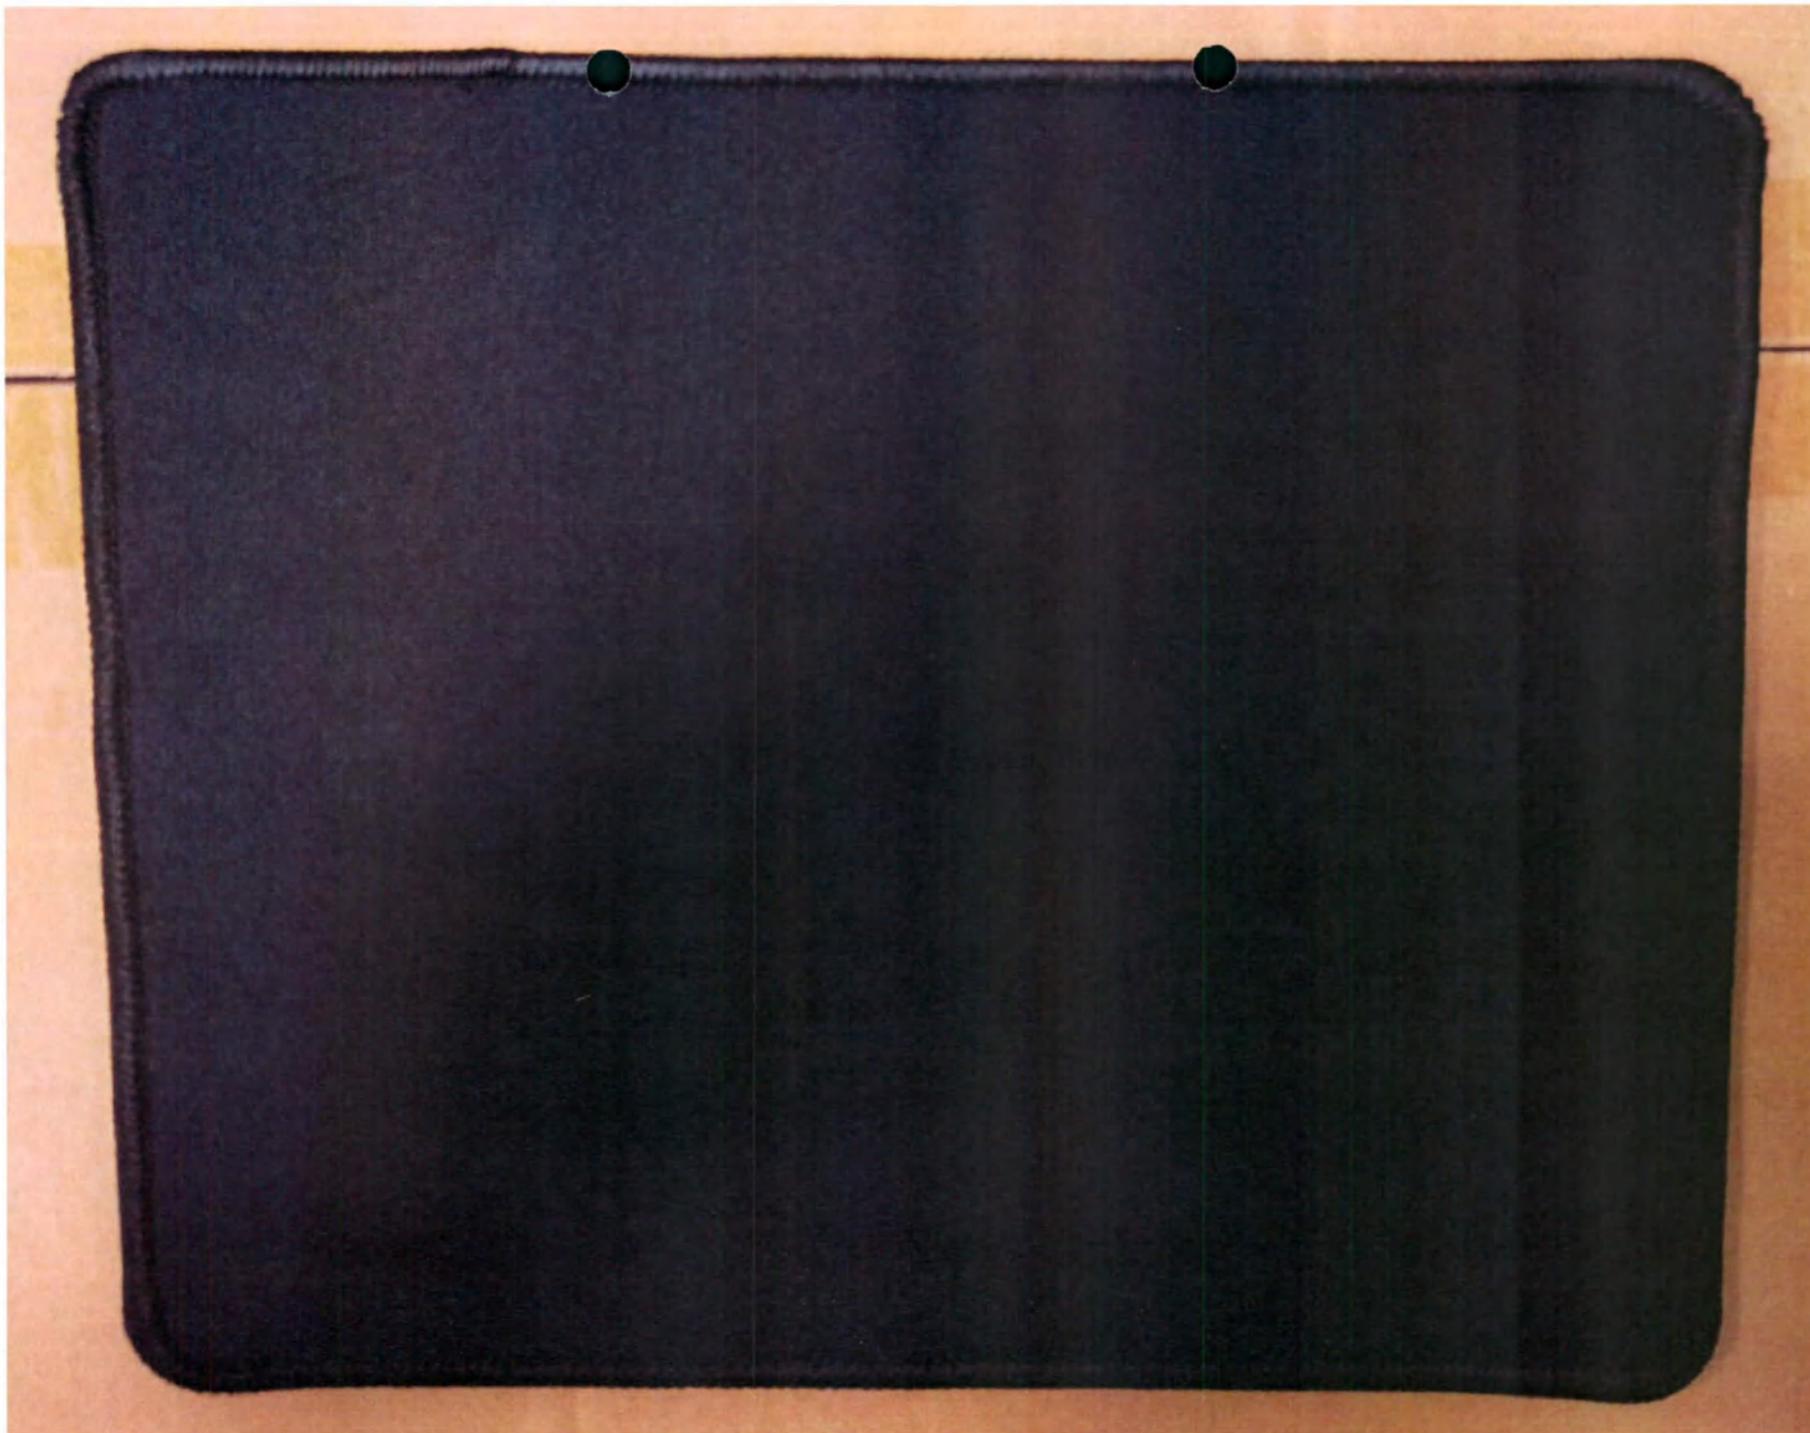


6.Коврик для мыши компьютерной (при необходимости)




7.Чашечки для образцов, 100 шт./уп.




8. Чашечки для образцов, 500 шт./уп. (при необходимости)

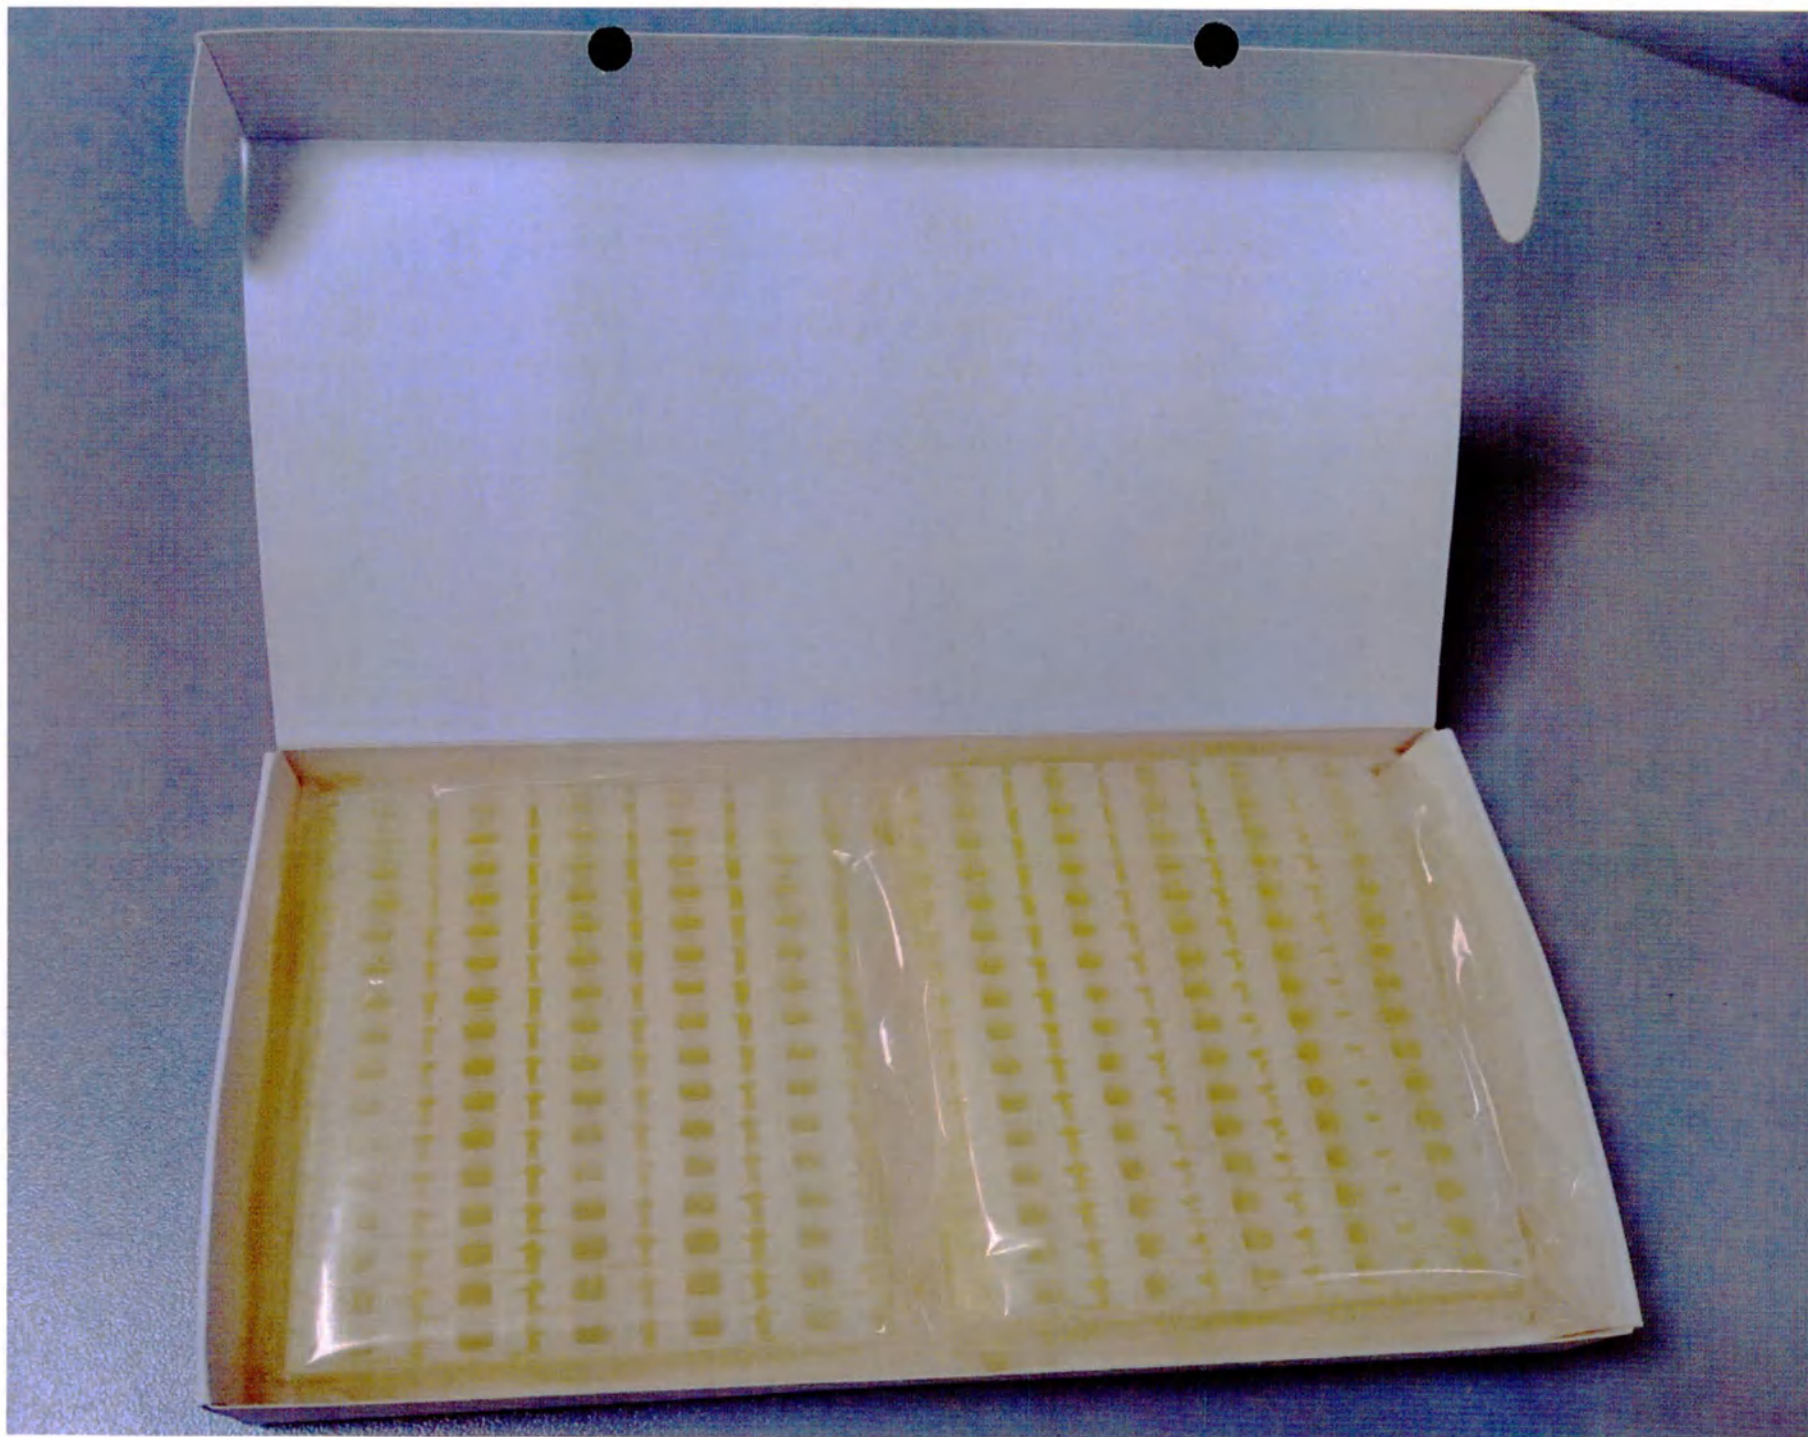

9.Реакционные кюветы, 160 шт./уп.

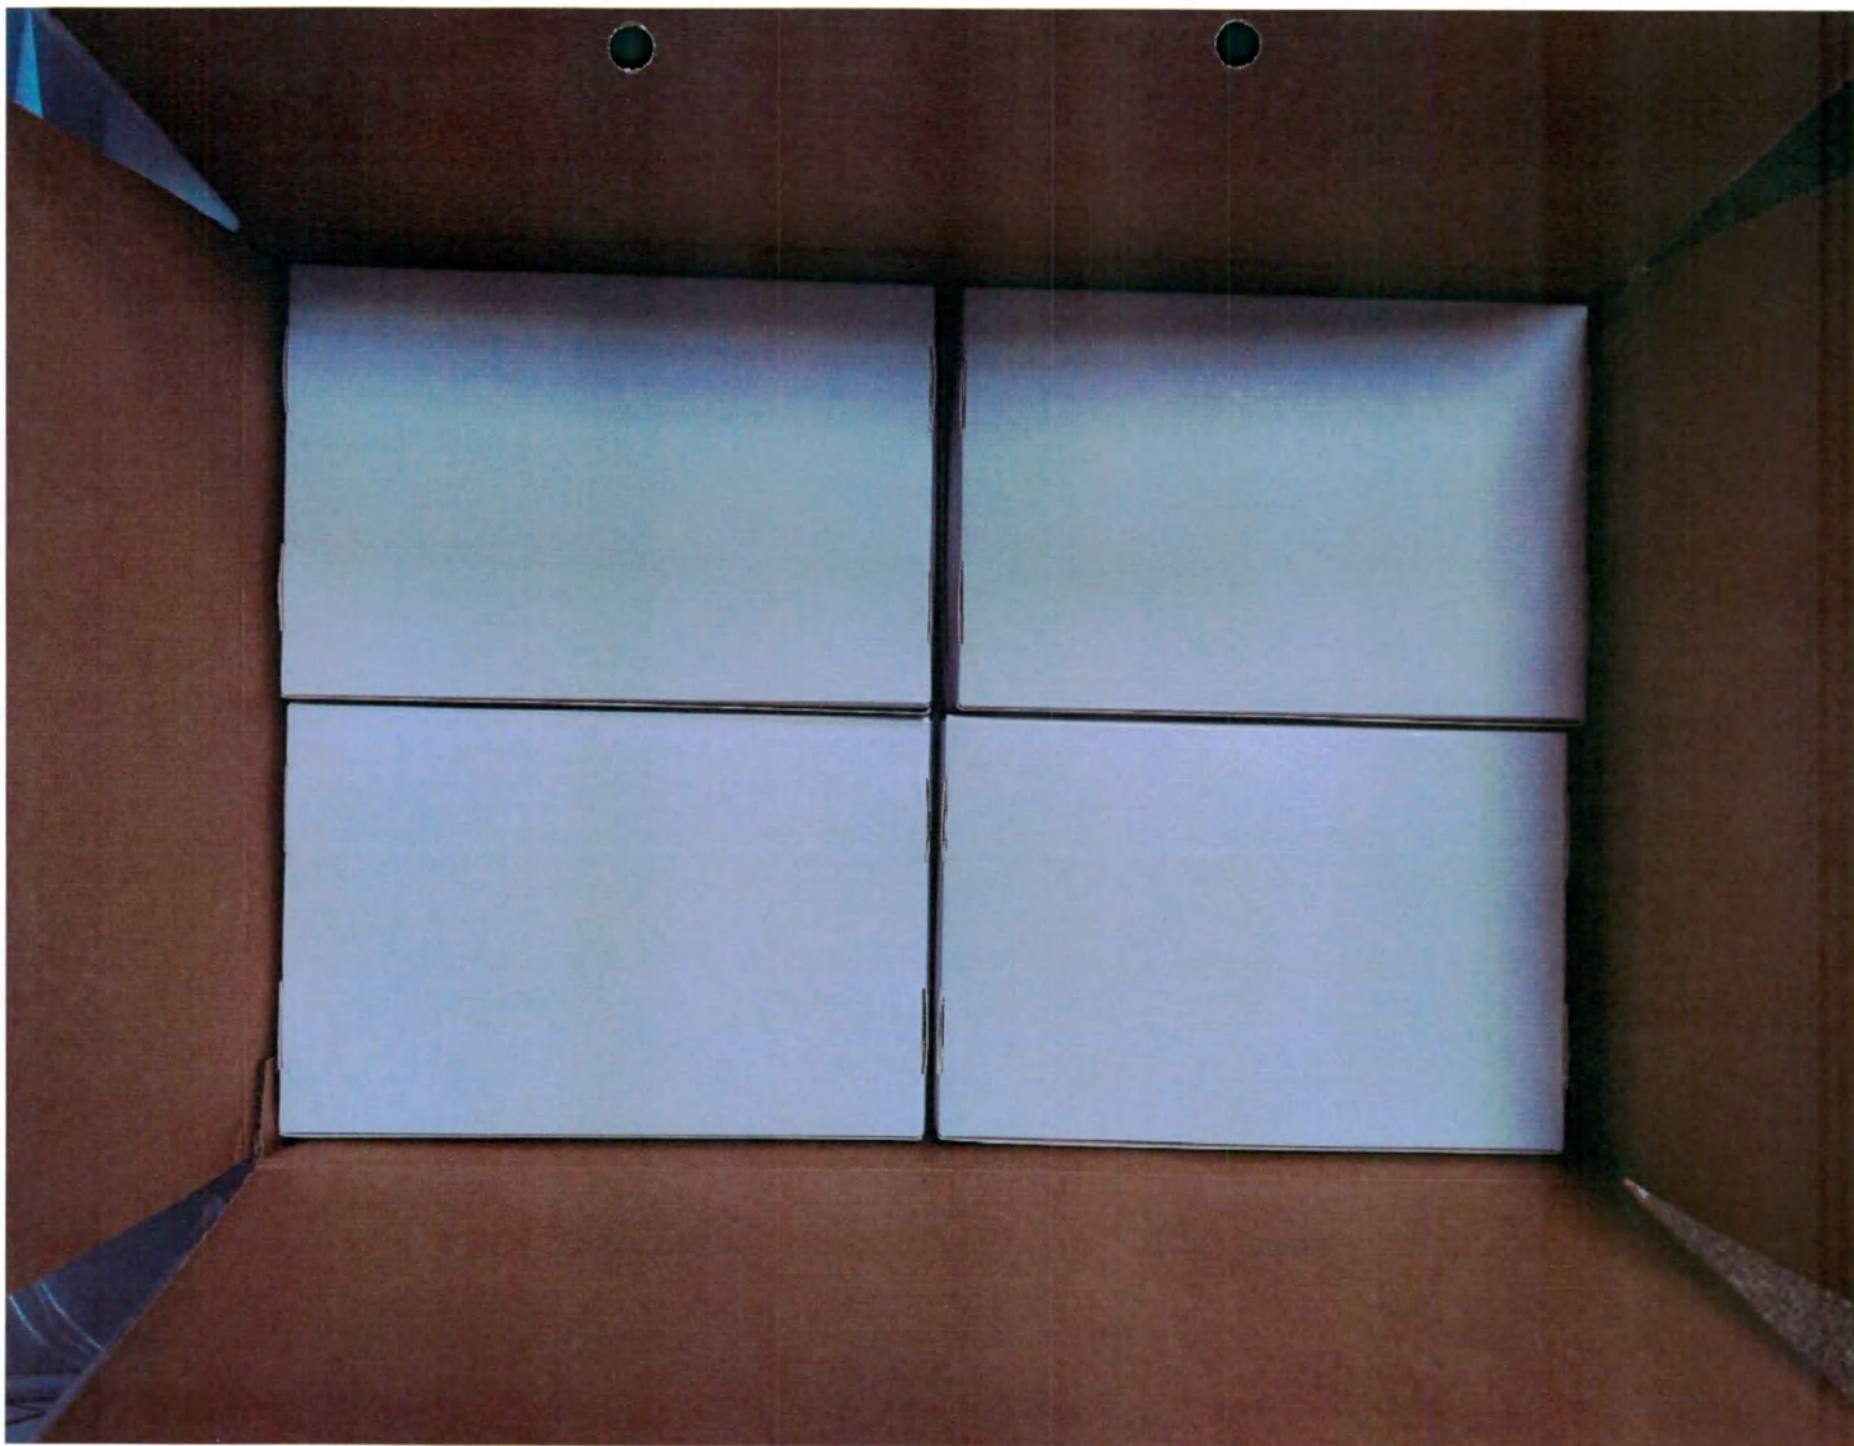

10.Реакционные кюветы, 160 шт./кор., 24 кор./уп. (при необходимости)

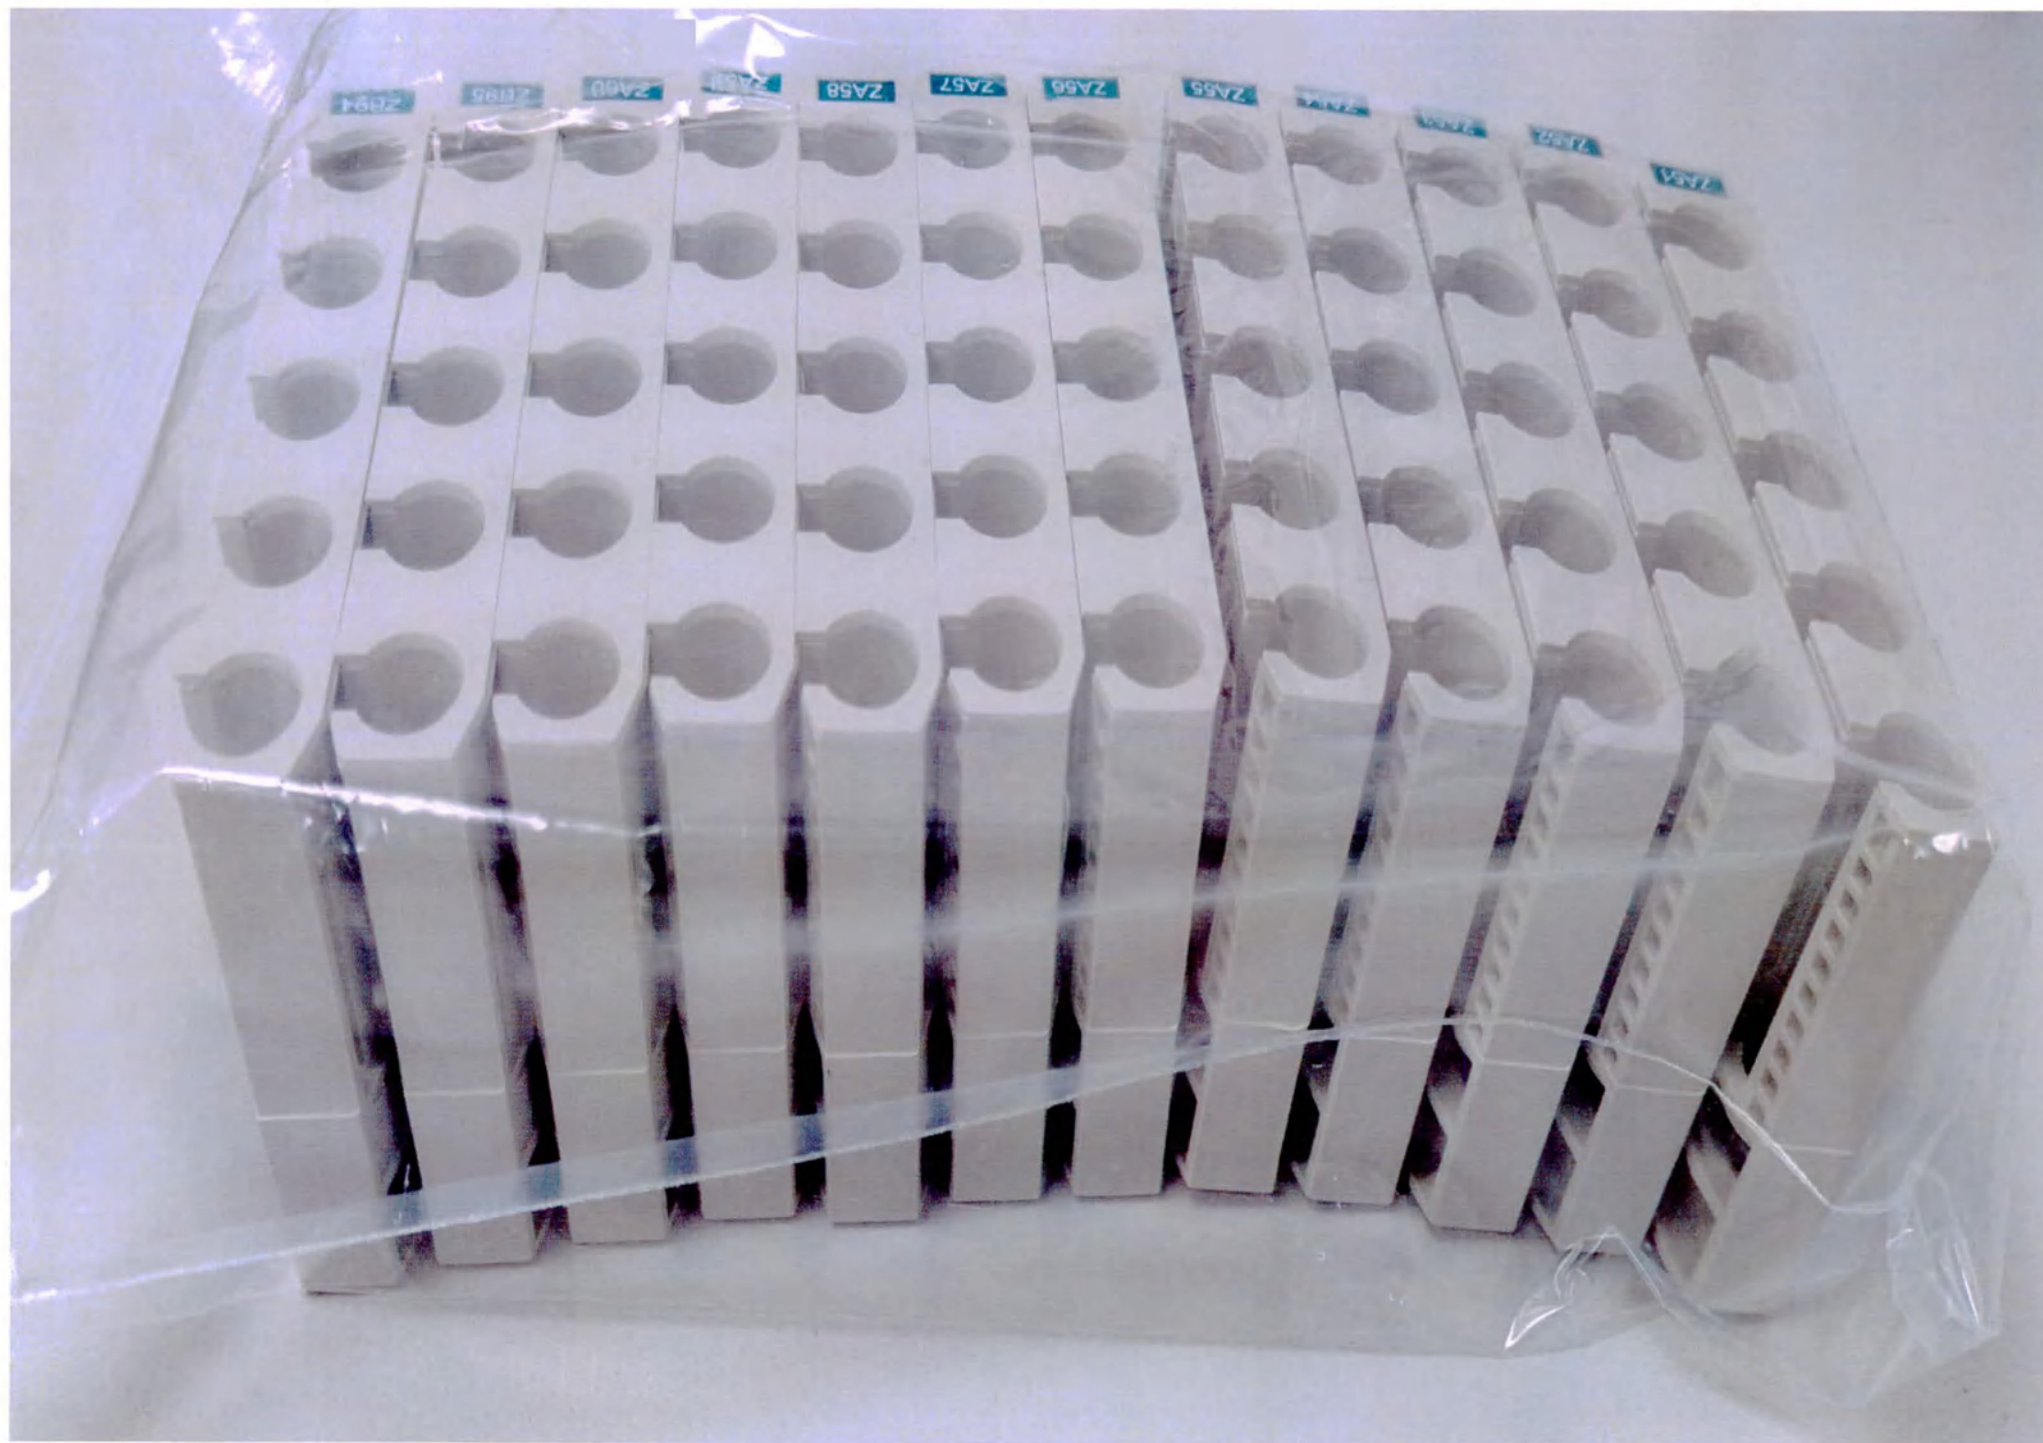

11.Штативы 13 мм для образцов (при необходимости)



12.Штативы 16 мм для образцов (при необходимости)




13. Контейнер для твердых отходов



14.Сканер штрих-кодов (Newland, модель NLS-HR21)




14.1 Сканер штрих-кодов (Newland, модель NLS-HR21) (маркировка)

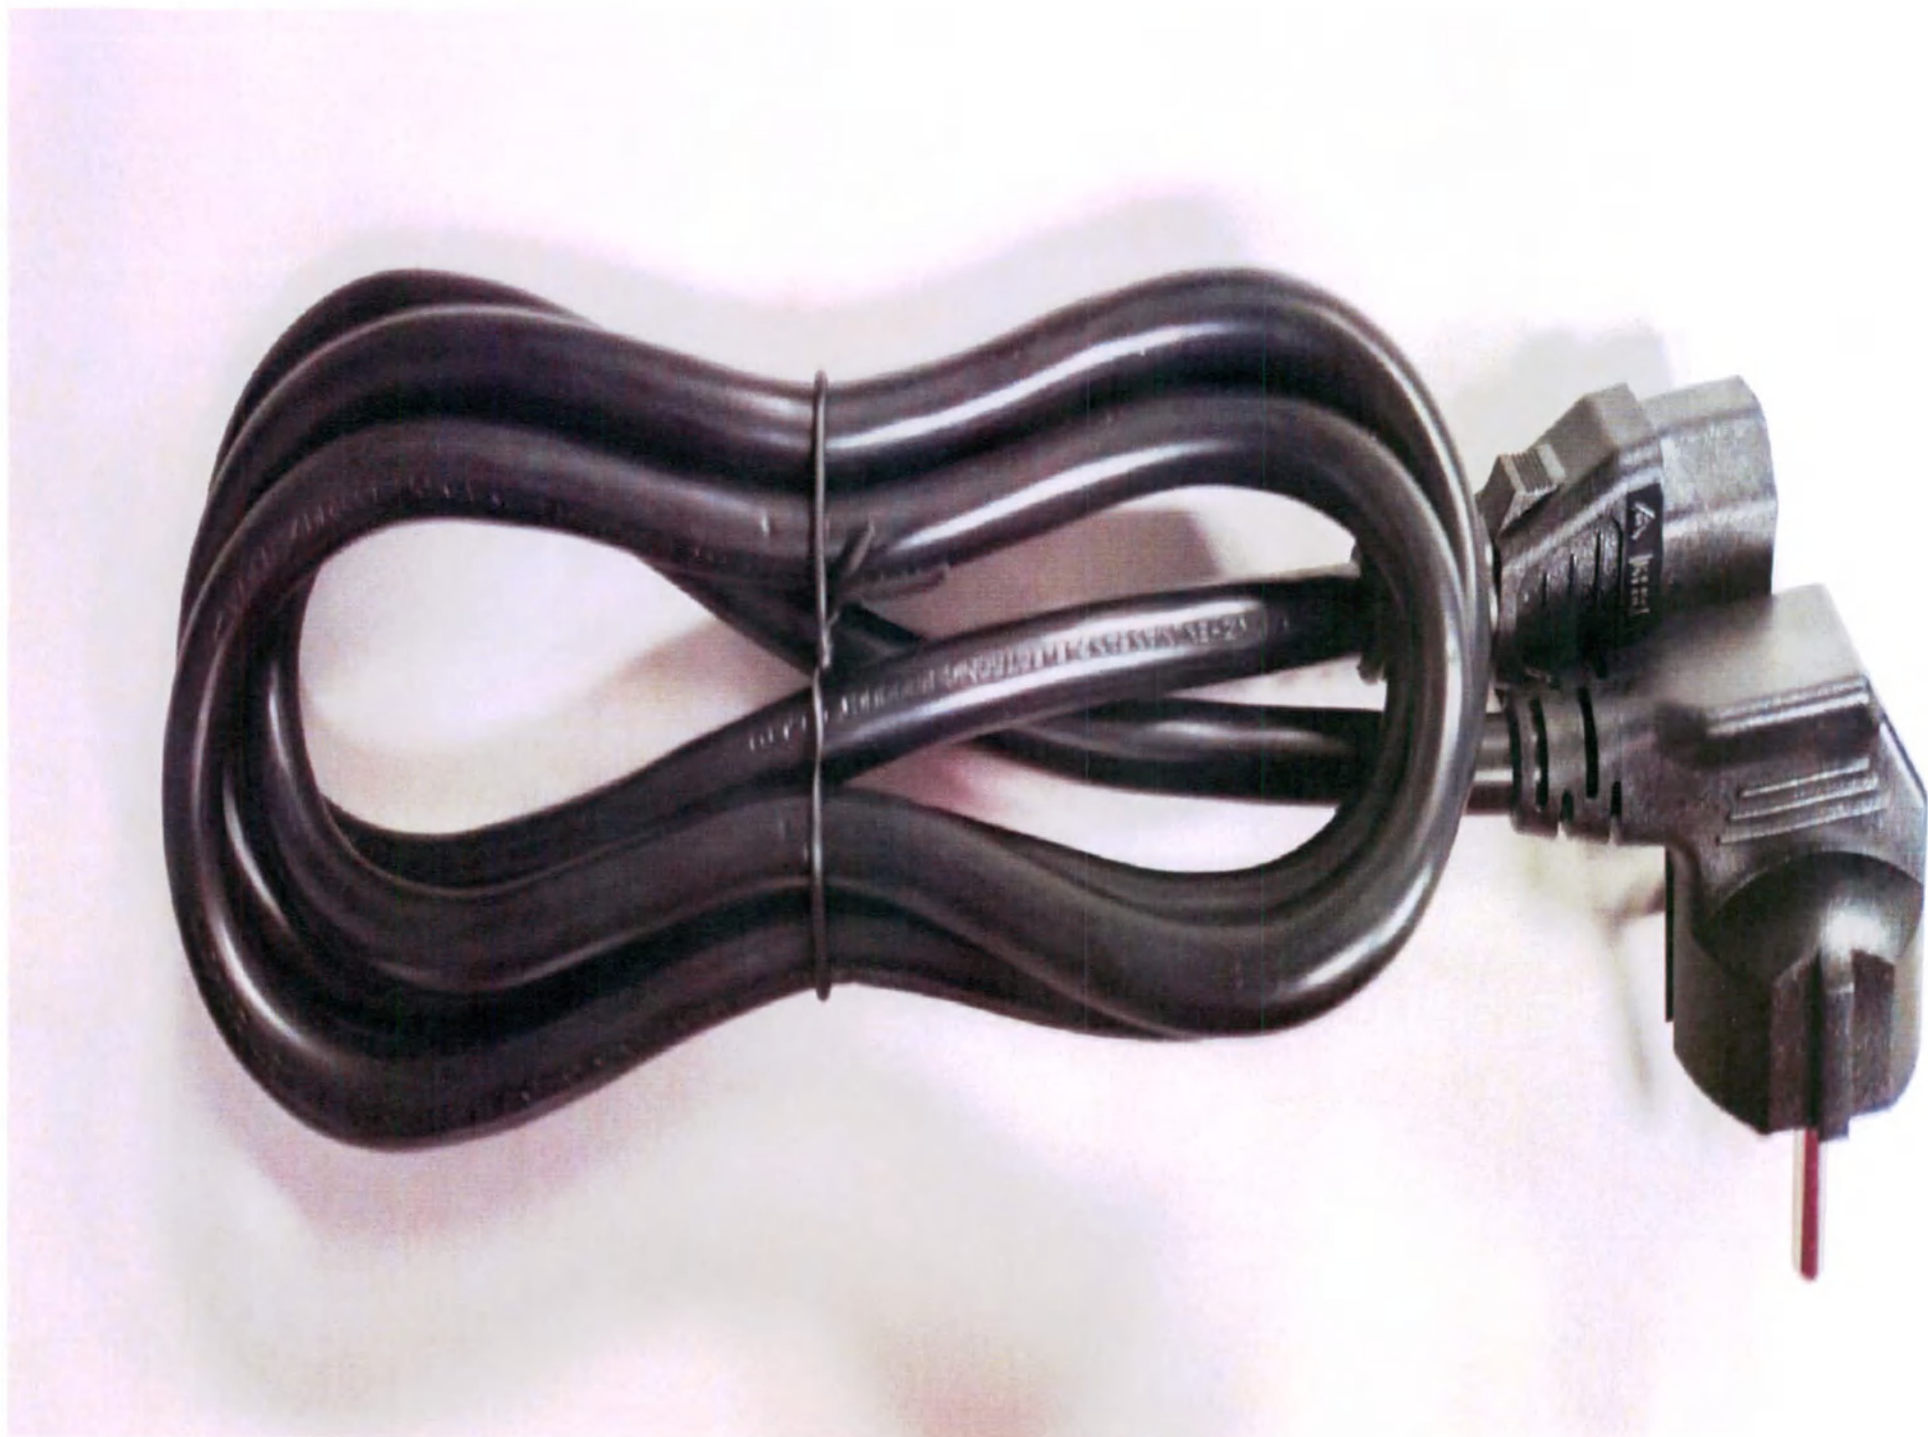

15.Кабель питания




16.Кабель передачи данных

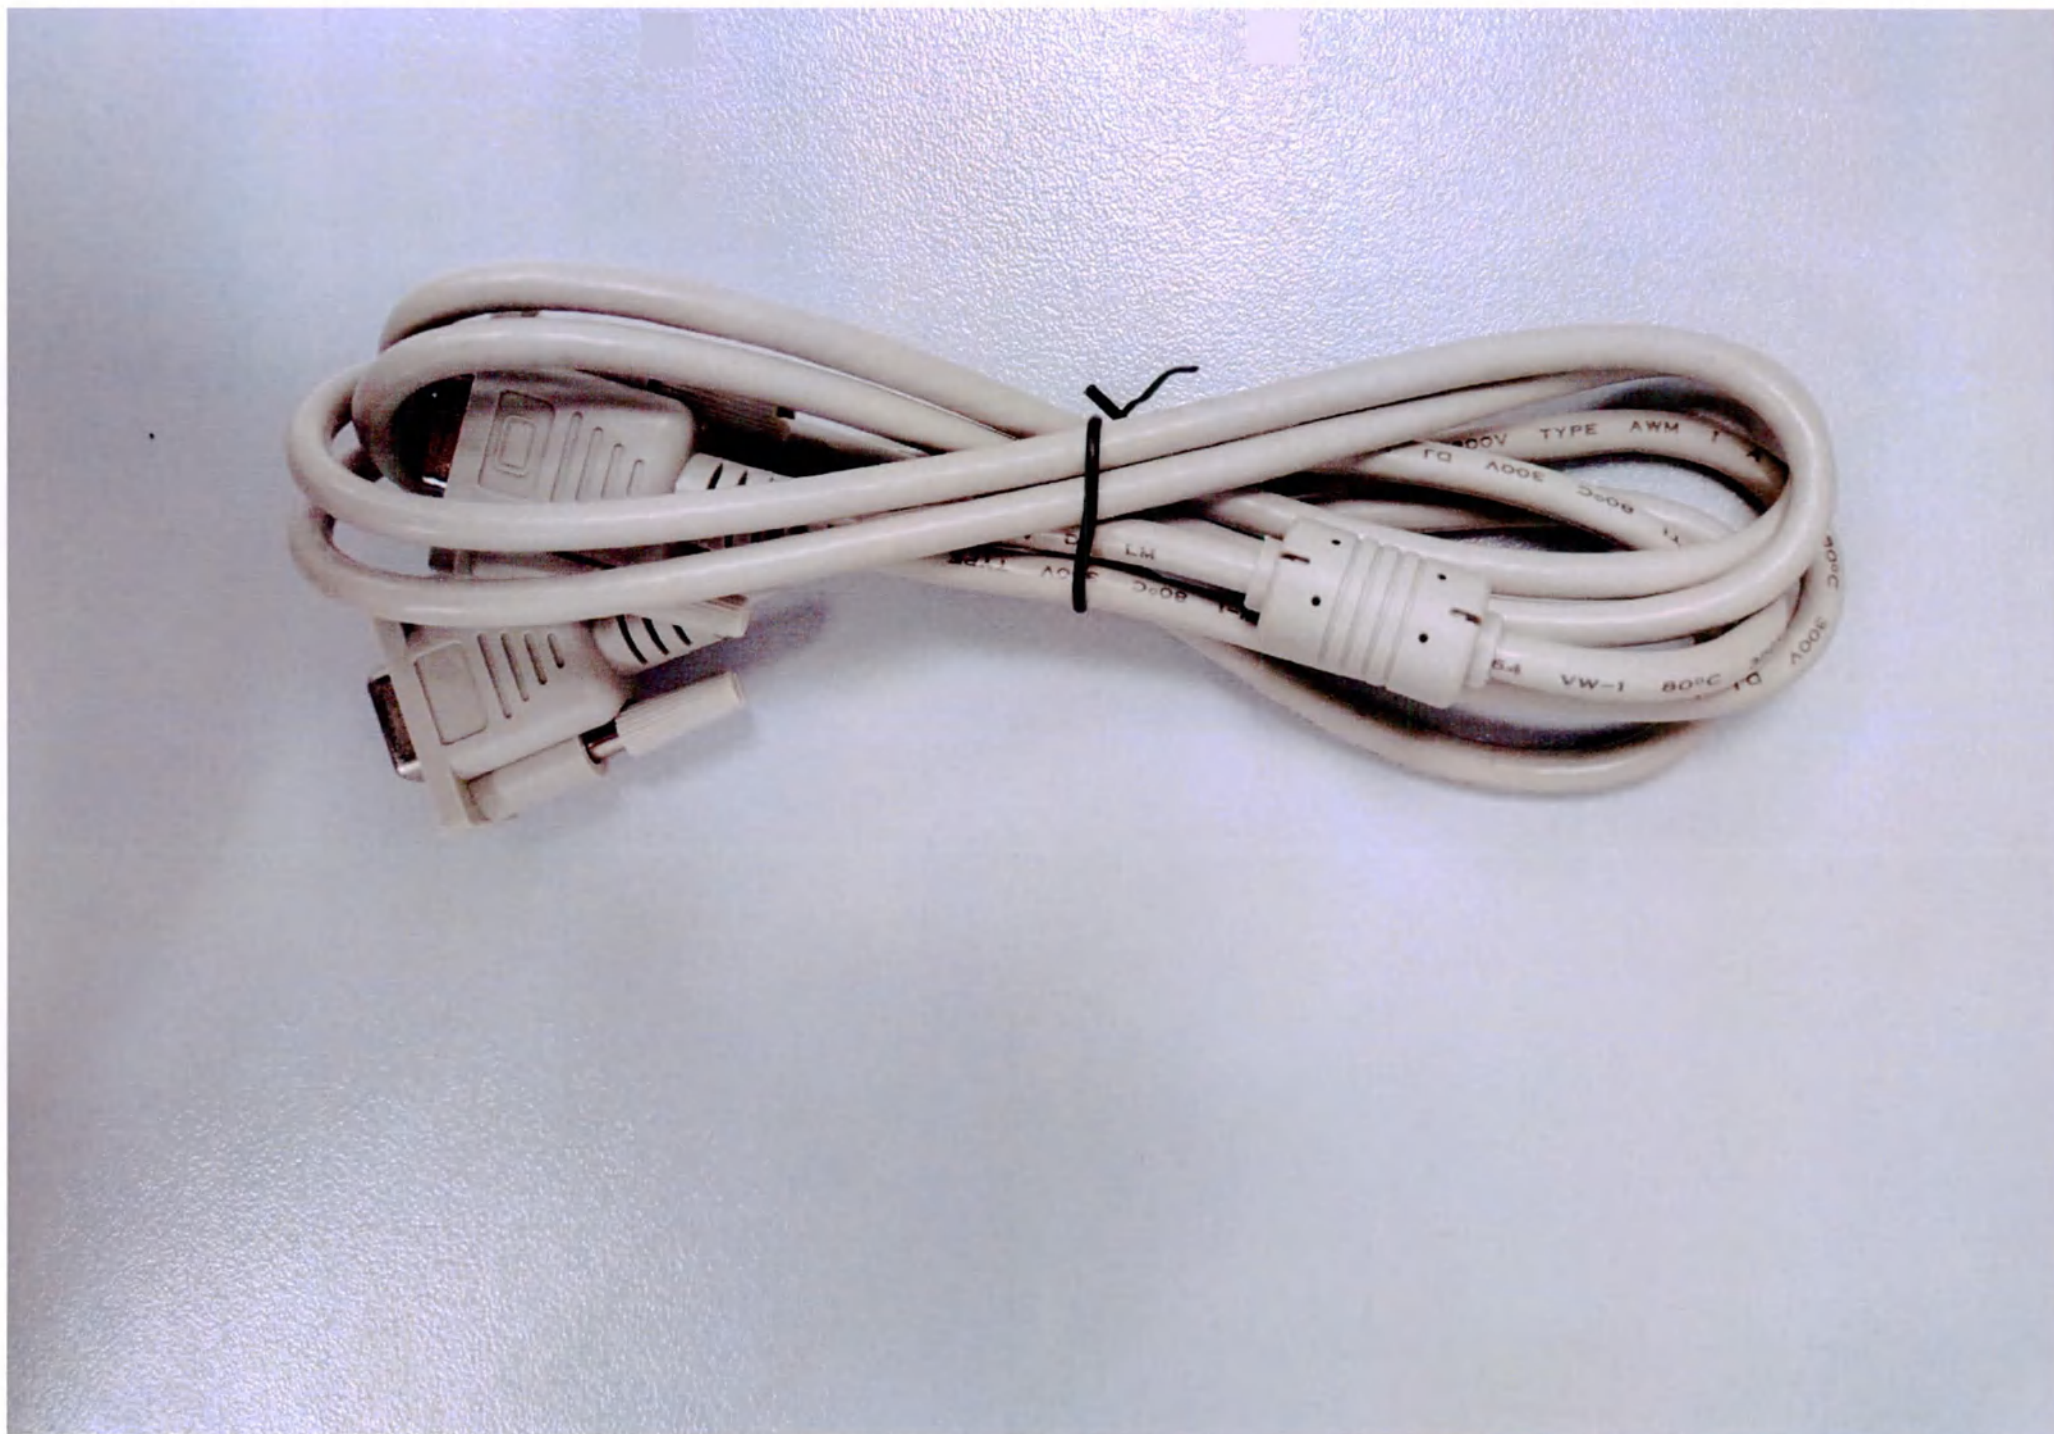


17.Кабель RS-232



18.Руководство по эксплуатации

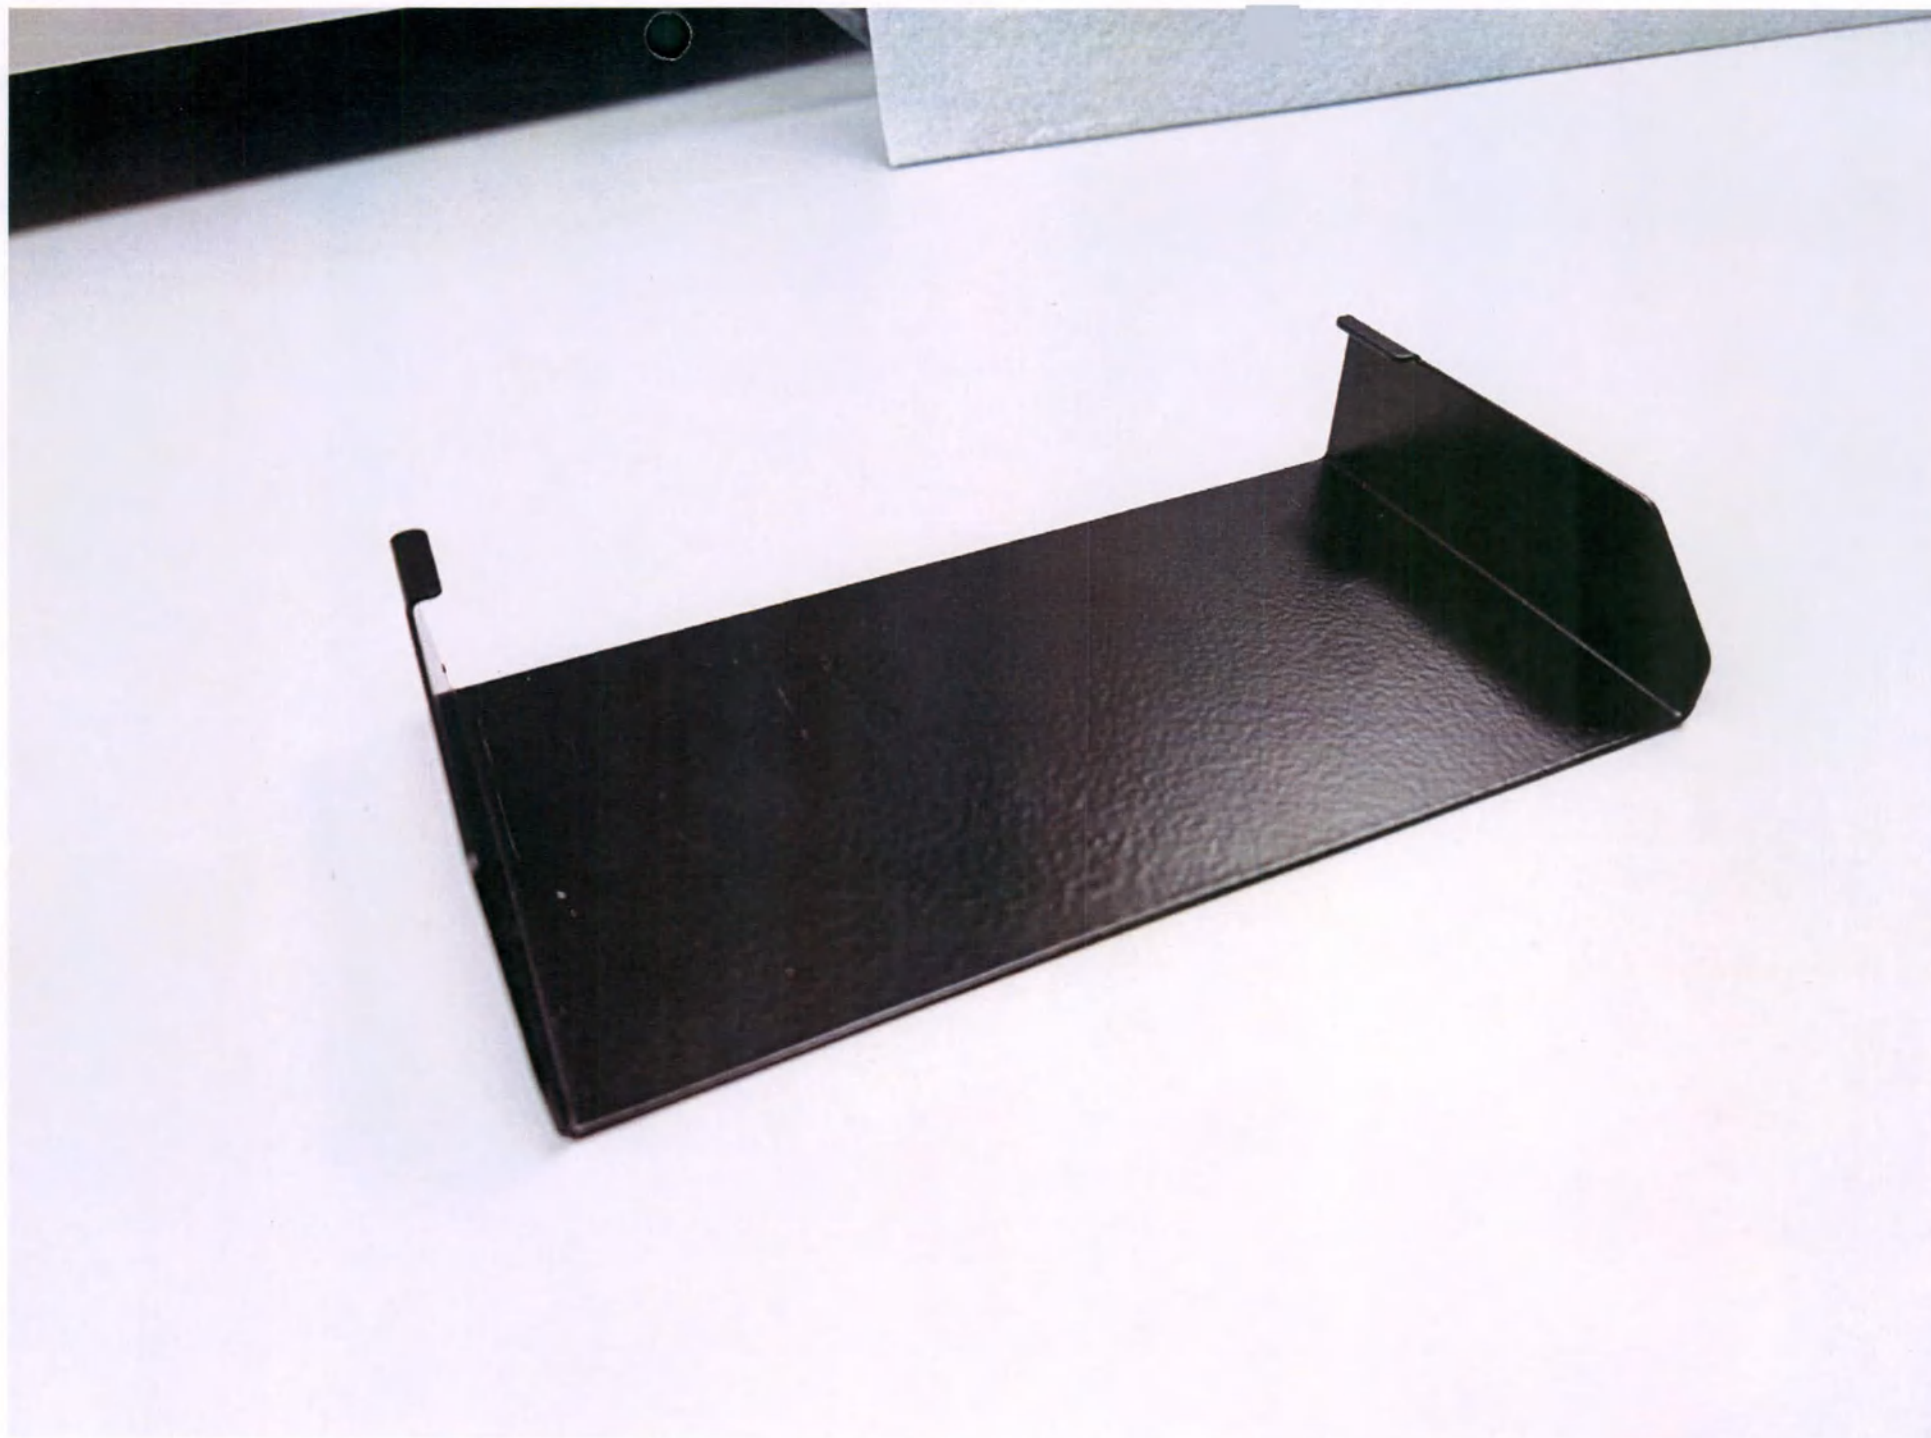


19. Удлинительная стойка для контейнера для твердых отходов

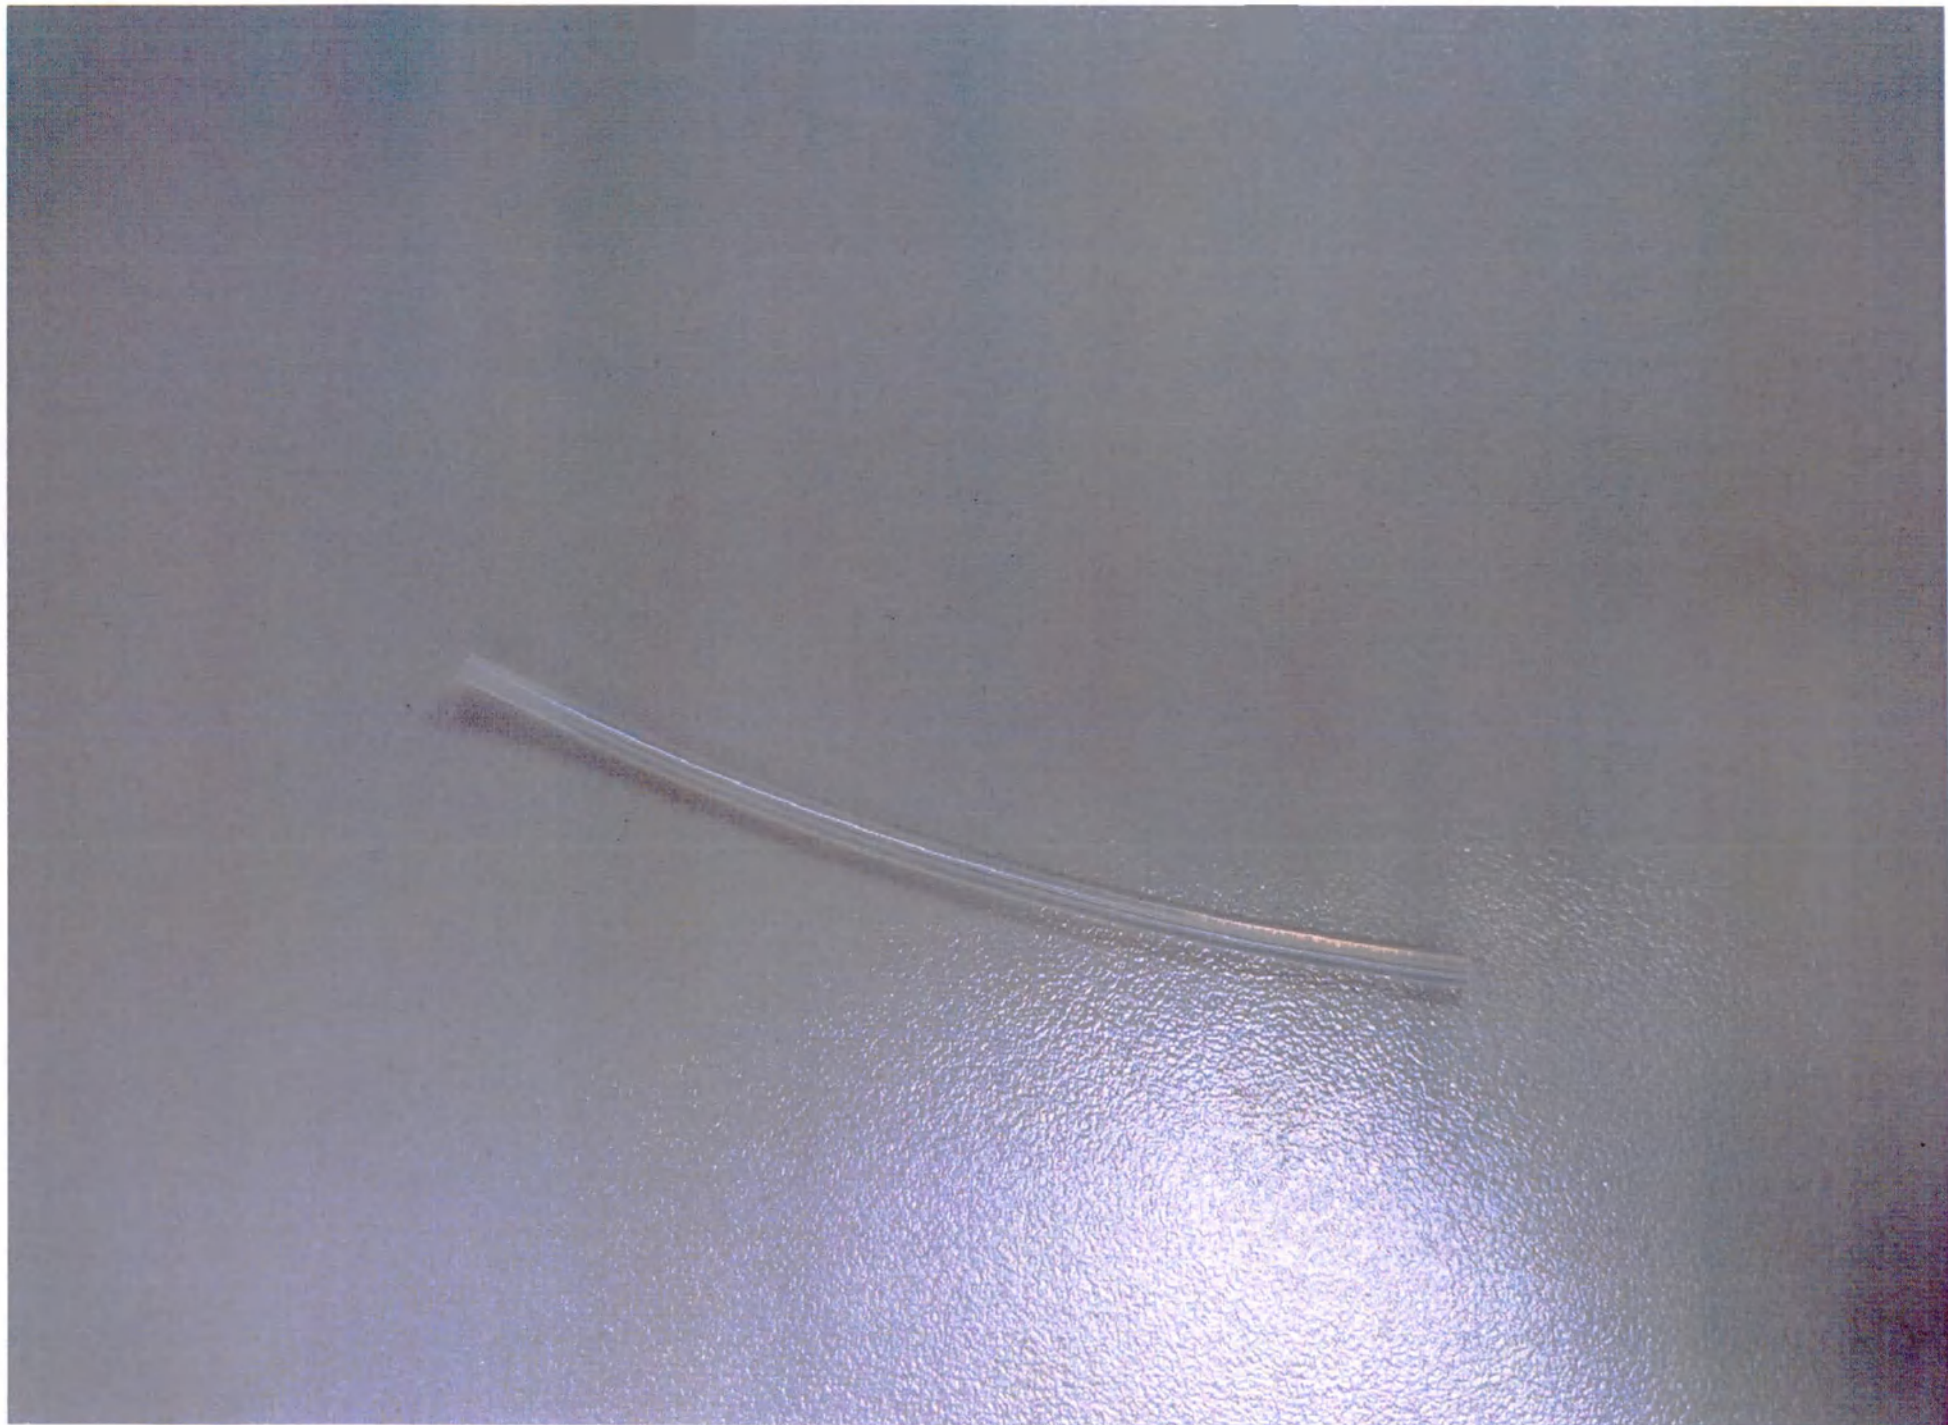


20.Силиконовая трубка (0,1 м)



21.Канистра для промывающего раствора Wash Buffer (5 л)

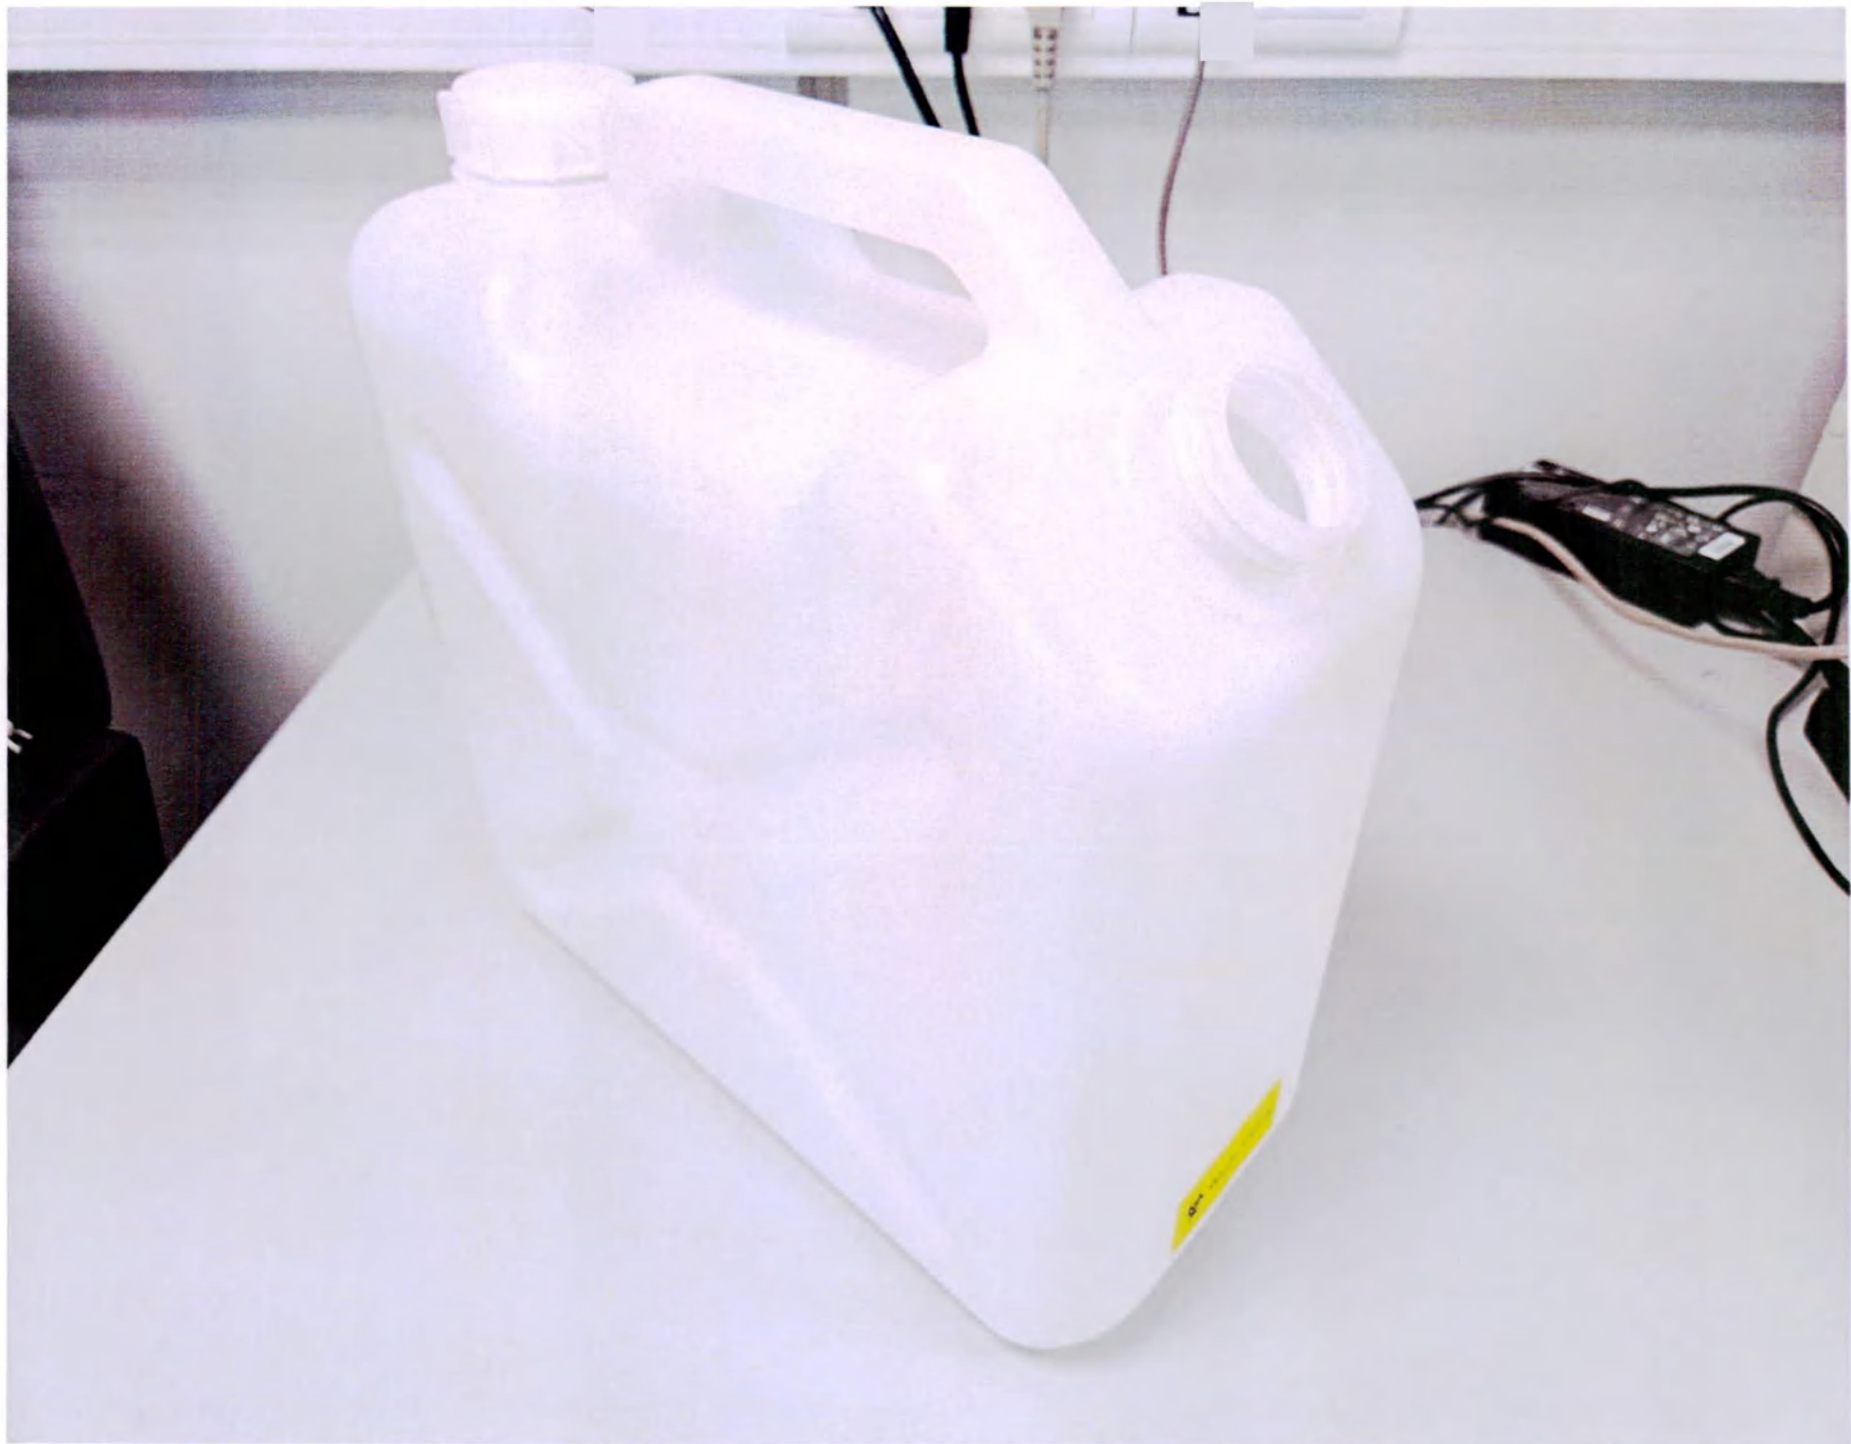


22.Канистра для жидких отходов (10 л)

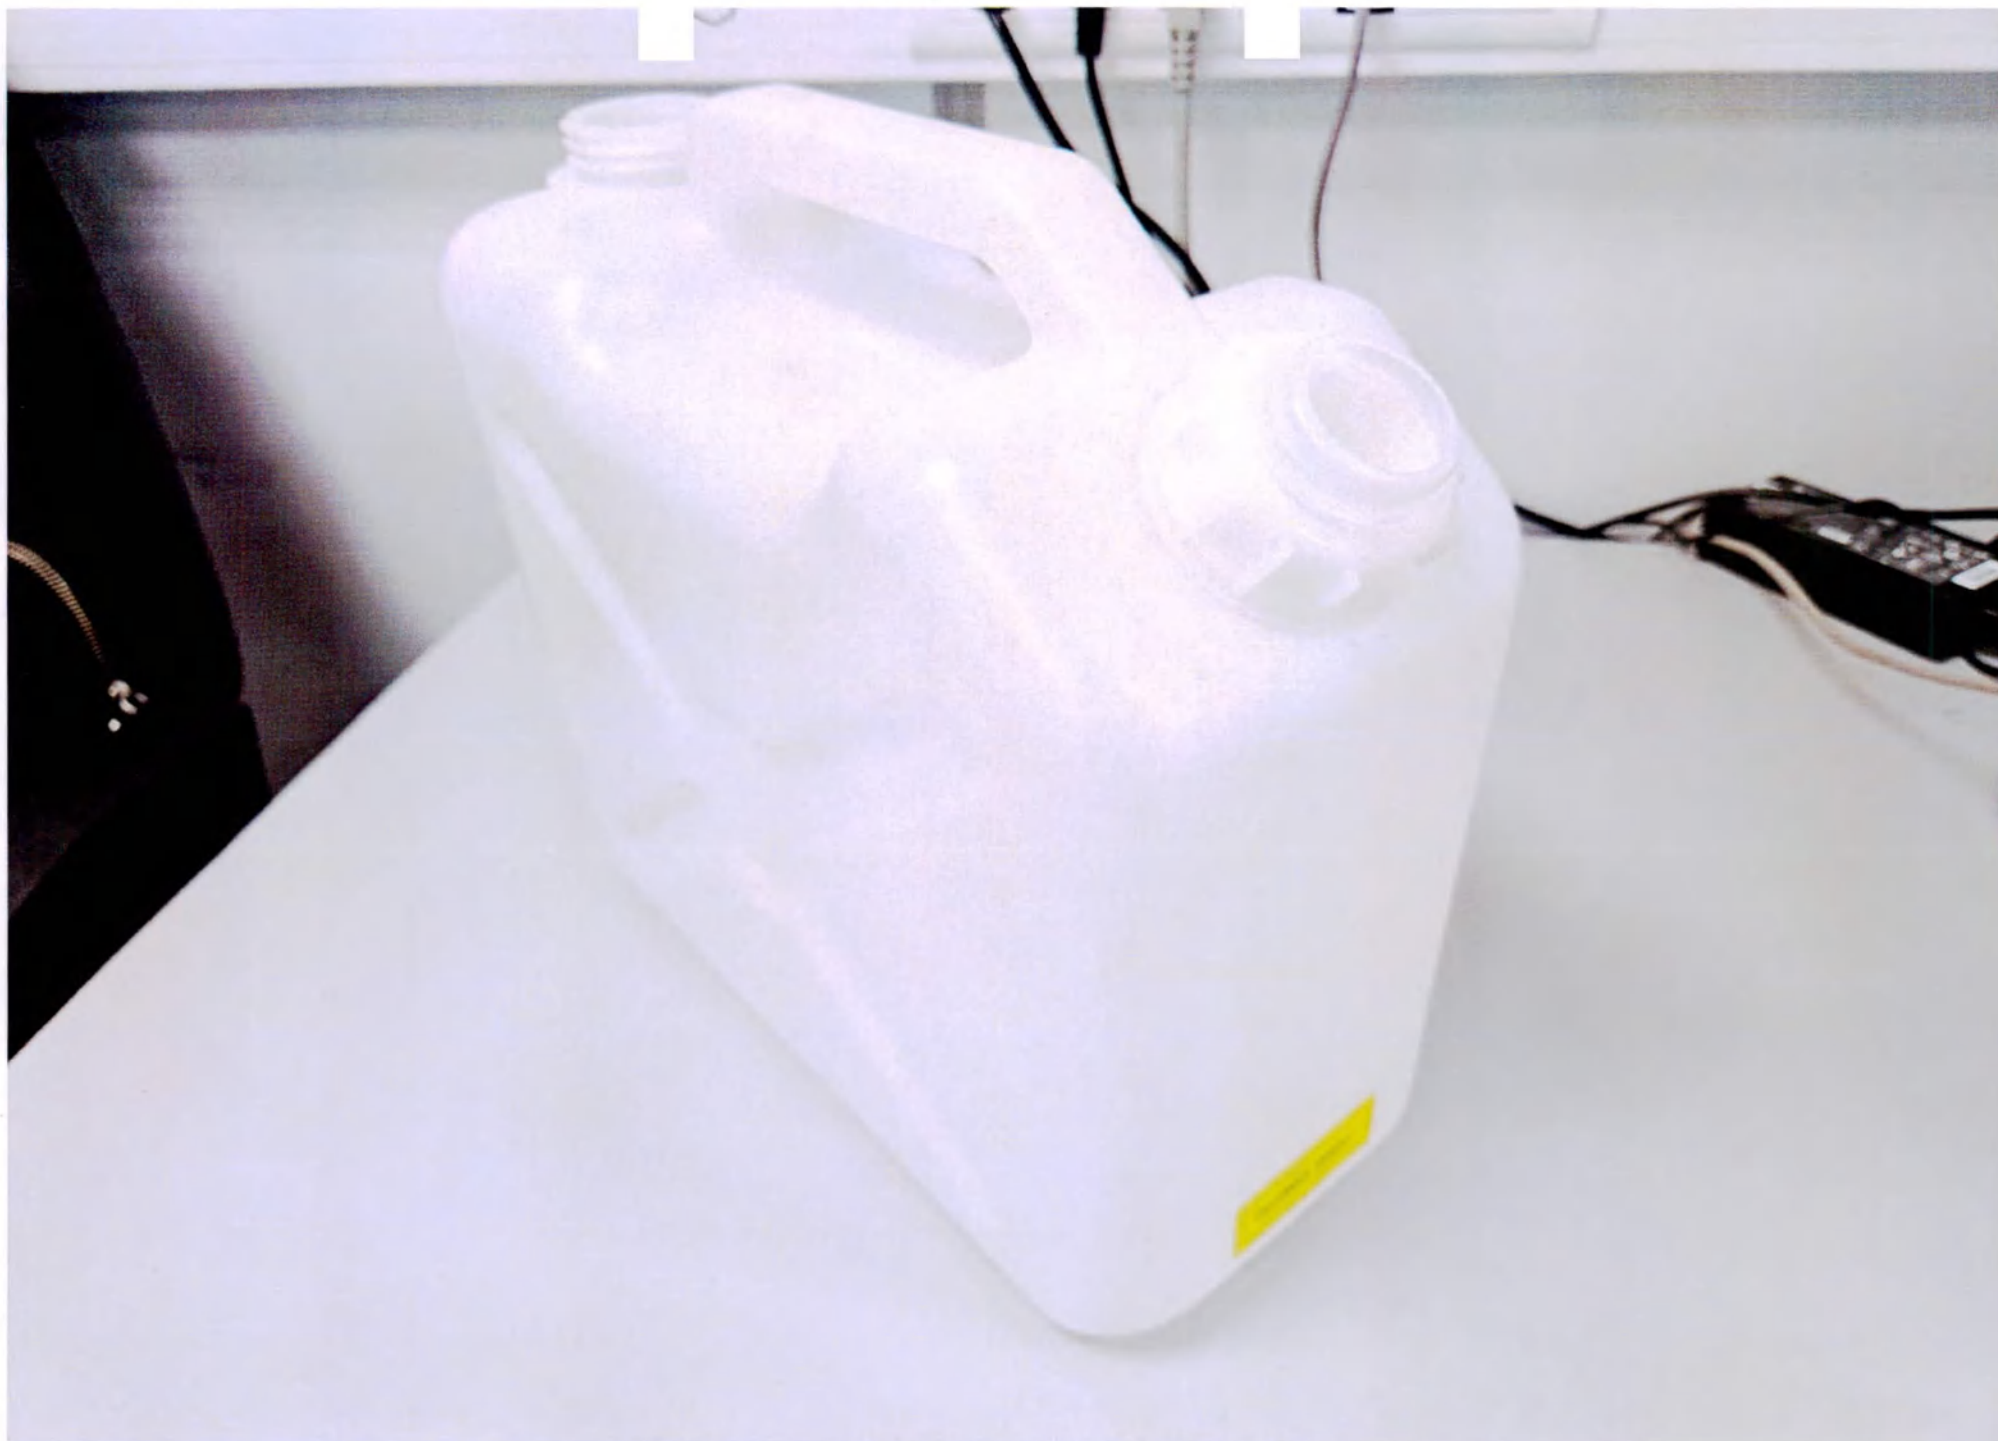


23.Канистра для очищенной воды (10 л)



24.Поплавковый выключатель в сборе для канистры для очищенной воды

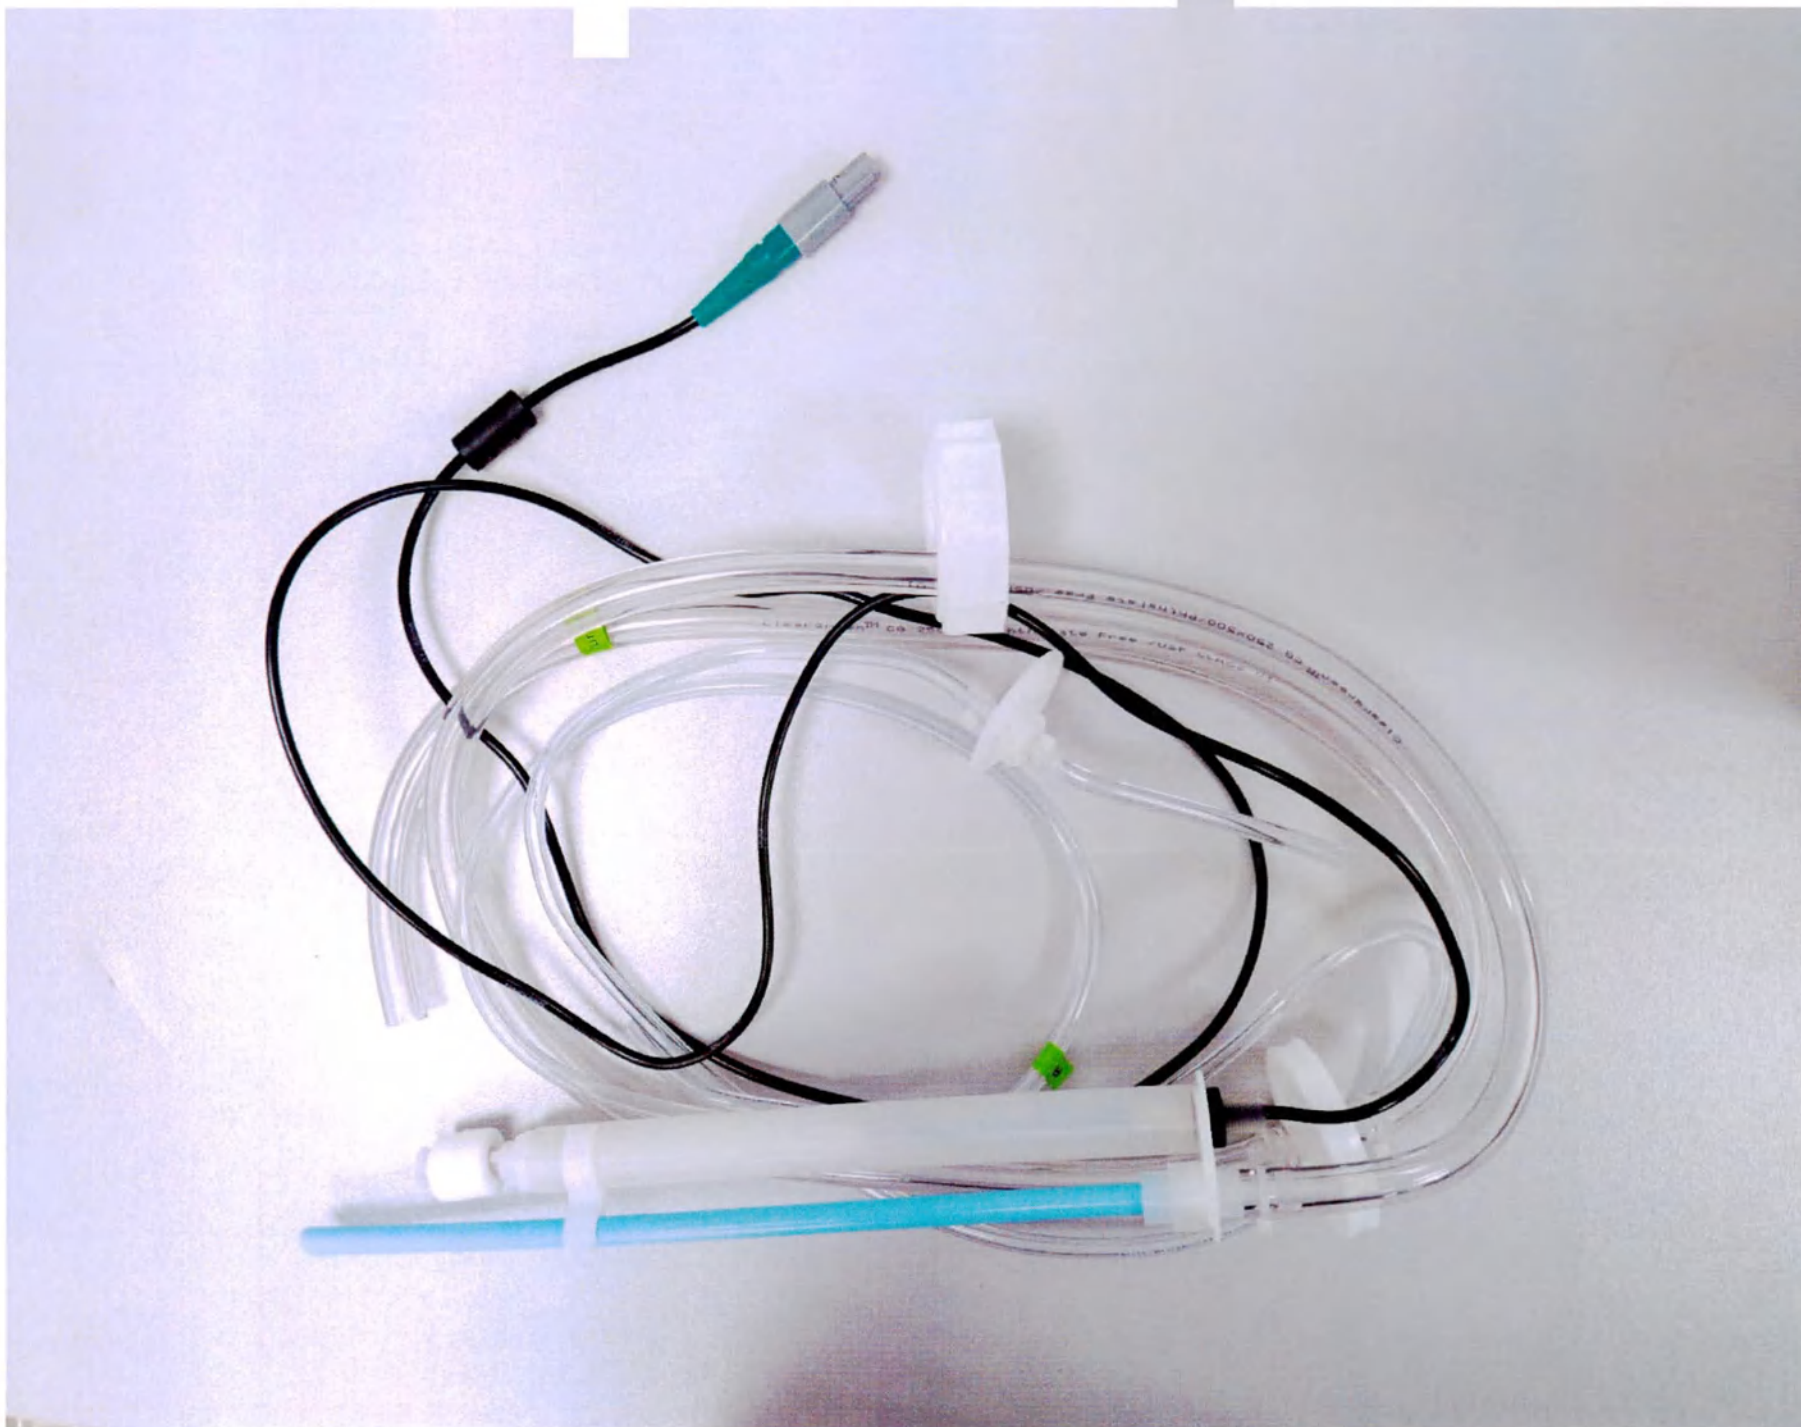

25. Поплавковый выключатель в сборе для канистры для жидких отходов

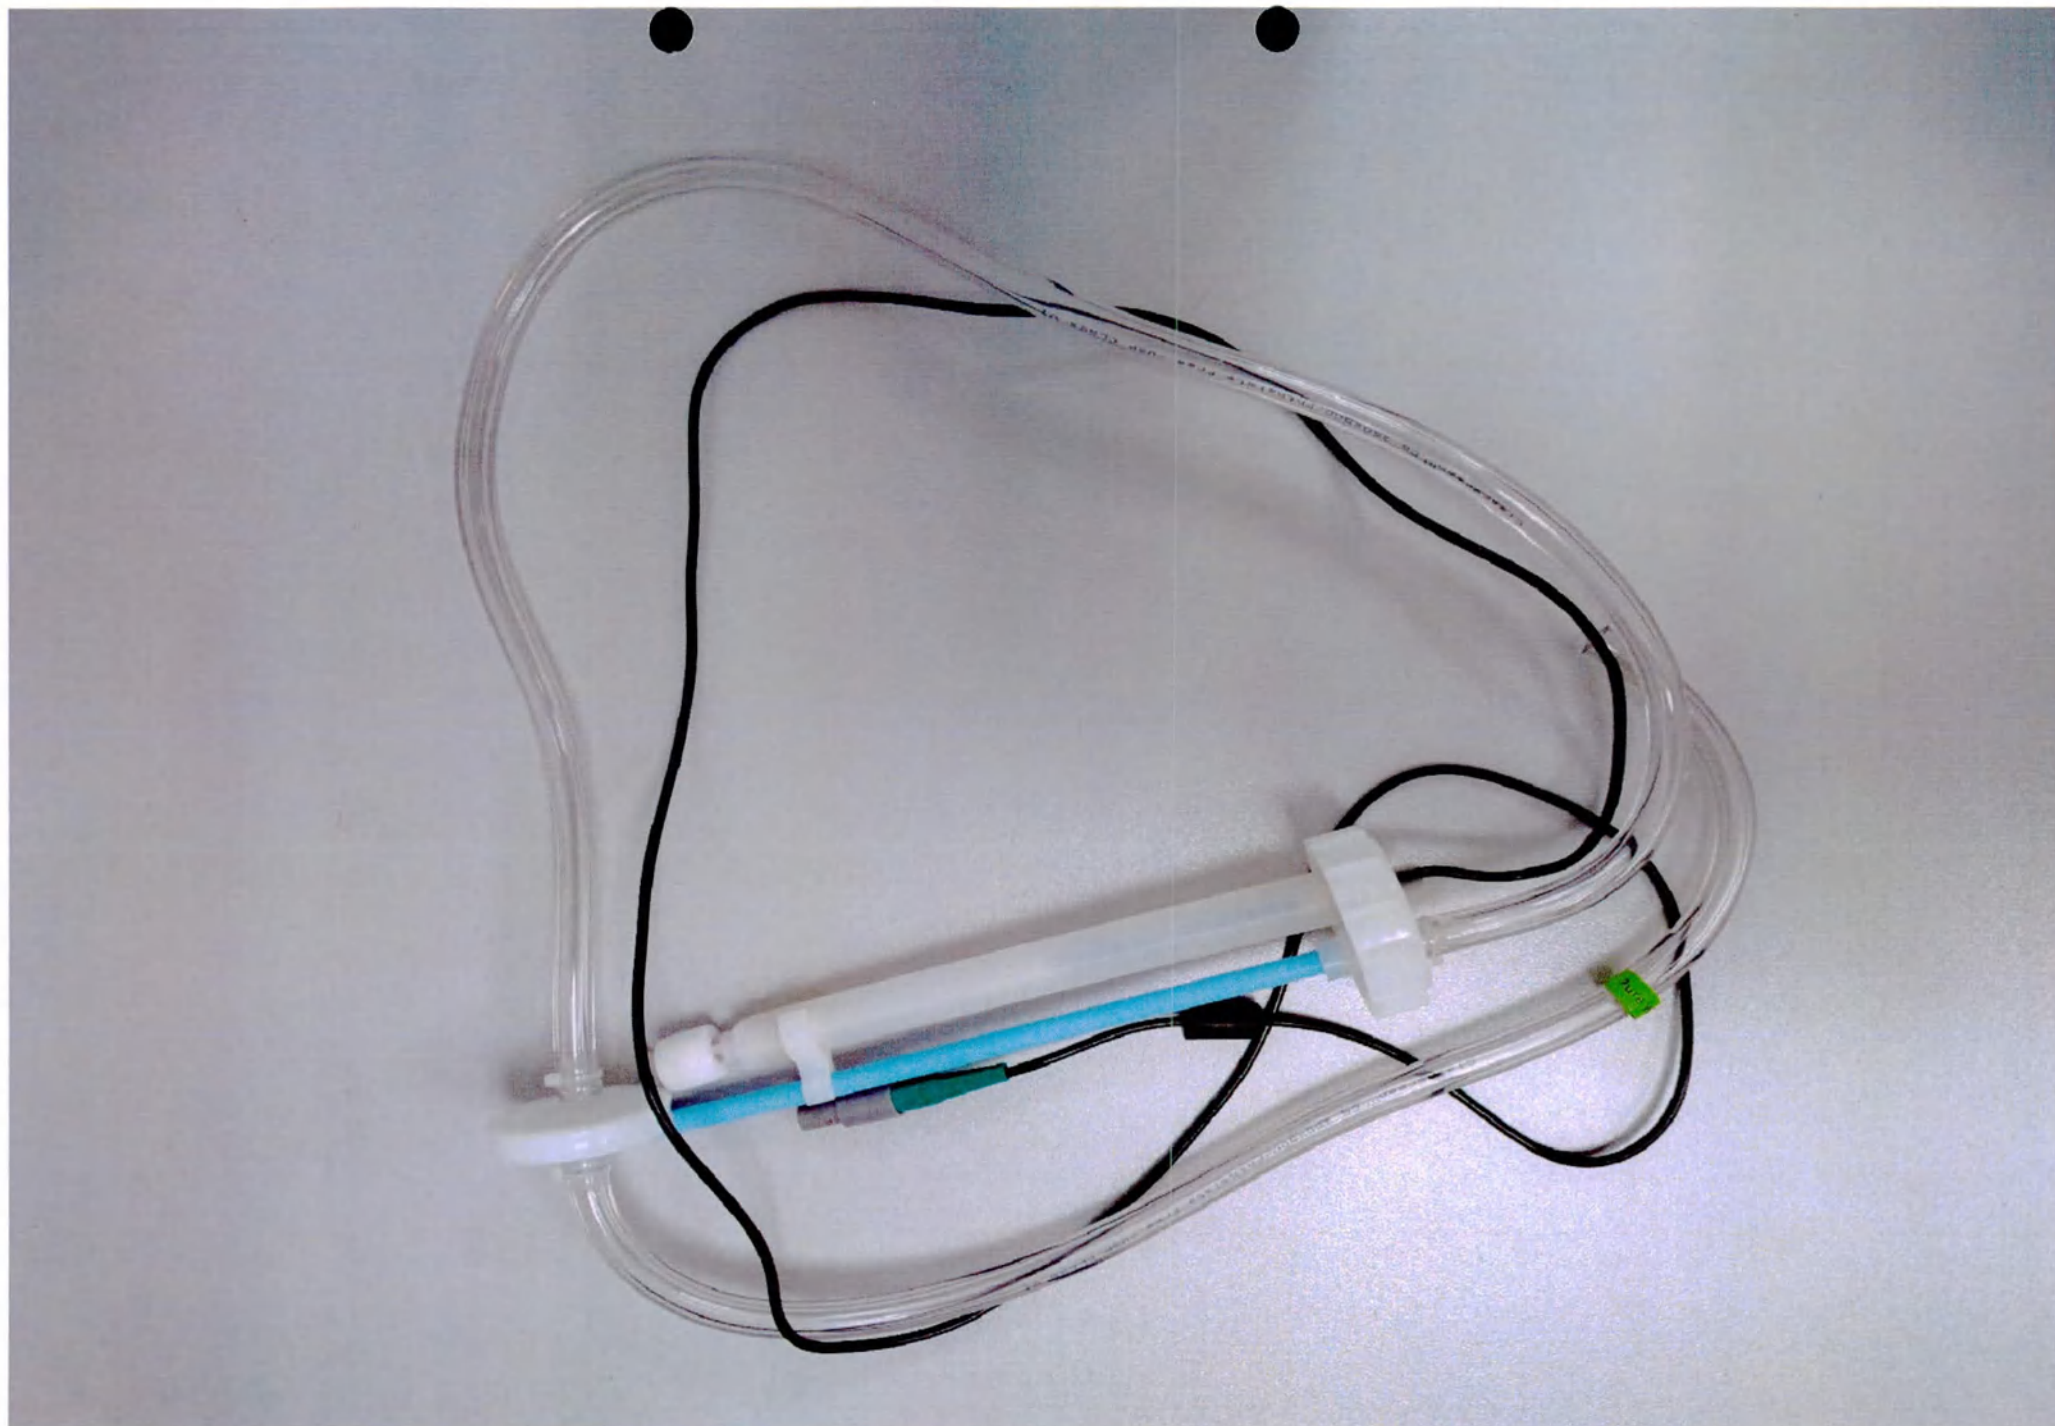

26. Поплавковый выключатель в сборе для канистры для промывающего раствора Wash Buffer




27.Флакон для разведения промывающего раствора System Wash (1 л)



28. Флакон для субстрата А (белый)



29.Флакон для субстрата В (коричневый)

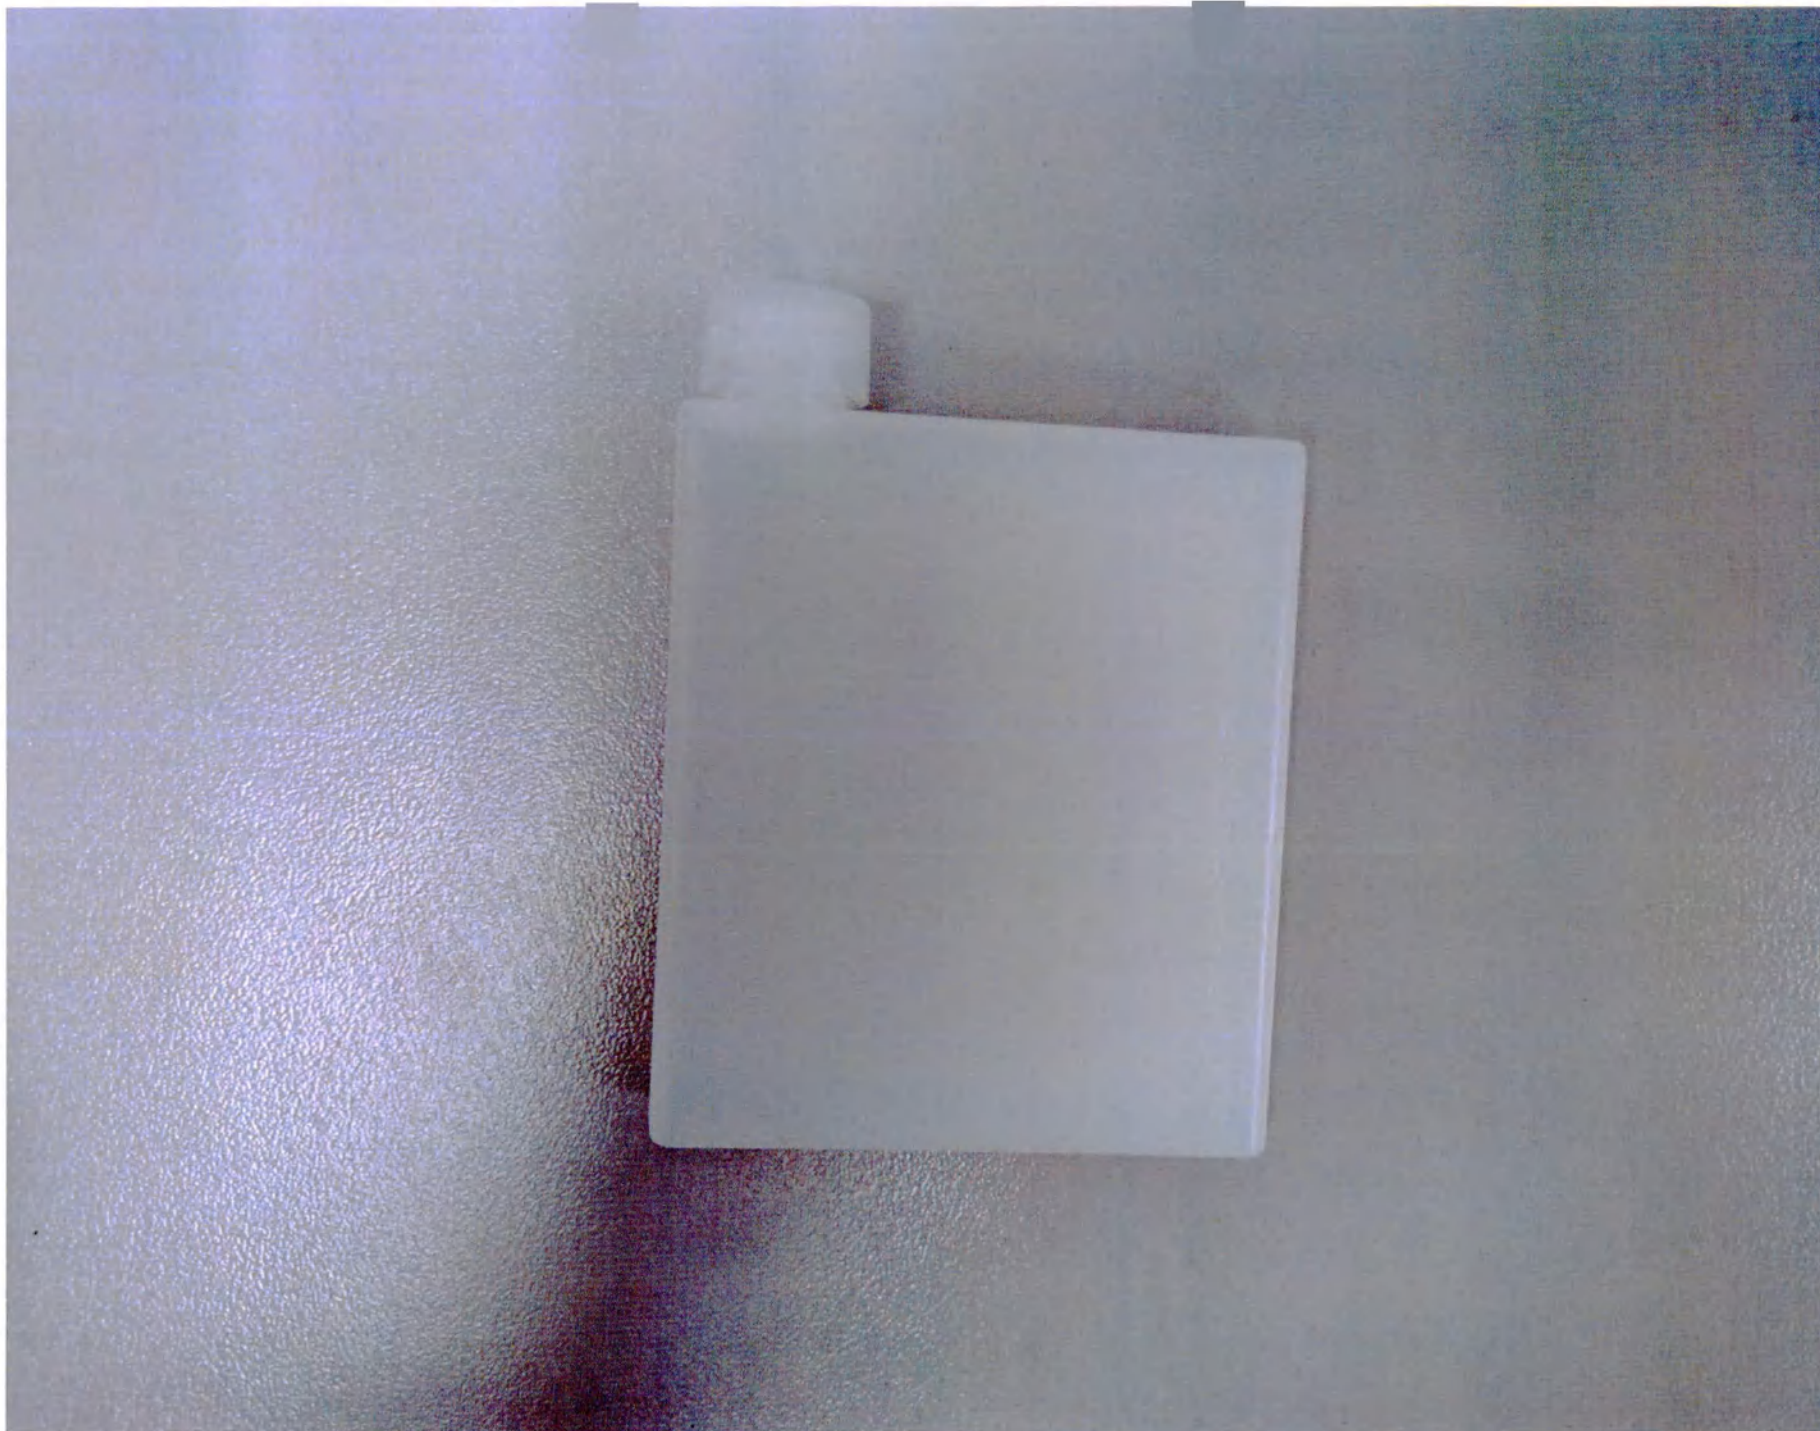

30.Флакон для промывающего раствора System Wash



31.Флакон для разбавителя 1




32.Флакон для разбавителя 2



33.Предохранитель




34. Крышка карусели реагентов

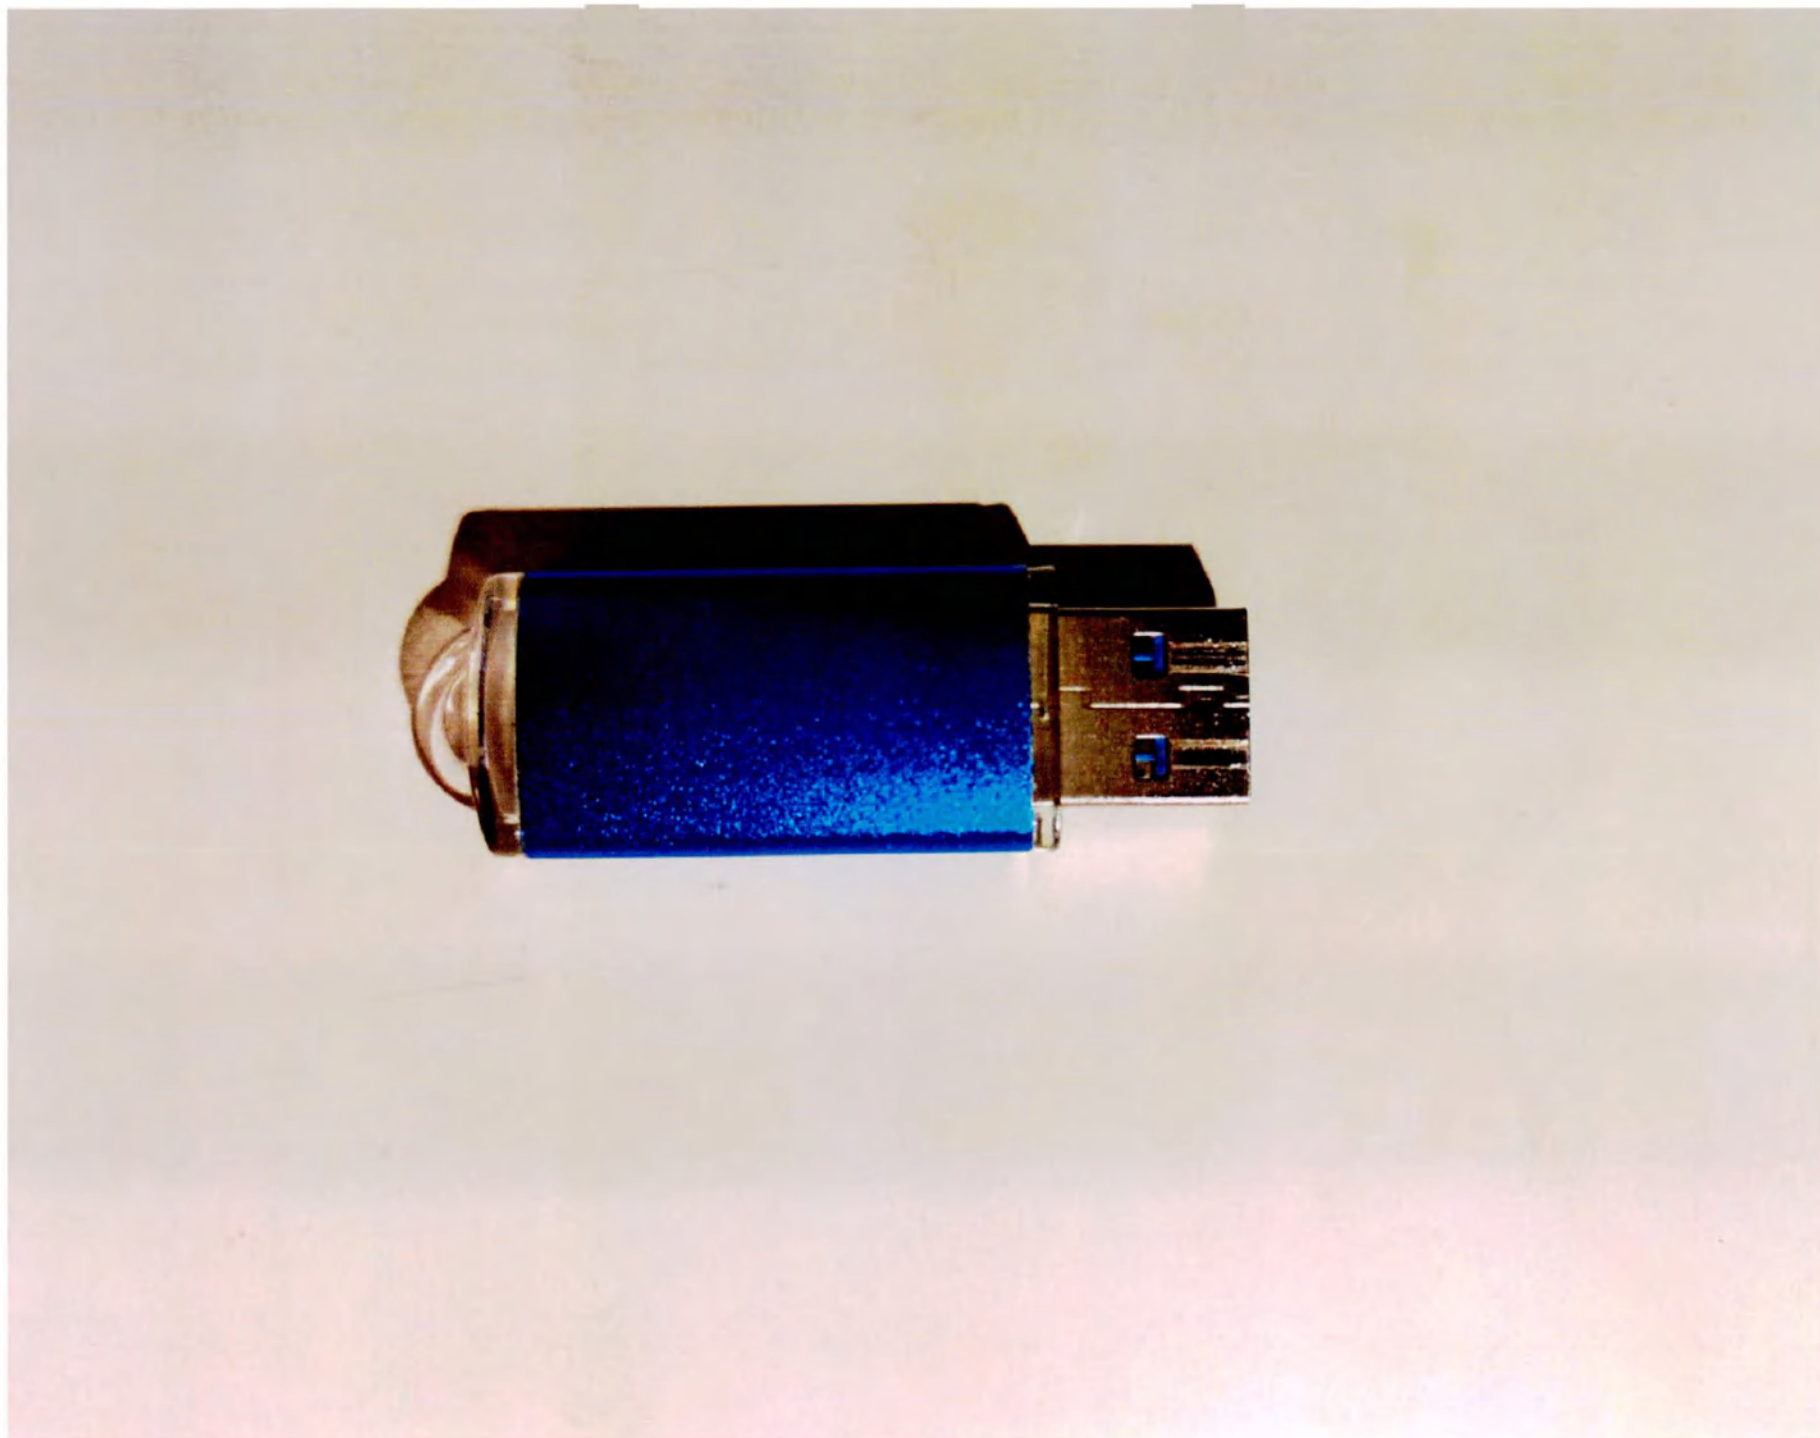


35.USB-флеш-накопитель




Принадлежности. 1.Набор сервисных инструментов

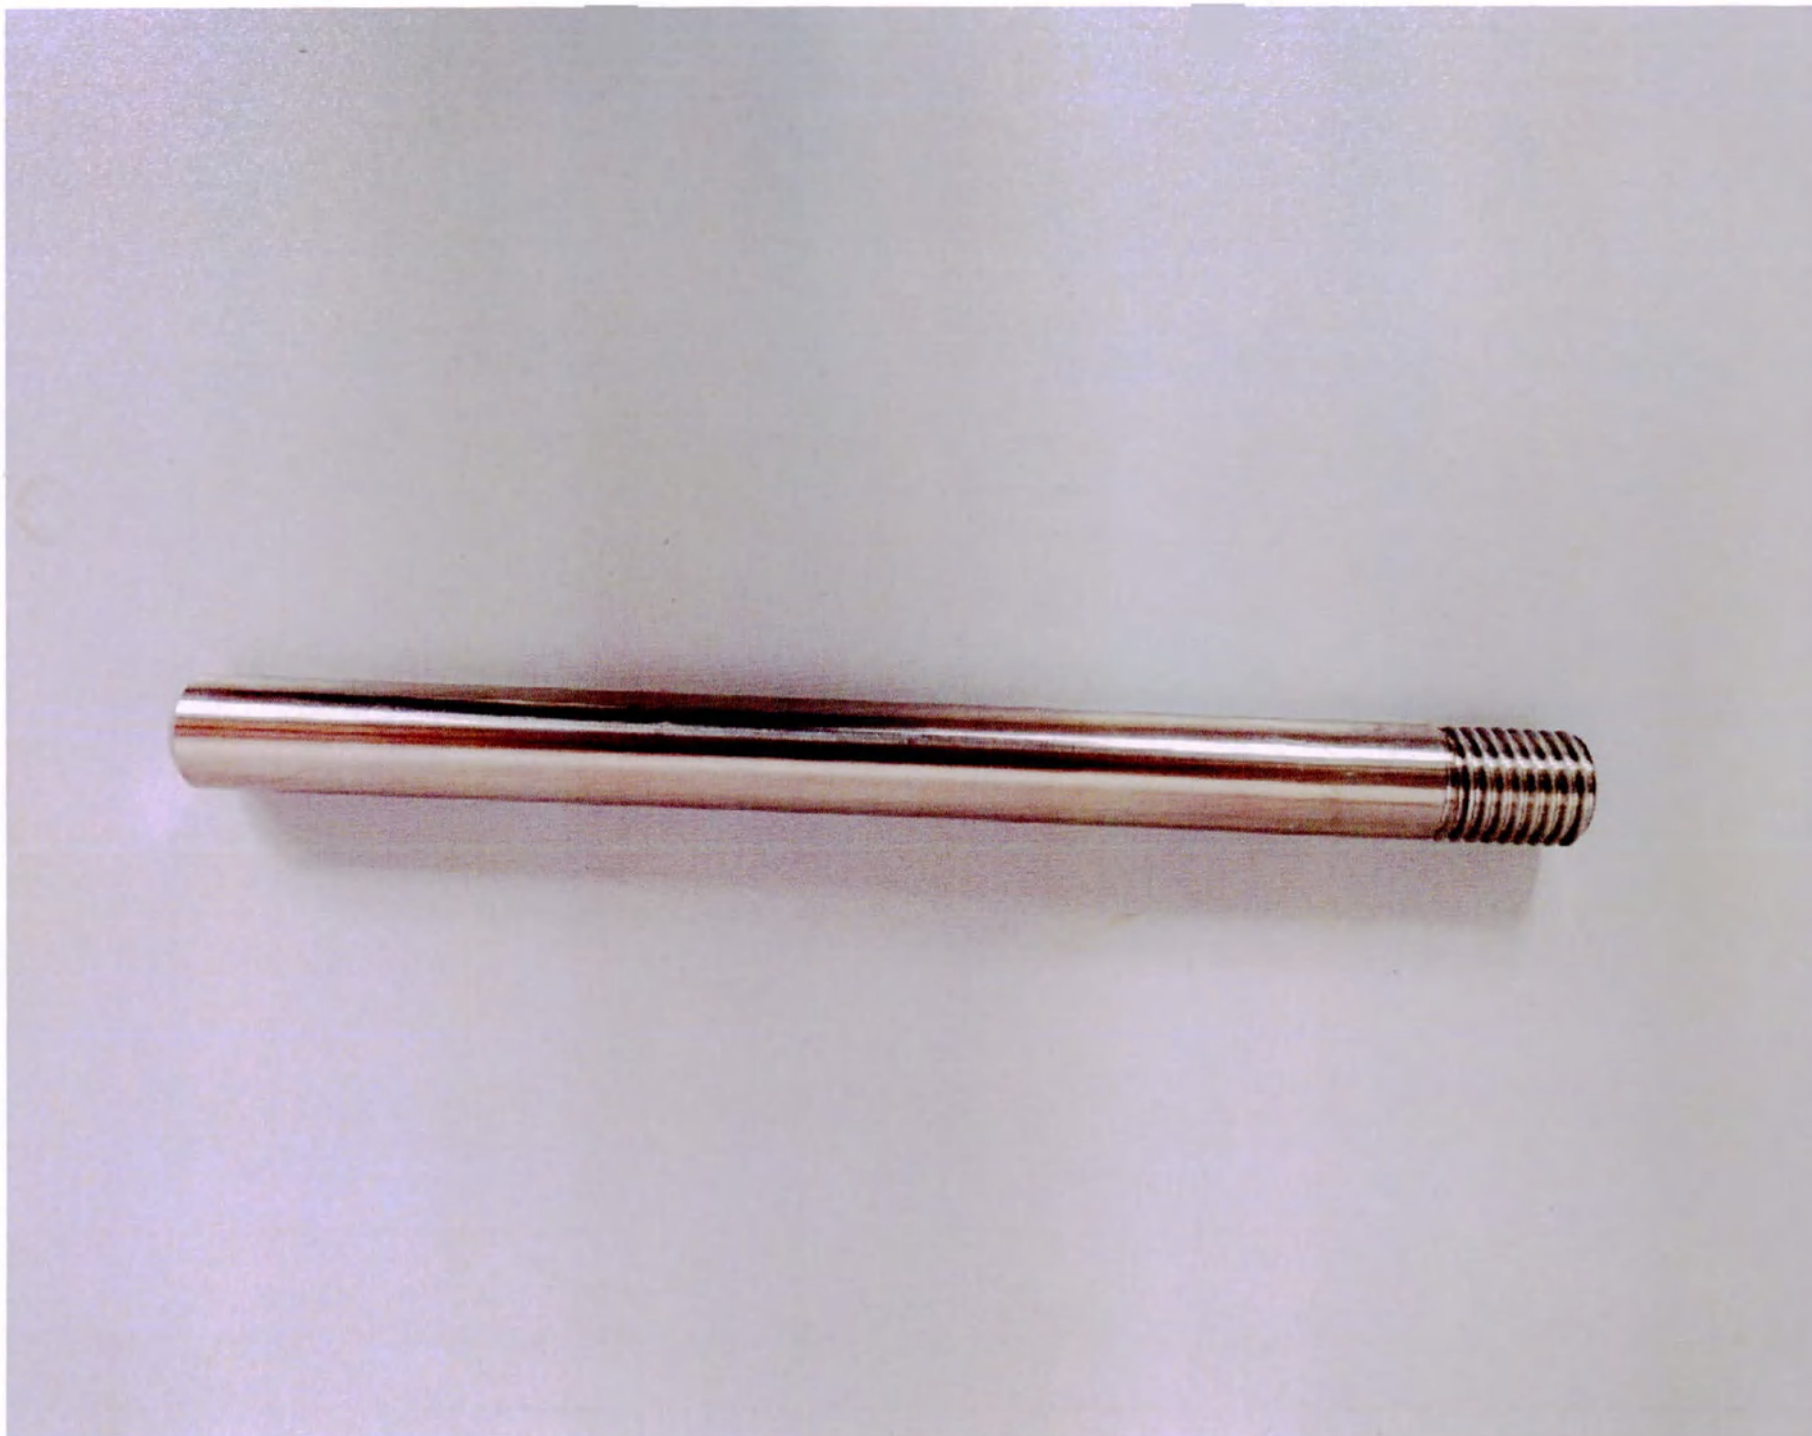


2.Ручки

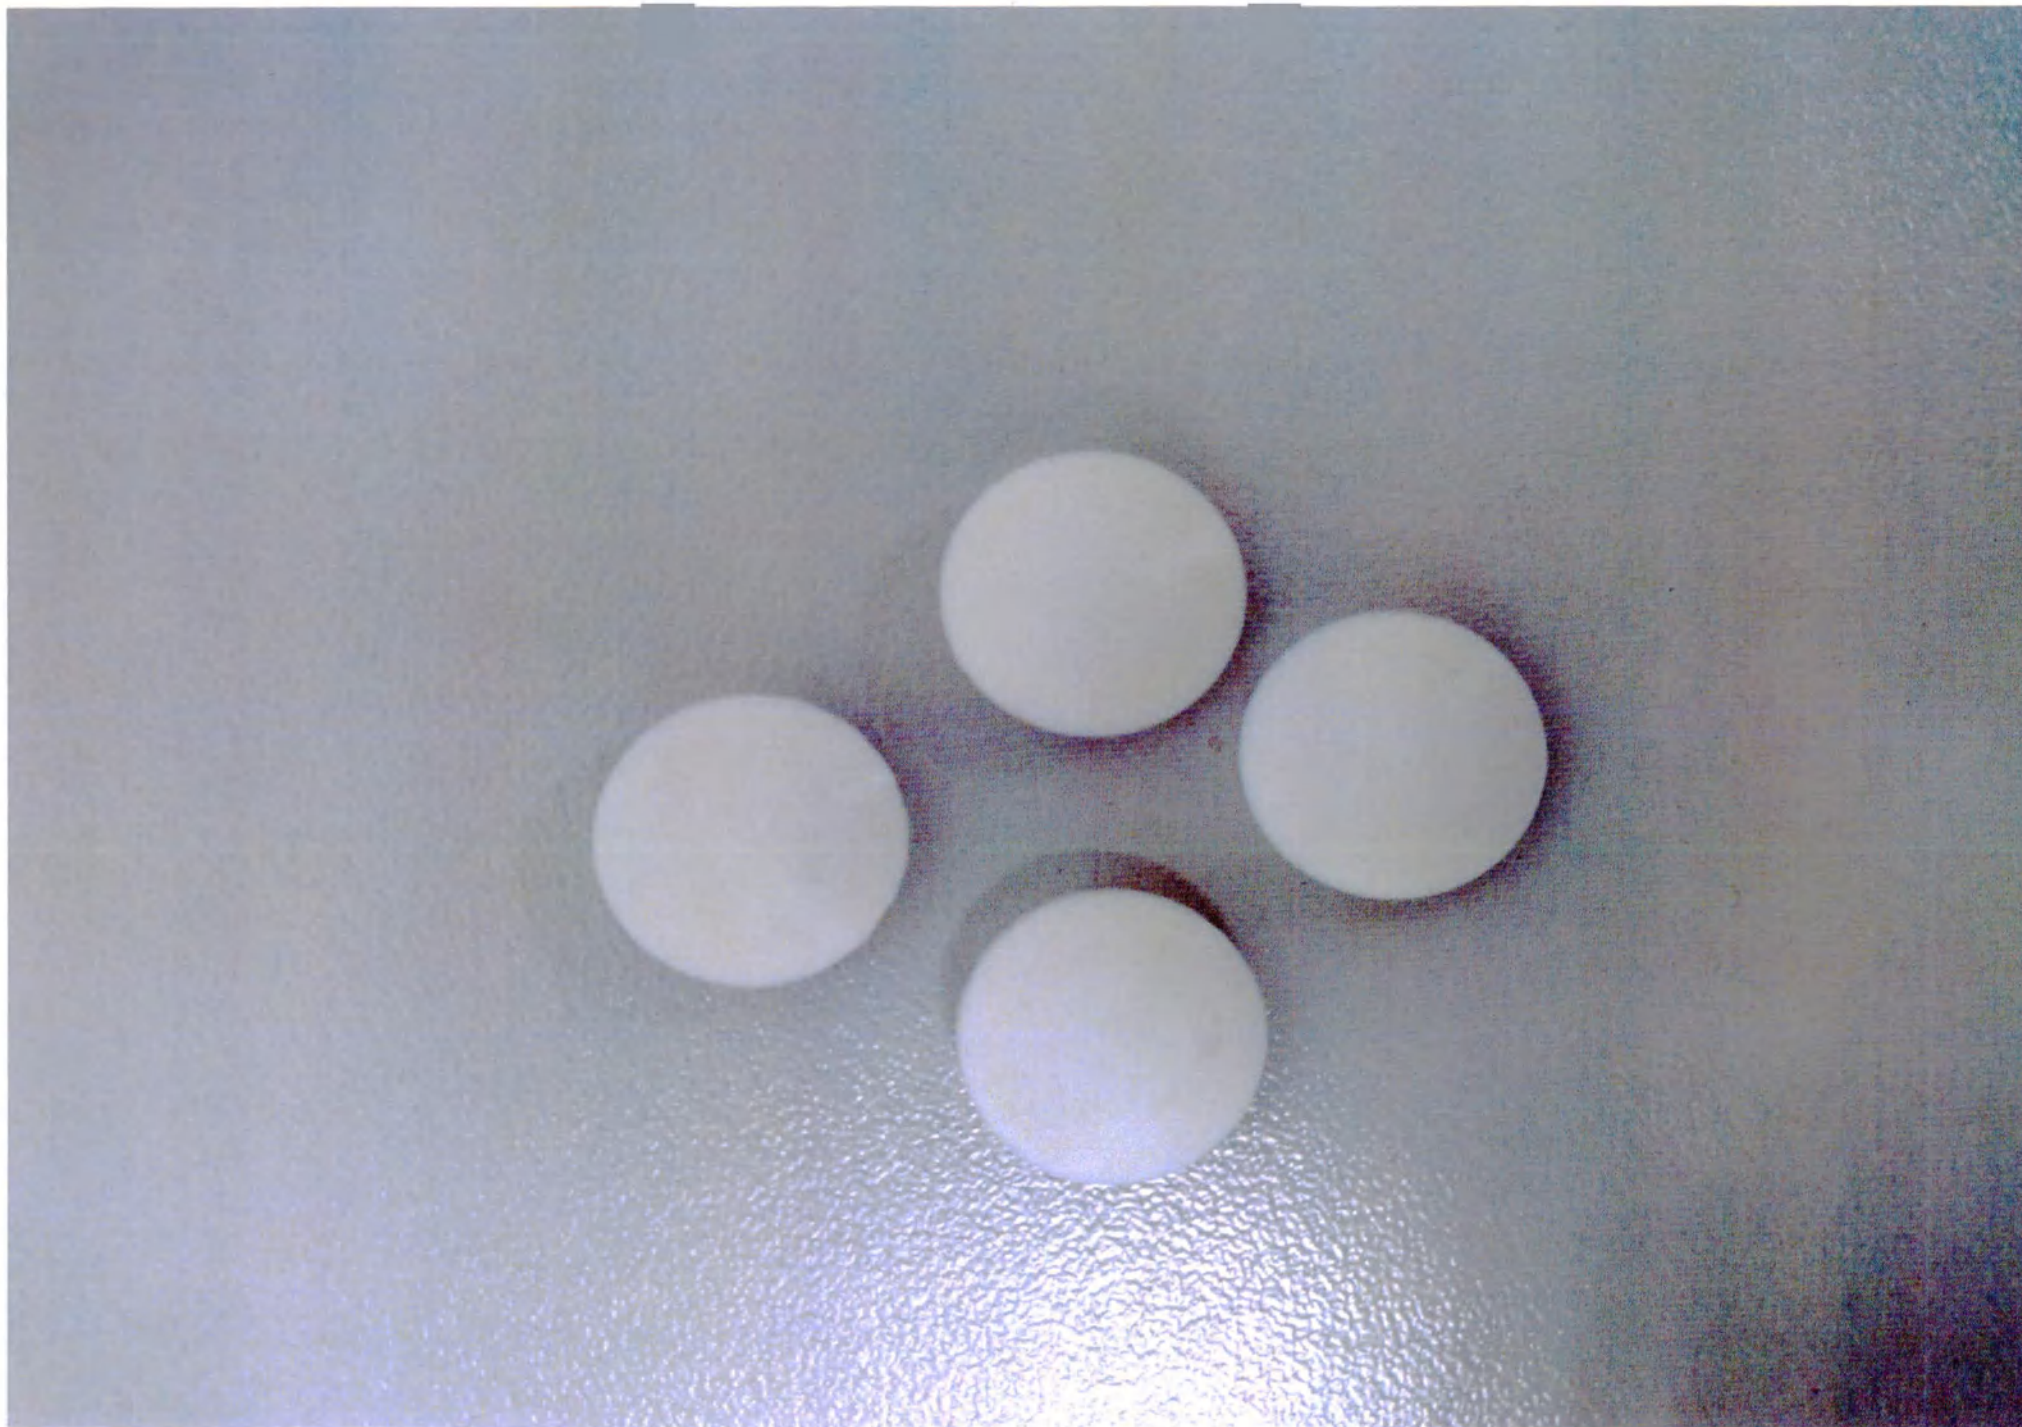

3.Заглушки

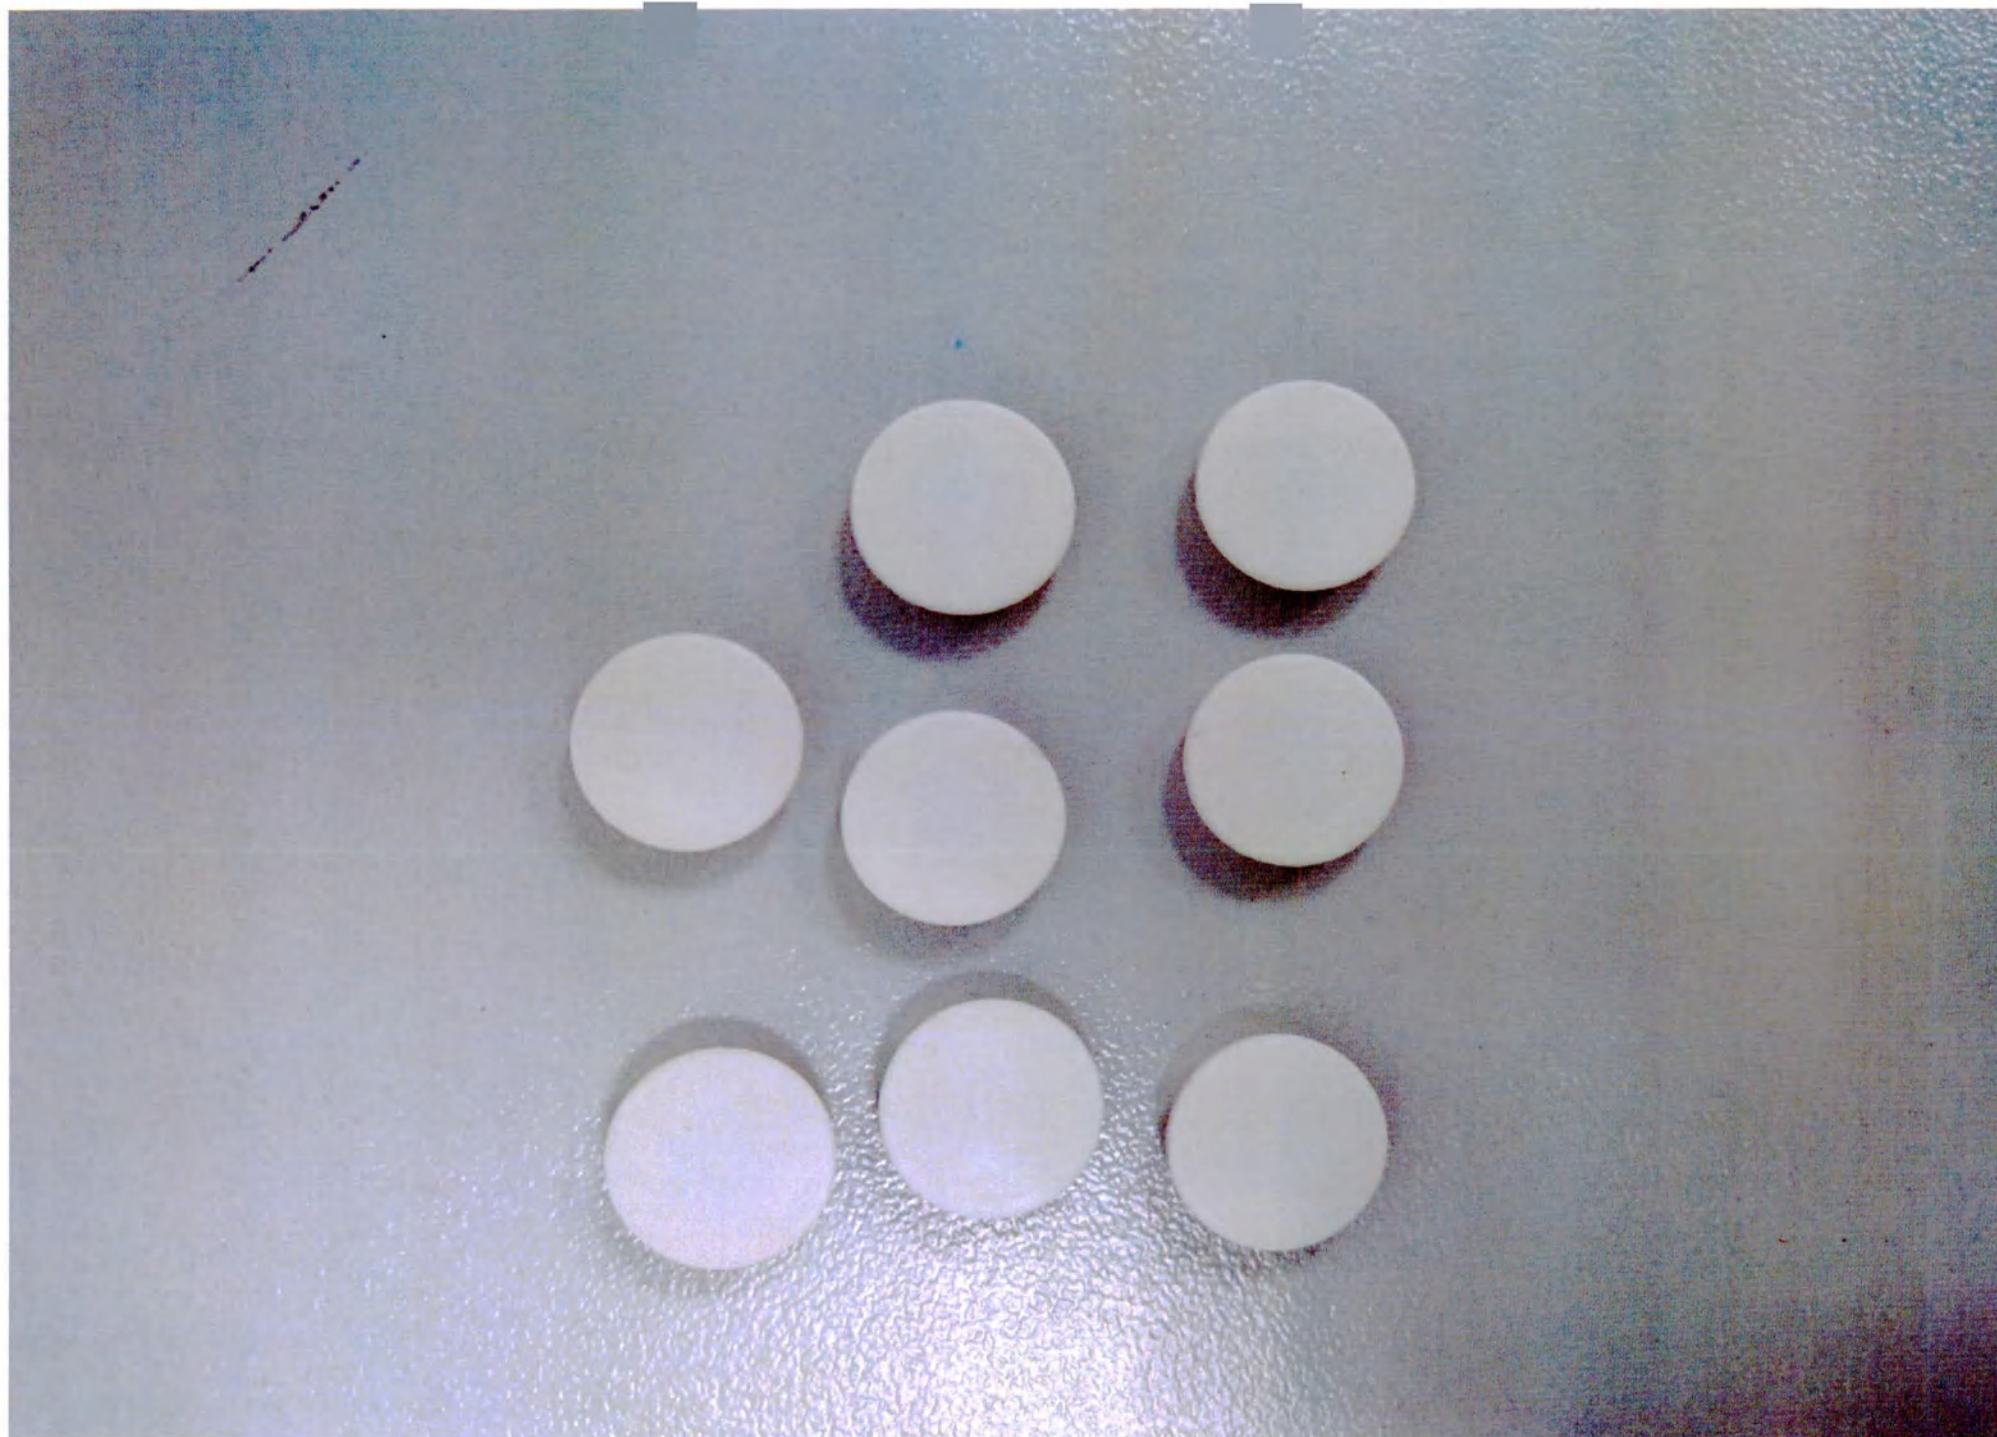

4.Крышка силиконовая

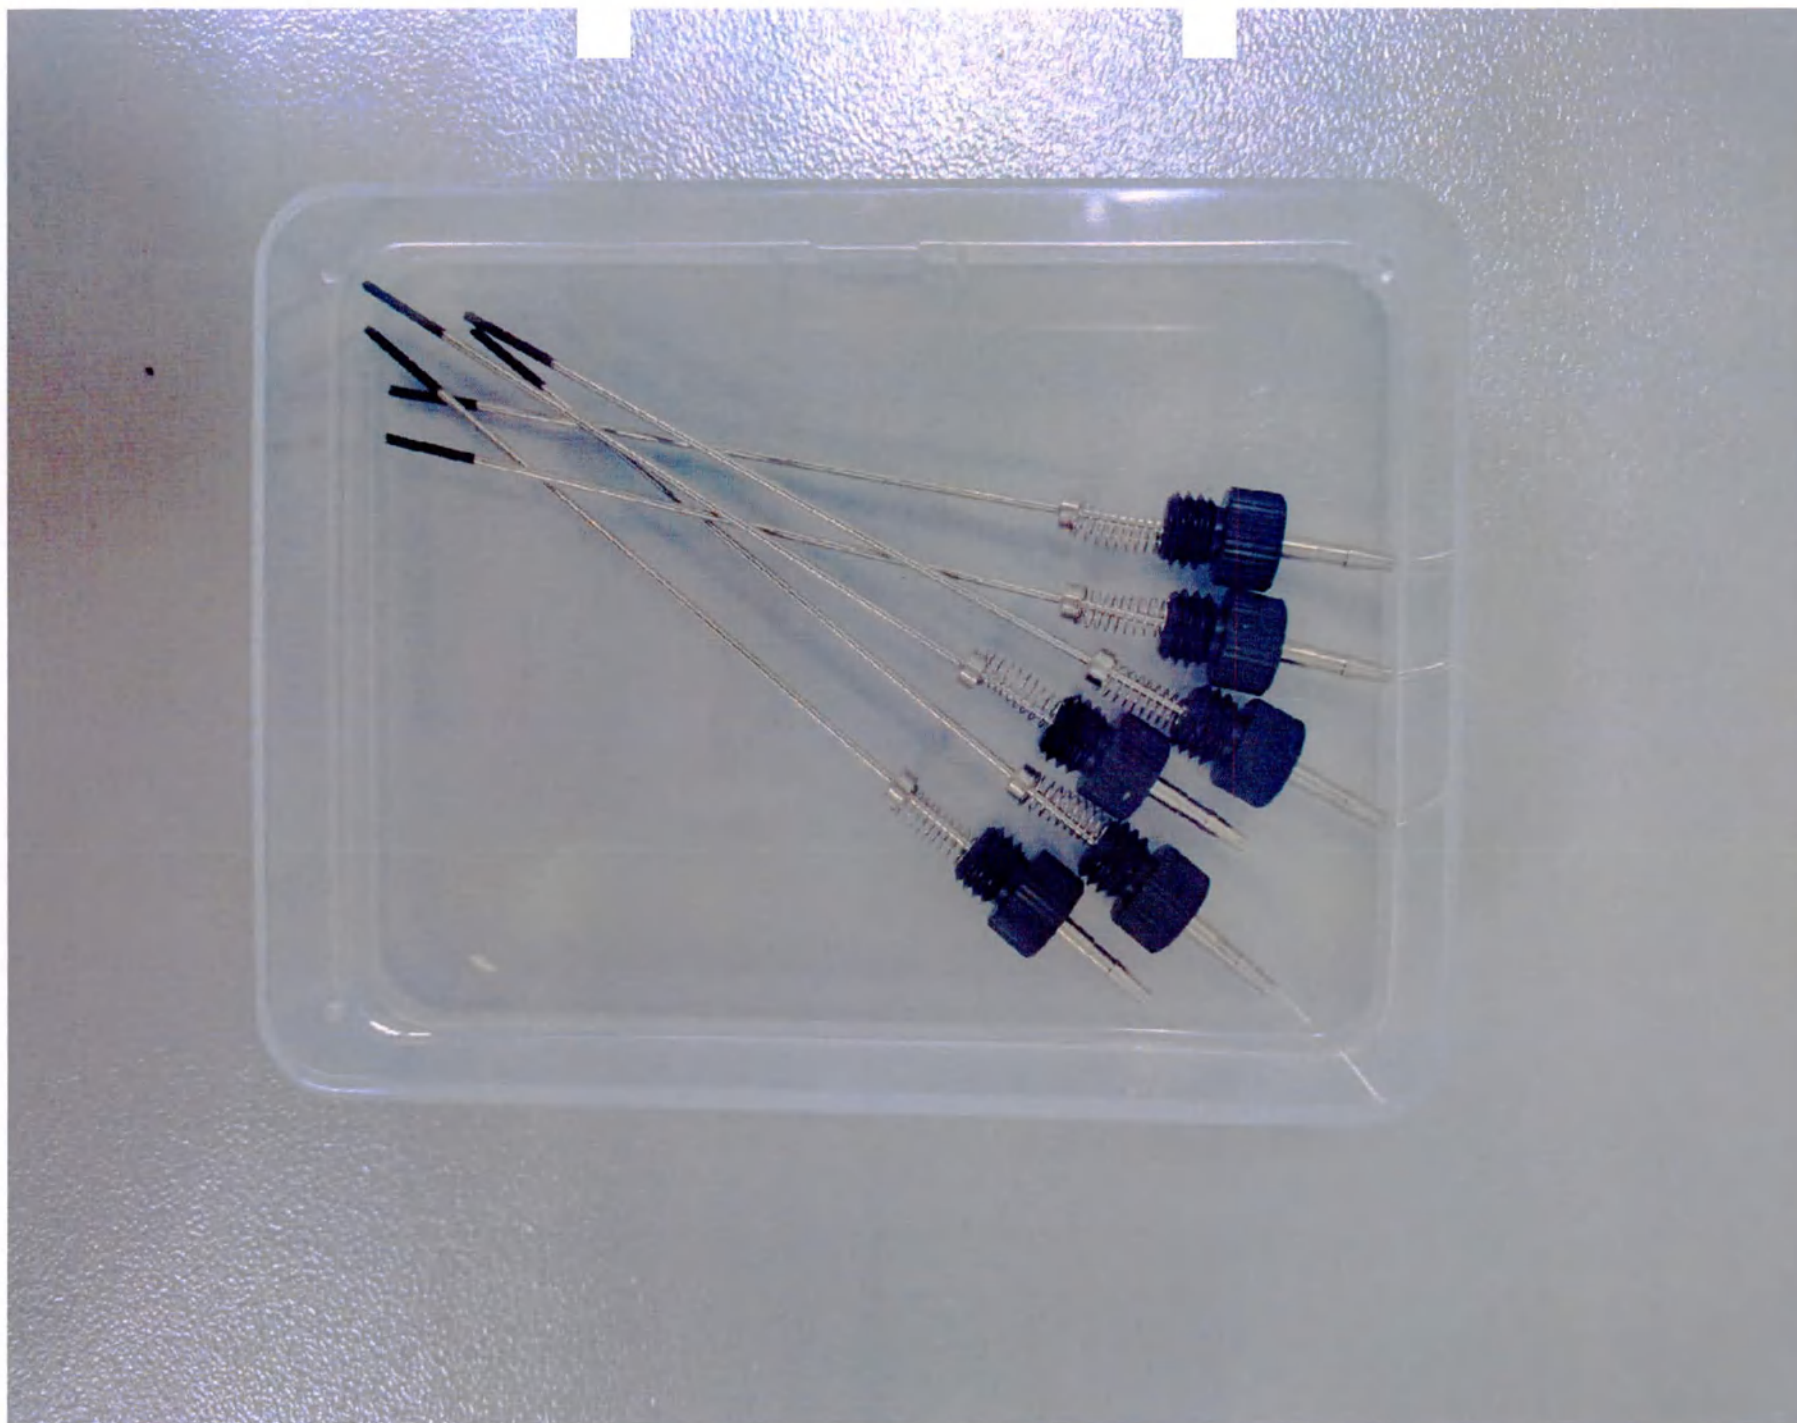

5.Игла для модуля промывки дополнительная



6. Устройство для автоматической подачи воды и удаления жидких отходов AutoFluid с кабелем



7.Стяжки кабеля (CV-100)



Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.
No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone,
Zhengzhou 450016, China

Automatic Luminescence Immunoassay Analyzer

AutoLumo A1860


SN **707 300 1422**

REF **07073**

Voltage Rating: 230V~

Power Rating: 1000VA

Frequency: 50/60Hz



2023-11-13

Tel: + 86 - 371- 67985313



IVD



**Анализатор автоматический иммунохемилюминесцентный
AutoLumo A1860 с принадлежностями**

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Информация о производителе, серийный номер, дата производства
указаны на оригинальной маркировке медицинского изделия

Только для профессионального использования

230 В ~

1000 ВА

50/60 Гц



Уполномоченный представитель производителя
на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Маркировка медицинского изделия

Device Name	Automatic Luminescence Immunoassay Analyzer		
#	AutoLumo A1860		
SN	707 300 1422		
Package Size	(1270×865×960) mm ±10%		
Weight	(183 kg + (50) kg) ±10%		
 			
 Autobio Labtec Instruments Co., Ltd. No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone, Zhengzhou 450016, China Tel: + 86- 371- 67985313 Website: en.autobio.com.cn			
IVD	This product is used for In Vitro Diagnostic purpose.		

Транспортная маркировка медицинского изделия



Транспортная упаковка медицинского изделия

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на

(сложно сшить)

листах

