

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО "Некстэлидженс"



О.А.Гревцов

"12" января 2024 г.

МАКЕТЫ ЭТИКЕТОК НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

Аппарат для гистологической вакуумной проводки тканей

Infiltra® в составе, по ТУ 26.60.12-010-89079081-2018

Маркировочная этикетка изделия в варианте исполнения NX01.300

Этикетка 70 мм x 40 мм

Аппарат для гистологической вакуумной
проводки тканей Infiltra® в составе,
по ТУ 26.60.12-010-89079081-2018

NEXTELLIGENCE

SN 0015-0523

РУ №ПЗН 2019/8748 от 04.10.2023

REF BV-006-902-02

ТУ 26.60.12-010 - 89079081 - 2018



ООО «Некстэлидженс»
199106, Россия, г. Санкт-Петербург,
Линия 22-я В.О., д. 3, к. 6 литера Д,
помещ. 2-Н, ком. 4



~220В±10%, 50±0,5Гц, 1400 ВА

Маркировочная этикетка изделия в варианте исполнения NX01.150

Этикетка 70 мм x 40 мм

Аппарат для гистологической вакуумной
проводки тканей Infiltra® в составе,
по ТУ 26.60.12-010-89079081-2018

NEXTELLIGENCE

SN 0014-0523

РУ №ПЗН 2019/8748 от 04.10.2023

REF BV-006-902

ТУ 26.60.12-010 - 89079081 - 2018





ООО «Некстэлидженс»
199106, Россия, г. Санкт-Петербург,
Линия 22-я В.О., д. 3, к. 6 литера Д,
помещ. 2-Н, ком. 4



~220В±10%, 50±0,5Гц, 1400 ВА

Маркировка транспортной упаковки изделия в варианте исполнения NX01.300

Этикетка 110 мм x 140 мм

Аппарат для гистологической вакуумной проводки тканей Infiltra® в составе, по ТУ 26.60.12-010-89079081-2018			
Изготовлено по ТУ 26.60.12-010-89079081-2018 РУ №РЗН 2019/8748 от 04.10.2023 Оборудование для профессионального применения.			
NEXTELLIGENCE			
			
Масса нетто 133±5 кг		Масса брутто 161±8 кг	
	05.2023		
REF	BV-006-902-02		
SN	0015-0523		
	ООО "Некстэллдженс". 199106, РФ, г. Санкт-Петербург, Линия 22-я В.О., д. 3, к. 6 литера Д, помещ. 2-Н, ком. 4. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "Некстэллдженс", 199106, РФ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 7, Линия 22-я В.О., д. 3, к. 6 литера Д, помещ. 2-Н, ком. 4, тел./факс (812) 9850685. www.nextint.ru		

Маркировка транспортной упаковки изделия в варианте исполнения NX01.150

Этикетка 110 мм x 140 мм

Аппарат для гистологической вакуумной проводки тканей Infiltrator® в составе, по ТУ 26.60.12-010-89079081-2018		
Изготовлено по ТУ 26.60.12-010-89079081-2018 РУ №РЗН 2019/8748 от 04.10.2023 Оборудование для профессионального применения.		
NEXTELLIGENCE		
Масса нетто 133±5 кг		Масса брутто 161±8 кг
	05.2023	
REF	BV-006-902	
SN	0014-0523	
	ООО "Некстэлдженс", 199106, РФ, г. Санкт-Петербург, Линия 22-я В.О., д. 3, к. 6 литера Д, помещ. 2-Н, ком. 4. Организация уполномоченная принимать претензии: ООО "Некстэлдженс", 199106, РФ, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ № 7, Линия 22-я В.О., д. 3, к. 6 литера Д, помещ. 2-Н, ком. 4, тел./факс (812) 9850685. www.nextint.ru	

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 4 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «Некстэллѐженс»


О.А. Гребцов
«28» июля 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Некстэлдженс»
Гревцов О.А. 10 января 2024 г.




Фотографические изображения Аппарата для гистологической вакуумной
проводки тканей Infiltra® в составе, с принадлежностями, по ТУ 26.60.12-010-
89079081-2018

С учетом изменений №3 от 10.01.2024 г.

1. Аппарат для гистологической вакуумной проводки тканей Infiltra® NX01.150
- 1.1. Общий вид




1.2. Вид сверху

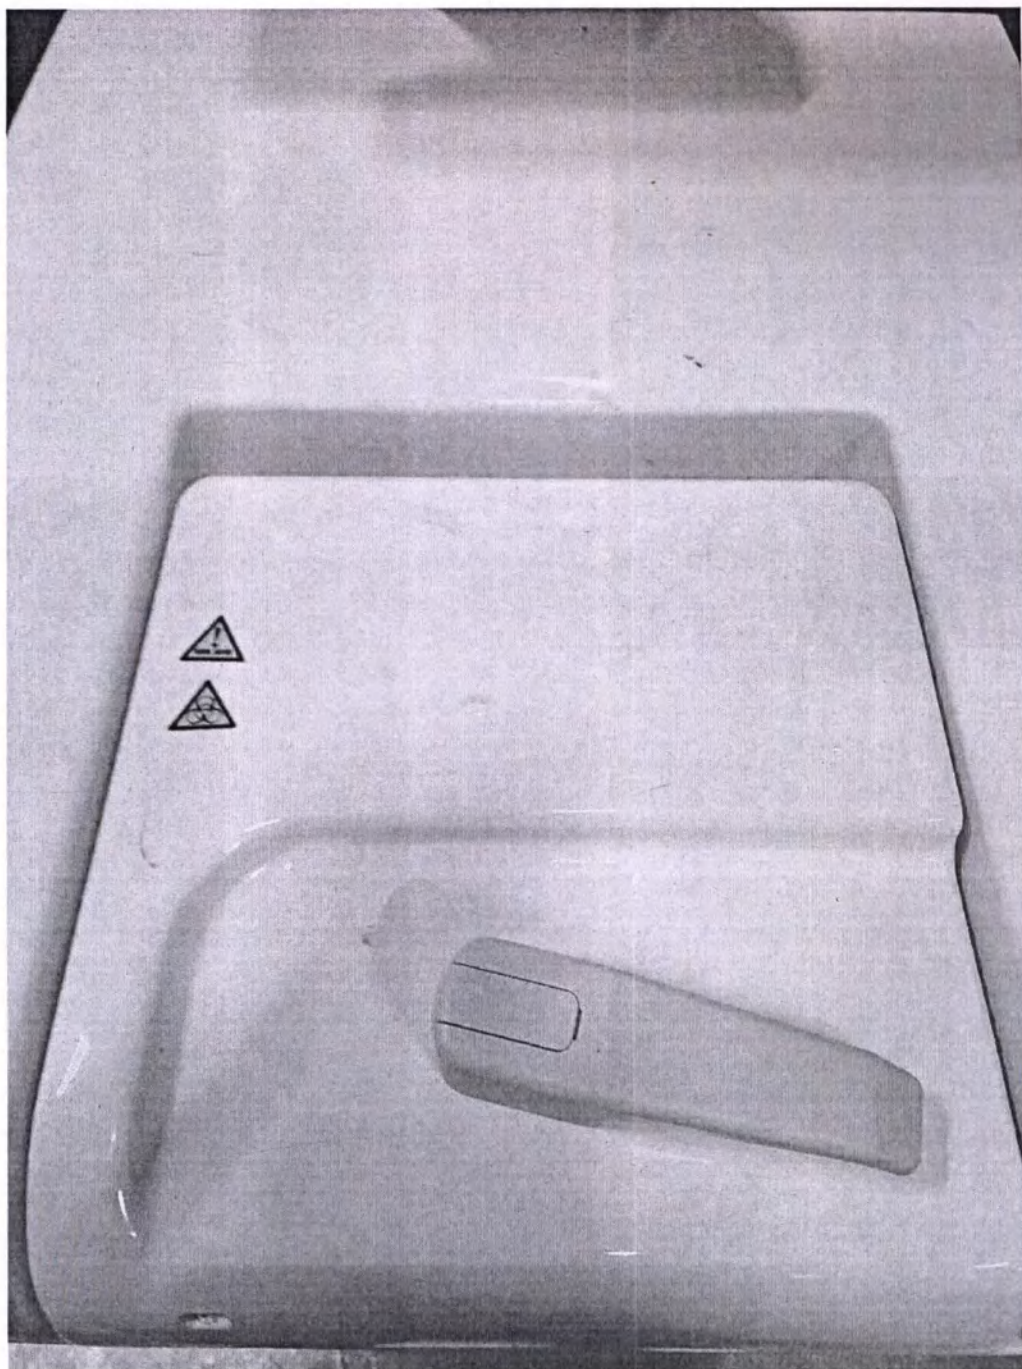


2. Аппарат для гистологической вакуумной проводки тканей Infiltra® NX01.300
2.1. Общий вид



2.2. Вид сверху

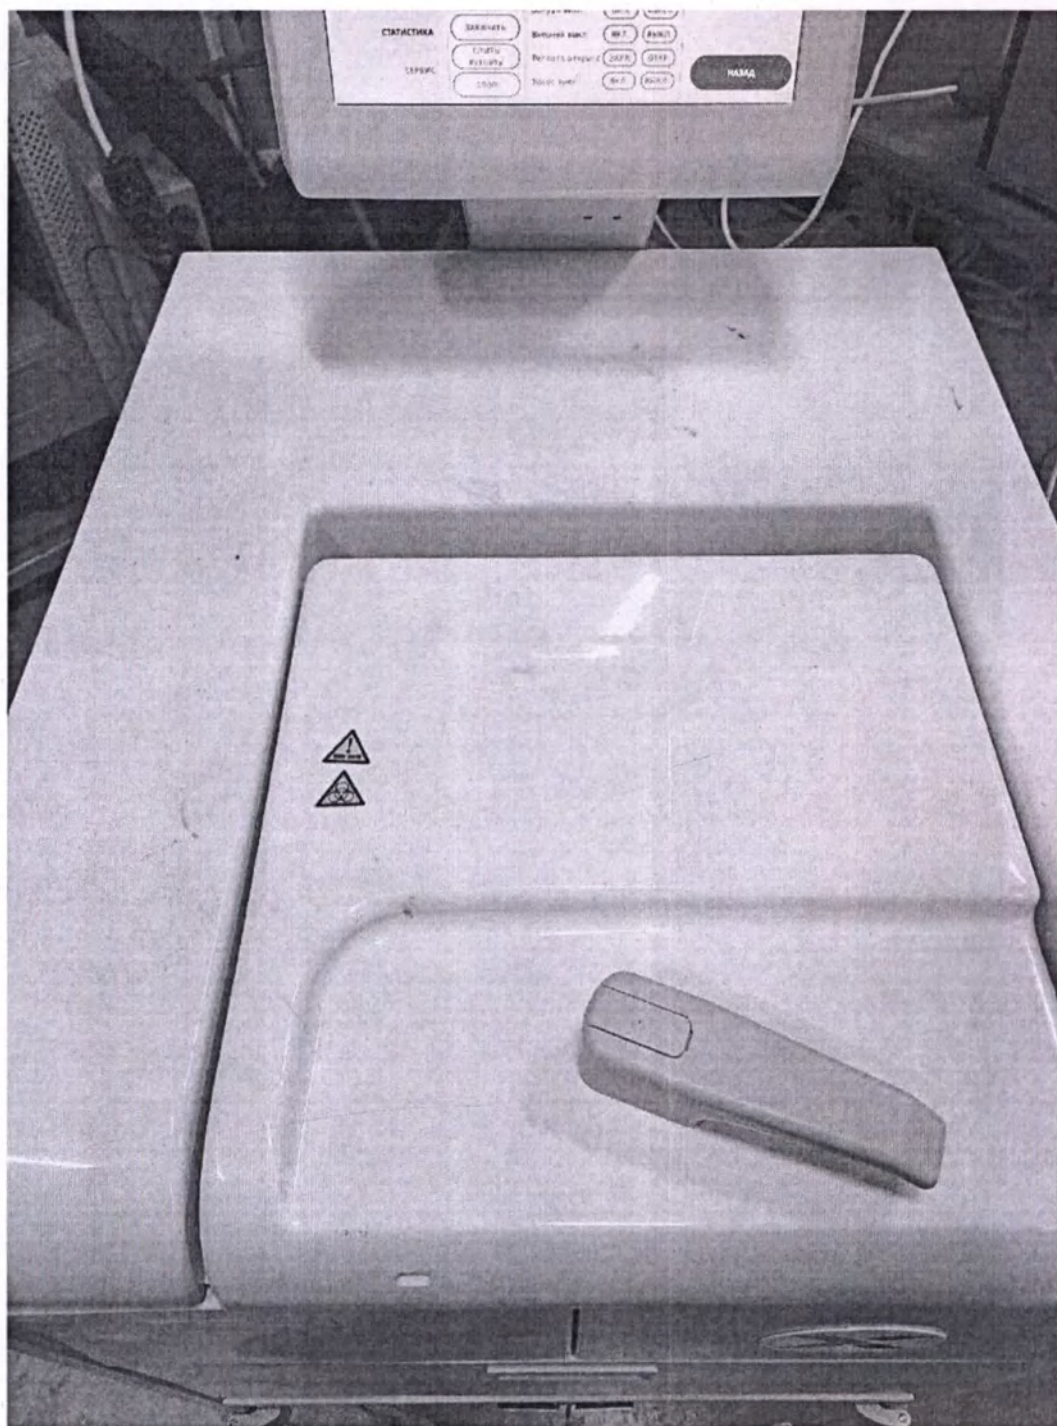


3. Зона маркировки и подключения на Аппарат для гистологической вакуумной проводки тканей Infiltra® NX01.150

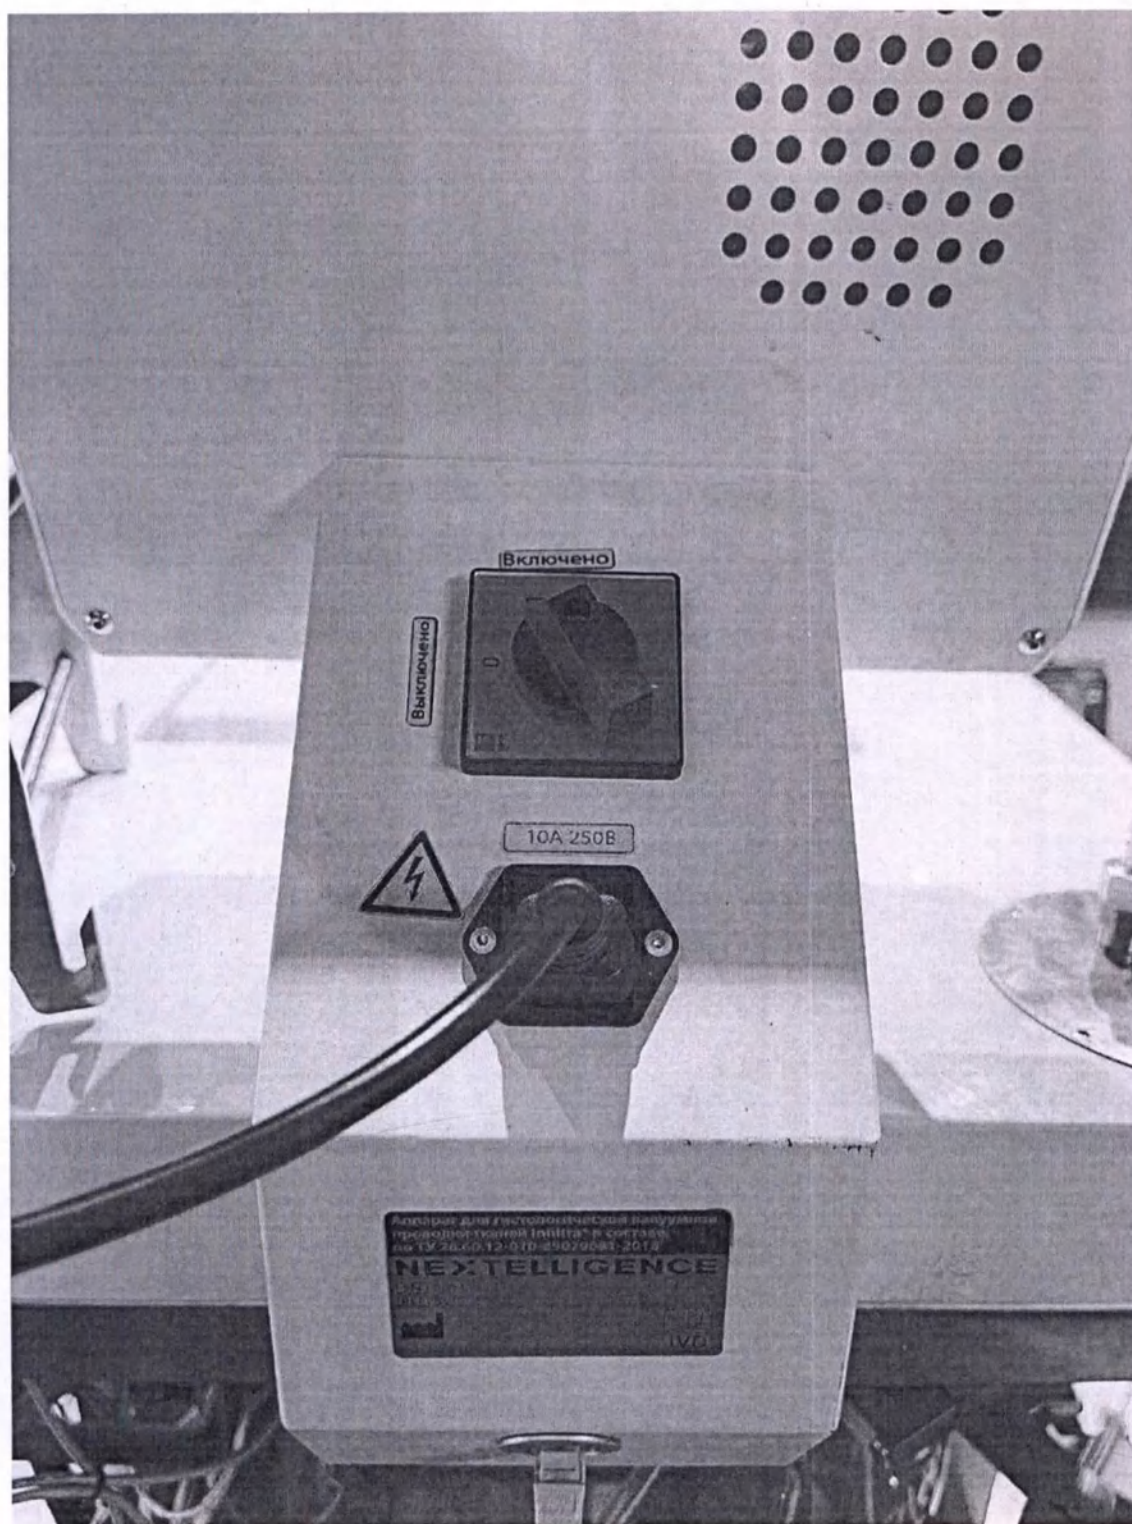


-
- Аппарат для гистологической вакуумной проводки тканей Infiltra®
- ## NEXTELLIGENCE
- | | | |
|------------|---------------|--------------------------------|
| ASN | 0015-0523 | BY 1923421798748 от 04.10.2022 |
| REF | BV-006-902-02 | DZ 26.60.2.015-89072981-0012 |
- ООО «Некстеллидженс»
г. Минск, ул. Мухоморова, д. 1
Полное наименование:
«Минск», ул. Мухоморова, д. 1
Регистрационный номер:

ИД
IVD
- ~220В±10%, 50-0,5Гц, 7400 ВА


5. RFID брелок для идентификации пользователя:

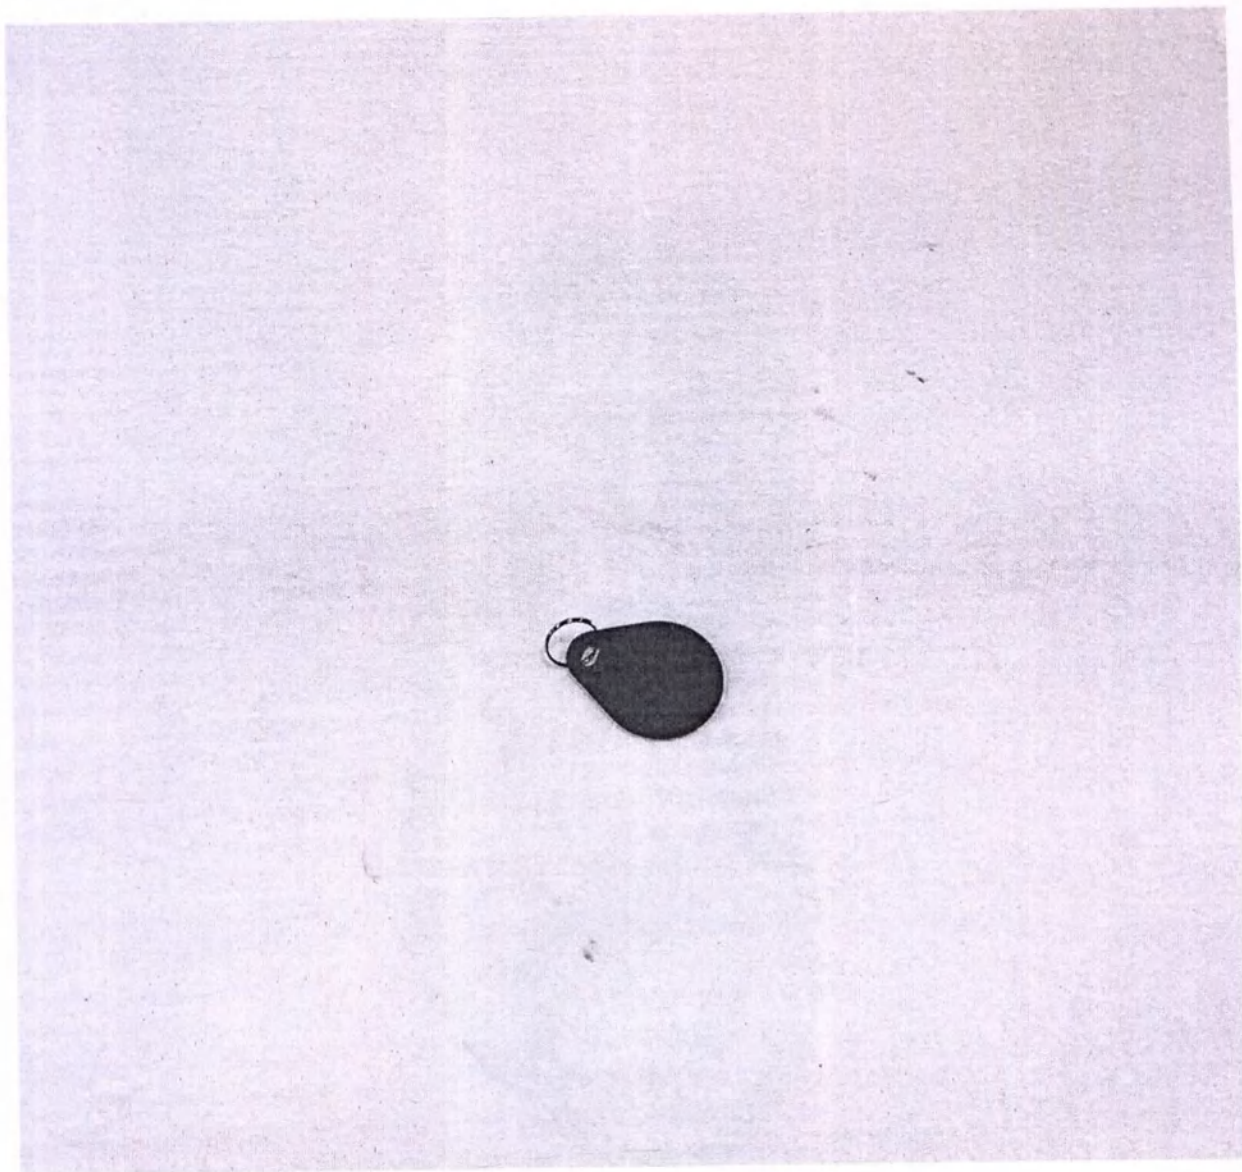


6. Кабель питания

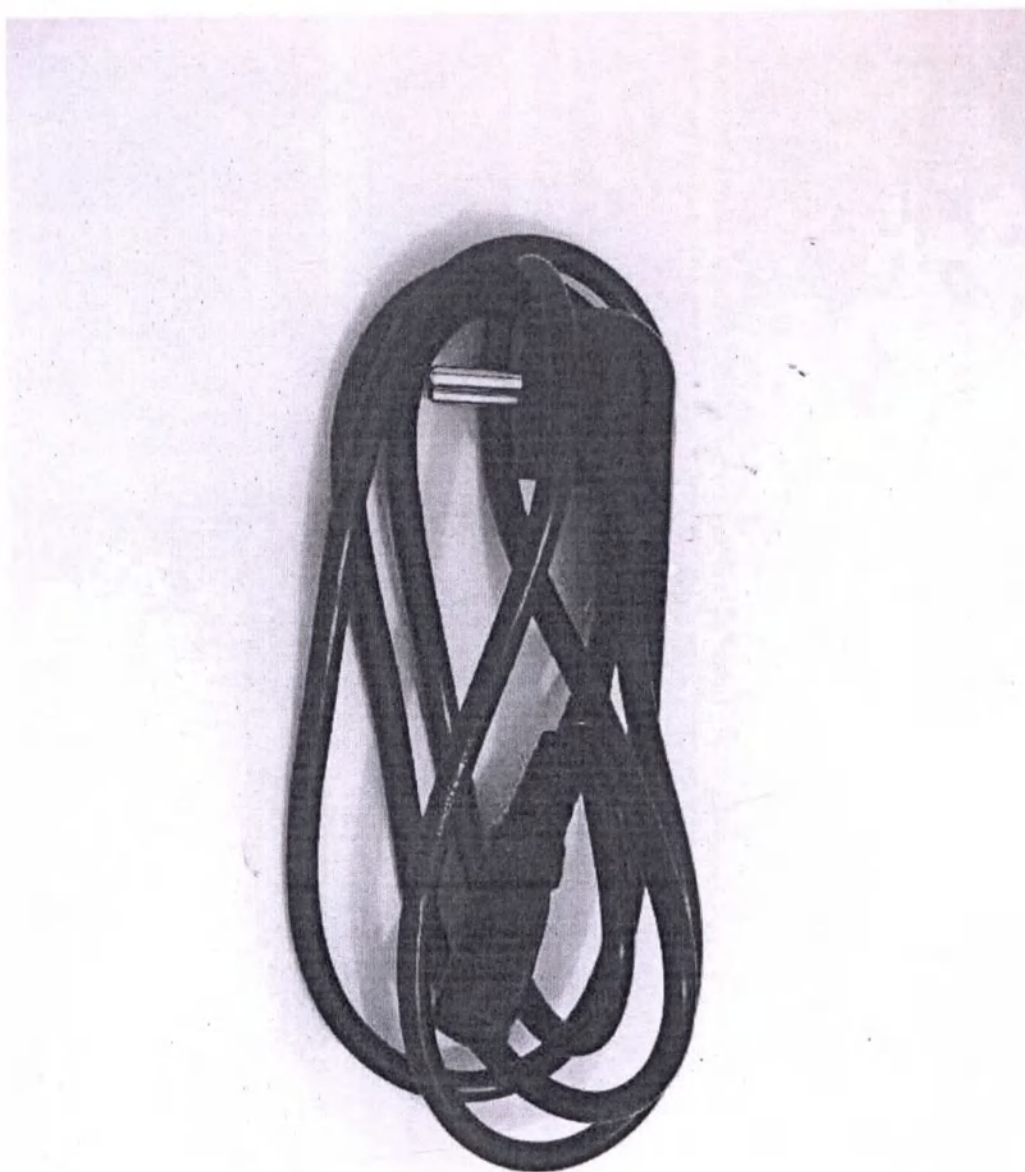


7. Корзина на 75 кассет для Аппарата для гистологической вакуумной проводки тканей Infiltra® NX01.150

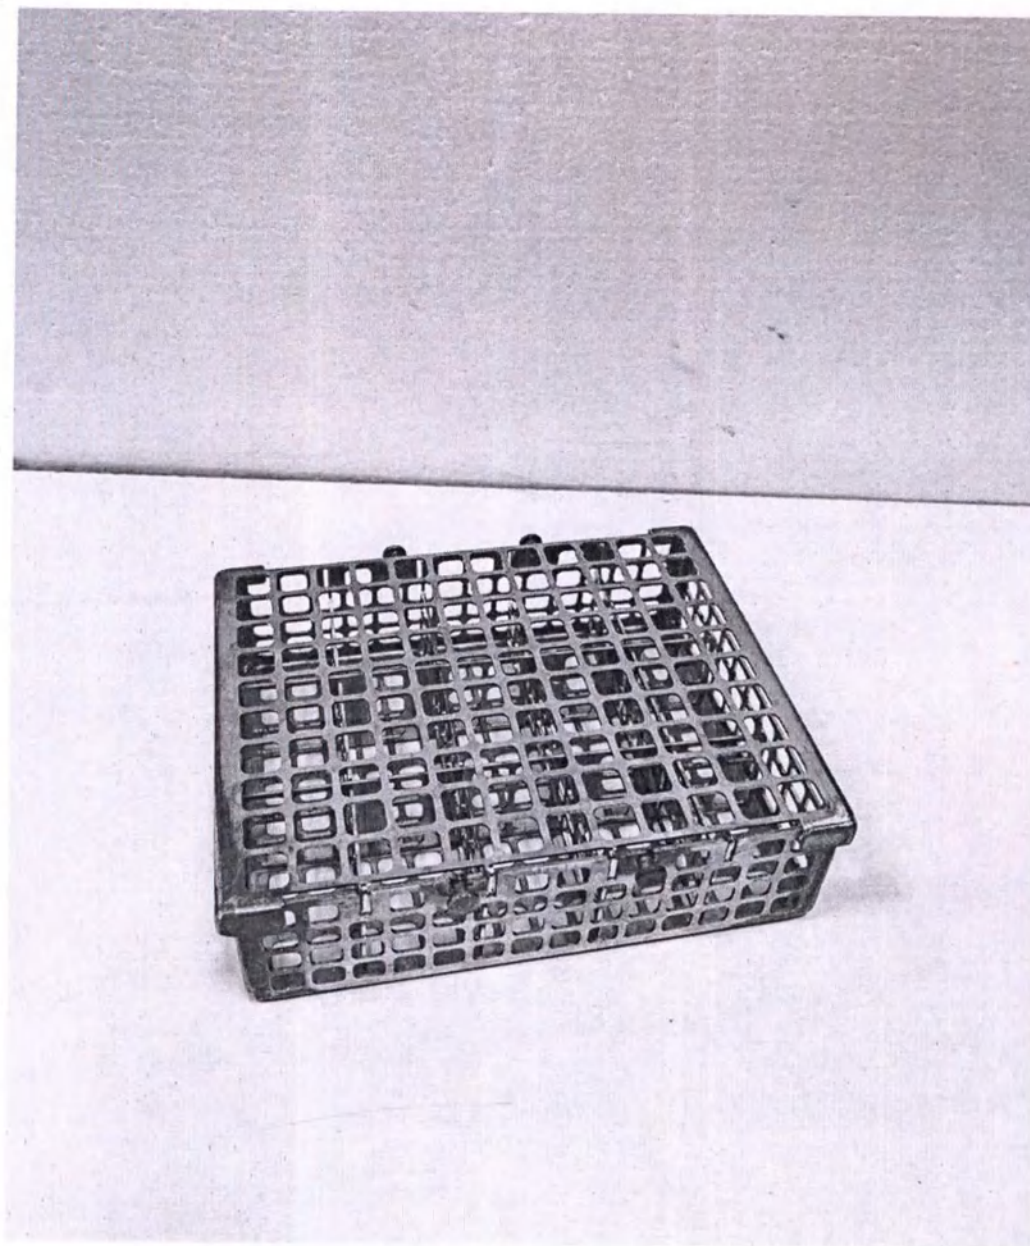


8. Корзина на 150 кассет для Аппарата для гистологической вакуумной проводки тканей Infiltra® NX01.300

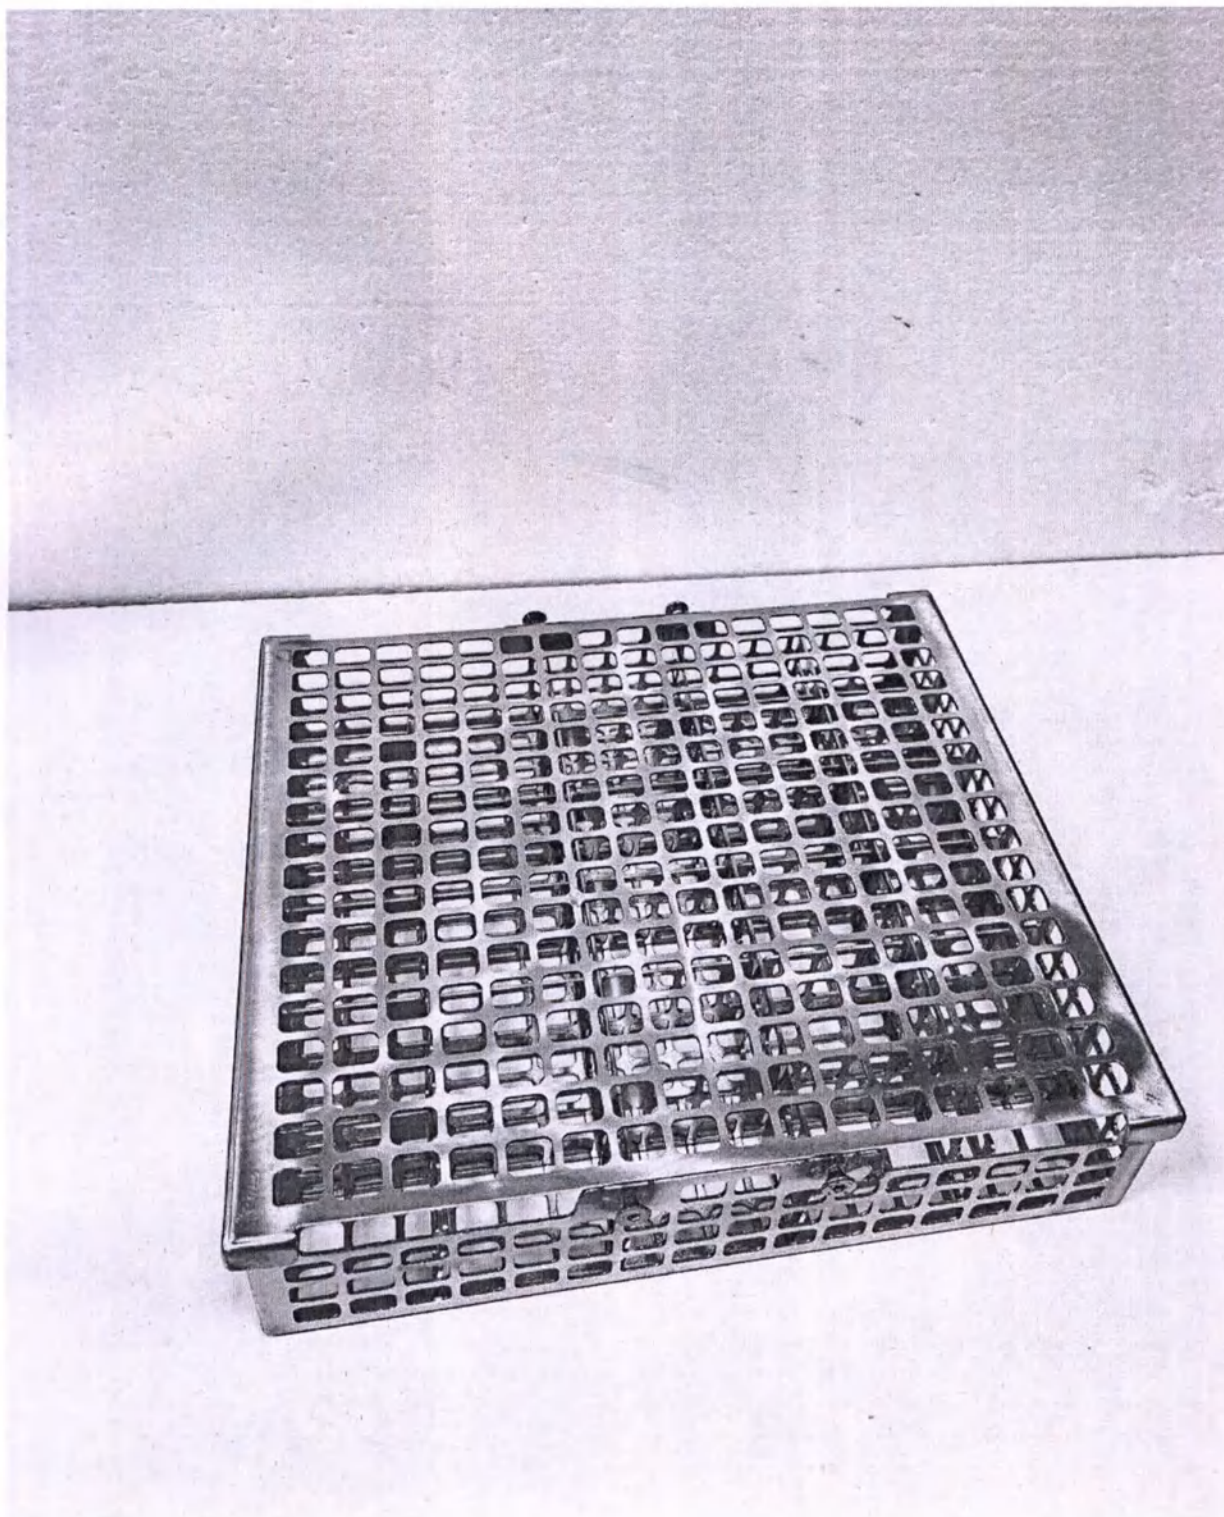


9. Экстрактор корзин

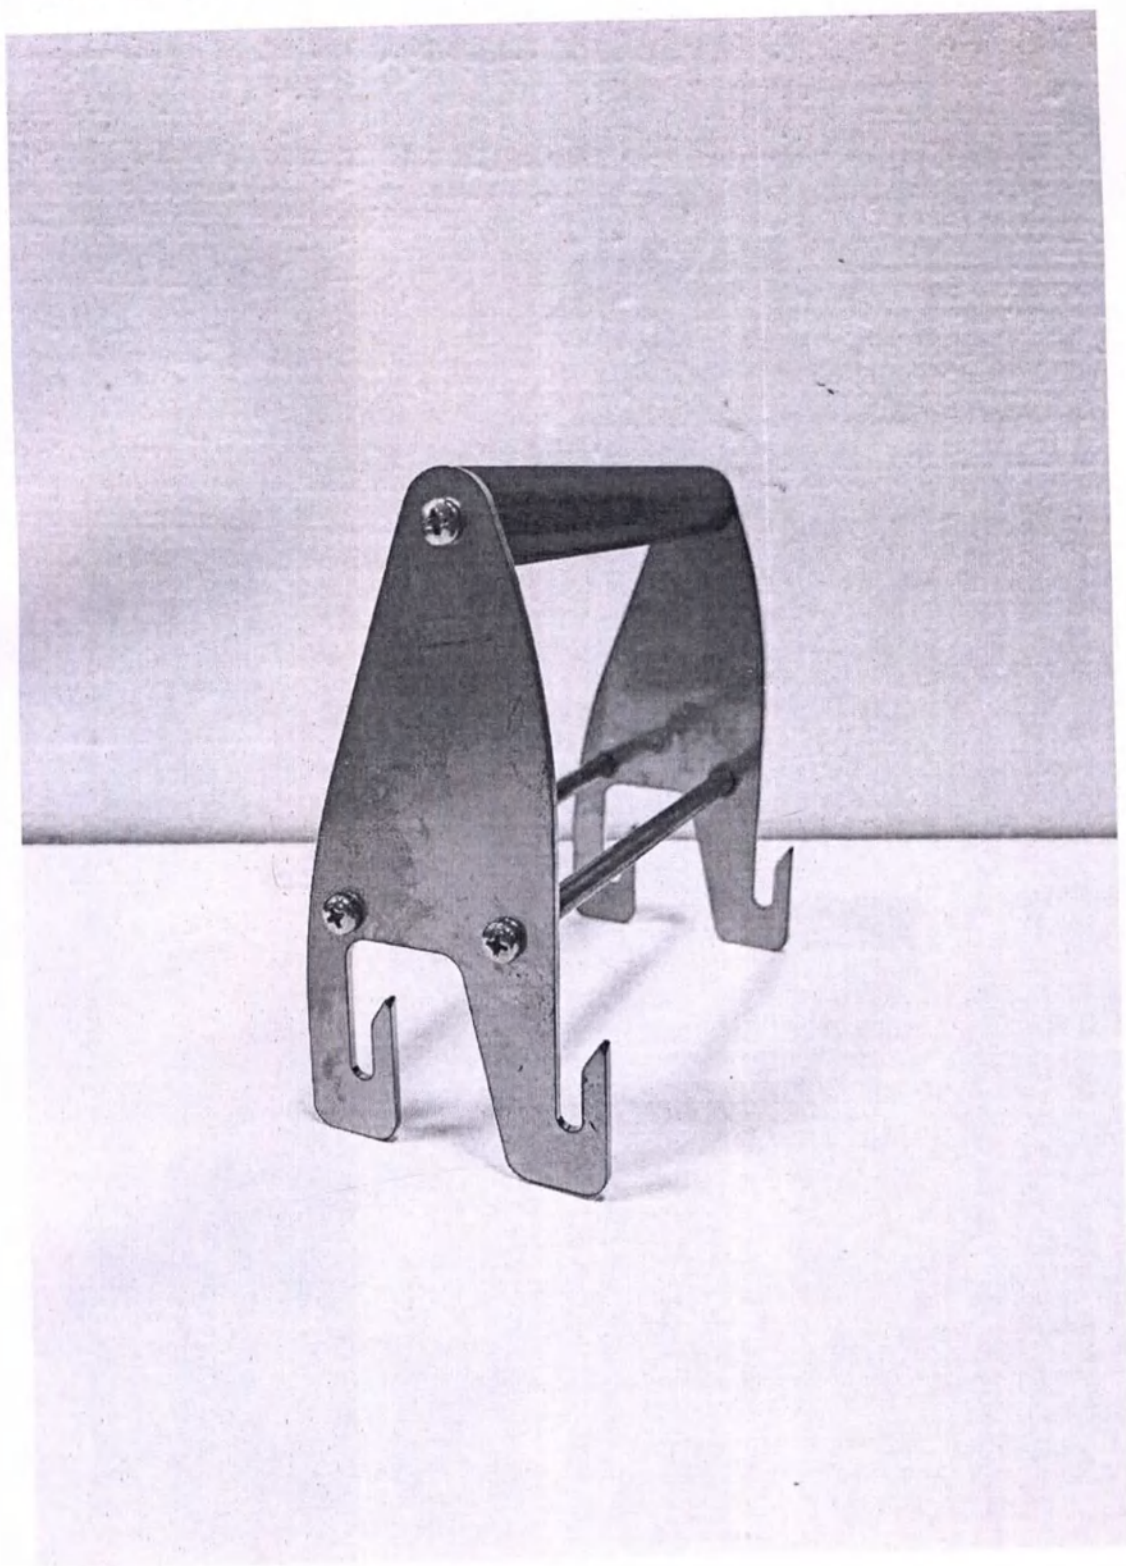


10. Трубка для внешнего слива

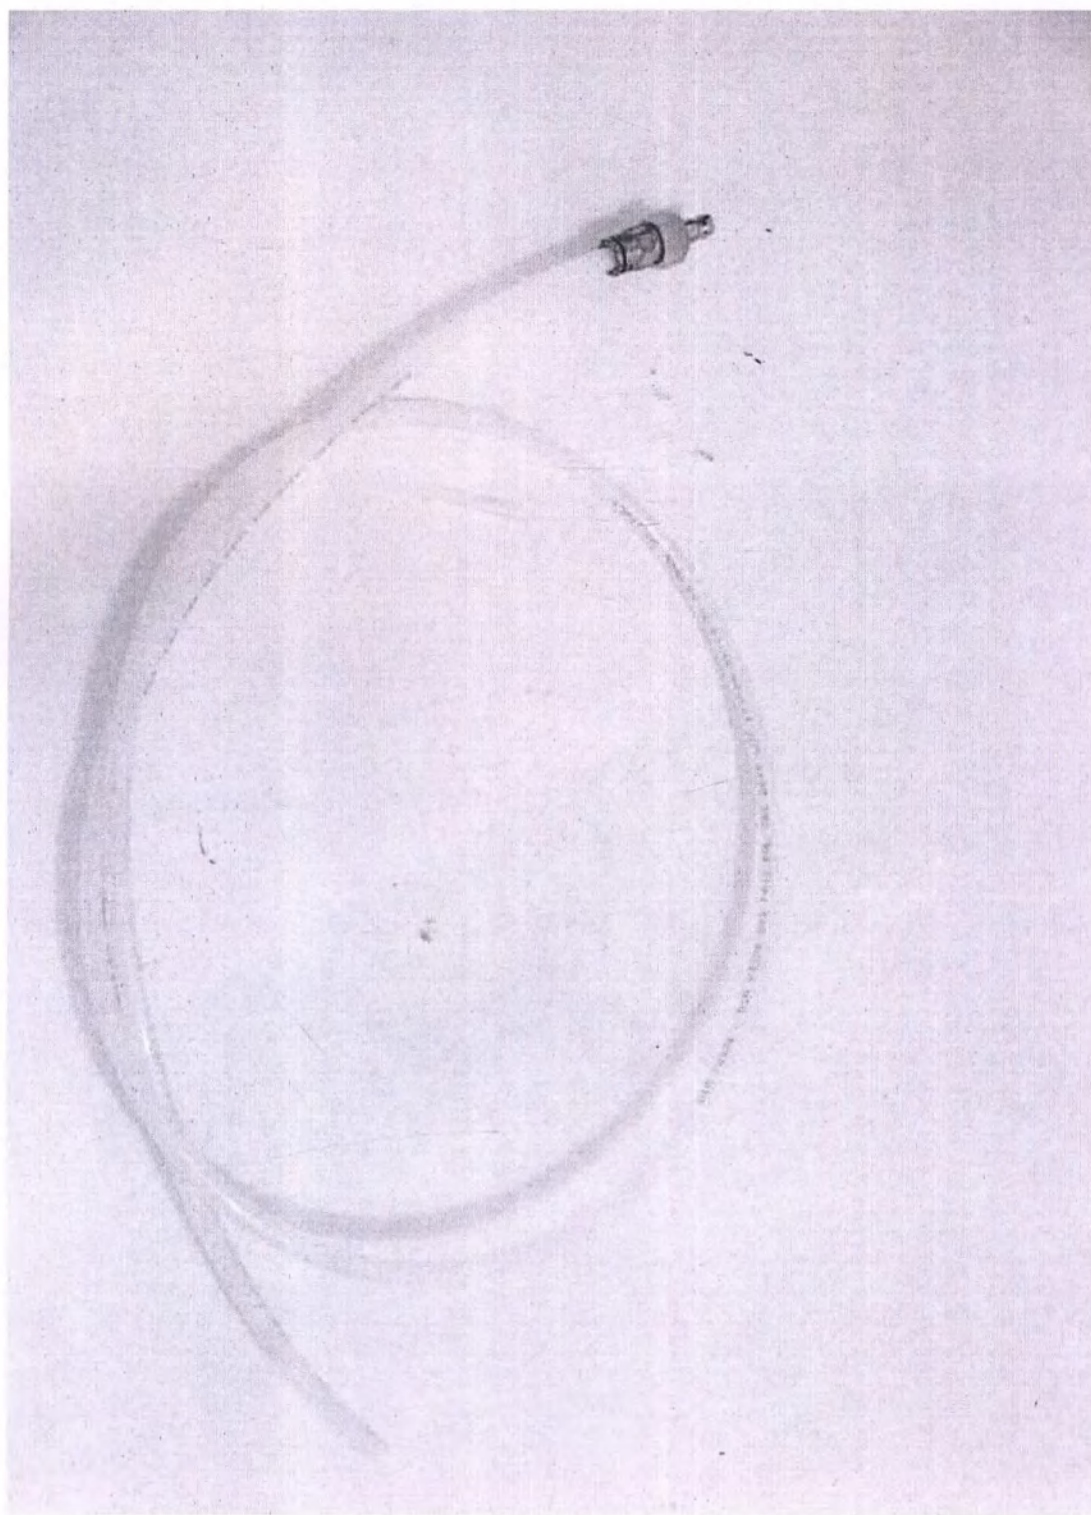


11. Угольный фильтр

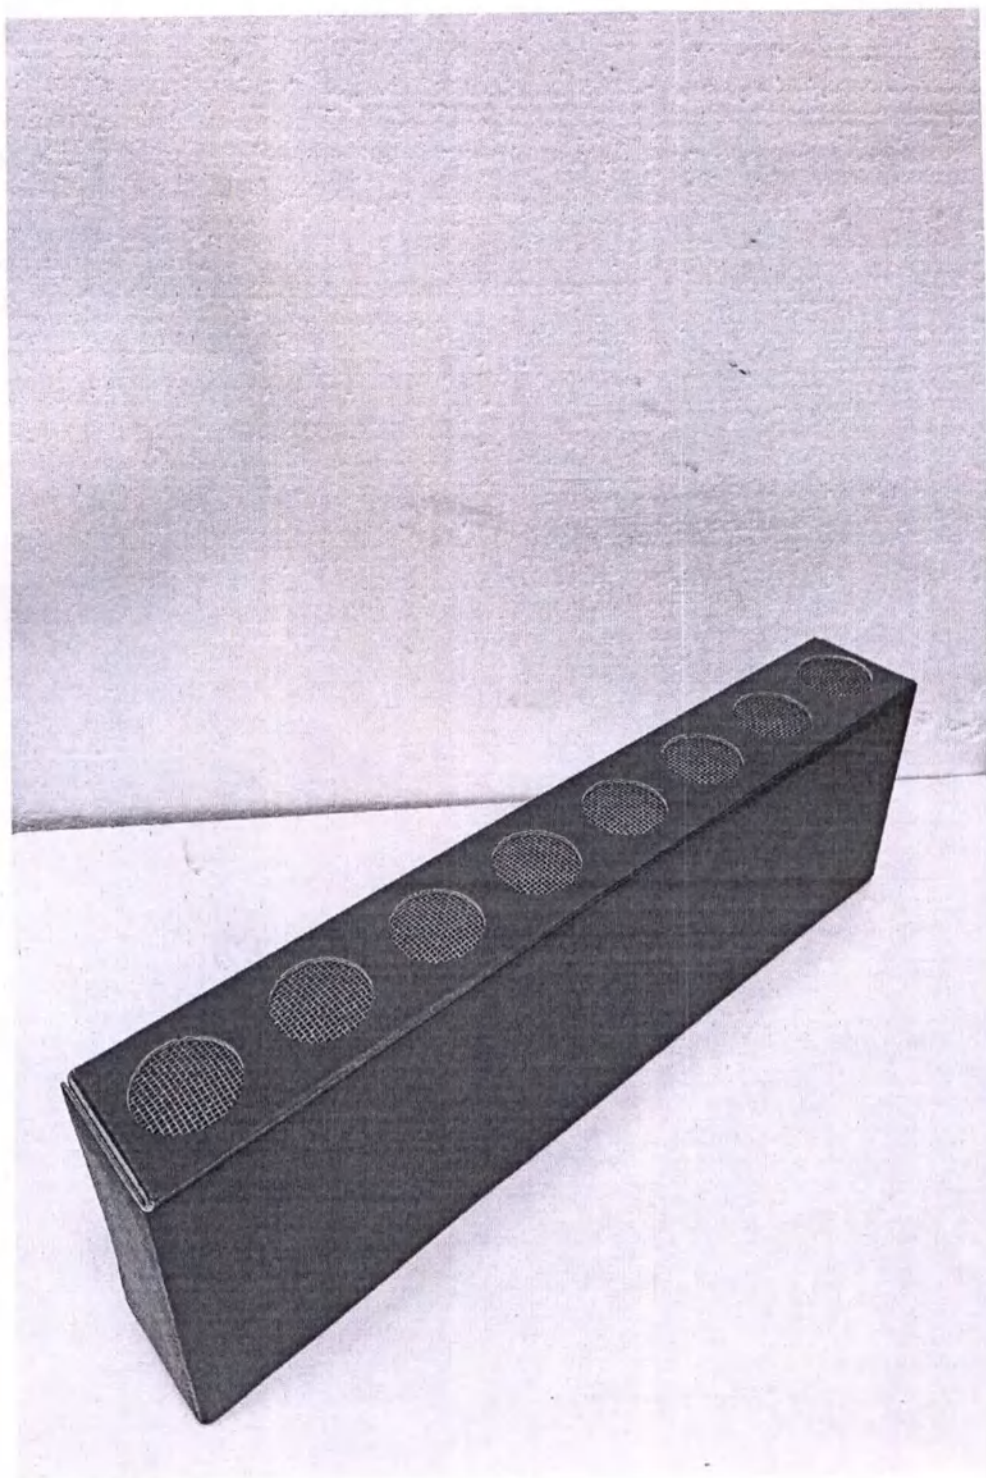


12. Канистра 3000 мл

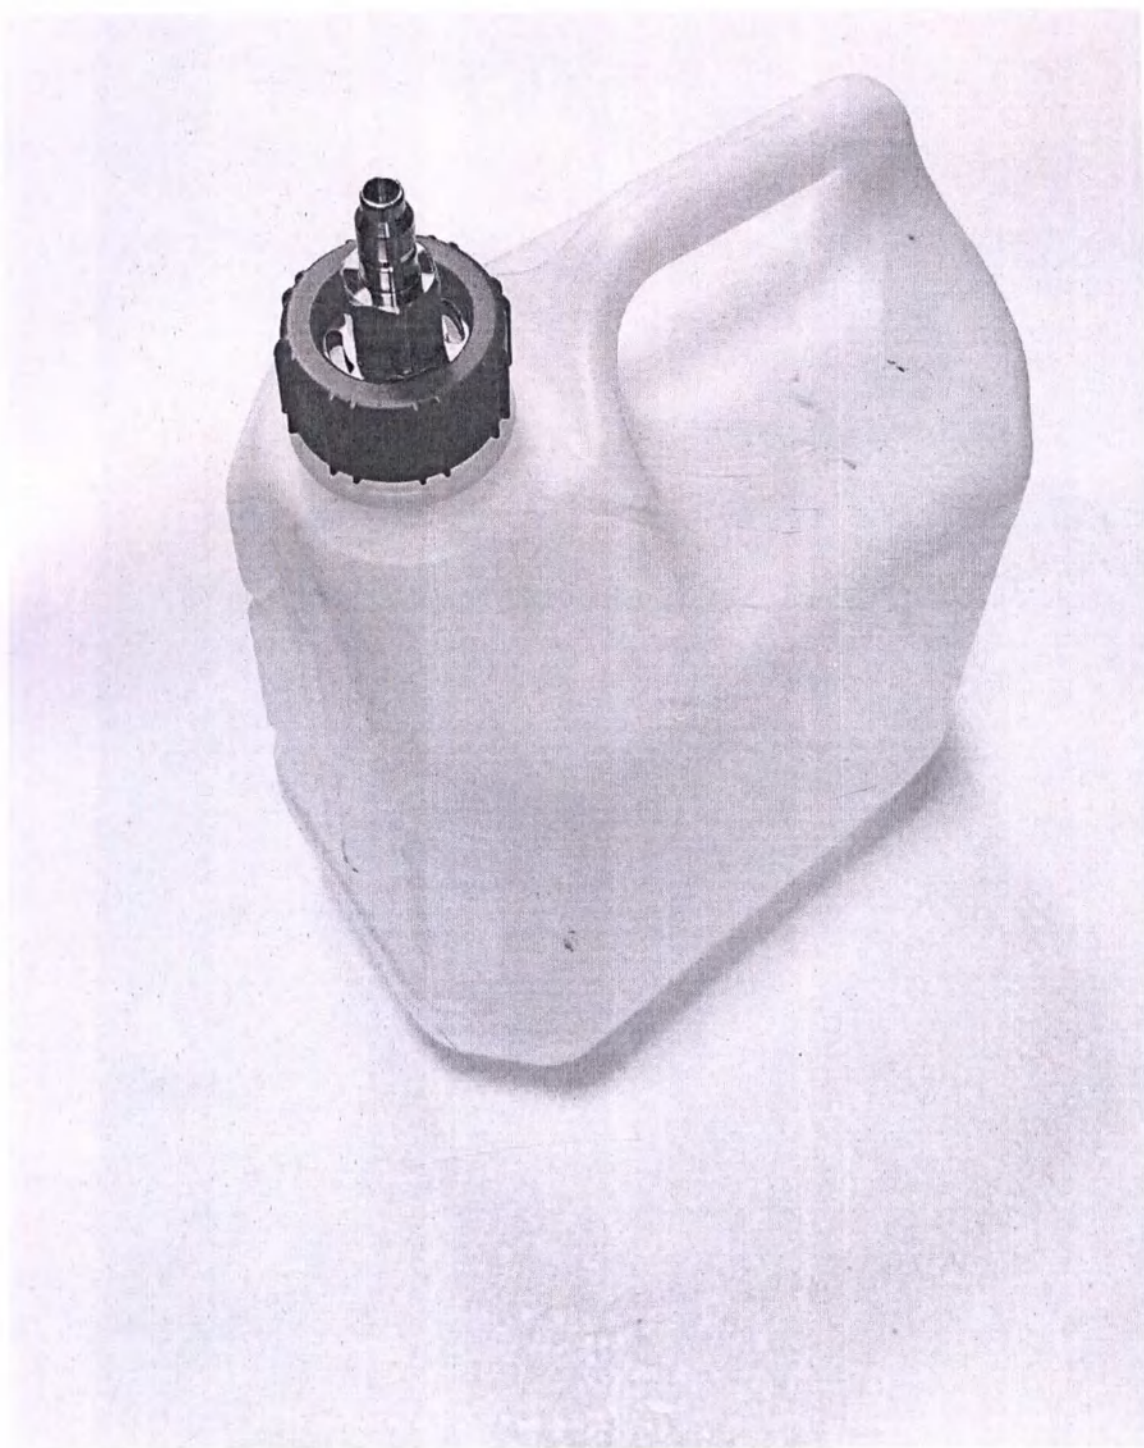


13. Руководство по эксплуатации

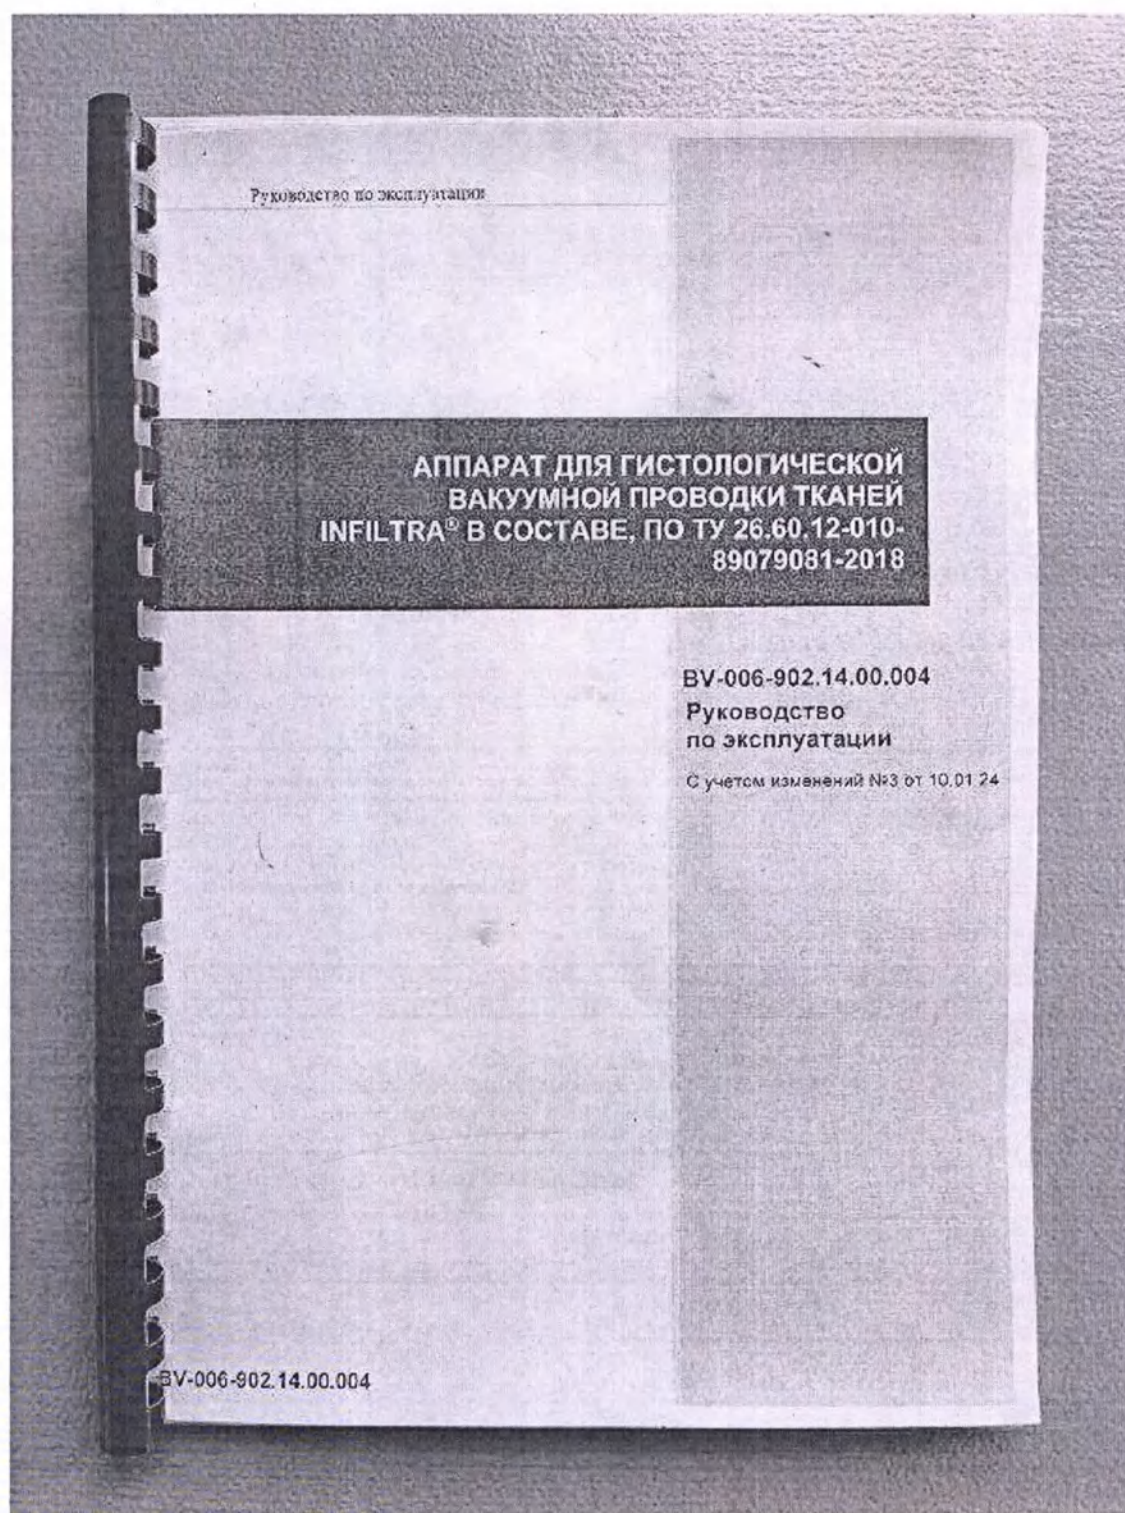


14. Резервуар для парафина

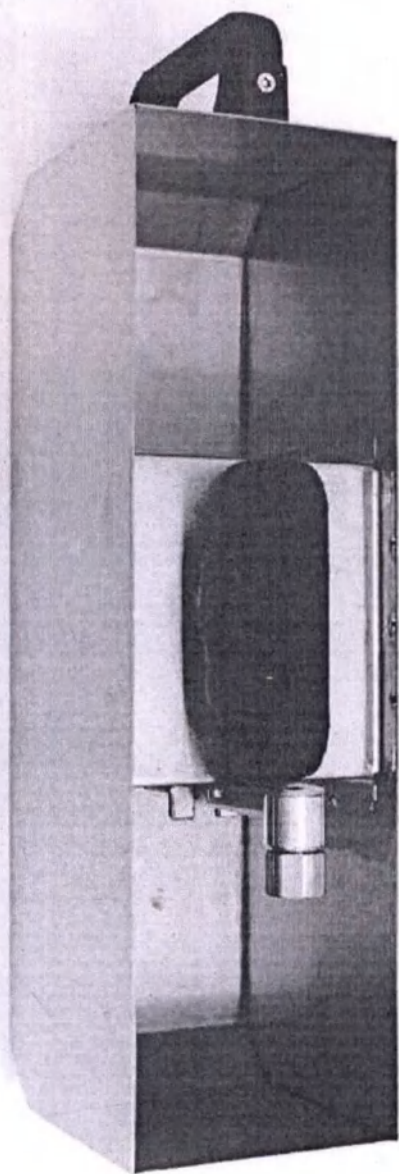


15. Лоток для накопления излишков парафина

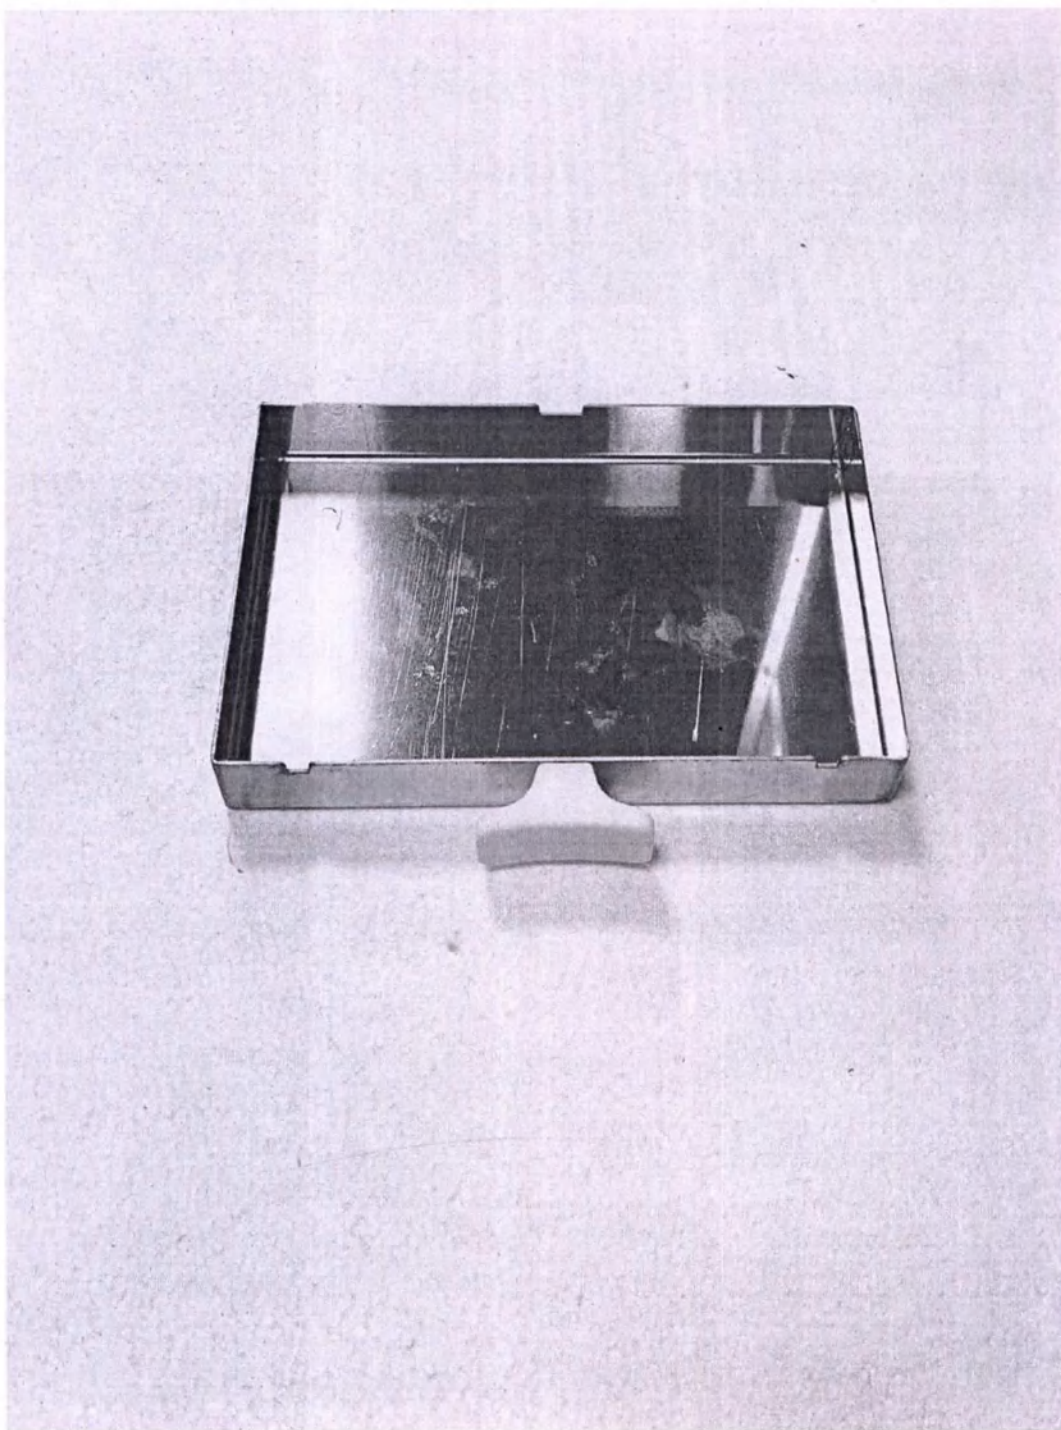


16. Набор идентификационных наклеек на канистры для Аппарата для гистологической вакуумной проводки тканей Infiltra® NX01.150

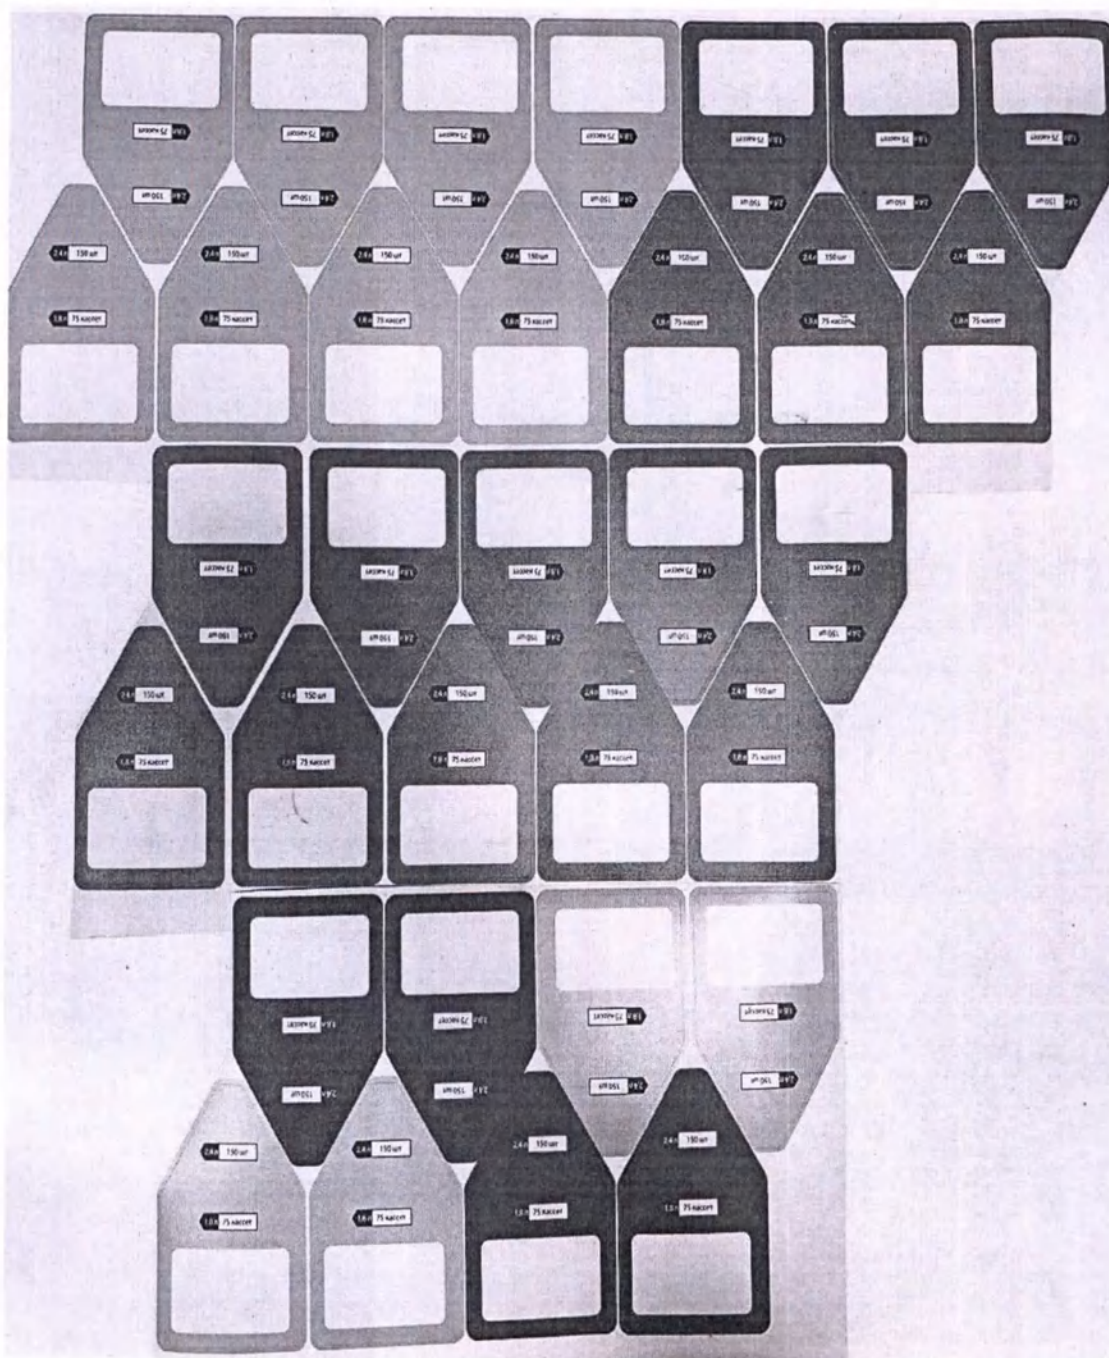

17. Набор идентификационных наклеек на канистры для Аппарата для гистологической вакуумной проводки тканей Infiltra® NX01.300

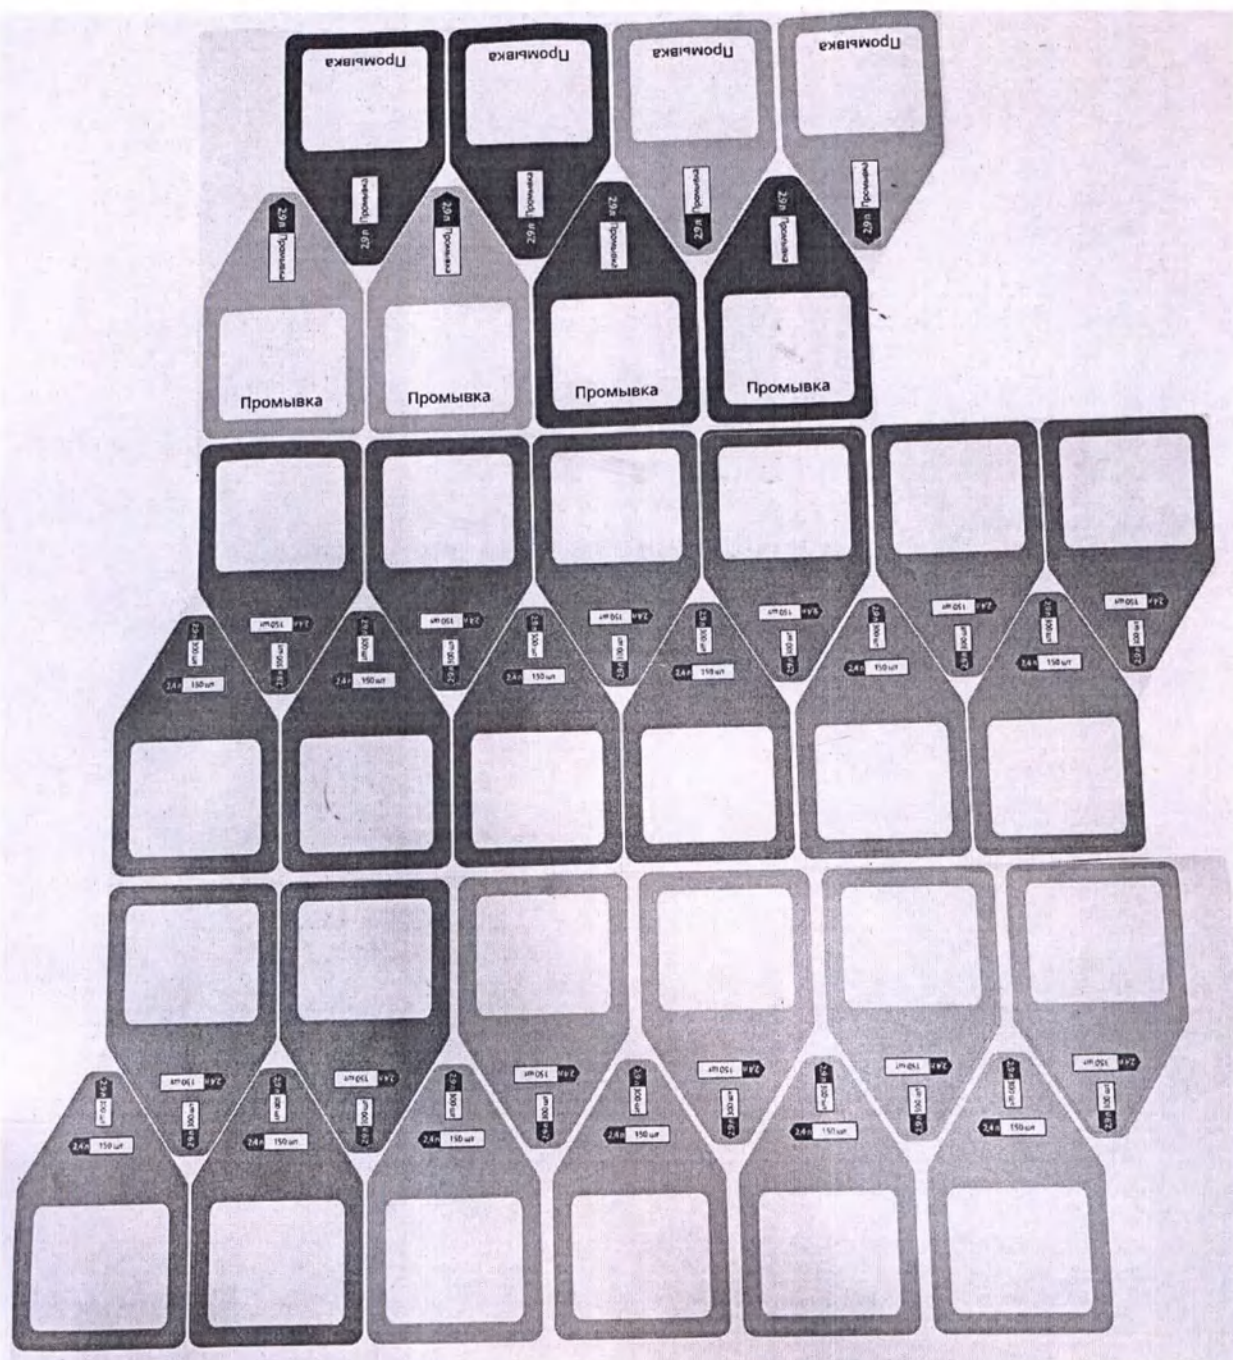

18. USB карта памяти, 16 Гб

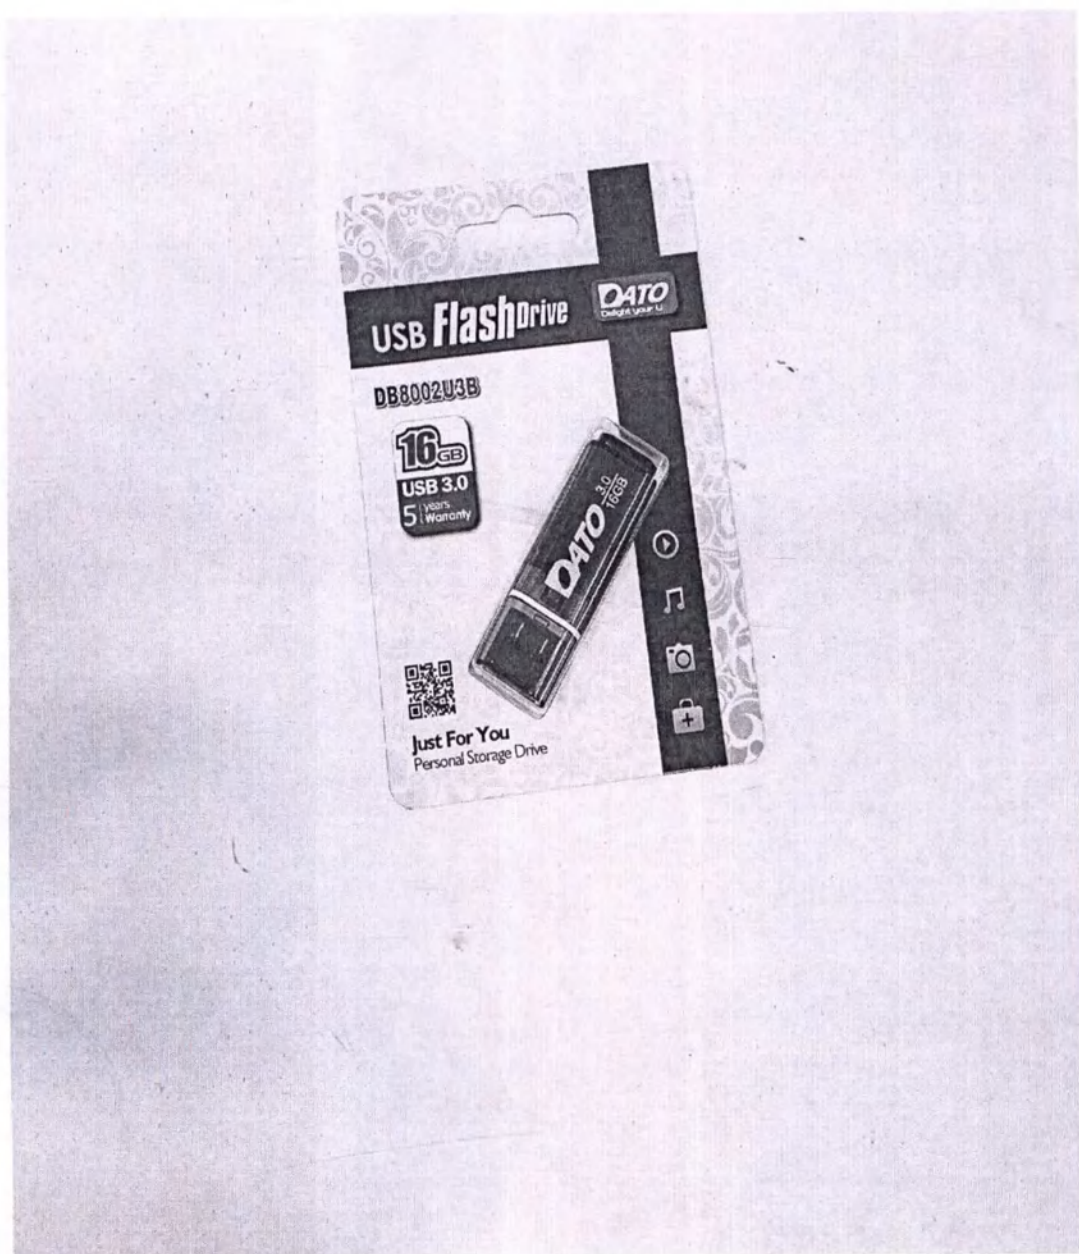

прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 2.1 лист(ов)

Генеральный директор
ООО «Некстэллдженс»

О.А. Гревцов
«28» июня 2024 г.

