

Макет маркировки на медицинское изделие

Набор реагентов для количественного определения мочевины в сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT "Мочевина2 Реагенты для ARCHITECT (Urea Nitrogen2)"

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Мочевина2 Реагенты для ARCHITECT (Urea Nitrogen2), Кат. № 04T1220



04T1220



Набор реагентов для количественного определения мочевины в сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT "Мочевина2 Реагенты для ARCHITECT (Urea Nitrogen2)"

4 комплекта картриджей по 350 тестов в составе: 1. Реагент 1 (Urea Nitrogen2 R1) – 4 x 24,8 мл; 2. Реагент 2 (Urea Nitrogen2 R2) – 4 x 10,0 мл; 3. Инструкция по применению – 1 шт. / Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия. / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland. / Страна происхождения: Ирландия / РУ № _____ / от _____. / Инструкция по применению на русском языке: [www. www.corelaboratory.abbott/IFU/](http://www.corelaboratory.abbott/IFU/) Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.

Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1
Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет маркировки медицинского изделия для обращения на территории Российской Федерации
Мочевина2 Реагенты для ARCHITECT (Urea Nitrogen2), Кат. № 04T1230



04T1230




Набор реагентов для количественного определения мочевины в сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT "Мочевина2 Реагенты для ARCHITECT (Urea Nitrogen2)"

4 комплекта картриджей по 1450 тестов в составе: 1. Реагент 1 (Urea Nitrogen2 R1) – 4 x 53,9 мл; 2. Реагент 2 (Urea Nitrogen2 R2) – 4 x 33,1 мл; 3. Инструкция по применению – 1 шт. / Производитель: «Эбботт Ирландия Диагностическое подразделение» (Abbott Ireland Diagnostics Division), Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland, Ирландия. / Место производства: Abbott Ireland Diagnostics Division, Lisnamuck, Longford, Co. Longford, Ireland. / Страна происхождения: Ирландия / РУ № _____ / от _____. / Инструкция по применению на русском языке: [www. www.corelaboratory.abbott/IFU/](http://www.corelaboratory.abbott/IFU/) Серия, использовать до, условия хранения указаны в графических символах. Расшифровку графических символов см. в инструкции.



Авторизованный представитель изготовителя на территории России:

ООО «Эбботт Лэбораториз», 125171, Россия, г. Москва, Ленинградское шоссе, 16А, стр. 1
Тел: +7 (495) 258 42 80; Факс: +7 (495) 258 42 81

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Мочевина2 Реагенты для ARCHITECT (Urea Nitrogen2), Кат. № 04T1220

Urea2	 Urea Nitrogen2 FOR USE WITH ARCHITECT
R1 4 x 24.8 mL	
R2 4 x 10.0 mL	
	CONTAINS: AZIDE
	IVD
	
REF 04T1220	 4 x 350
 www.corelaboratory.abbott/IFU	Версия
 Exp.	Двумерный штрих-код
LOT	
G93368R01	Уникальный идентификатор изделия (код)
 Abbott Ireland Diagnostics Division Lisnamuck, Longford Co. Longford Ireland +353-43-3331000 PRODUCT OF IRELAND	

Макет оригинальной маркировки медицинского изделия Мочевина2 Реагенты для ARCHITECT (Urea Nitrogen2), Кат. № 04T1230

Urea2	 Urea Nitrogen2 FOR USE WITH ARCHITECT
R1 4 x 53.9 mL	
R2 4 x 33.1 mL	
	CONTAINS: AZIDE
	IVD
	
REF 04T1230	 4 x 1450
 www.corelaboratory.abbott/IFU	Версия
 Exp.	Двумерный штрих-код
LOT	
G93367R01	Уникальный идентификатор изделия (код)
 Abbott Ireland Diagnostics Division Lisnamuck, Longford Co. Longford Ireland +353-43-3331000 PRODUCT OF IRELAND	

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Мочевина2 Реагенты для ARCHITECT (Urea Nitrogen2), Кат. № 04T1220

G93371R01 ABBOTT AIDD Longford, Ireland Штрих-код FOR USE WITH ARCHITECT Urea2 IVD REF 04T12R R1 24.8 mL CONTAINS: AZIDE 2°C 8°C SN Exp. LOT Abbott	G93371R01 Urea2 R1
G93372R01 ABBOTT AIDD Longford, Ireland Штрих-код FOR USE WITH ARCHITECT Urea2 IVD REF 04T12T R2 10.0 mL CONTAINS: AZIDE 2°C 8°C SN Exp. LOT Abbott	G93372R01 Urea2 R2

Макет маркировки компонентов медицинского изделия Мочевина2 Реагенты для ARCHITECT (Urea Nitrogen2), Кат. № 04T1230

G93369R01 ABBOTT AIDD Longford, Ireland Штрих-код	FOR USE WITH ARCHITECT Urea2 IVD REF 04T12R R1 53.9 mL CONTAINS: AZIDE 2°C 8°C Abbott SN Exp. LOT	R1 Urea2 G93369R01
G93370R01 ABBOTT AIDD Longford, Ireland Штрих-код	FOR USE WITH ARCHITECT Urea2 IVD REF 04T12T R2 33.1 mL CONTAINS: AZIDE 2°C 8°C Abbott SN Exp. LOT	R2 Urea2 G93370R01

Всего прошито и пронумеровано





Общество с ограниченной ответственностью "Эбботт Лэбораториз"
125171, Москва, Ленинградское шоссе, д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80


Факс: (495) 258 42 81


abbott-russia@abbott.com

Фотографические изображения общего вида медицинского изделия


Набор реагентов для количественного определения мочевины в сыворотке и плазме крови, или моче человека энзиматическим спектрофотометрическим методом на биохимических анализаторах ARCHITECT "Мочевина2 Реагенты для ARCHITECT (Urea Nitrogen2)"


Фотографическое изображение общего вида упаковки МИ Мочевина2 Реагенты для ARCHITECT (Urea Nitrogen2), Кат. № 04T1220

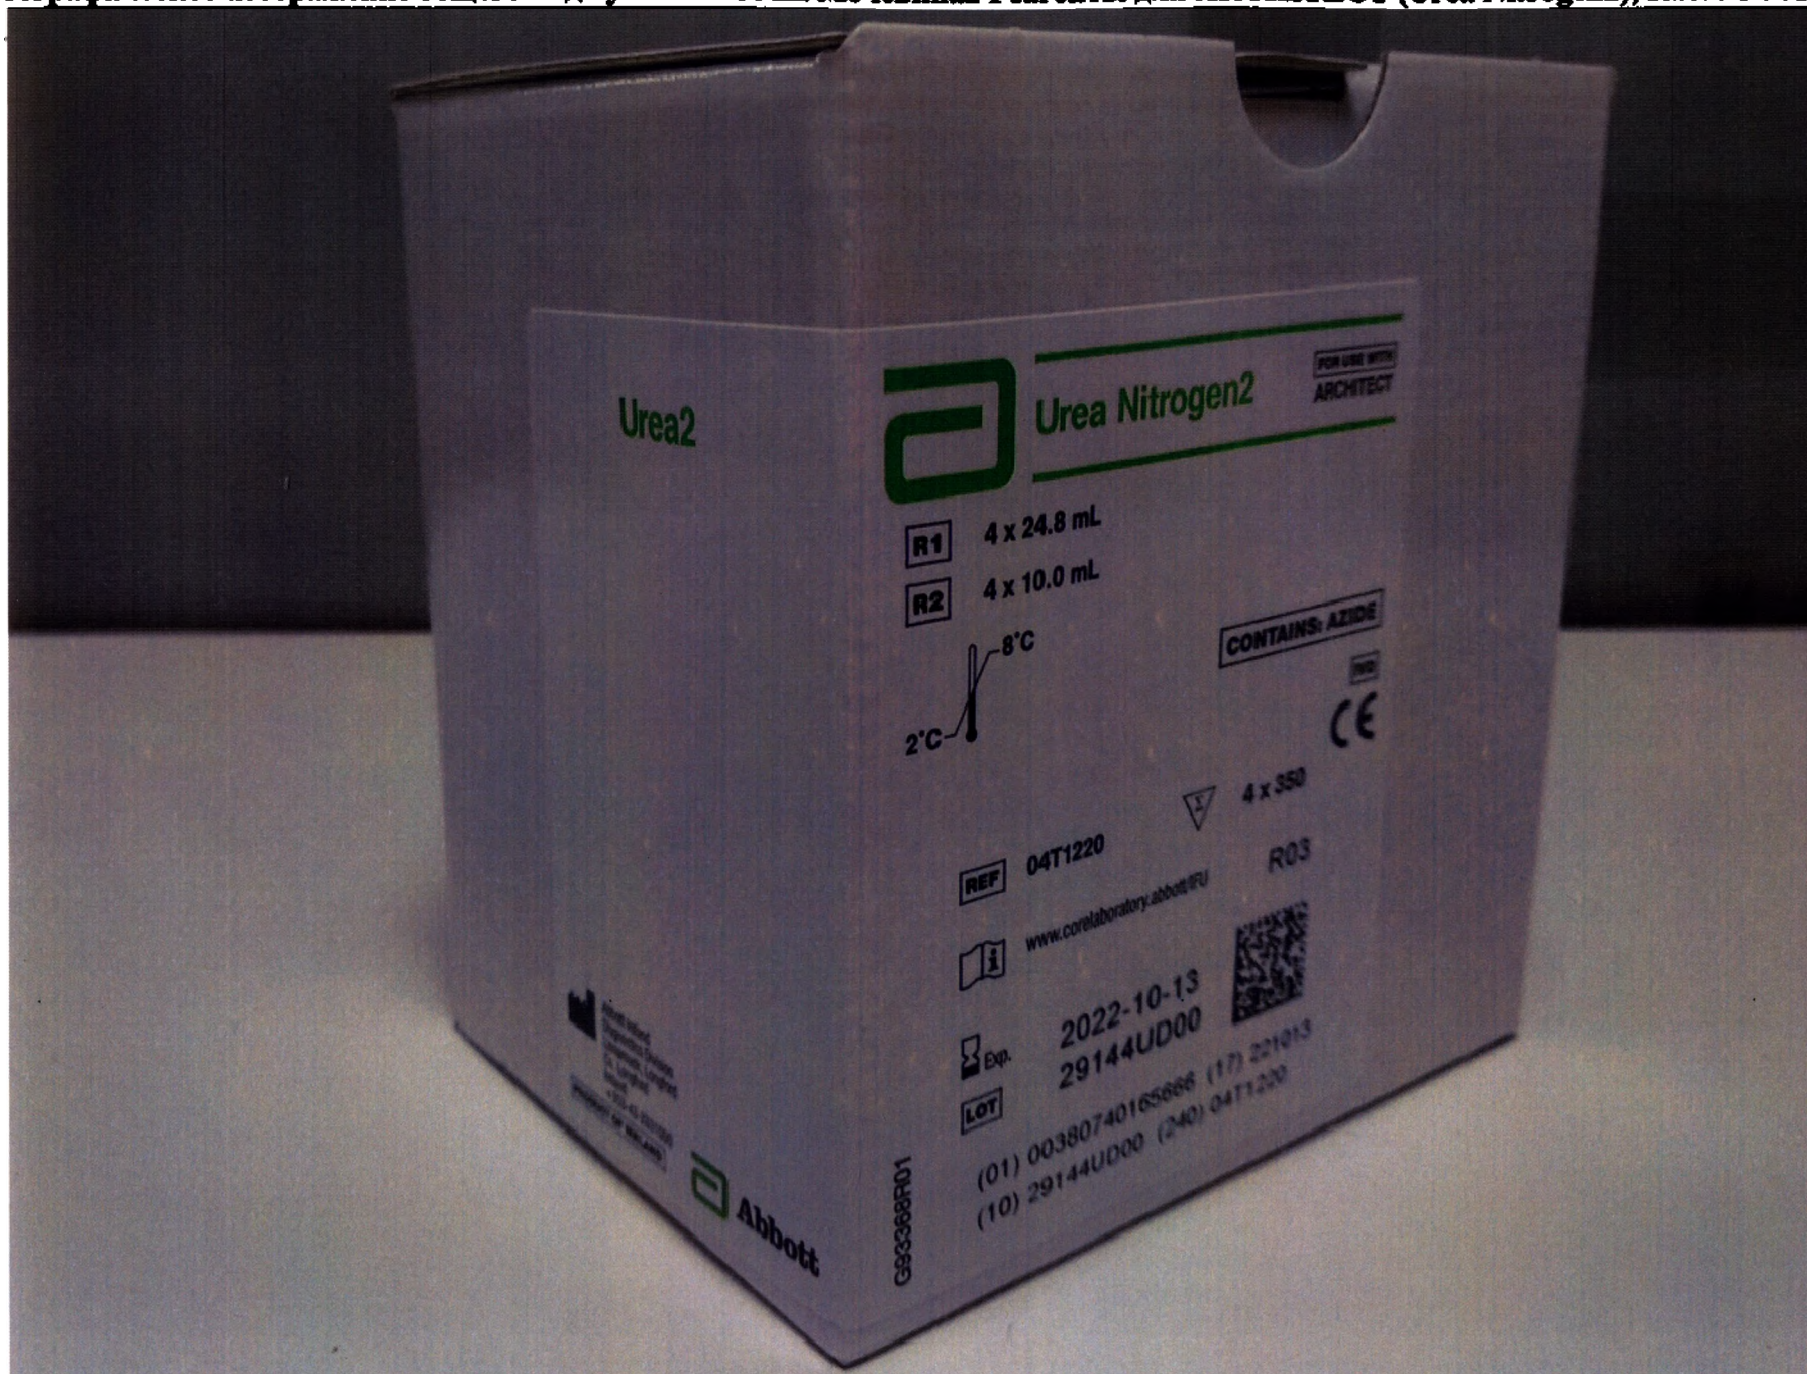


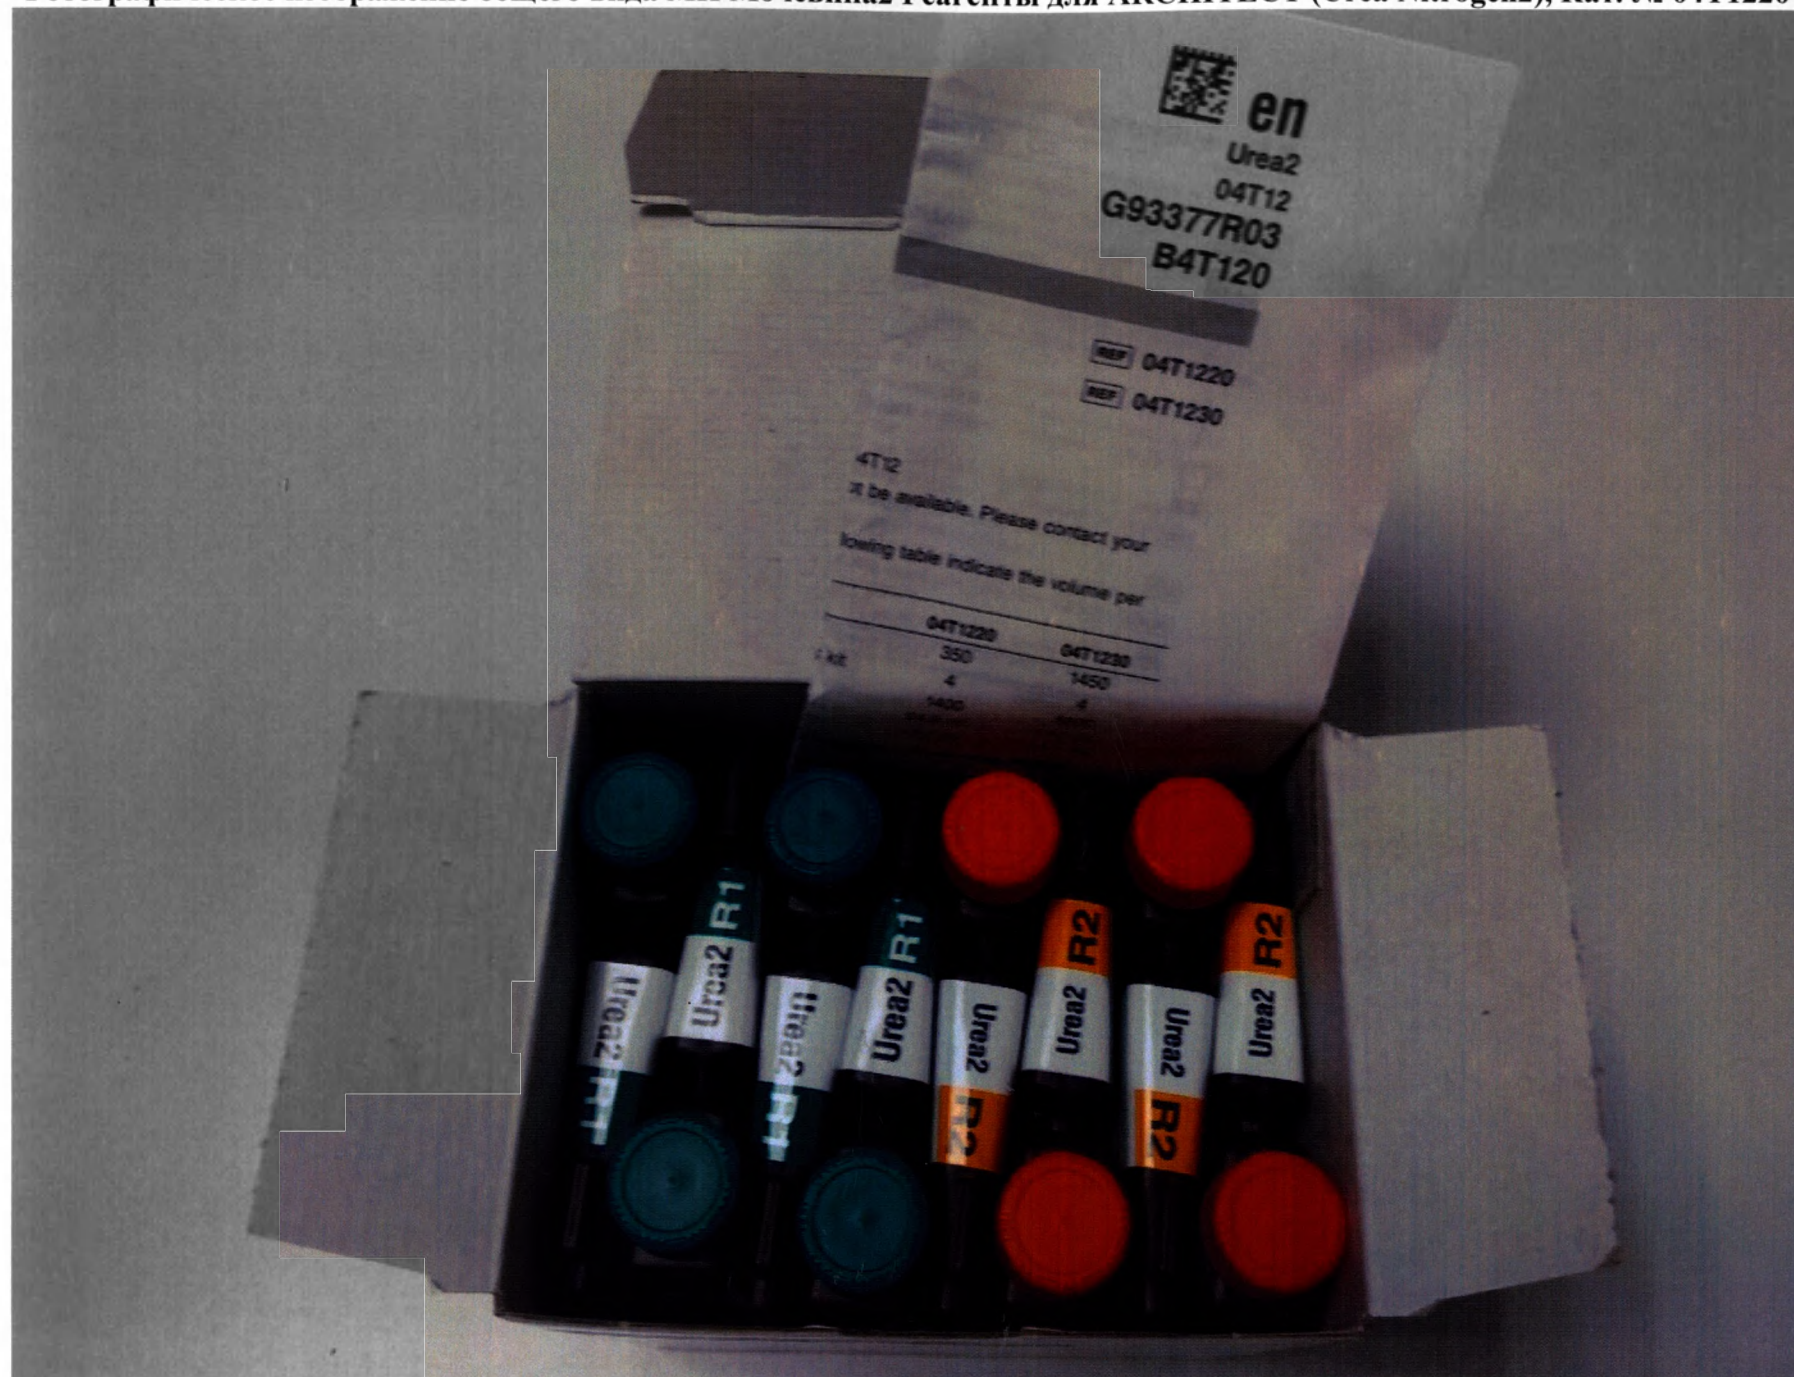



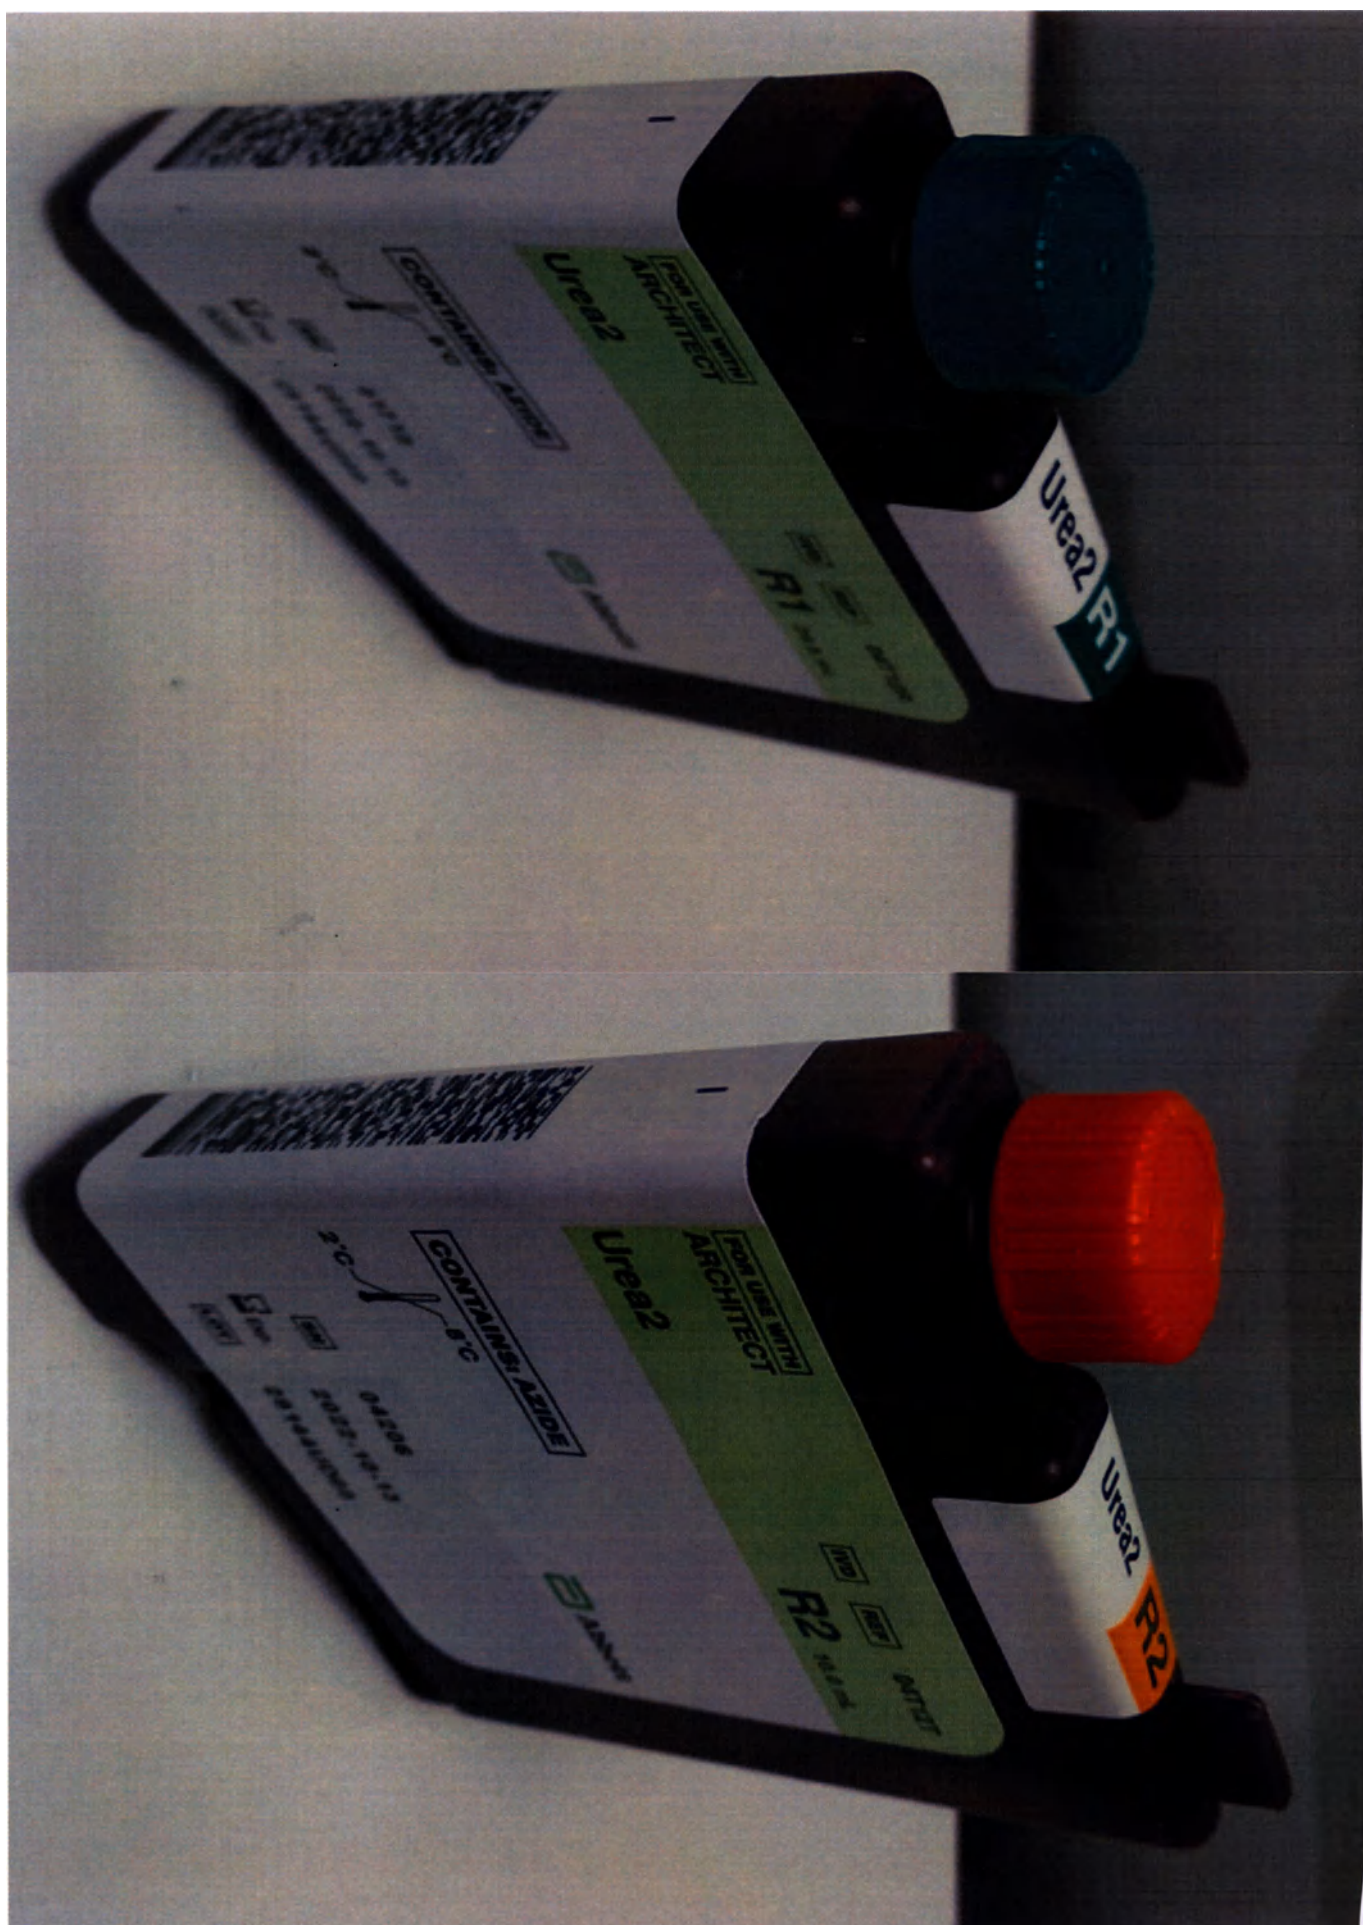

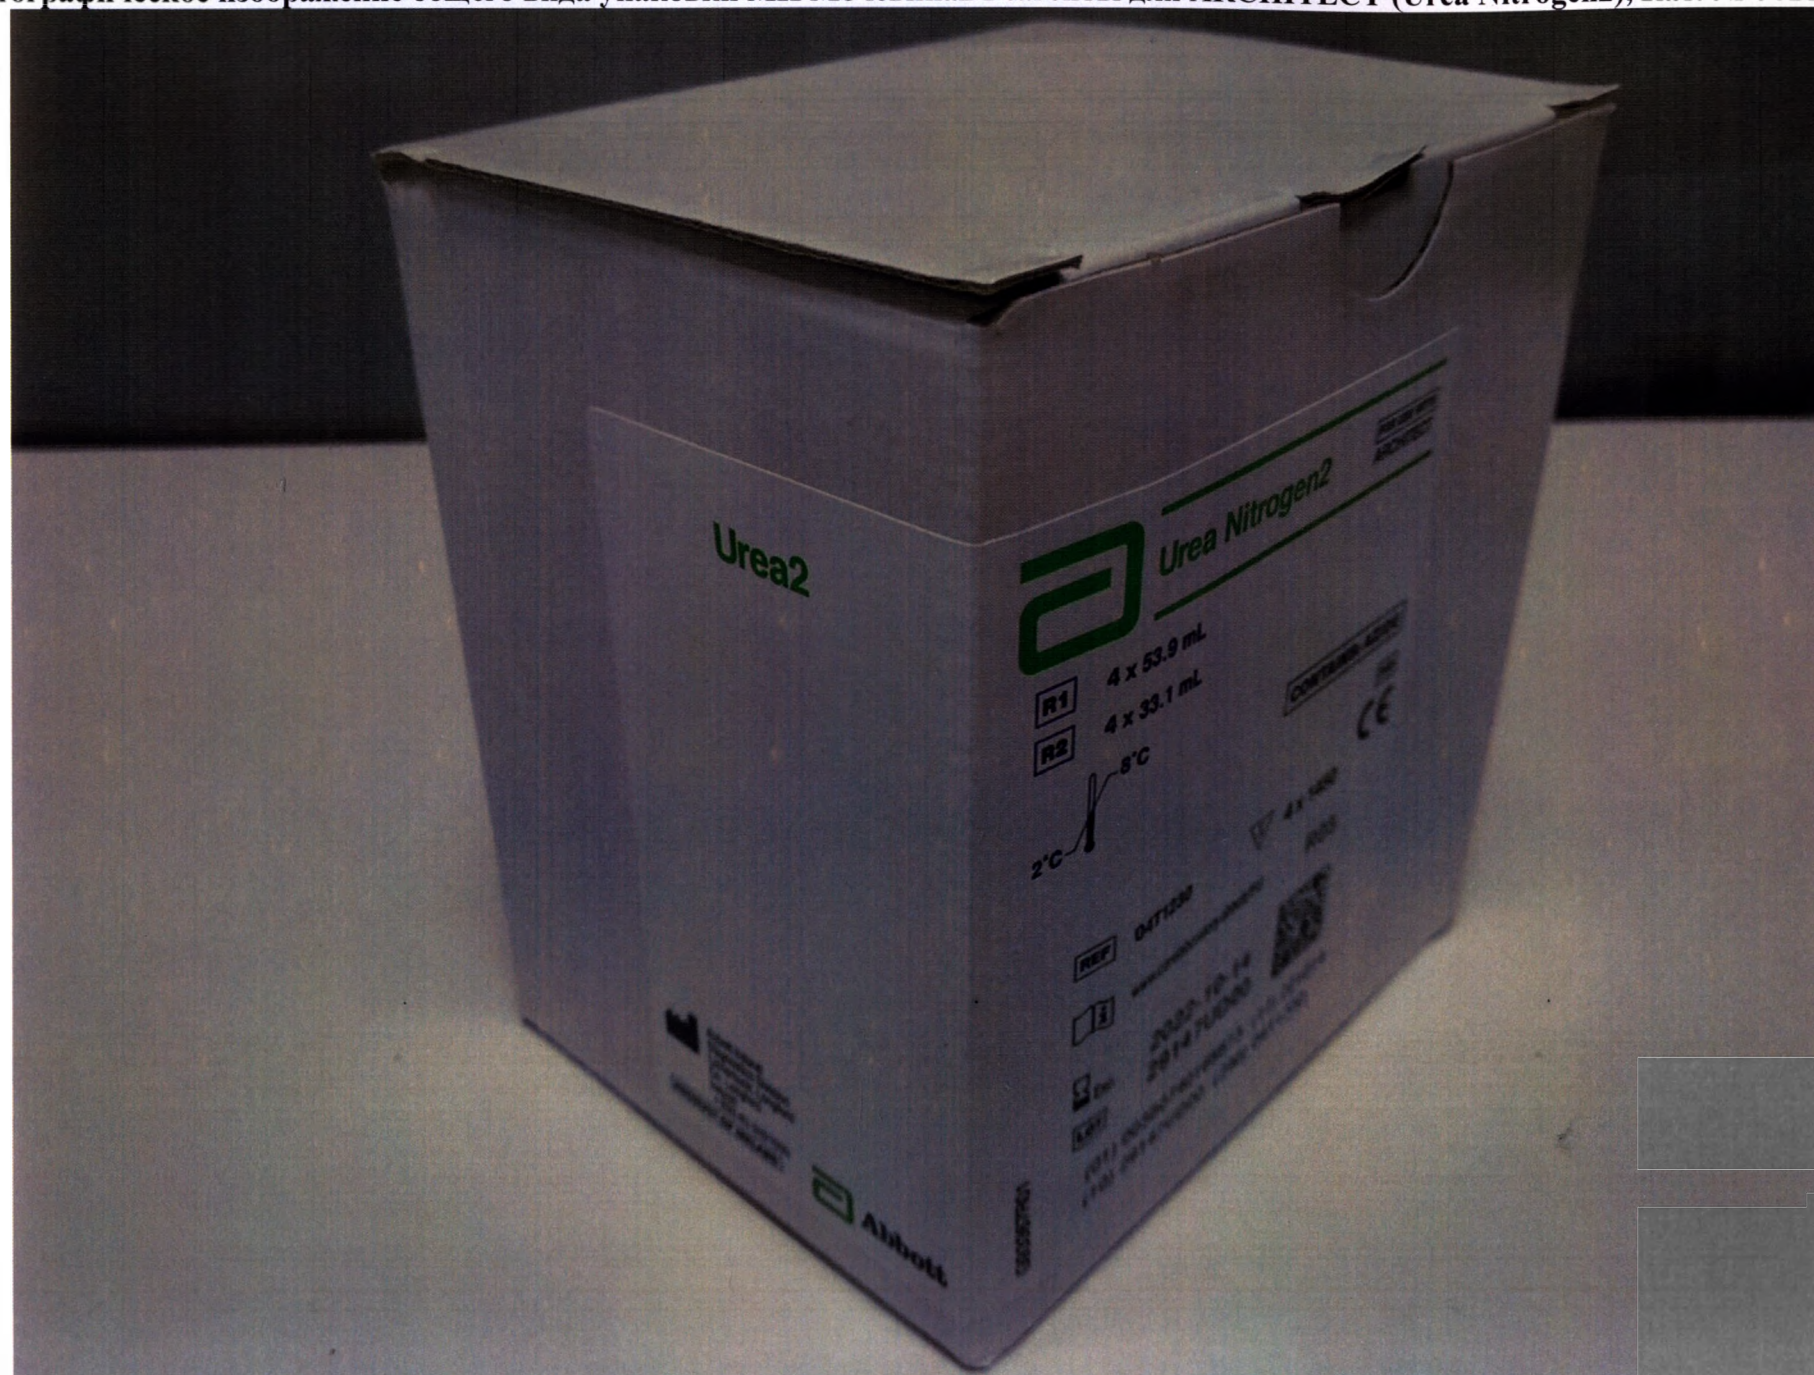

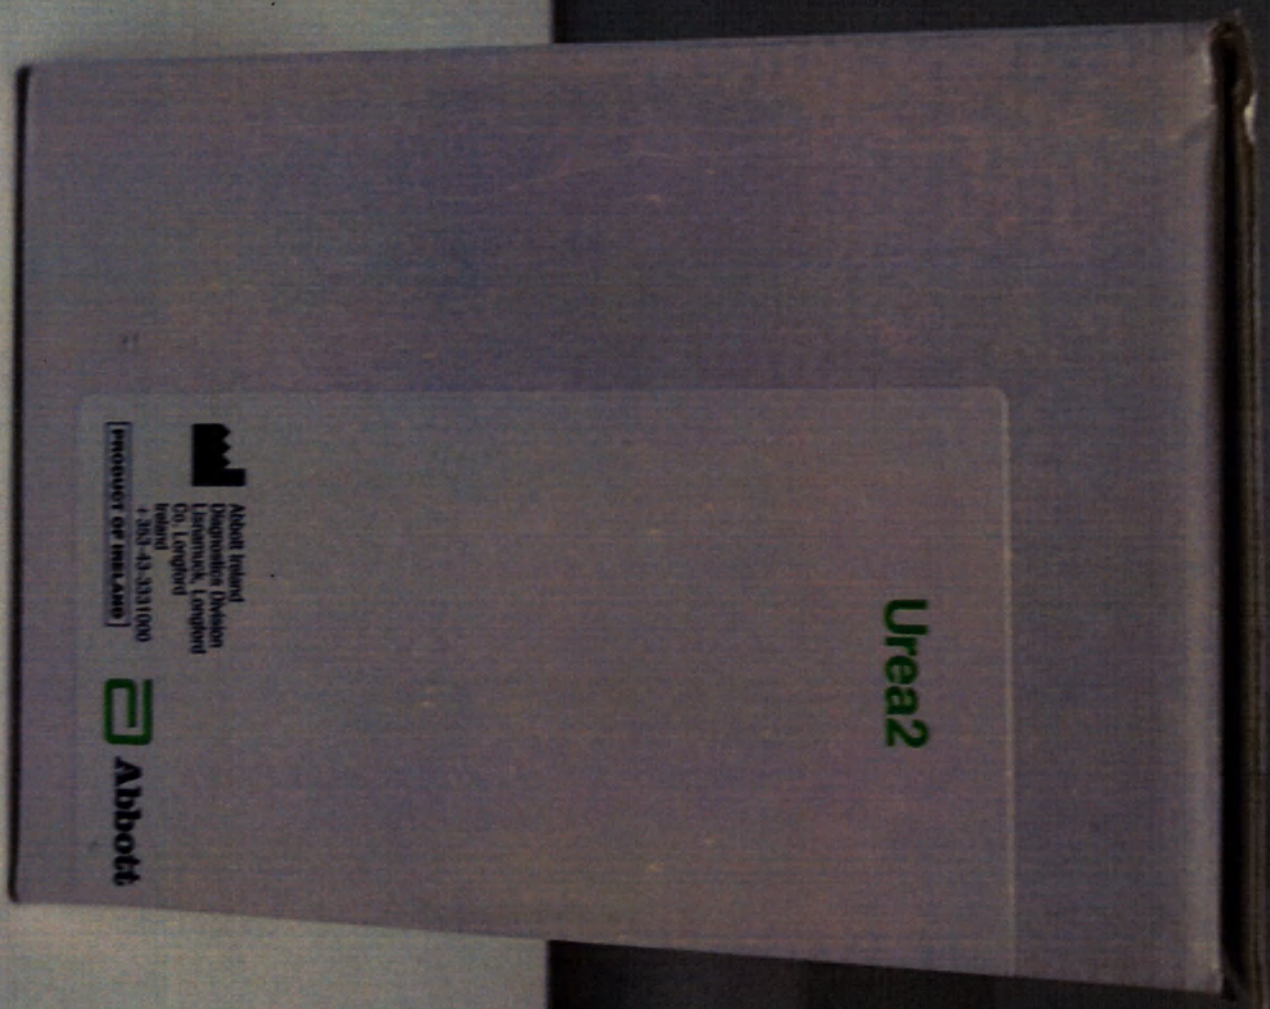




Urea Nitrogen2

FOR USE WITH
ARCHITECT

R1 4 x 53.9 mL

R2 4 x 33.1 mL



CONTAINS: AZIDE

IVD



REF 04T1230



4 x 1450



www.corelaboratory.abbott/IFU

R03



Exp.

2022-10-14

LOT


29147UD00




G93367R01

(01) 00380740165673 (17) 221014

(10) 29147UD00 (240) 04T1230

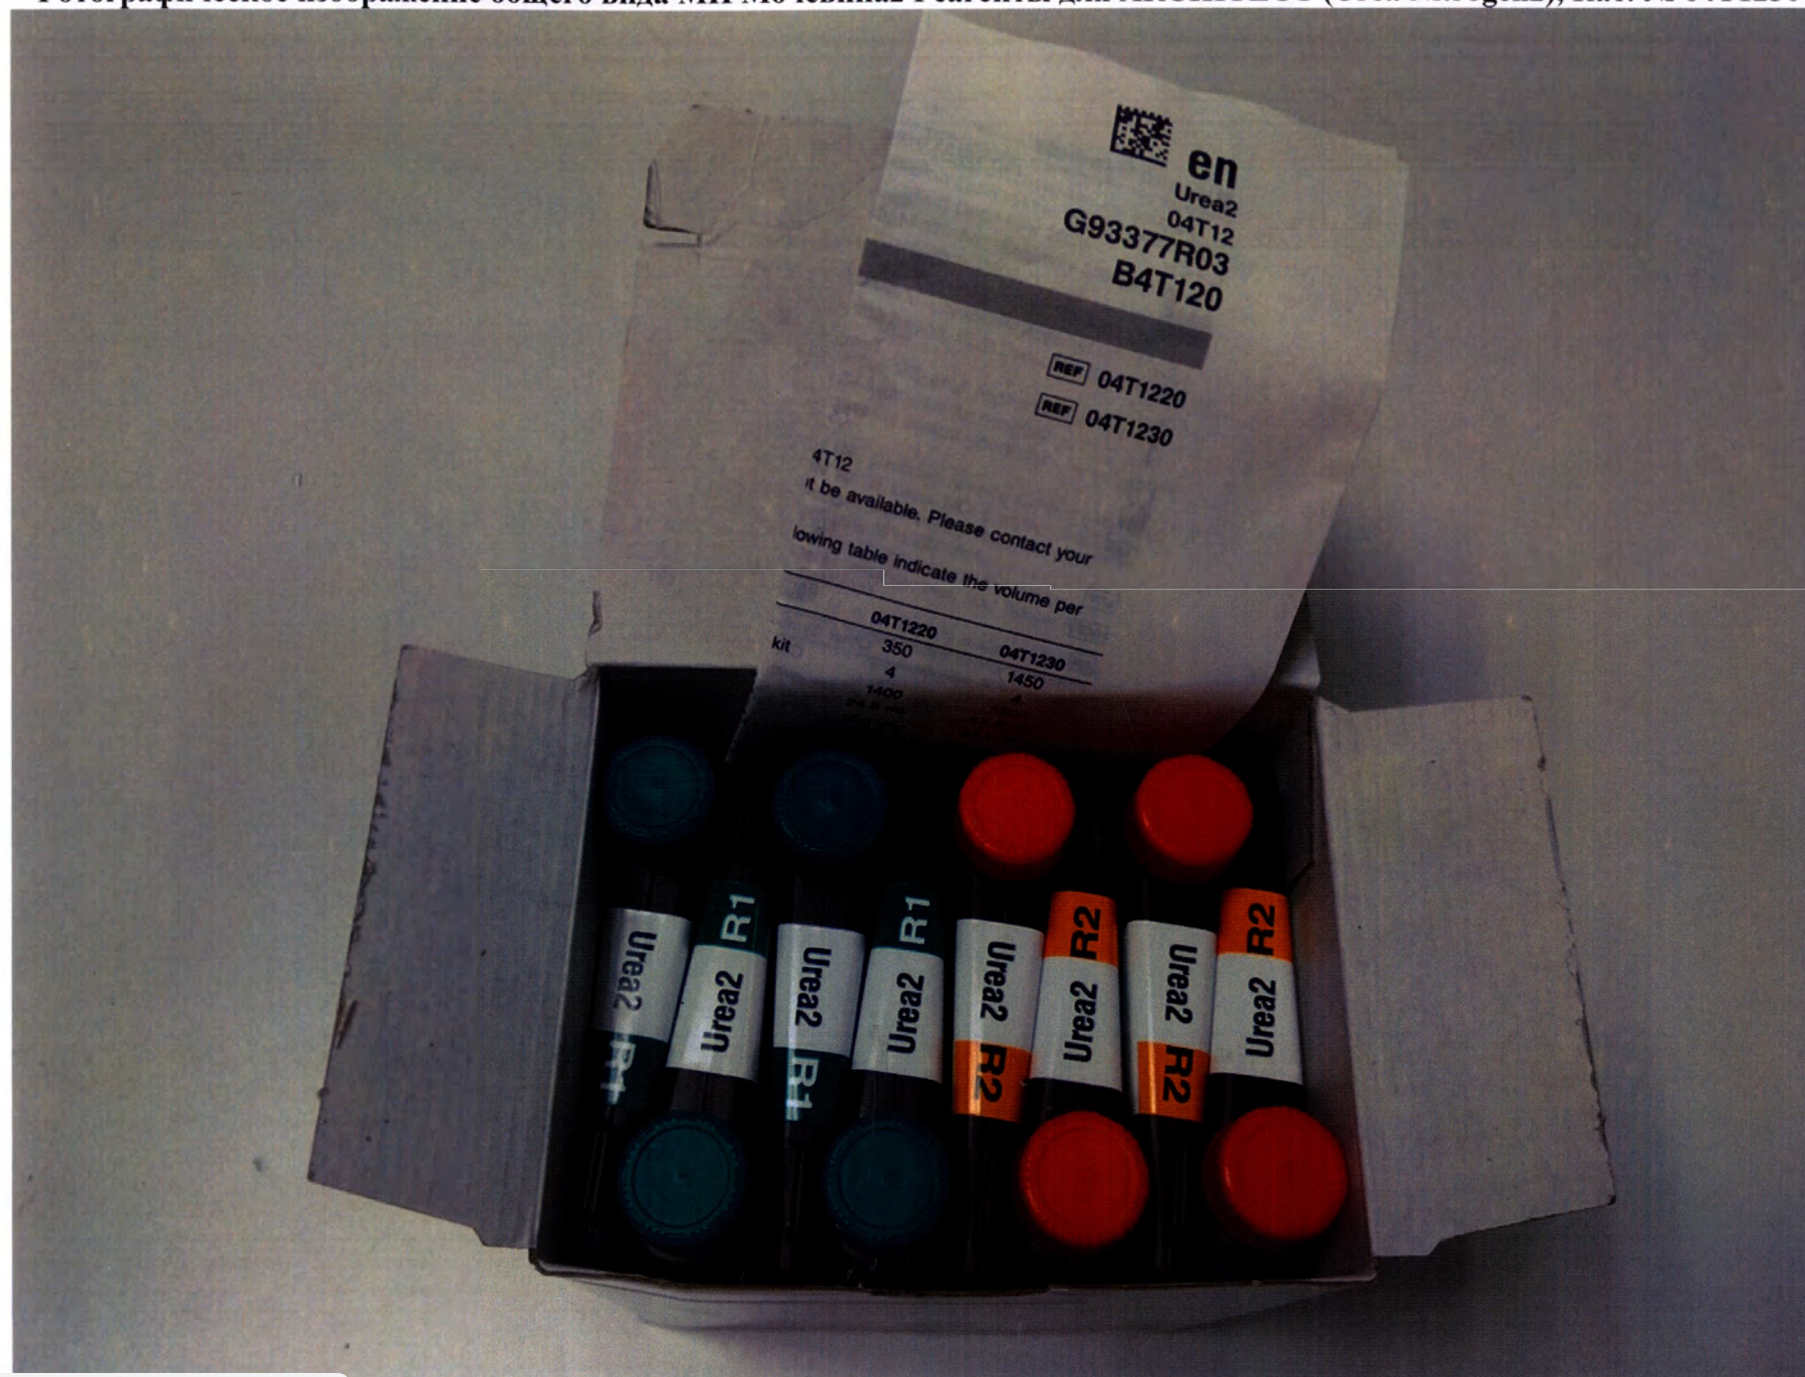



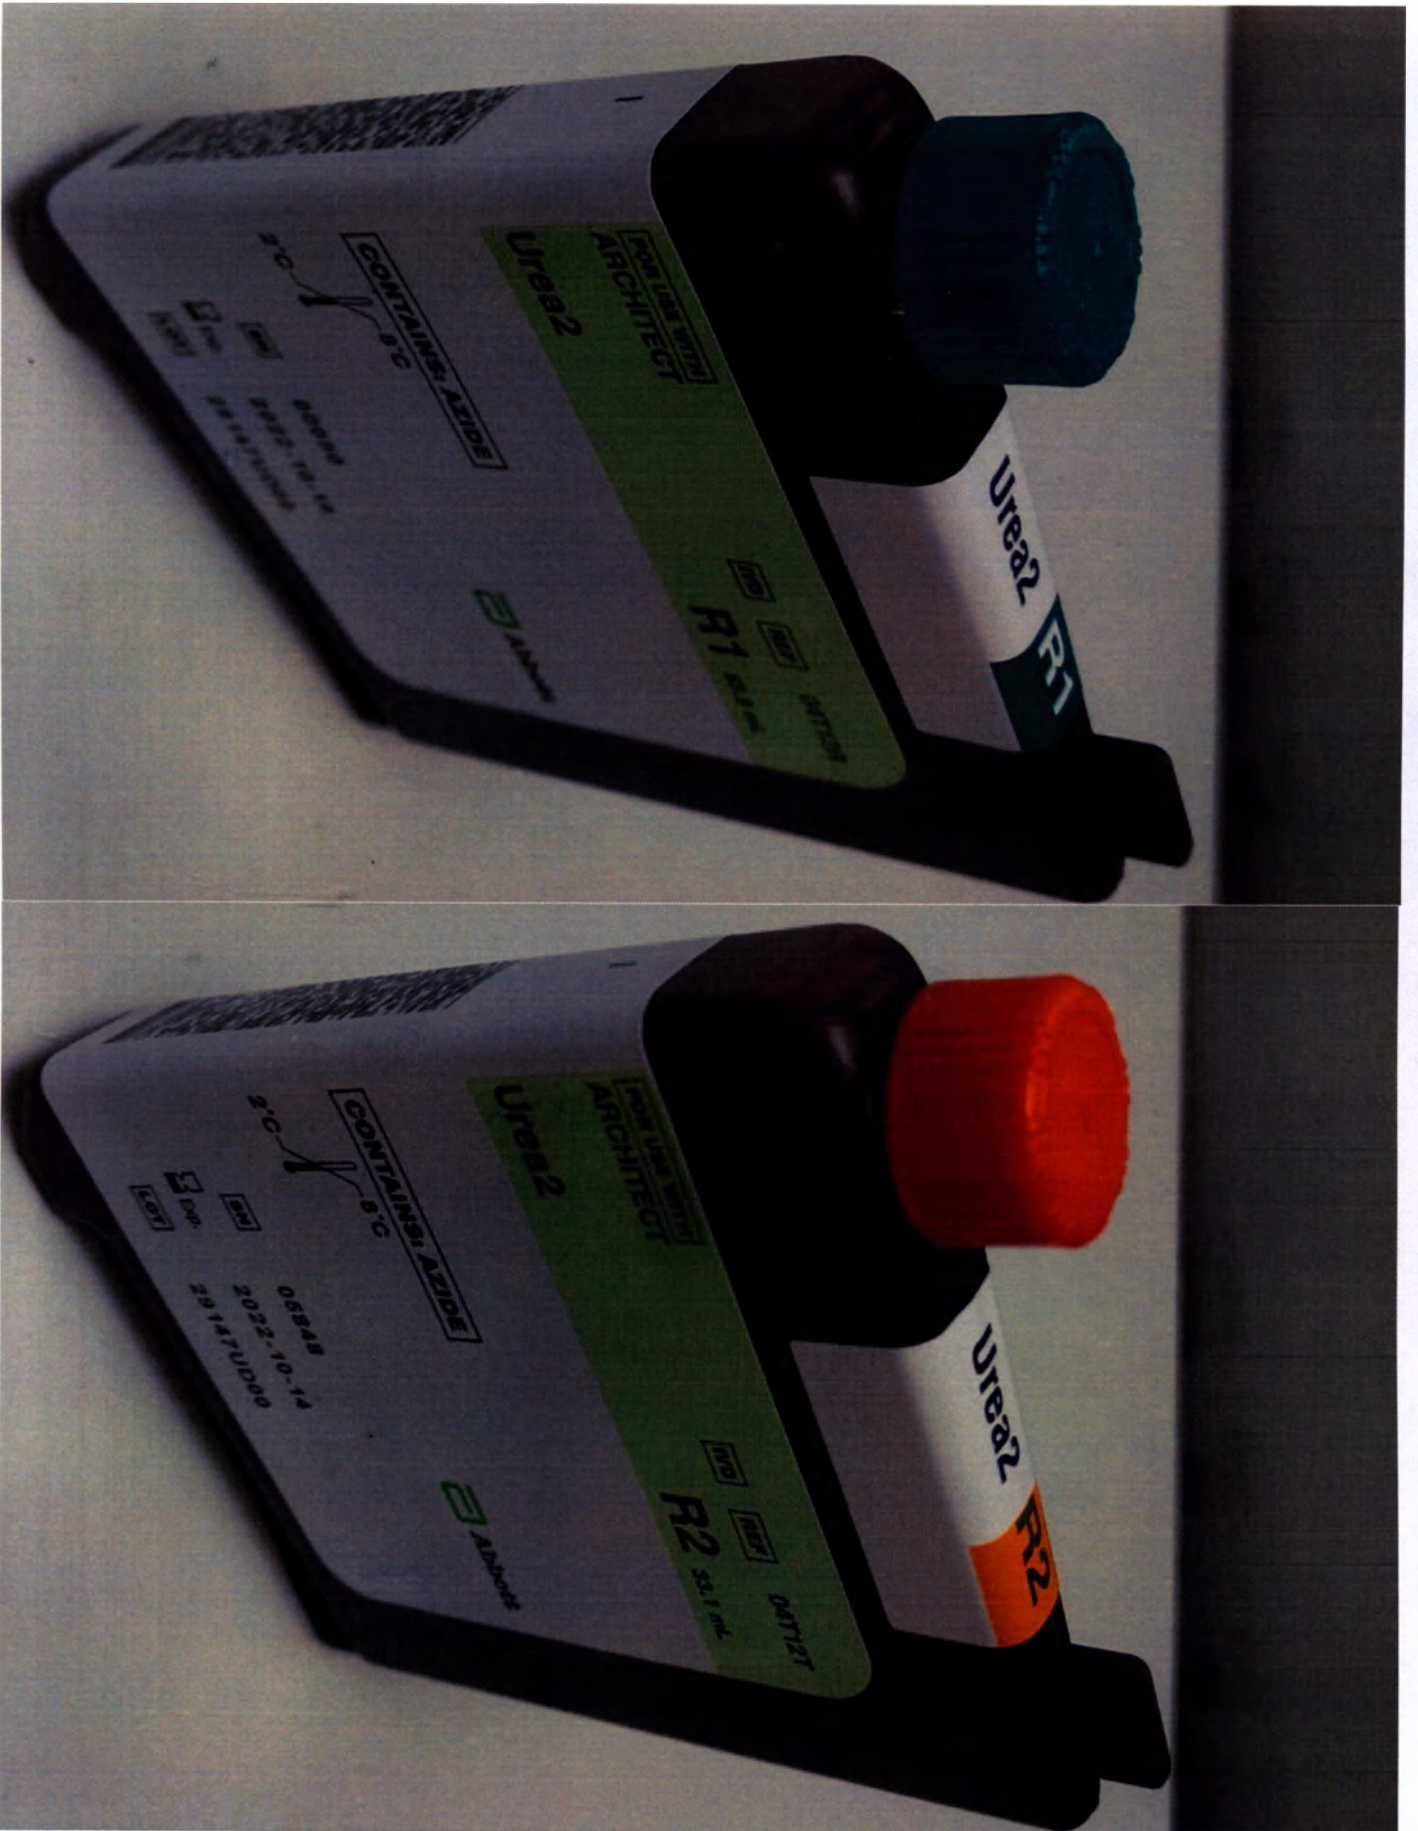

Всего прошито и пронумерован

11 листов

Подпись

