

Общество с ограниченной ответственностью «АДАНИ РУС»
190005, г. Санкт-Петербург, Набережная Обводного канала, д.118А, лит. X, помещение 7-Н, офис 7
ИНН 7839089877, КПП 783901001, ОГРН 1177847274065
Тел. +7 812 389 23 88 E-mail: rus-info@advin.ru

Фотографические изображения
медицинского изделия

**Аппарат рентгеновский маммографический
МАММОСКАН 2М с принадлежностями**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор




В.О. Скачков

Аппарат рентгеновский маммографический МАММОСКАН 2М с принадлежностями:




1. Рентгеновское штативное устройство XRS1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь:

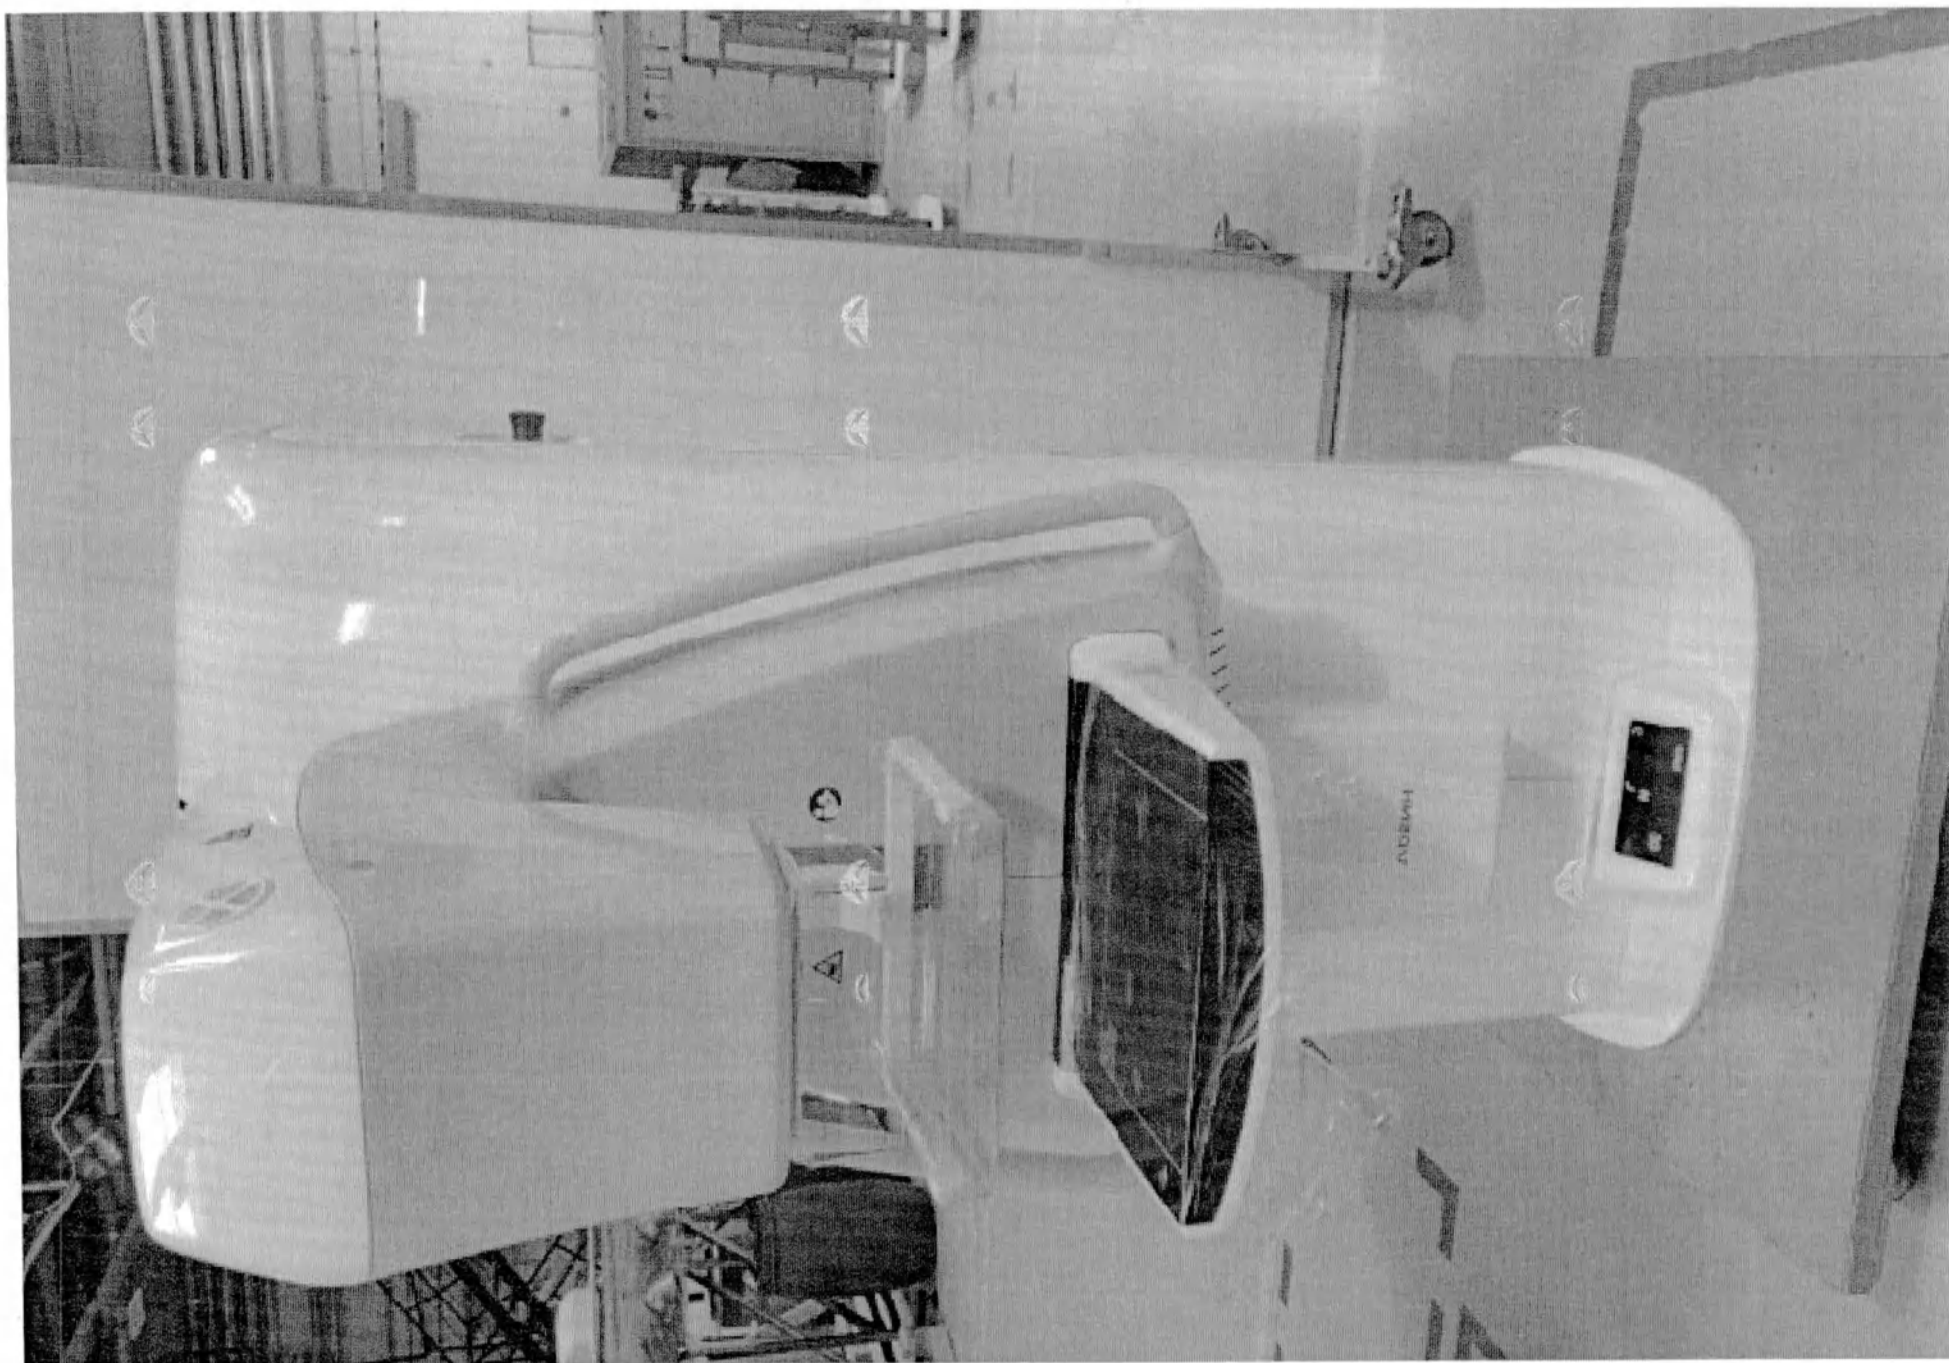


1.1. Приёмник рентгеновского излучения серии Mammo1012 производства iRay Technology Company Limited, Китай;




или серии RSM2430 производства DRTECH CORPORATION, Республика Корея;

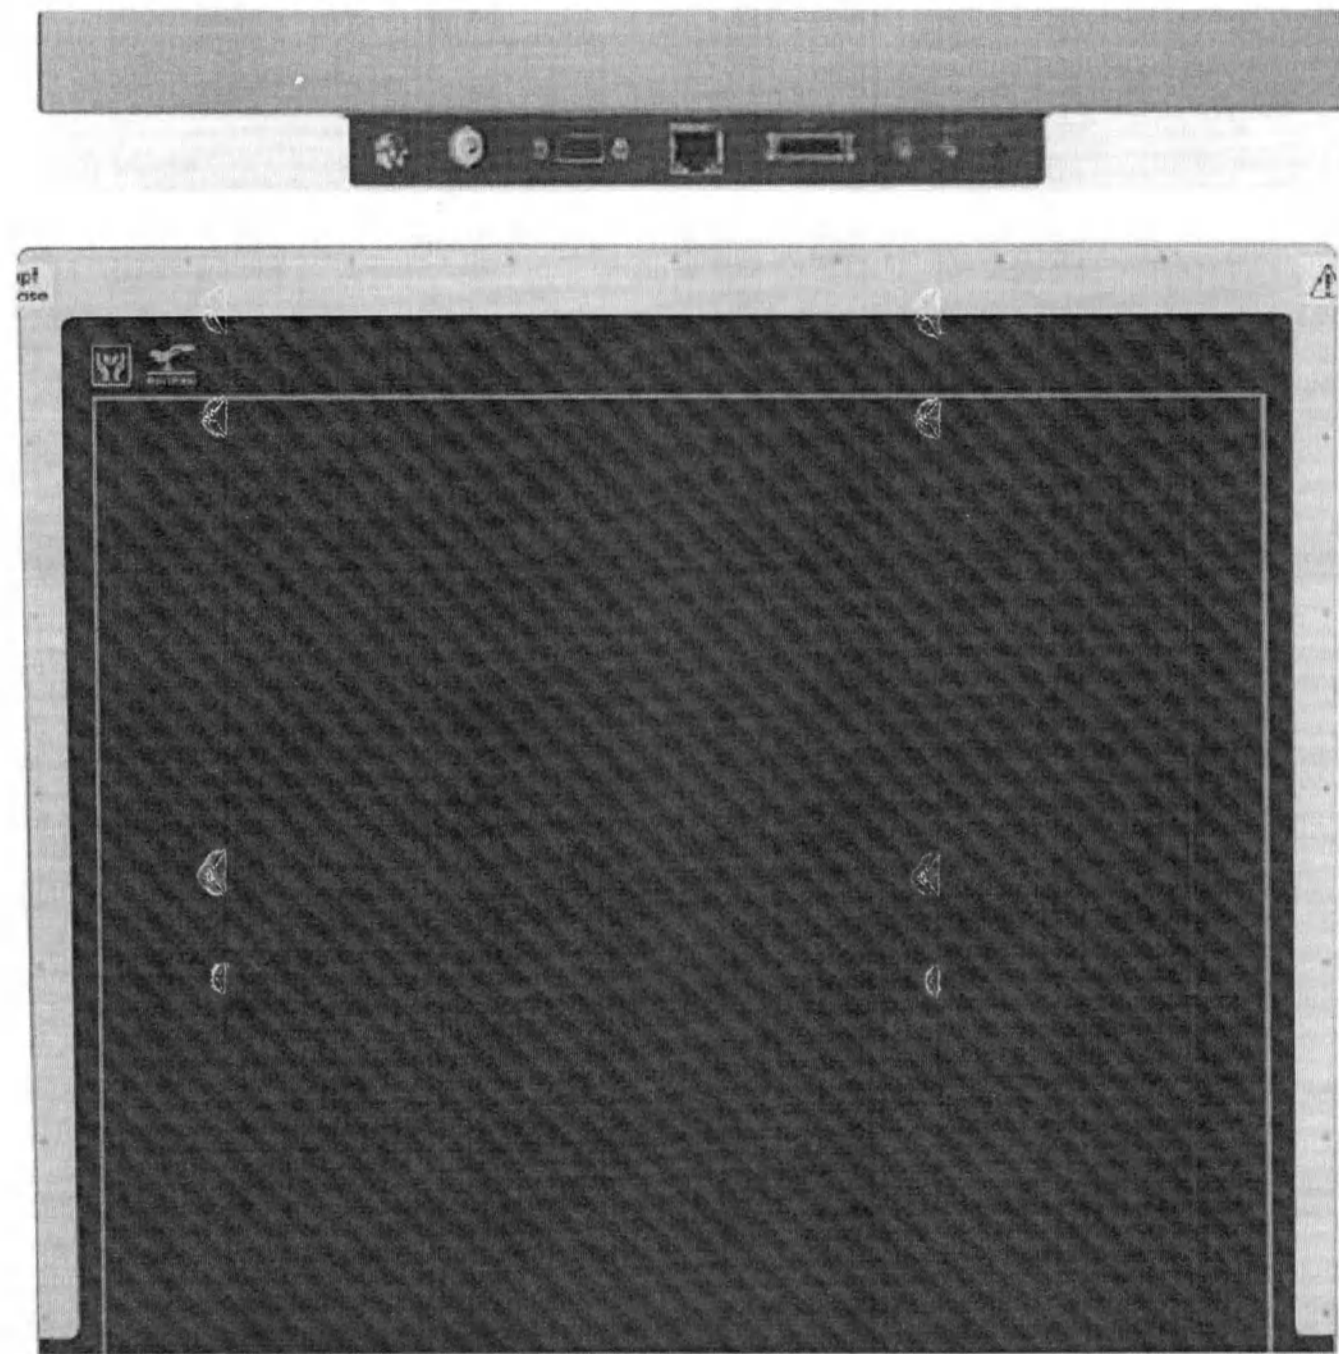


или серии VIVIX-M 1210 производства Vieworks Co., Ltd., Республика Корея;

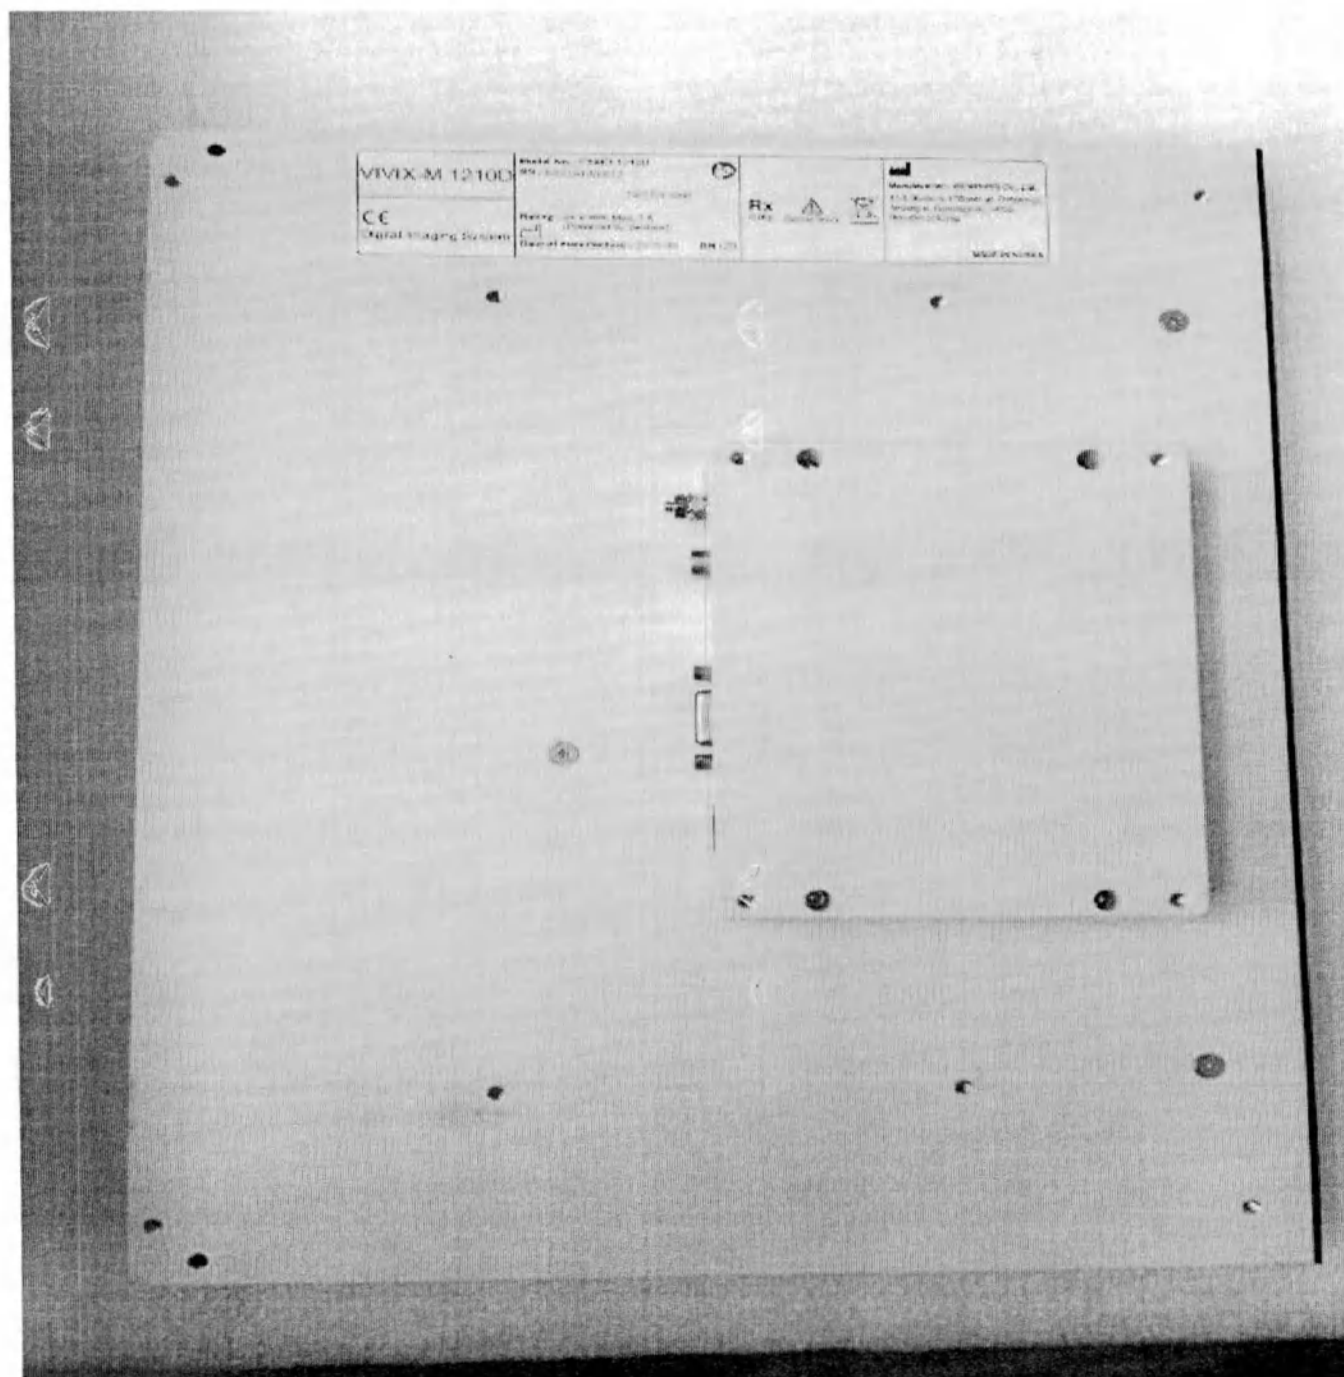


или серии XRR1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

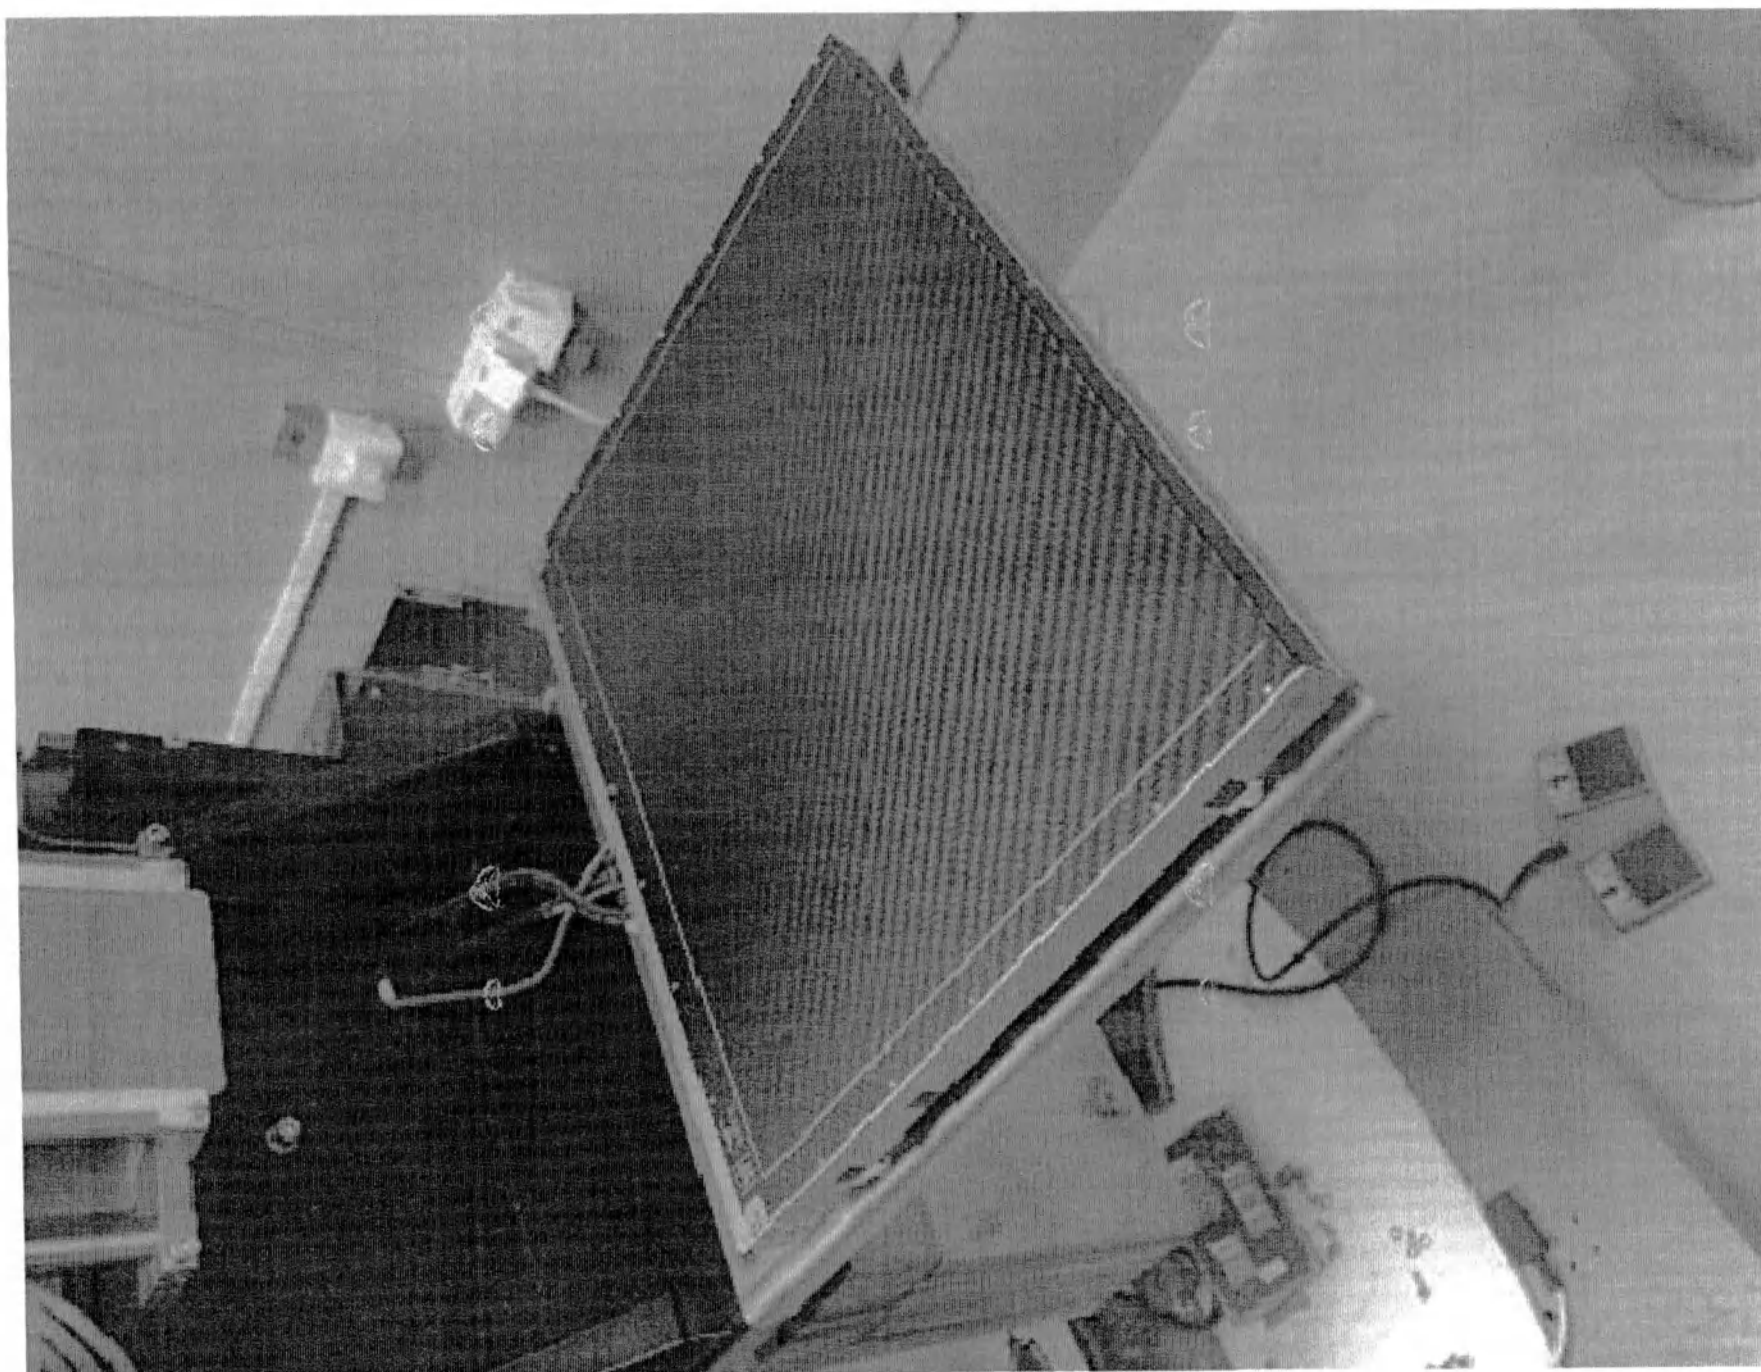

1.2. Рентгеновский излучатель серии M113 производства Varex Imaging Corporation, США;

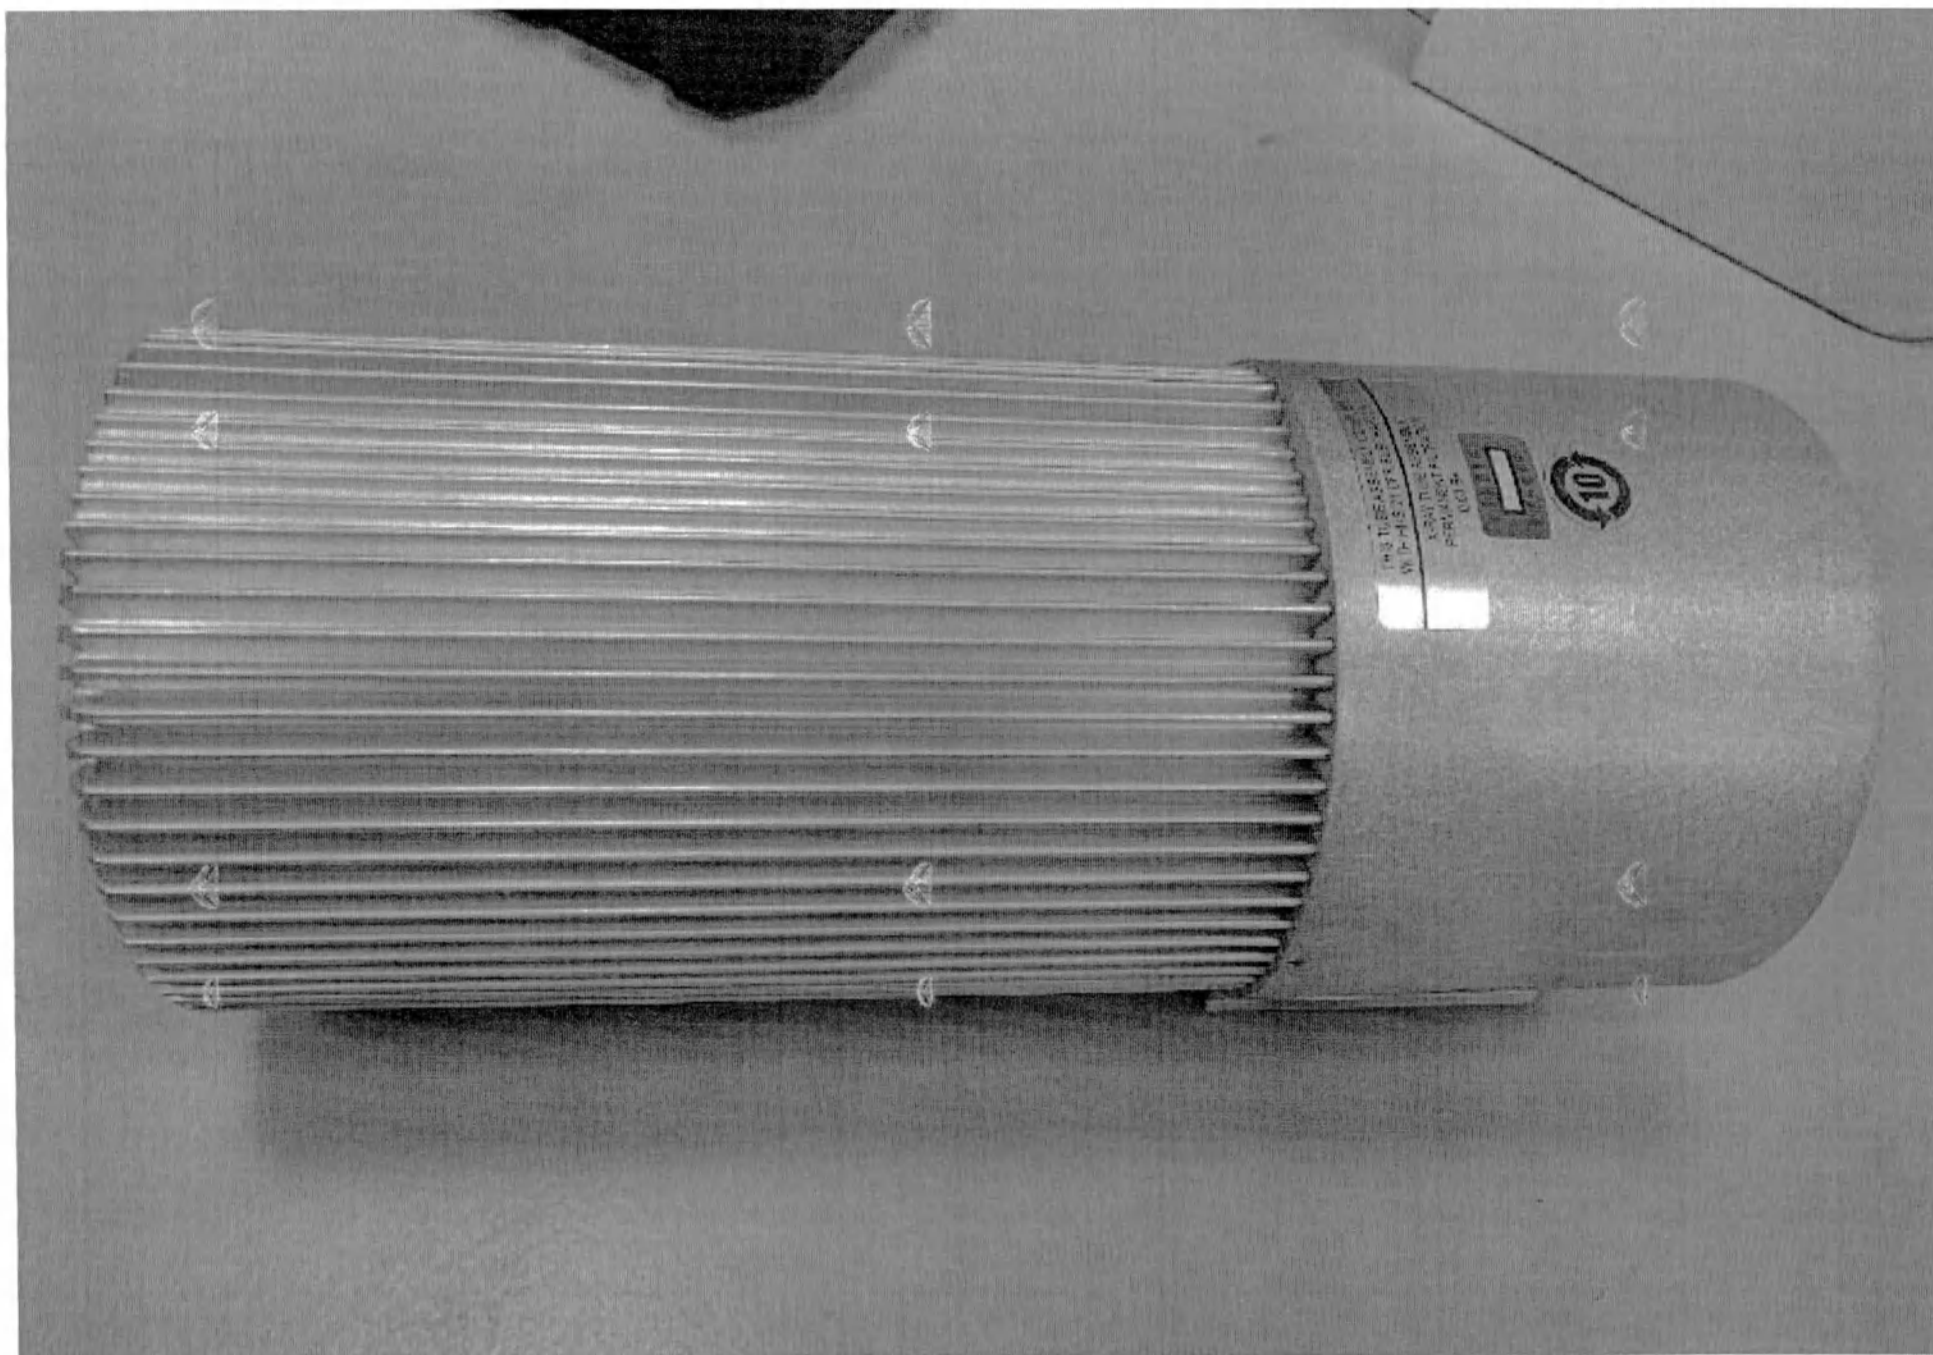


или серии H5077 производства Hangzhou Kailong Medical instruments Co., Ltd, Китай;

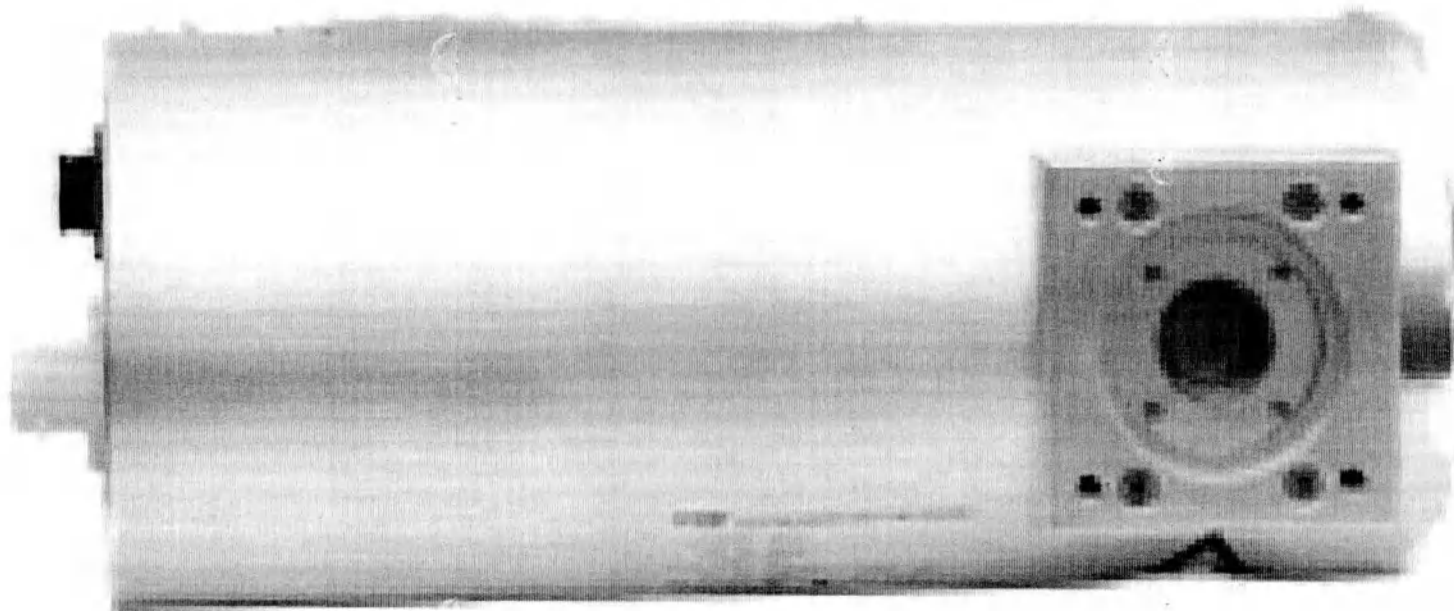


или серии C339VXM1016 производства I.A.E. S.p.A., Италия;




или серии ХК1016 производства I.A.E. S.p.A., Италия;

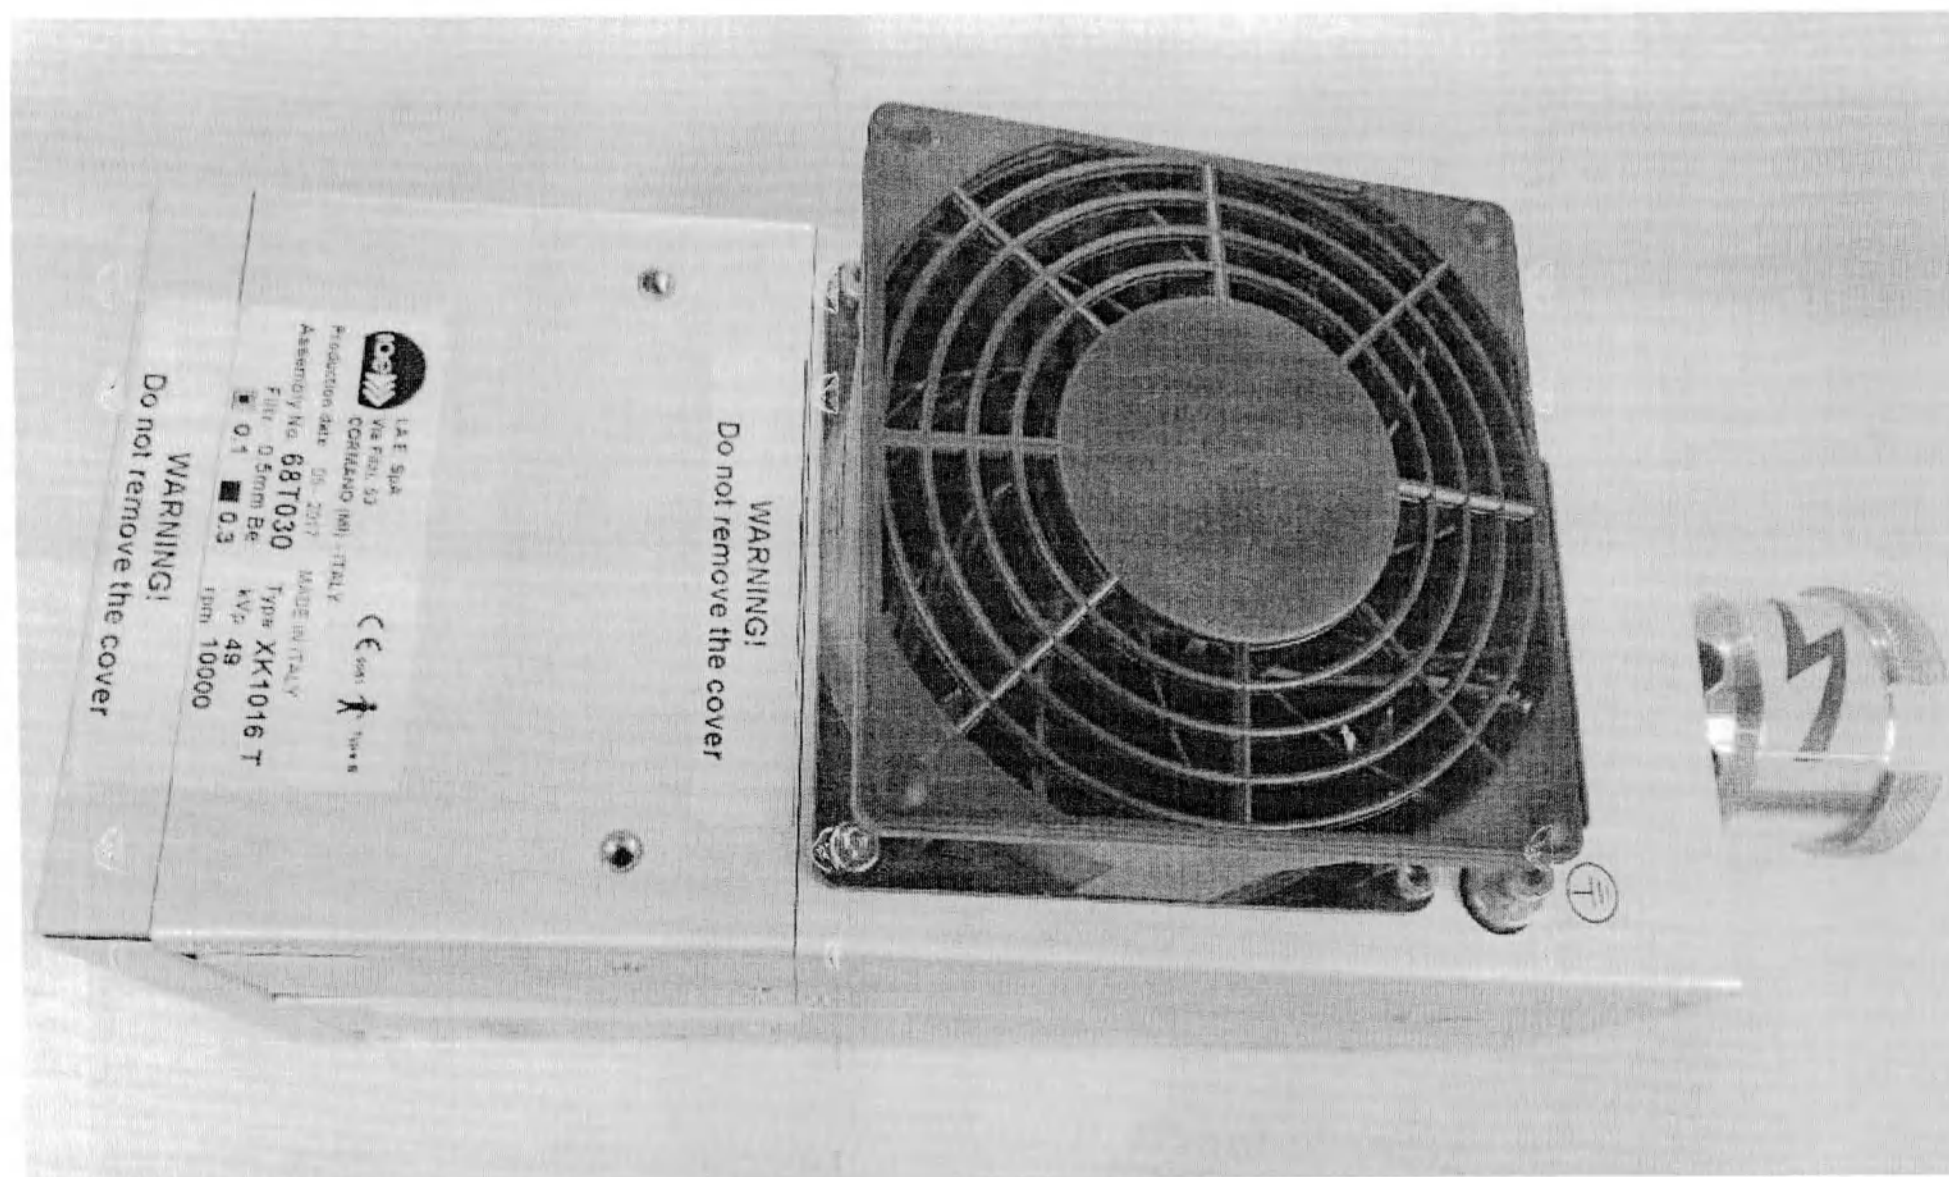

или серии XRE1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

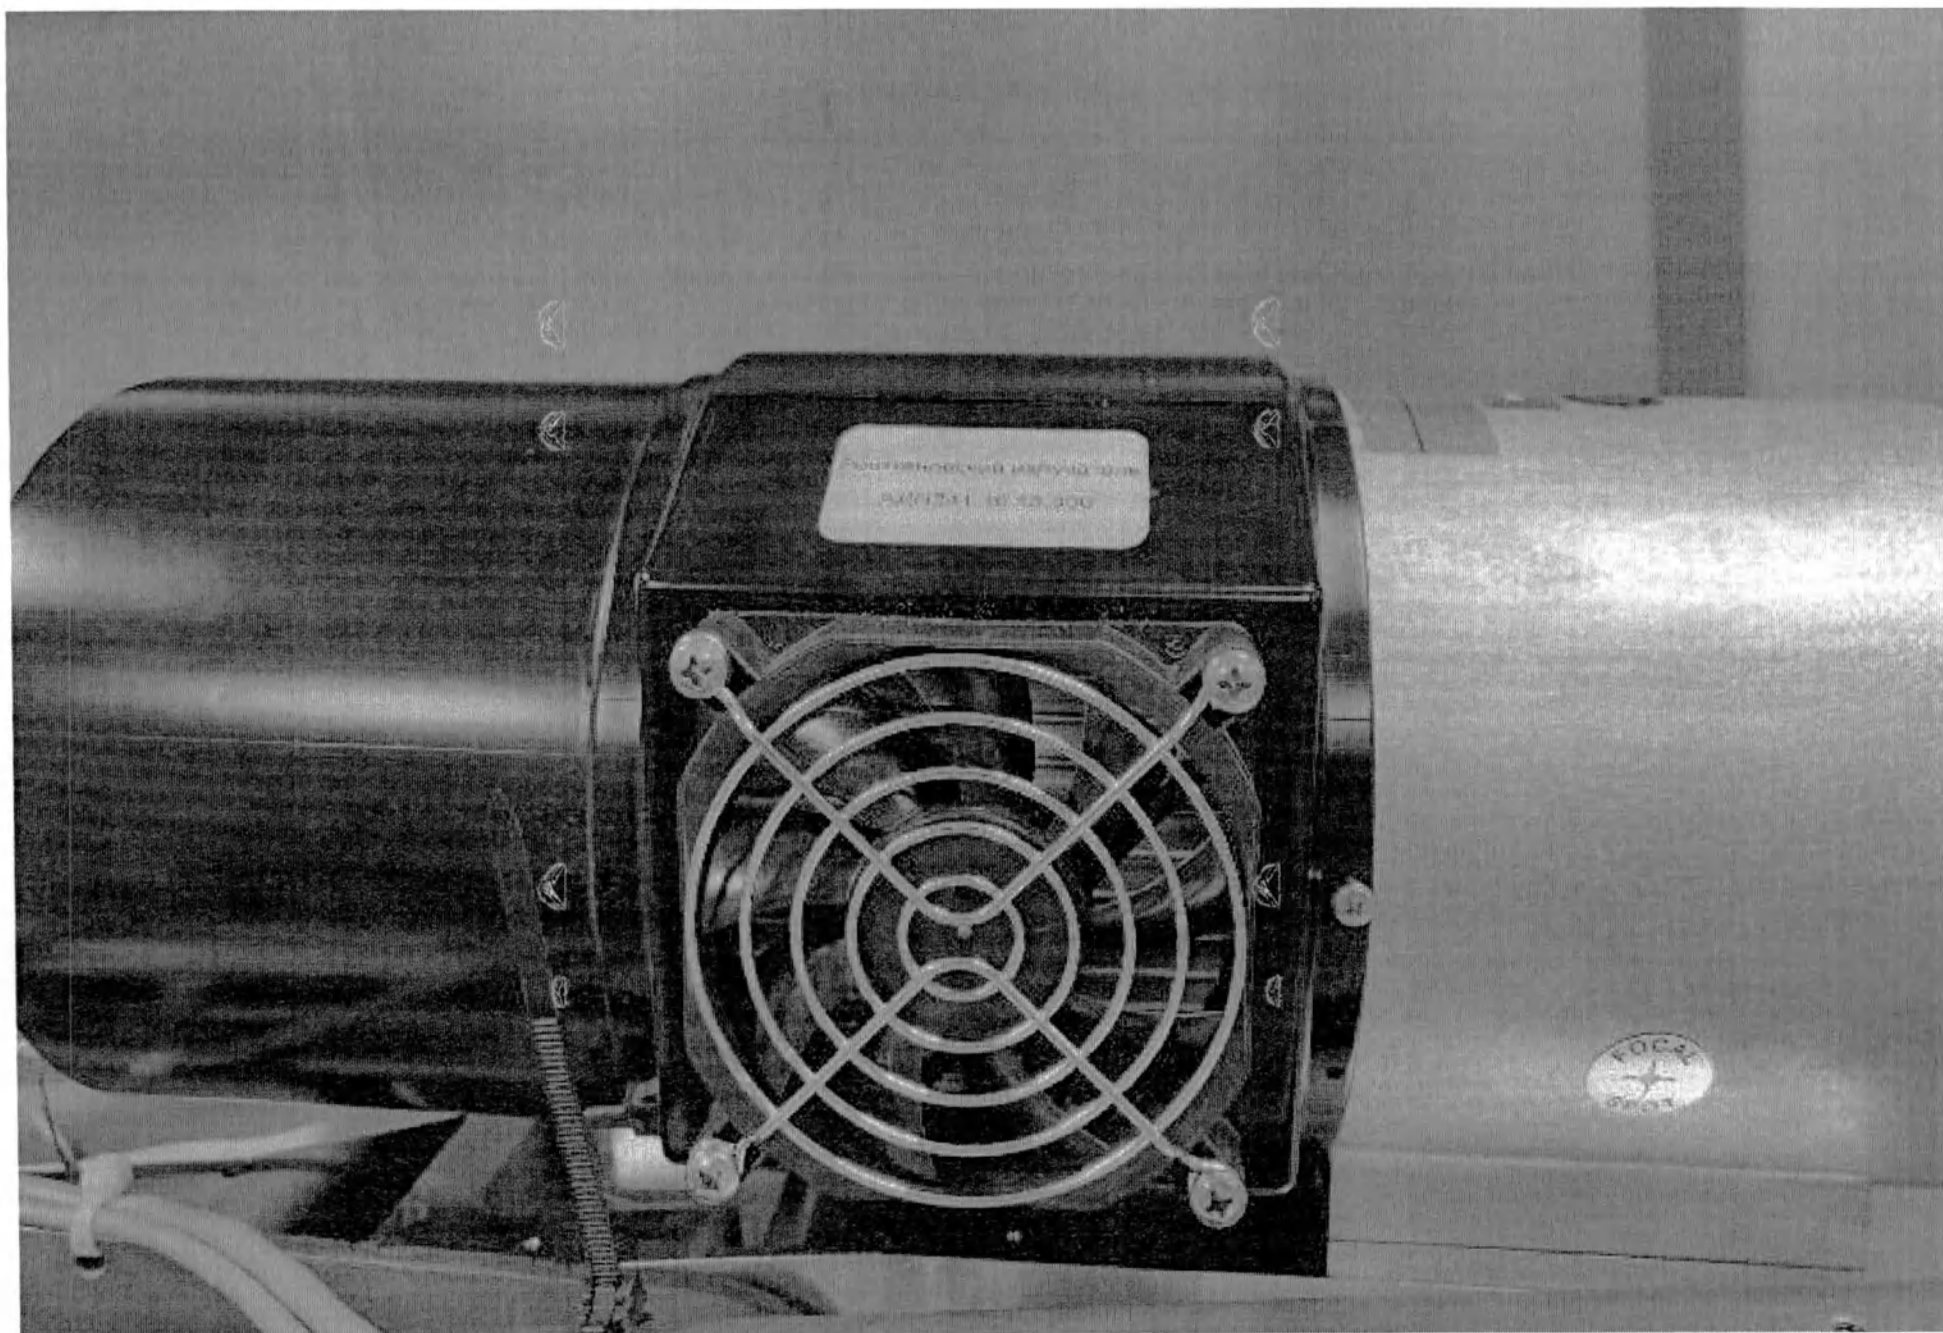

1.3. Рентгеновское питающее устройство серии PMX

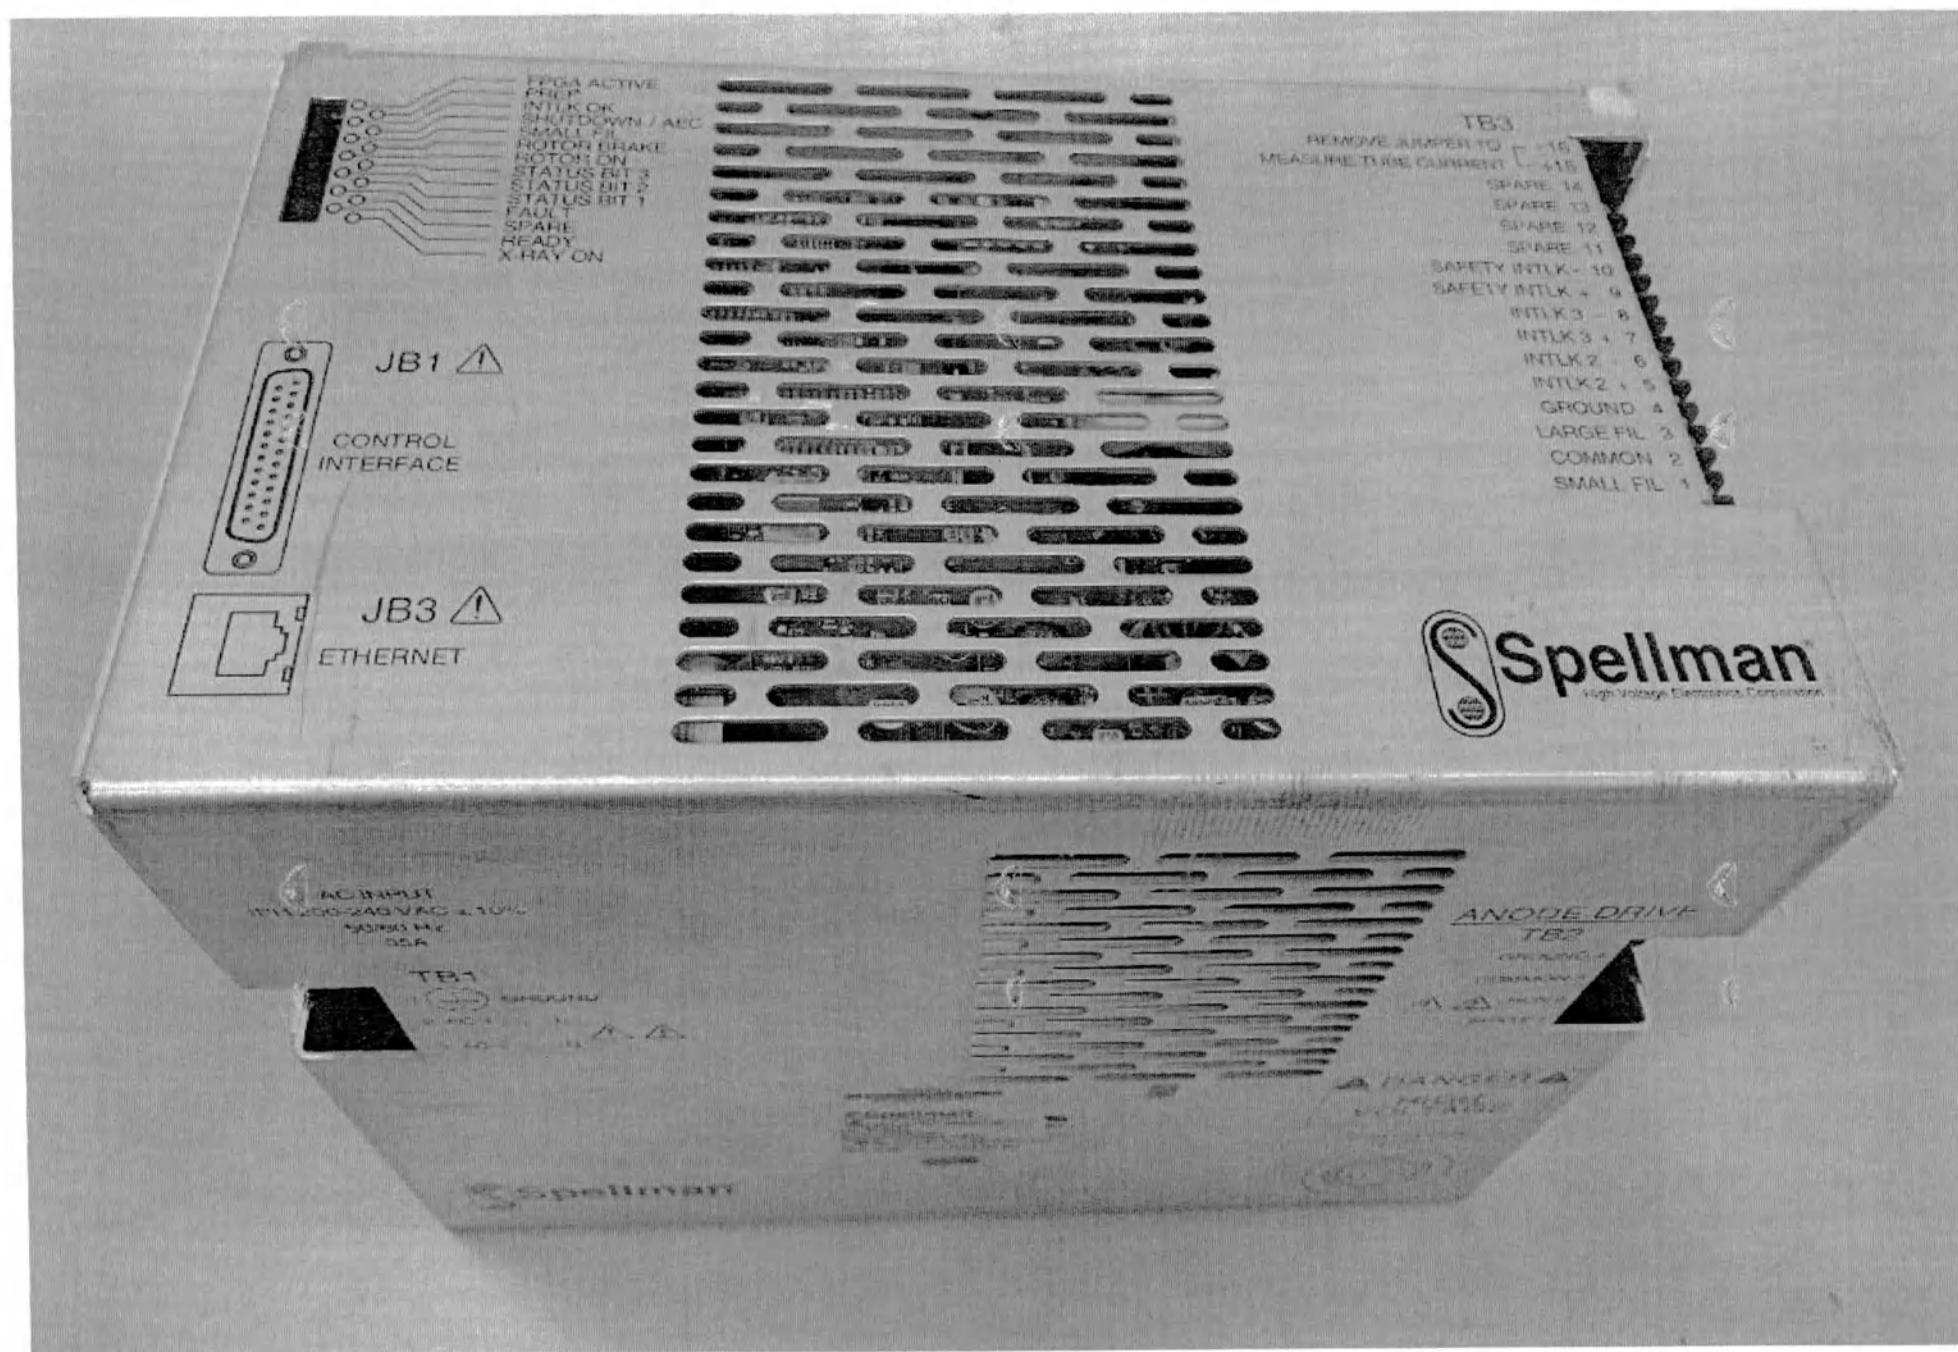

или серии VMX производства Spellman High Voltage Electronics Corporation, США;




или серии PSG производства Suzhou Powersite Electric Co., LTD Китай;




или серии HF1 производства Imd Generators Srl, Италия;




или серии XPD1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

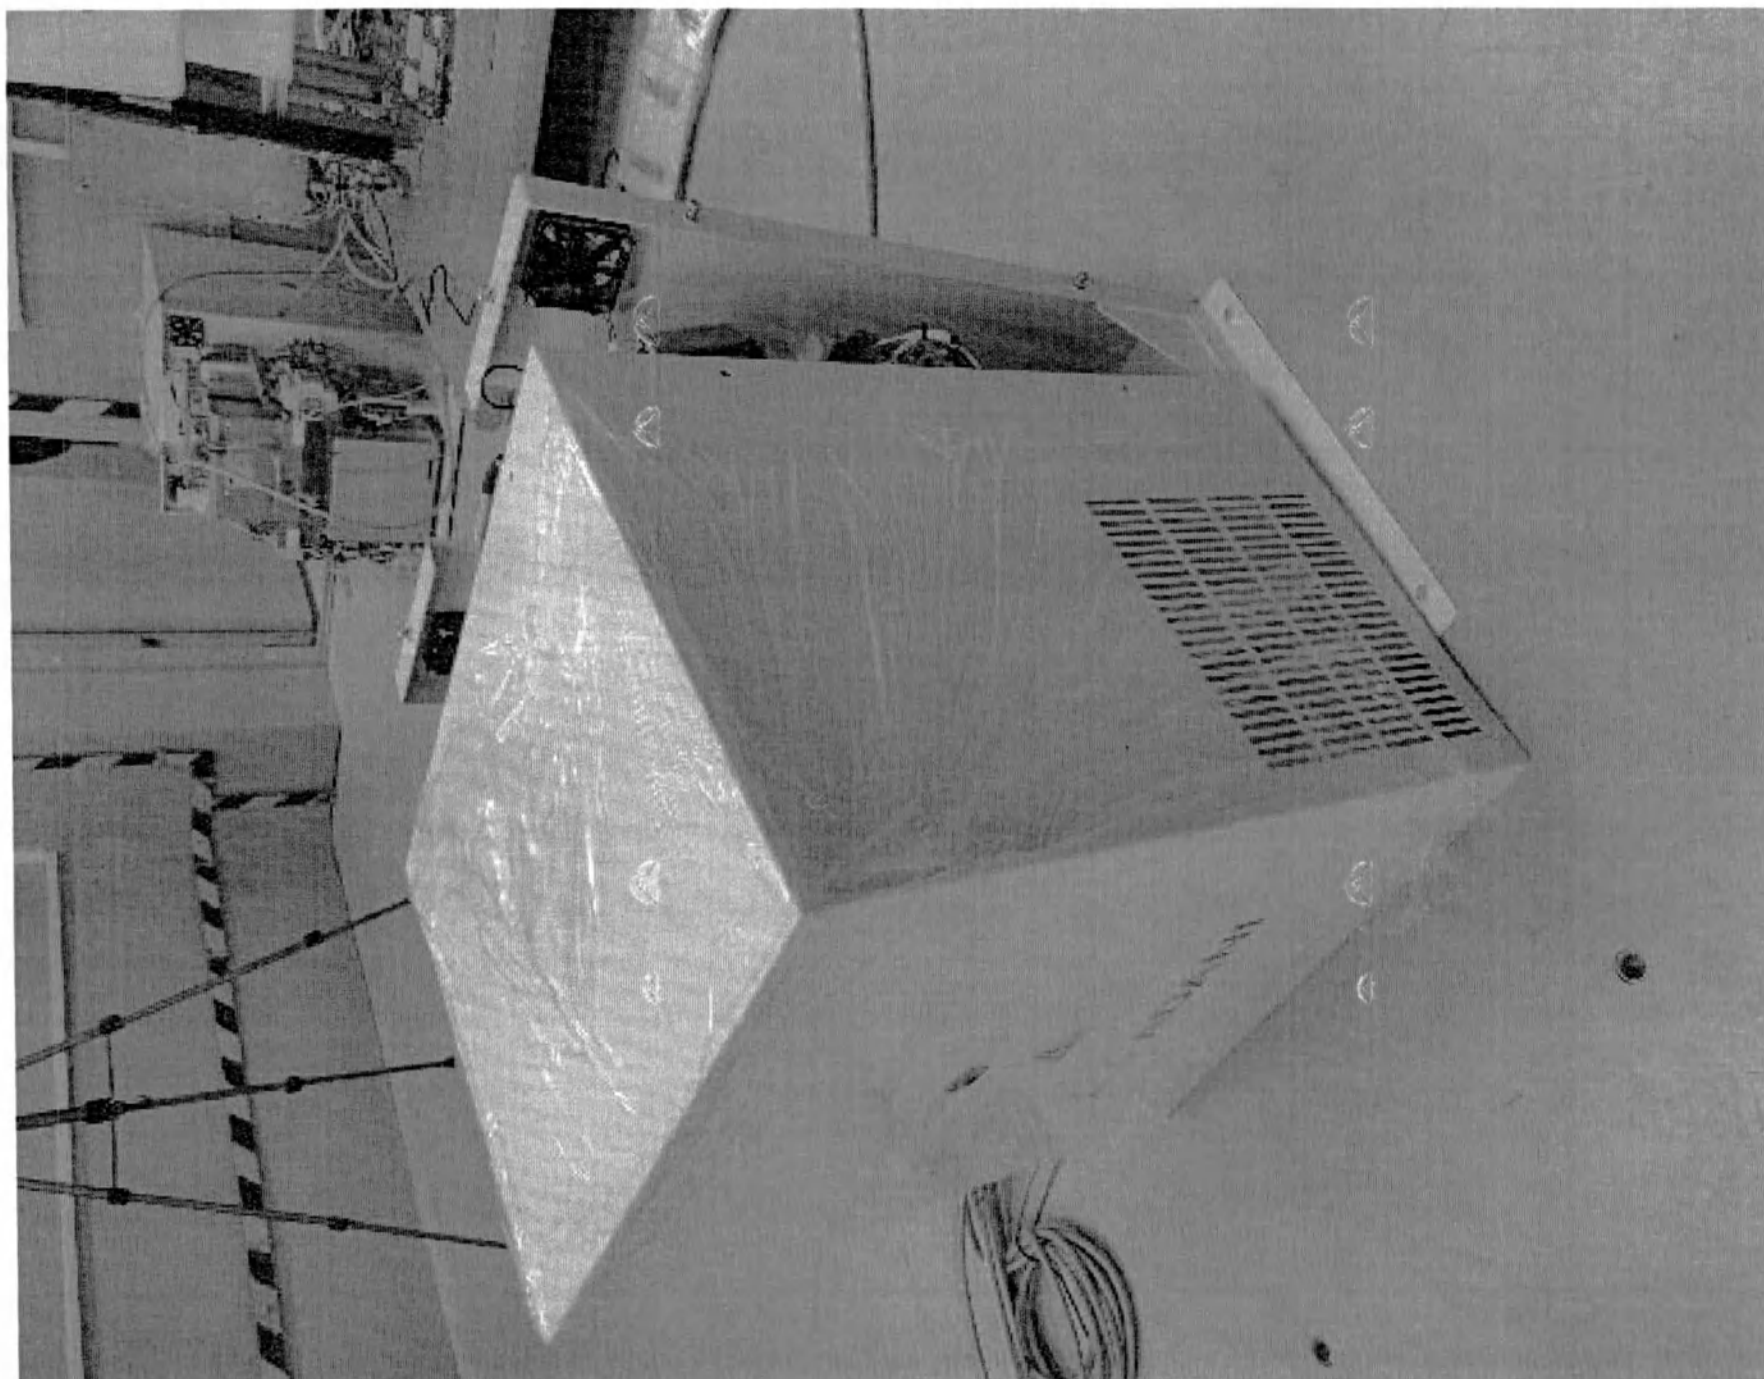


1.4. Коллиматор RF1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

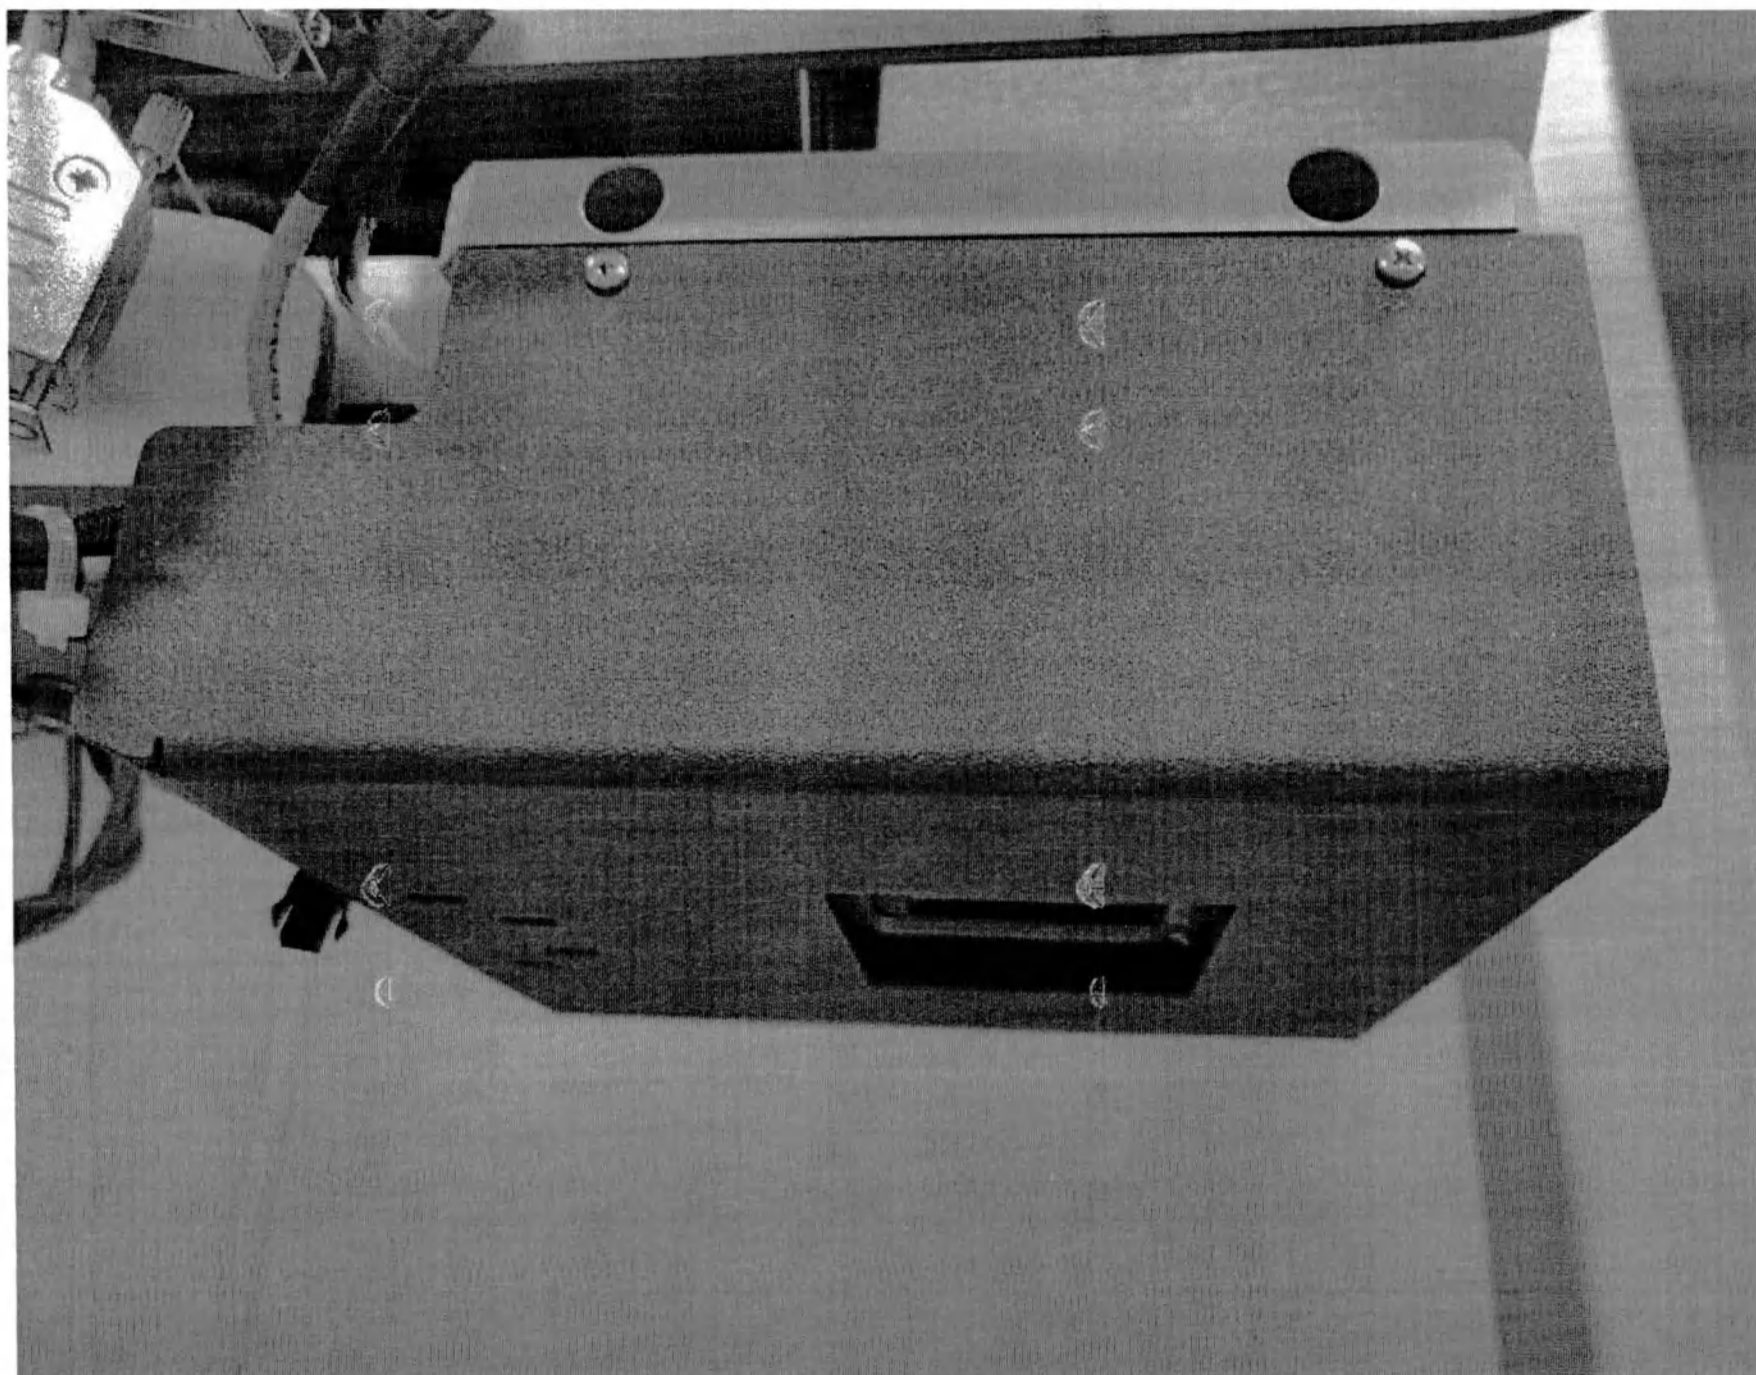


1.5. Ножные переключатели компрессии P01 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

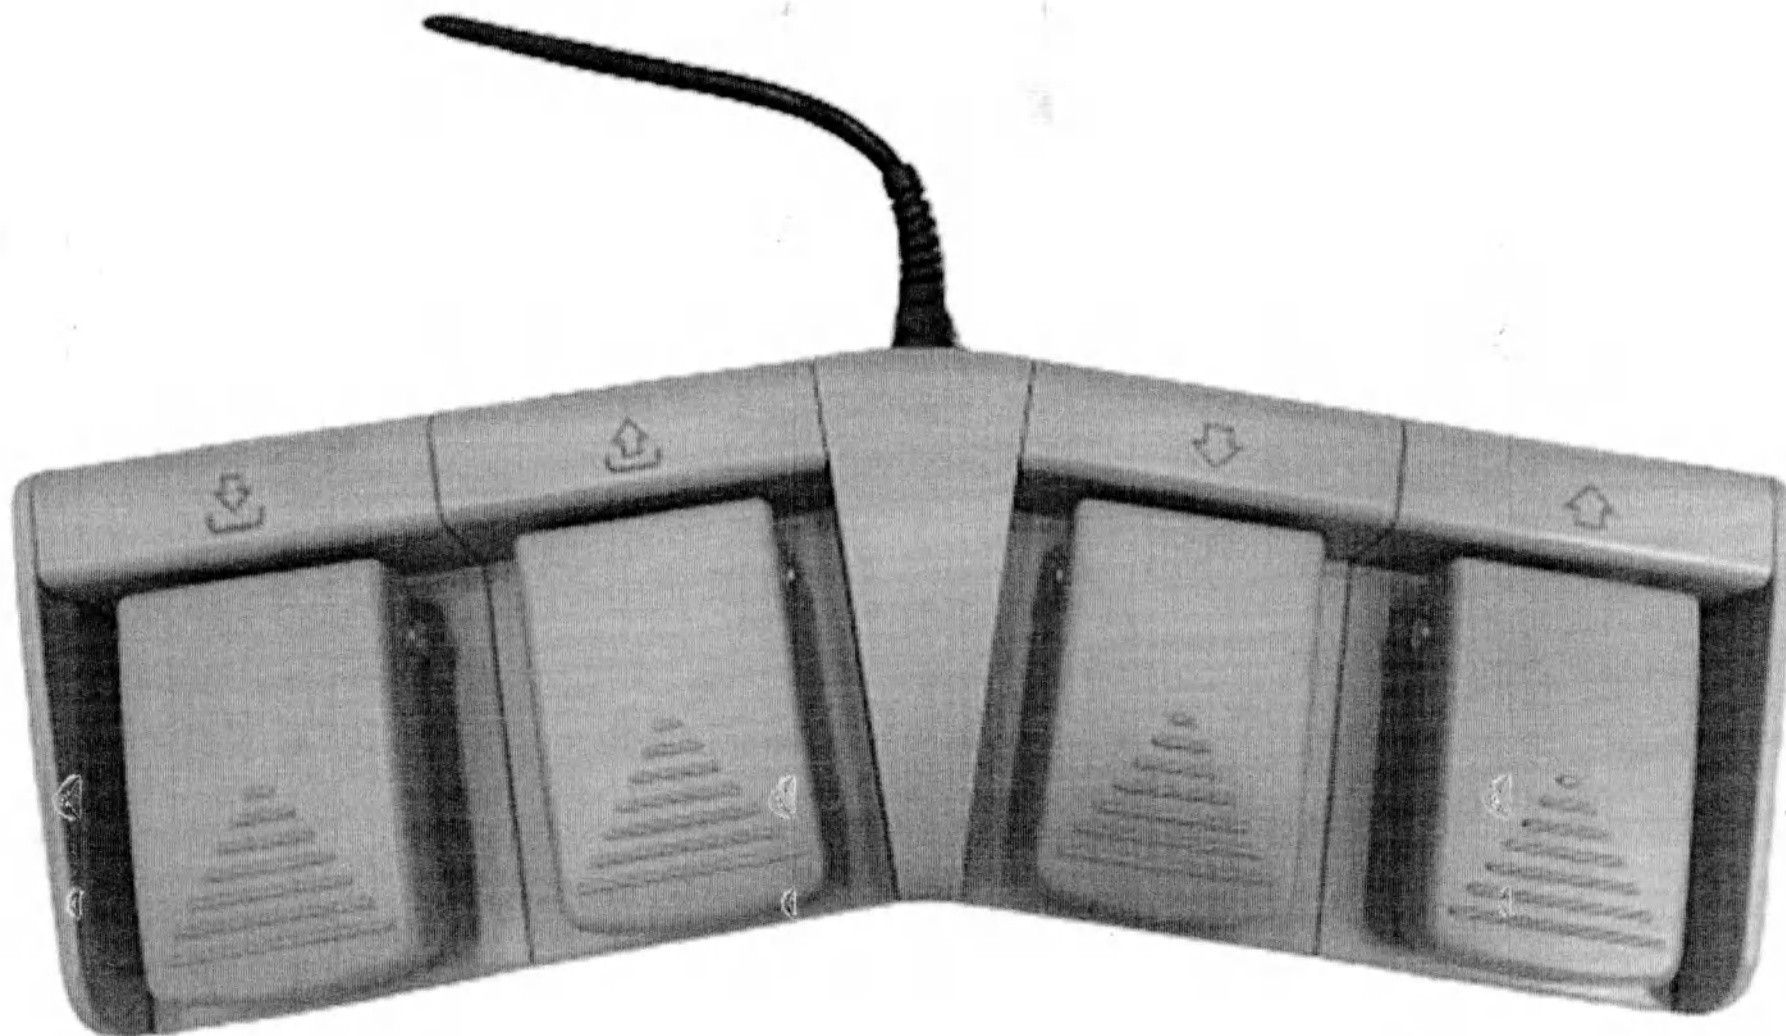

2. Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора AWS1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь:

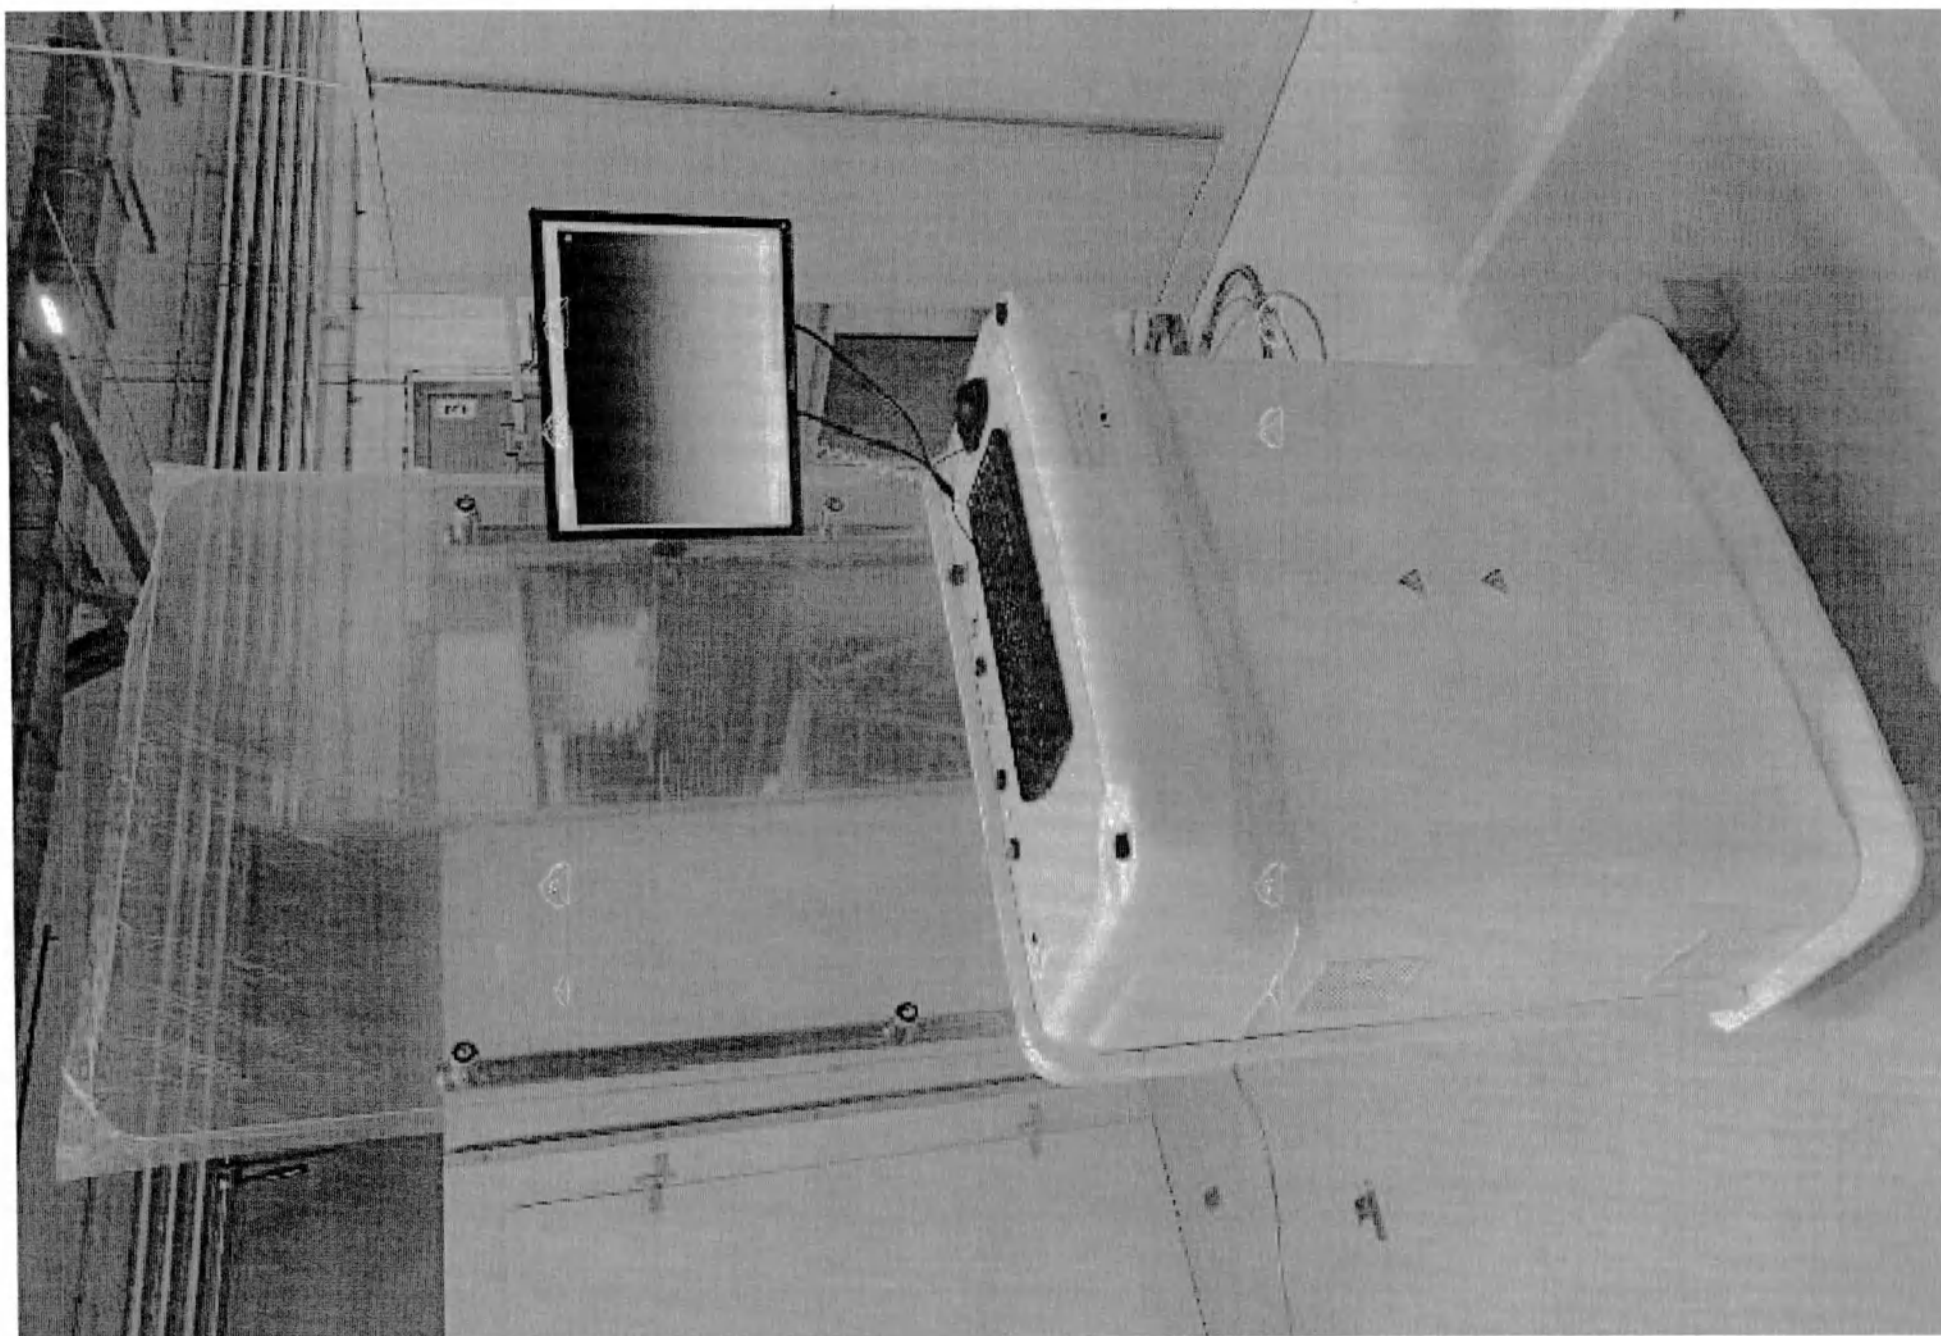

2.1. Медицинская рабочая станция AW1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

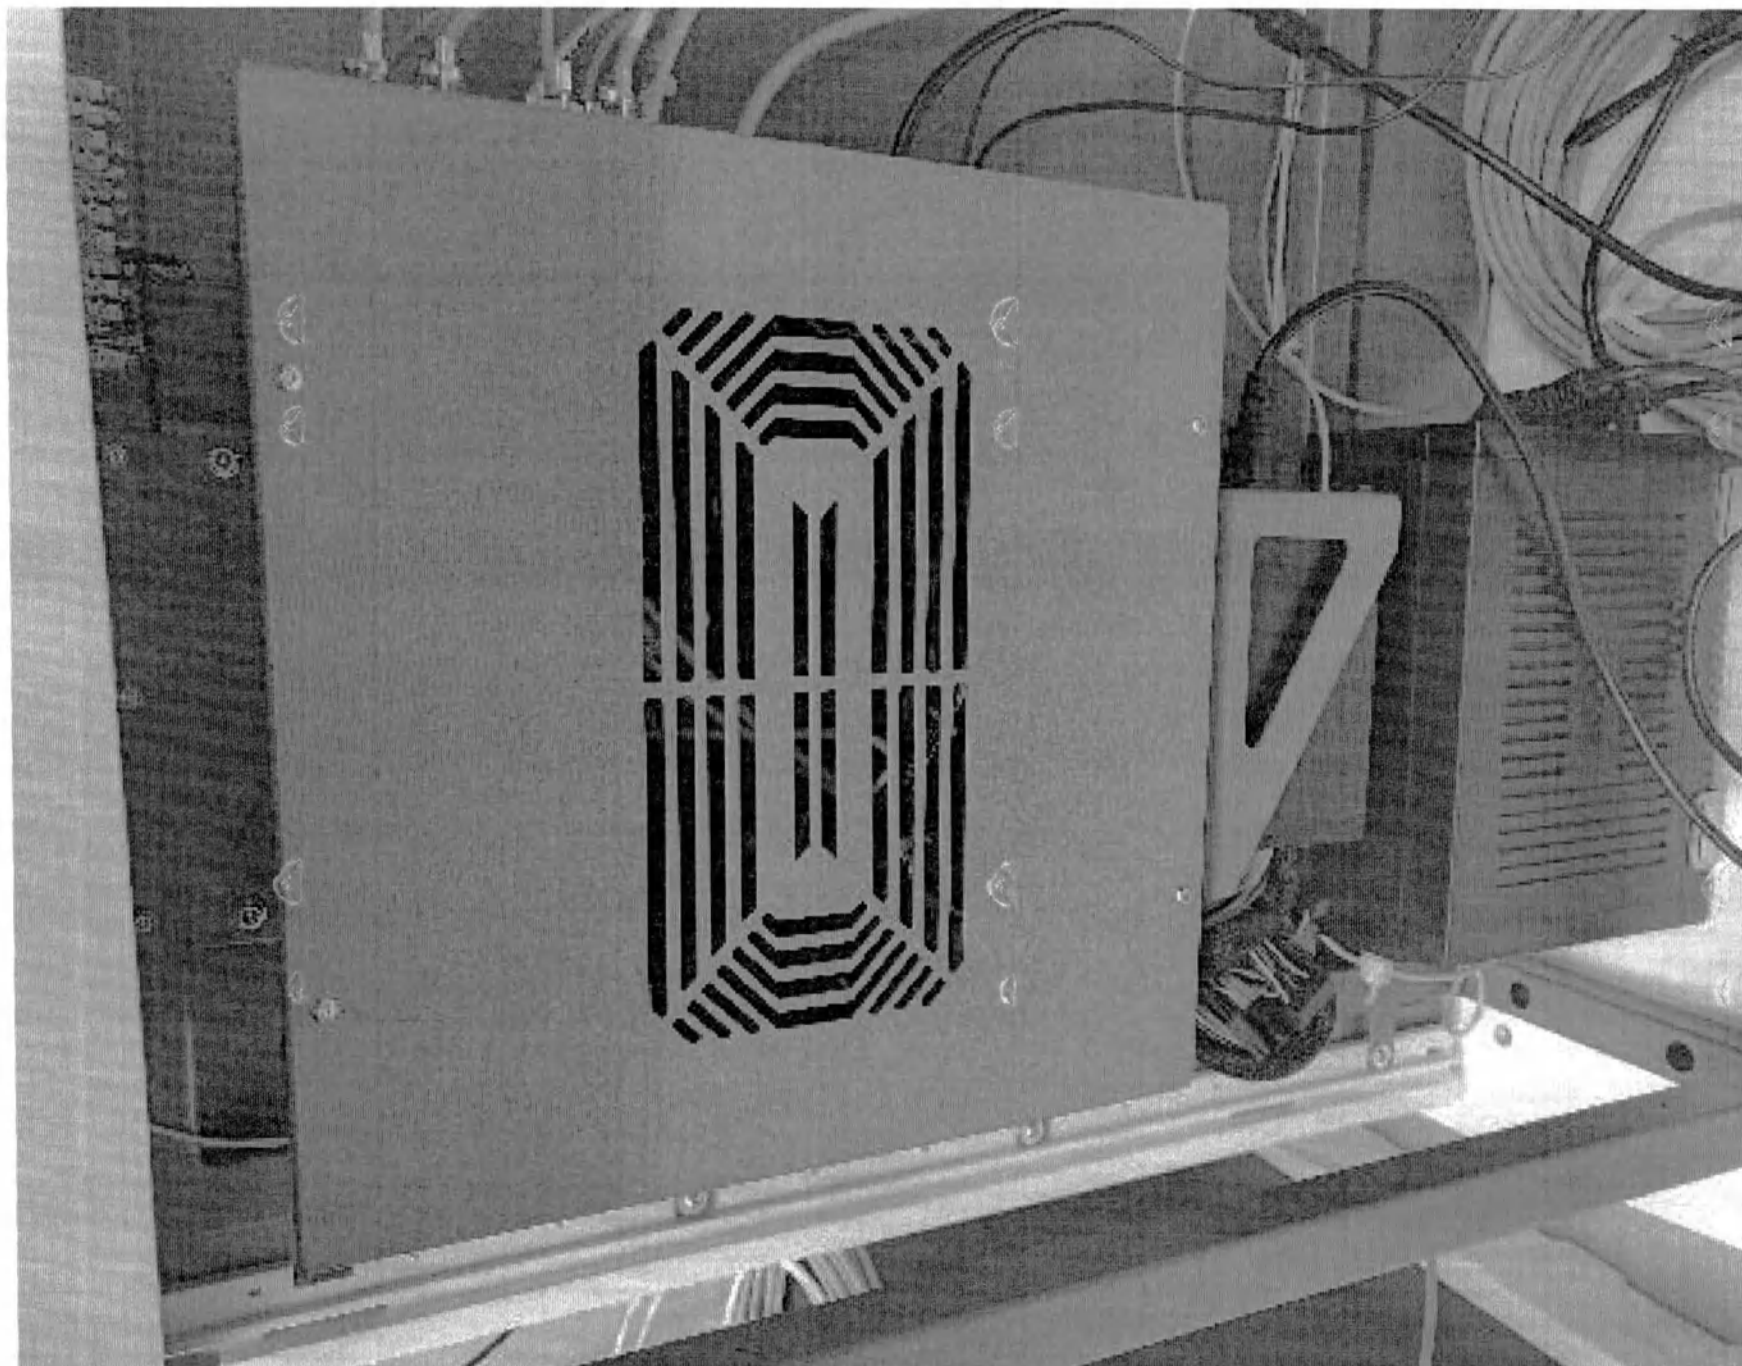

2.2. Монитор ЖК с диагональю от 19 до 24 дюймов производства MMD (Shanghai) Electronics Technology Co. Ltd, Китай;



или производства Wistron Corporation, Тайвань;




или производства Samsung Electronics Co. Ltd, Республика Корея.




2.3. Программный комплекс medMammoScan производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

ЗАО «АДВИН СМАРТ ФЭКТОРИ»


ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС "MEDMAMMOSCAN"

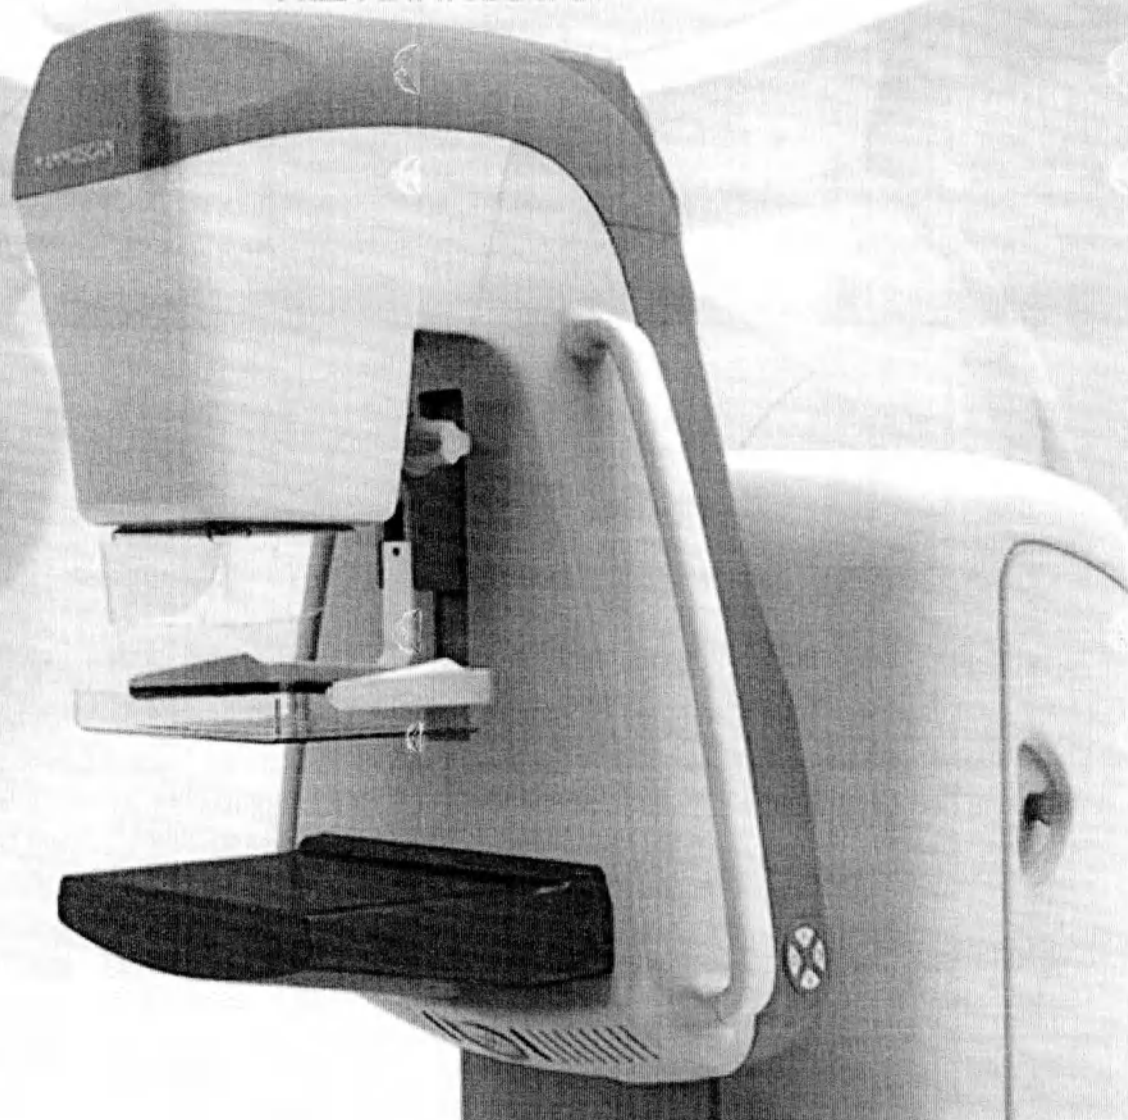

2.4. Рабочее место оператора OW2 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

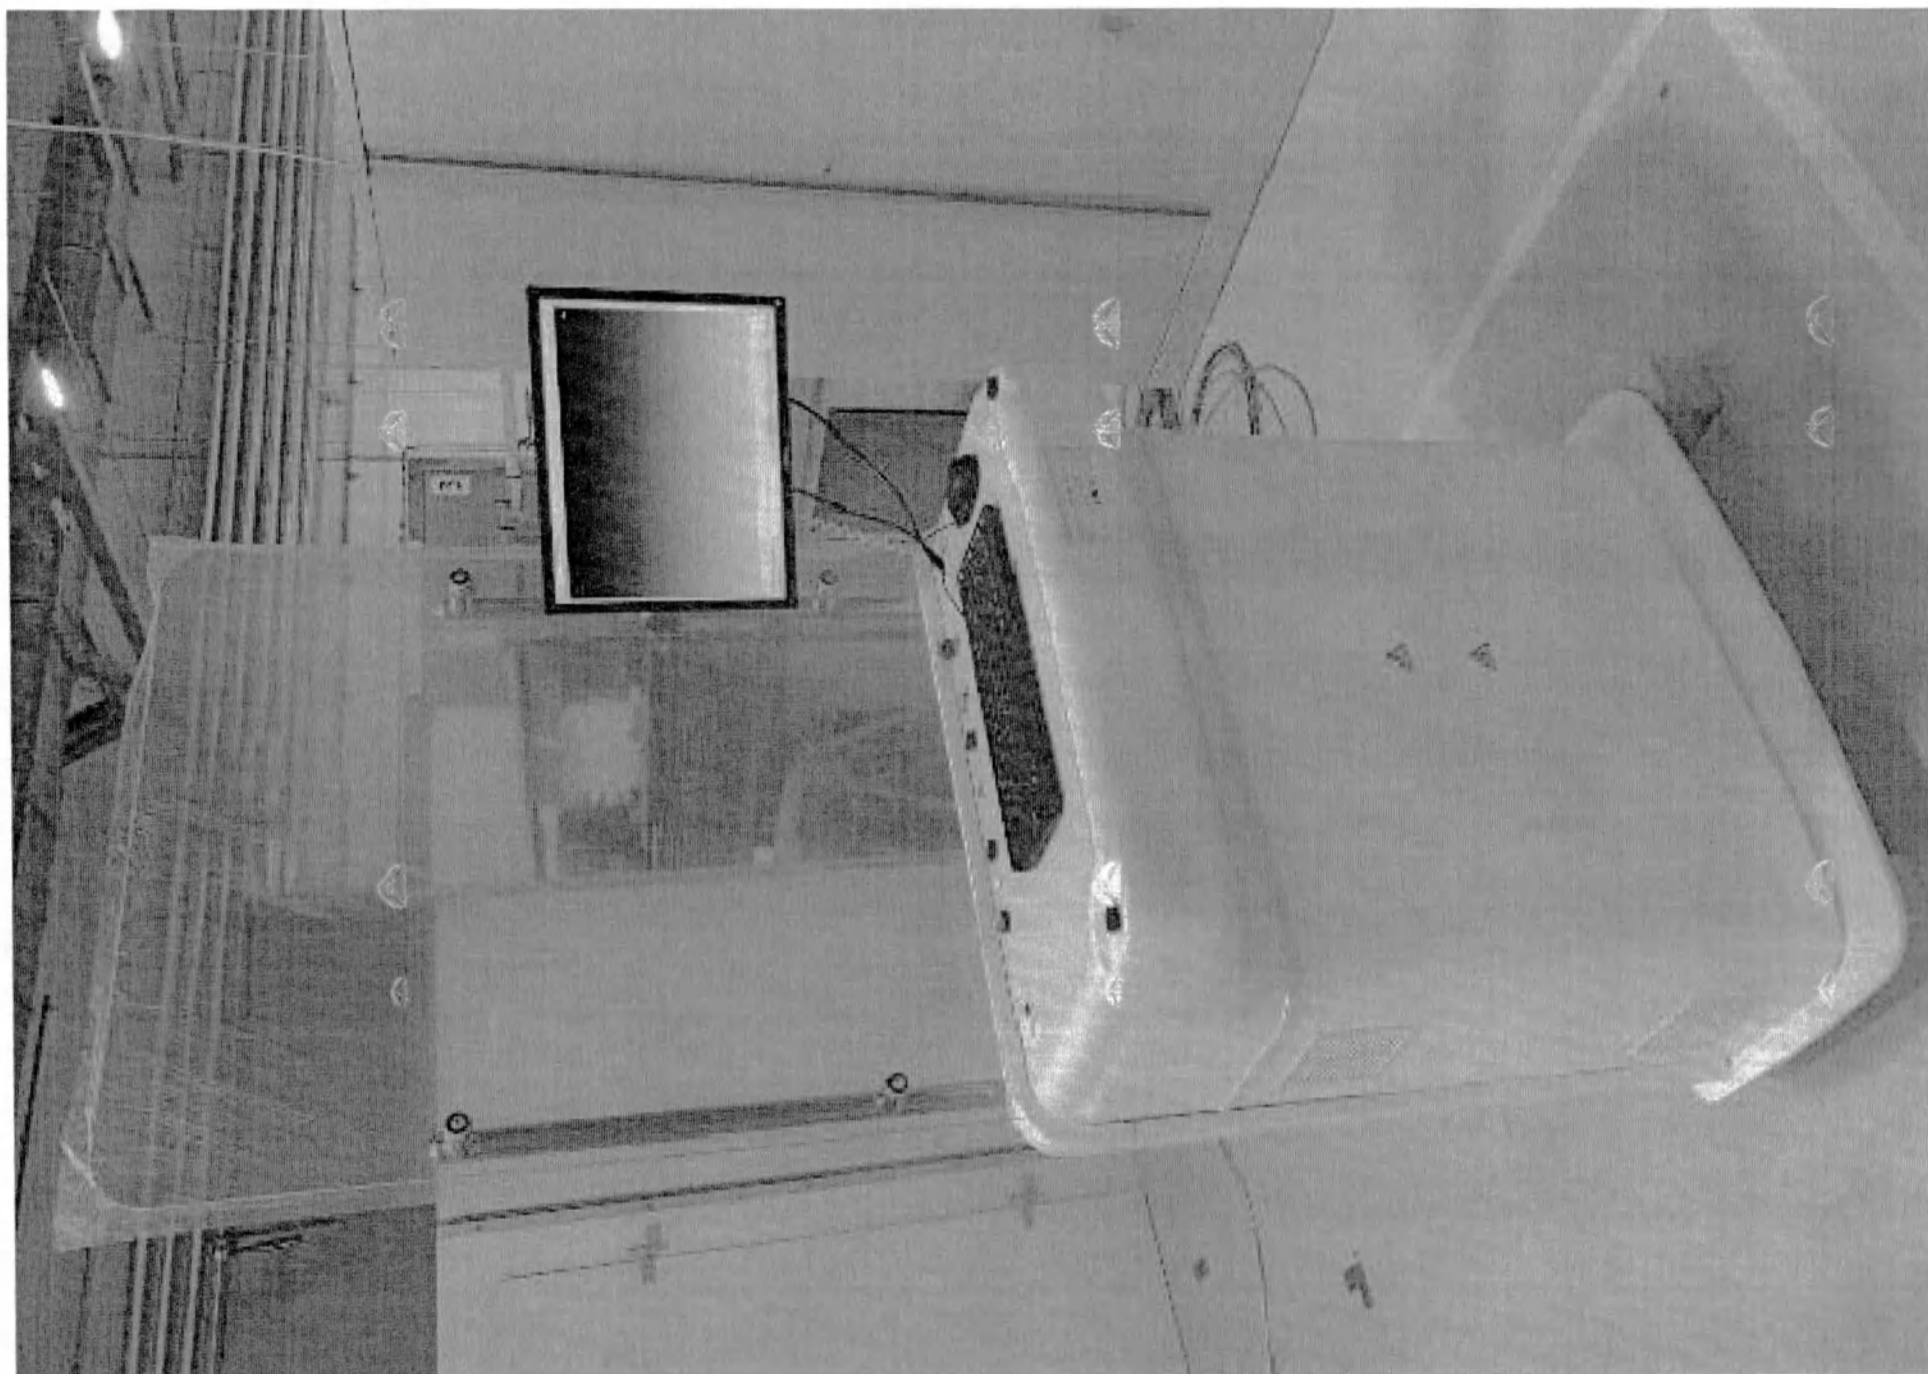

3. Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача рентгенолога AWD1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь:

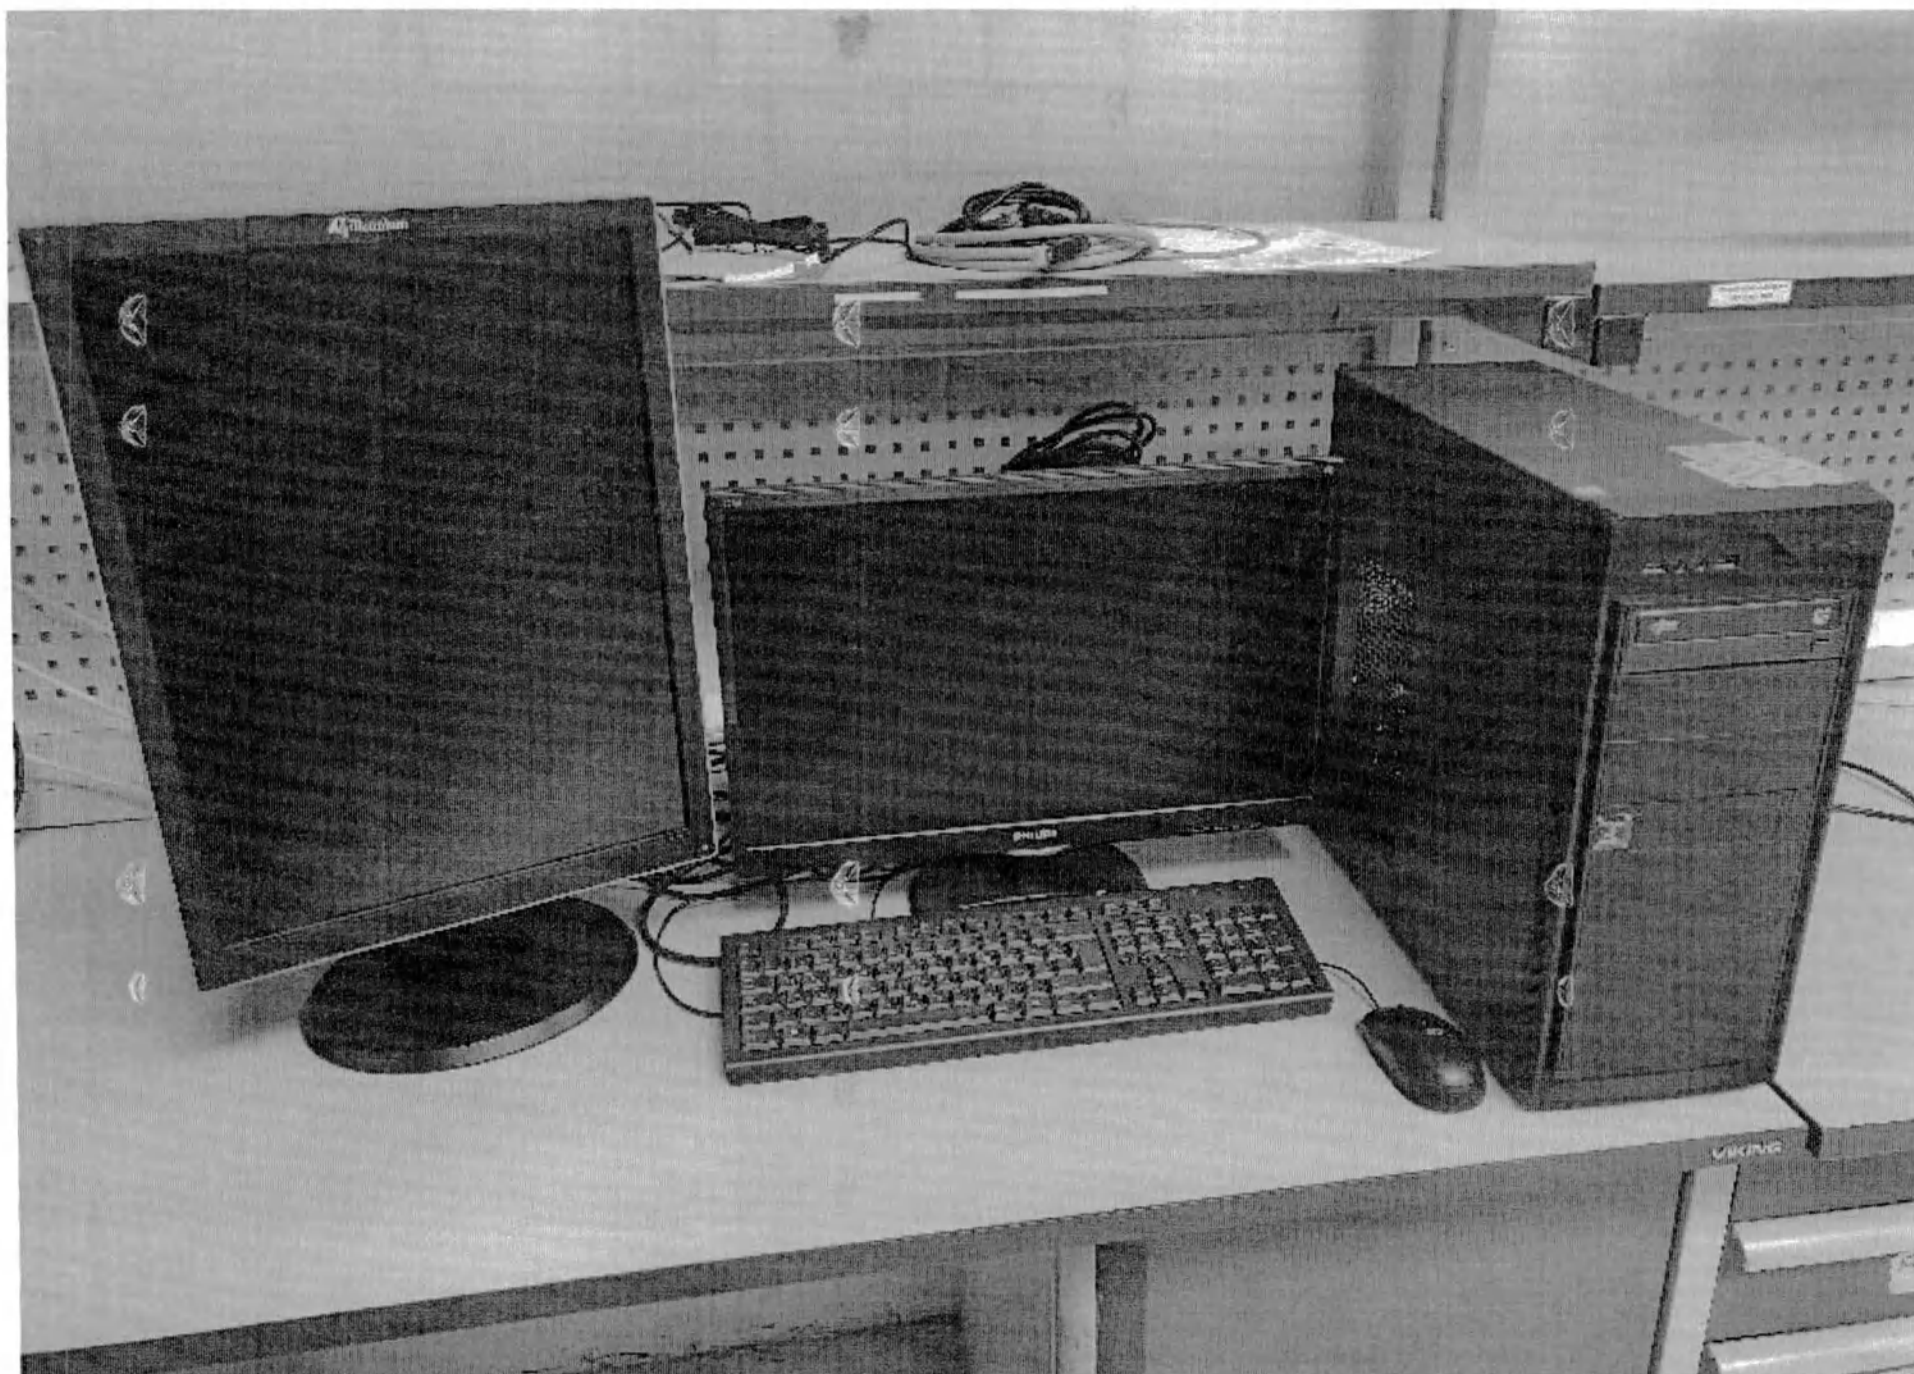

3.1. Медицинская рабочая станция DW1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь (при необходимости);



3.2. Монитор ЖК с диагональю от 19 до 24 дюймов производства MMD (Shanghai) Electronics Technology Co. Ltd, Китай;




или производства Wistron Corporation, Тайвань;




или производства Samsung Electronics Co. Ltd, Республика Корея;




3.3. Монитор медицинский диагностический с диагональю от 21 до 40 дюймов серии MS производства JVCKENWOOD Corporation, Япония;

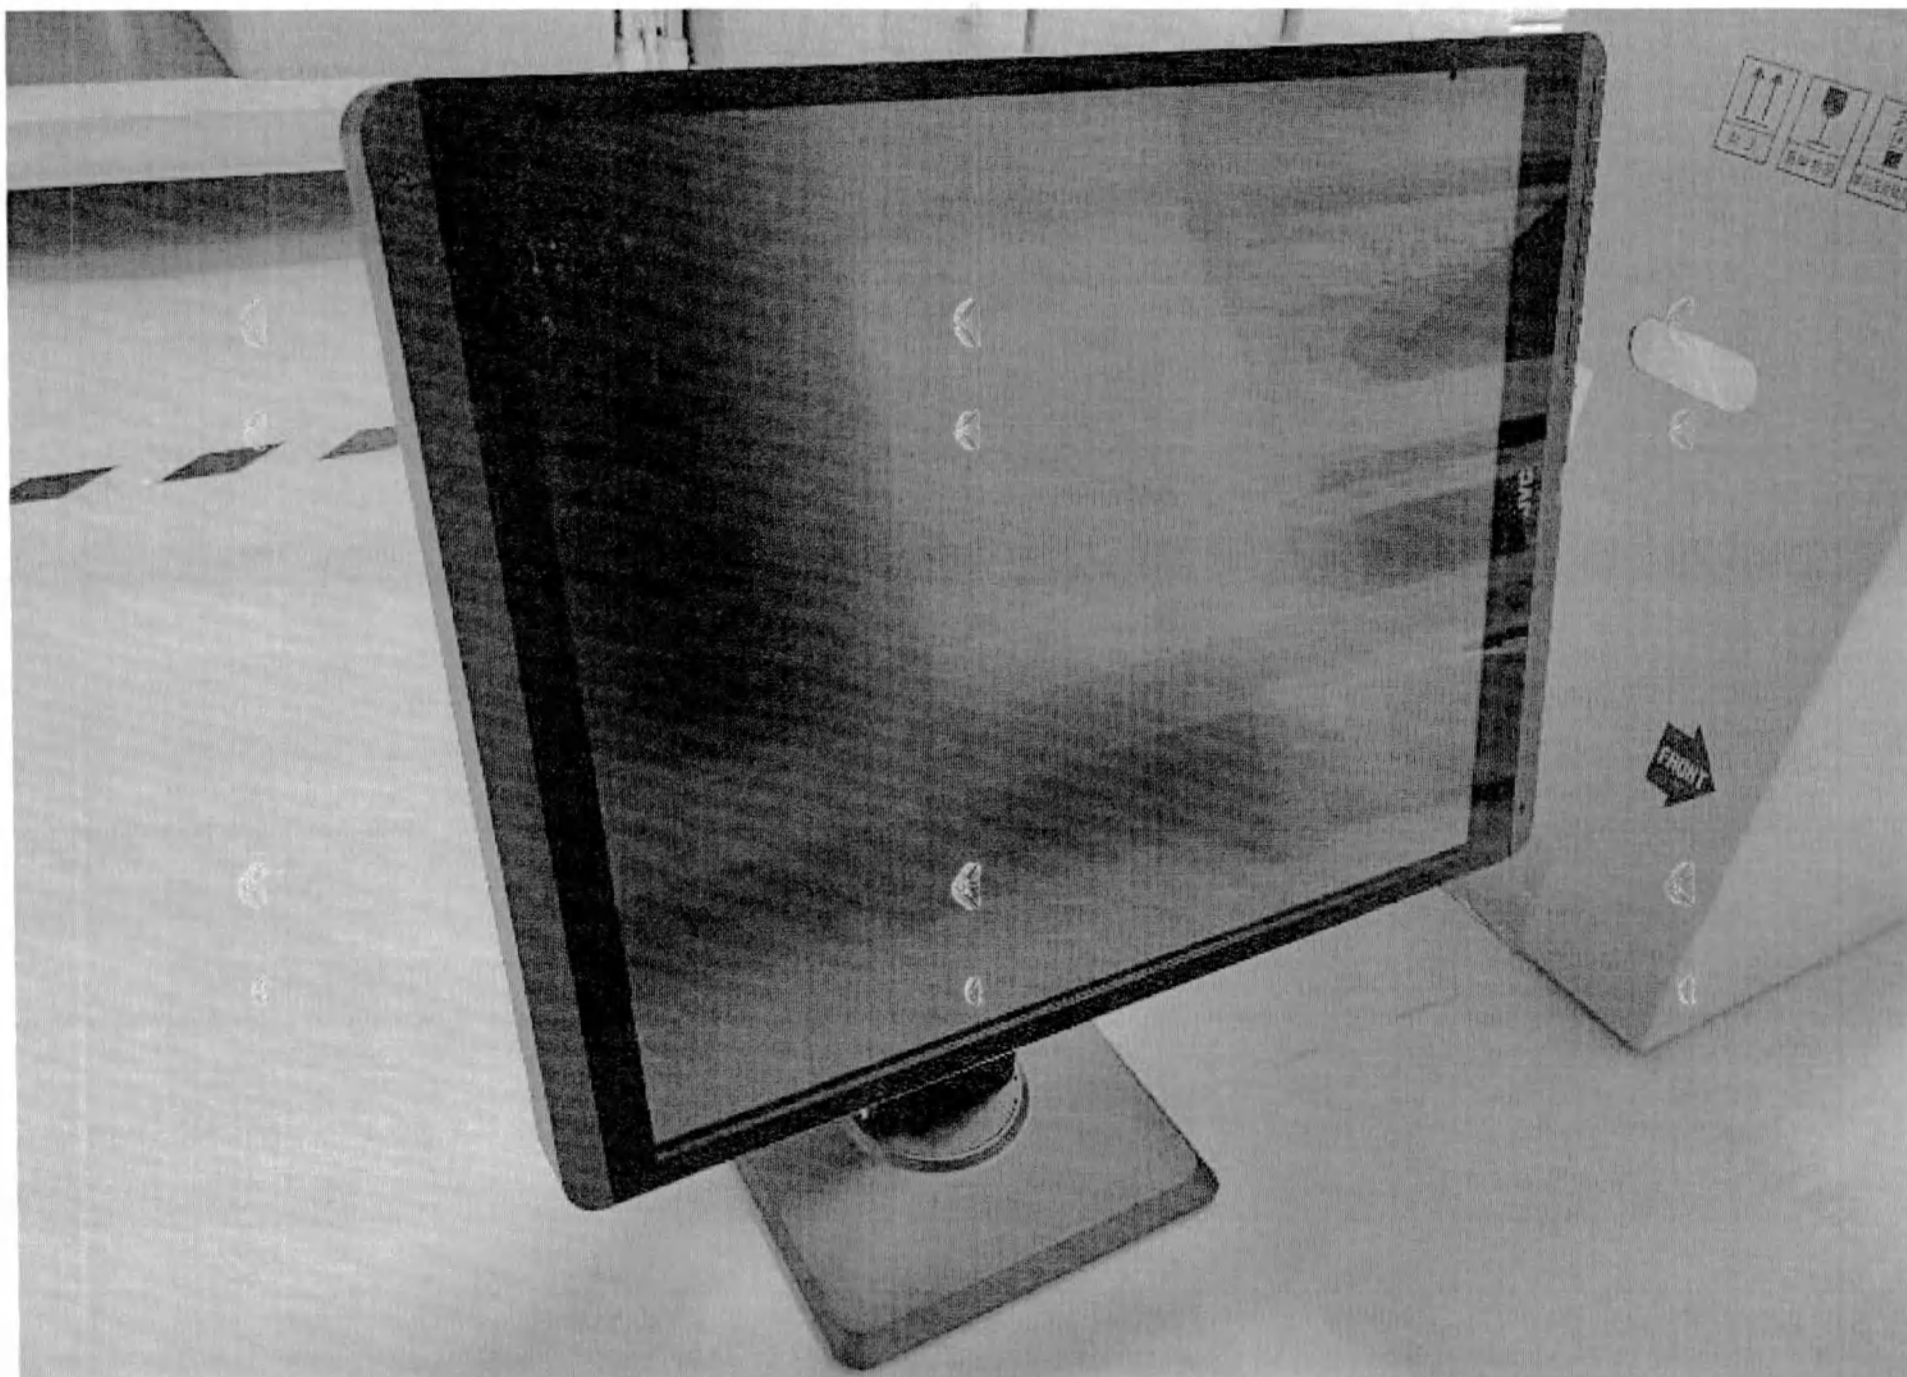


или серии G производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd., Китай;

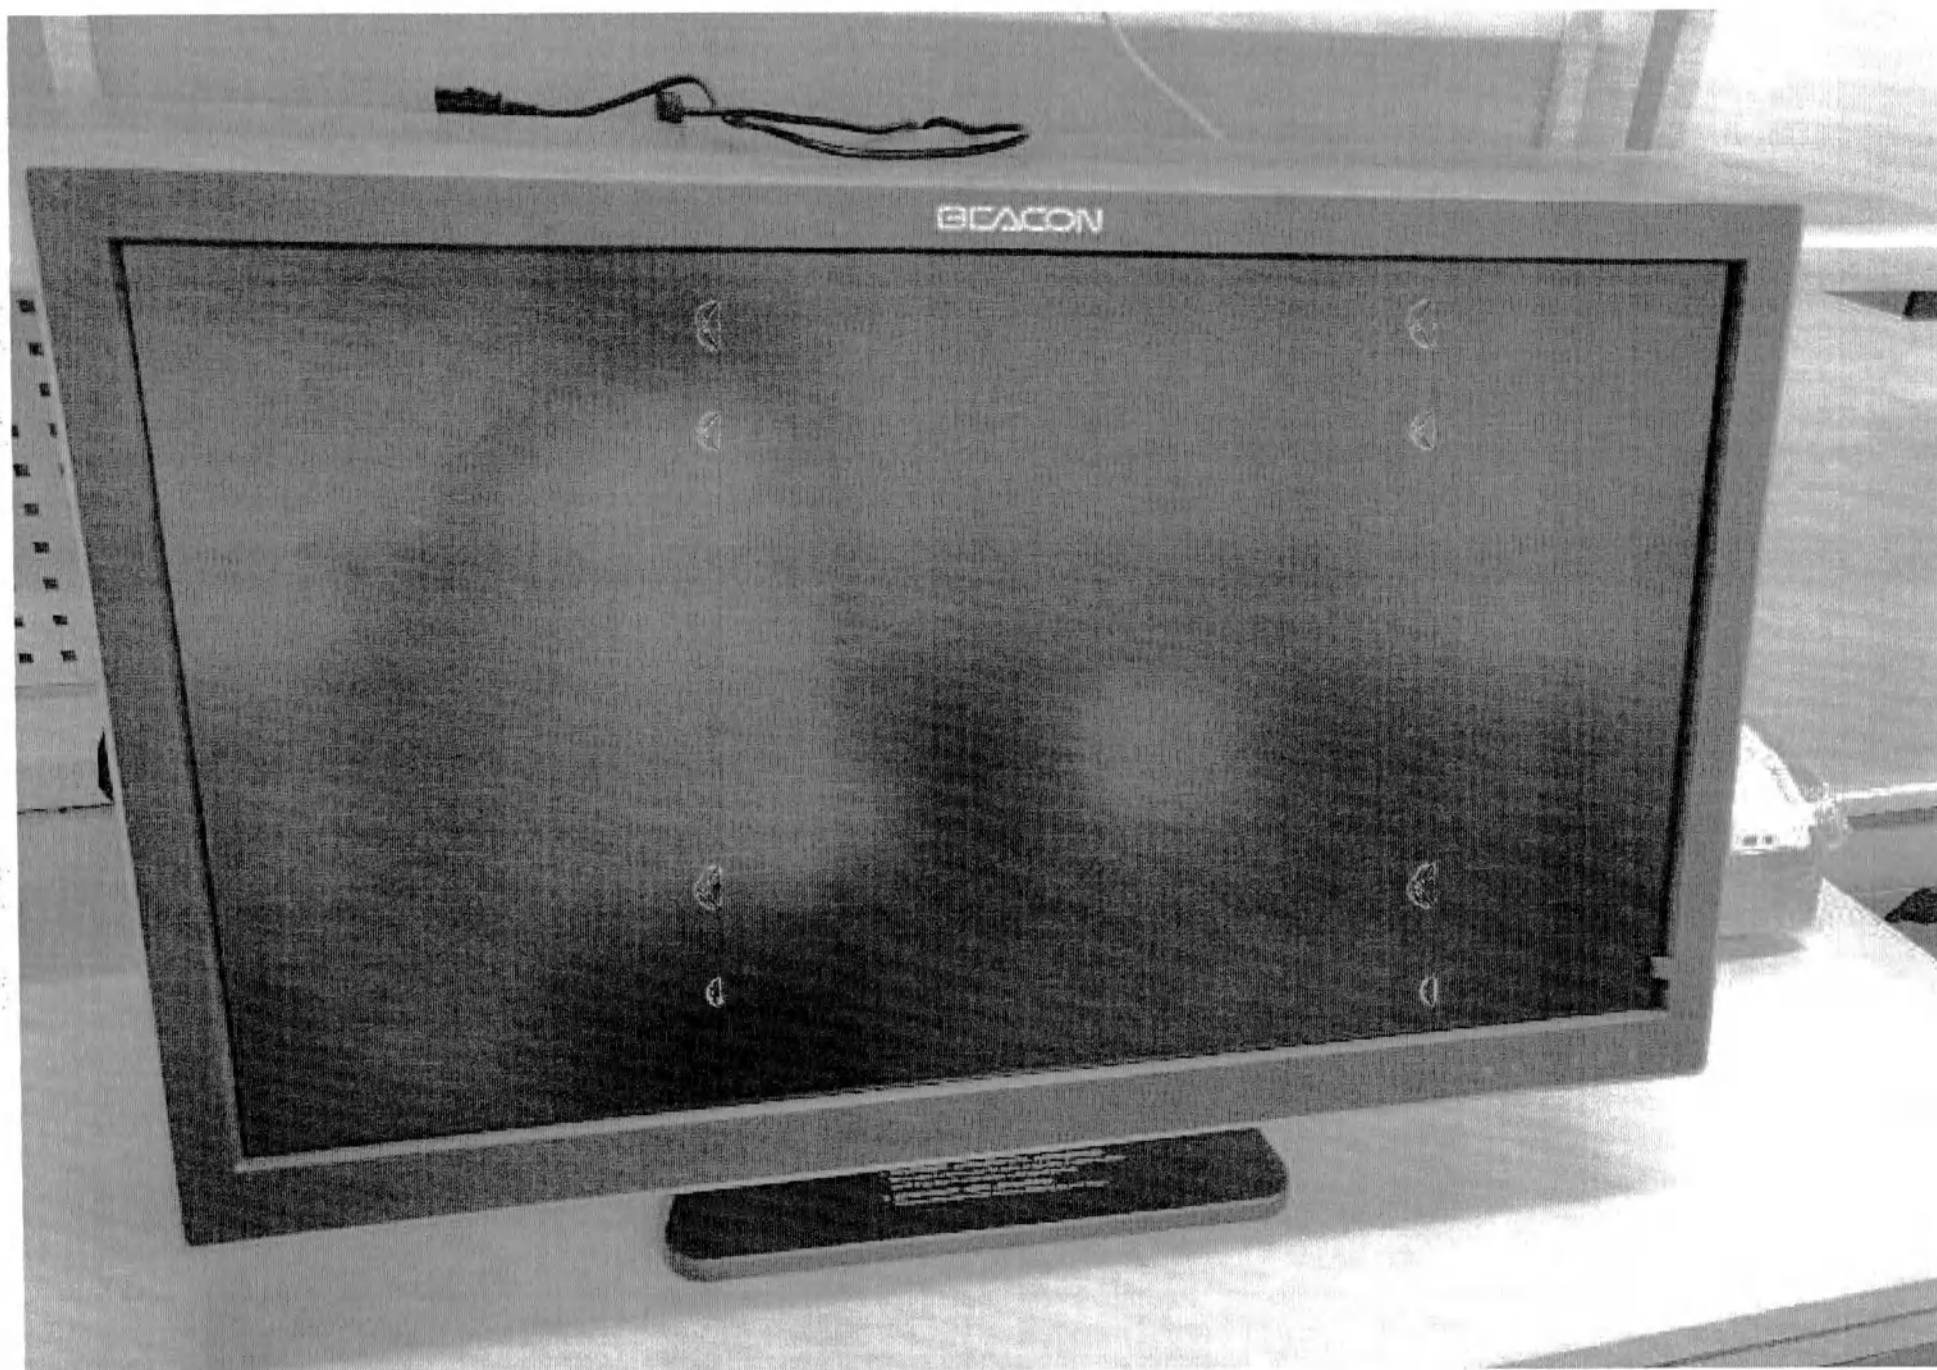


или серии MX производства Foreseeson GmbH, Германия;

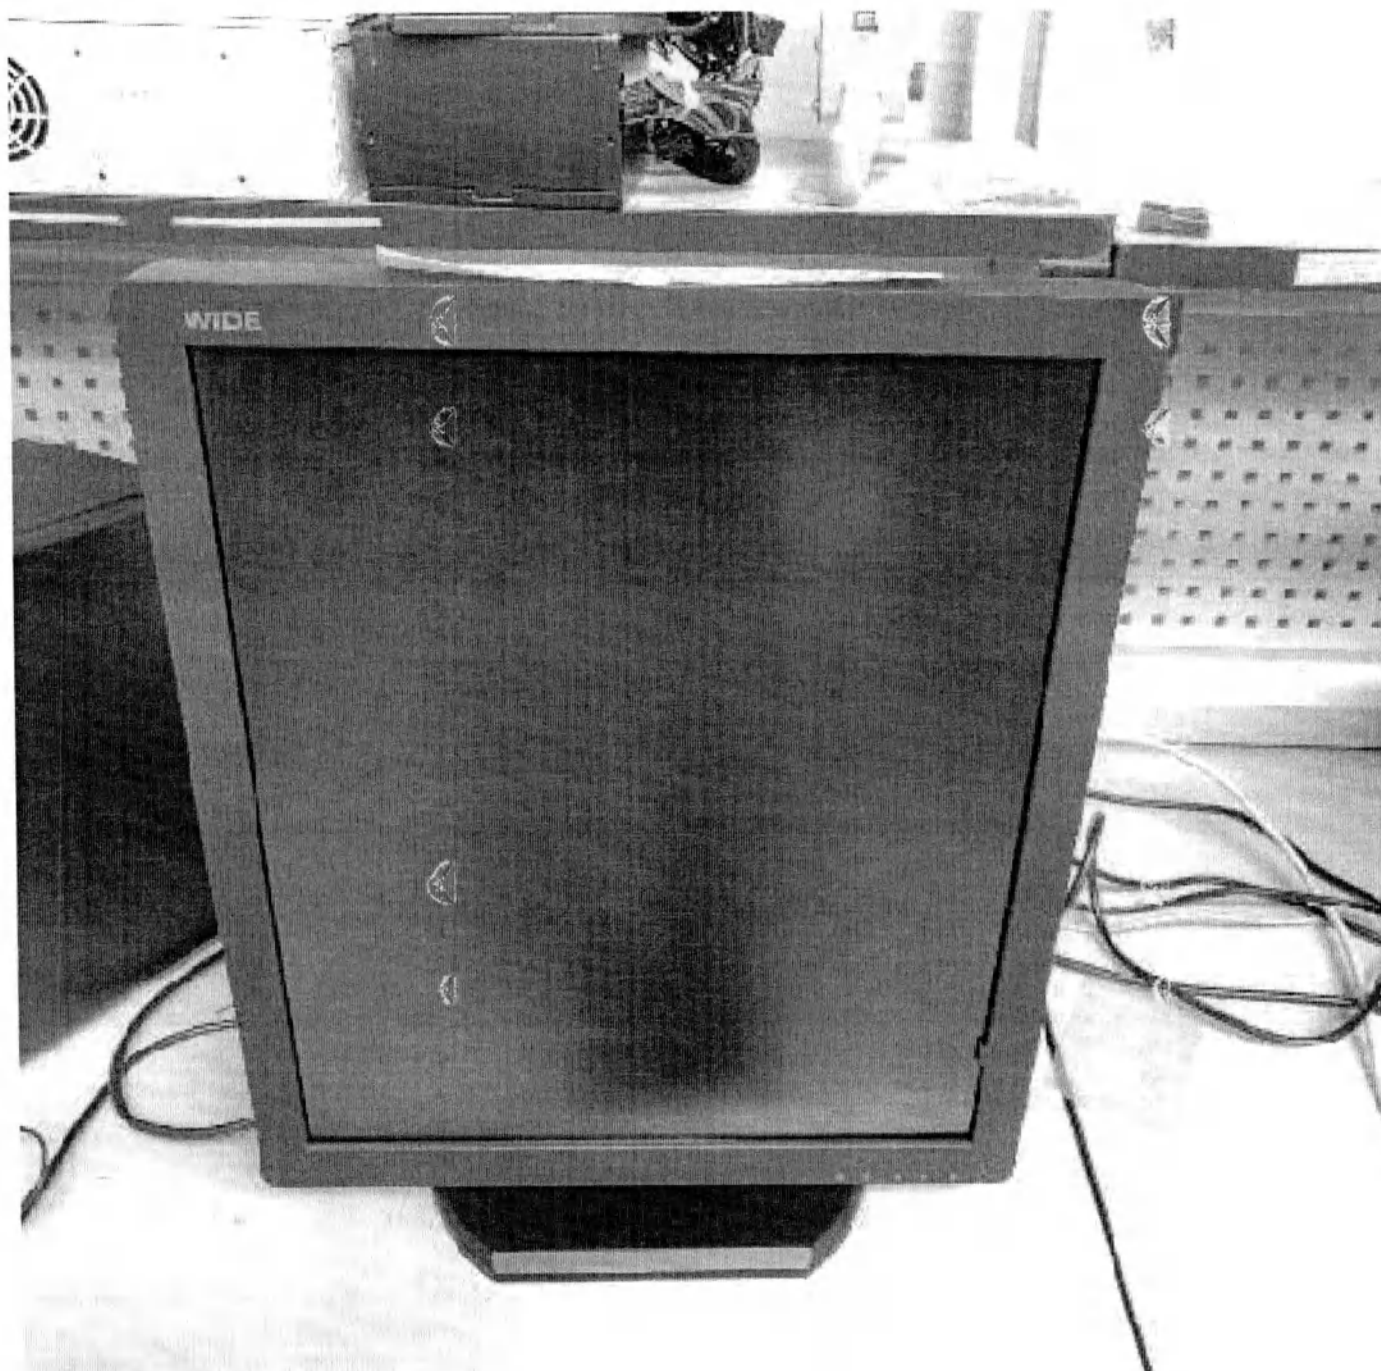


или серии М производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd., Китай;

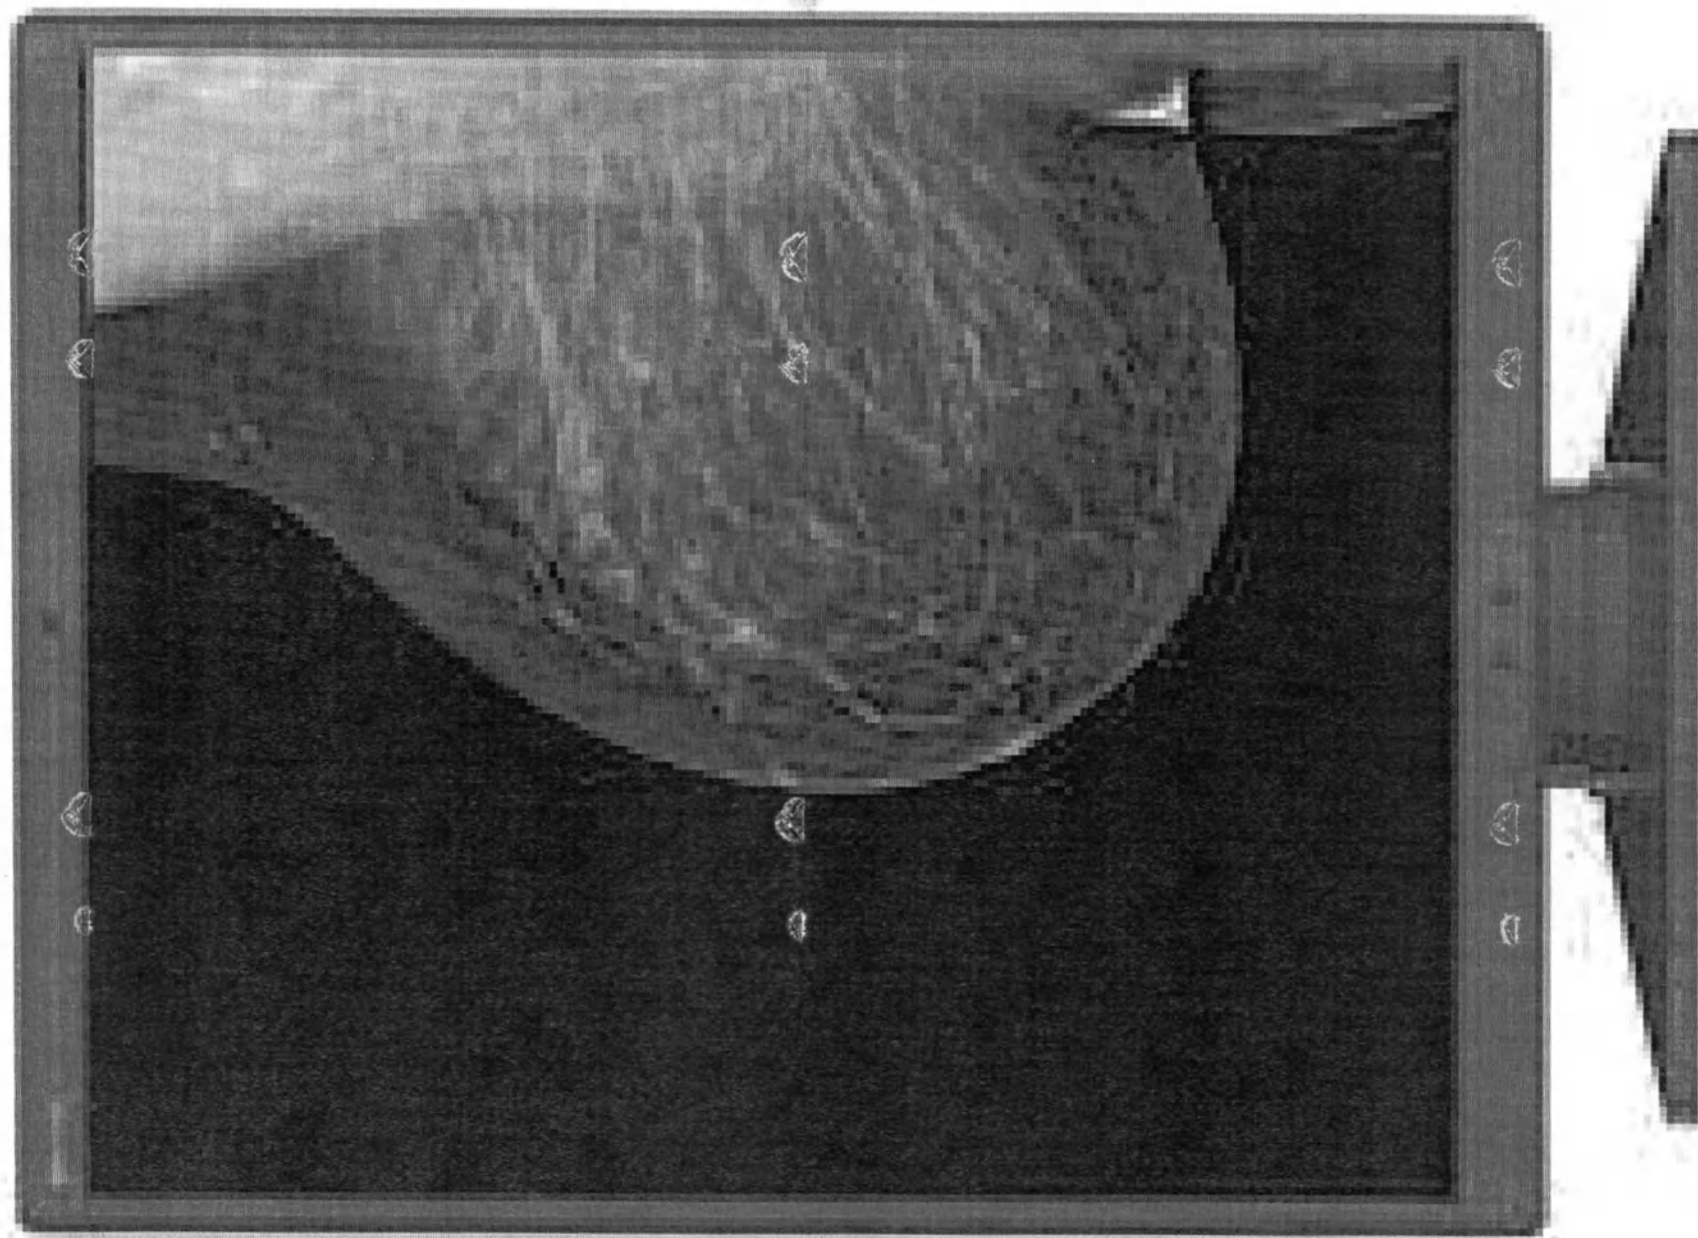

или серии 21X производства Shenzhen KTC Medical Solutions Co., Ltd. Китай.

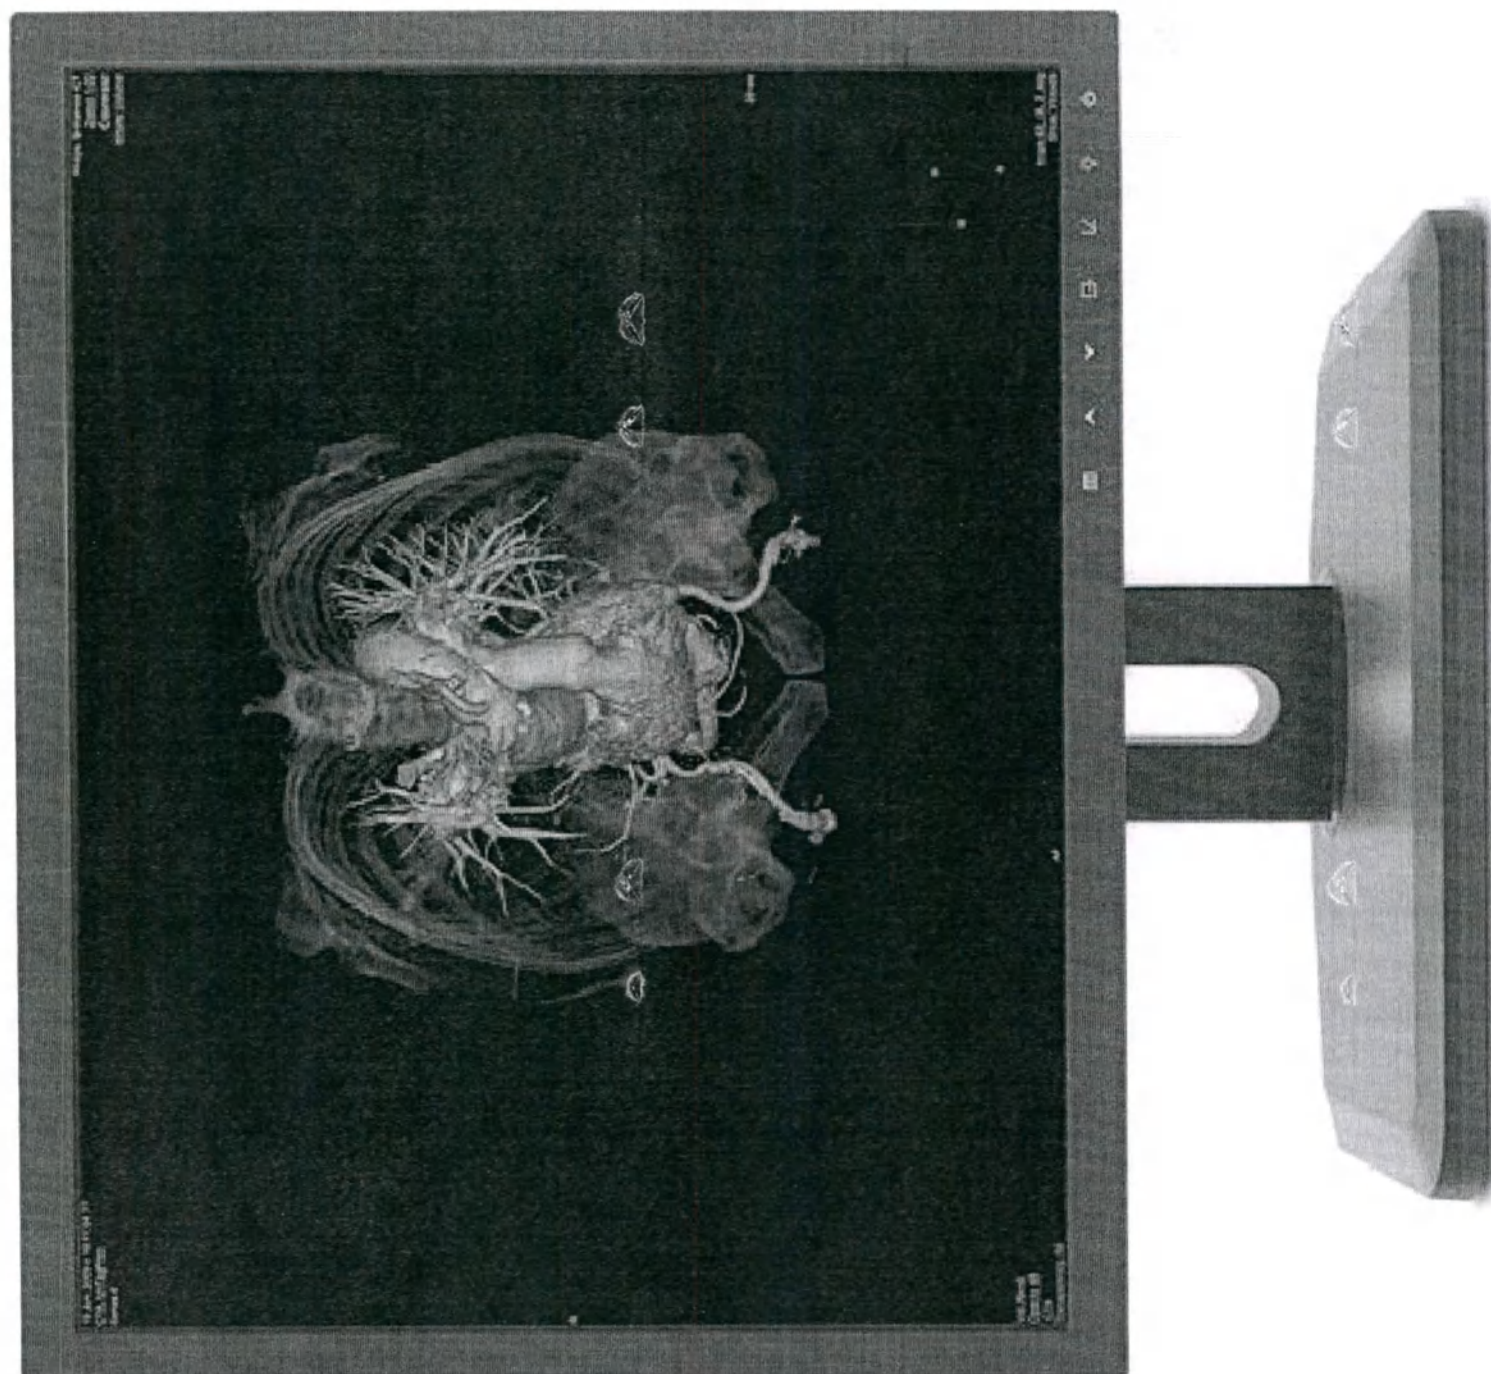


3.4. Программный комплекс MedXView производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь;

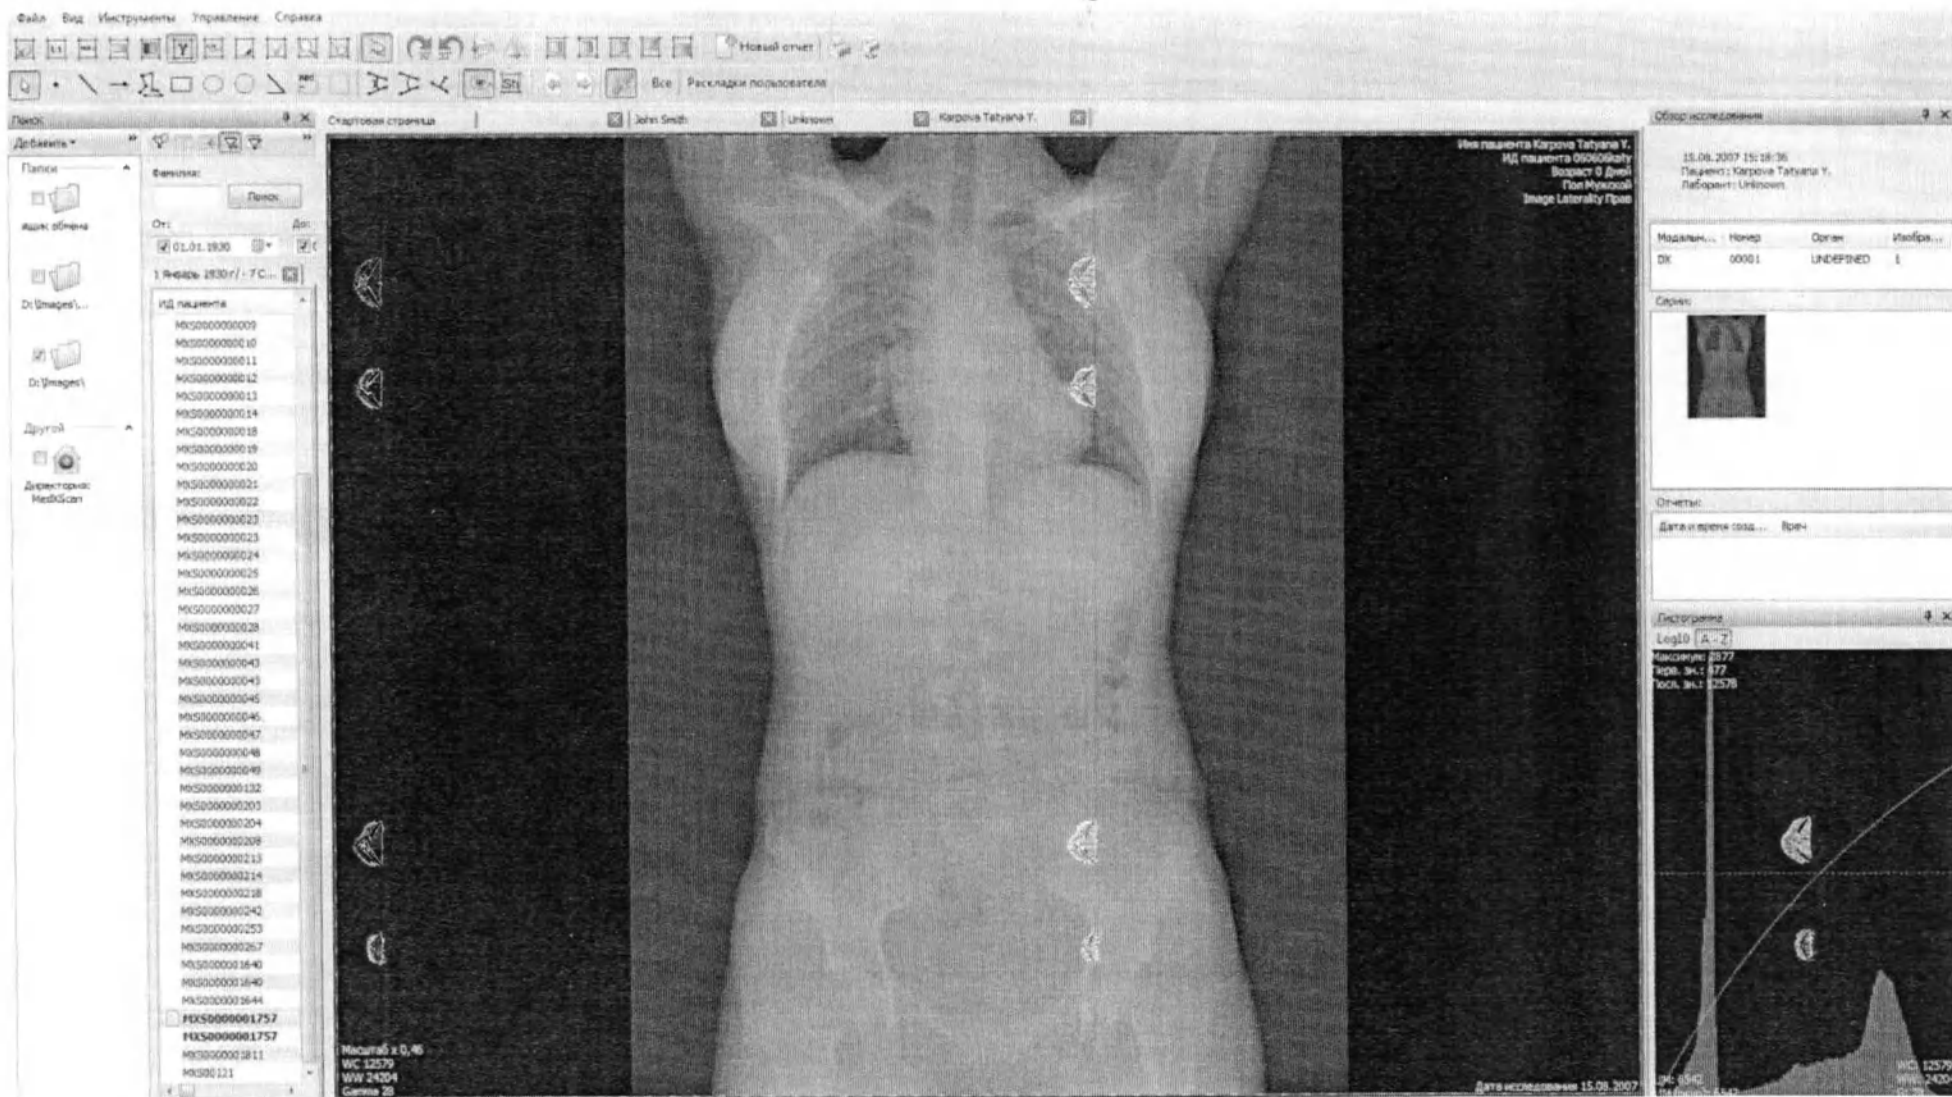


или программное обеспечение специализированное «АПК АрхиМед» по ТУ 62.01.29-002-98944313-2015 производства ООО «Мед-Рей», Российская Федерация (РУ № РЗН 2019/8485);



или комплекс аппаратно-программный автоматизированной обработки и протоколирования медицинских диагностических исследований «АрхиМед» по ТУ 9440-001-98944313-2007 производства ООО «Мед-Рей», Российская Федерация (РУ № ФСР 2008/02715);

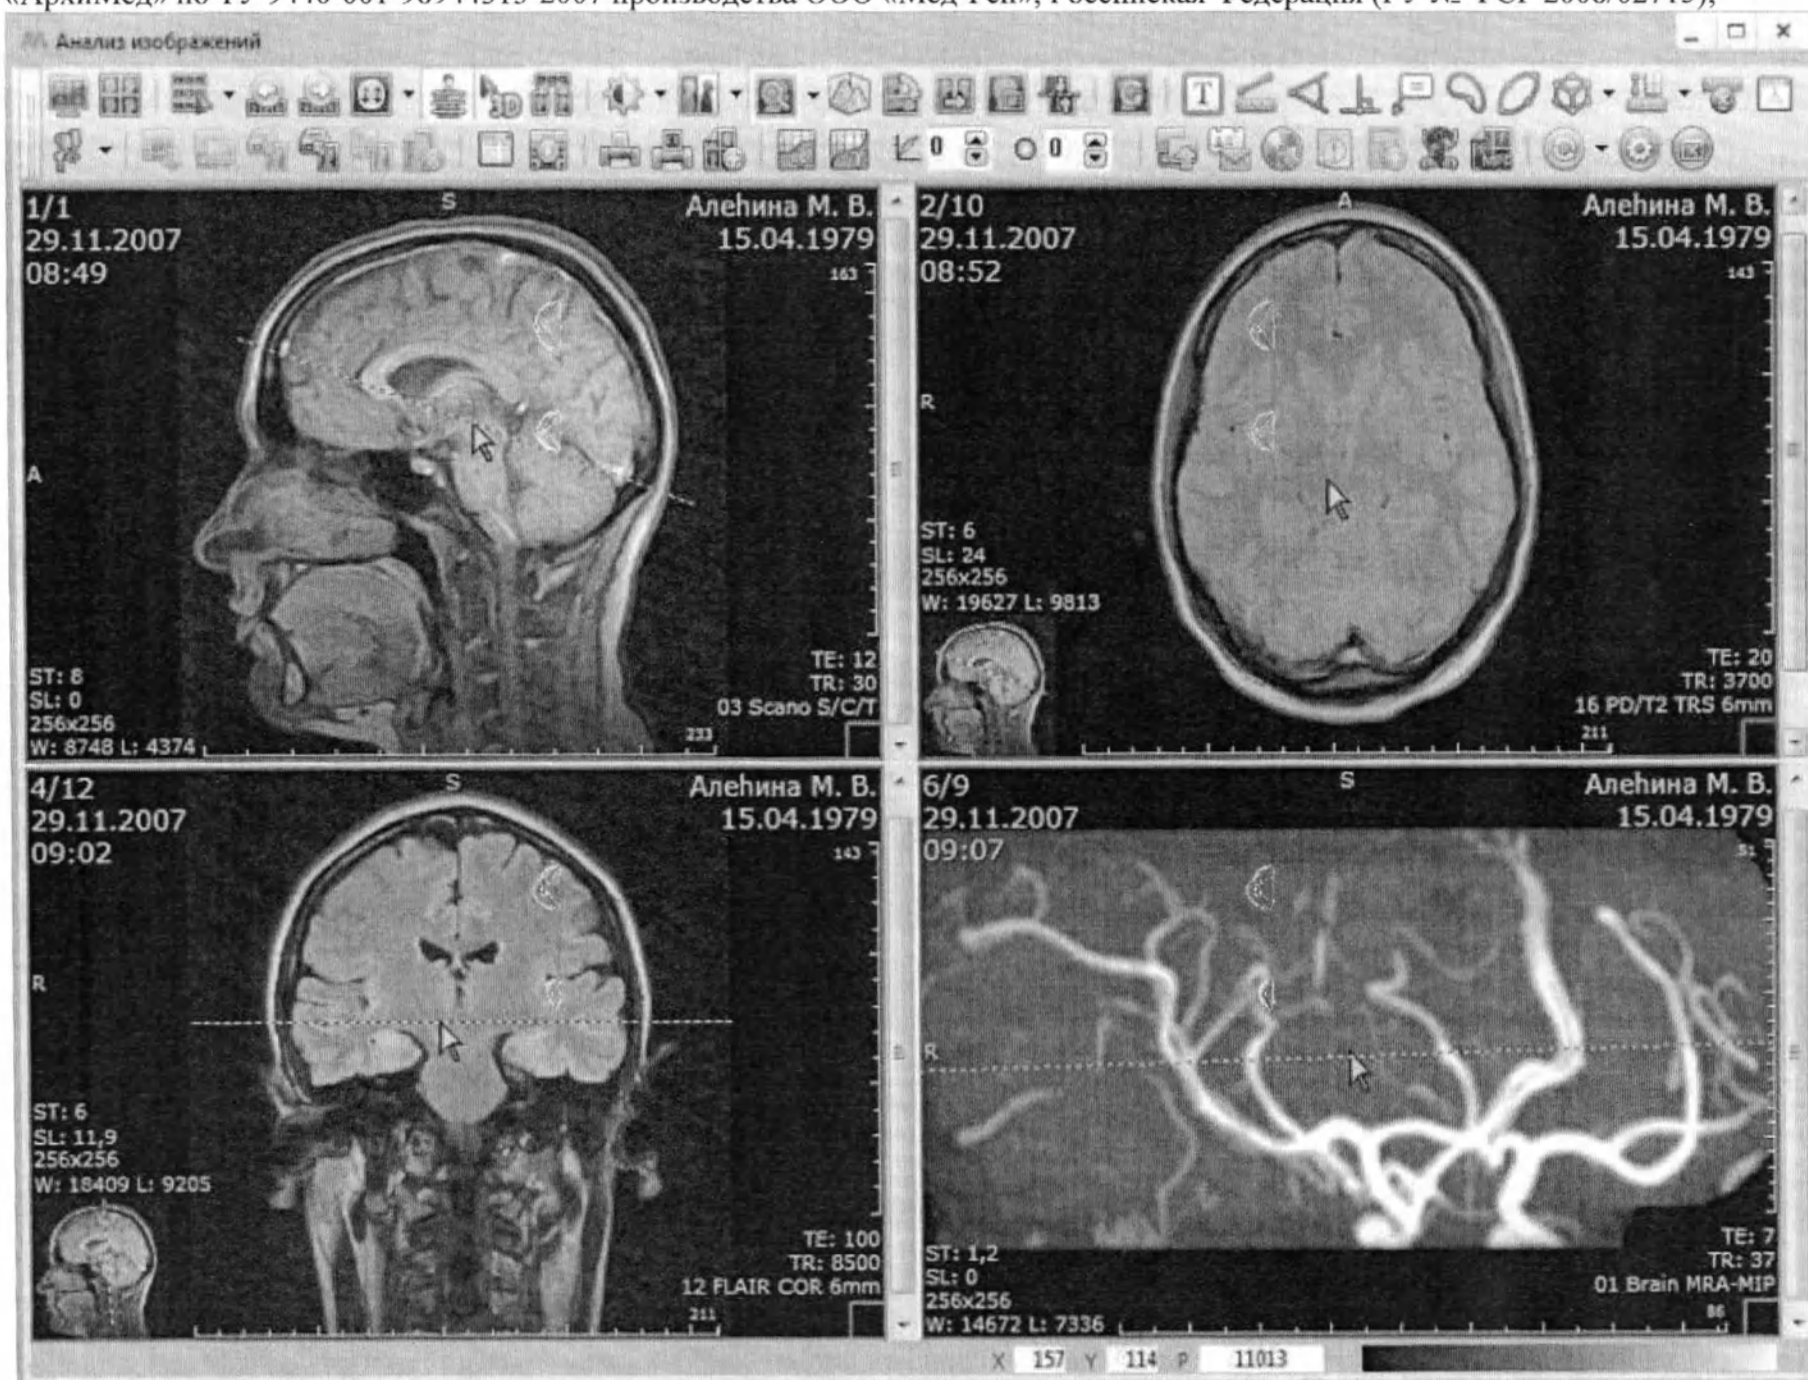


или комплекс программ для визуализации, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон DICOM Архив» по ТУ 9442-133-38226244-2015 ООО «ЛИНС», Российская Федерация (РУ № РЗН 2017/5621); или комплекс программ для визуализации, обработки, архивирования и экспорта медицинских изображений и данных «ЛИНС Махаон Рабочая станция врача» по ТУ 9442-233-38226244-2015 ООО «ЛИНС», Российская Федерация (РУ № РЗН 2017/5616);

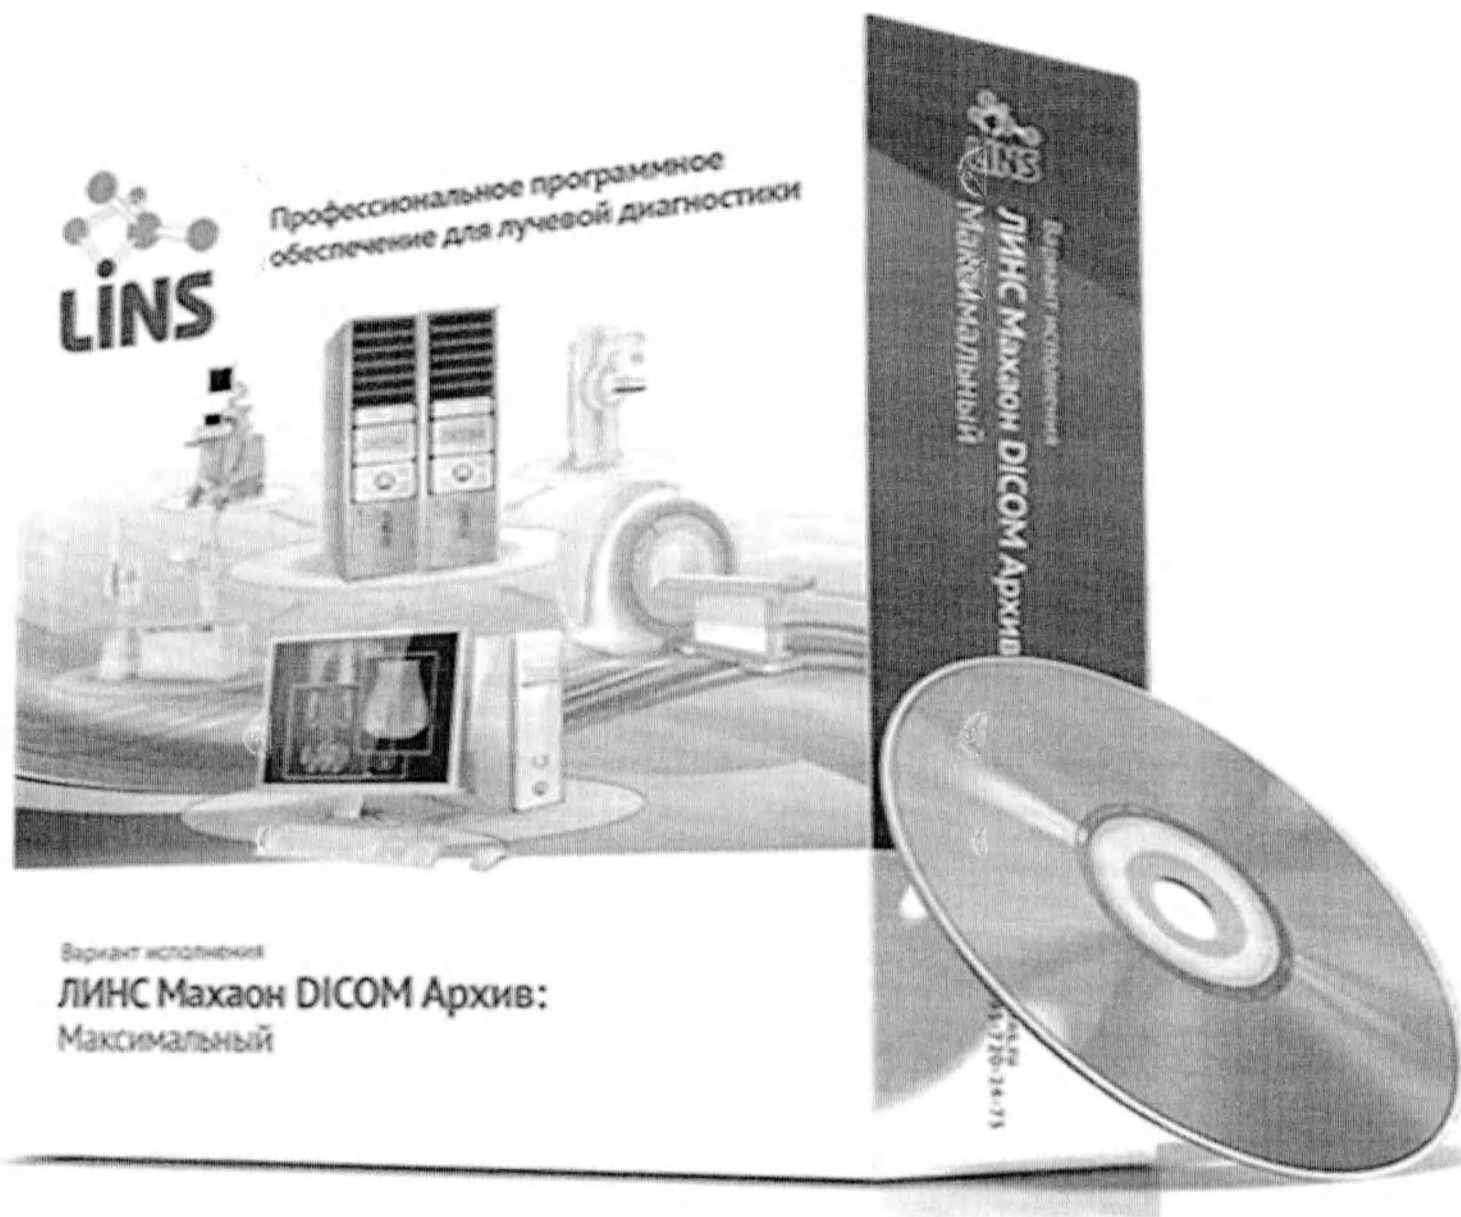

[illegible]

или программно-аппаратный комплекс ПАК получения, обработки, трехмерной реконструкции, передачи и хранения, медицинских диагностических изображений «Комета 3Di PACS» производства ООО «Комета», Российская Федерация (РУ № РЗН 2021/13248);

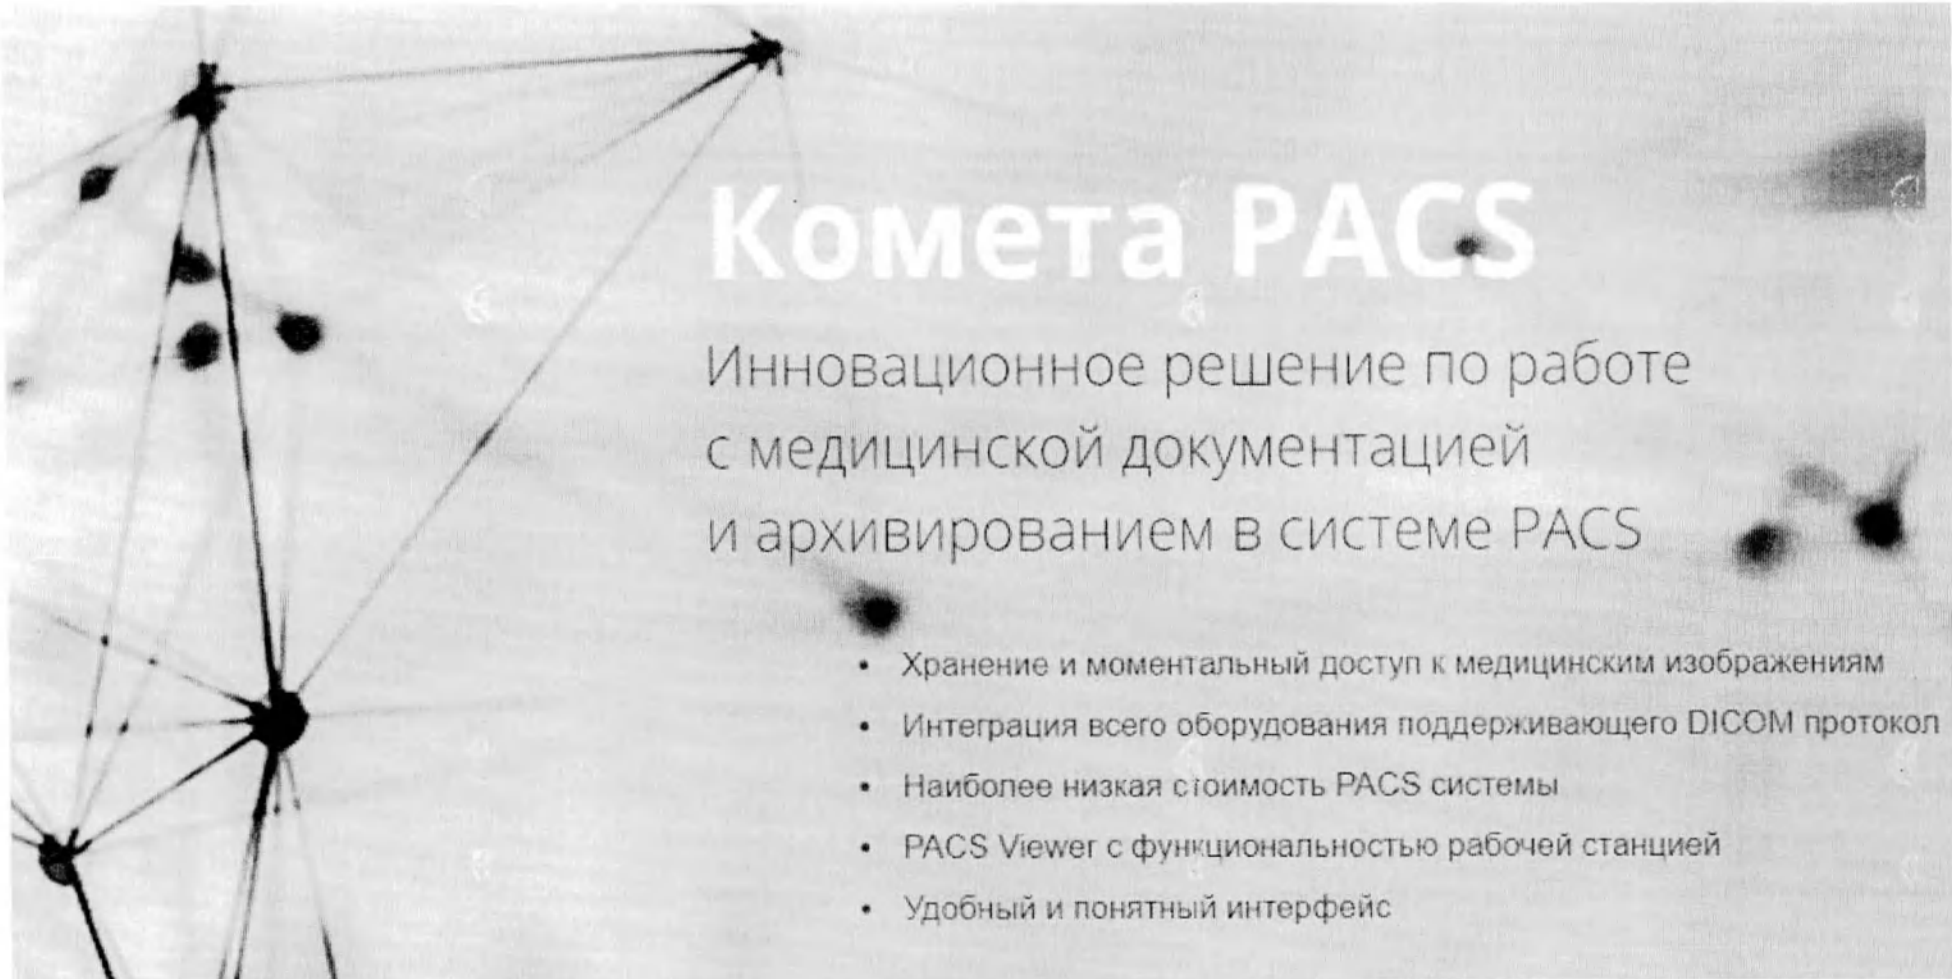

Комета PACS

Инновационное решение по работе с медицинской документацией и архивированием в системе PACS

- Хранение и моментальный доступ к медицинским изображениям
- Интеграция всего оборудования поддерживающего DICOM протокол
- Наиболее низкая стоимость PACS системы
- PACS Viewer с функциональностью рабочей станцией
- Удобный и понятный интерфейс


3.5. Принтер лазерный А4, ч/б производства Xerox Limited, Великобритания;




или производства Samsung Electronics Co Ltd, Республика Корея;



или производства HP Inc, США;

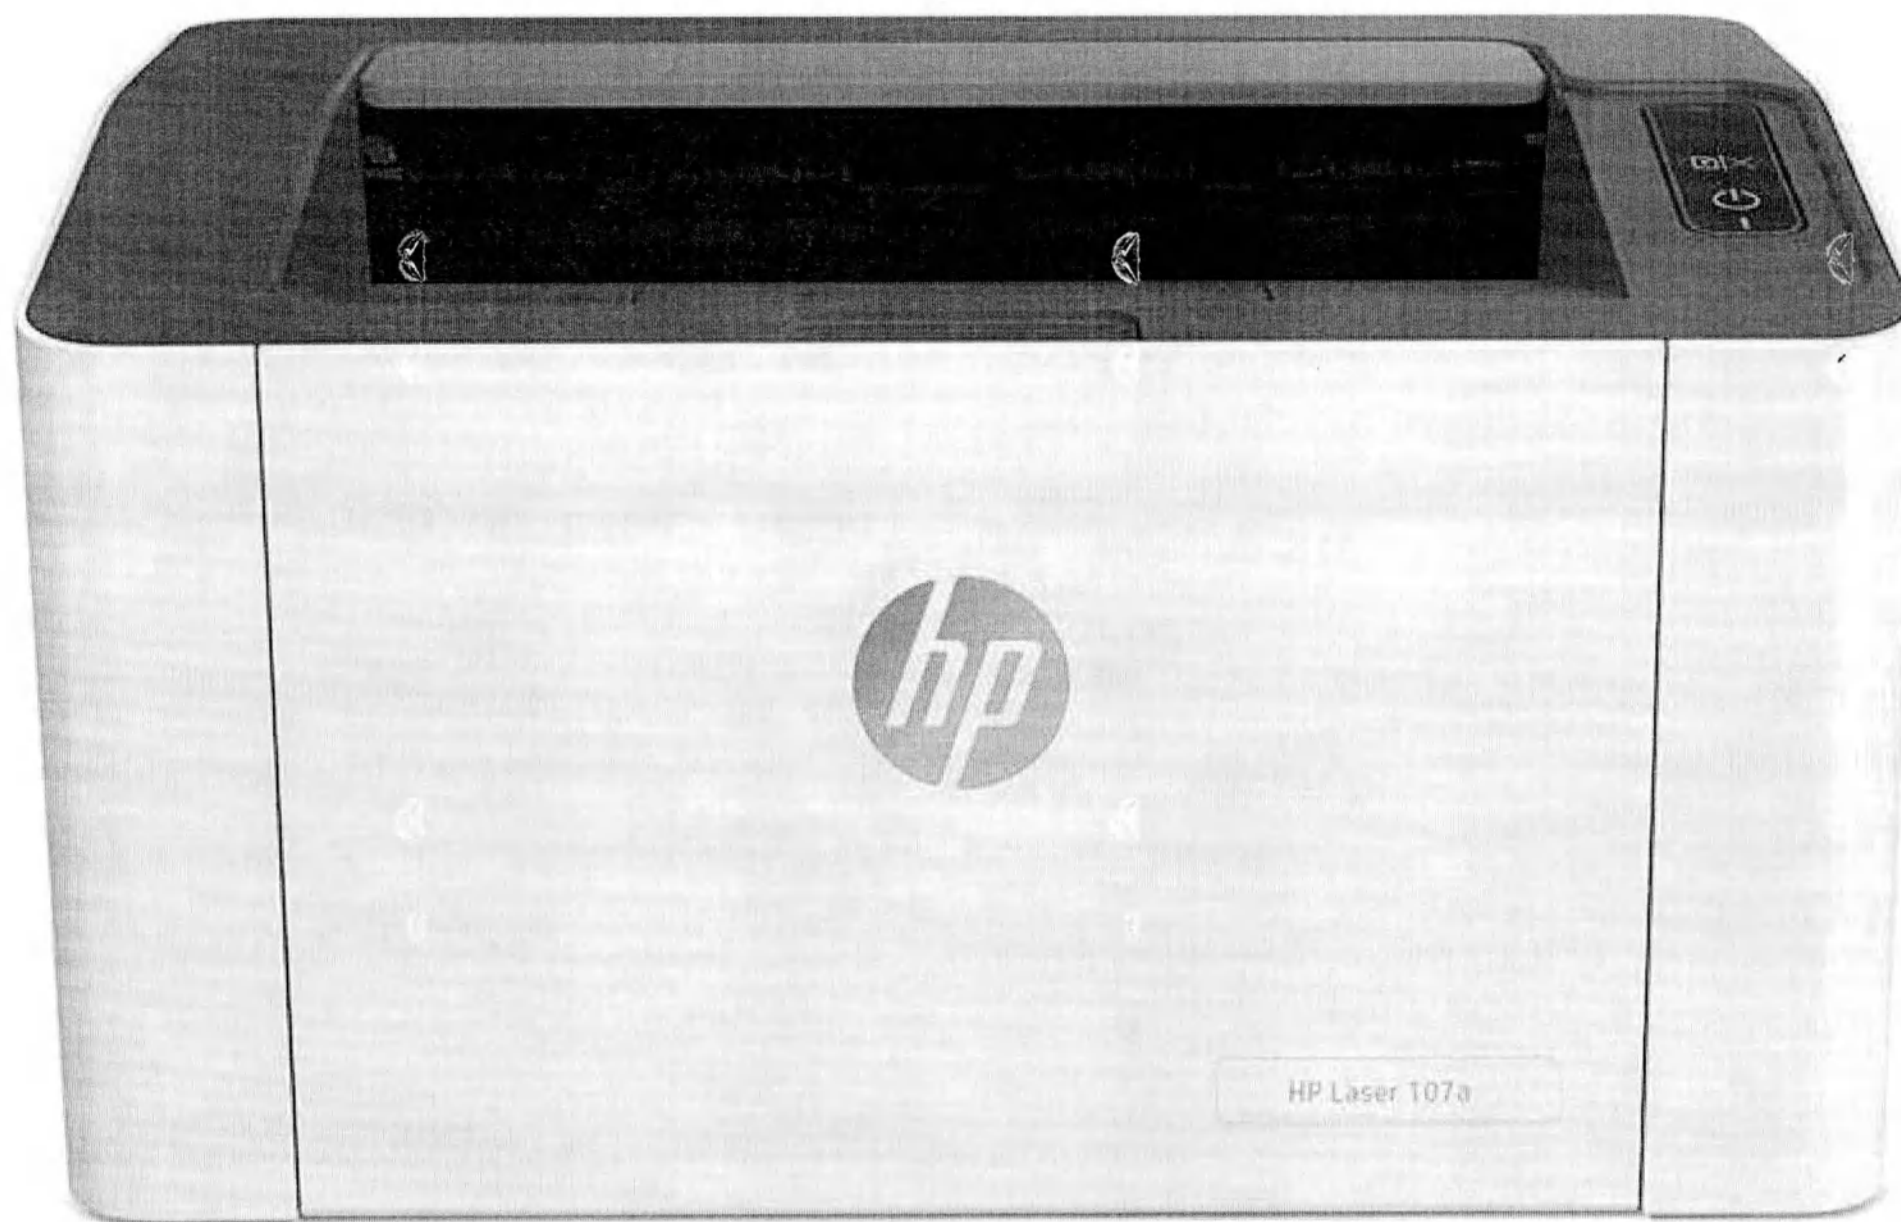

или производства Canon Inc, Япония.

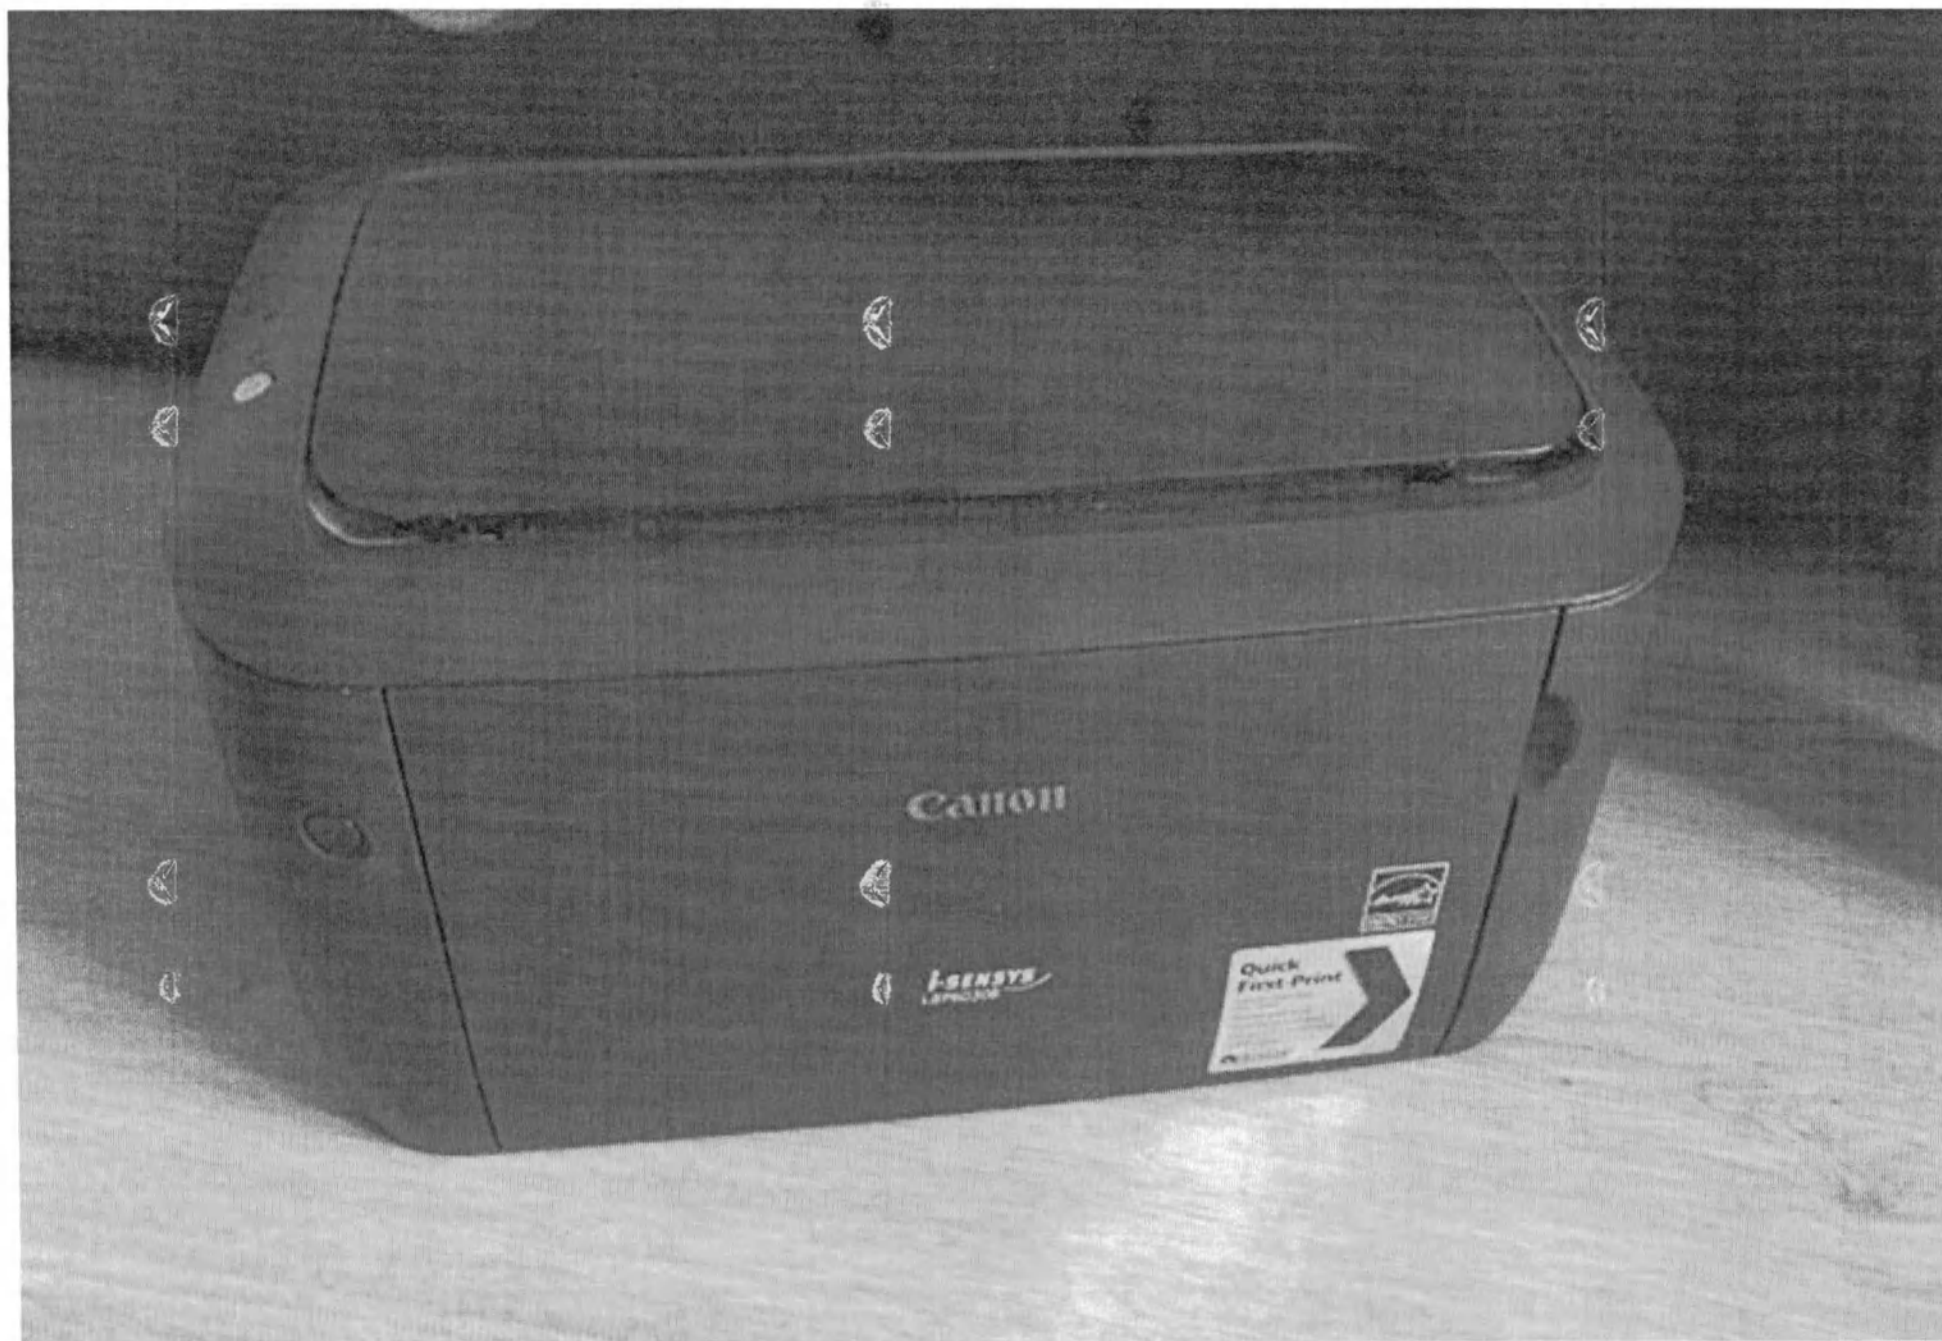


4. Камера мультиматная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями производства Agfa N.V., Бельгия (ПУ № ФСЗ 2008/01838);



или принтер медицинский KND6320 производства Shenzhen Kenid Medical Devices CO., LTD., Китай (РУ № РЗН 2022/17803).



5. Программно-аппаратный комплекс для хранения исследований производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

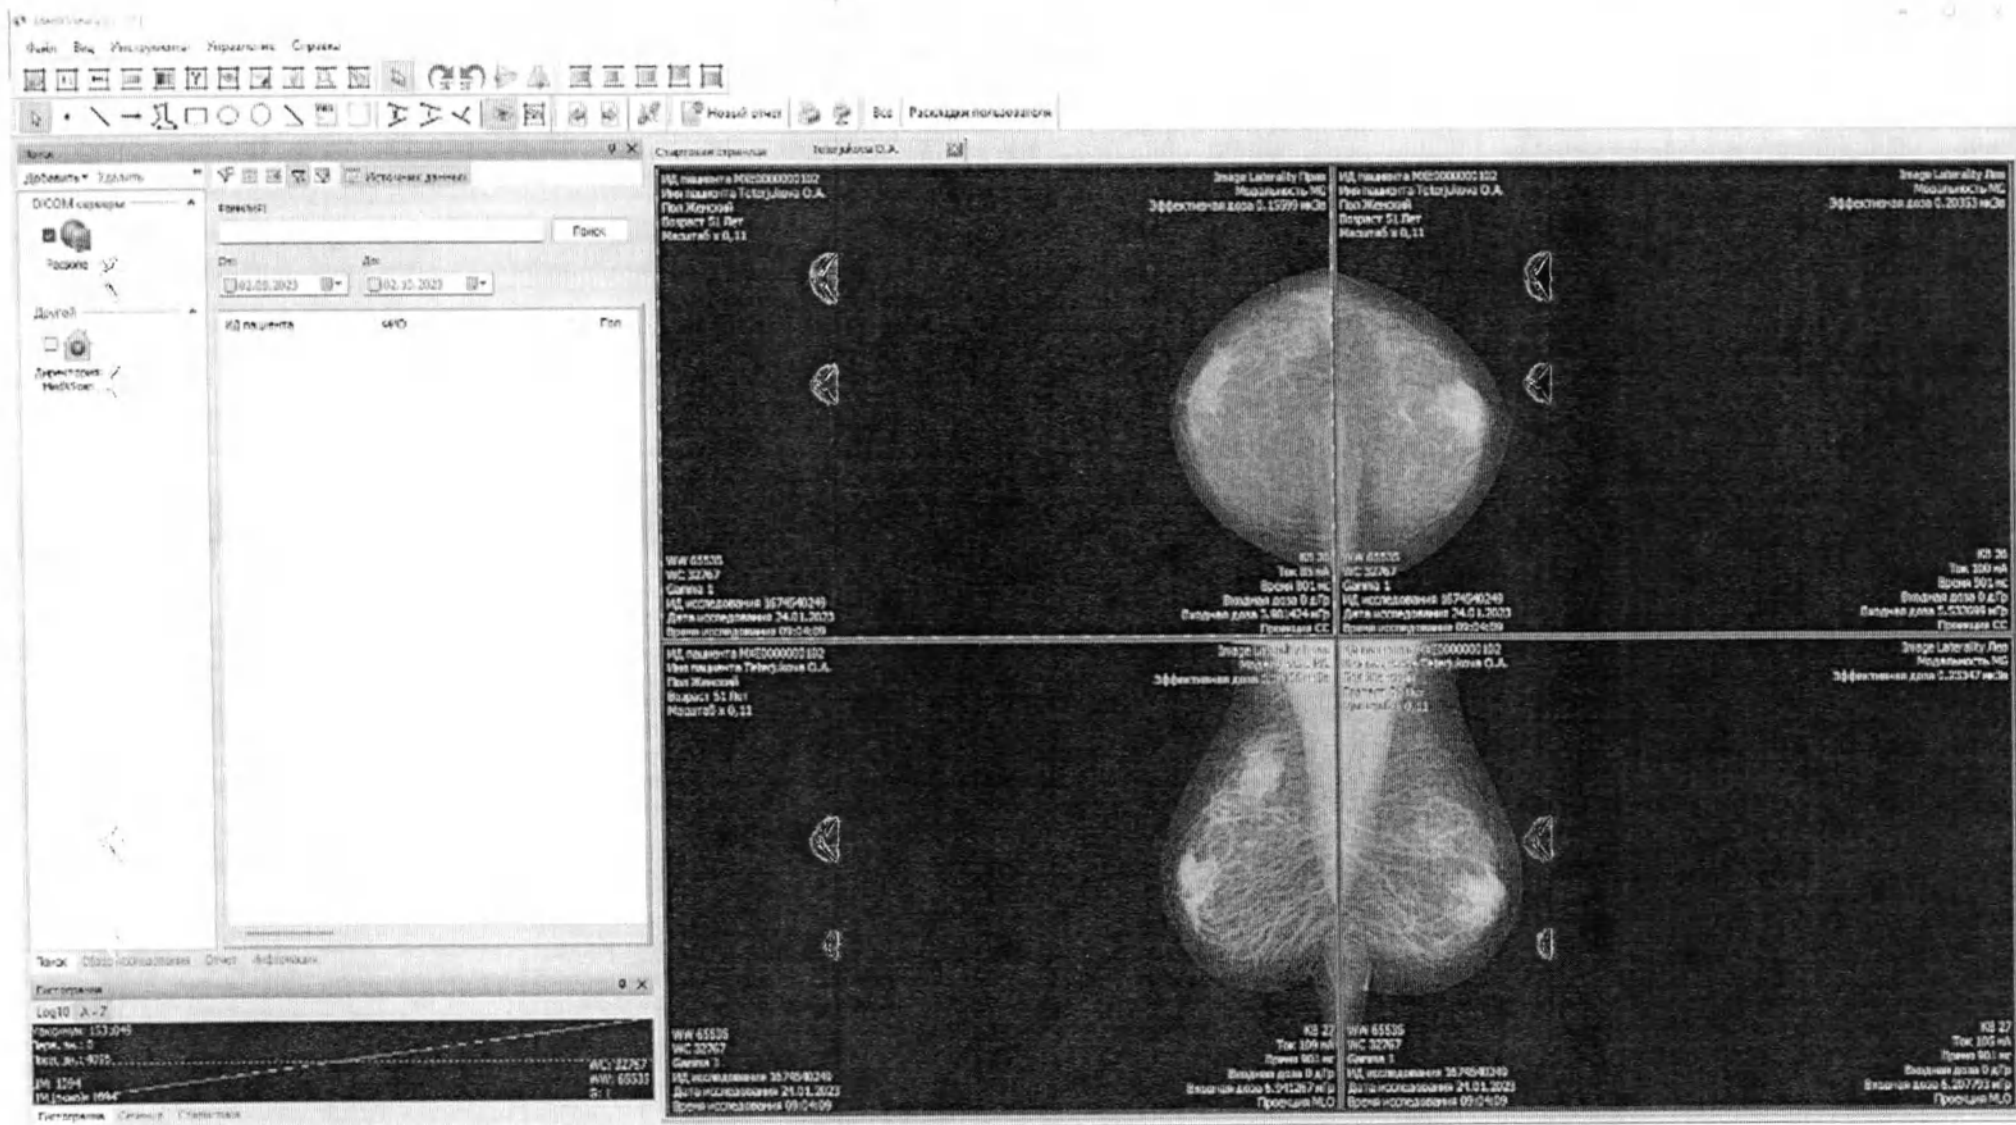

6. Модуль автоматического определения качества укладки PGMI производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

ADVIN
Модуль работы

Проверка изображения

 15.06.2022
02:40:2022



Неудовлетворительно

Критерии	Выполнено / не выполнено
Административная информация: проверка изображения	
Критерии проверки качества для ЦО	
Корректная укладка изображений: да/нет	Нет
Корректная ориентация	Да
Корректная ориентация изображения	Да
Корректная ориентация	Да
Достаточная степень контраста	Да
Корректная ориентация изображения	Да
Корректная ориентация изображения	Нет
Корректная ориентация	Да
Корректная ориентация	Да




 Принять

 Отклонить


 Распечатать

 Сохранить как...

7. Фантом для калибровки детектора (Блок проверки однородности поля изображения) 001 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

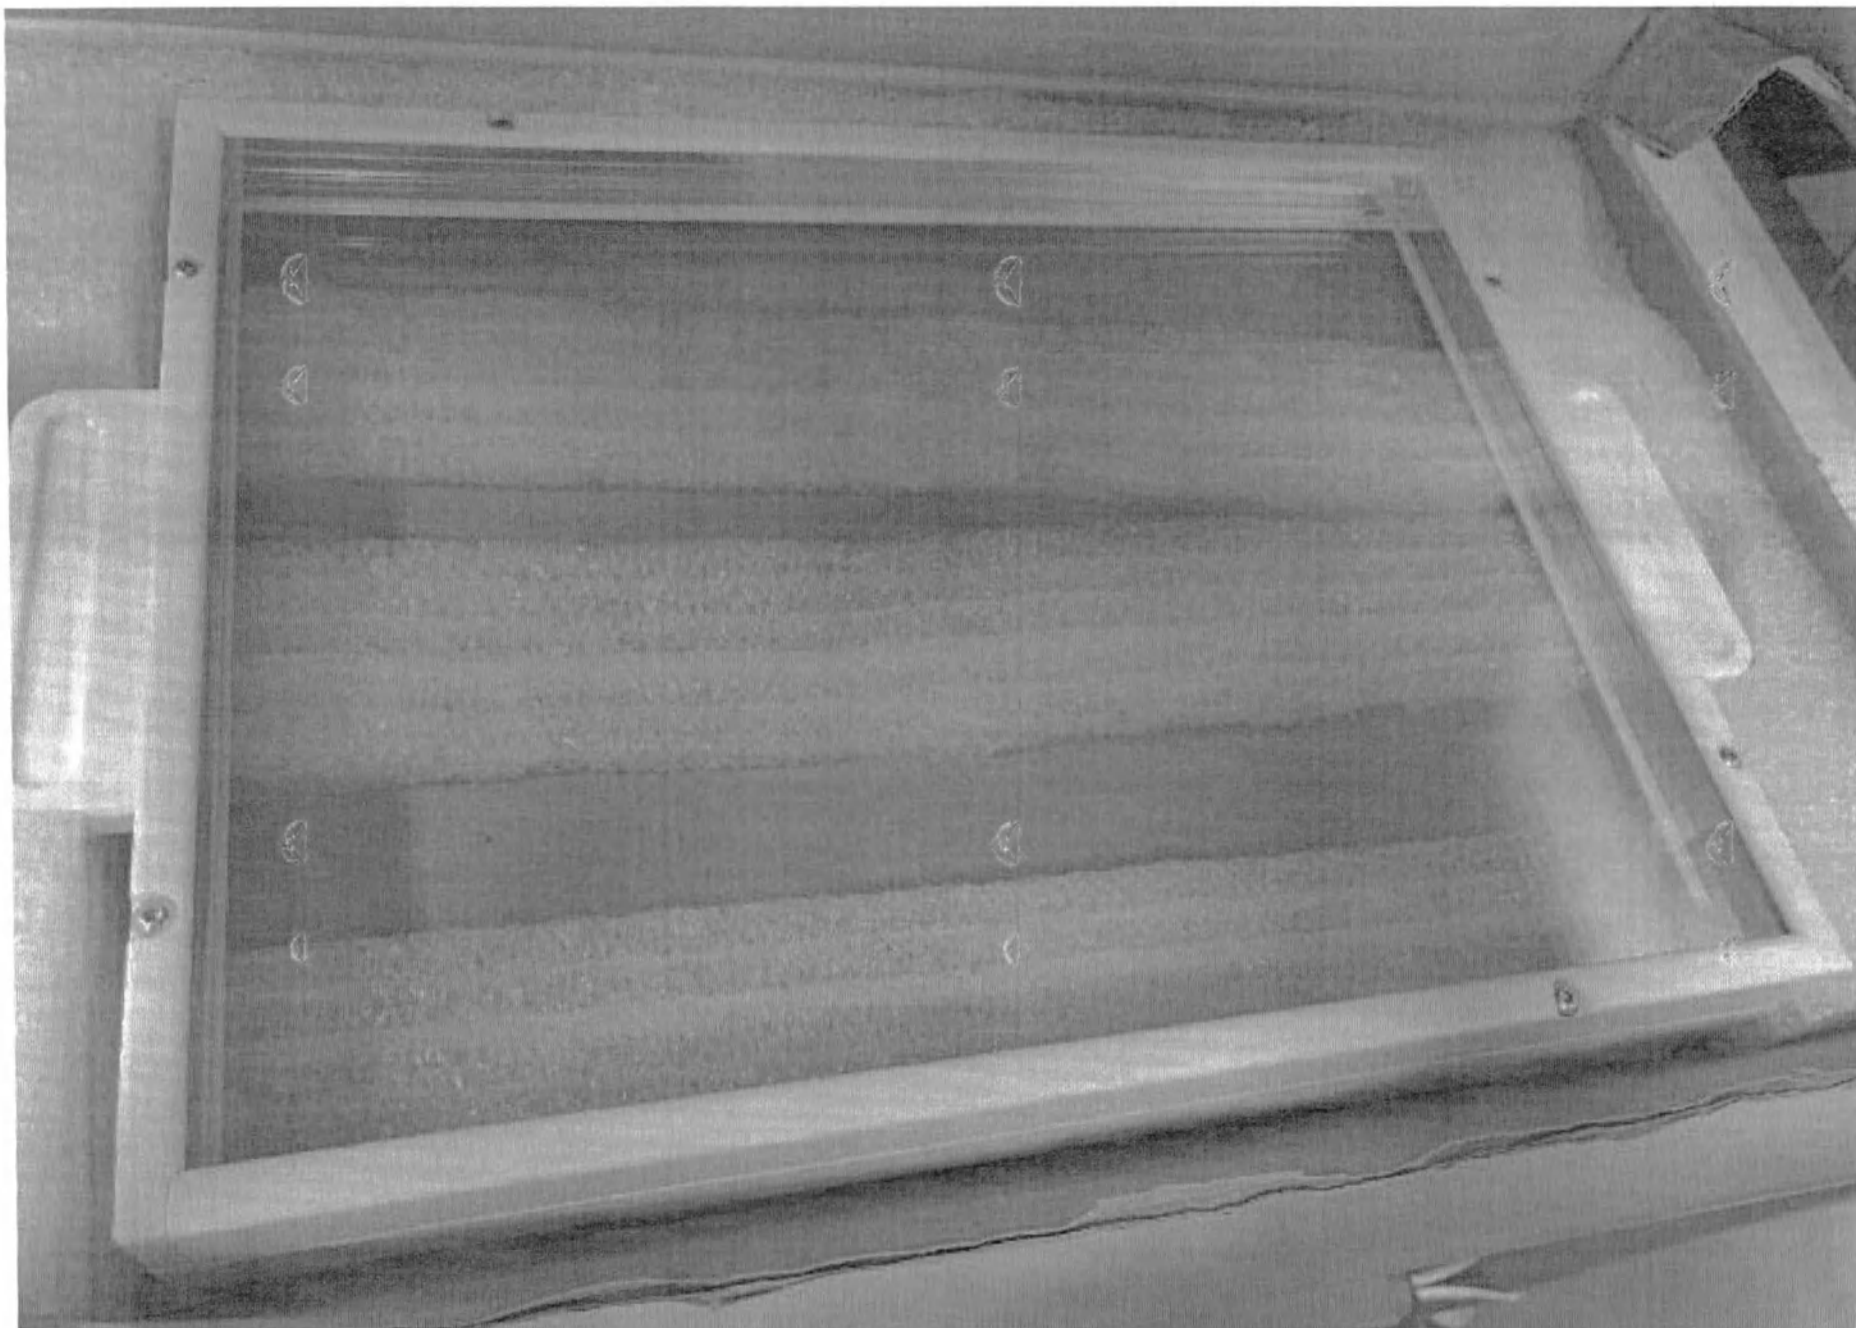


8. Изделия индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов из рентгенозащитного материала МЗ-7 по ТУ 9398-012-59003778-07 производства ООО «Защита-Чернобыль М», Российская Федерация (РУ № ФСР 2007/00888);

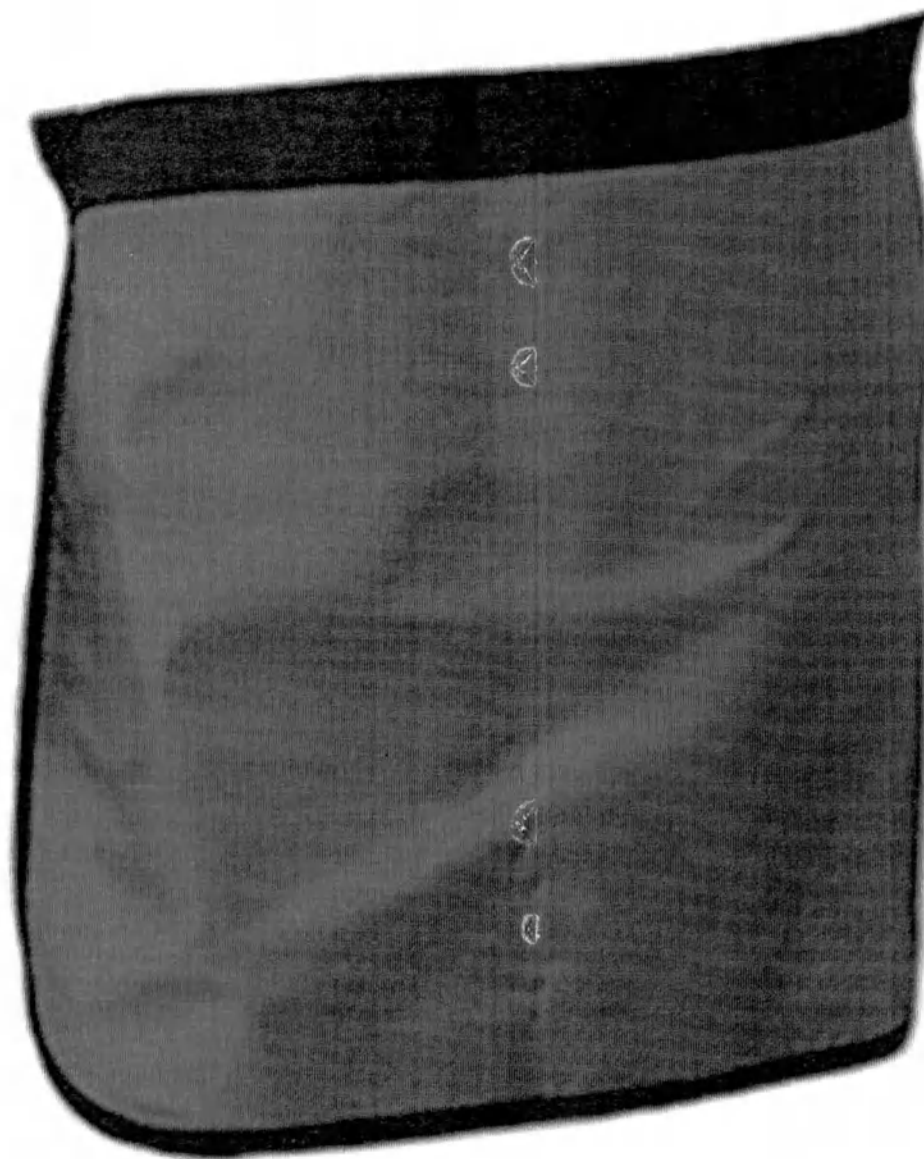




или комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004 производства ЗАО «РЕНЕКС», Российская Федерация (РУ № ФСР 2008/03184).



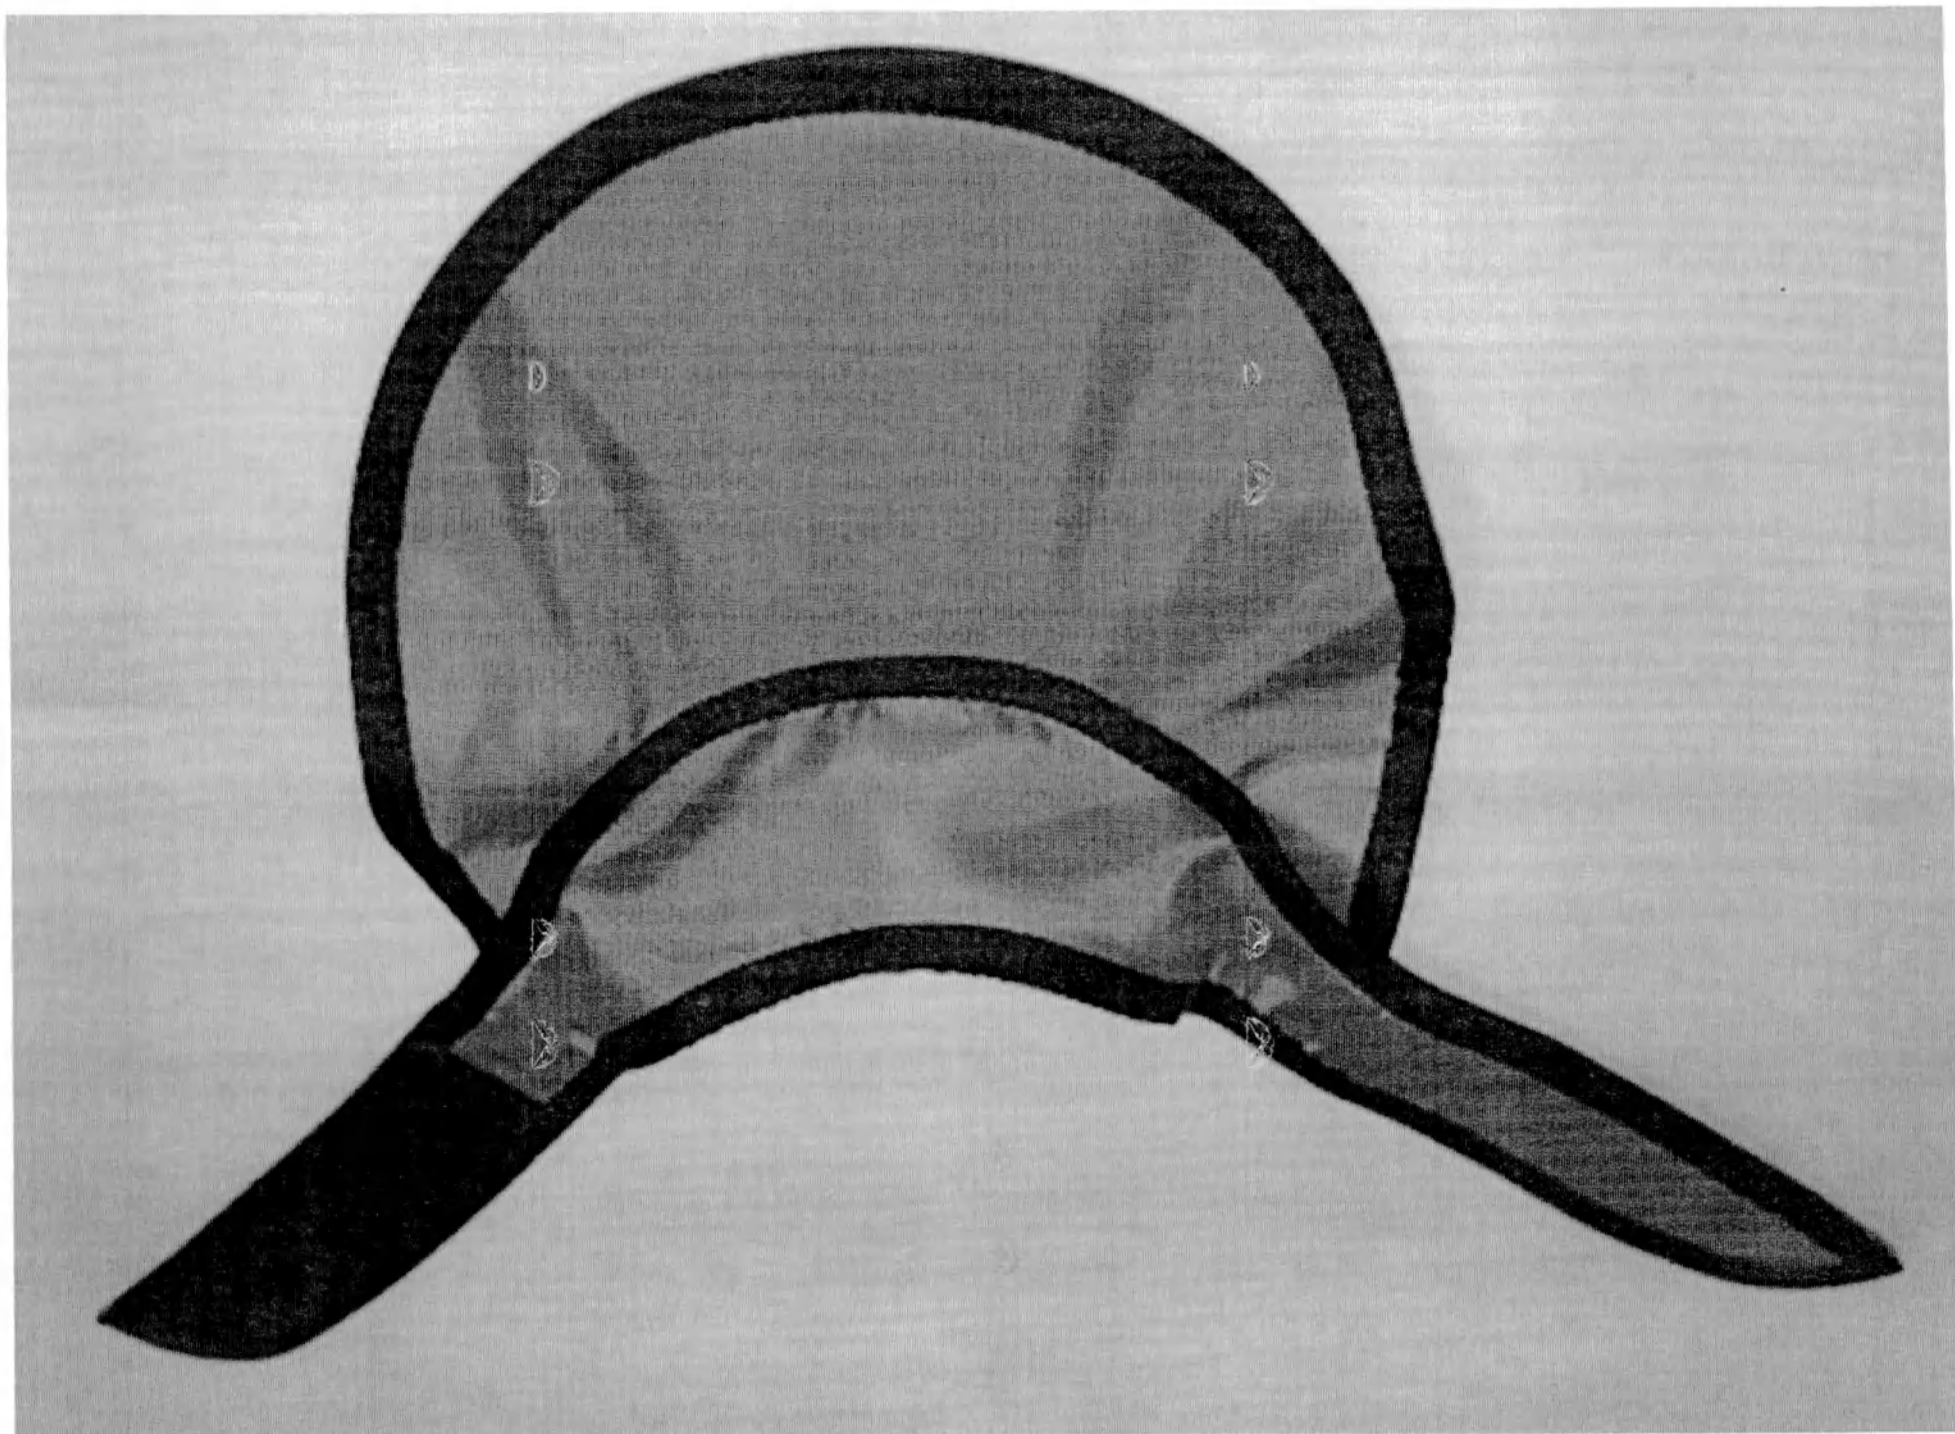




9. Приспособление для хранения принадлежностей АС2 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

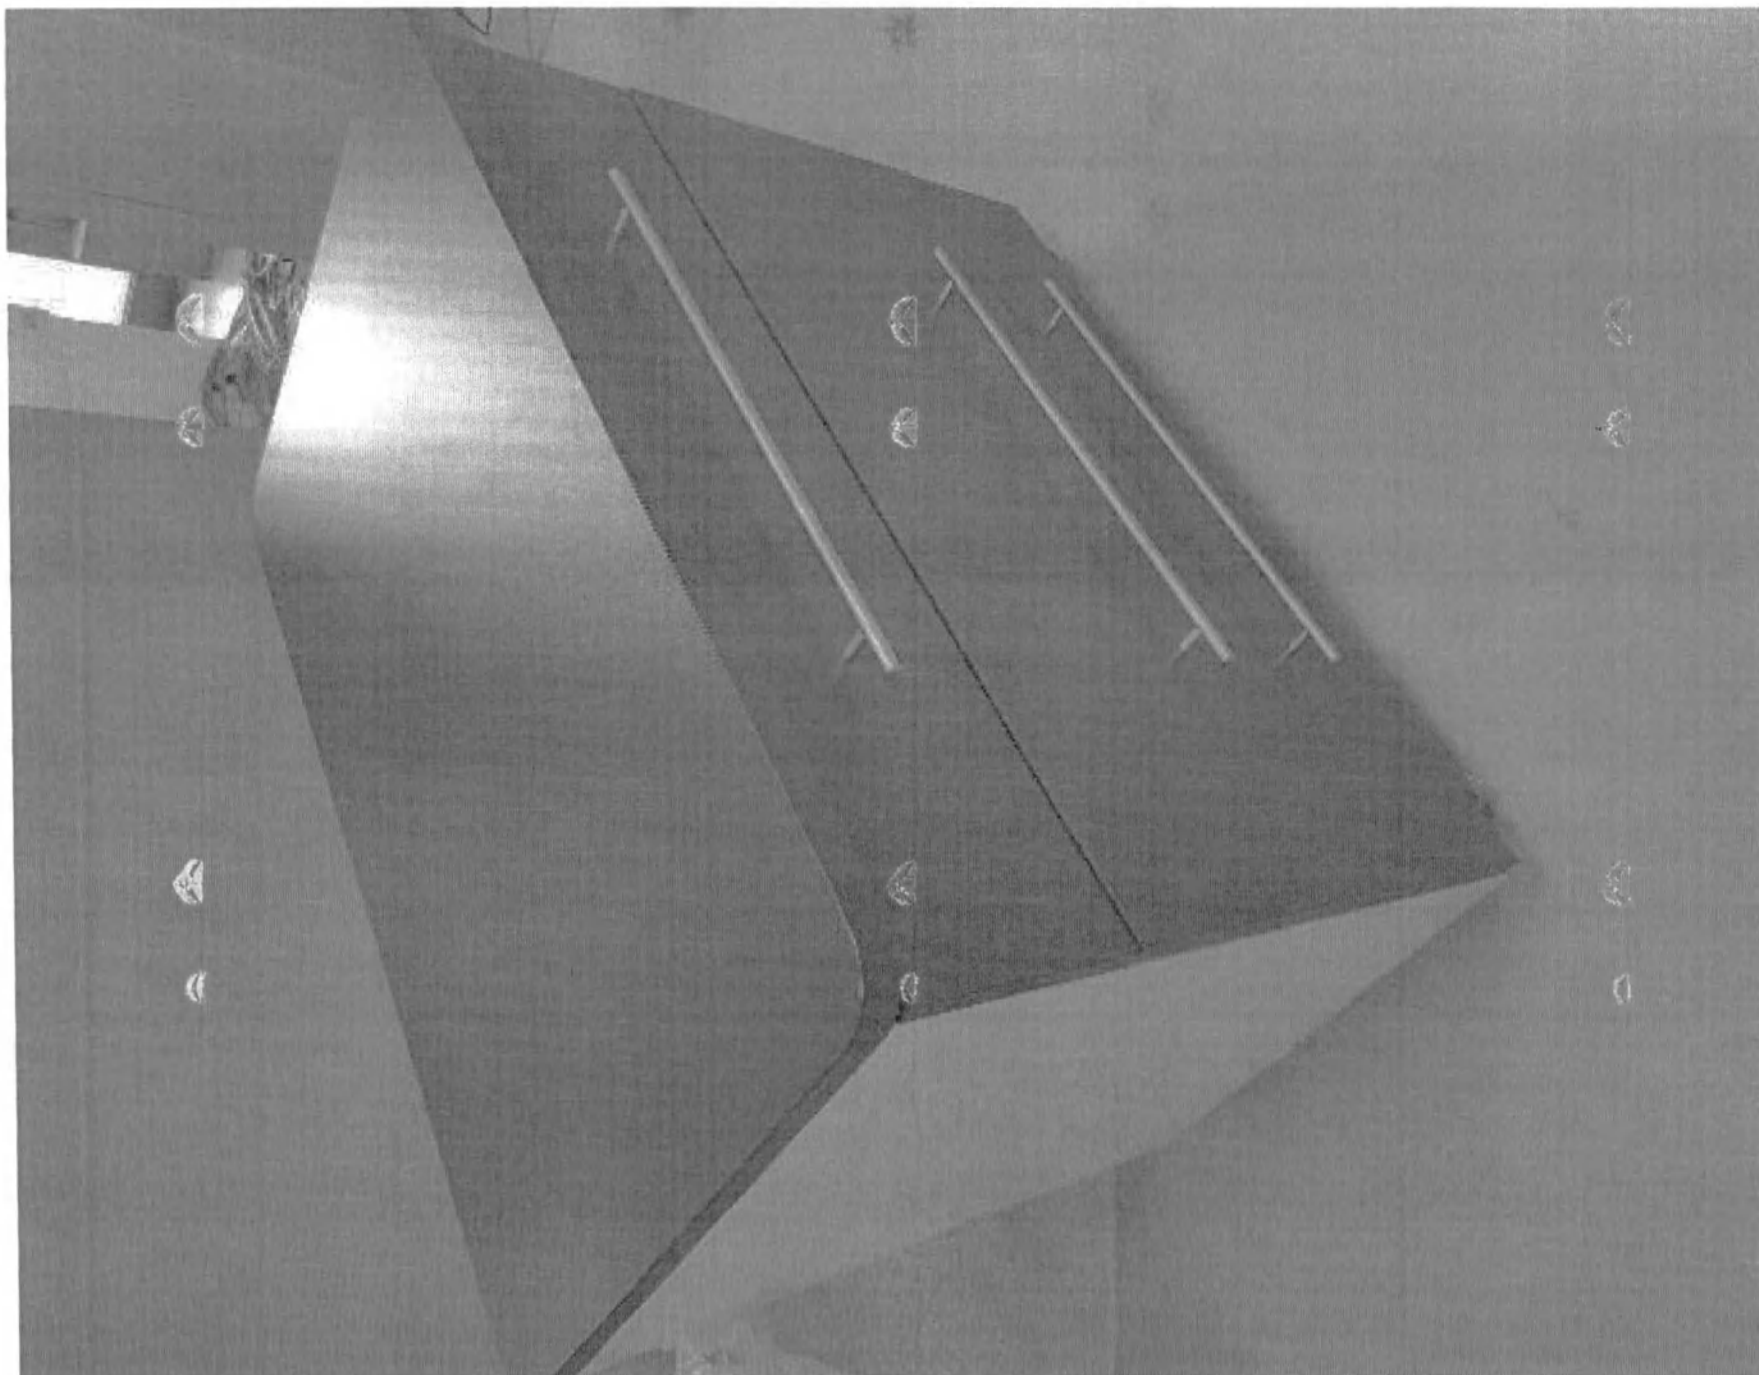


10. Стол для съёмки с увеличением 1,5х производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

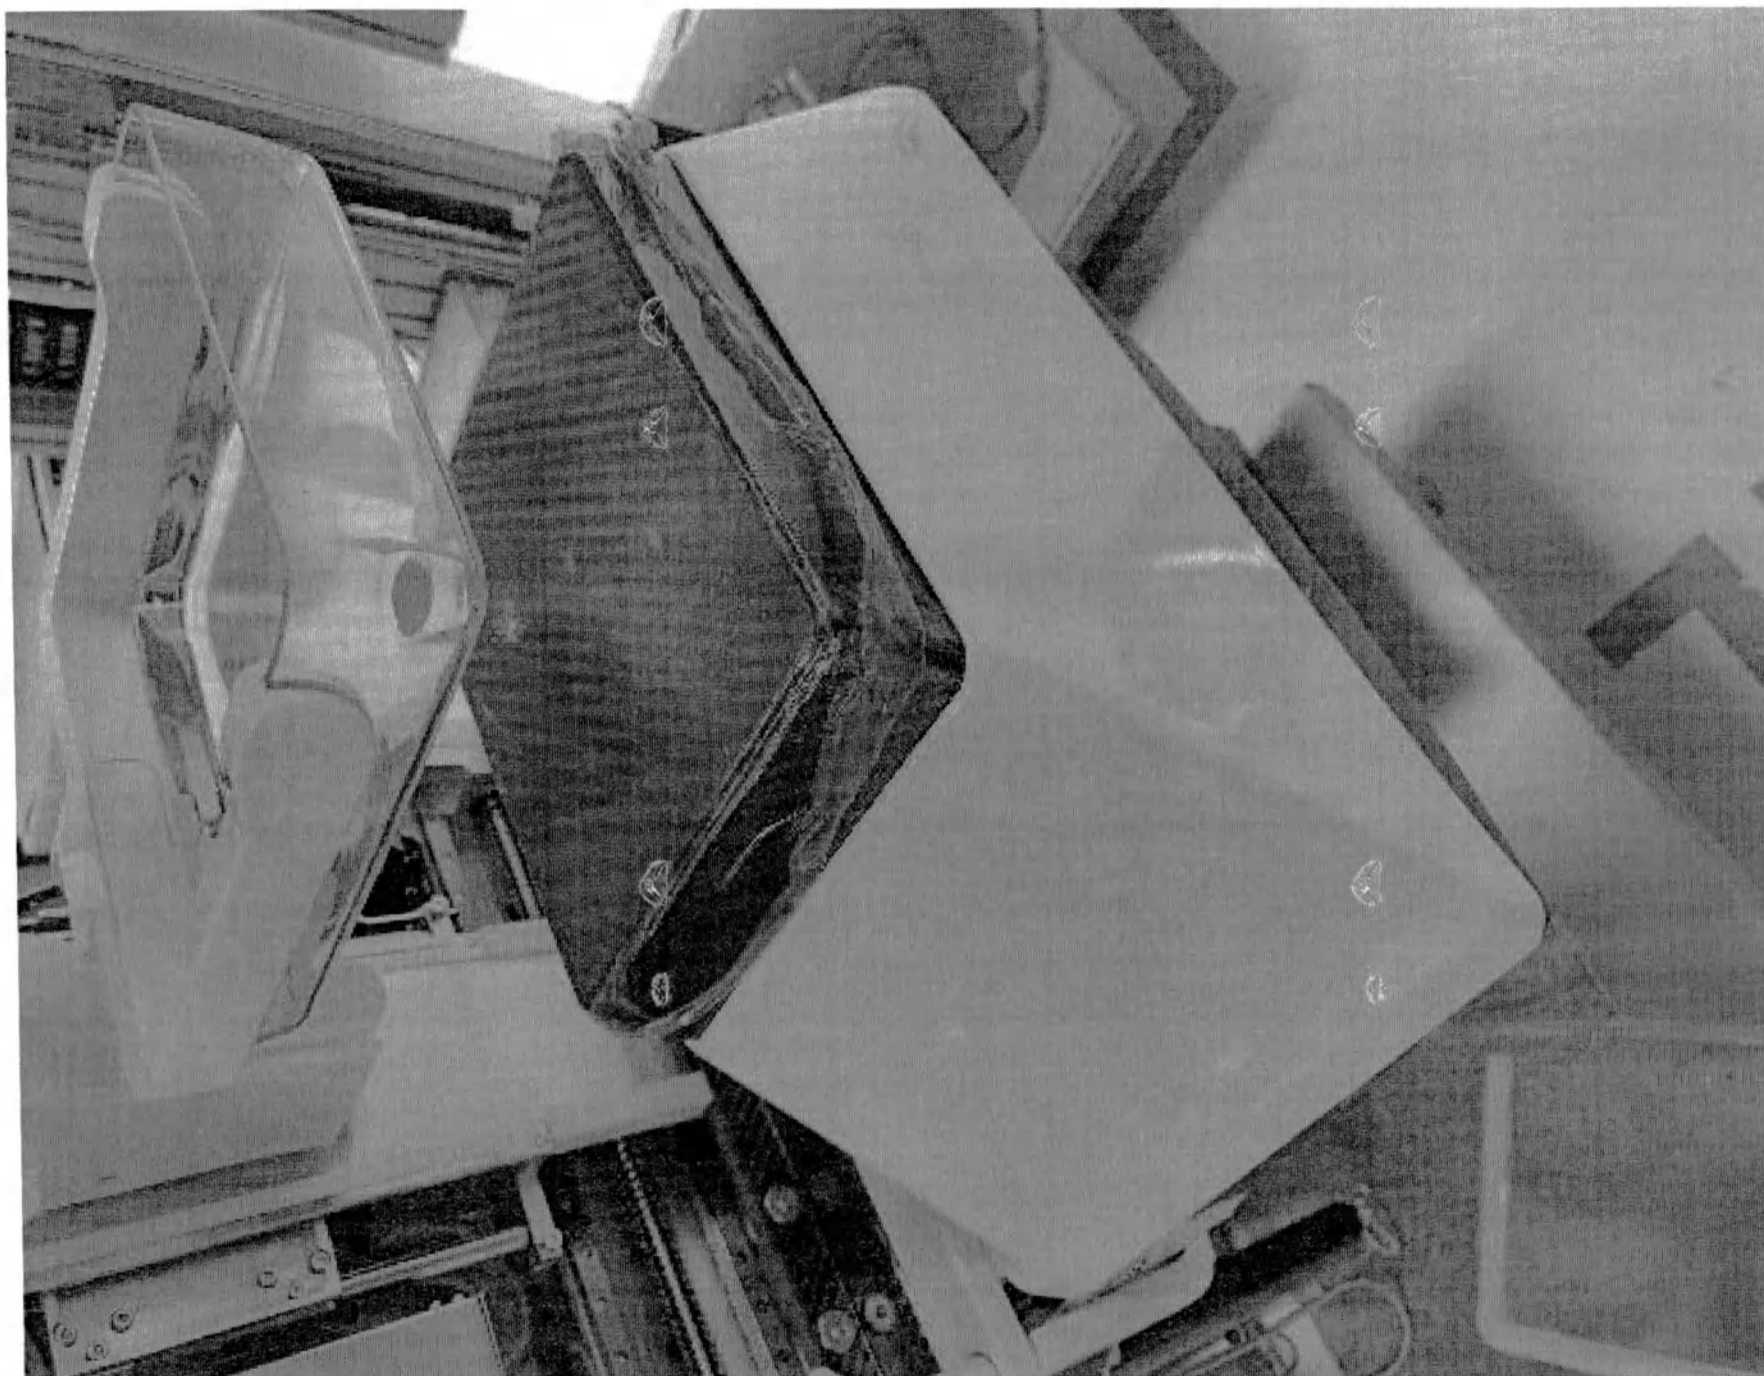

11. Пленка термографическая медицинская Drystar DT 10 Маммо производства Agfa N.V., Бельгия (РУ № РЗН 2015/2951);




или пленка термографическая KND-A для принтеров медицинских производства Shenzhen Kenid Medical Devices CO., LTD., Китай (РУ № РЗН 2023/19442).

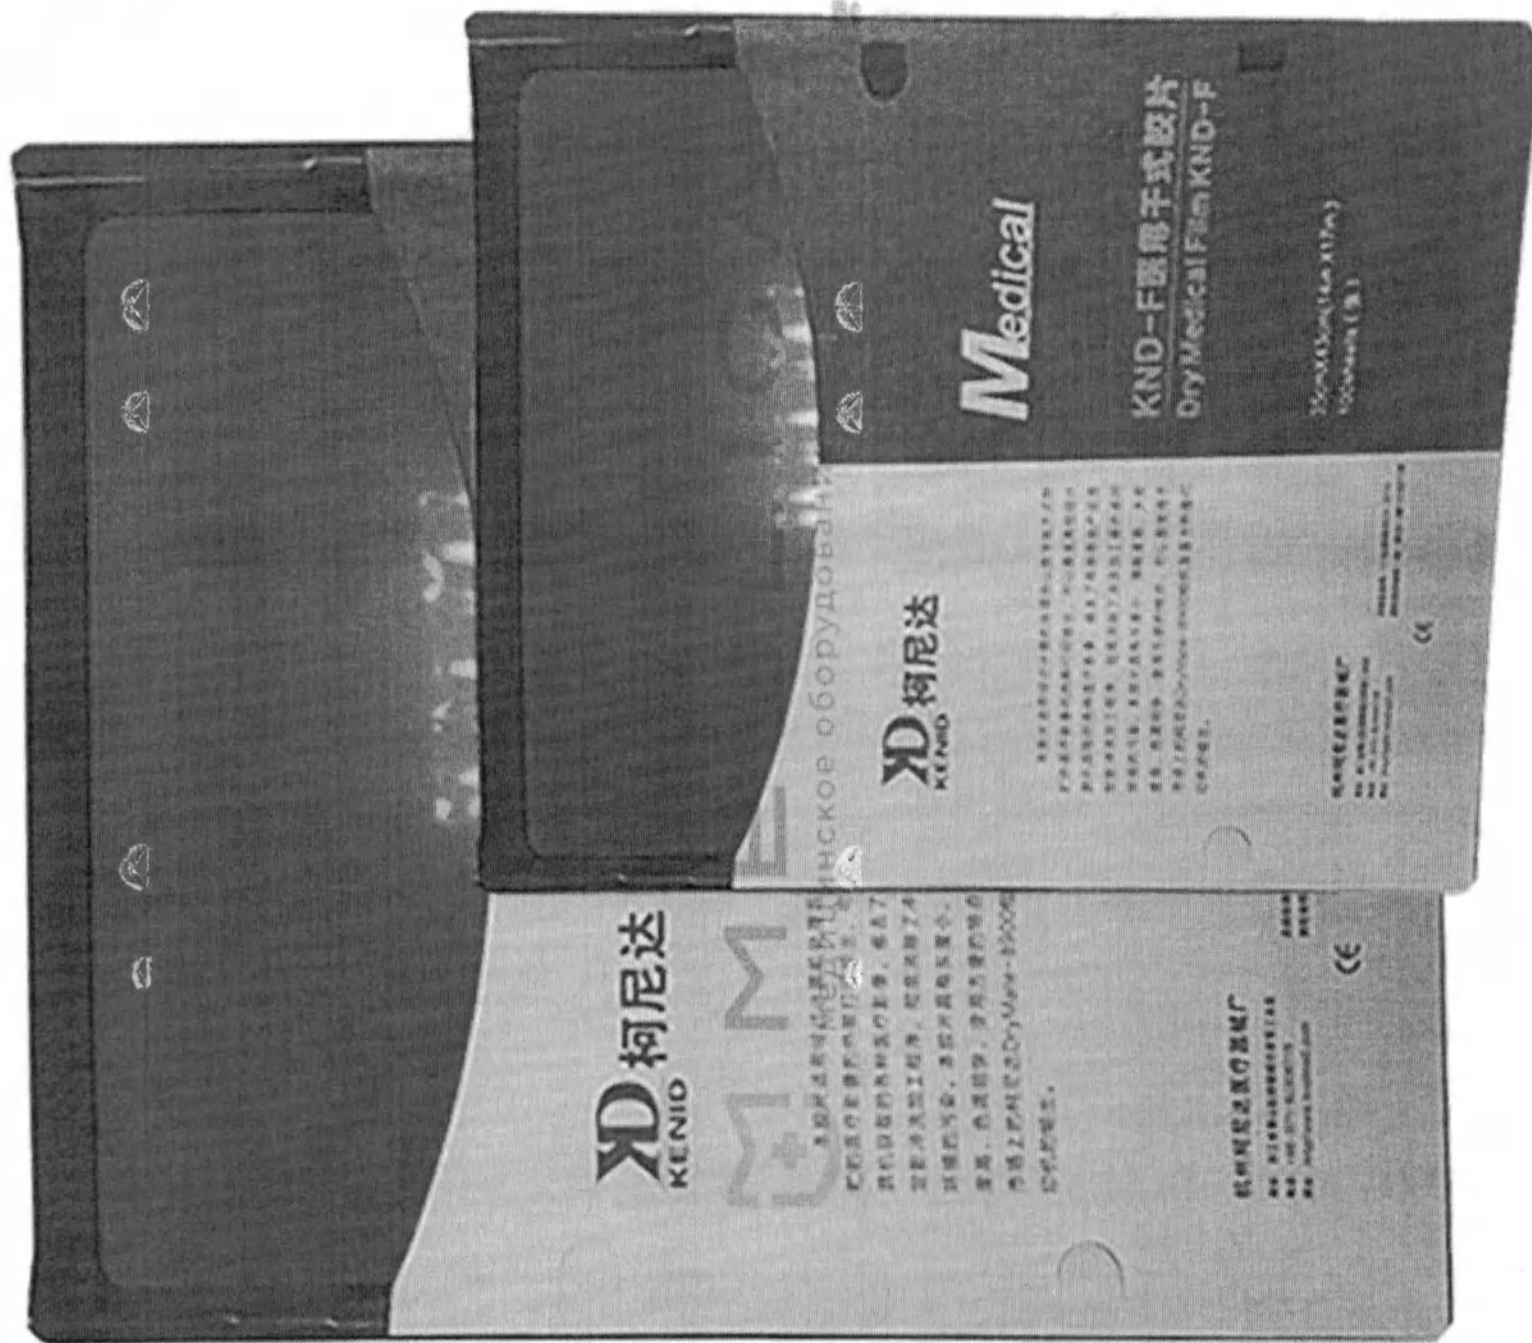


Принадлежности:


1. Прижим 24x30 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

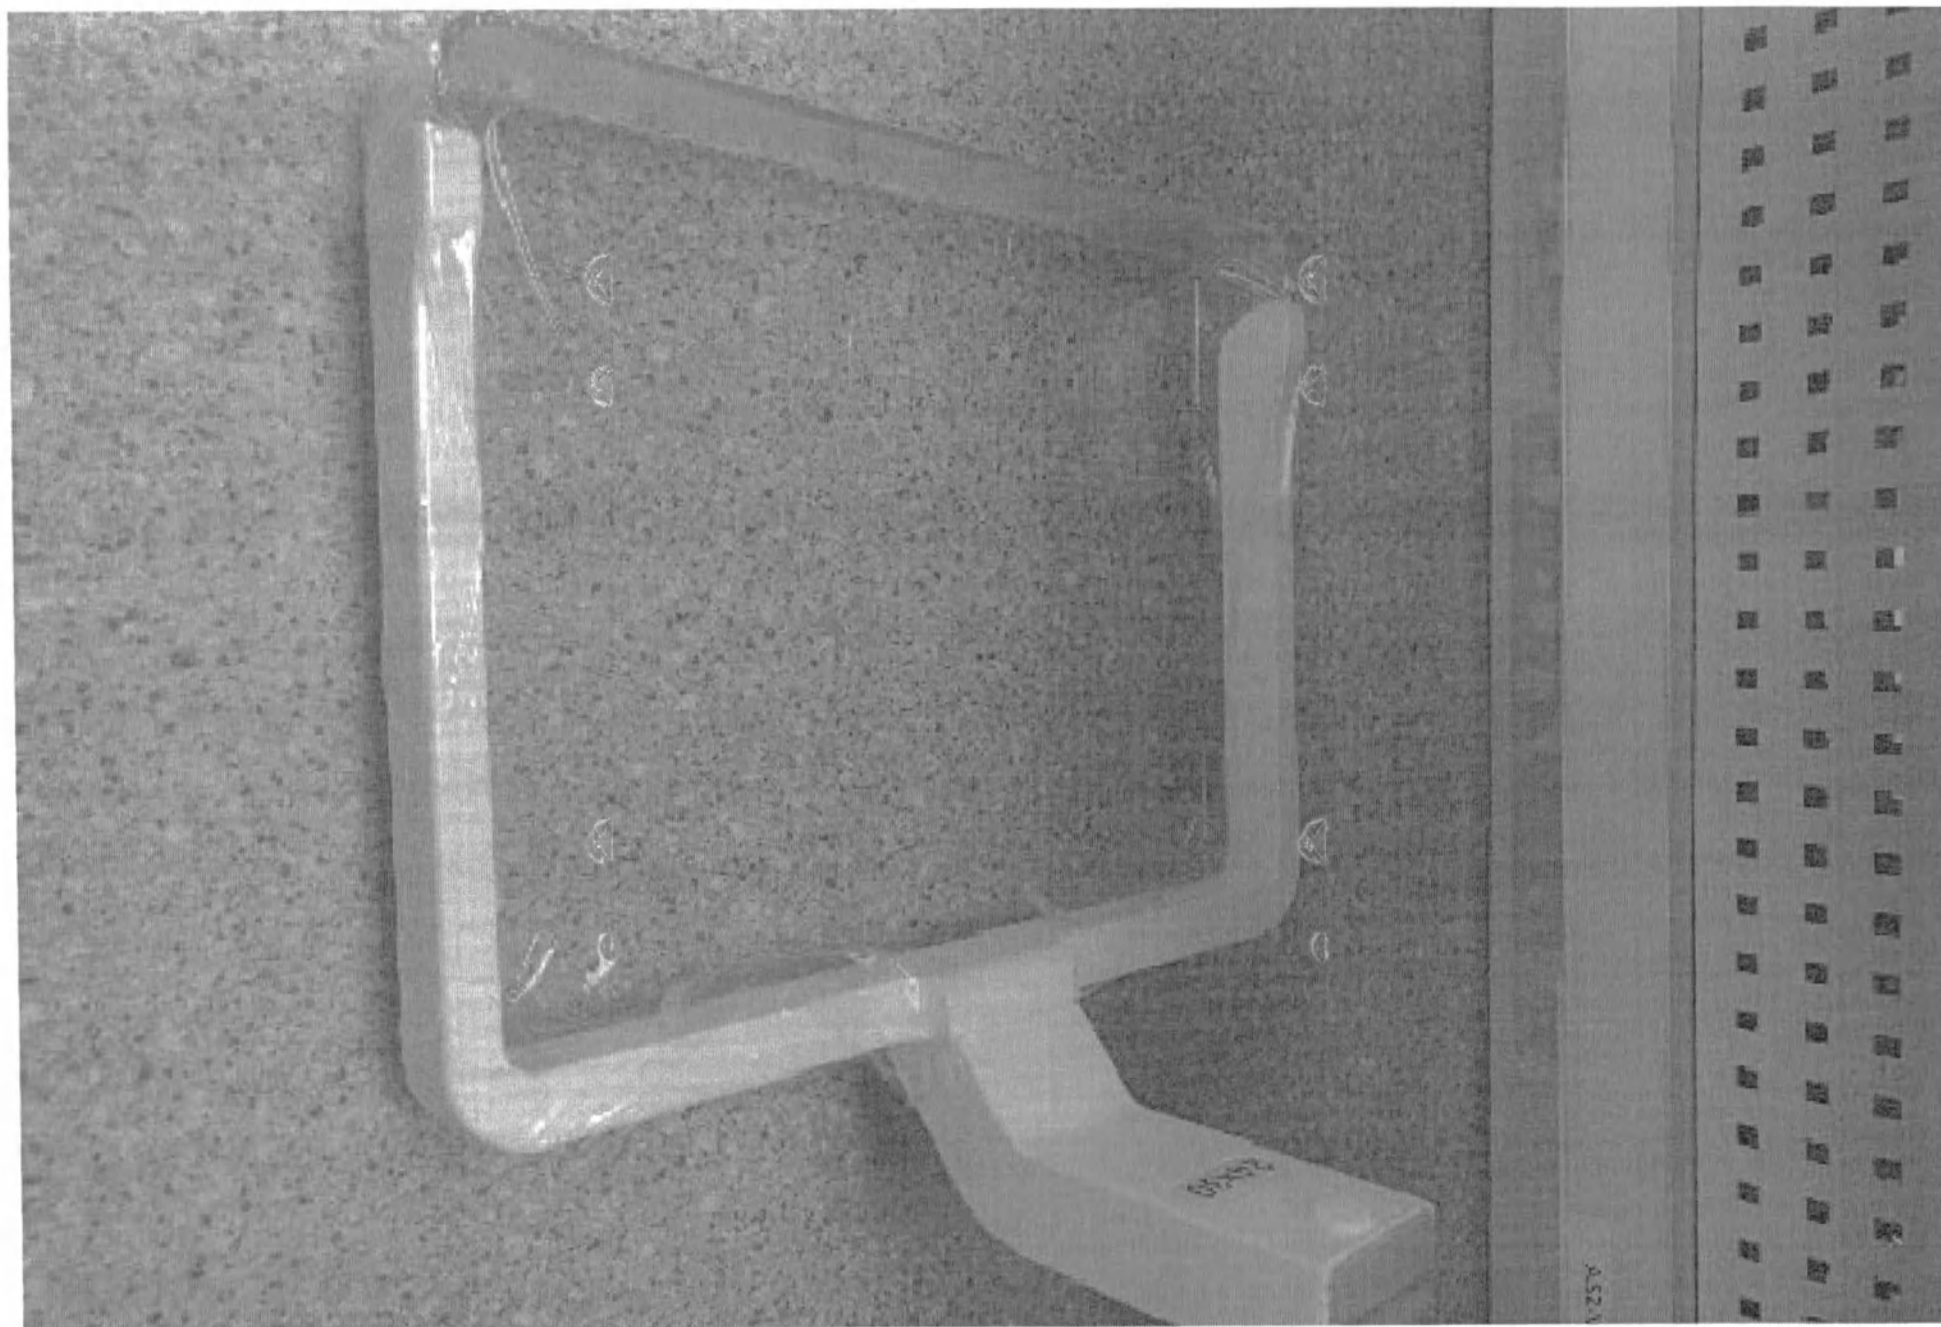


2. Прижим 18x24 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

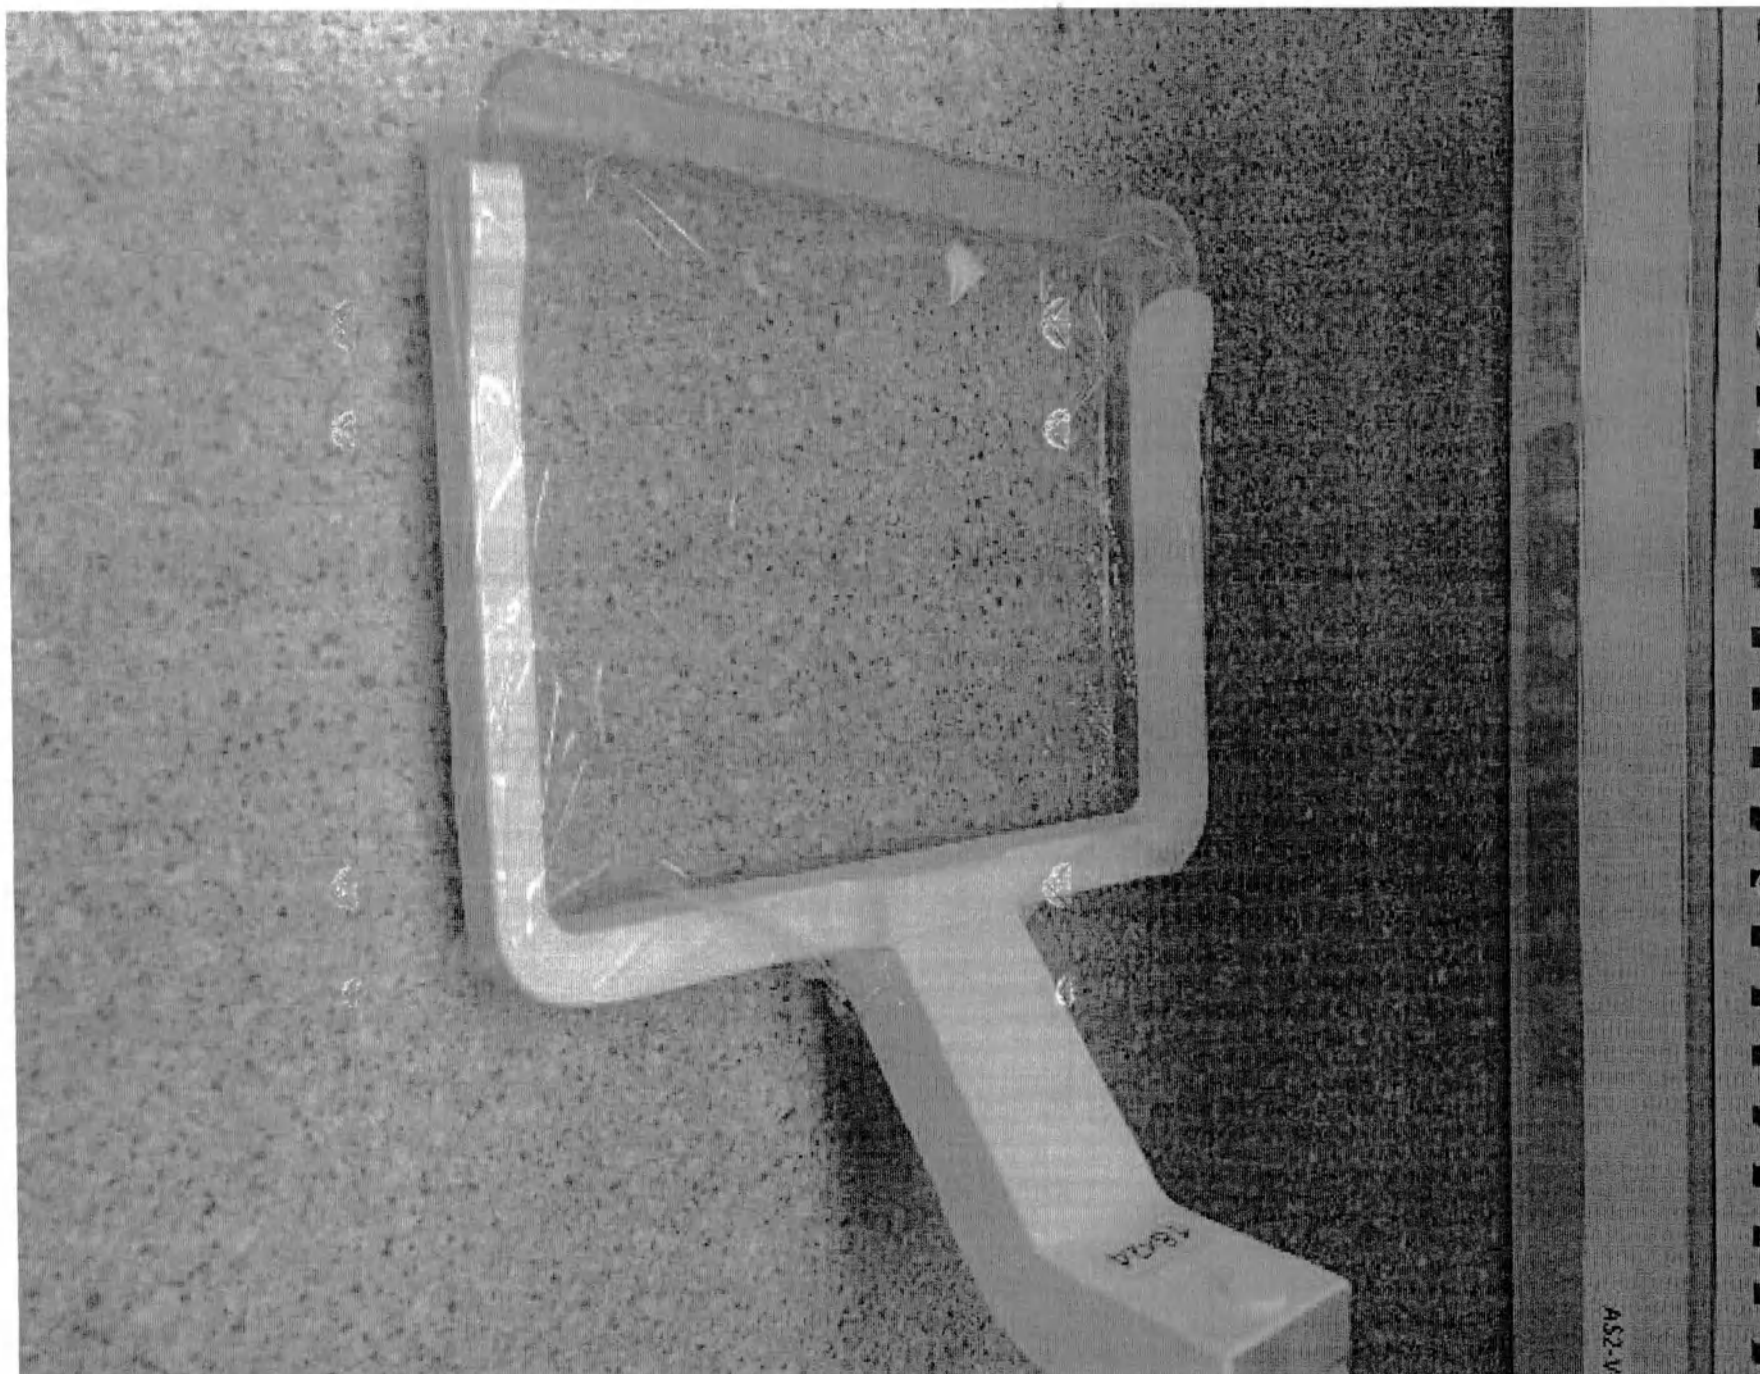


3. Прижим 10x10 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

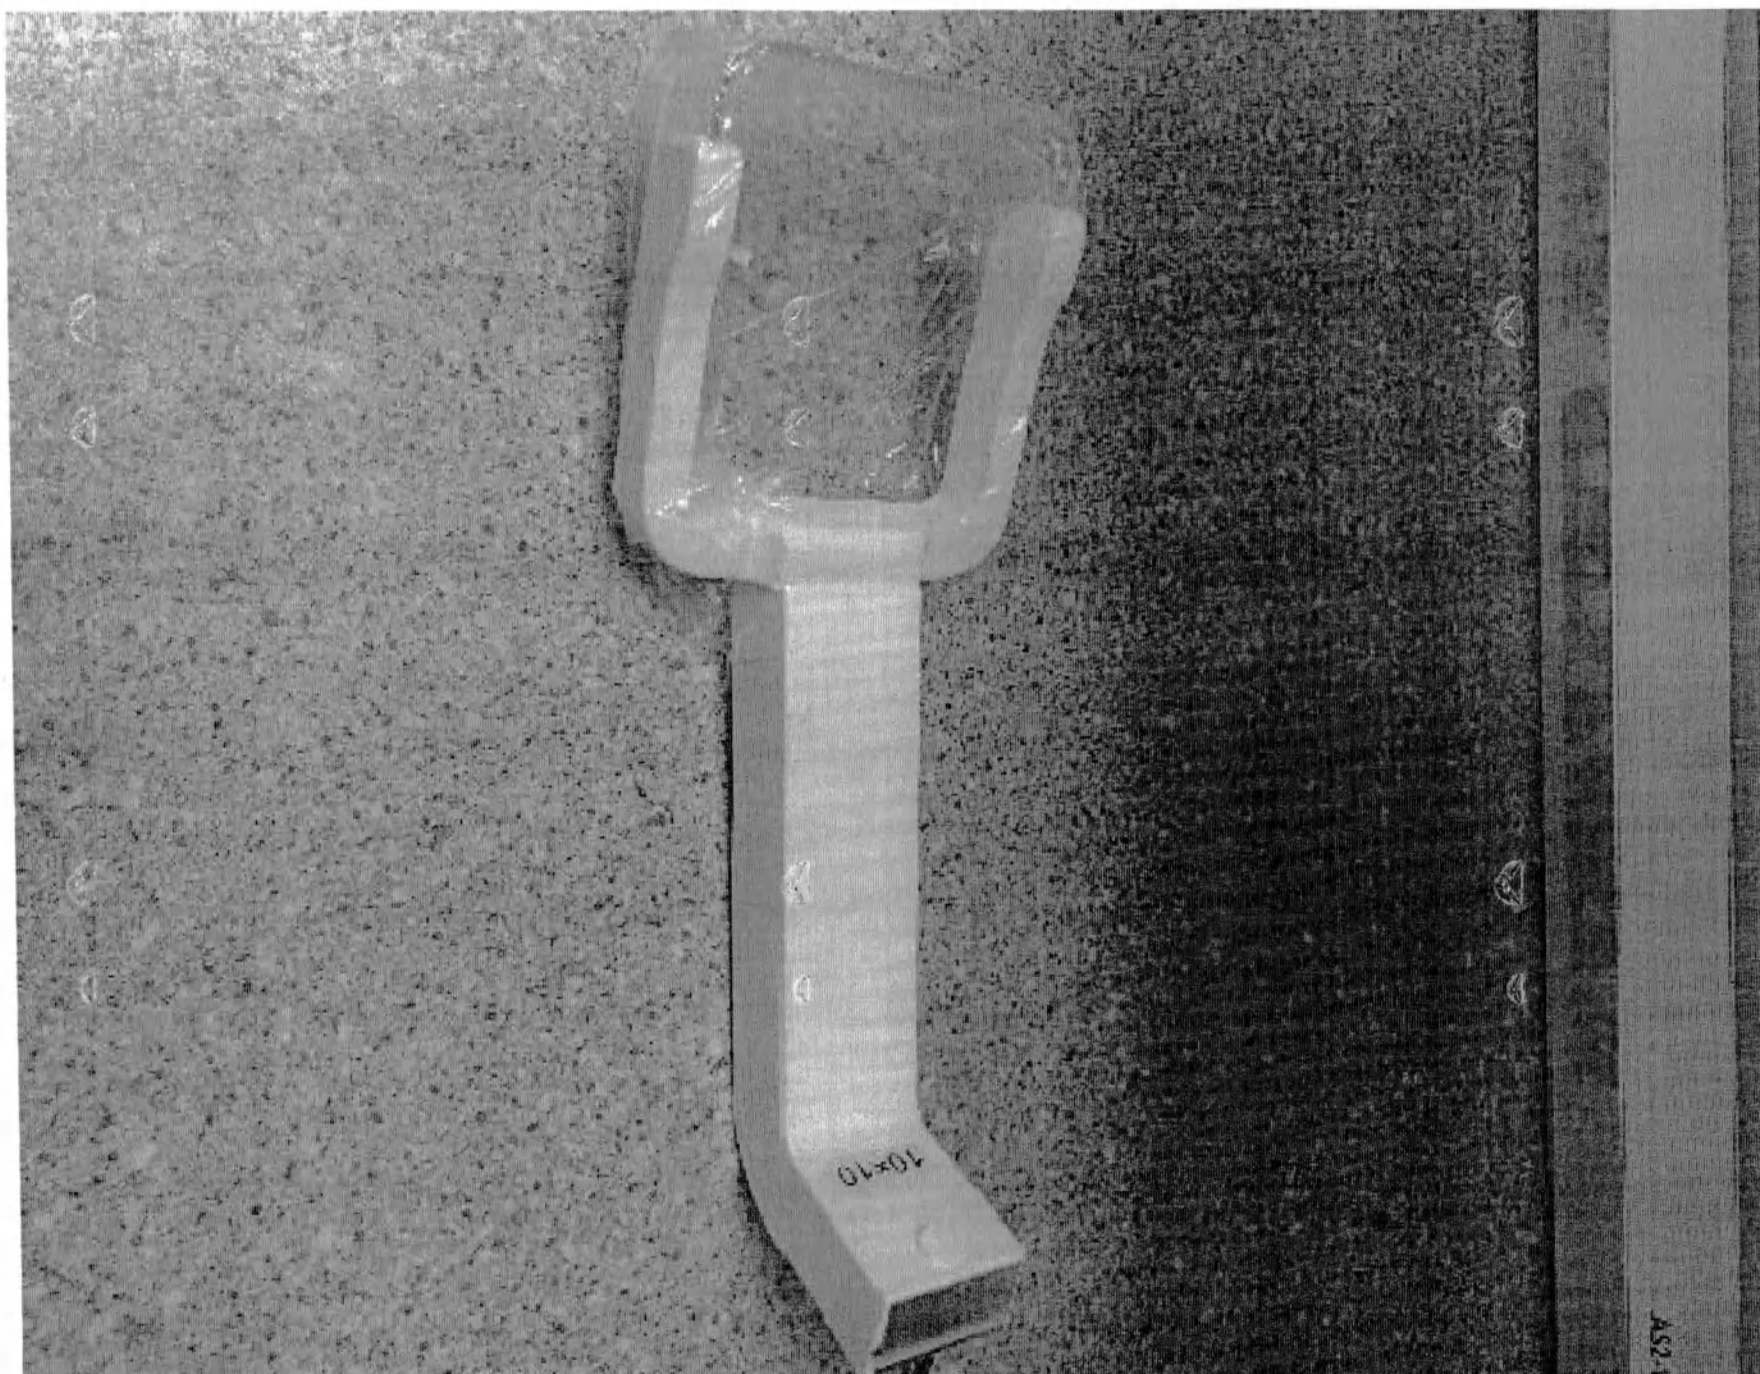


4. Прижим 15x15 для прицельной съёмки производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

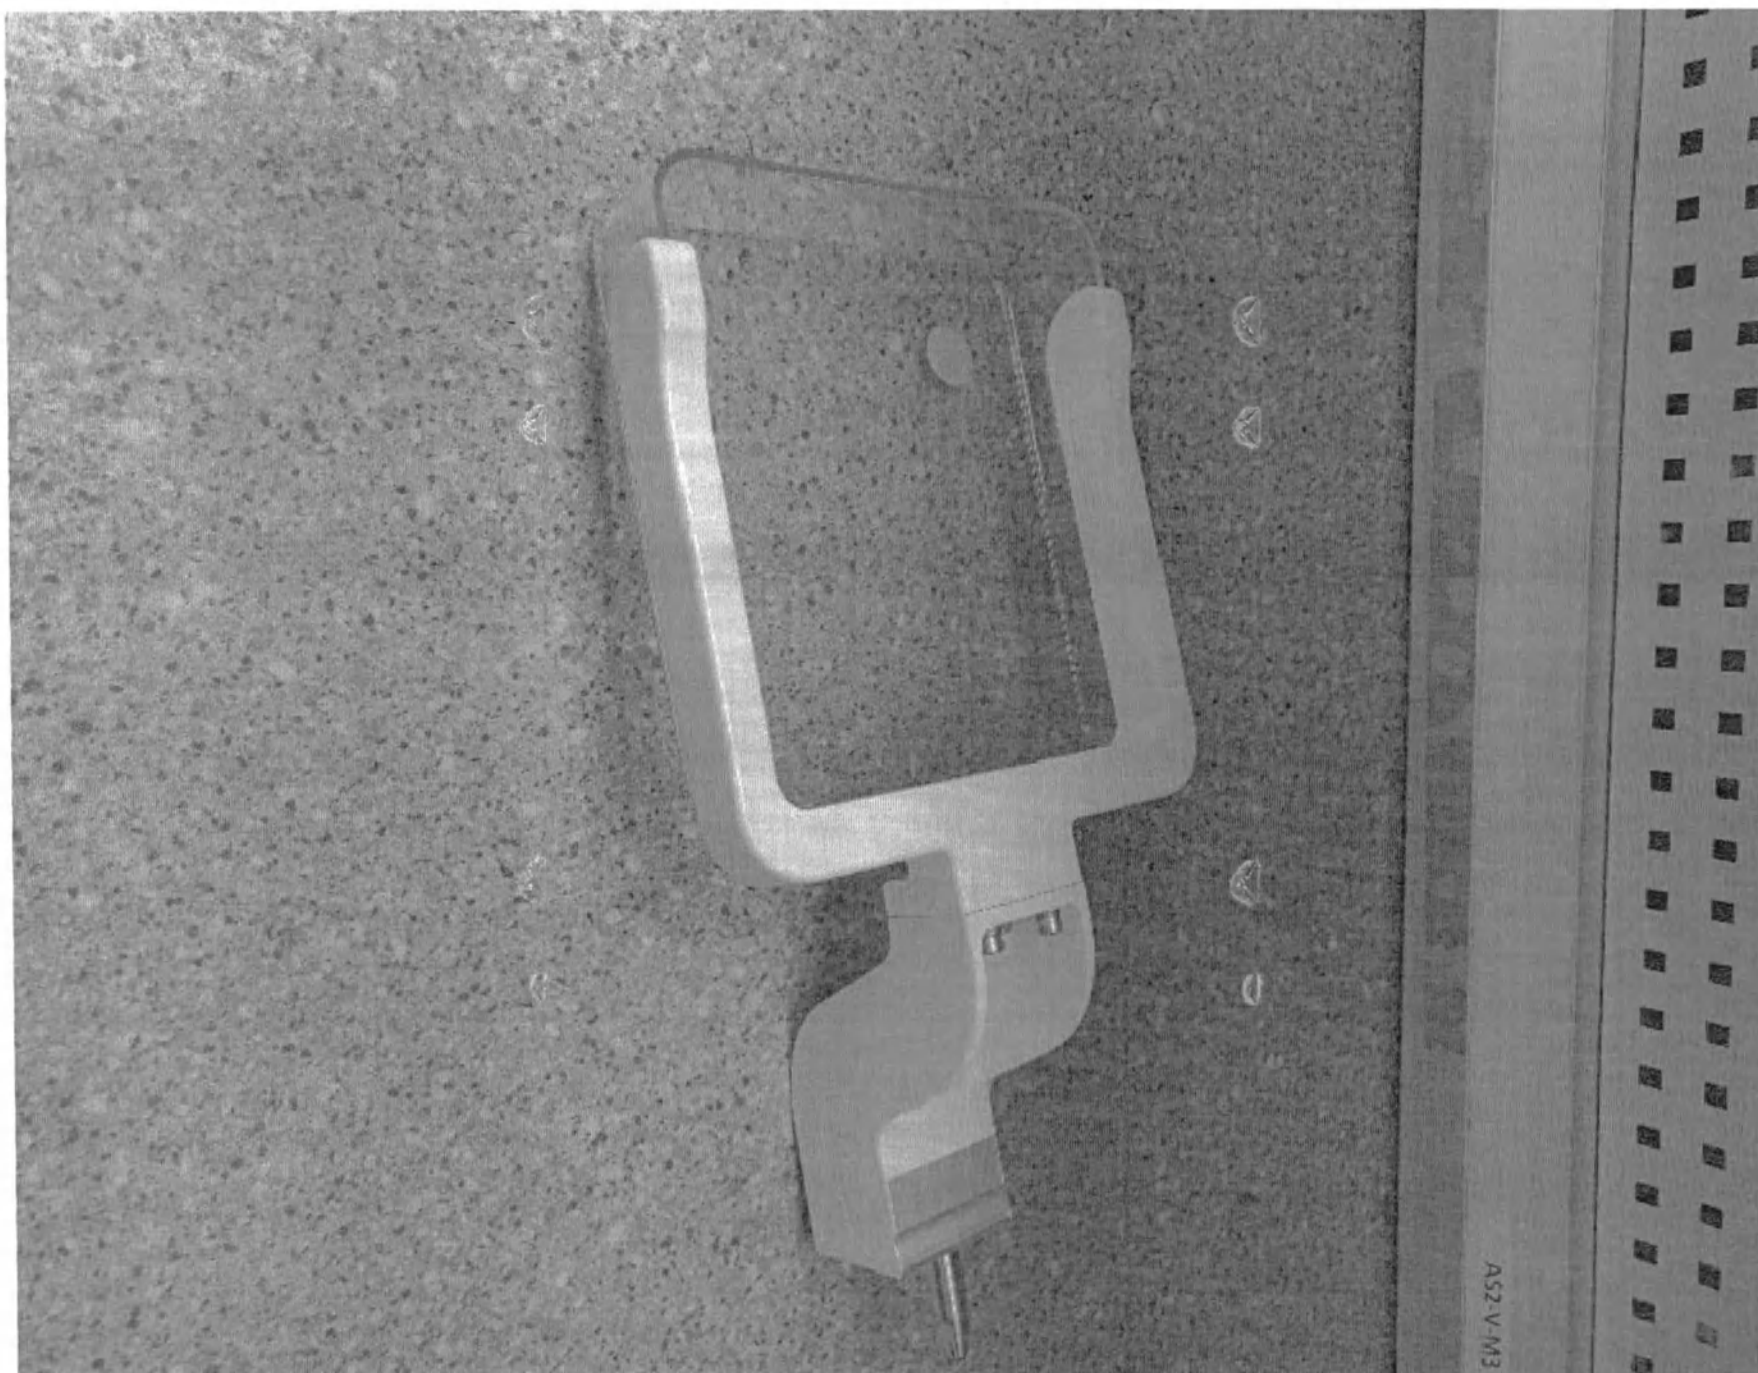

Упаковка

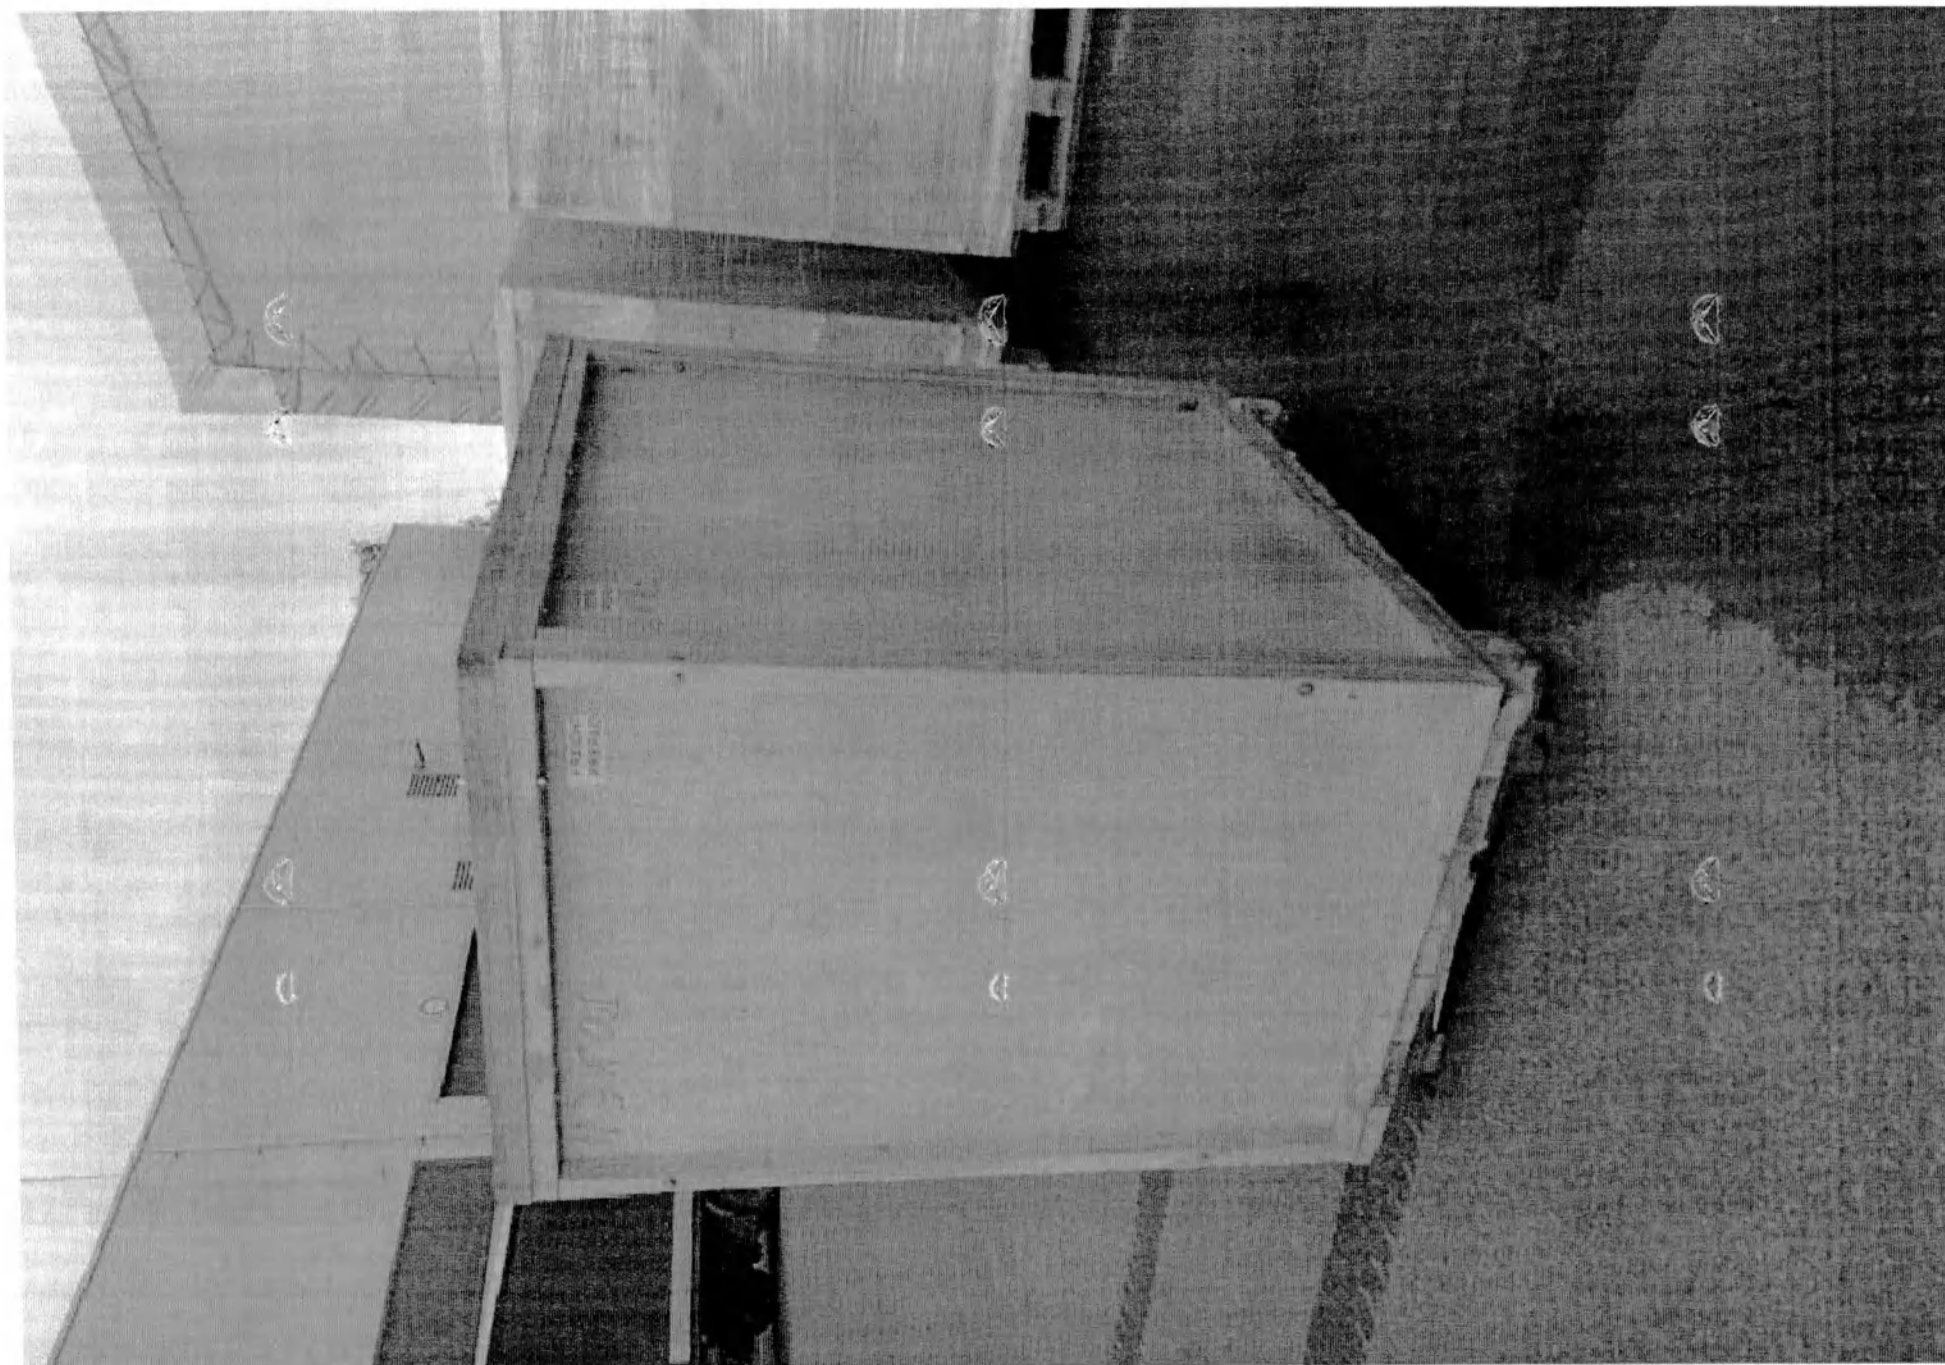

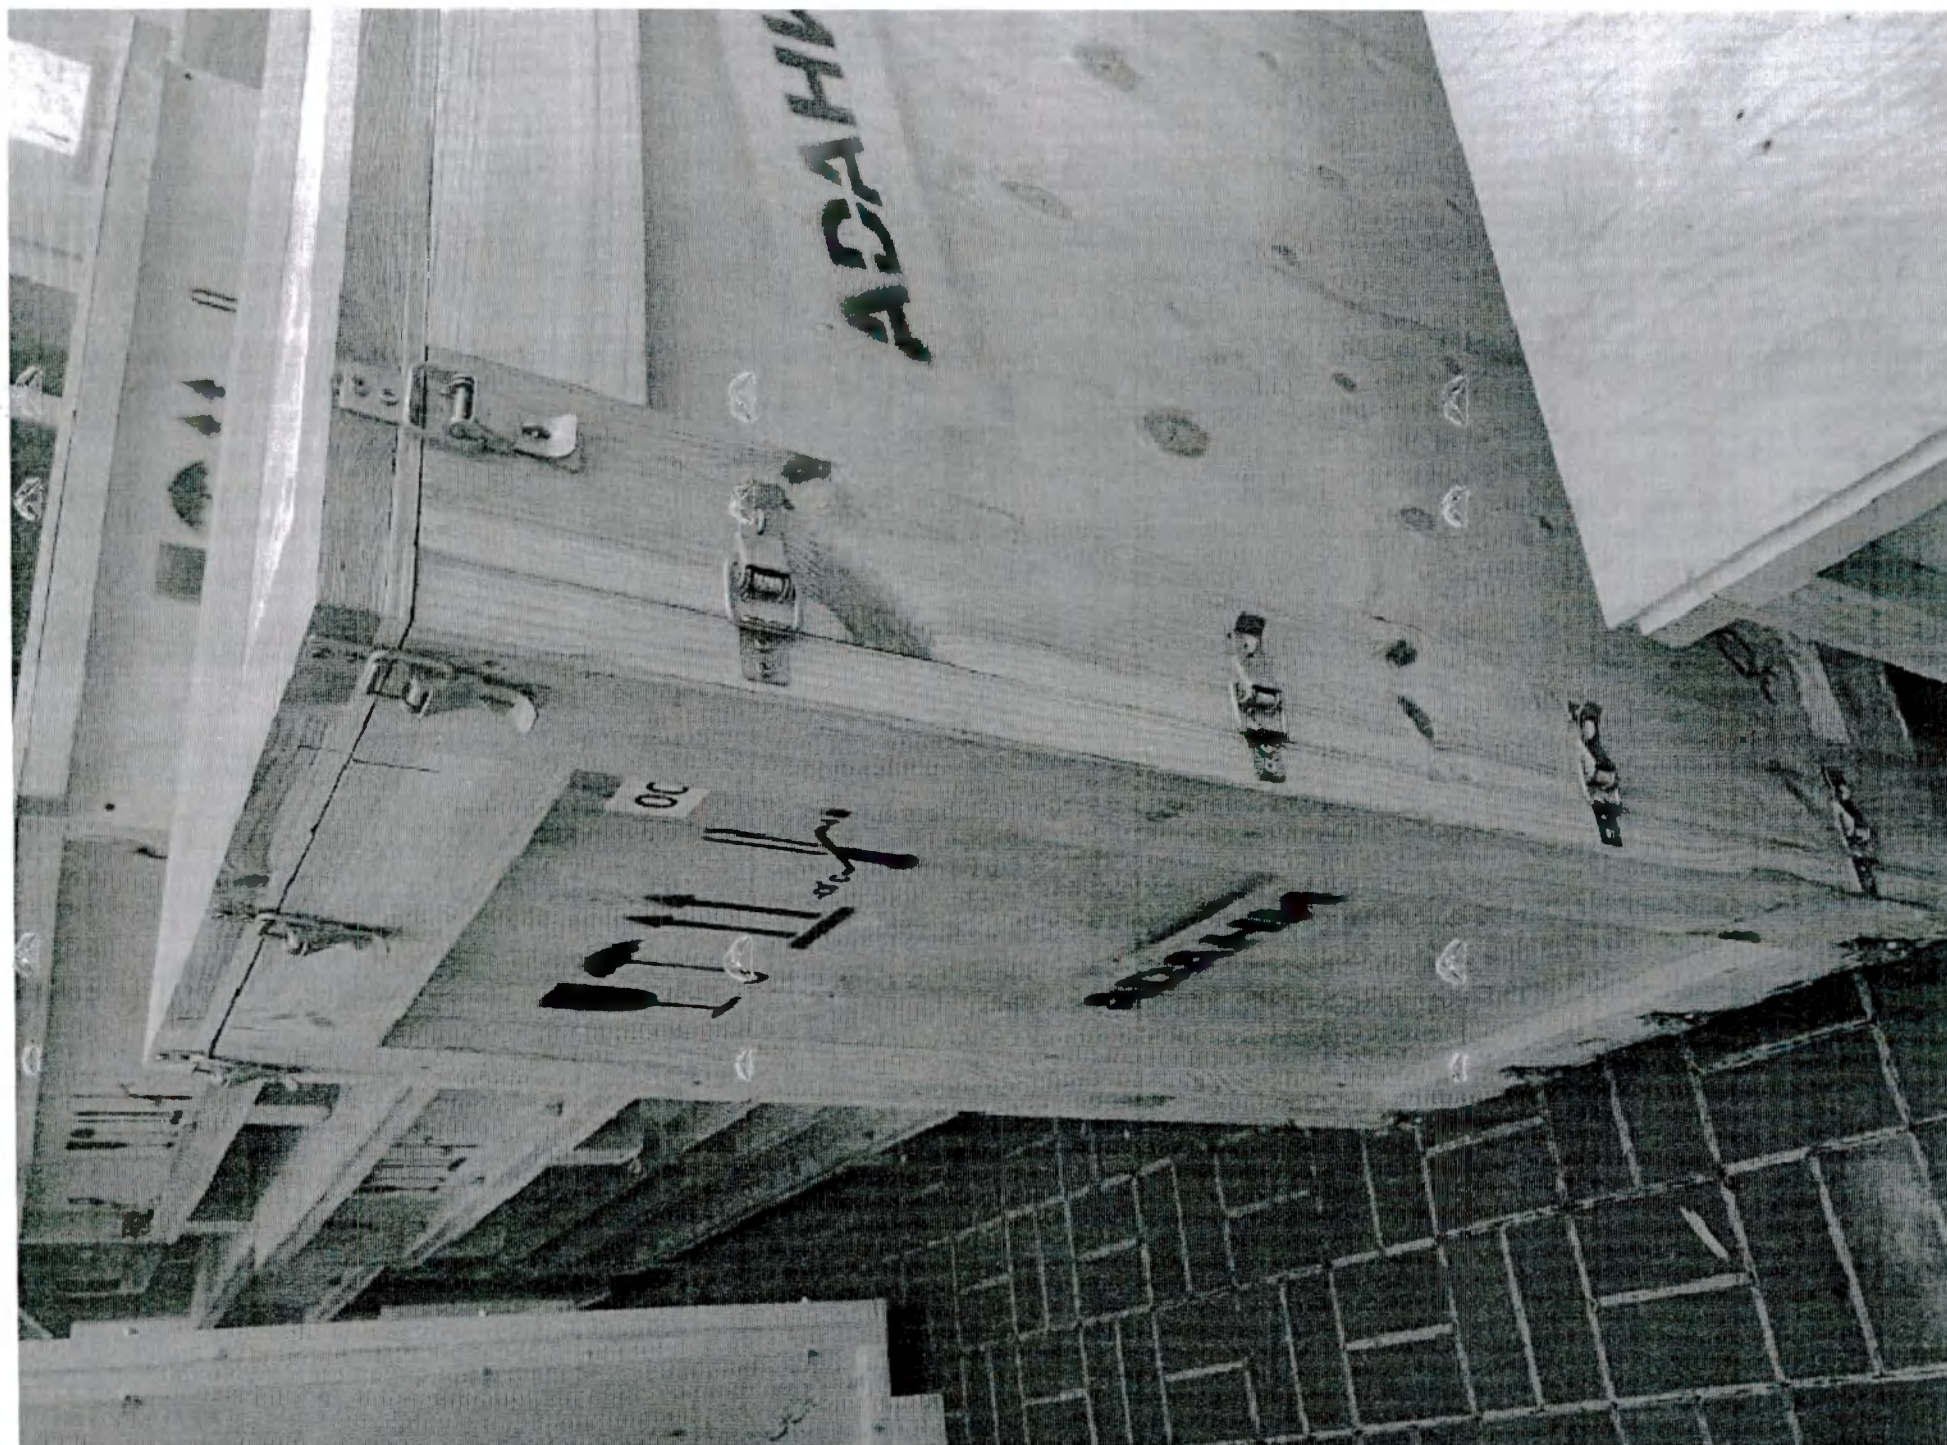

Образцы маркировки


Аппарат рентгеновский маммографический МАММОСКАН 2М




Рентгеновское штативное устройство XRS1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.




Приёмник рентгеновского излучения серии Mammo1012 производства iRay Technology Company Limited, Китай.

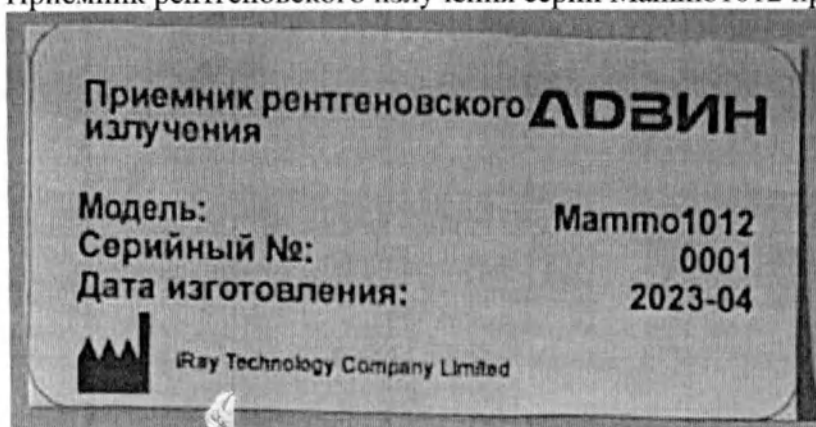


Приёмник рентгеновского излучения серии RSM2430 производства DRTECH CORPORATION, Республика Корея.

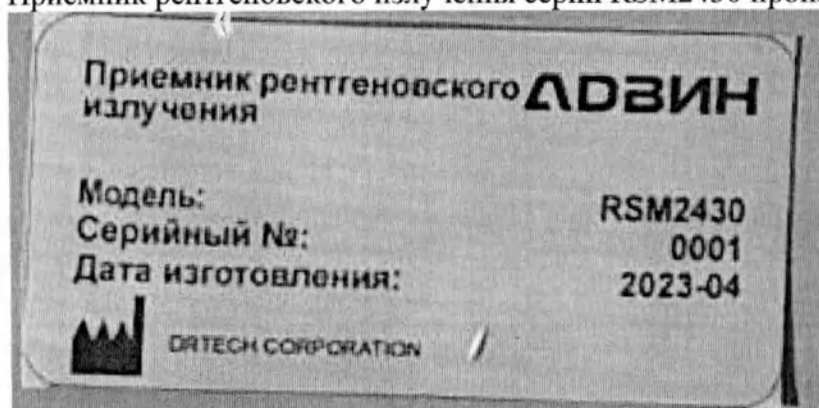

Приёмник рентгеновского излучения серии VIVIX-M 1210 производства Vieworks Co., Ltd., Республика Корея.

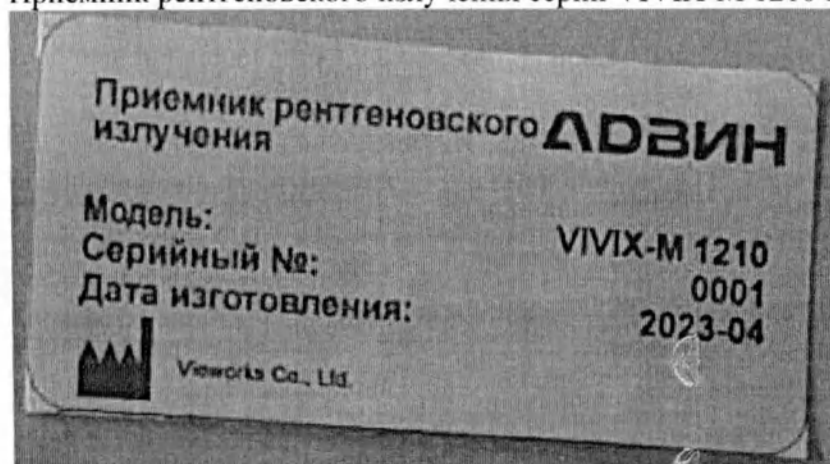


Приёмник рентгеновского излучения серии XRR1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

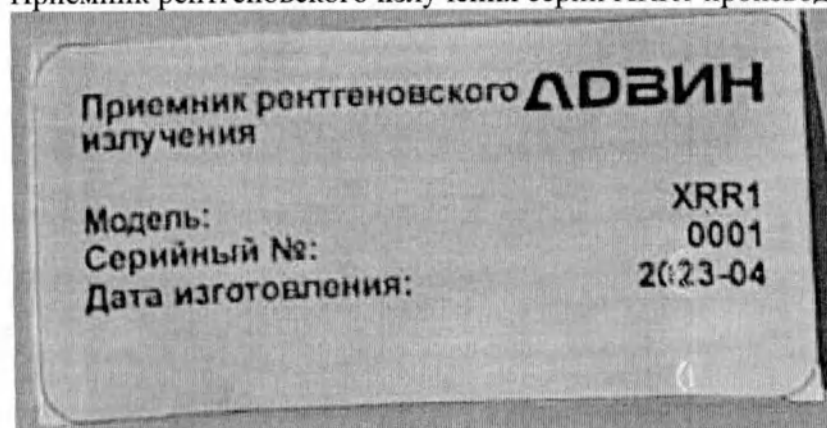


Рентгеновский излучатель серии M113 производства Varex Imaging Corporation, США.




Рентгеновский излучатель серии H5077 производства Hangzhou Kailong Medical instruments Co., Ltd, Китай.

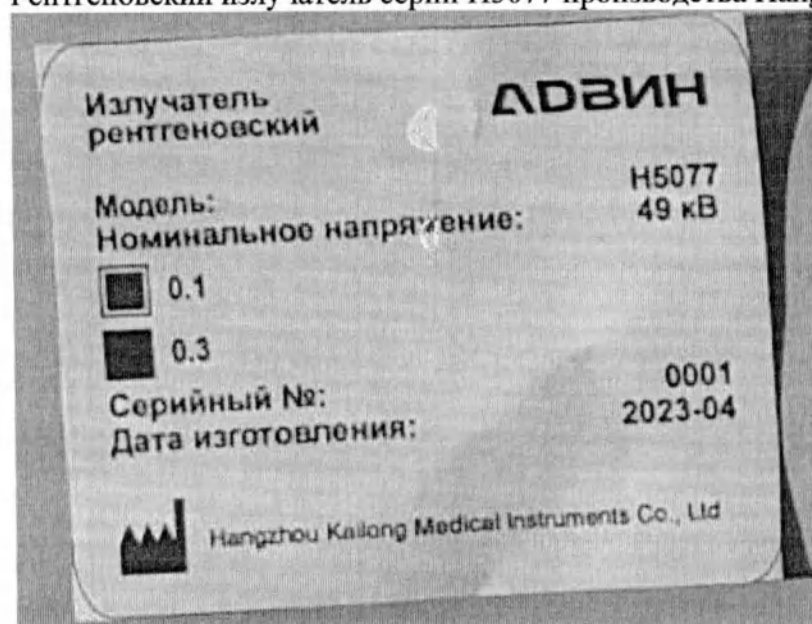


Рентгеновский излучатель серии C339VXM1016.

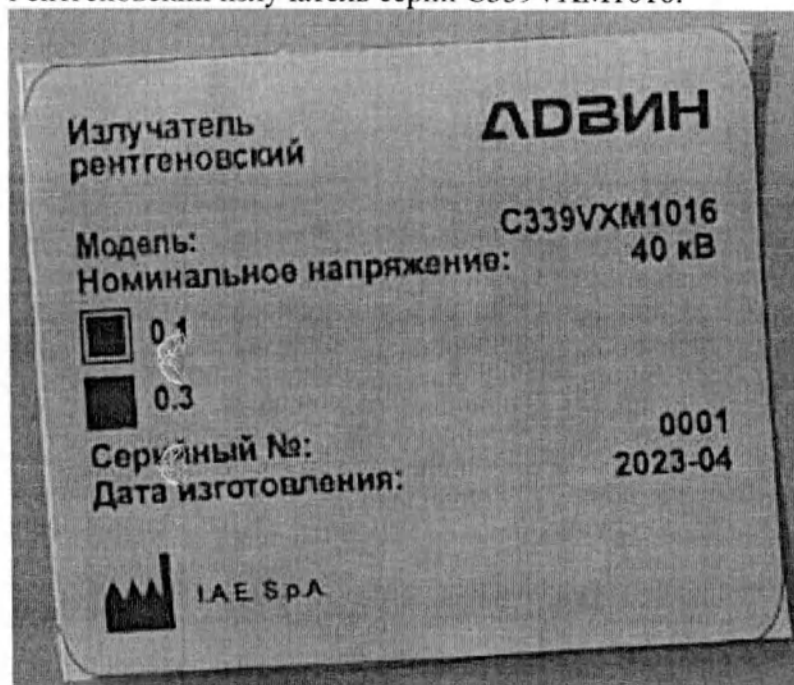


Рентгеновский излучатель серии ХК1016 производства I.A.E. S.p.A., Италия.

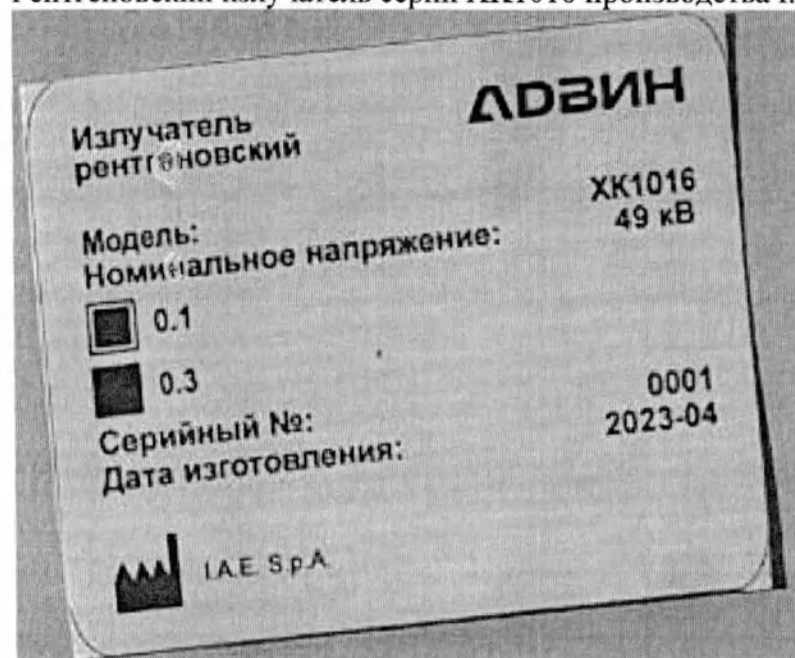

Рентгеновский излучатель серии XRE1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

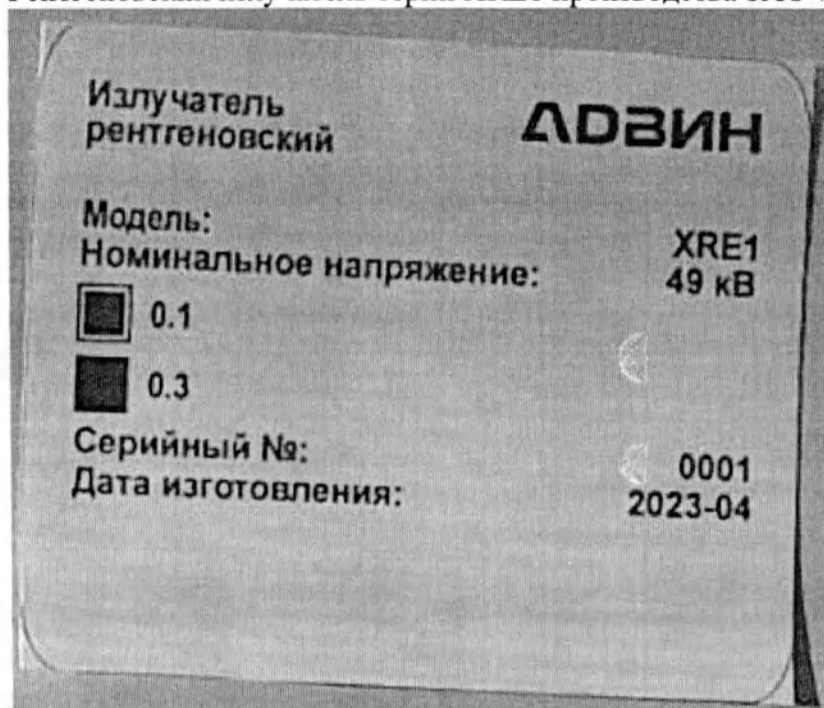

Рентгеновское питающее устройство серии PMX.

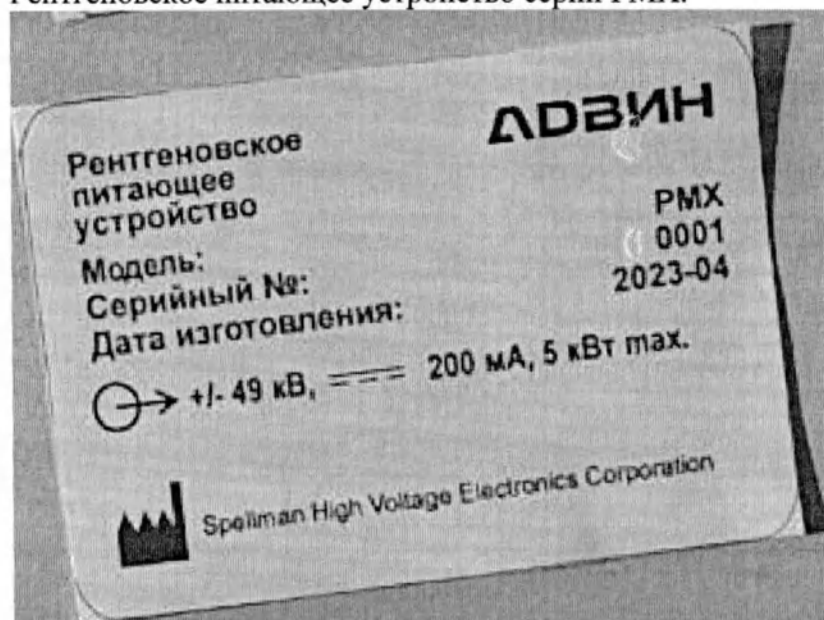


Рентгеновское питающее устройство серии VMX производства Spellman High Voltage Electronics Corporation, США.




Рентгеновское питающее устройство серии PSG производства Suzhou Powersite Electric Co., LTD Китай.




Рентгеновское питающее устройство серии HF1 производства Imd Generators Srl, Италия.

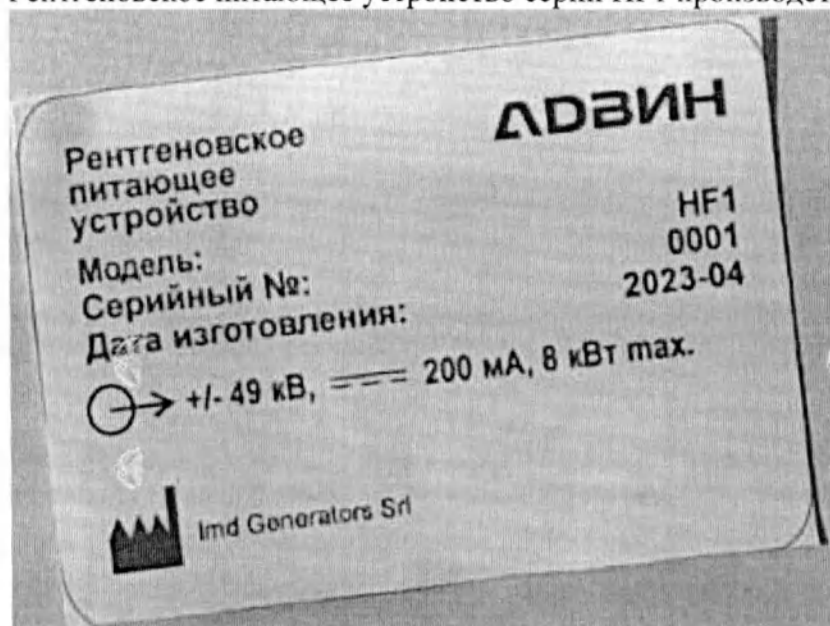


Рентгеновское питающее устройство серии XPD1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

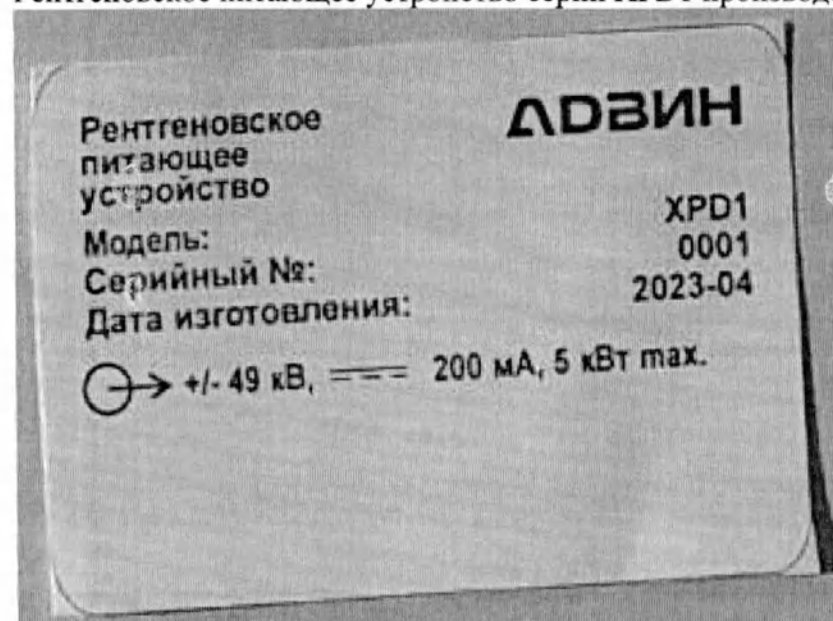


Коллиматор RF1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

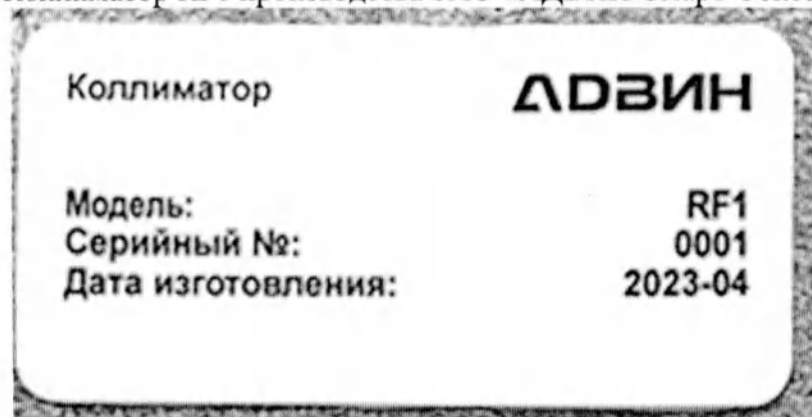


Ножные переключатели компрессии P01 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

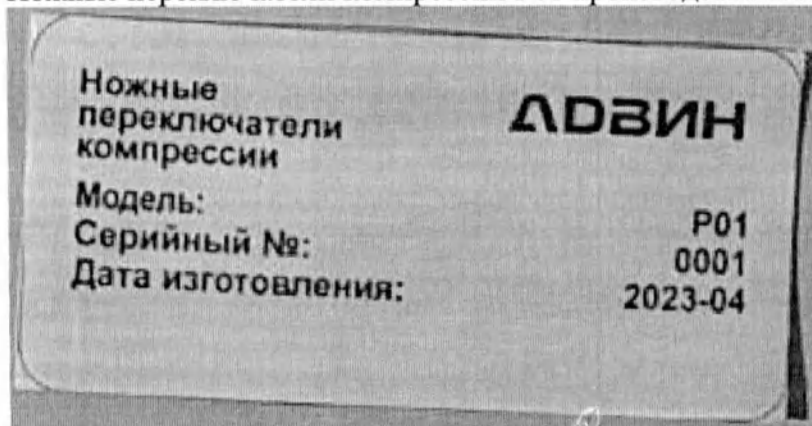

Автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора AWS1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

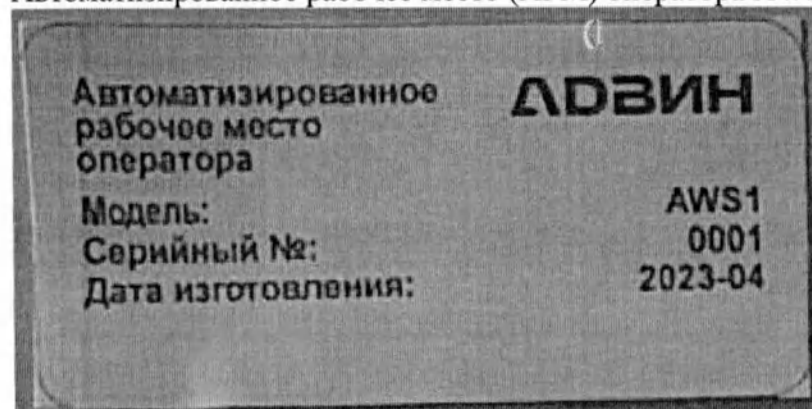


Медицинская рабочая станция AW1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

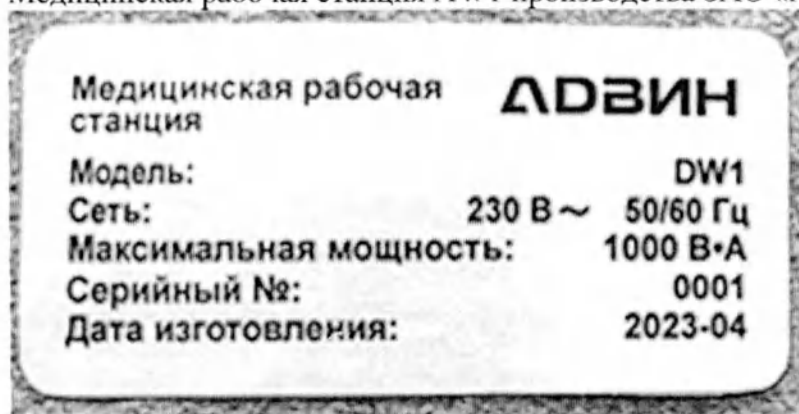


Монитор ЖК производства MMD (Shanghai) Electronics Technology Co. Ltd, Китай.



Монитор ЖК производства Wistron Corporation, Тайвань.

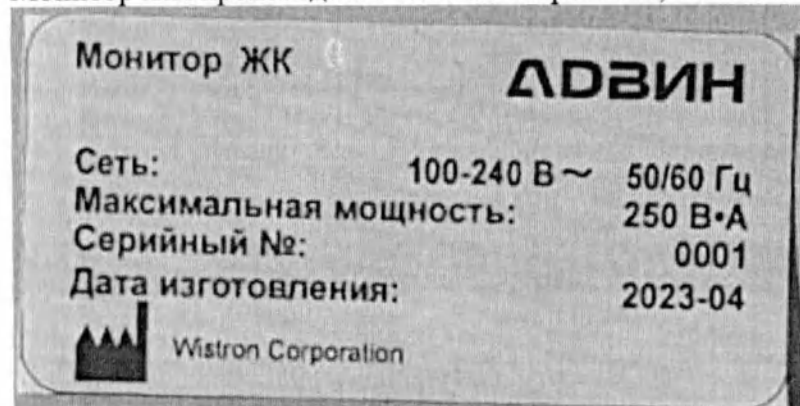


Монитор ЖК производства Samsung Electronics Co. Ltd, Республика Корея.

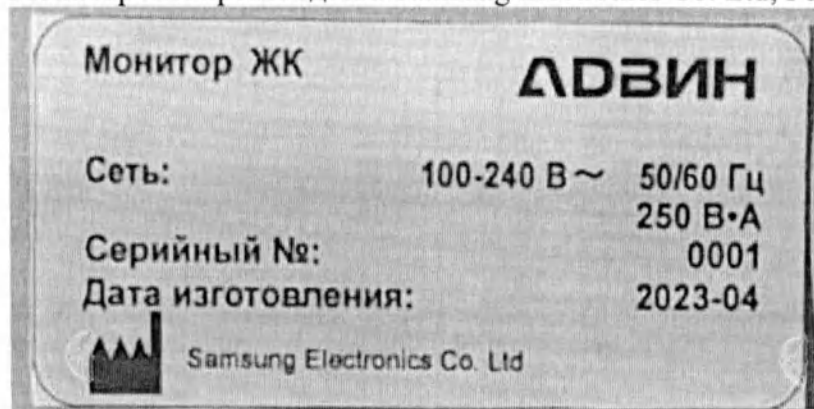


Рабочее место оператора OW2 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.




Автоматизированное рабочее место (АРМ) врача рентгенолога AWD1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

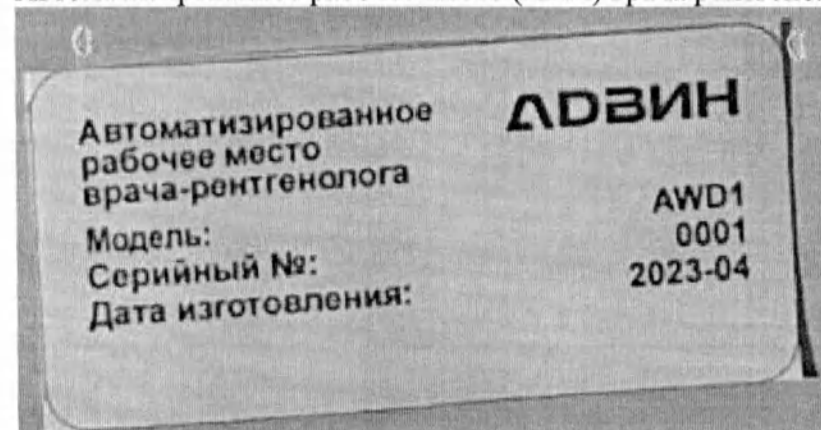


Медицинская рабочая станция DW1 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

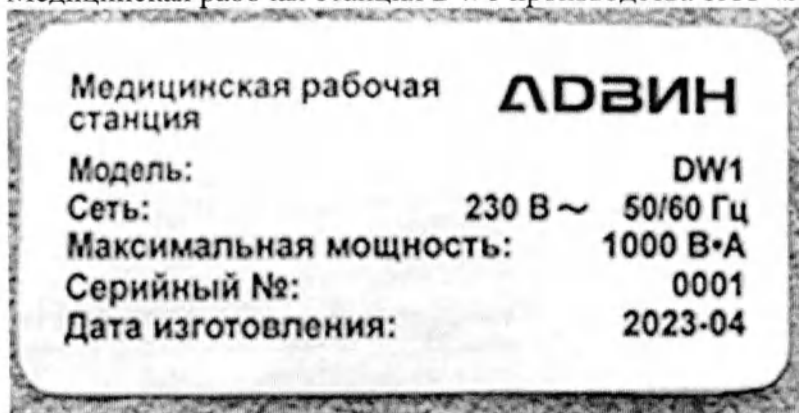


Монитор медицинский диагностический серии MS производства JVCKENWOOD Corporation, Япония.

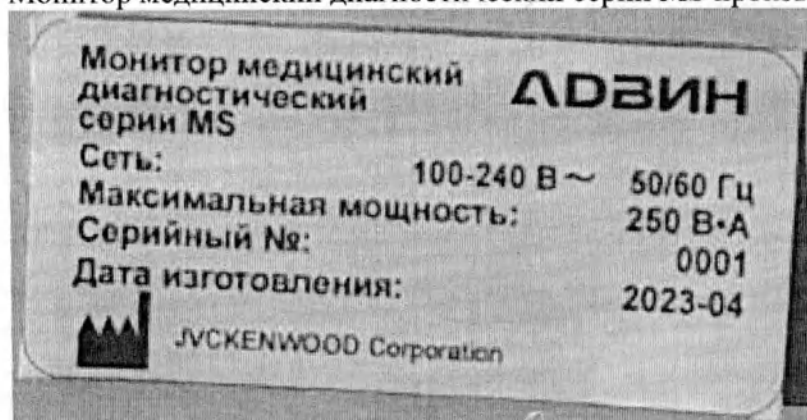

Монитор медицинский диагностический серии G производства Shenzhen Beacon Display Technology Co., Ltd., Китай.

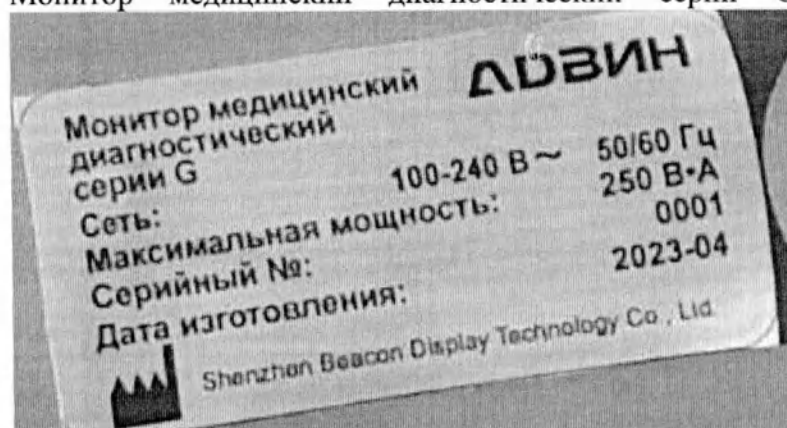


Монитор медицинский диагностический серии MX производства Foreseeson GmbH, Германия.

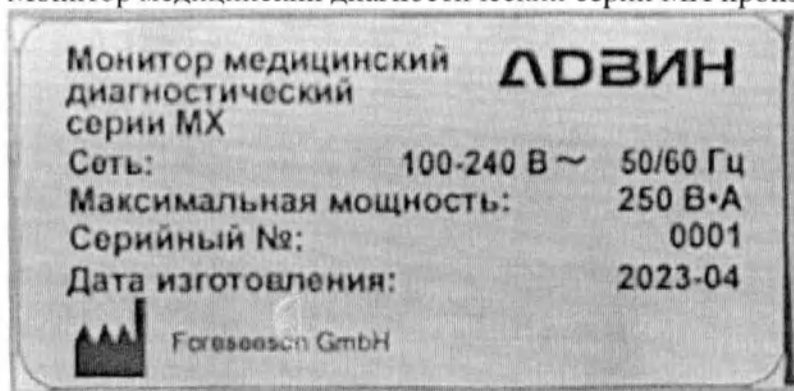


Монитор медицинский диагностический серии М производства Nanjing Jusha Display Technology Co., Ltd., Китай.




Монитор медицинский диагностический серии 21Х производства Shenzhen KTC Medical Solutions Co., Ltd. Китай.

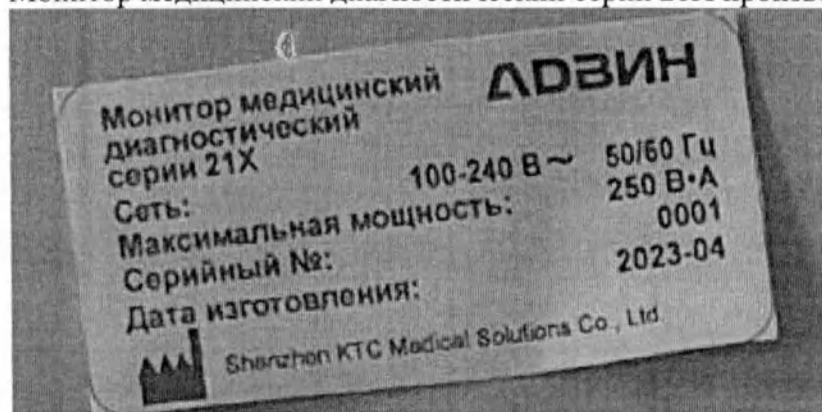


Принтер лазерный А4, ч/б производства Xerox Limited, Великобритания.

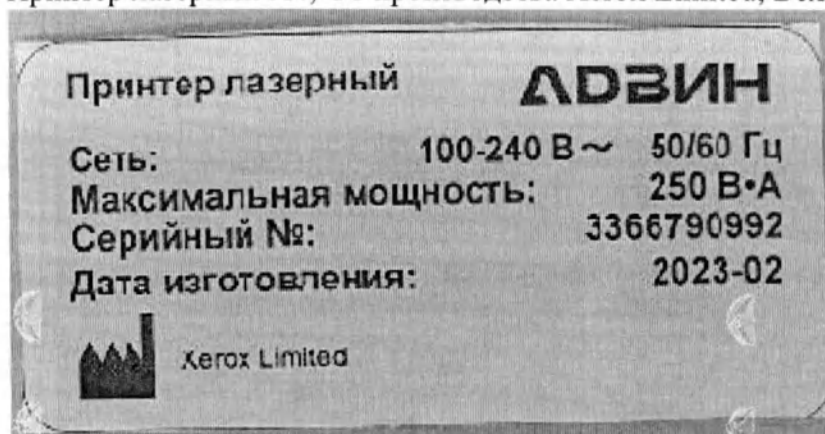


Принтер лазерный А4, ч/б производства Samsung Electronics Co Ltd, Республика Корея.

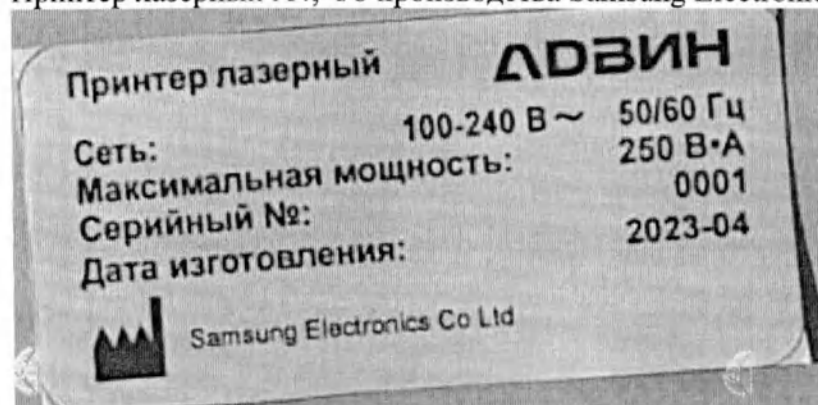


Принтер лазерный А4, ч/б производства HP Inc, США.

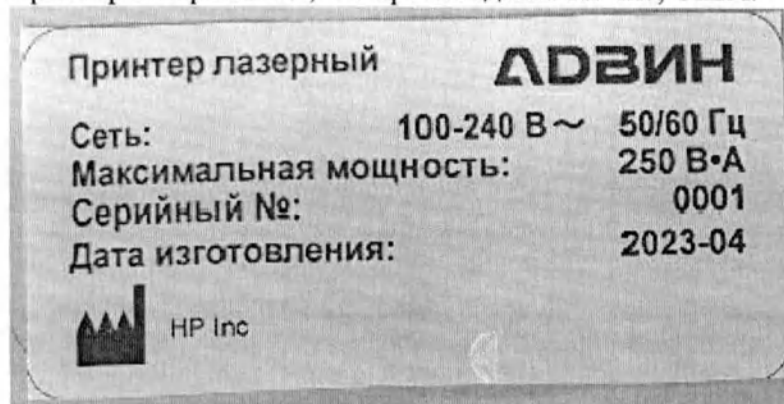


Принтер лазерный А4, ч/б производства Canon Inc, Япония.

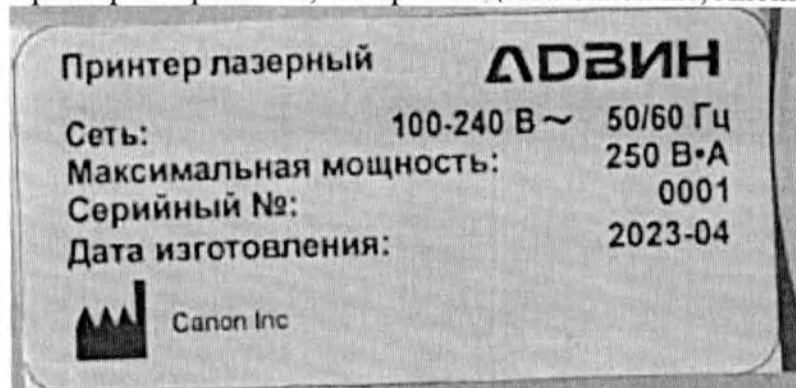


Камера мультиматная термографическая Drystar AXYS с принадлежностями производства Agfa N.V., Бельгия.

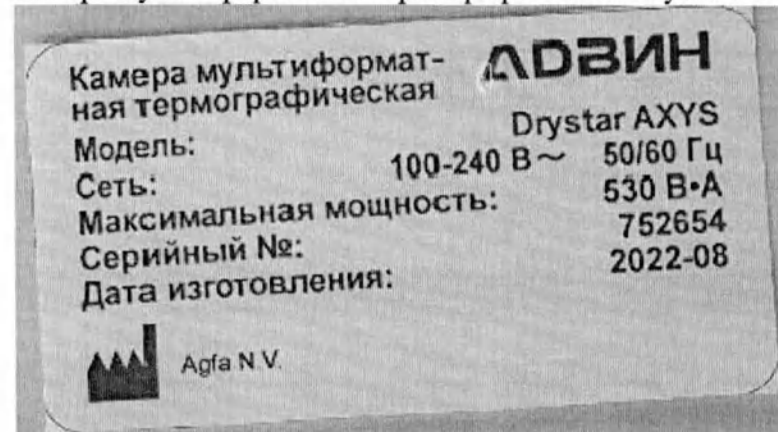


Принтер медицинский KND6320 производства Shenzhen Kenid Medical Devices CO., LTD., Китай.

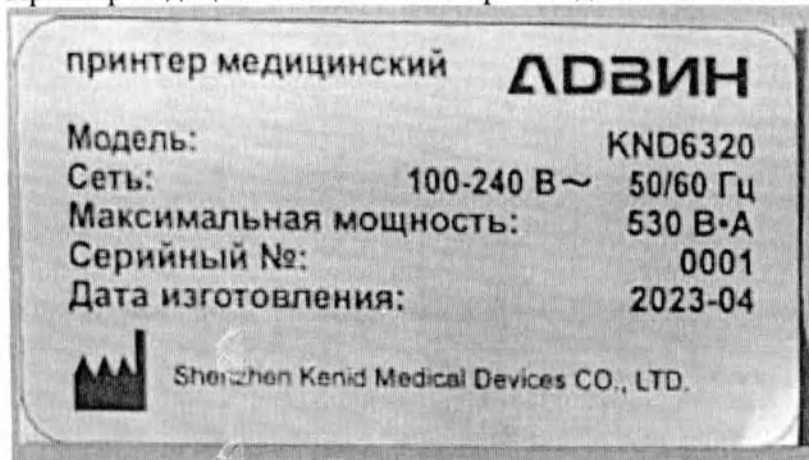


Фантом для калибровки детектора 001 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

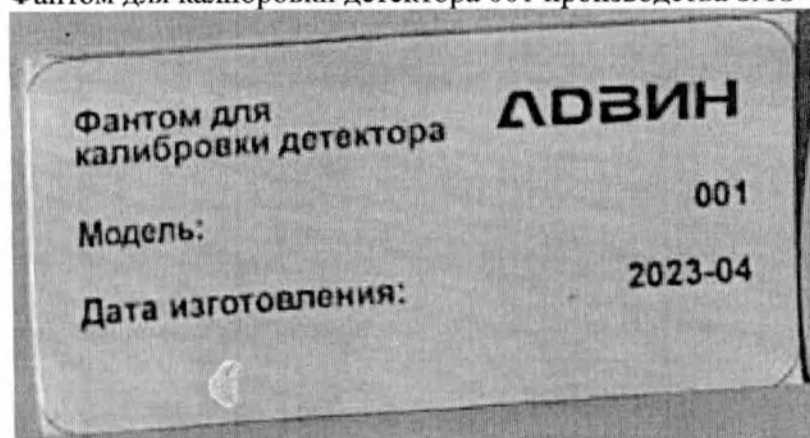


Изделия индивидуальной защиты для медицинского персонала и пациентов из рентгенозащитного материала МЗ-7 по ТУ 9398-012-59003778-07 производства ООО «Защита-Чернобыль М», Российская Федерация.

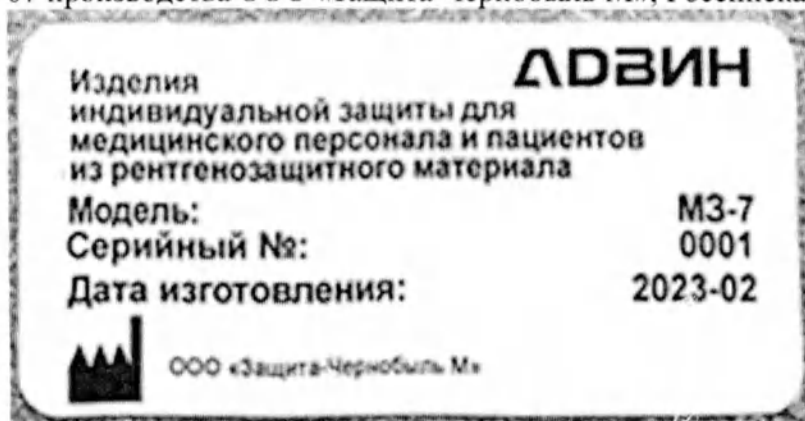


Комплект индивидуальных поливинилхлоридносвинцовых средств защиты пациентов и медицинского персонала от рентгеновского излучения КИСЗ-«РЕНЕКС» по ТУ 9398-010-21009821-2004 производства ЗАО «РЕНЕКС», Российская Федерация.

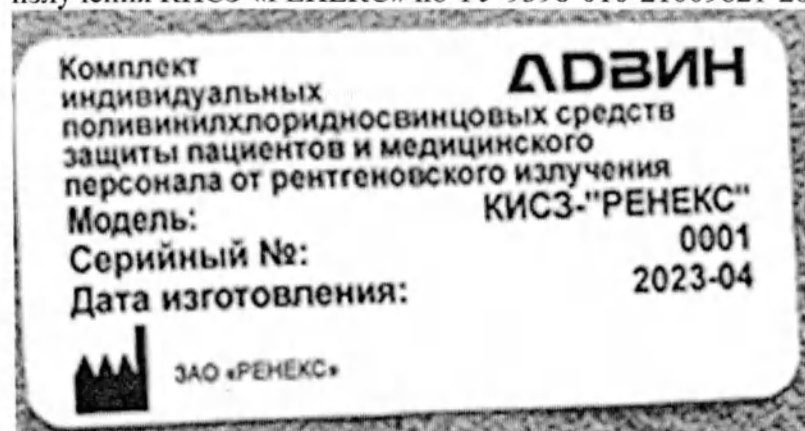


Приспособление для хранения принадлежностей АС2 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

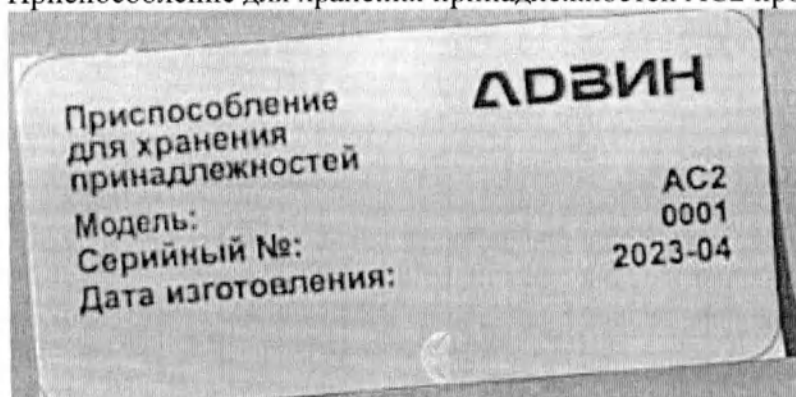


Стол для съёмки с увеличением 1,5х производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

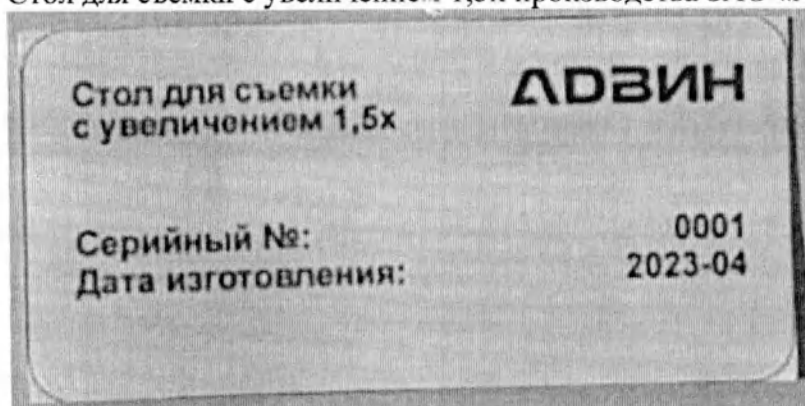


Пленка термографическая медицинская Drystar DT 10 Mammo производства Agfa N.V., Бельгия.

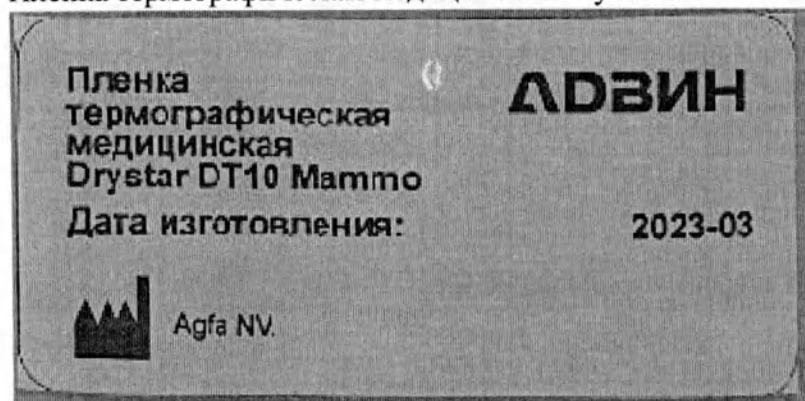


Пленка термографическая KND-A для принтеров медицинских производства Shenzhen Kenid Medical Devices CO., LTD., Китай.

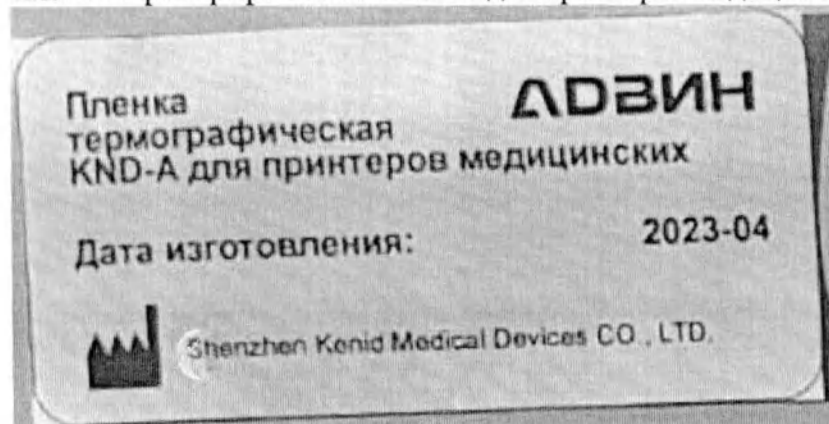


Прижим 24x30 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

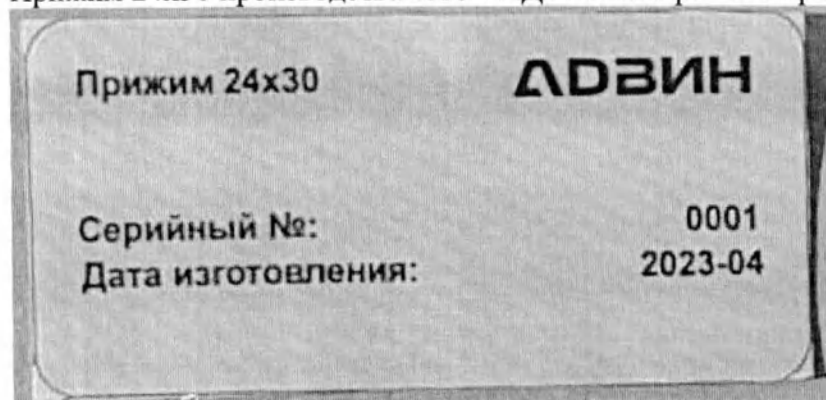


Прижим 18x24 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

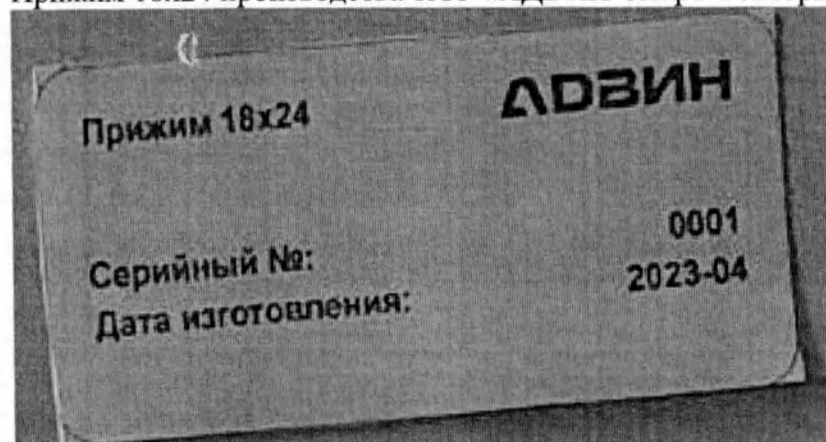

Прижим 10x10 производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

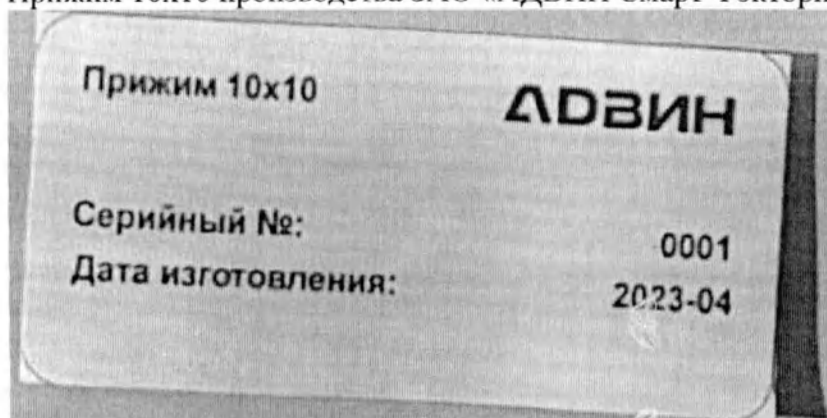

Прижим 15x15 для прицельной съёмки производства ЗАО «АДВИН Смарт Фэктори», Республика Беларусь.

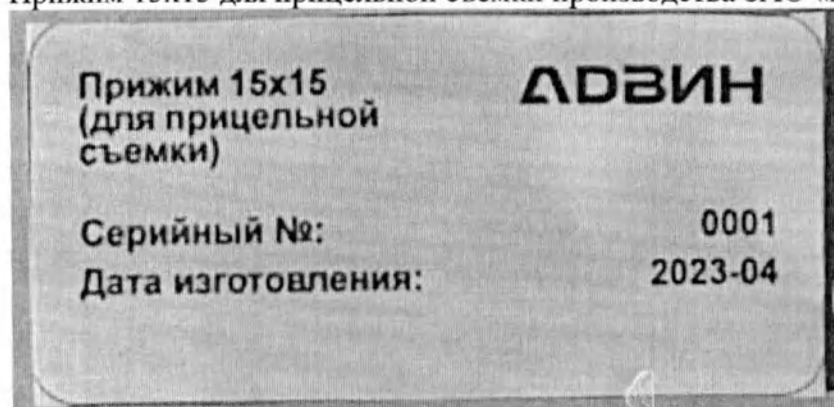

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

86 (восемьдесят шесть) листа (ов)

Генеральный Директор ООО "АДАНИ РУС"

/В.О. Скачков/

