




www.neurosoft.com, info@neurosoft.com
Телефоны: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99
Факс: +7 4932 24-04-35
Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5

УТВЕРЖДАЮ



Заместитель президента
ООО "Нейрософт"

 И.К. Маламант


"05" сентября 2024 г.

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ,
ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-5" по ТУ 26.60.12-044-13218158-2017»
с учетом извещения об изменении № 3,
в том числе фотографические изображения принадлежностей,
необходимые для применения медицинского изделия по назначению,
а также фотография изделия в упаковке



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия «Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-5" по ТУ 26.60.12-044-13218158-2017» (пример размещения на столе-тележке СТ-3/Р)¹

¹ Стол на фотографическом изображении предназначен для демонстрации, не входит в состав (комплект поставки) медицинского изделия

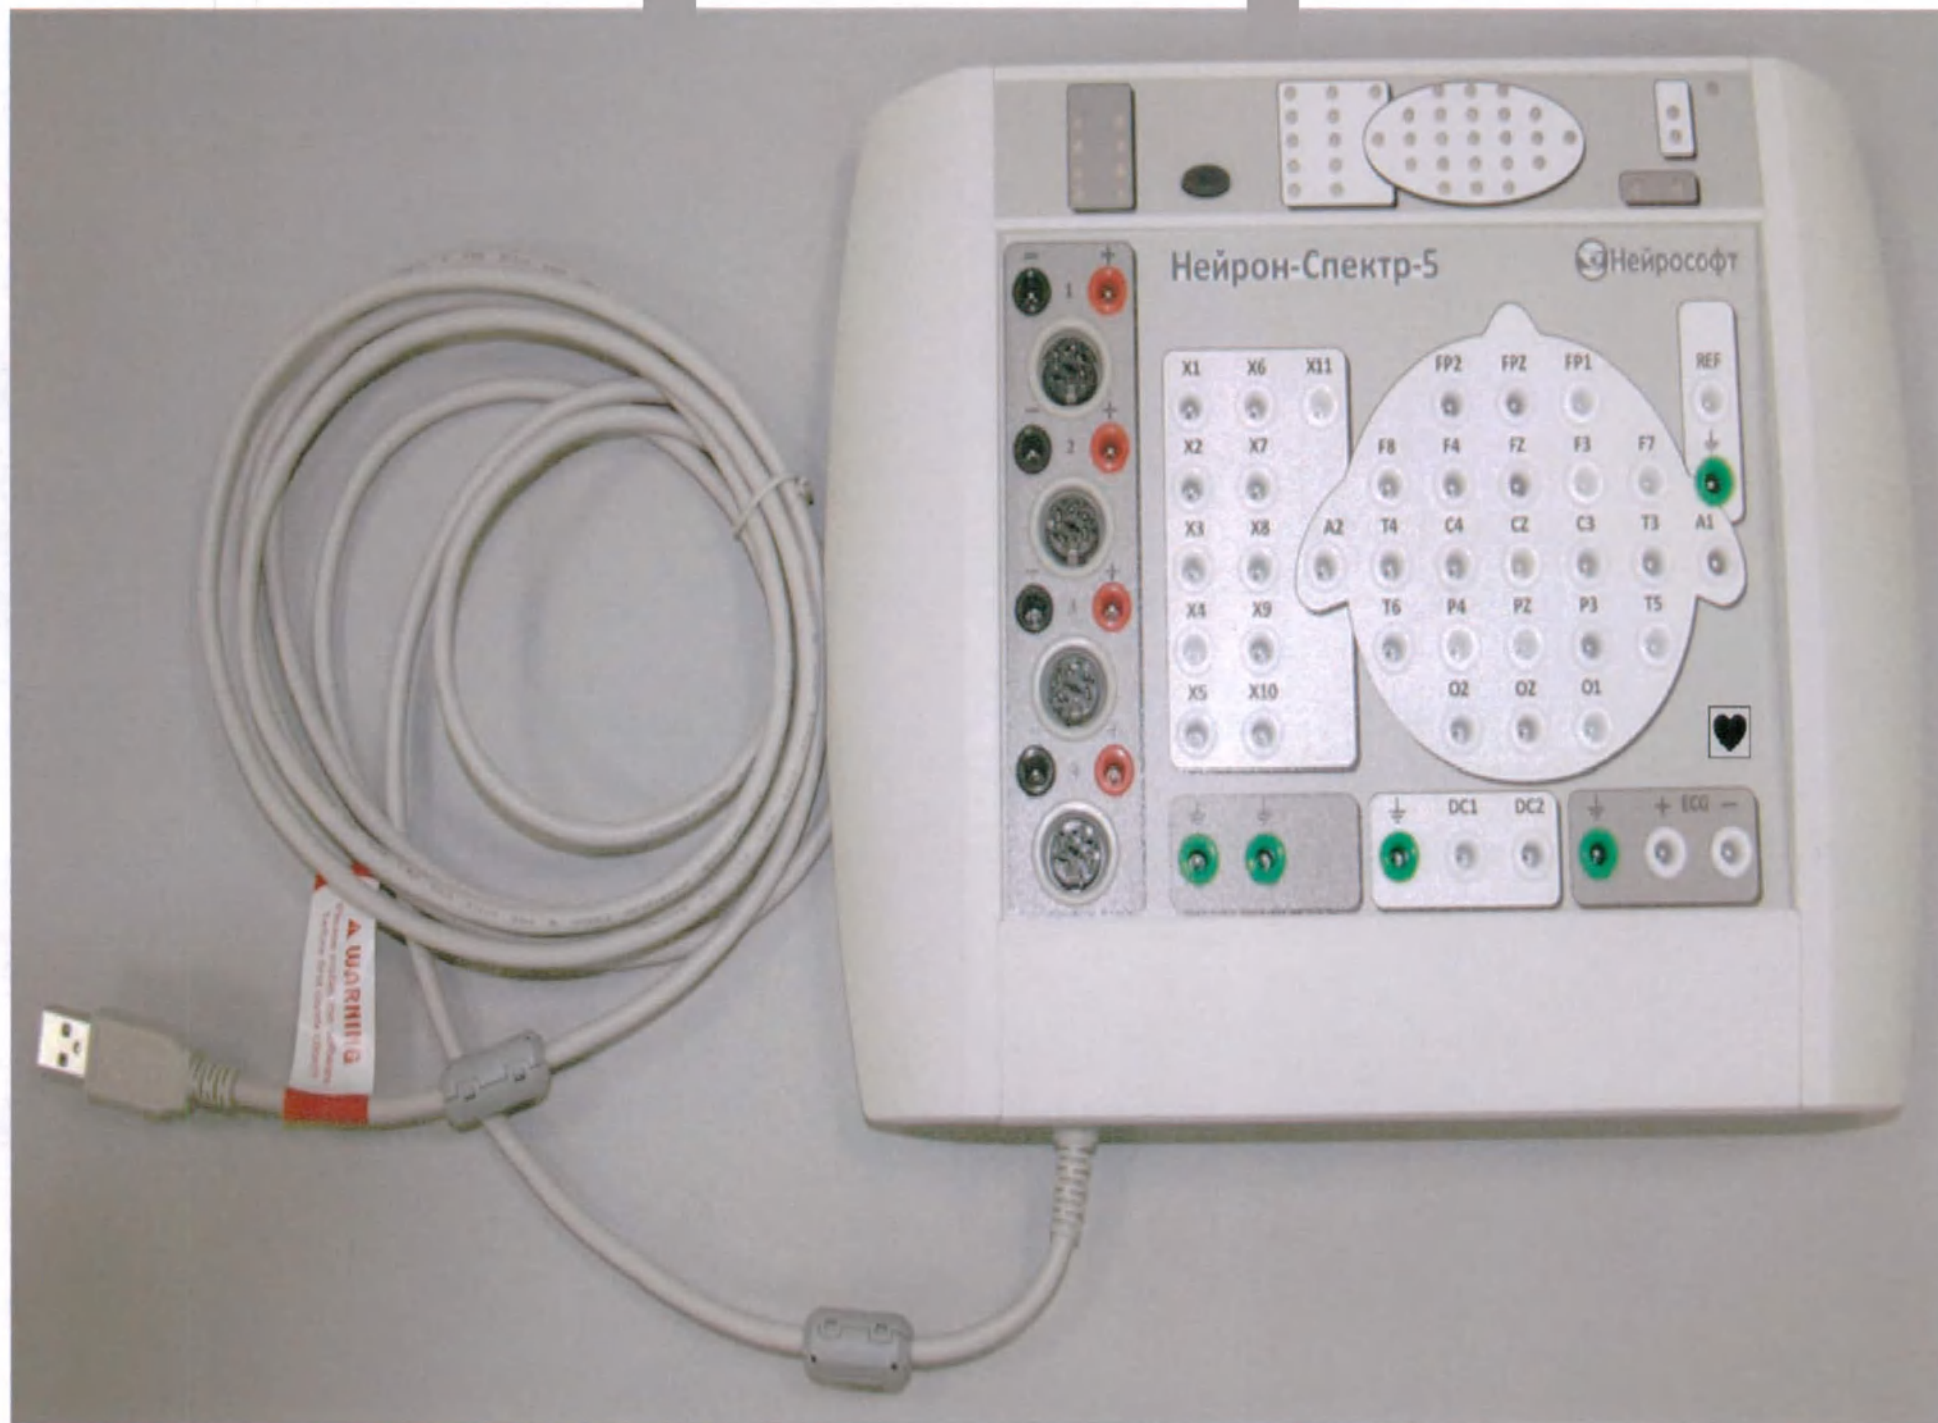

Блок электронный «Нейрон-Спектр-5»



Стойка напольная «СН-3»



Крепление к стойке




Фотостимулятор светодиодный «ФС-1»



Стойка напольная «СН-8»



Стойка напольная «СН-14»

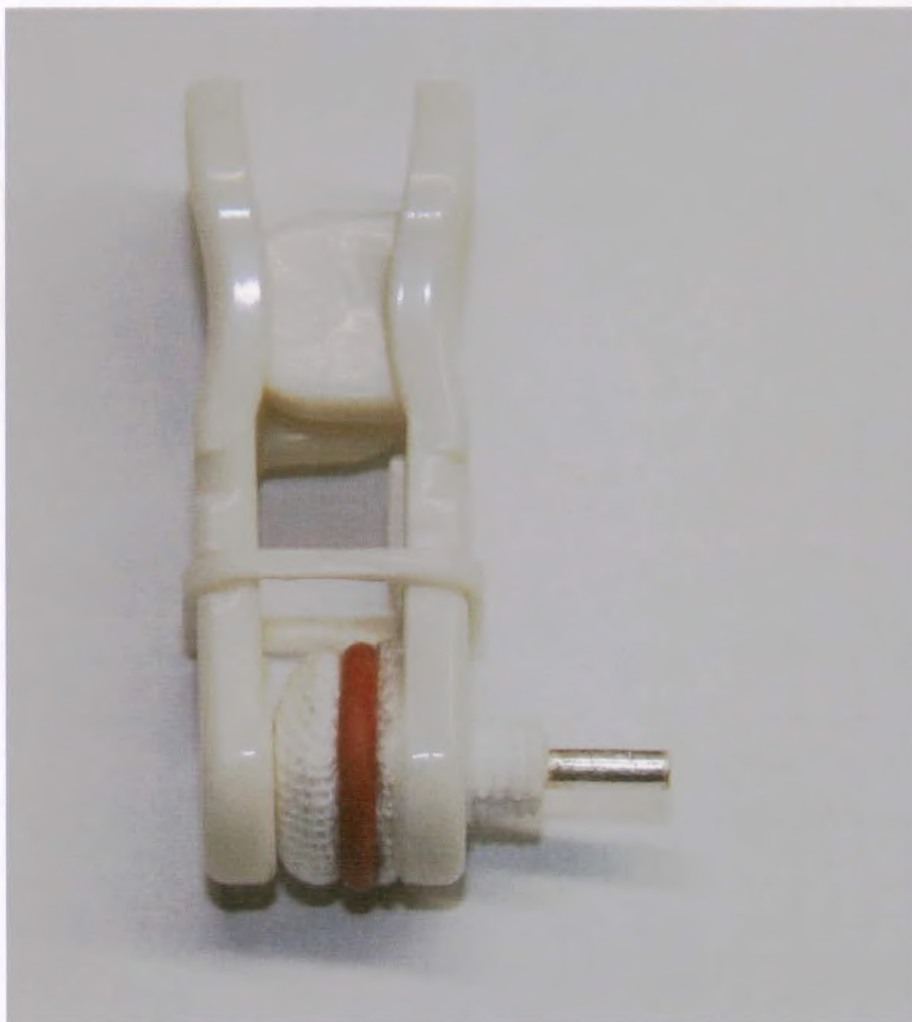


Ушной электрод




Мостиковый электрод


Комплект ЭЭГ-электродов (25 мостиковых, 3 ушных)

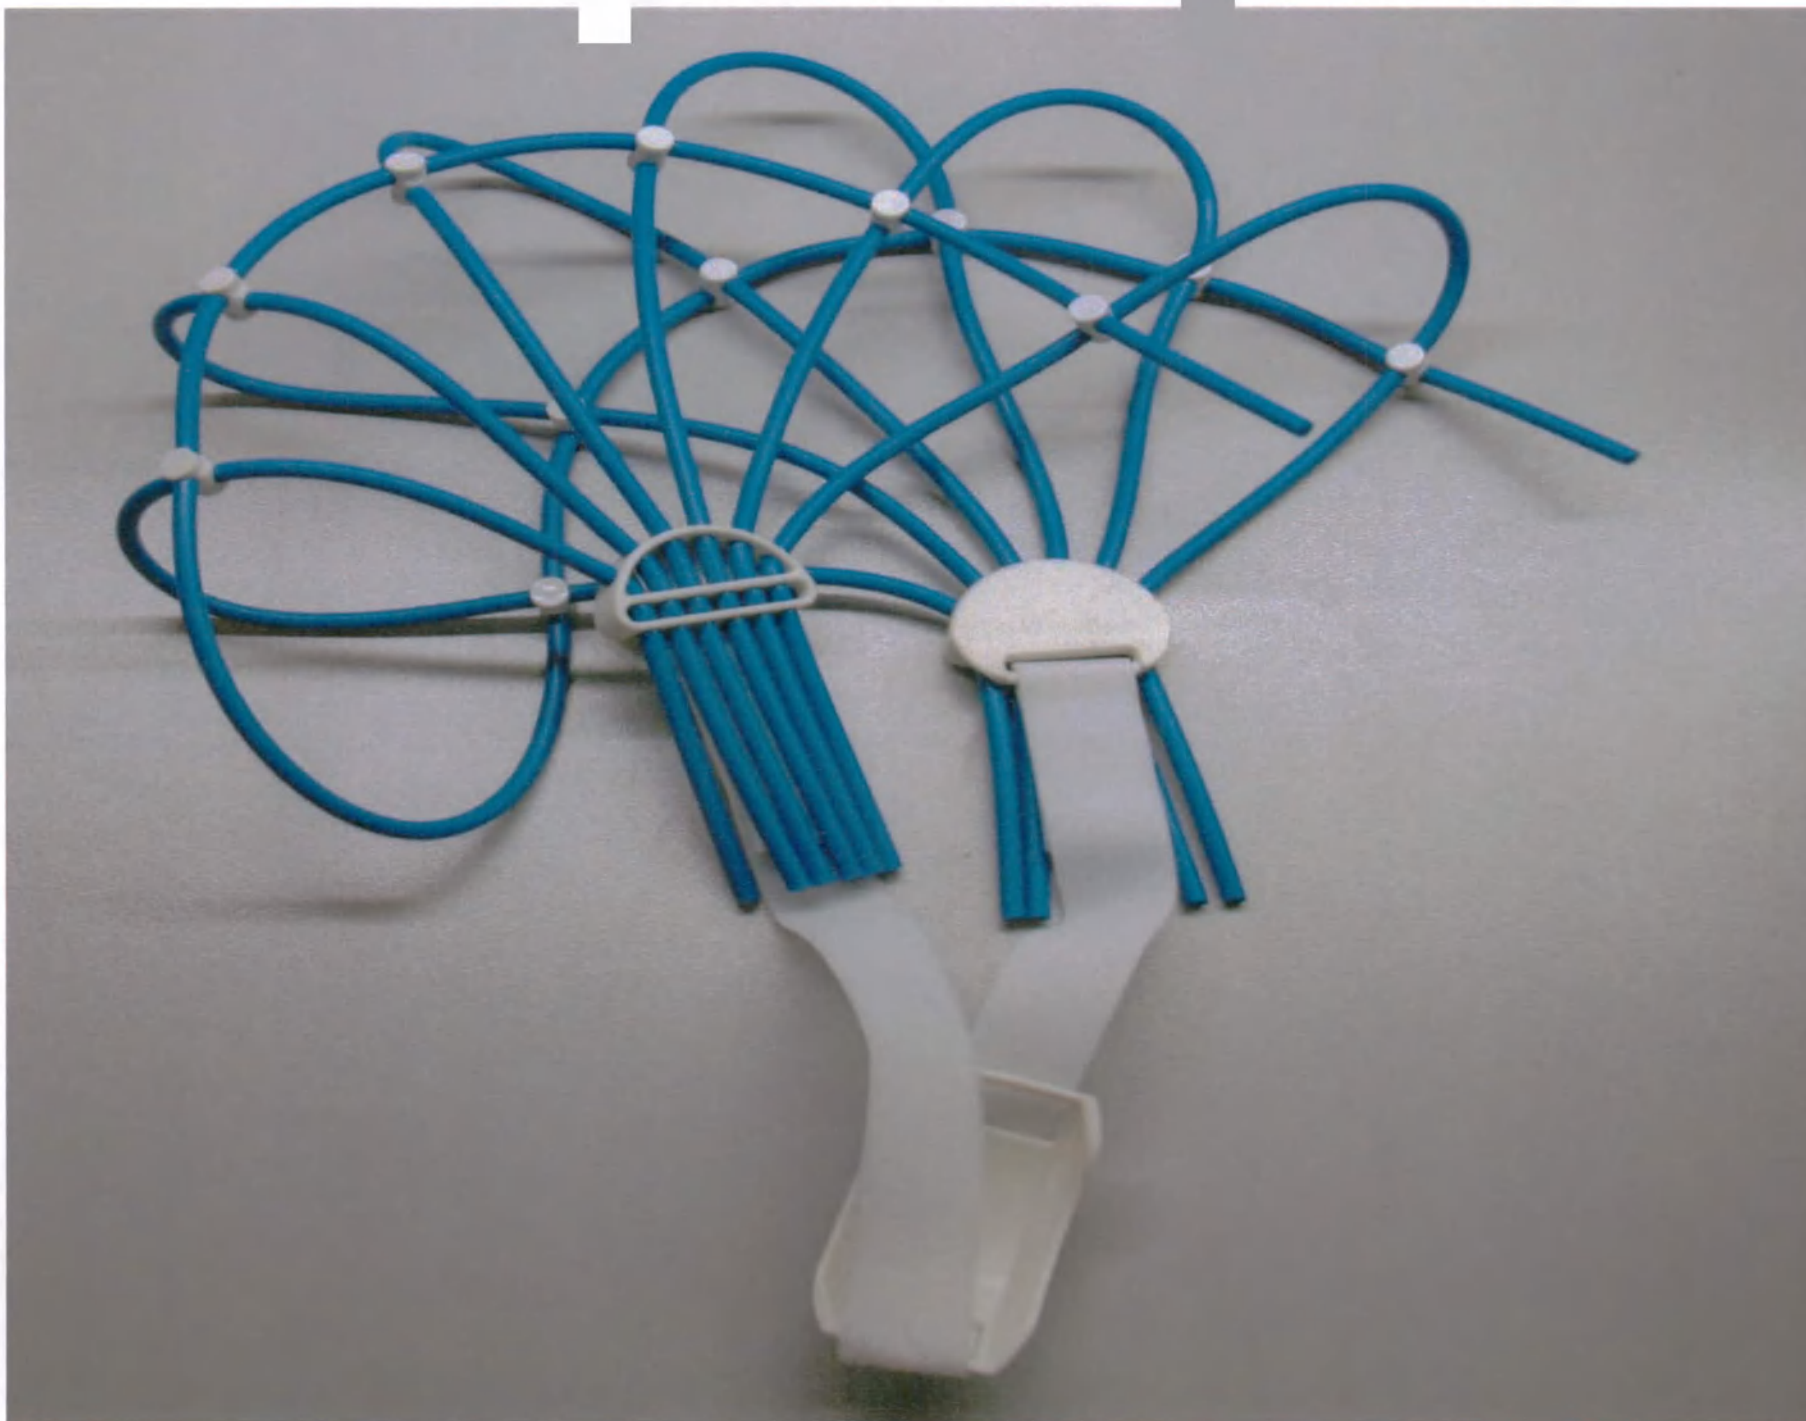

Шлем для крепления электродов ЭЭГ (54-62)

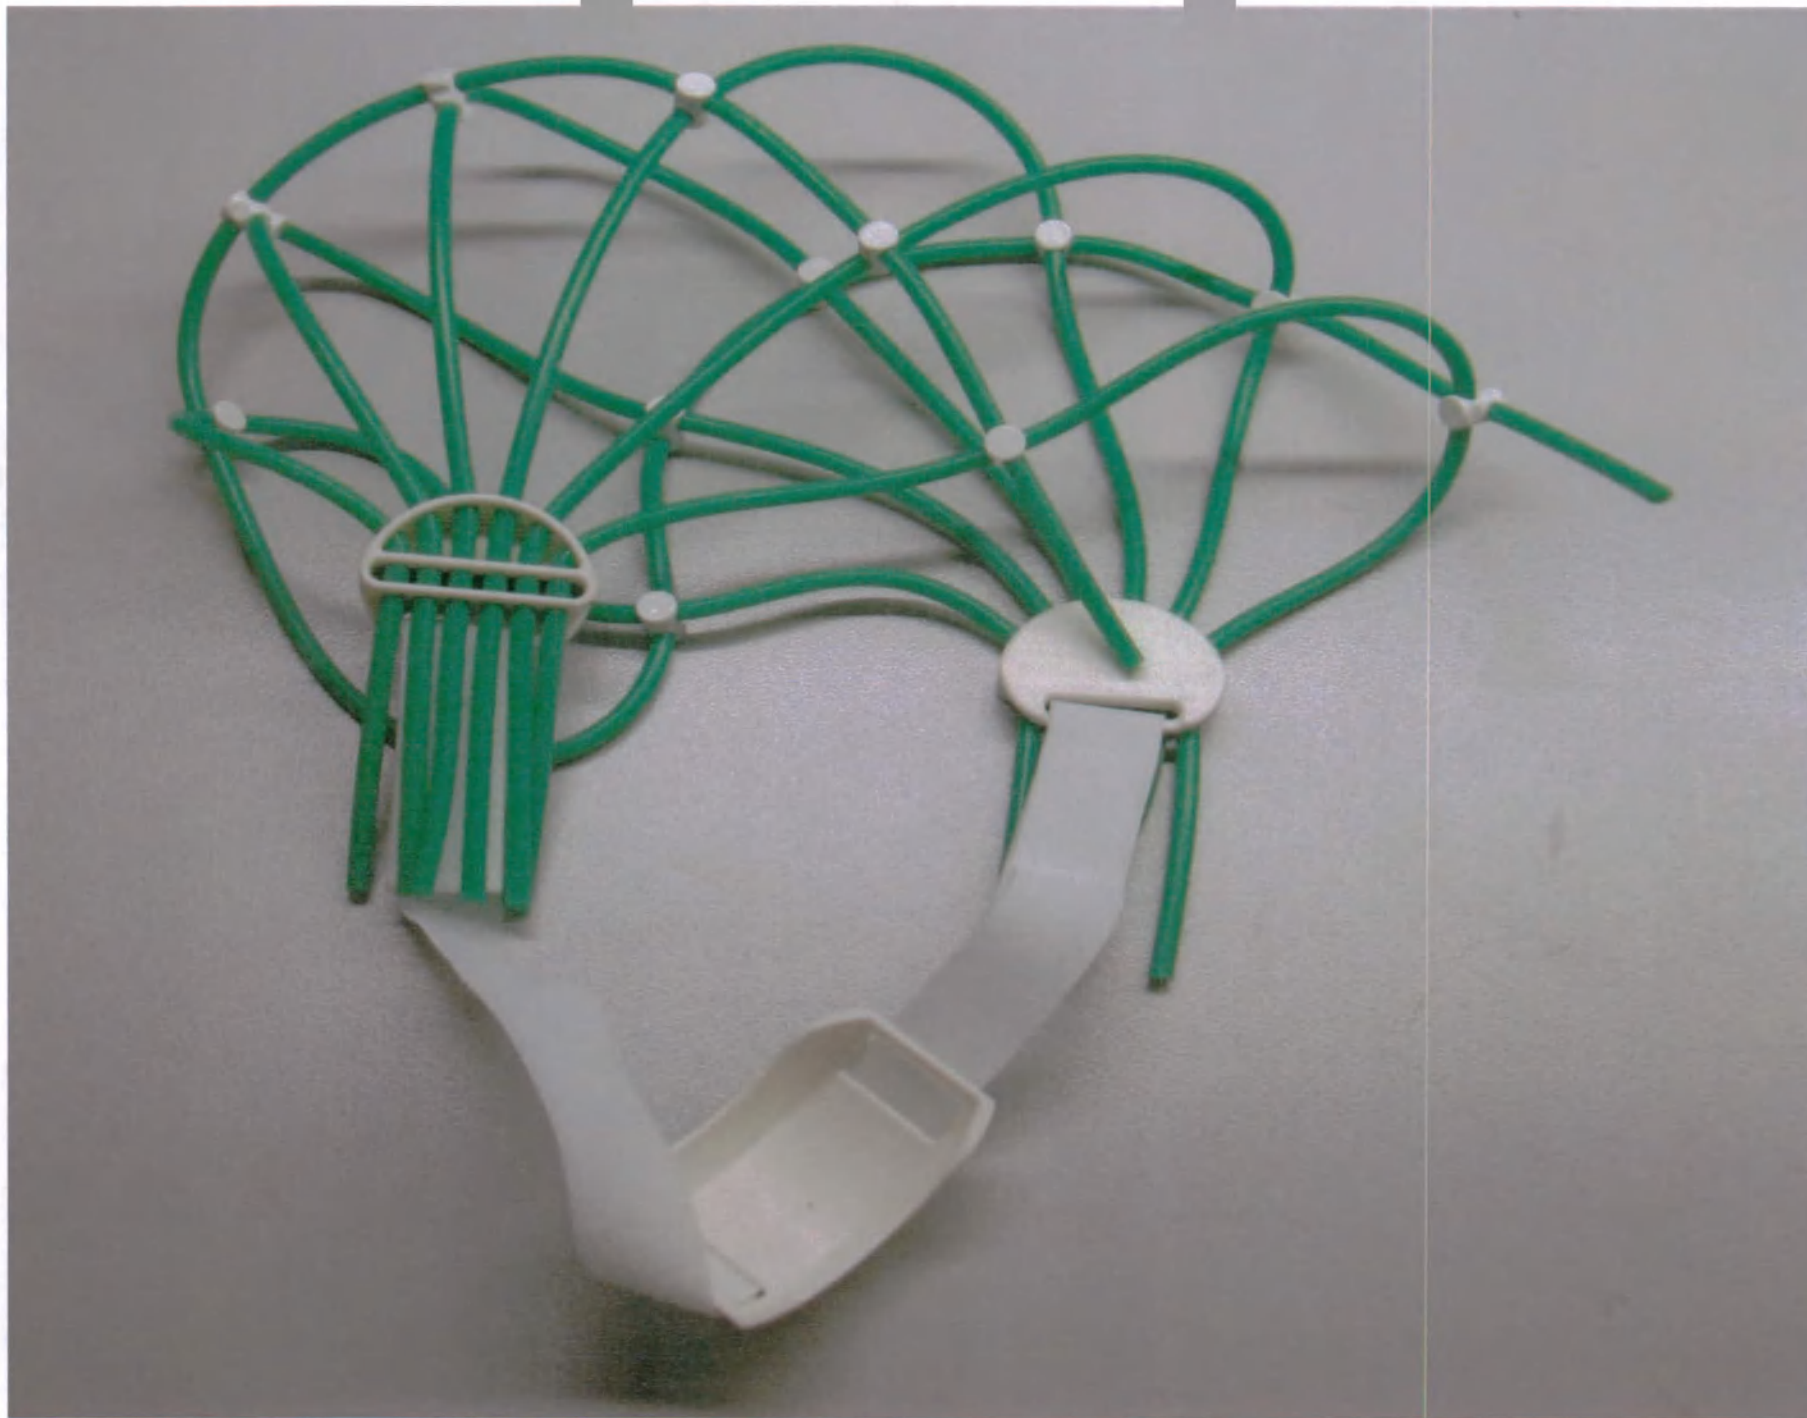

Шлем для крепления электродов ЭЭГ (48-54)

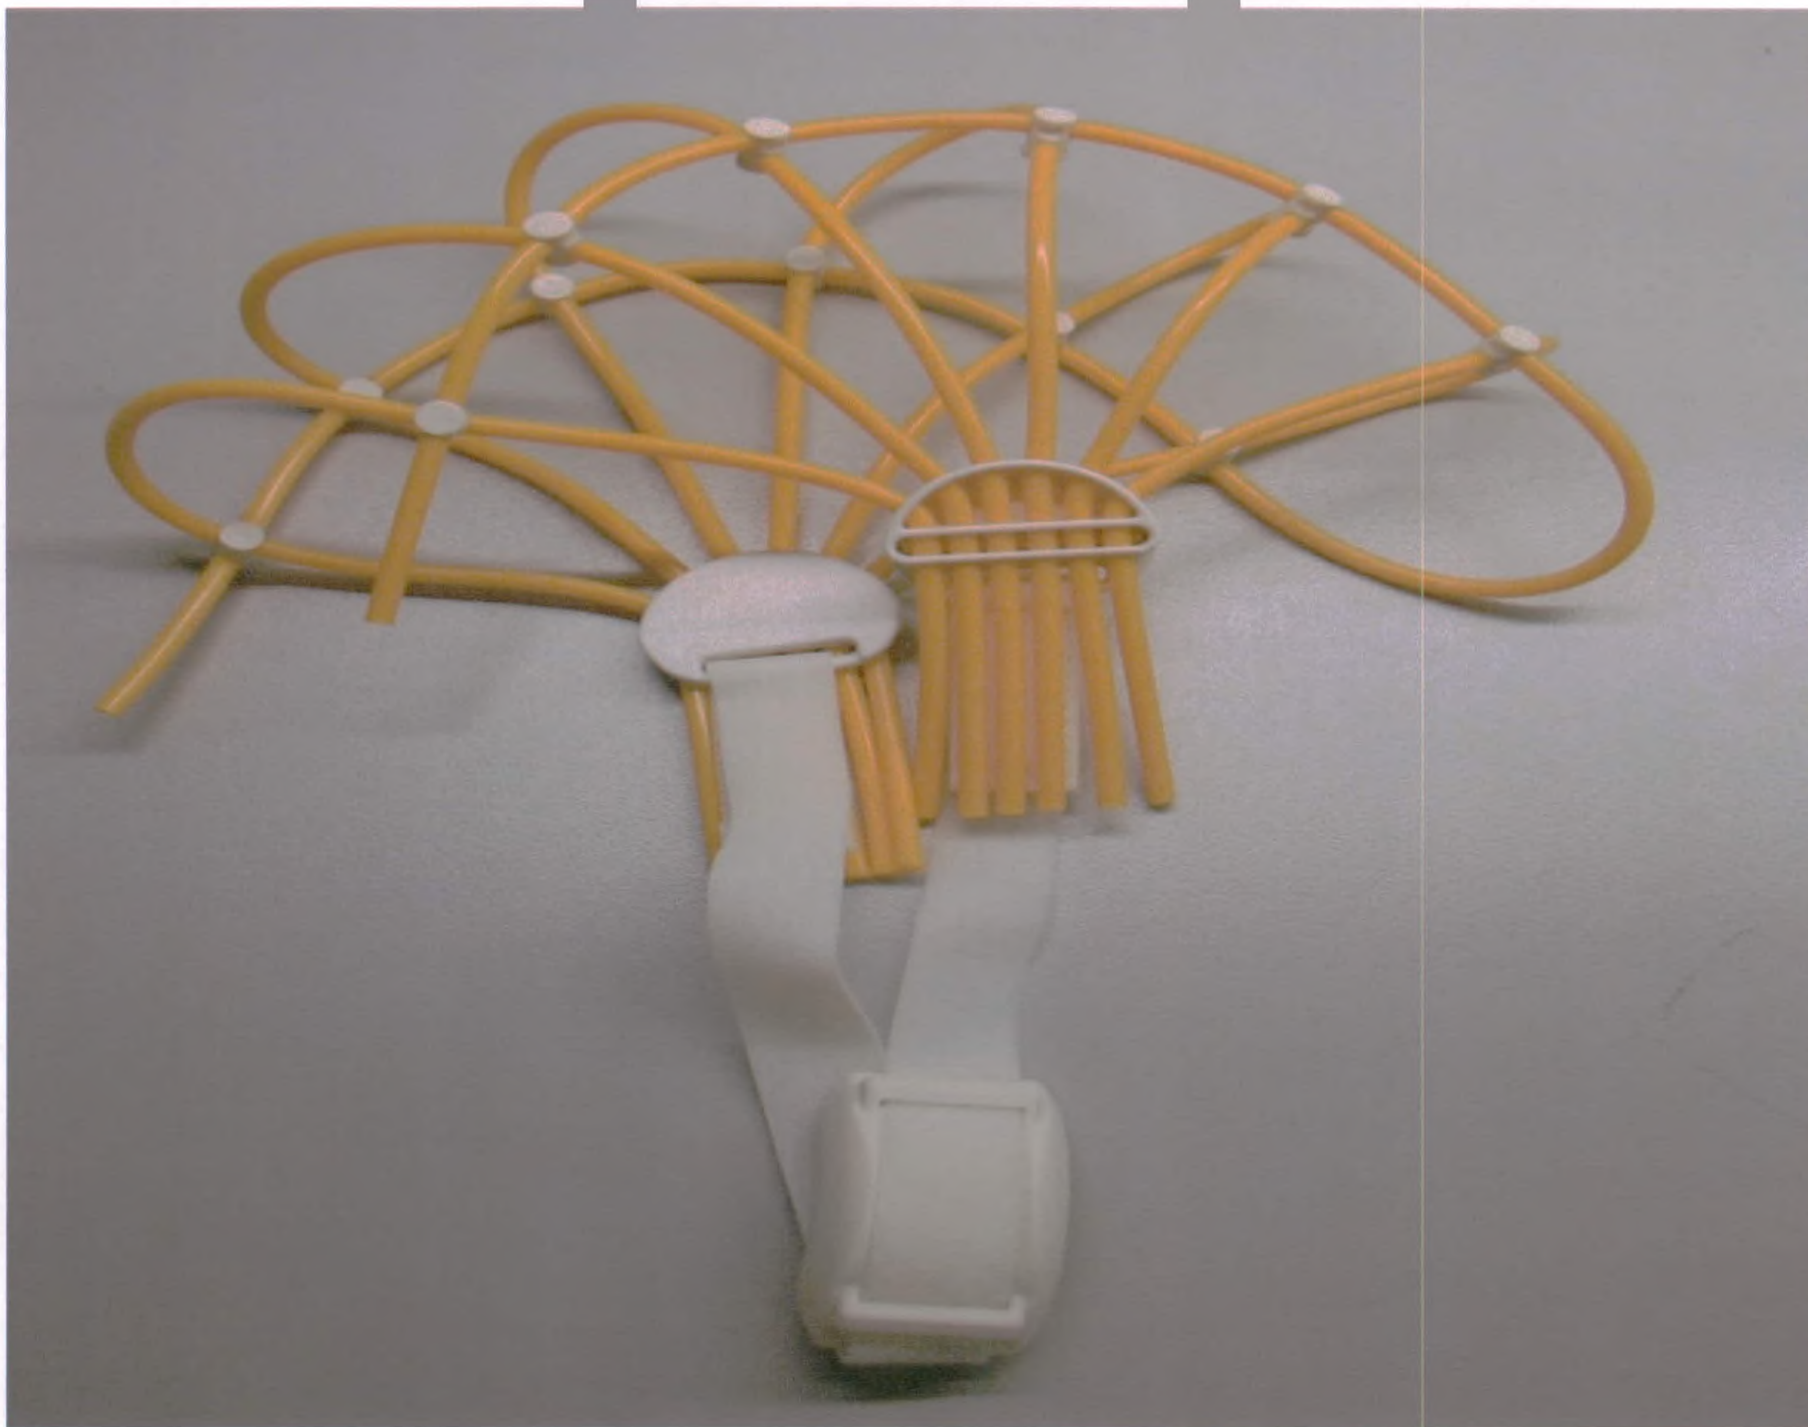

Шлем для крепления электродов ЭЭГ (42-48)



Шлем для крепления электродов ЭЭГ (34-42)



Электрод ЭЭГ чашечковый с кабелем отведения «ЭВП



Электрод ЭЭГ чашечковый с кабелем отведения «С1234»



Электрод ЭЭГ ушной




Электрод одноразовый подкожный монополярный игольчатый с кабелем отведения «S50716»



Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул: MN4013D10SRU, Spes Medica («Спес Медика»), Италия, РУ № РЗН 2022/18886



Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул: MN4013D10BRU, Spes Medica («Спес Медика»), Италия, РУ № РЗН 2022/18886

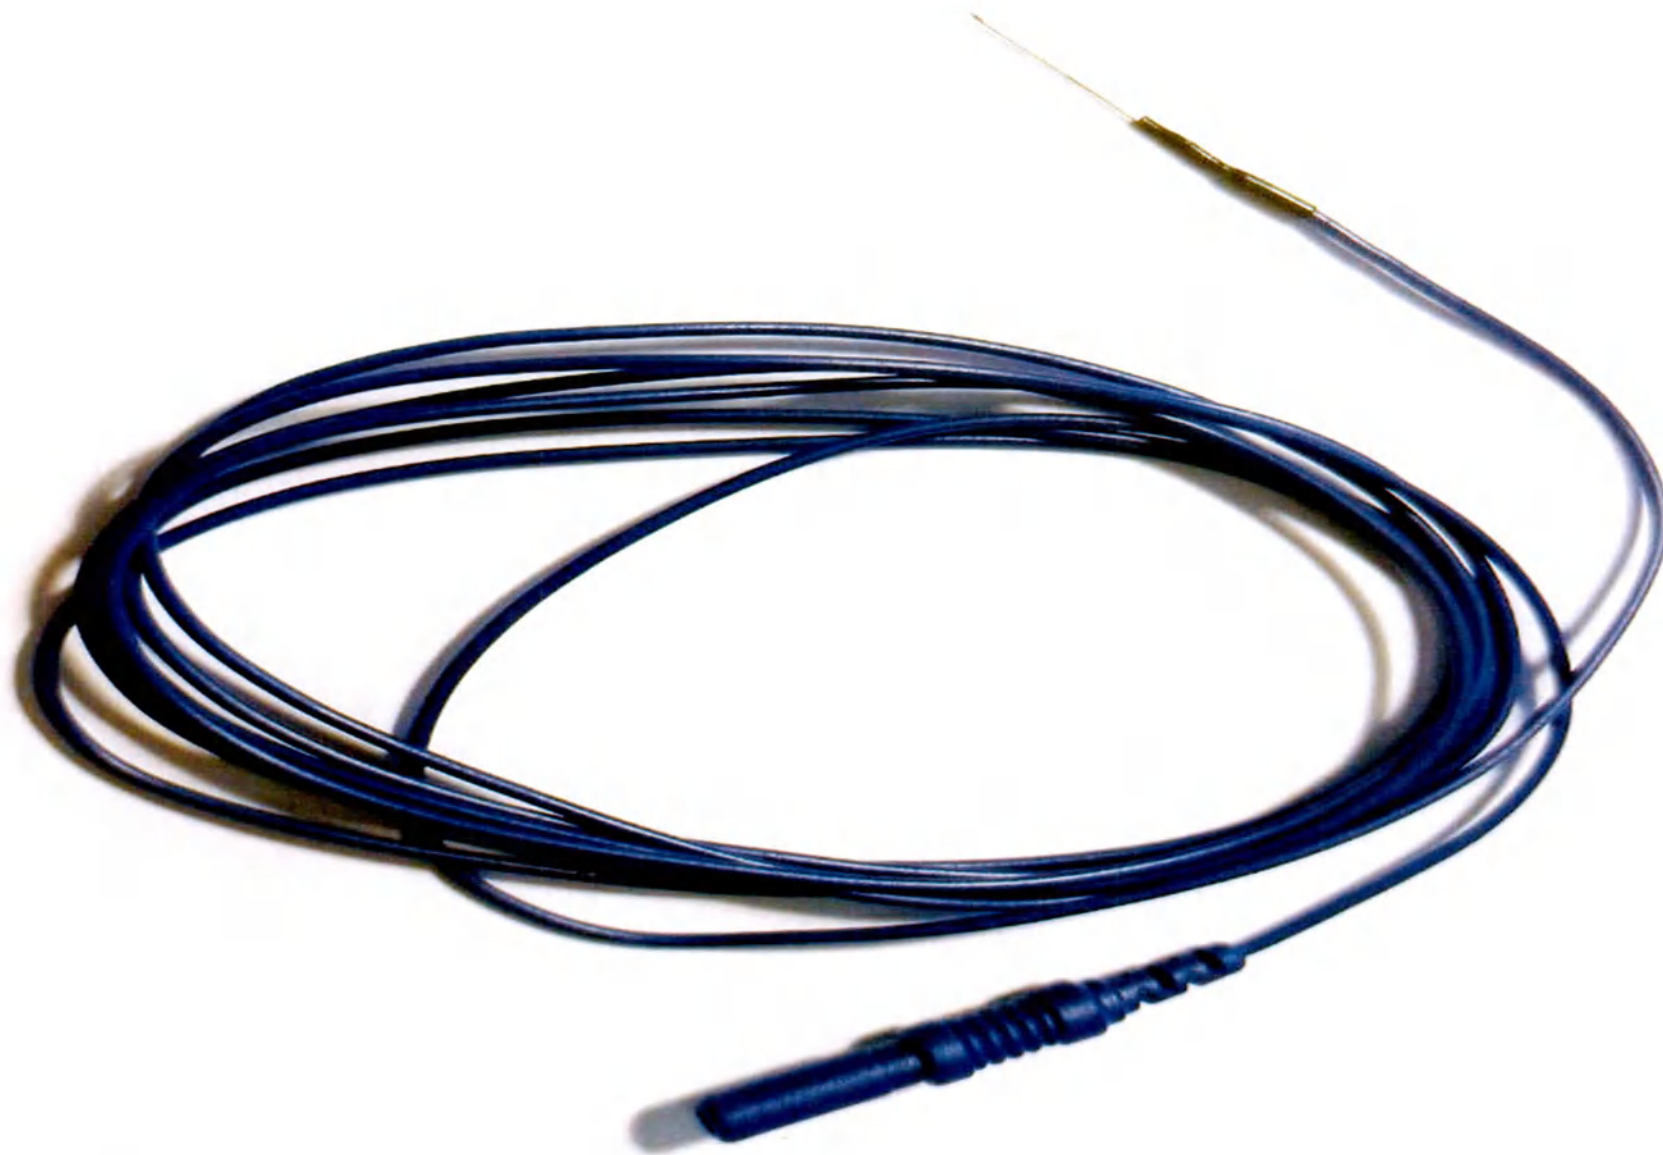

Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул: MN4013D15SRU,
Spes Medica («Спес Медика»), Италия, РУ № РЗН 2022/18886



Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул: MN4013D15BRU, Spes Medica («Спес Медика»), Италия, РУ № РЗН 2022/18886



Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 200 см, артикул: MN4013D20SRU, Spes Medica («Спес Медика»), Италия, РУ № РЗН 2022/18886




Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 250 см, артикул: MN4013D25SRU, Spes Medica («Спес Медика»), Италия, РУ № РЗН 2022/18886



Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 13 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 250 см, артикул: MN4013D25BRU, Spes Medica («Спес Медика»), Италия, РУ № РЗН 2022/18886



Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 100 см, артикул: MN4018D10SRU, Spes Medica («Спес Медика»), Италия, РУ № РЗН 2022/18886

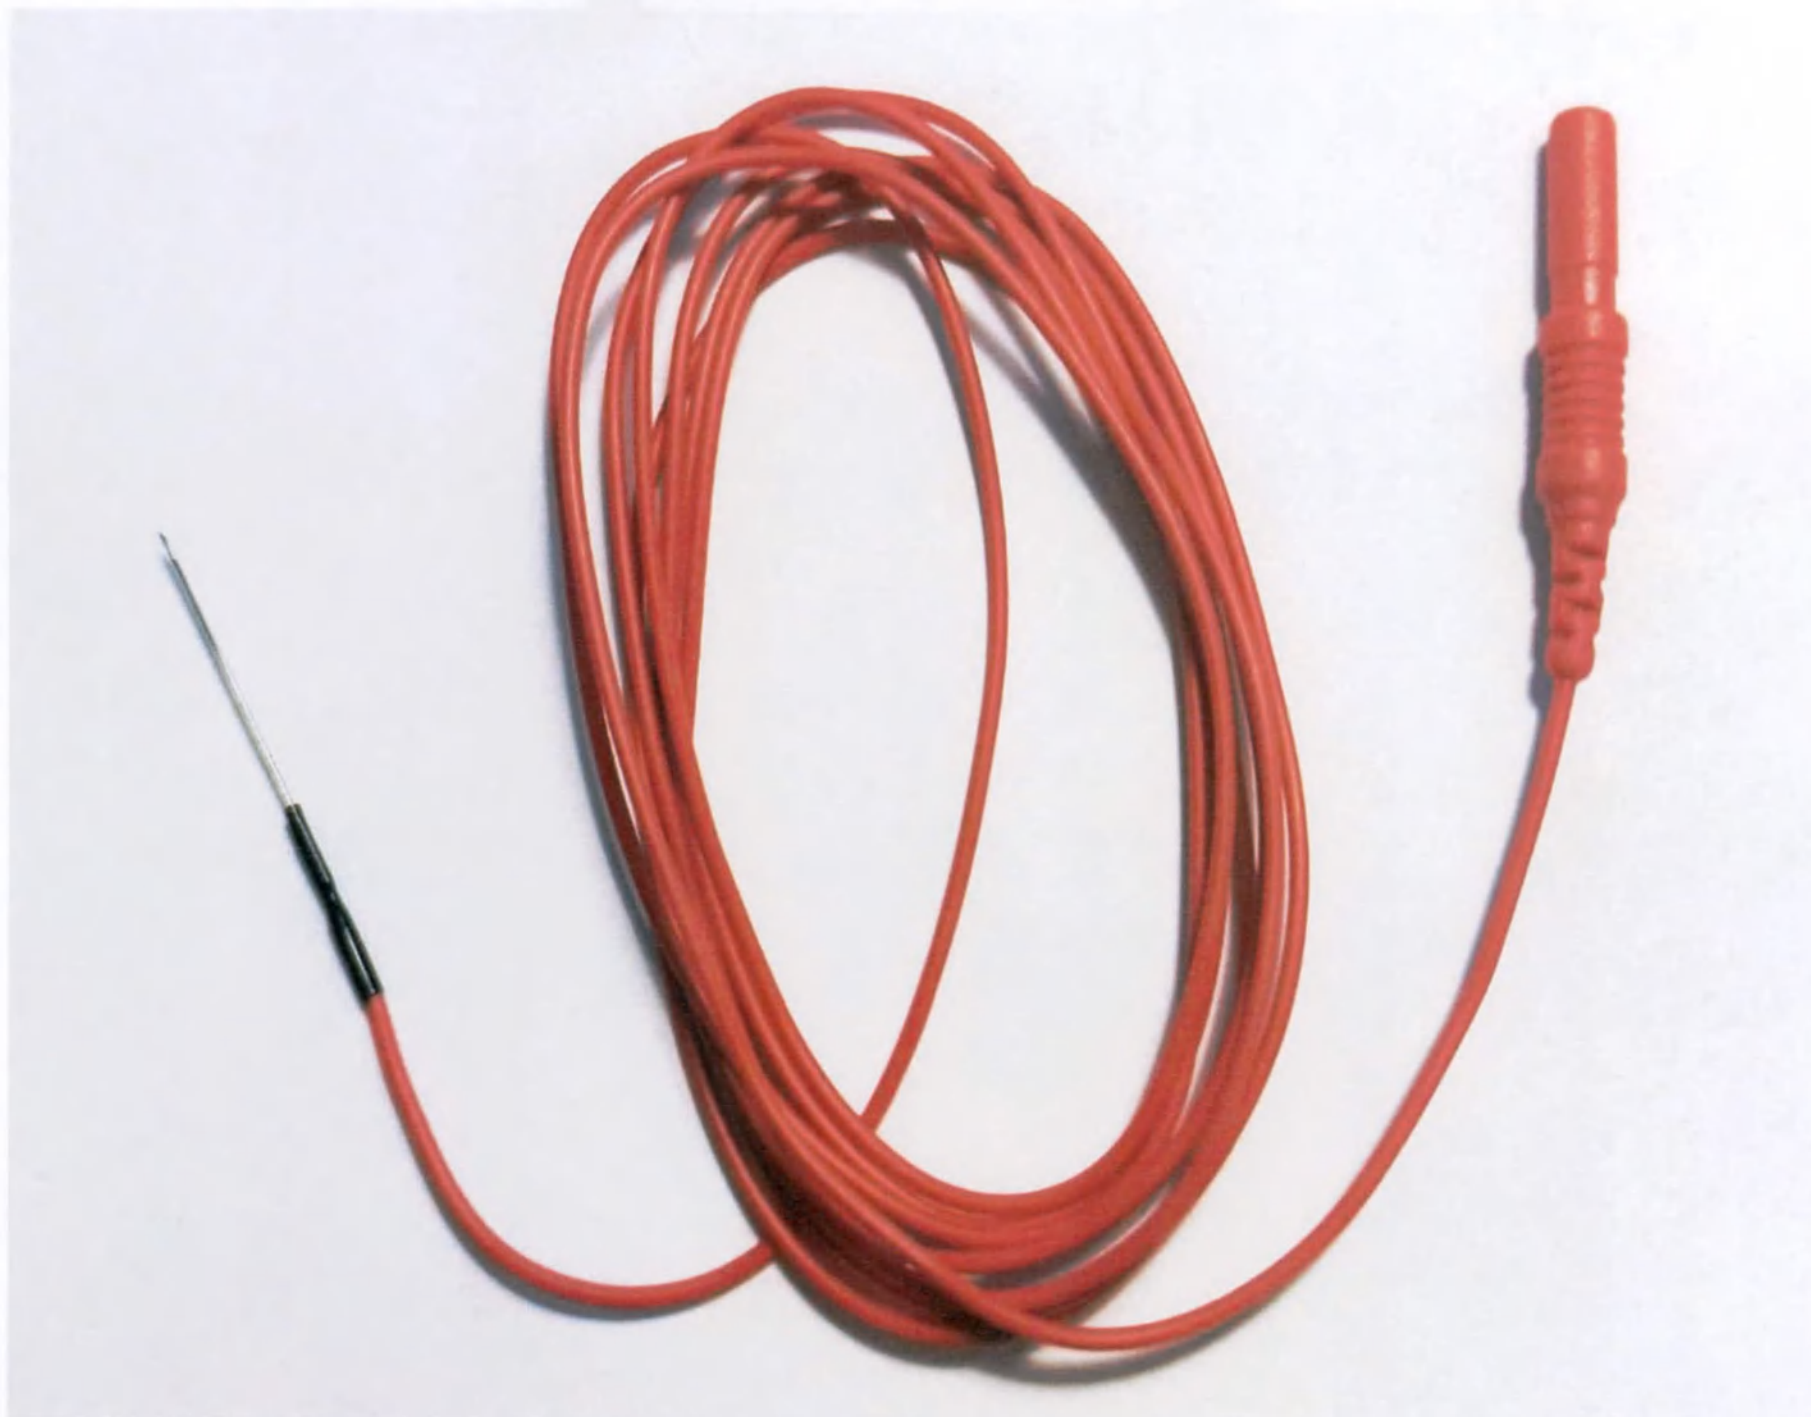

Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул: MN4018D15SRU, Spes Medica («Спес Медика»), Италия, РУ № РЗН 2022/18886




Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 18 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 250 см, артикул: MN4018D25SRU, Spes Medica («Спес Медика»), Италия, РУ № РЗН 2022/18886




Электрод игольчатый подкожный с длиной иглы 22 мм, диаметром иглы 0.40 мм, с кабелем длиной 150 см, артикул: MN4022D15SRU, Spes Medica («Спес Медика»), Италия, РУ № РЗН 2022/18886




Шапочка Electro-CAP для снятия электроэнцефалограммы (для 19-канальной регистрации), размер 46-50 (XSM)
(Electro-Cap International, Inc., США)

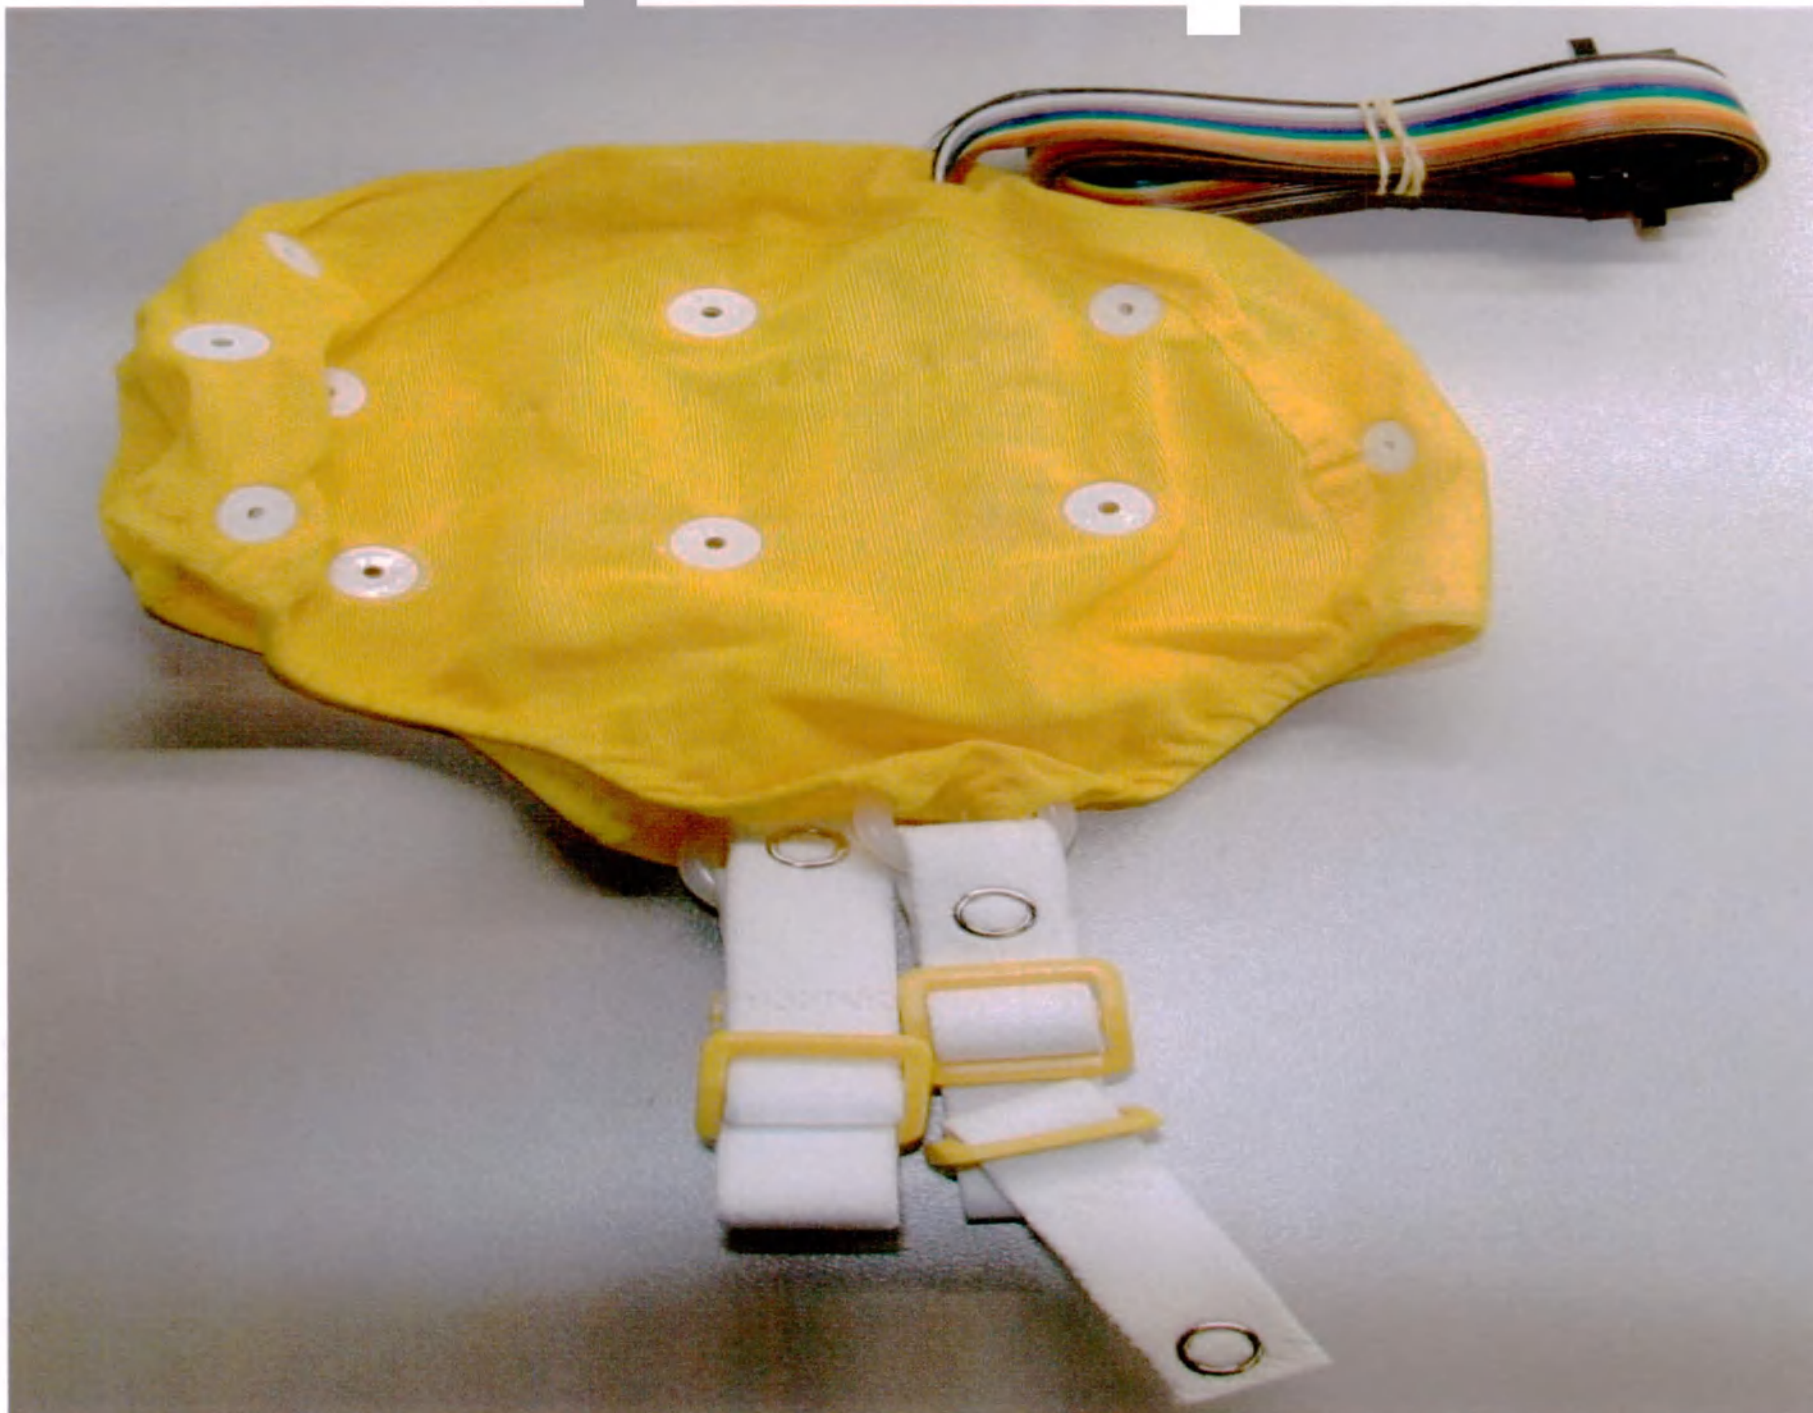

Шапочка Electro-CAP для снятия электроэнцефалограммы (для 19-канальной регистрации), размер 50-54 (SM)
(Electro-Cap International, Inc., США)

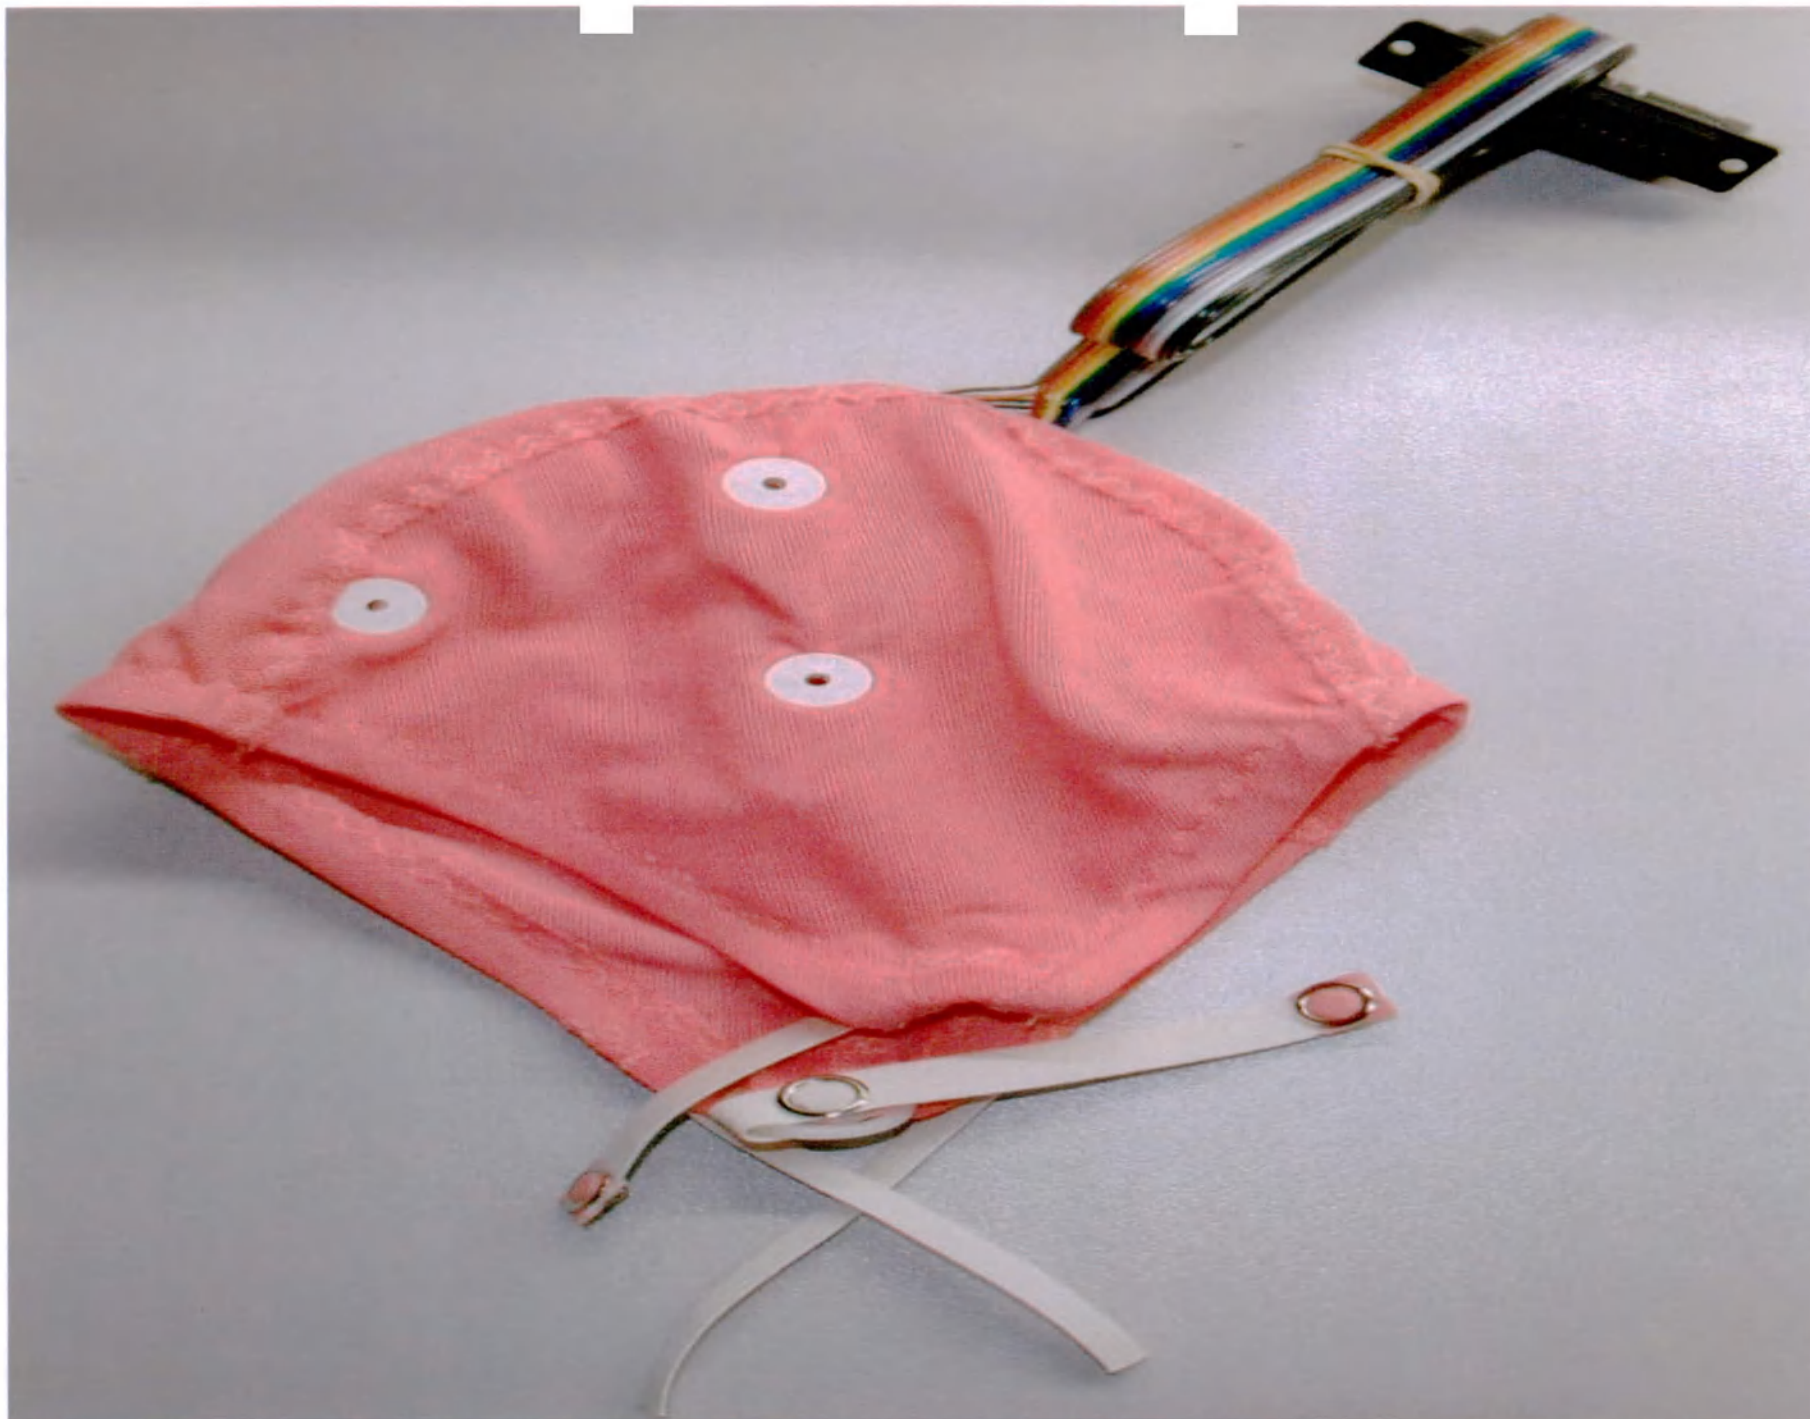

Шапочка Electro-CAP для снятия электроэнцефалограммы (для 19-канальной регистрации), размер 38-42 (детский)
(Electro-Cap International, Inc., США)

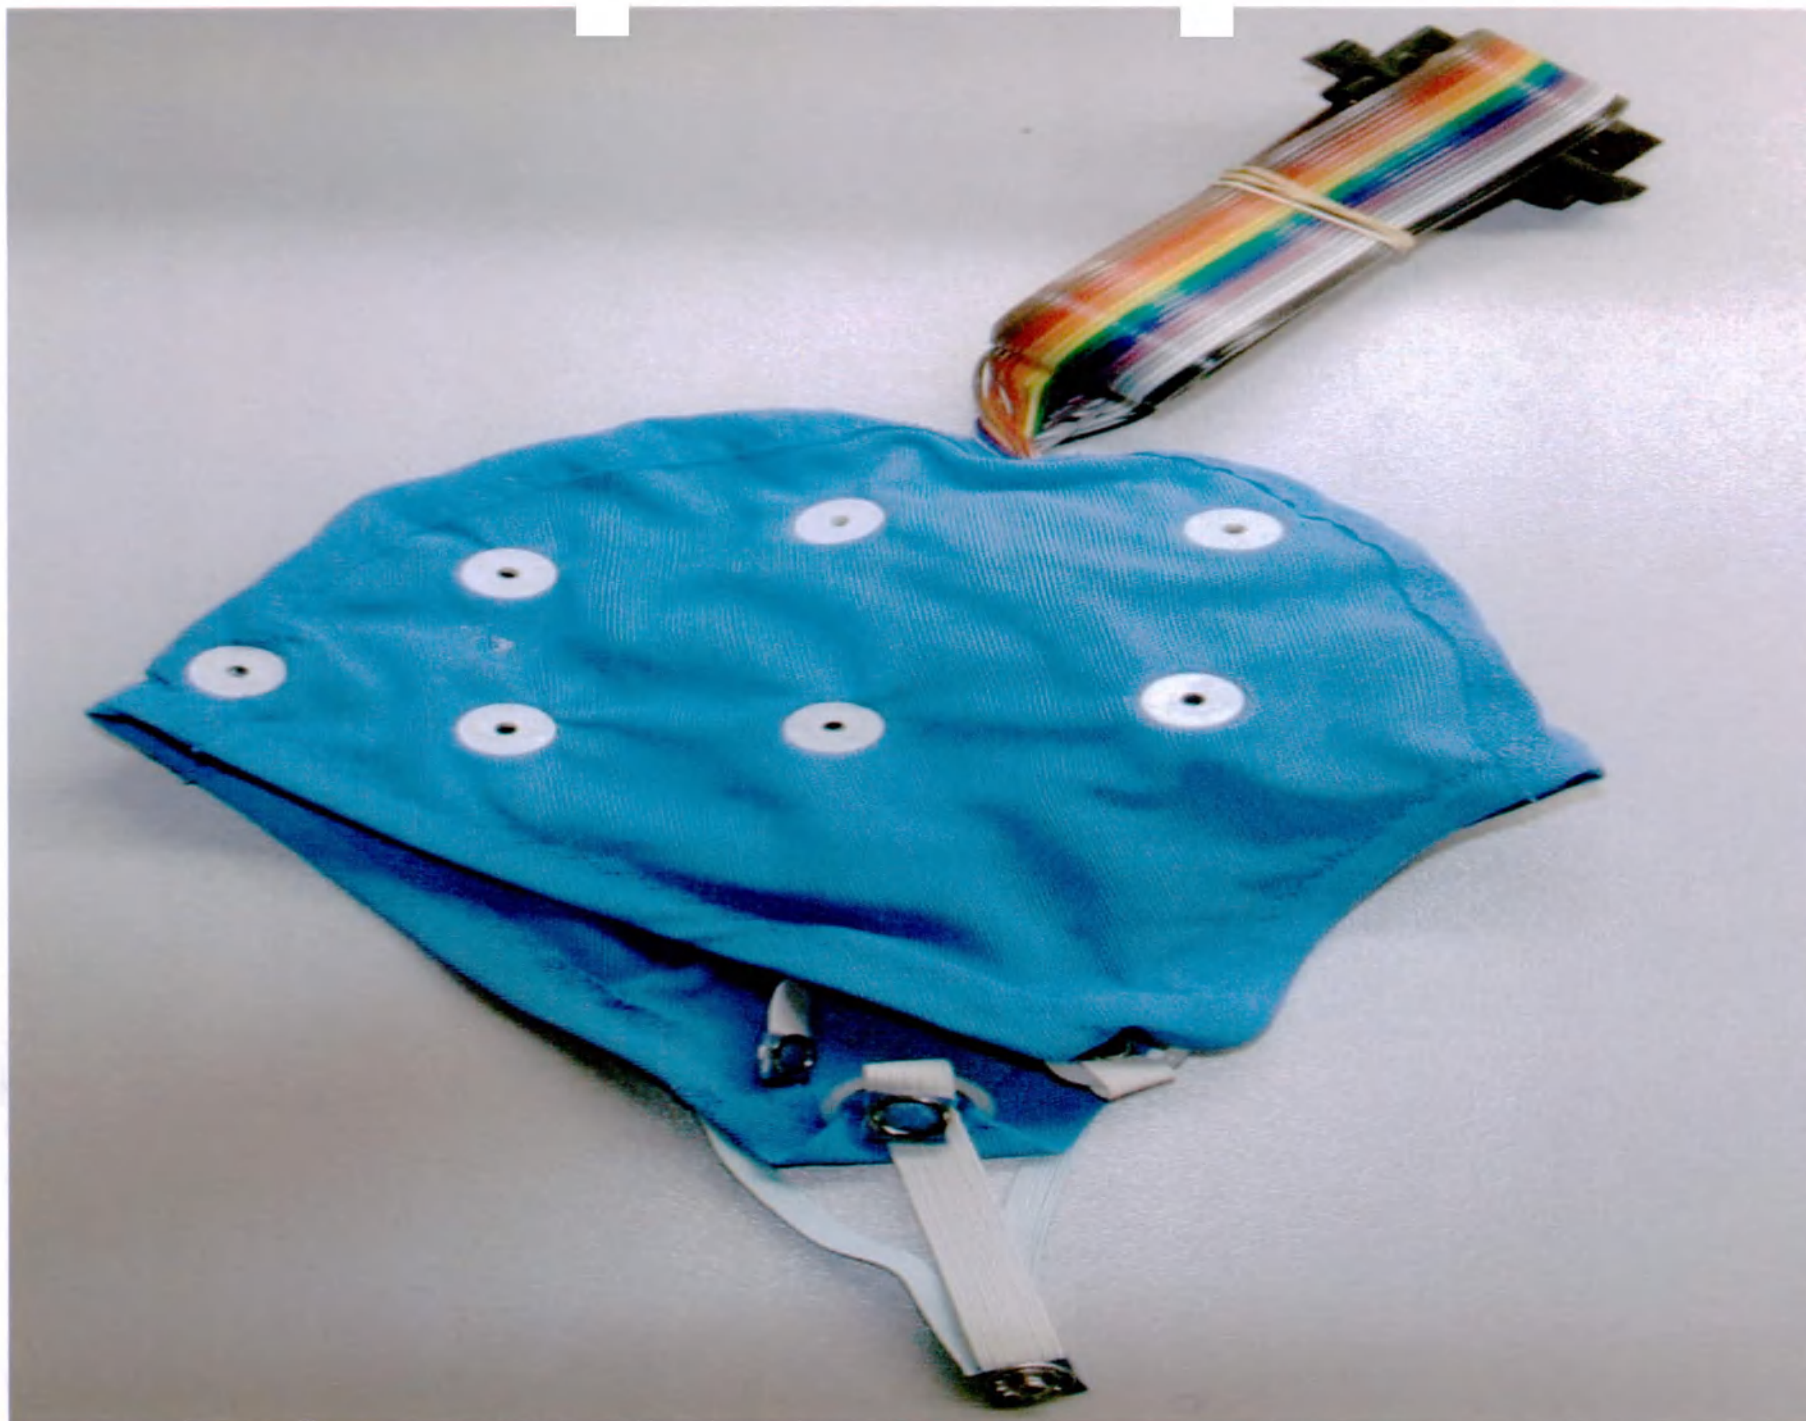

Шапочка Electro-CAP для снятия электроэнцефалограммы (для 19-канальной регистрации), размер 42-46 (детский)
(Electro-Cap International, Inc., США)



Шапочка Electro-CAP для снятия электроэнцефалограммы (для 19-канальной регистрации), размер 54-58 (М)
(Electro-Cap International, Inc., США)



Шапочка Electro-CAP для снятия электроэнцефалограммы (для 19-канальной регистрации), размер 58-62 (L)
(Electro-Cap International, Inc., США)




Шапочка Electro-CAP для снятия электроэнцефалограммы (для 19-канальной регистрации), размер 34-88 (детский)
(Electro-Cap International, Inc., США)



Ремешок-крепление для электродной шапочки (Electro-Cap International, Inc., США)



Удлинитель кабеля шапочки ЭЭГ

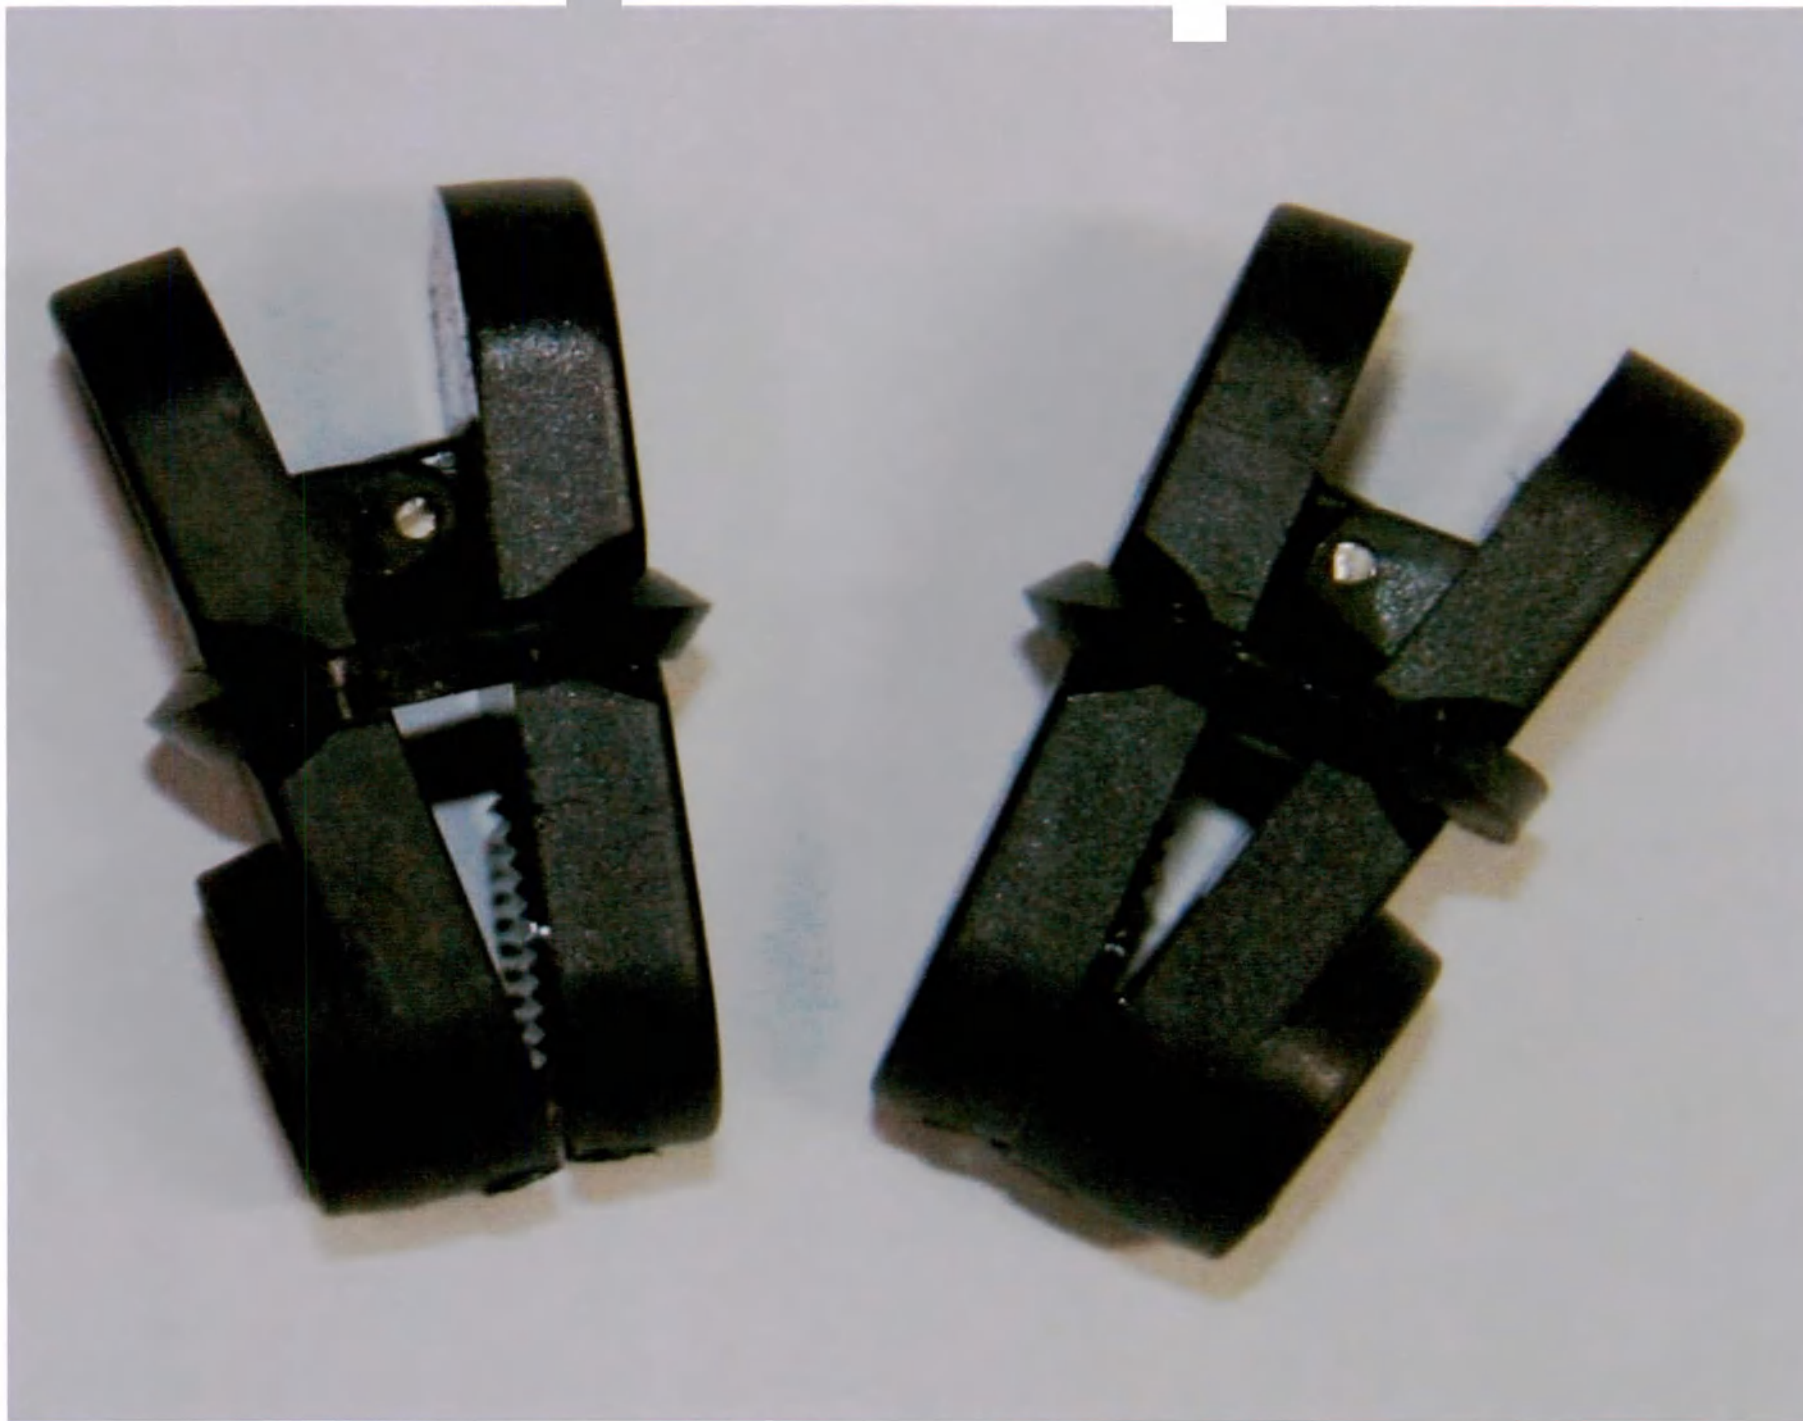

Пара ушных электродов для электродной шапочки (Electro-Cap International, Inc., США)



Специальная игла для заполнения электродов гелем (Electro-Cap International, Inc., США)




Кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ белый, 1 м



Кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ красный, 1 м



Кабель отведения для мостикового и ушного электрода ЭЭГ черный, 1 м

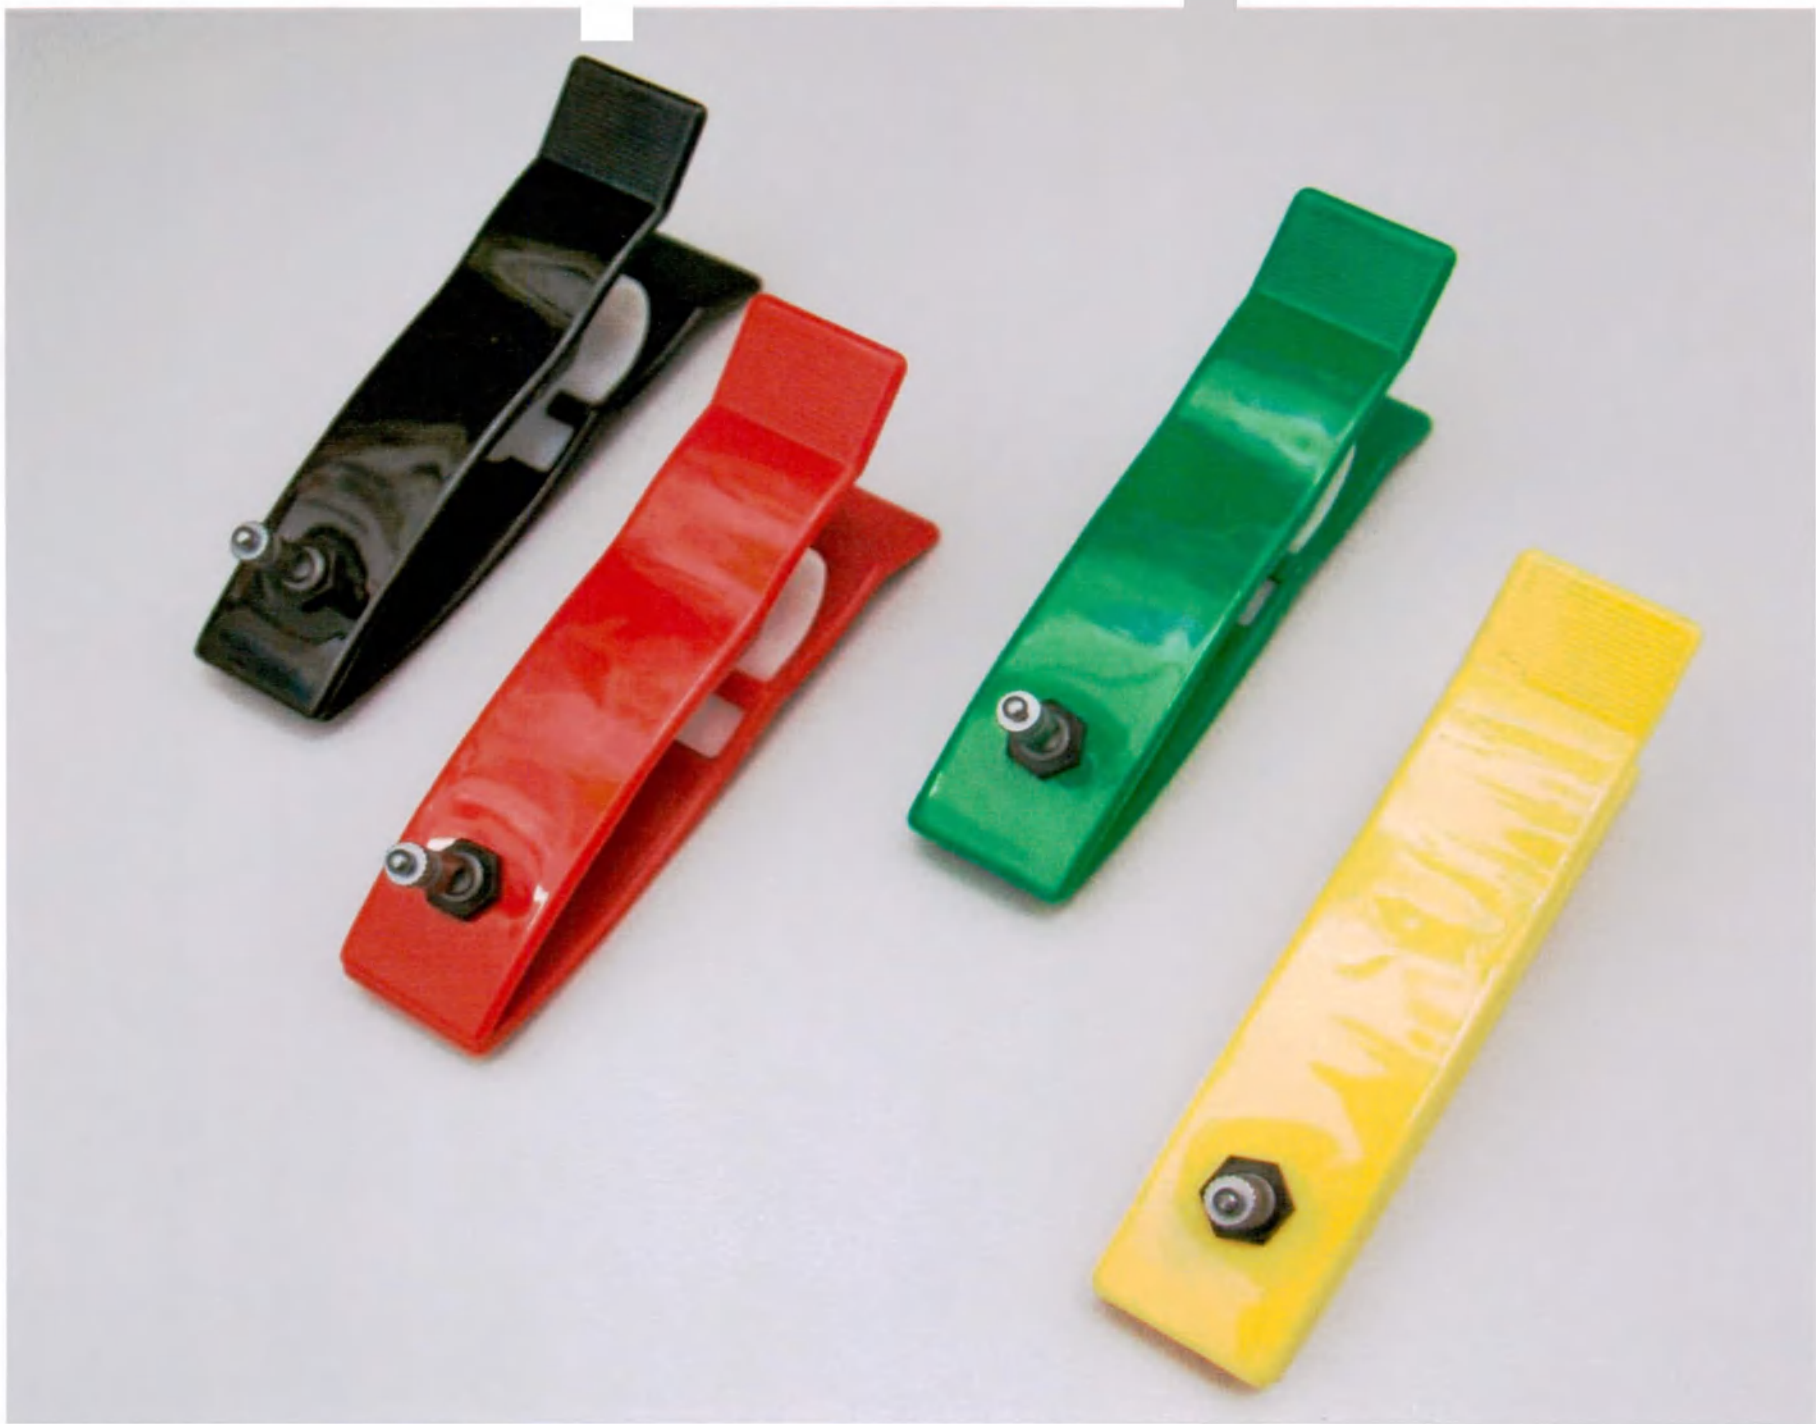

Электрод ЭКГ прижимной многоцветный на конечность, тип «прищепка»




Кабель отведения для одного канала ЭКГ (комплект 3 шт.)



Гарнитура компьютерная, диапазон частот 100-10000 Гц



Светодиодный фотостимулятор «ФС-2»,
в составе: блок фотостимулятора светодиодного, стойка напольная СН-7

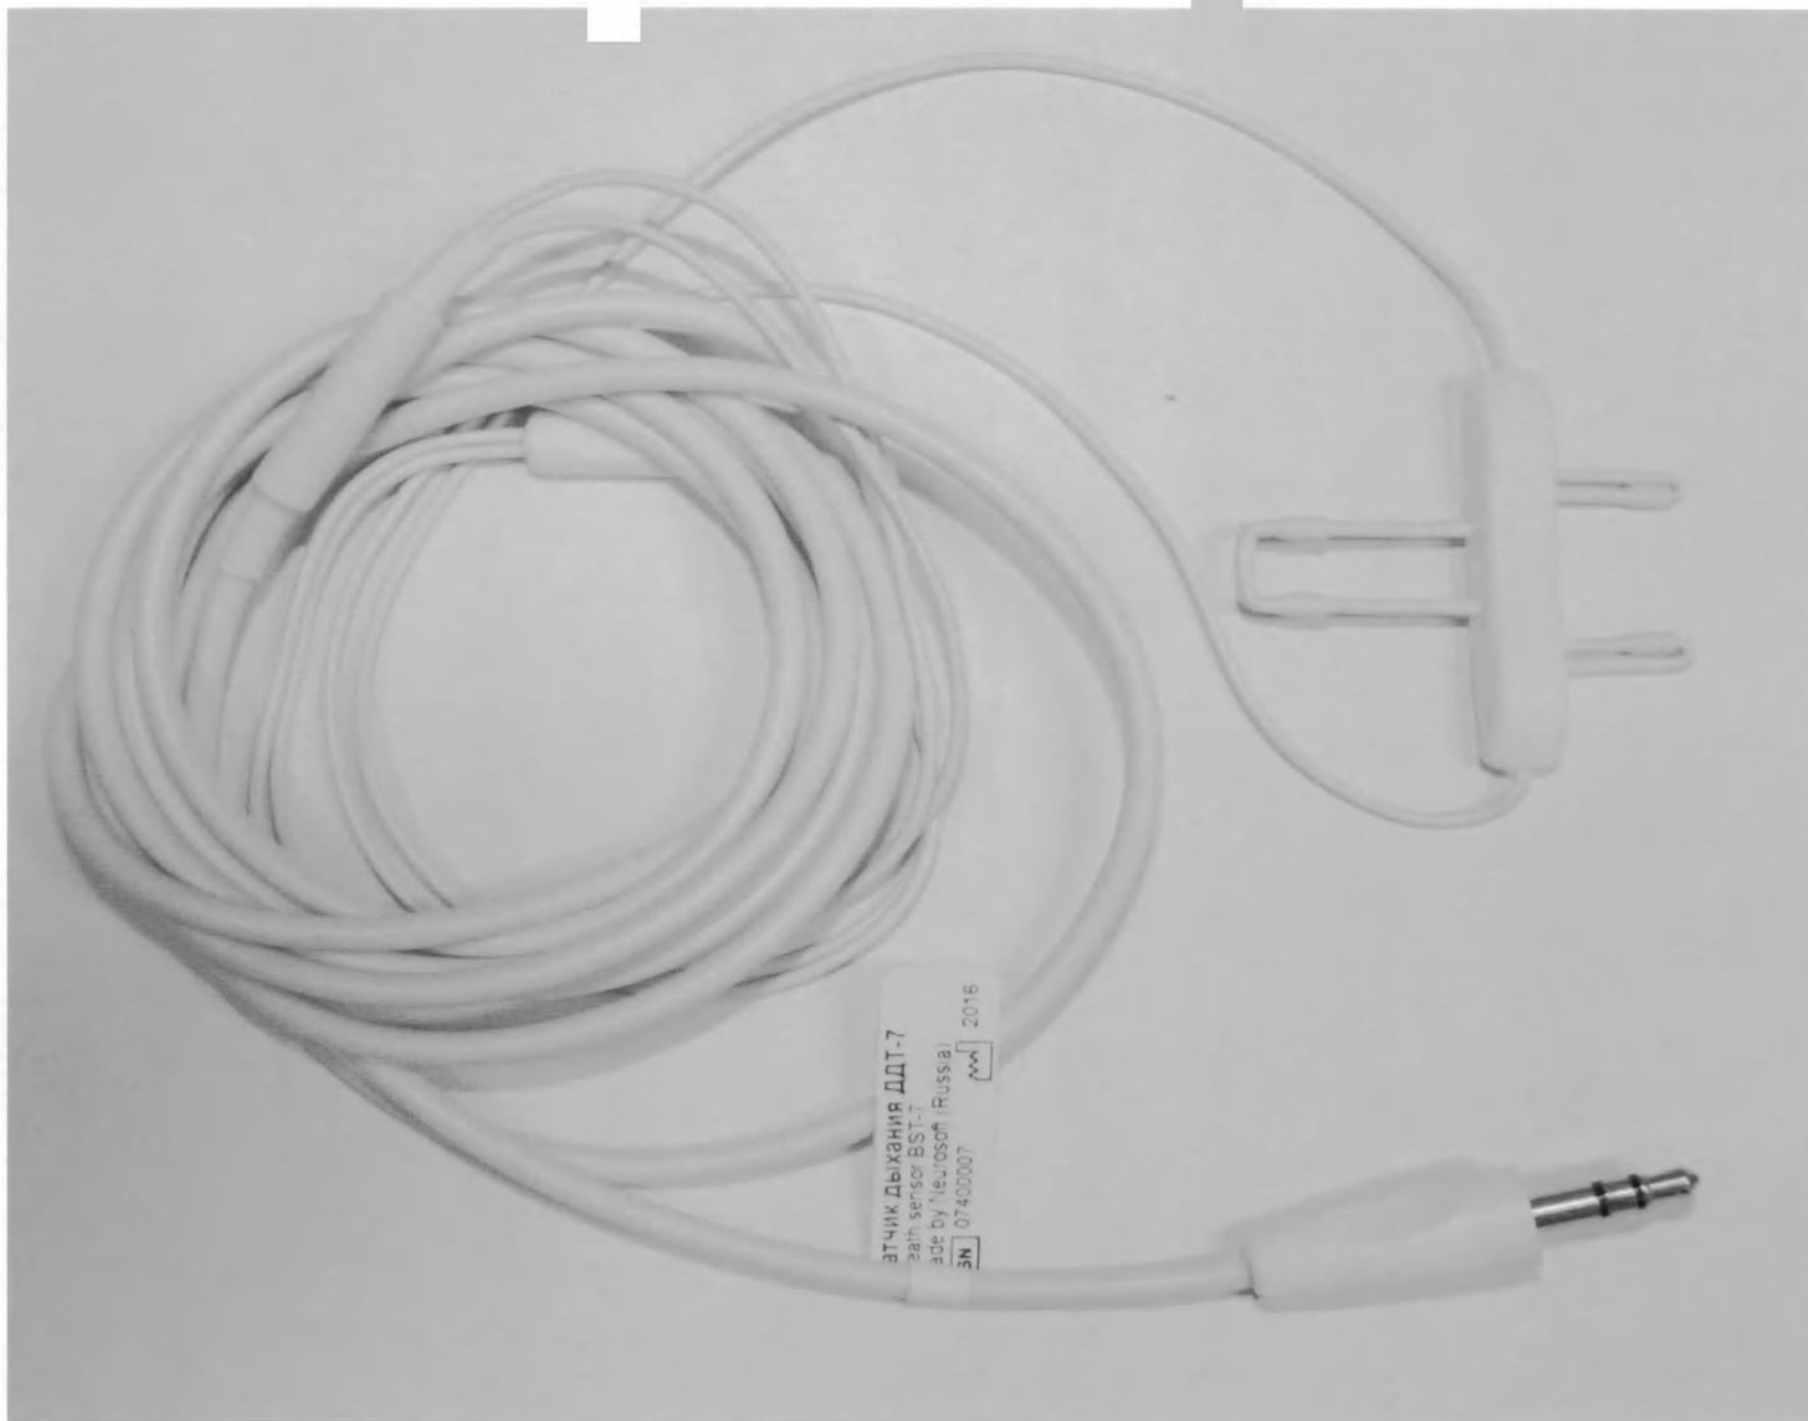


Датчик дыхания «ДДТ-7/В-20»



Датчик дыхания «ДДТ-7/Д-20»



Концентратор USB-LAN «KM-52E»

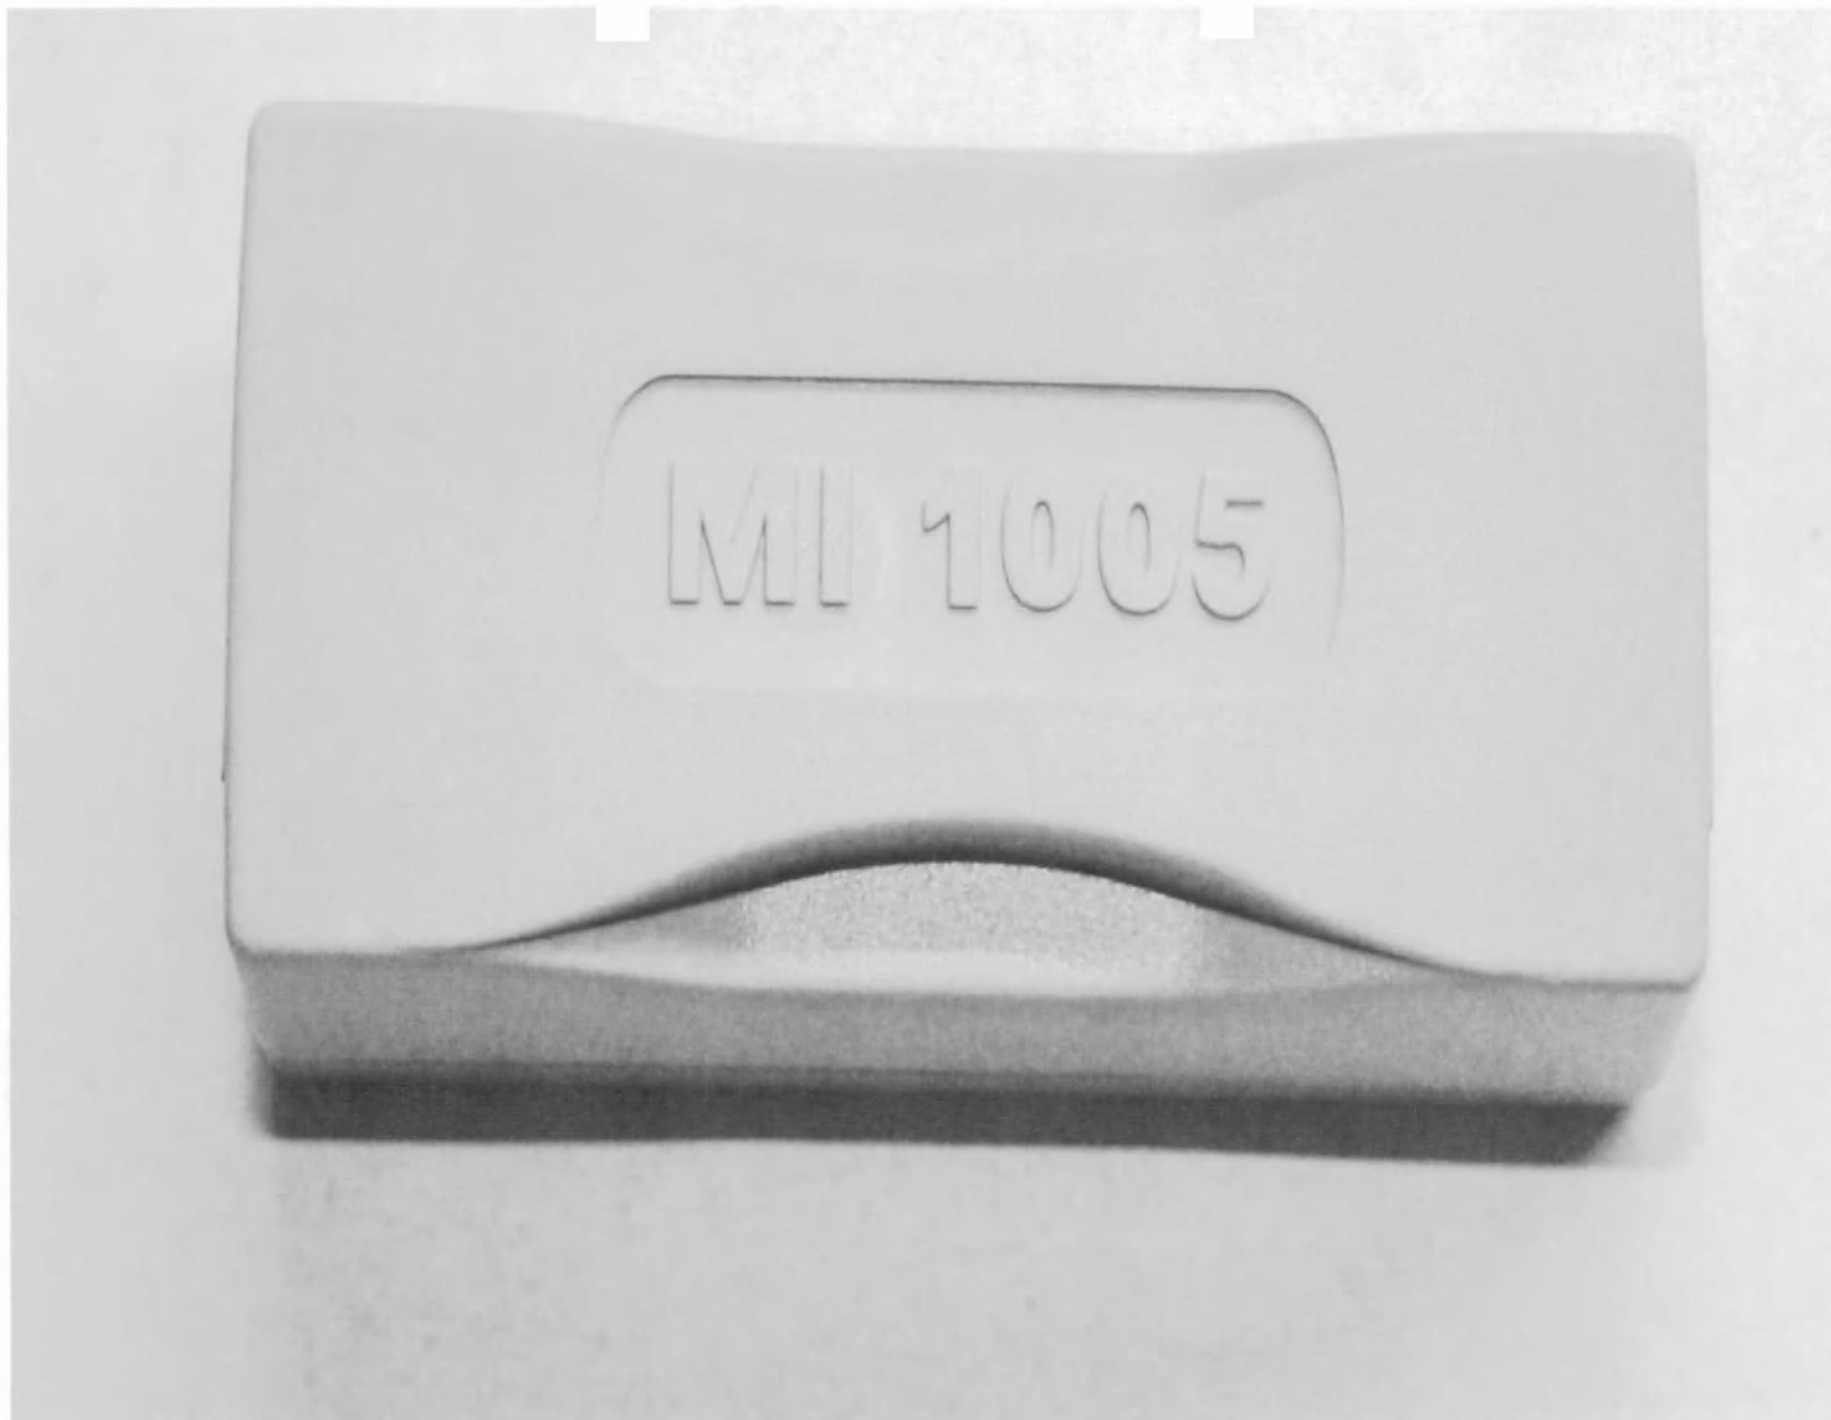

Преобразователь сетевого интерфейса, LAN-LAN, развязка 4 кВ




Датчик храпа «ДХ-1»




Датчик индукционный экскурсии грудной клетки и брюшной стенки "ДДИ-1-22",

в составе: блок электронный "ДДИ-1-22", лента фиксирующая, фиксатор, индукционный ремень

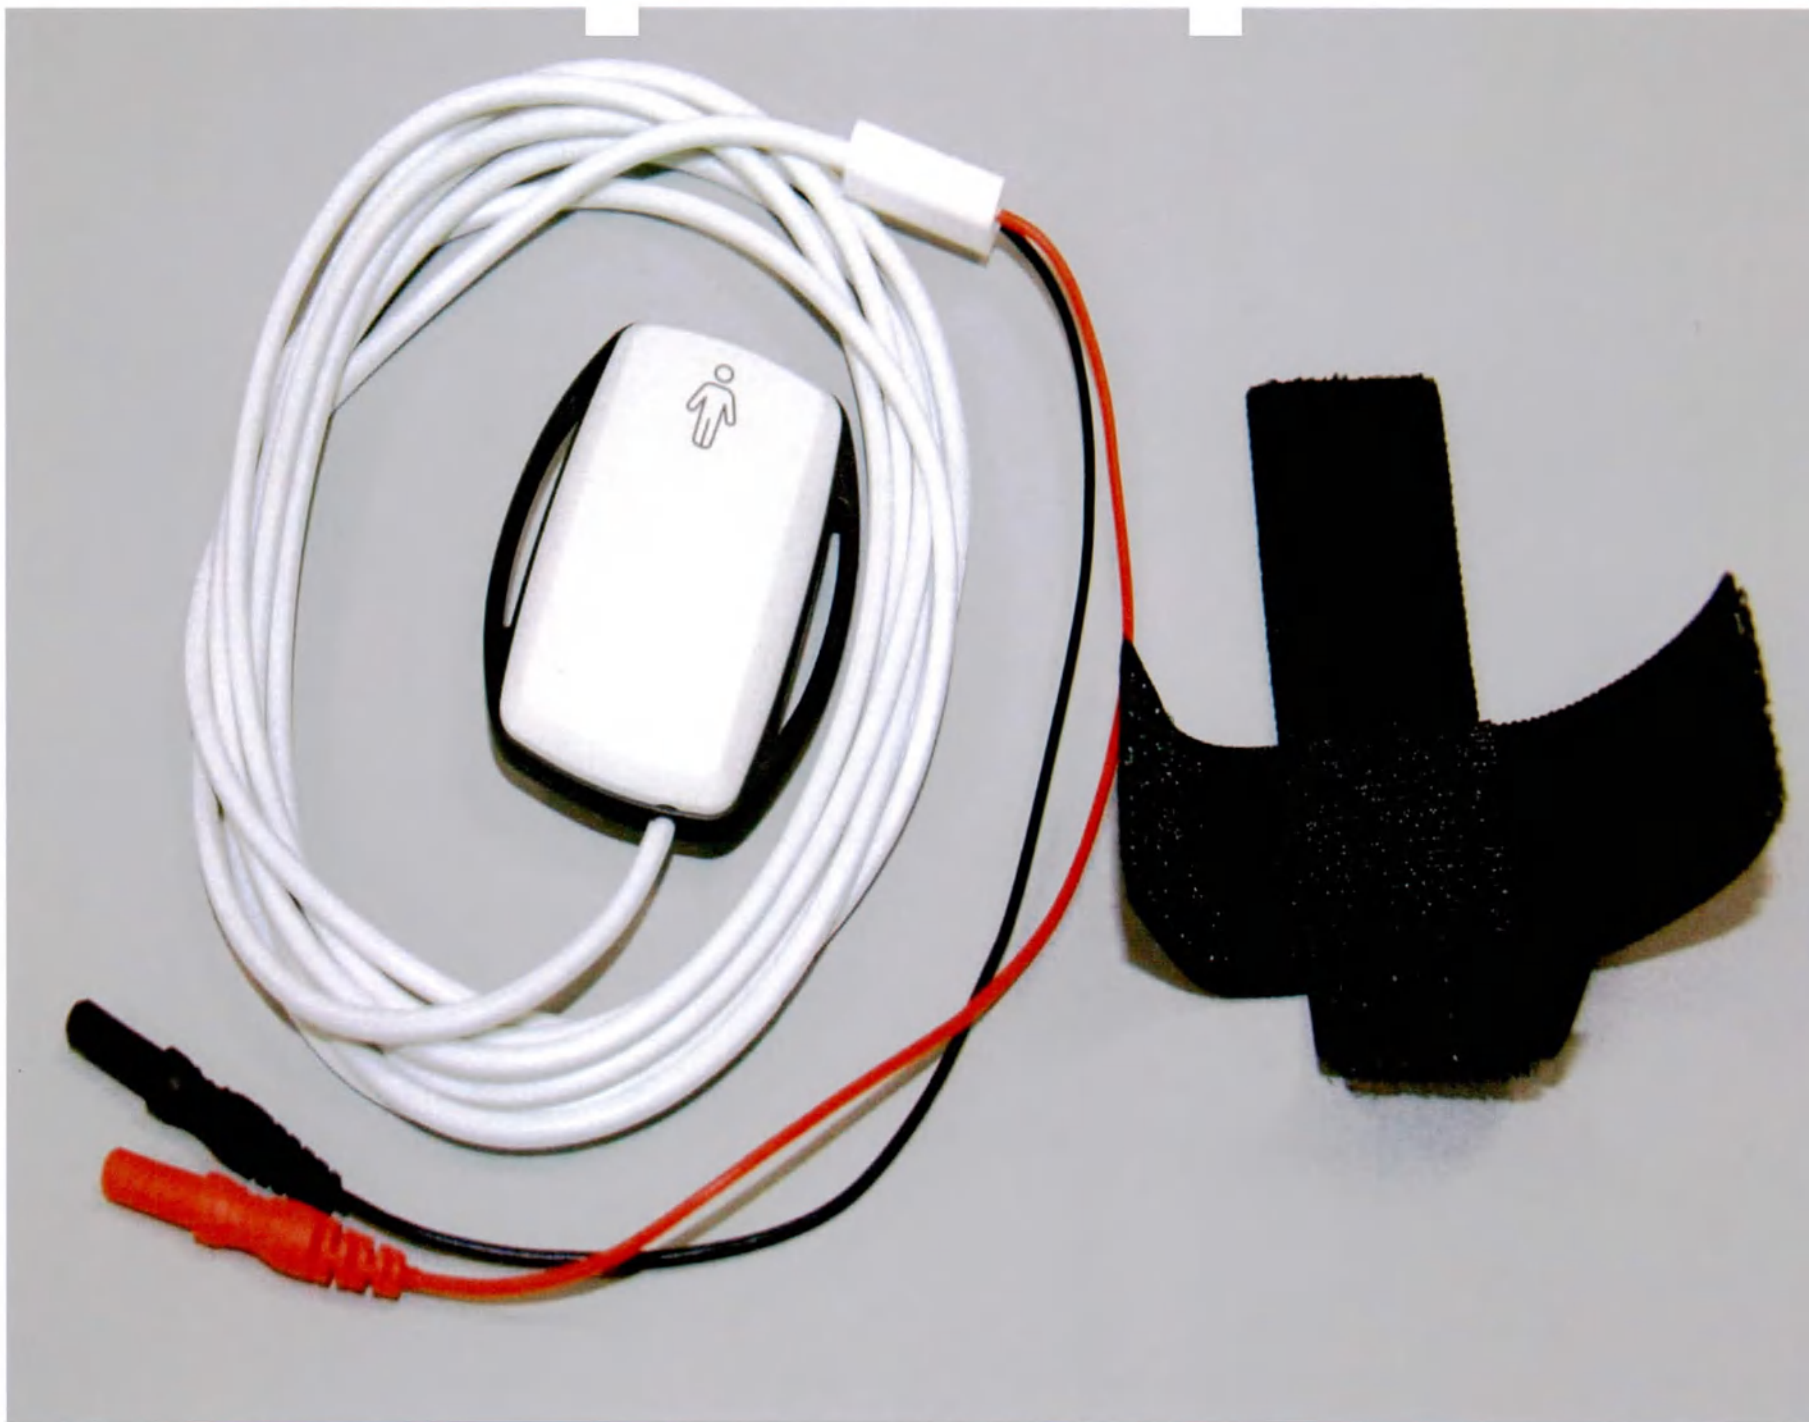

Датчик положения тела «ДПТ-2-22»,
в составе: блок электронный «ДПТ-2-22», крепление

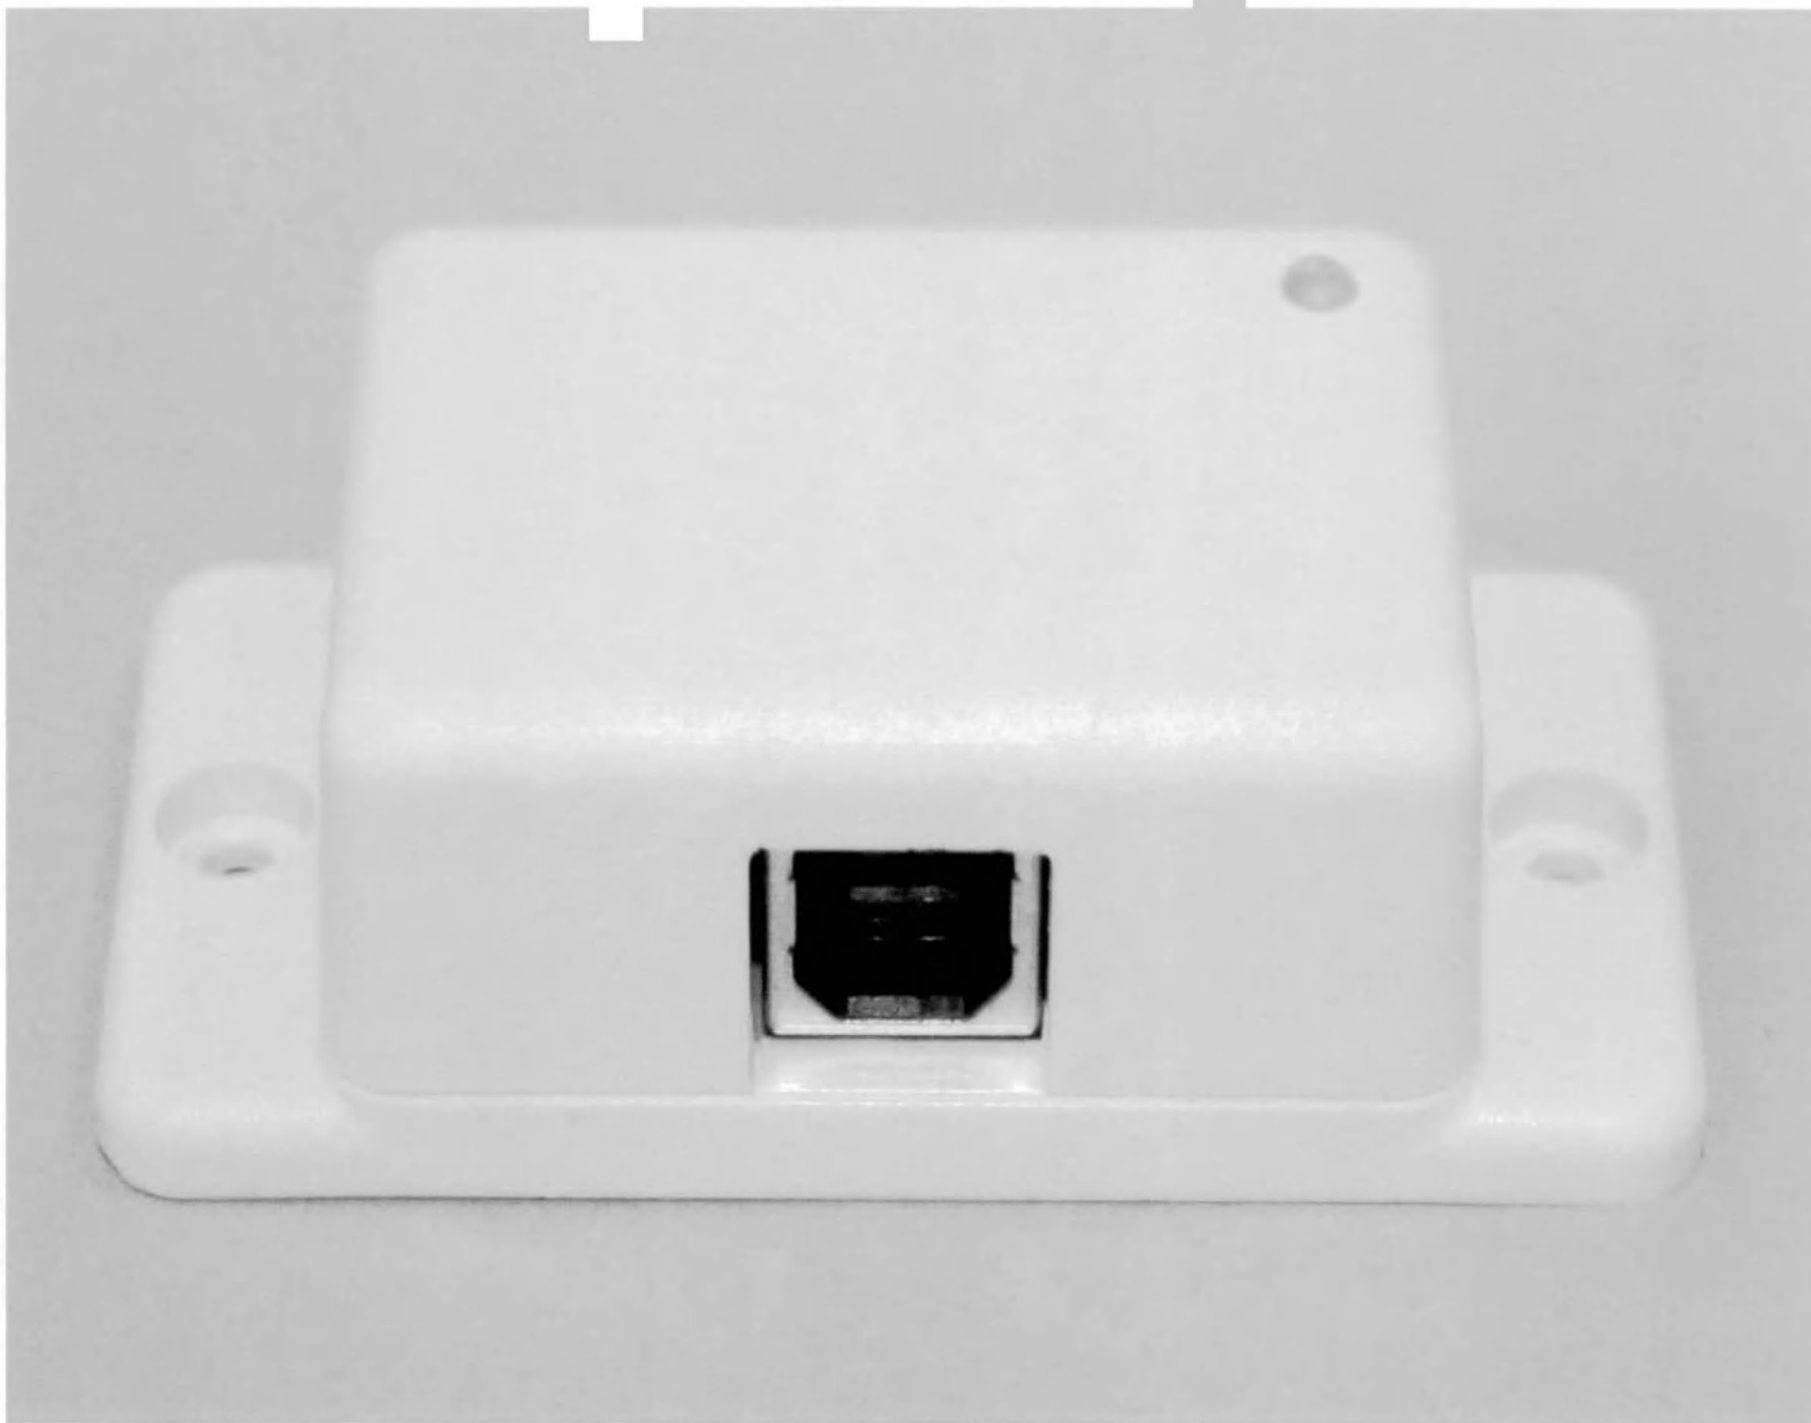


Датчик освещенности «ДО-1»



Датчик воздушного потока «ДД-3-20»



Канюля

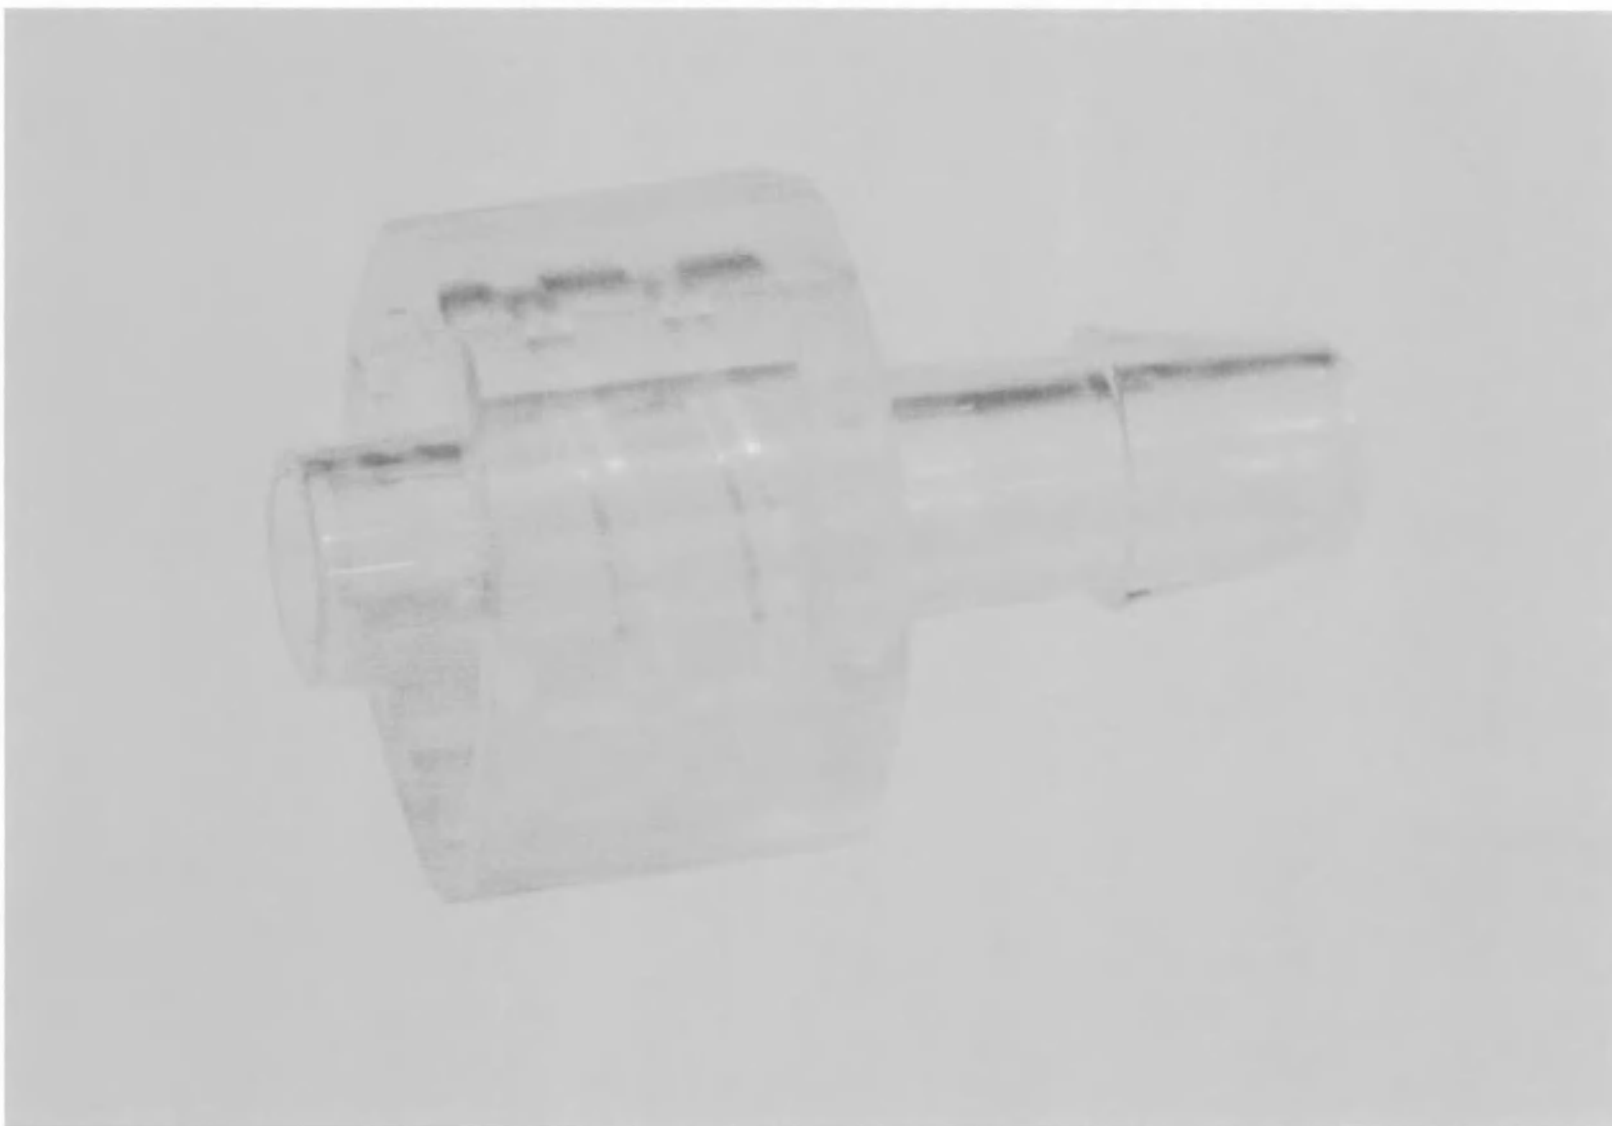

Переходник для канюли



Датчик воздушного потока «ДДП-1-20»




Канюля




Переходник для канюли



Датчик экскурсии грудной клетки и брюшной стенки,
в составе: датчик дыхания пьезокерамический «ДДП-4-22», комплект ремней

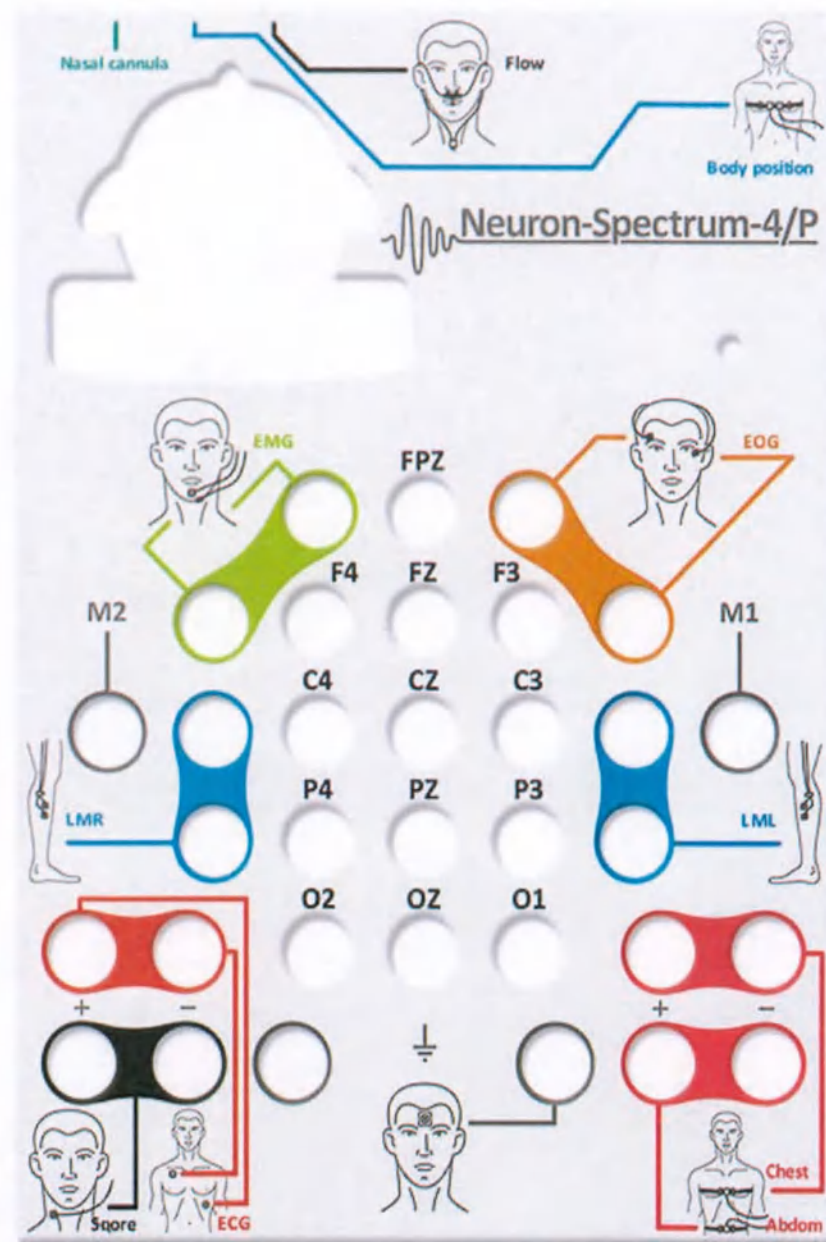

Накладка «Полисомнограф «Нейрон-Спектр-4/П»

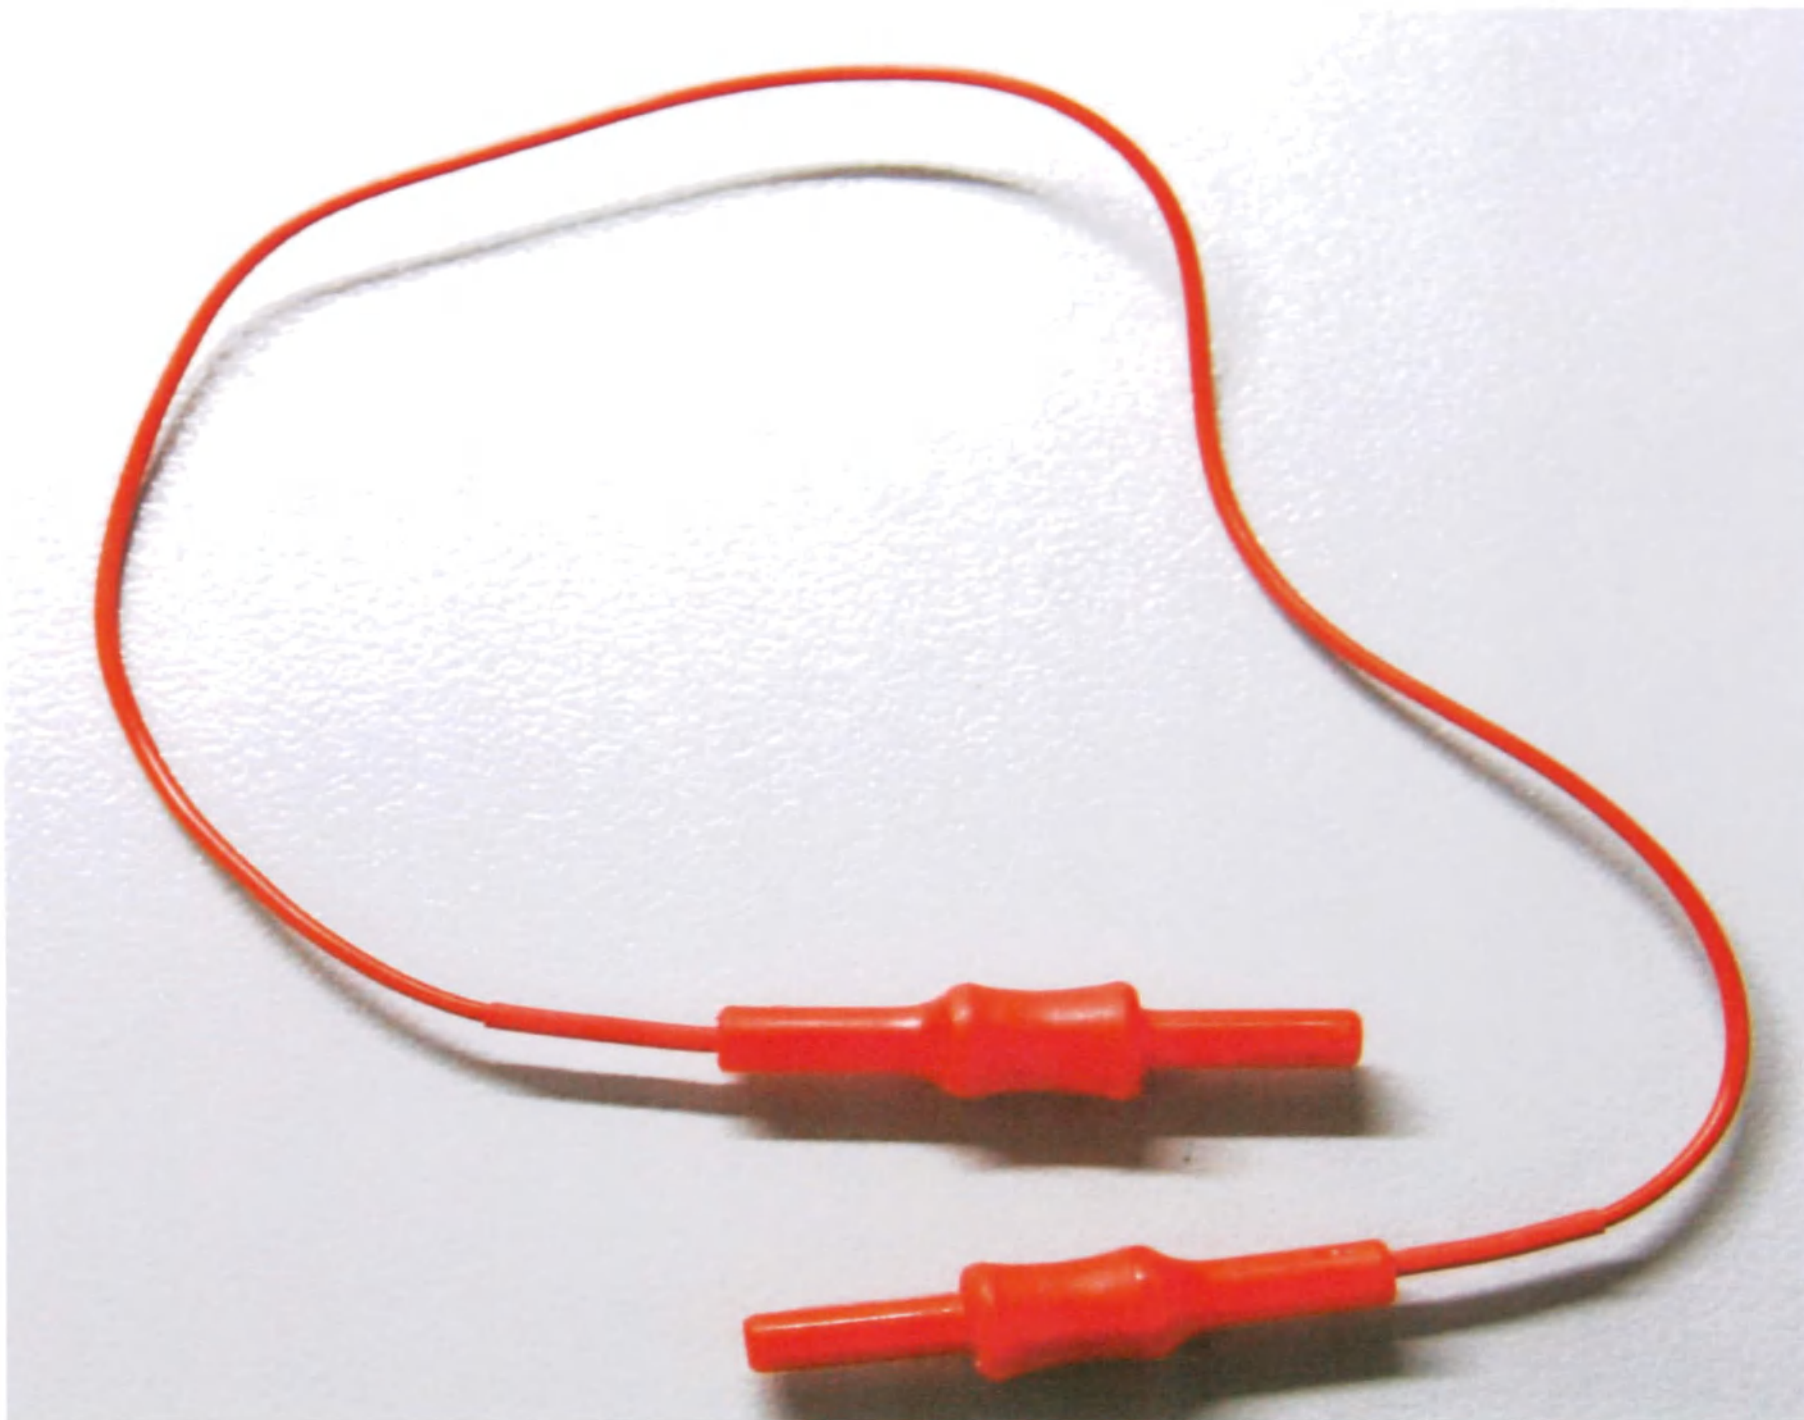

Кабель touch-proof- touch-proof



Блок формирования синхроимпульсов «БФСИ-1»



Клавиатура функциональная «КФ-01» (комплектация с держателем)




Блок педального управления



Стимулятор нервов вилочковий с регулируемым межэлектродным расстоянием и поворотным механизмом «Скат»



Концентратор USB внешний «КМ-7-2»

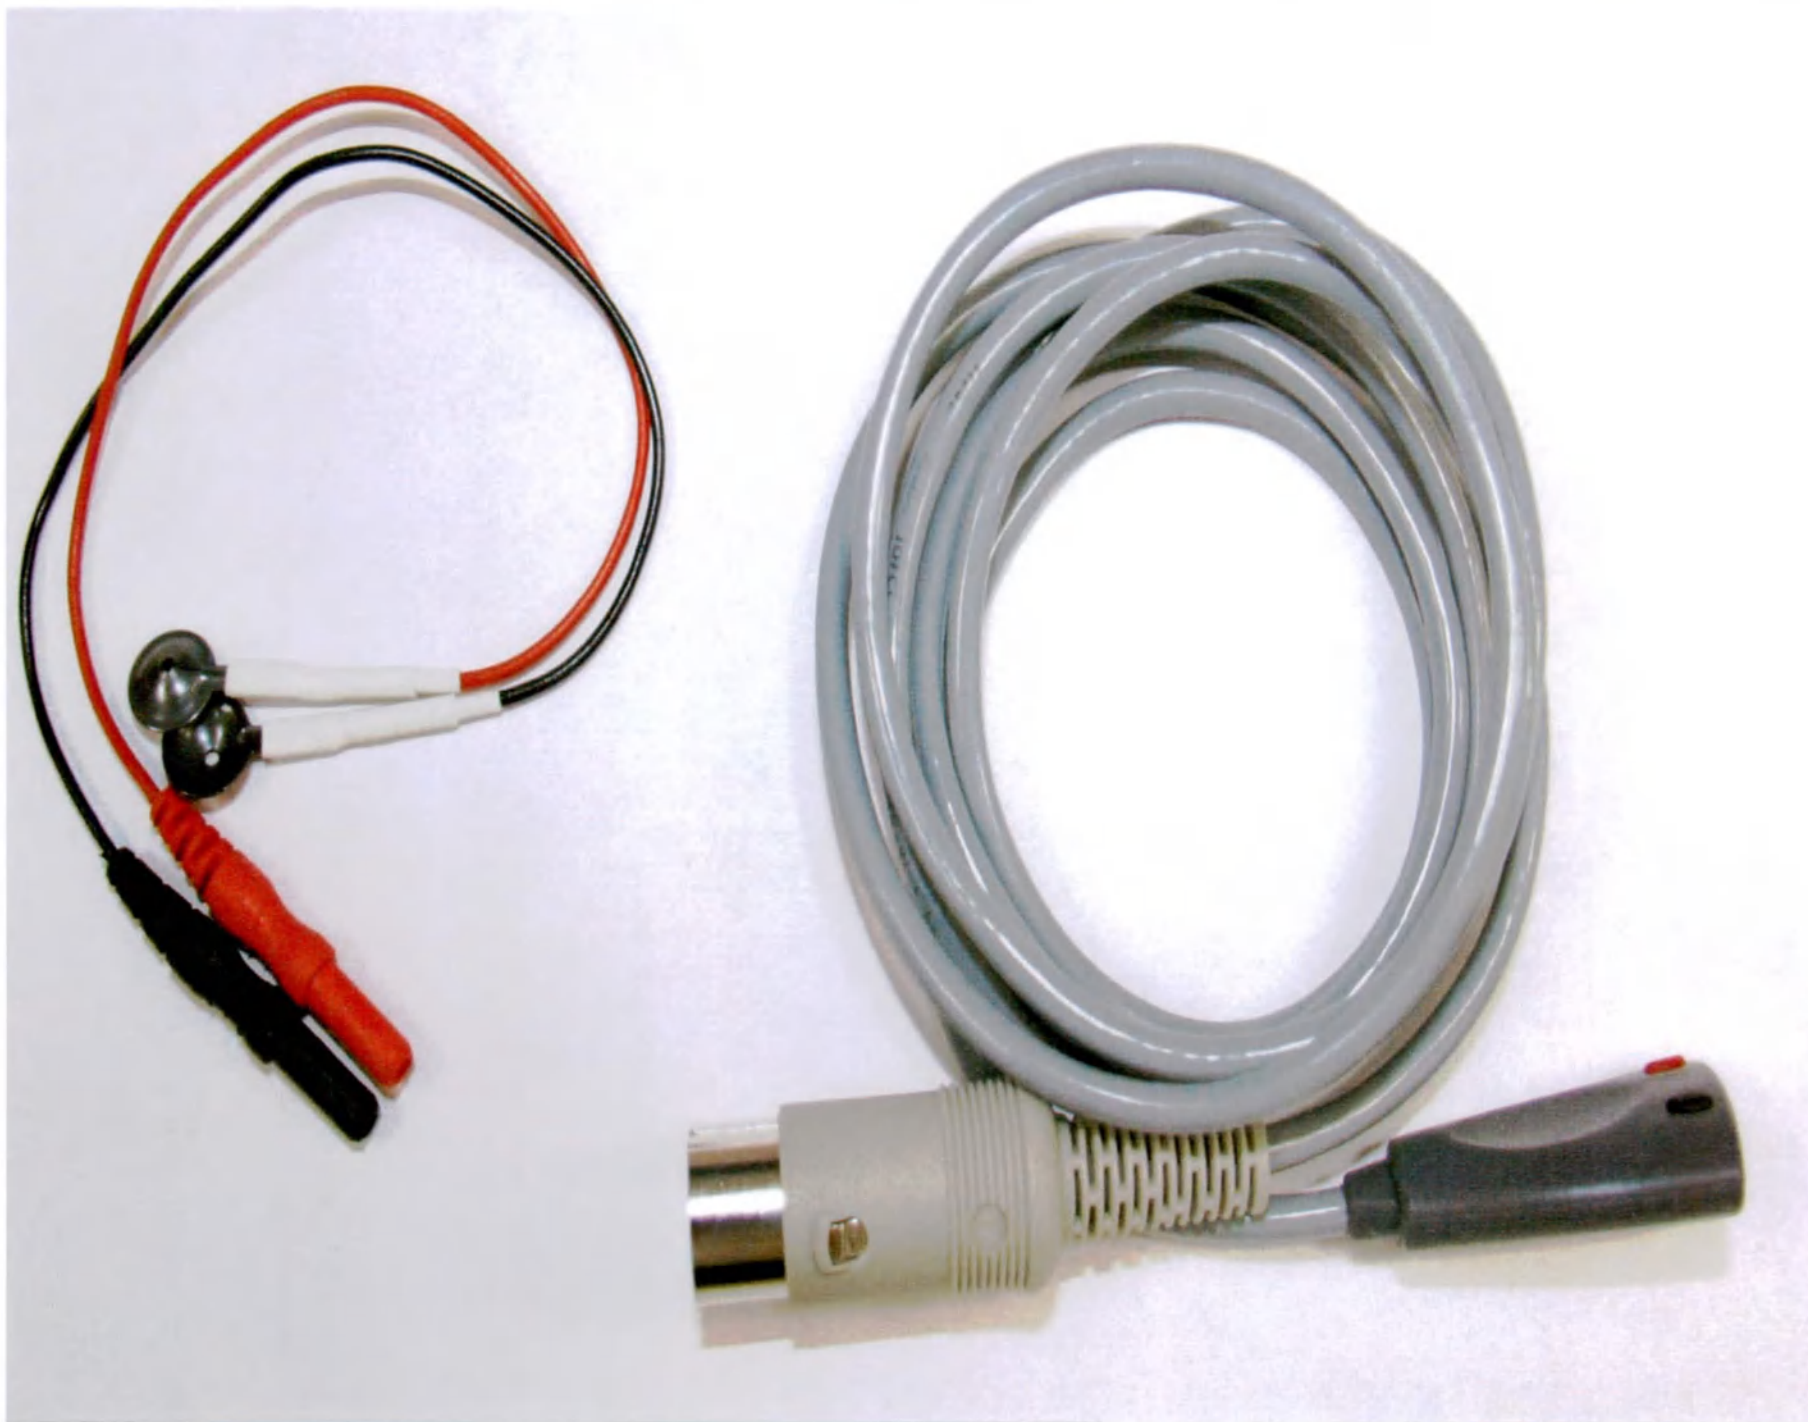

Электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным расстоянием «ЭПП-1»




Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием (взрослый) «ЭП-2»



Электрод поверхностный отводящий с постоянным межэлектродным расстоянием (детский) «ЭП-1»



Электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) широкий с кабелем отведения «ЭСО-2»

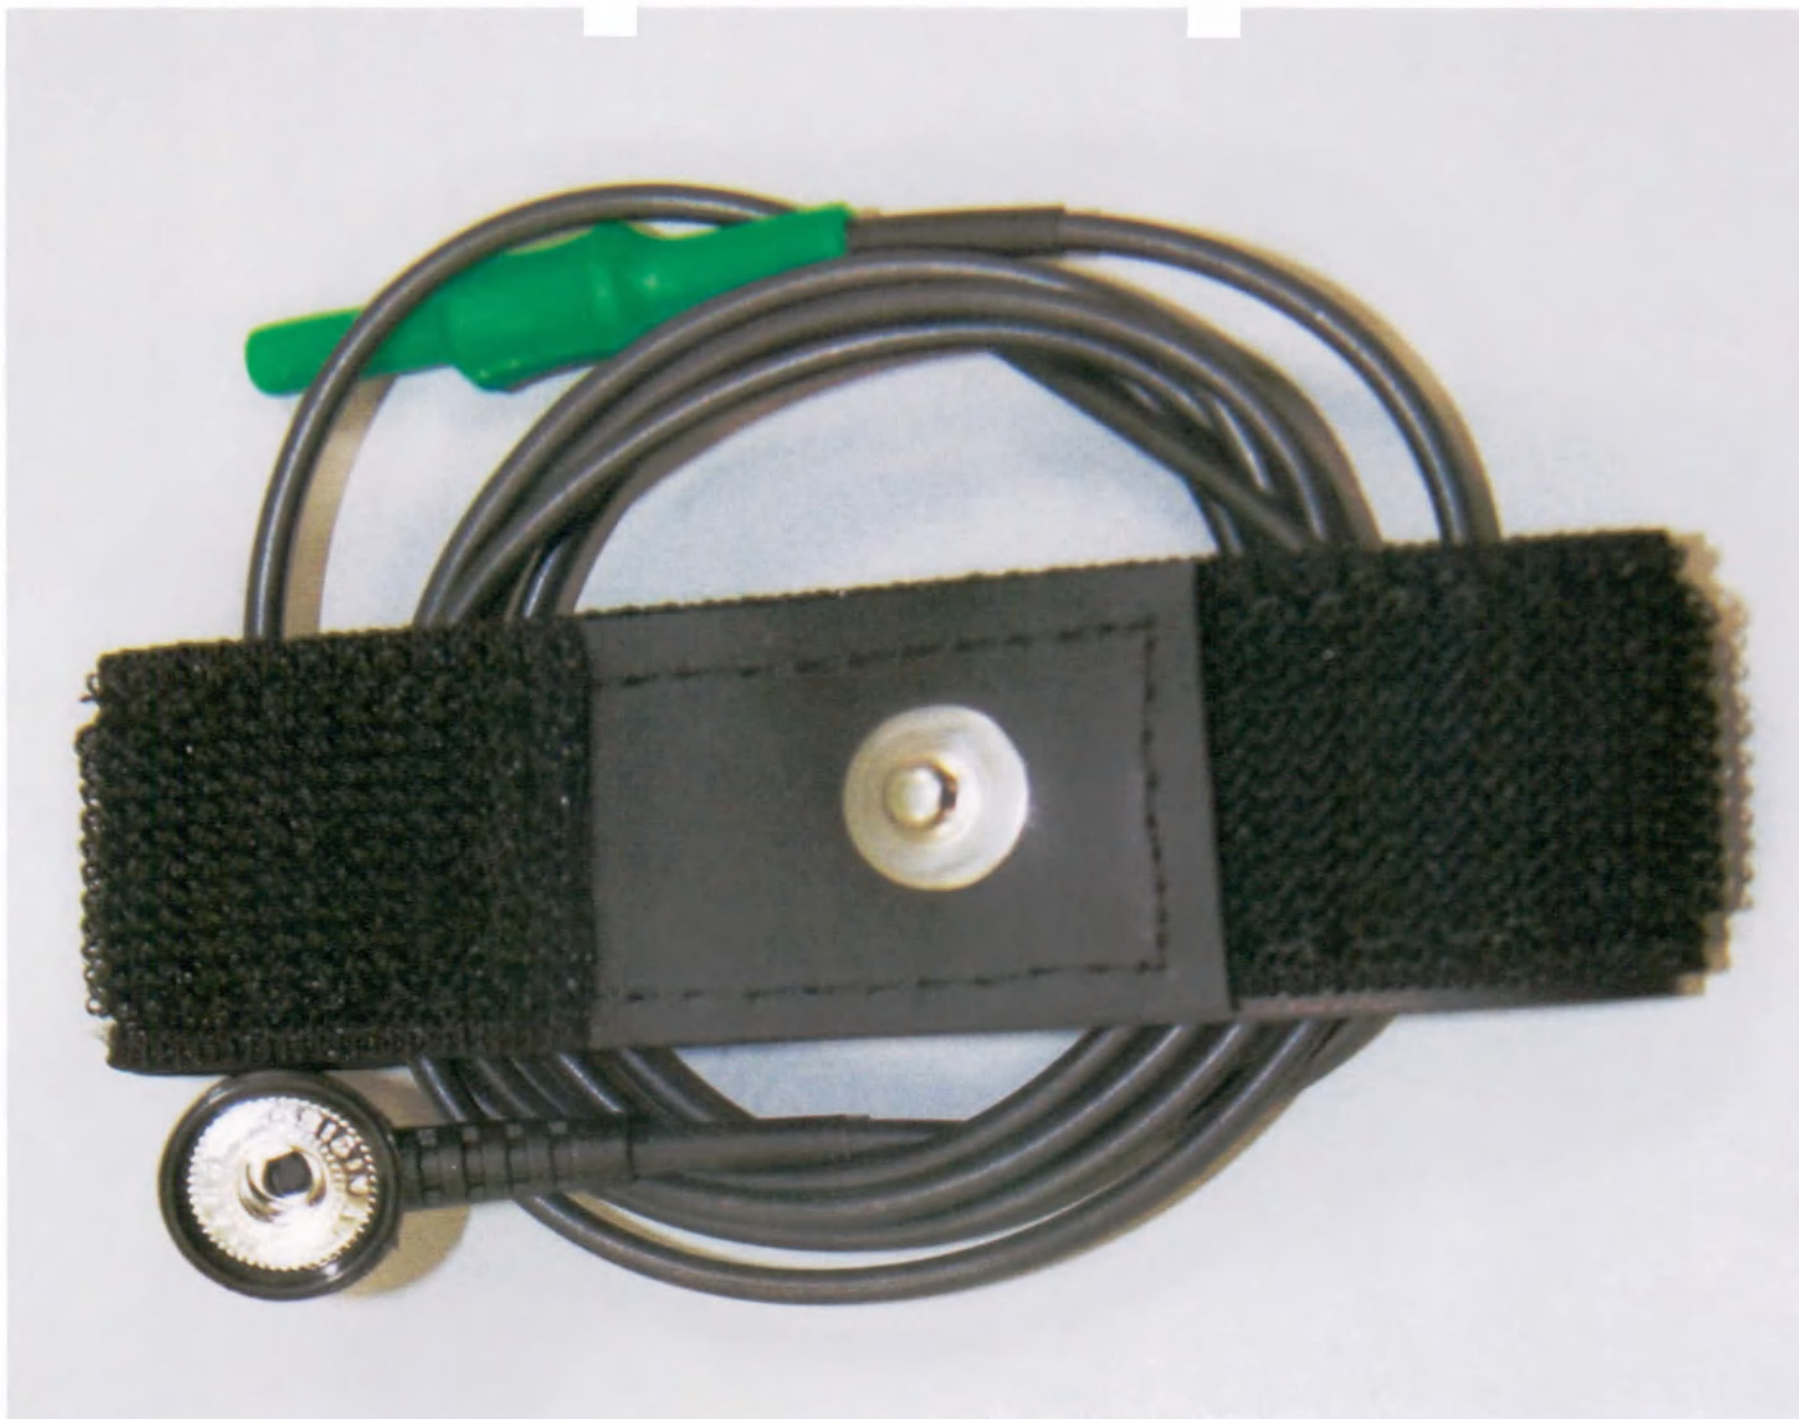

Электрод заземляющий с кабелем отведения (малый) «ЭЗ-1»



Электрод заземляющий с кабелем отведения (средний) «ЭЗ-2»



Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (5 шт.): белый, 1 м, зеленый, 1 м, красный, 1 м, черный, 1 м, желтый, 1 м




Электрод многоразовый чашечковый с кабелем отведения «С1234»



Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП»




Электрод многоразовый концентрический игольчатый «D1216» (20 мм)

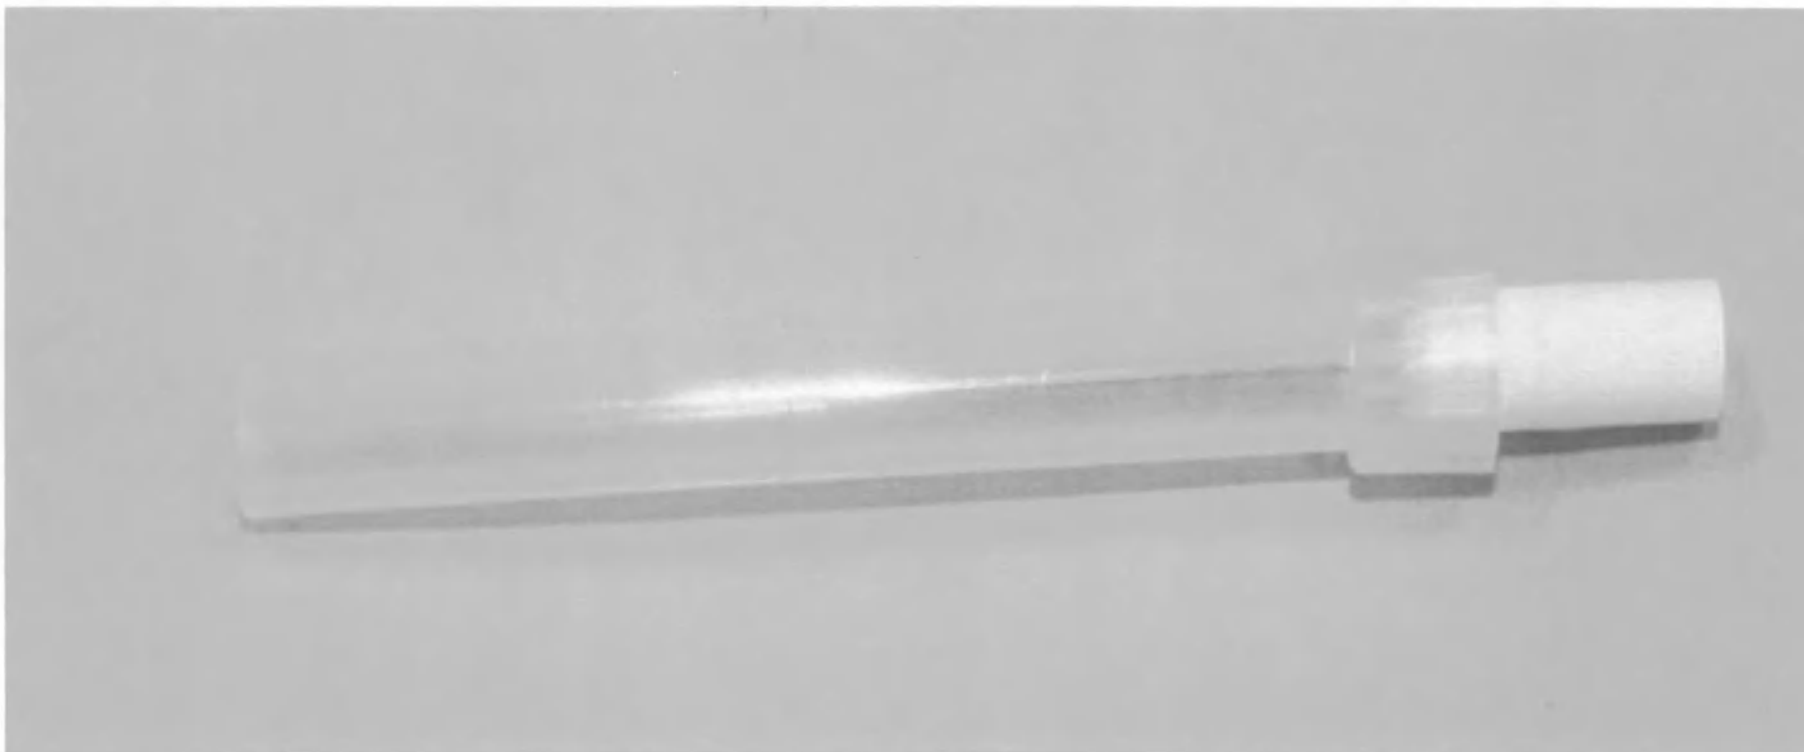

Электрод многоразовый концентрический игольчатый «D1216» (30 мм)




Электрод многоразовый концентрический игольчатый «D1216» (40 мм)

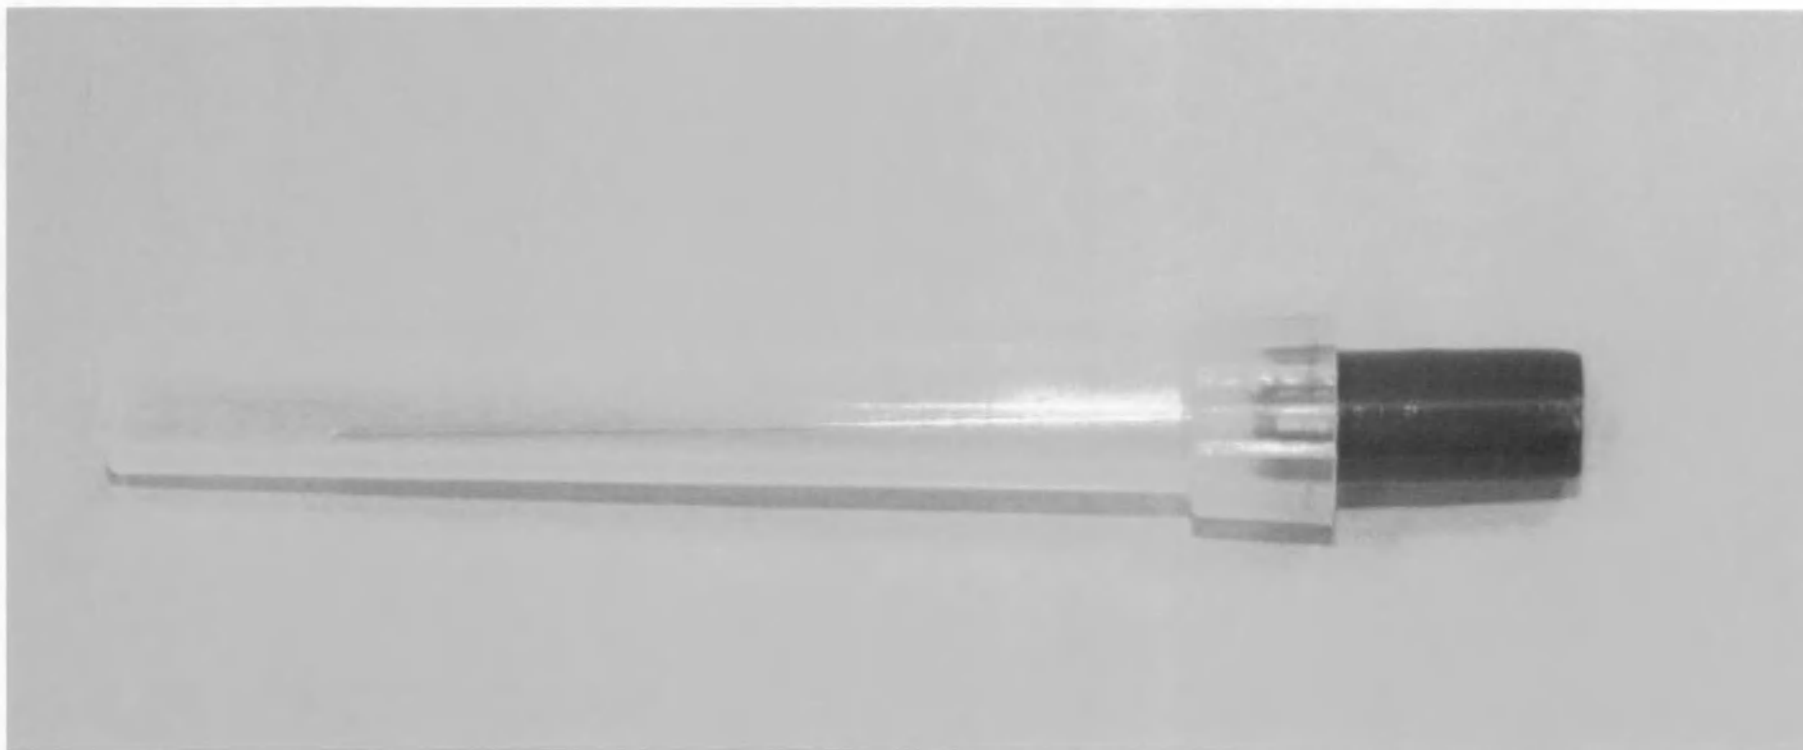


Электрод многоразовый концентрический игольчатый «D1216» (50 мм)



Электрод многоразовый концентрический игольчатый «D1216» (60 мм)

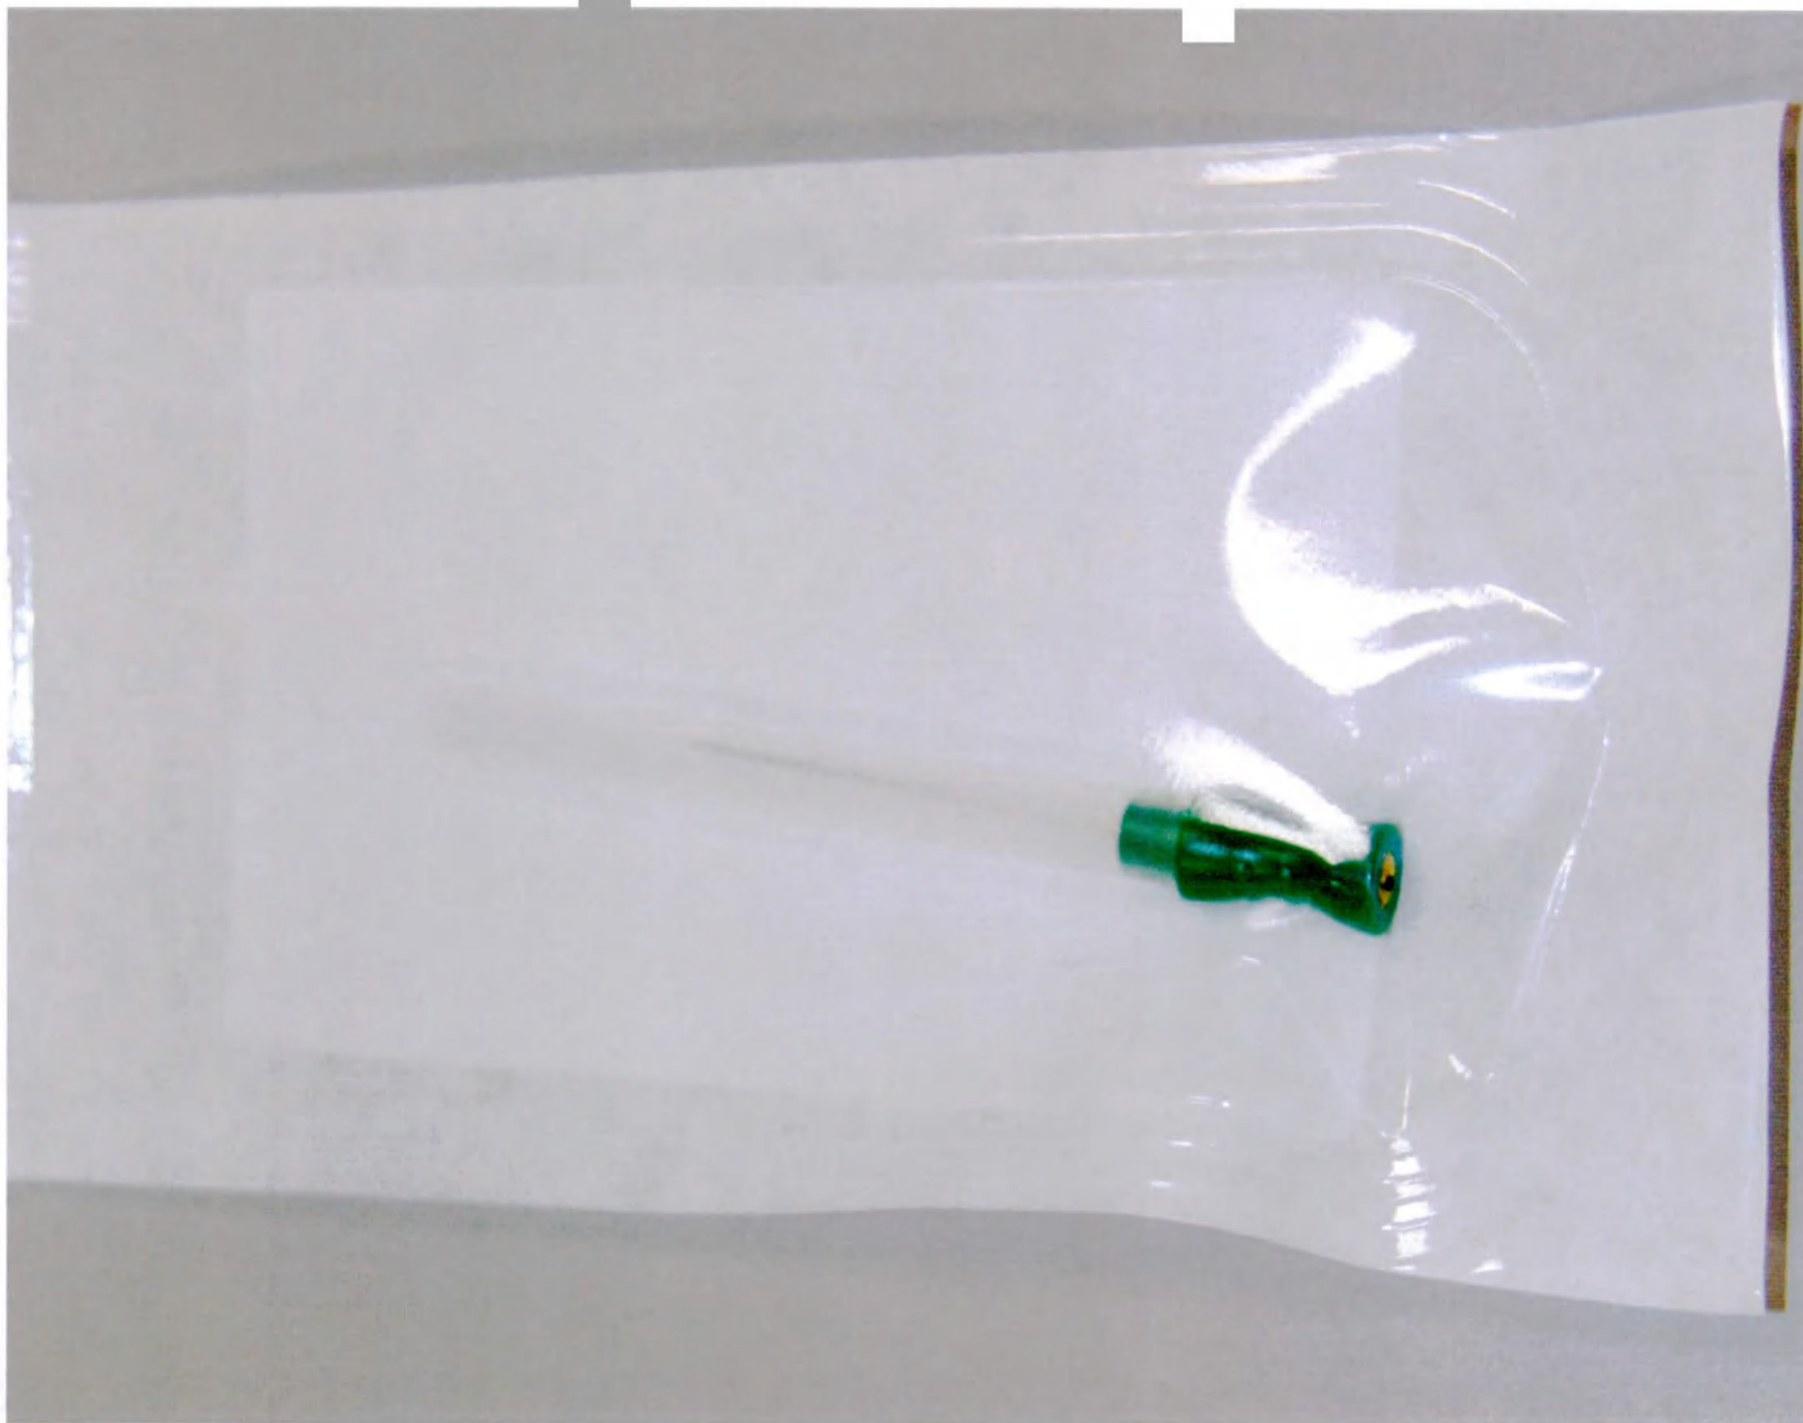

Электрод одноразовый концентрический игольчатый «B50600» (37 мм)

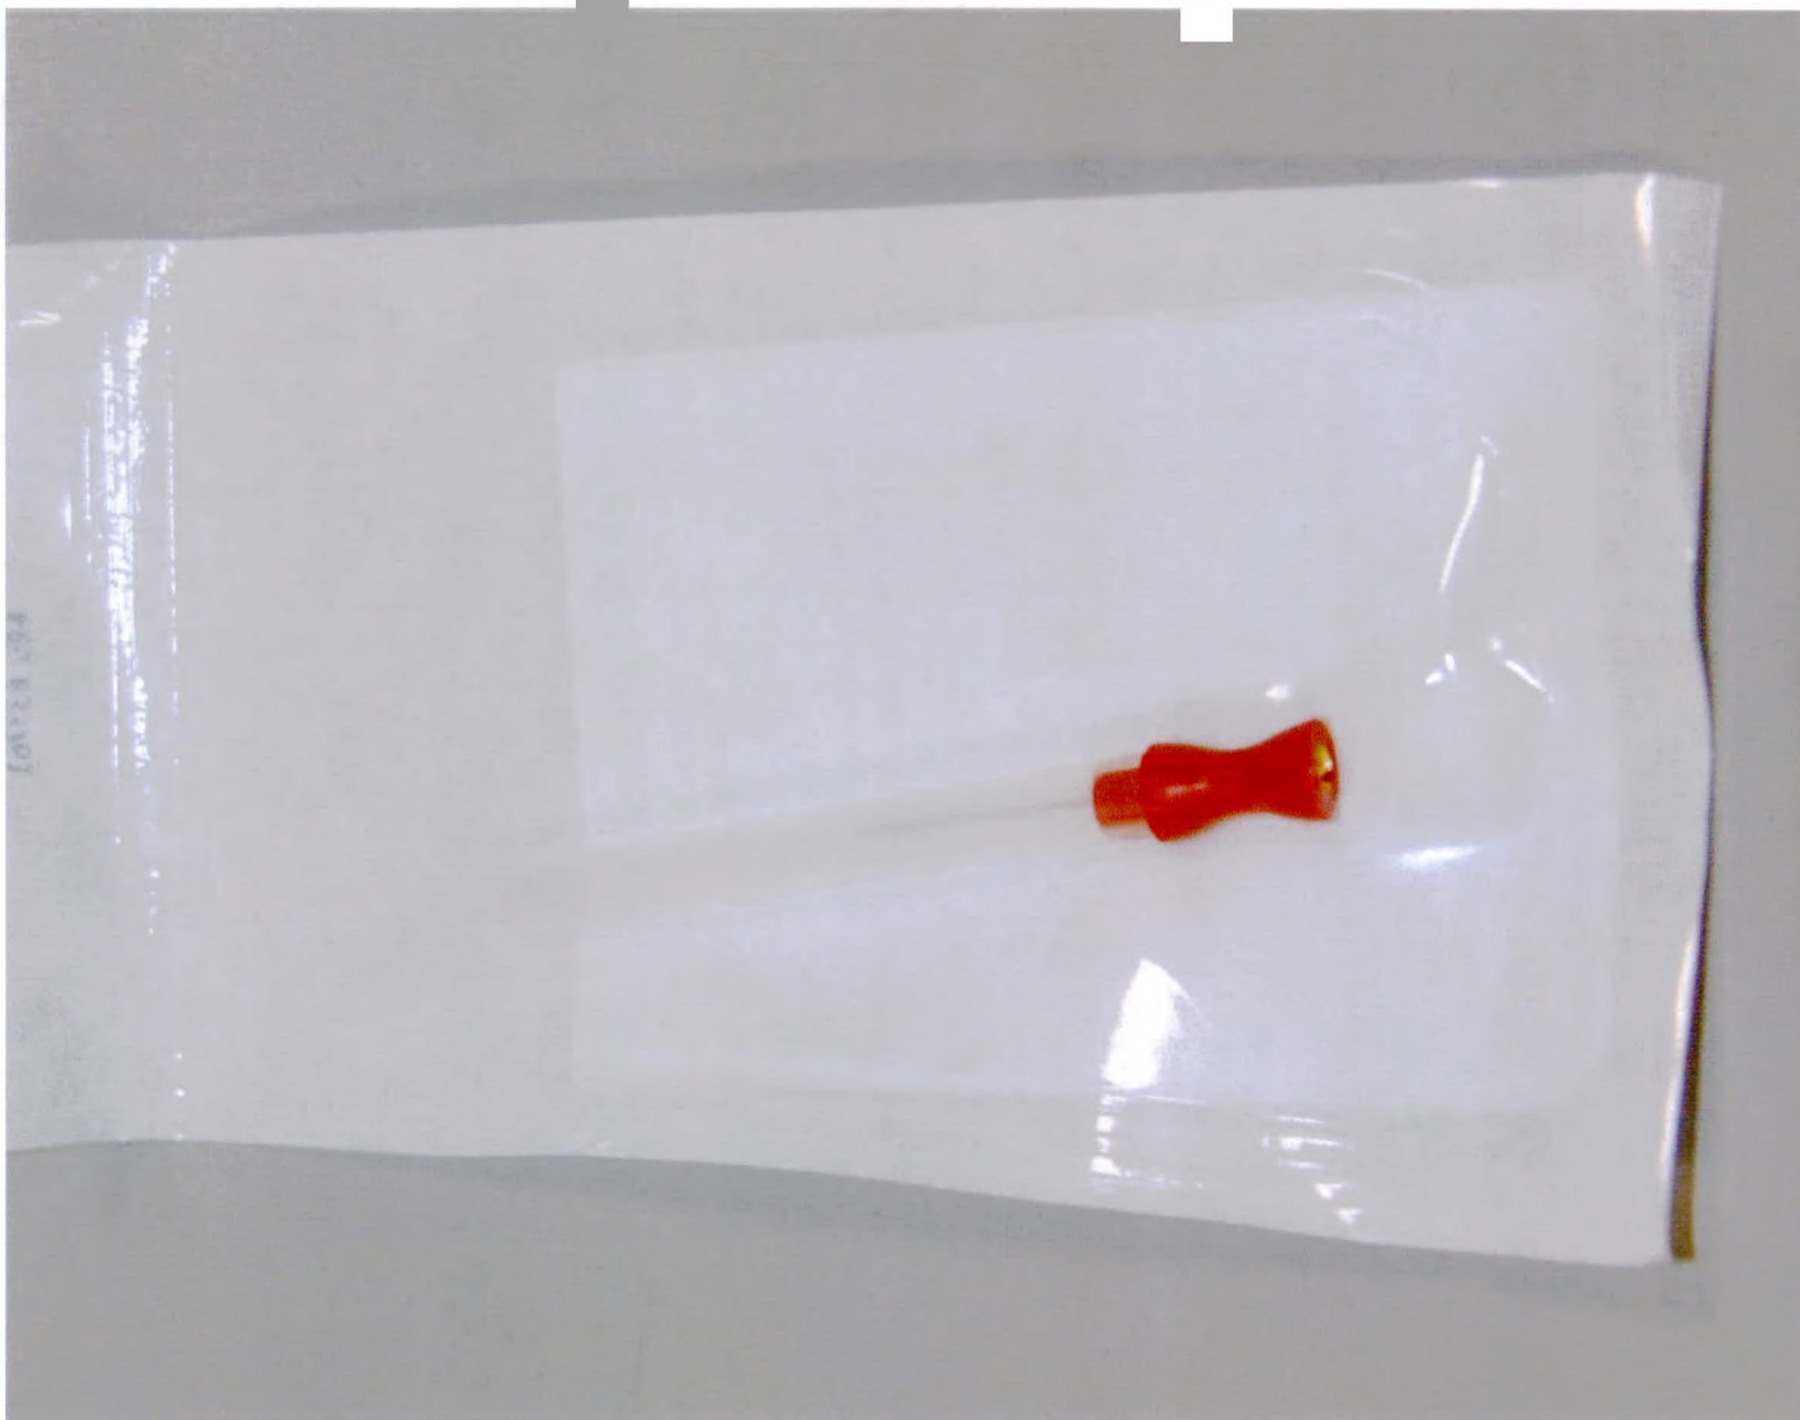

Электрод одноразовый концентрический игольчатый «B50600» (25 мм)



Электрод одноразовый концентрический игольчатый «B50600» (25 мм)




Электрод одноразовый концентрический игольчатый «B50600» (50 мм)



Электрод одноразовый концентрический игольчатый «B50600» (75 мм)



Адаптер для подключения концентрических игольчатых электродов «D60451»

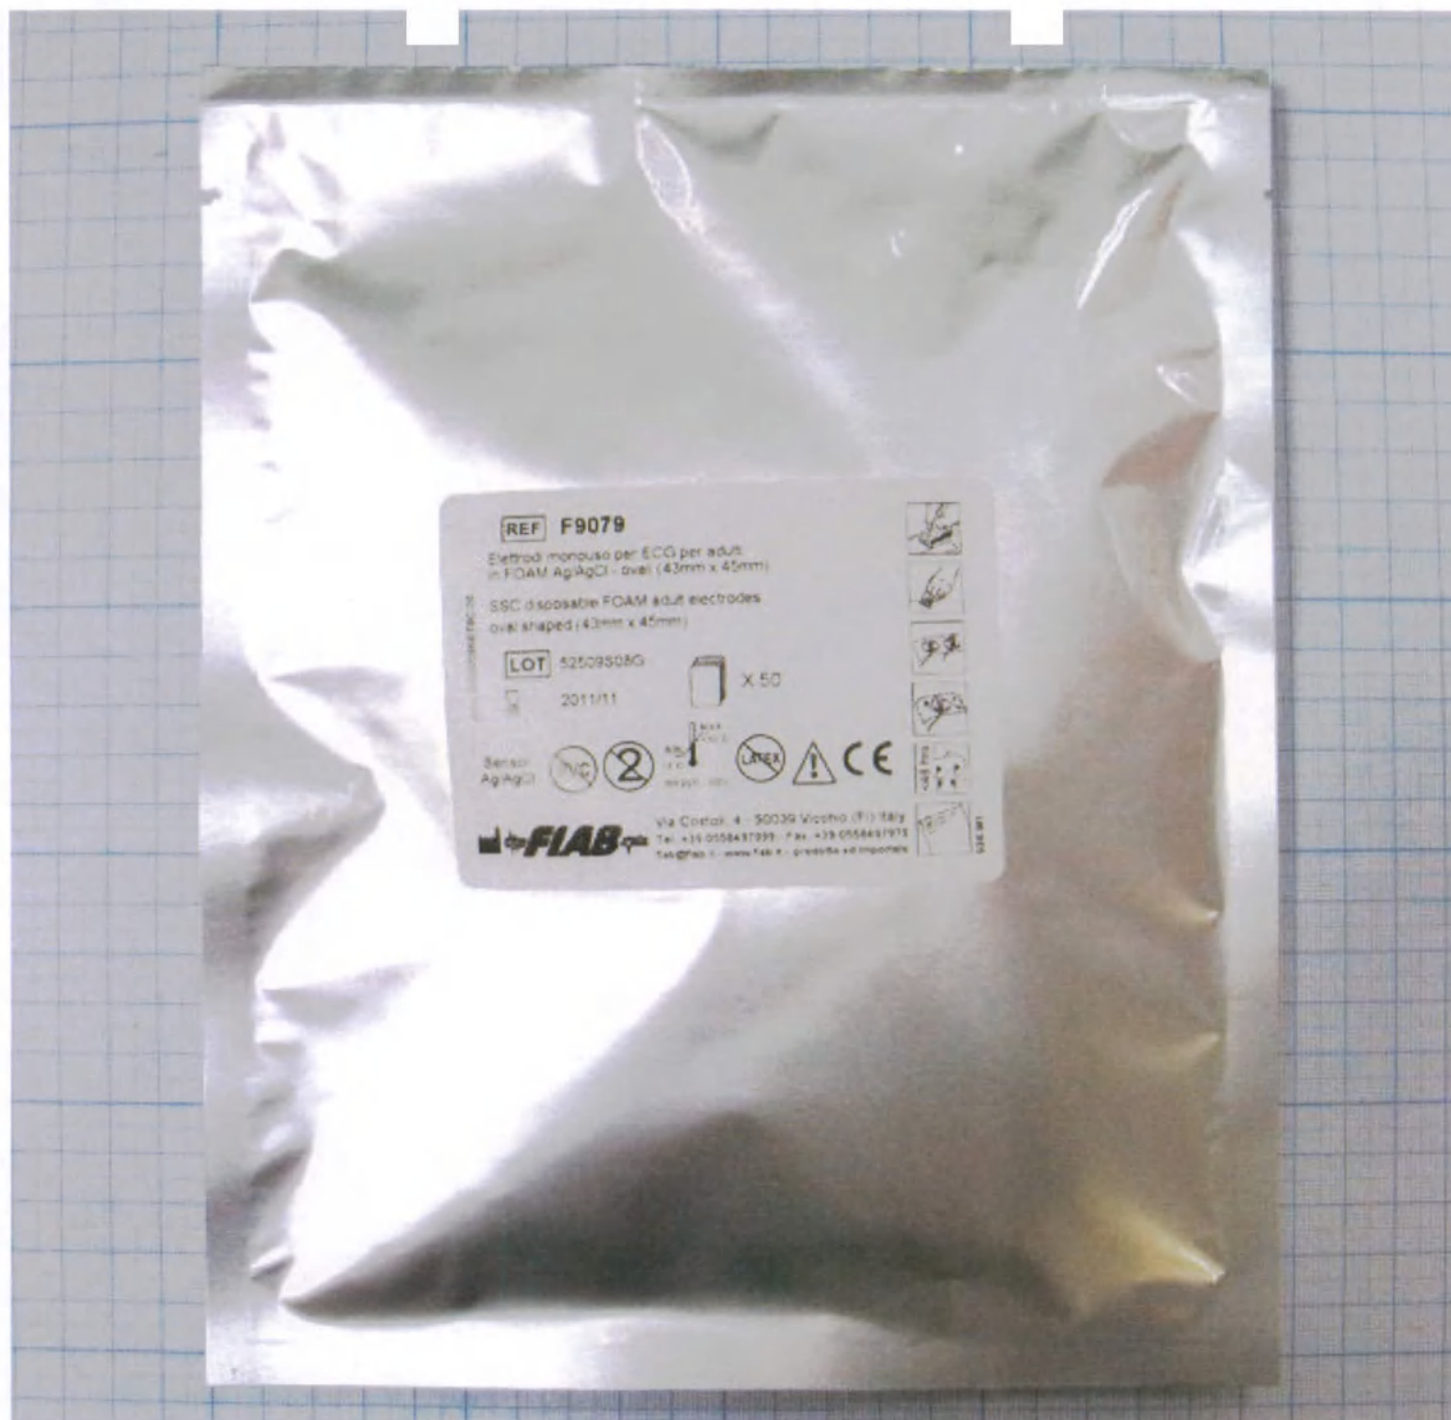

Электрод поверхностный отводящий одноразовый, самоклеящийся, тип коннектора «крокодил»



Электрод стимулирующий с фиксированным межэлектродным расстоянием со съёмными вкладышами (взрослый) «ЭС-2»



Рулетка измерительная, 1 м



Маркер



Гель электродный контактный «Унимакс», 250 г (ООО Гельтек-Медика, Россия)



Паста абразивная, предназначенная для уменьшения сопротивления и подготовки кожи перед наложением электродов

УНИПАСТА

ПАСТА ЭЛЕКТРОДНАЯ КОНТАКТНАЯ ВЫСОКОПРОВОДЯЩАЯ
АДГЕЗИВНАЯ ДЛЯ ЭЭГ И ЭМГ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТУ 9398-007-76063983-2012

 **ГЕЛЬТЕК™**

ISO 9001
ISO 13485

Паста электродная клеящая, предназначенная для обеспечения надежного контакта и фиксации электрода с кожей




Электрод стимулирующий с постоянным межэлектродным расстоянием (со съемными вкладышами) (детский) «ЭС-1»




Электрод токовый стимулирующий вилочковый (детский) «ЭСТ-1»




Электрод токовый стимулирующий вилочковый (взрослый) «ЭСТ-2»

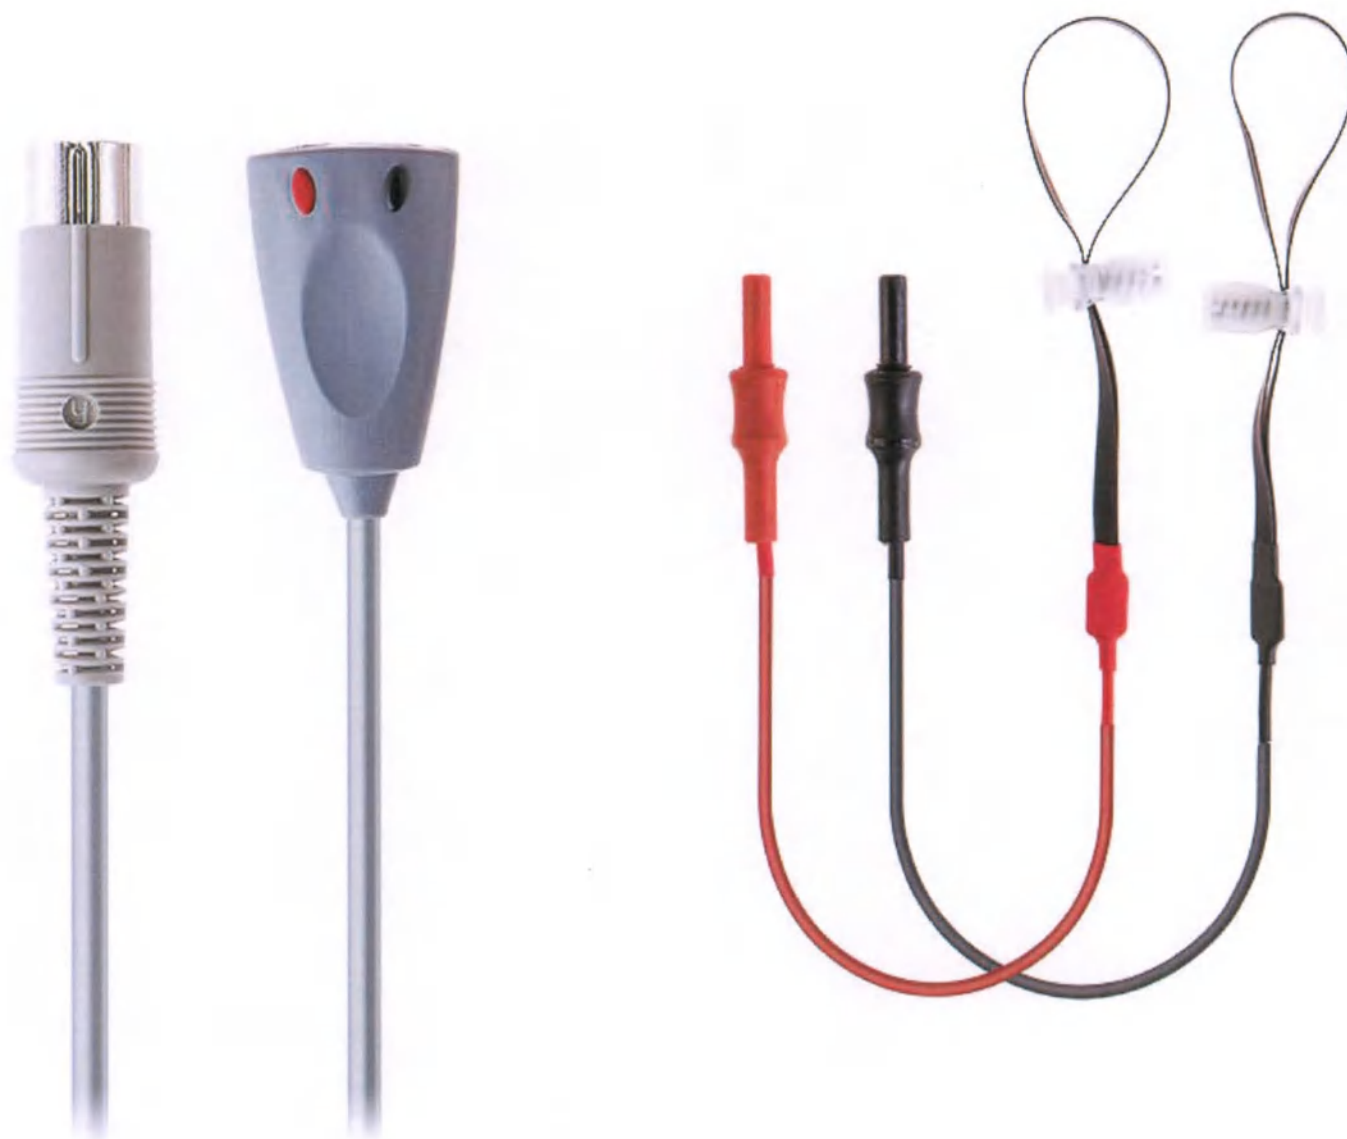


Электрод стимулирующий отводящий на палец (кольцевой) узкий с кабелем отведения «ЭСО-1»

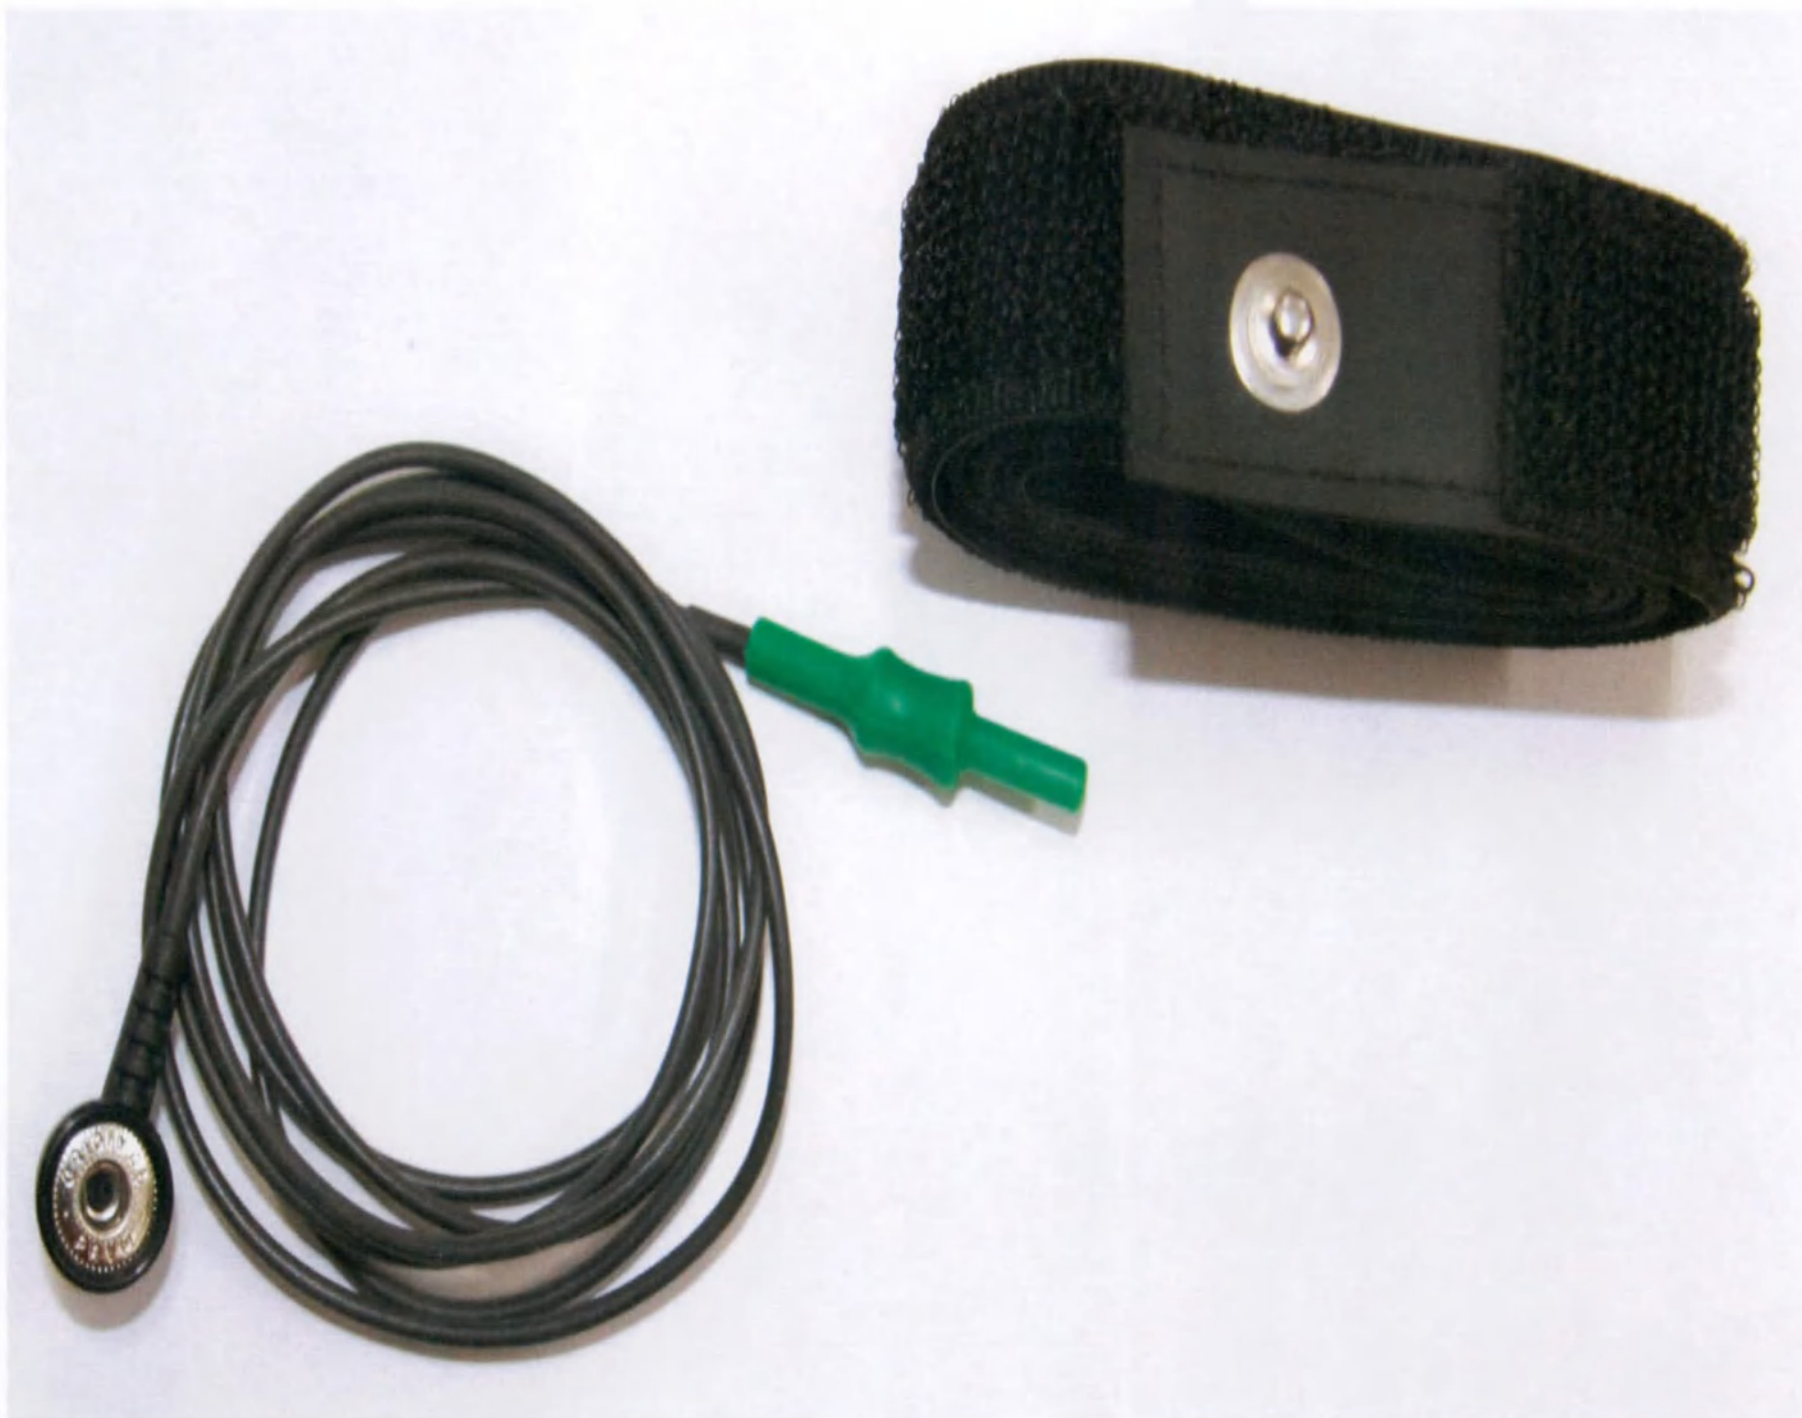

Электрод поверхностный заземляющий с кабелем отведения (большой) «ЭЗ-3»

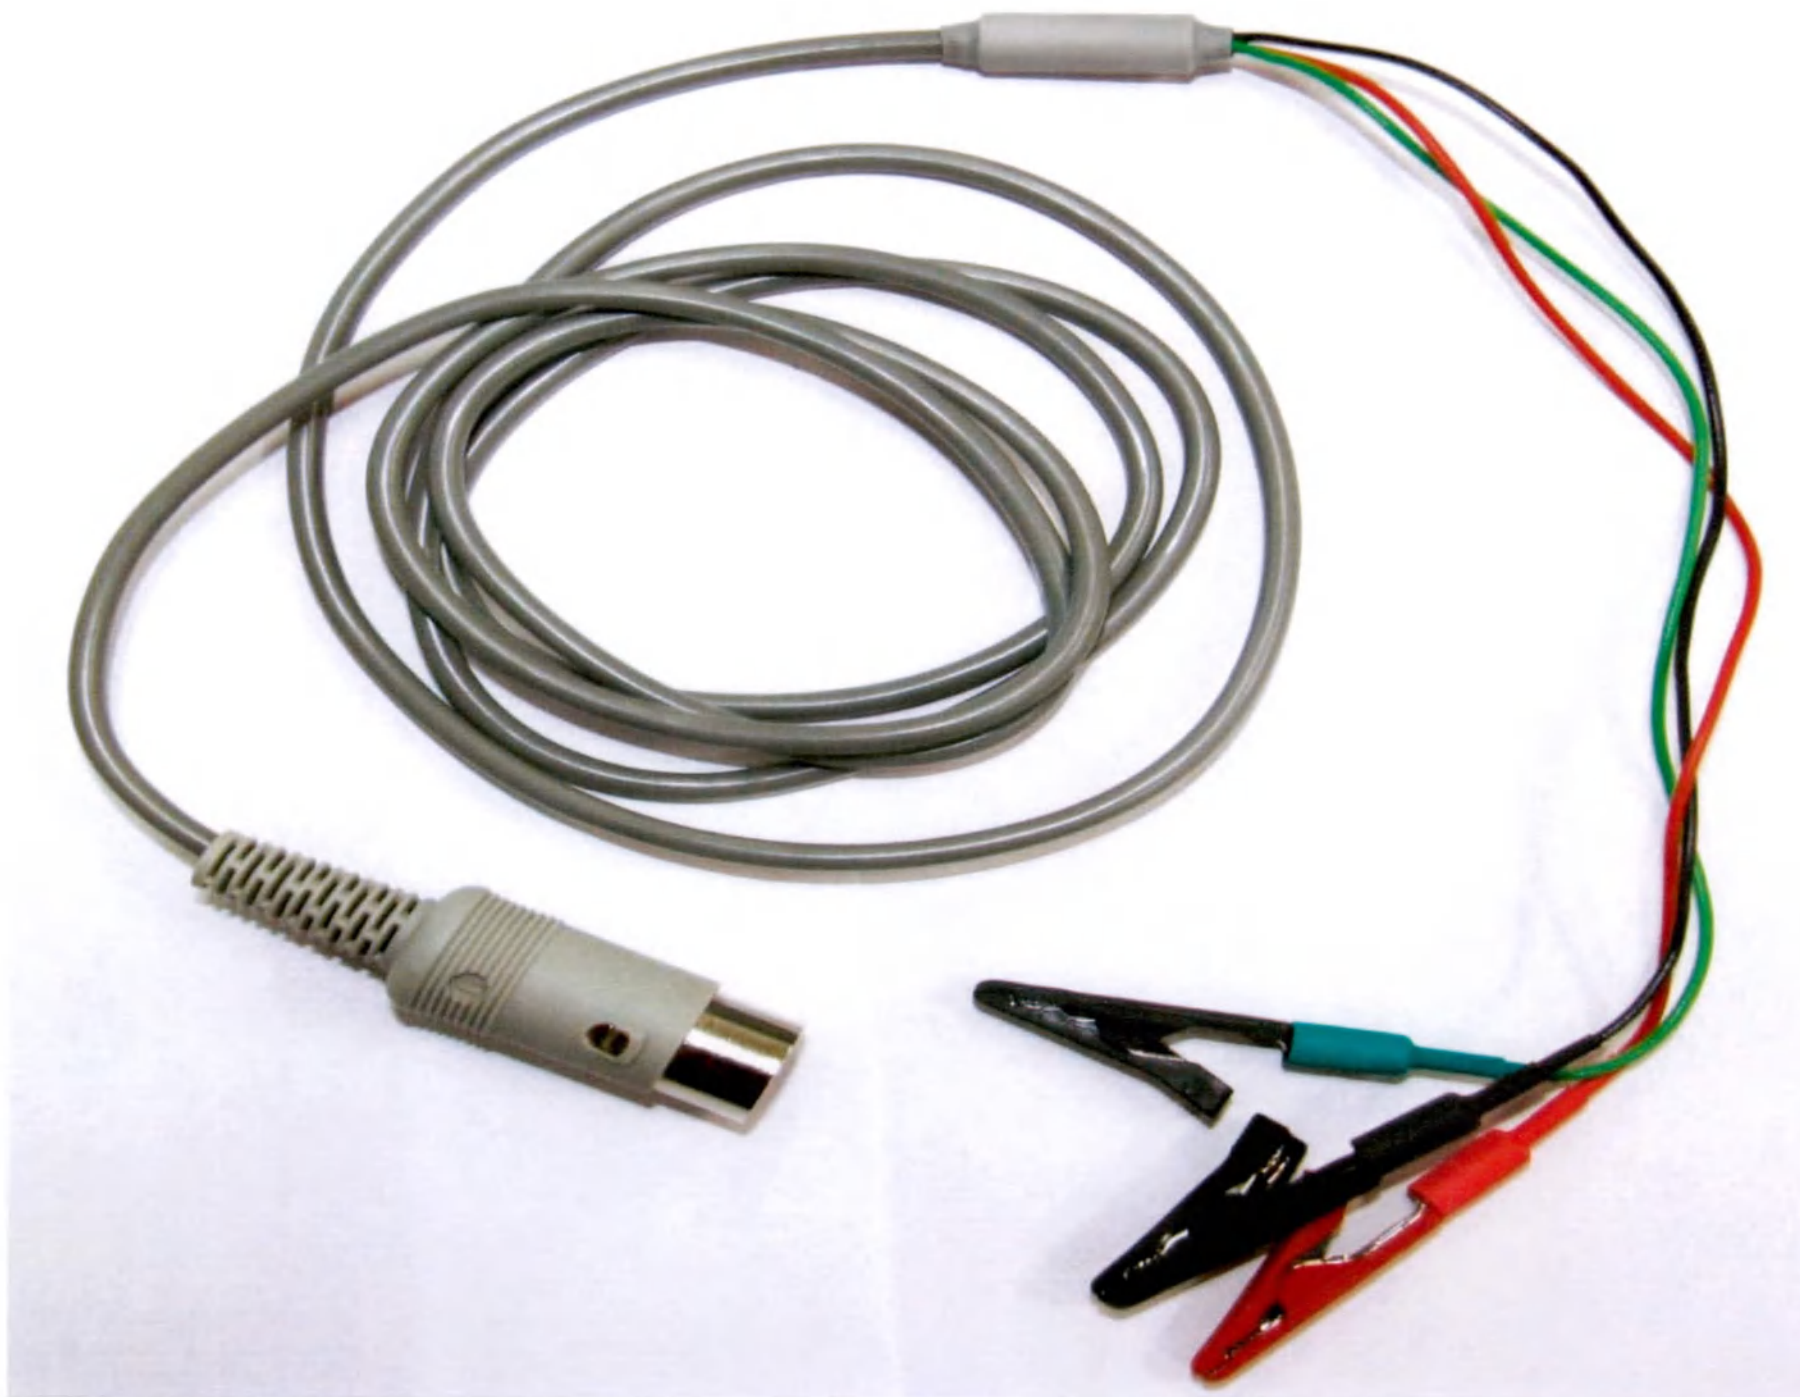


Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», DIN 240°

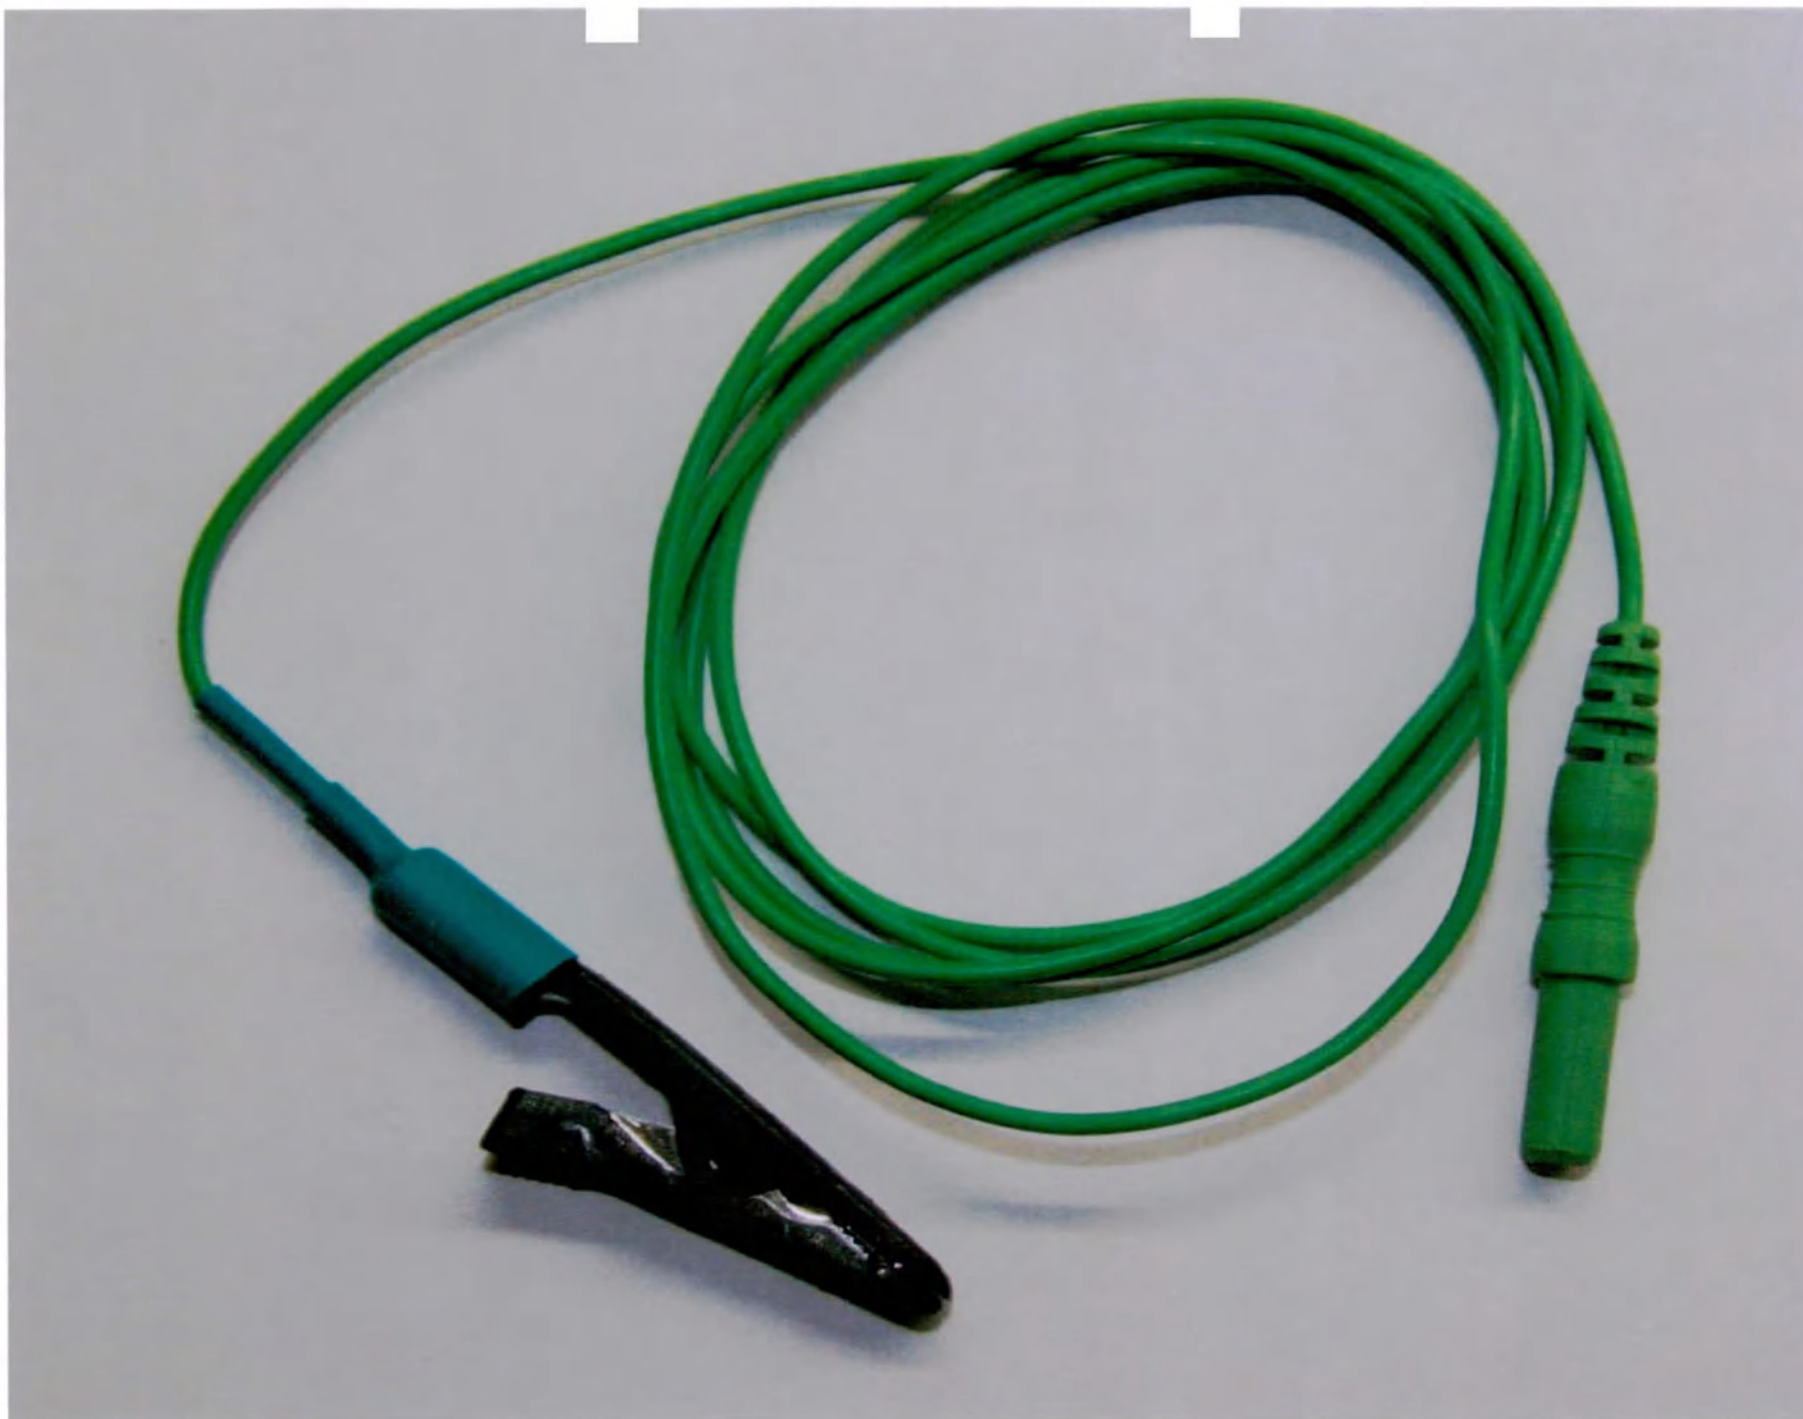

Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор» (зеленый)



Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения (для регистрации ЭЭГ, ЭМГ, ЭОГ)

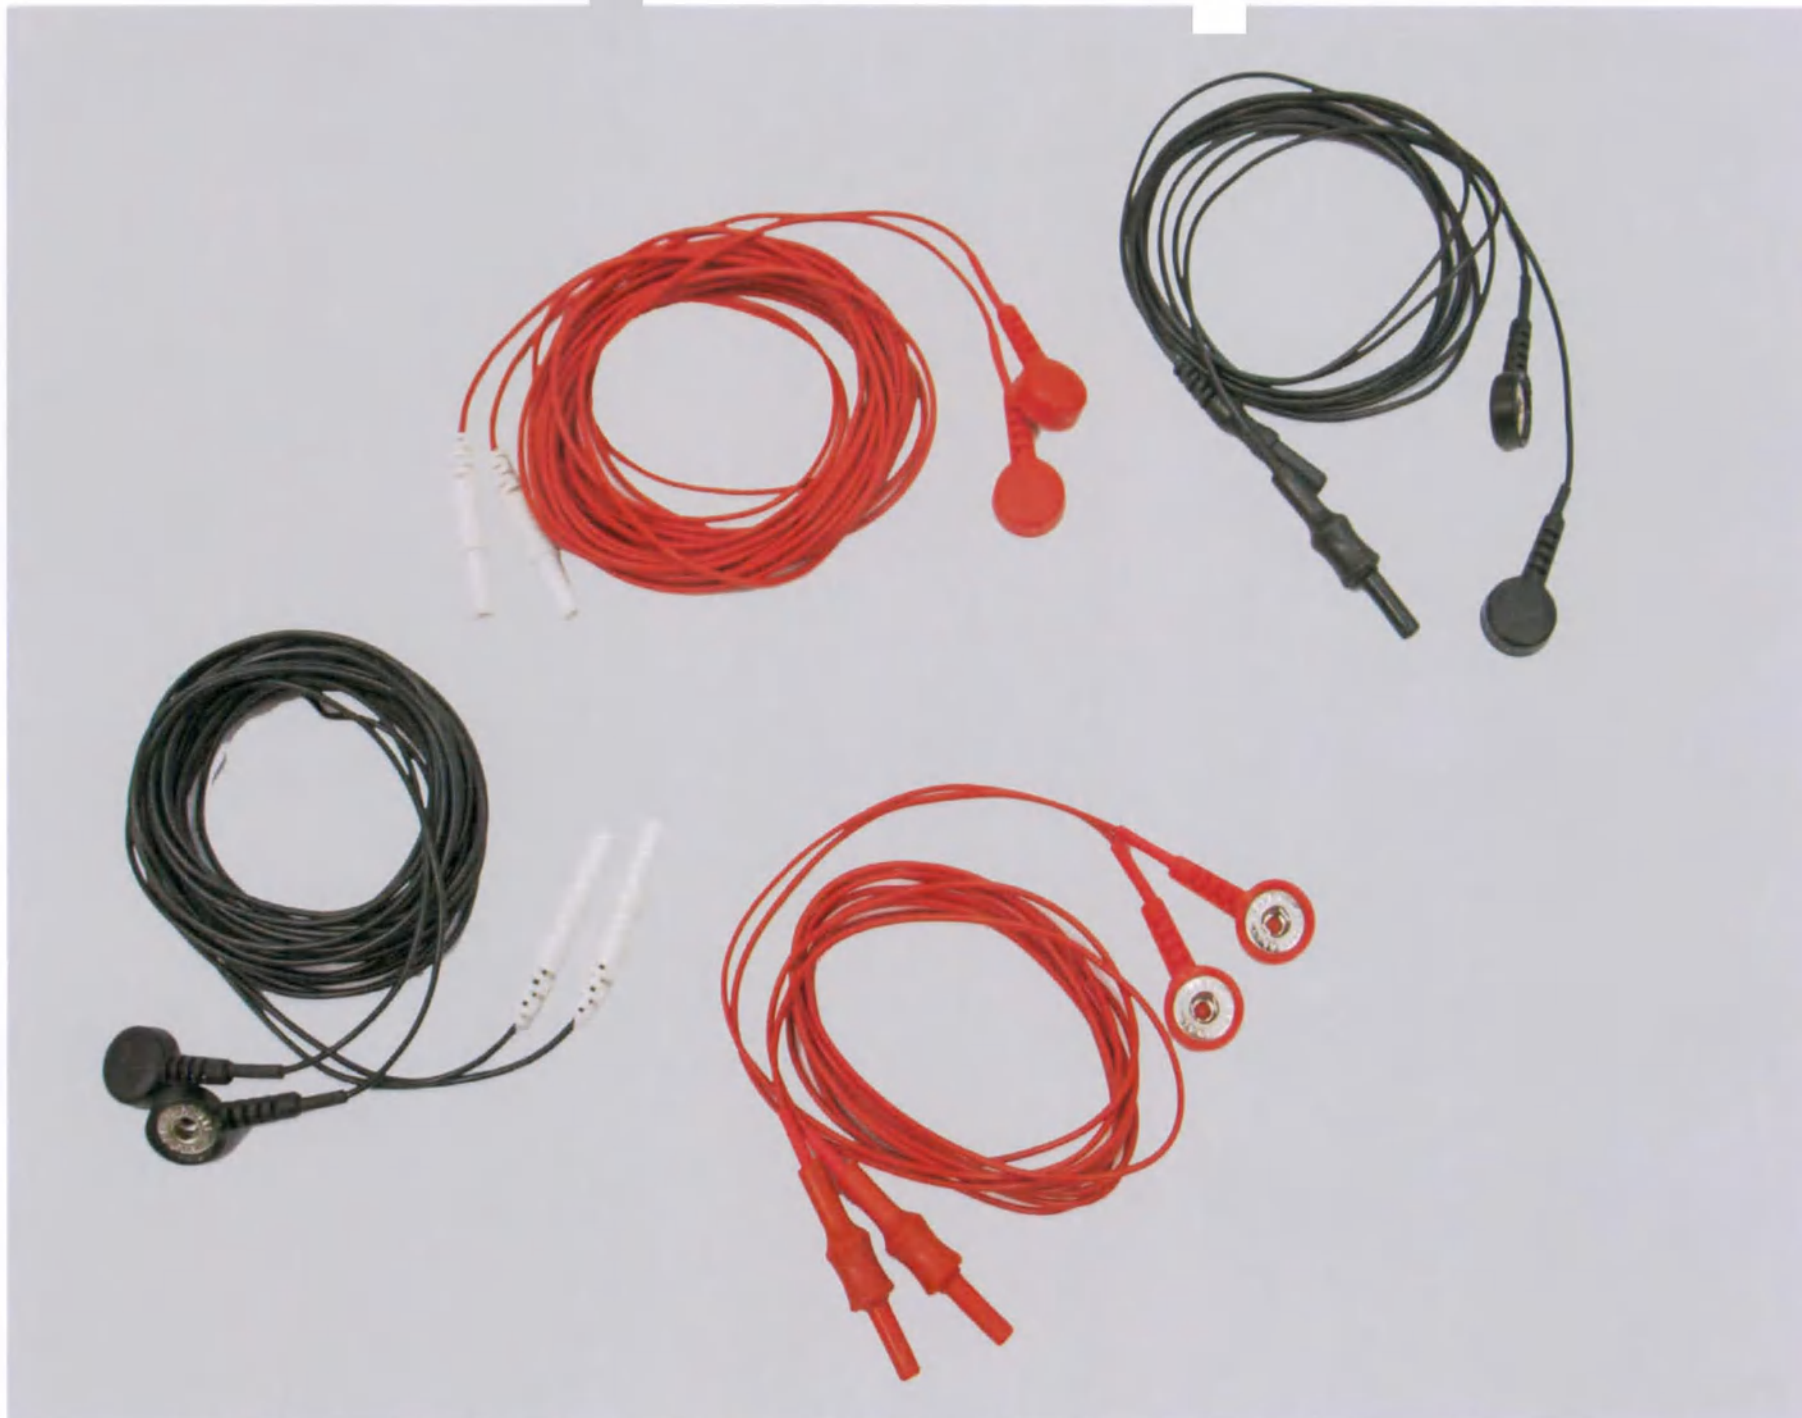

Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «кнопка», разъем touch-proof:
красный, 1,5 м; черный, 1,5 м; красный, 2,5 м; черный, 2,5 м



Электрод поверхностный отводящий одноразовый, гидрогелевый, самоклеющийся, коннектор типа "кнопка"



Блок пульсоксиметрический



Датчик пульсоксиметрический SpO2 одноразовый (Covidien Llc., США)



Датчик пульсоксиметрический SpO₂, детский (ООО «Микролюкс», Россия)



Датчик пульсоксиметрический SpO₂, взрослый (ООО «Микролюкс», Россия)



Видеокамера, моторизованная сетевая на креплении, питание от PoE или от сети, через отдельный блок питания, поддержка функции PTZ (Pan Tilt Zoom), оптический зум не менее x4, крепление на стене, потолке или штативе, автоматическое переключение режима съемки день/ночь и ИК-подсветка, поддерживаемое разрешение 720p и выше, наличие встроенного или подключаемого микрофона, поддержка протоколов передачи данных RTSP и ONVIF



Штатив для видеокамеры с креплением, максимальная нагрузка – не менее 5 кг, максимальная высота не менее 1500 мм,
минимальная высота не более 600 мм



Кабель сетевой для подключения IP-камеры UTP, cat.5E, 4×2



Система электродная электроэнцефалографическая МКС-КЭП в исполнении «МКС-КЭП-26» в составе: шлем MCScap (EC21 или Sleep) с предустановленными тонкими электродами и общим разъемом, ушной адаптер MCScap-A для крепления электродов, гель электродный «УНИАТЕМ» (ГЕЛЬТЕК) проводящий, шприц, игла с тупым наконечником, 1,5×20 мм, размеры: 42-48, 48-54, 54-60 (ООО «МКС», Россия)



Система электродная электроэнцефалографическая MCScar® по ТУ 26.60.12-053-17635079-2020 в варианте исполнения «MCScar CLINIC», производства ООО «МКС», Россия, РУ № РЗН 2023/20725



Система электродная электроэнцефалографическая MCScap® по ТУ 26.60.12-053-17635079-2020 в варианте исполнения «MCScap SLEEP», производства ООО «МКС», Россия, РУ № РЗН 2023/20725




Система электродная электроэнцефалографическая MCSap® по ТУ 26.60.12-053-17635079-2020 в варианте исполнения «MCSap PROFESSIONAL», производства ООО «МКС», Россия, РУ № РЗН 2023/20725




Система электродная электроэнцефалографическая MCScap® по ТУ 26.60.12-053-17635079-2020 в варианте исполнения «MCScap BASE», производства ООО «МКС», Россия, РУ № РЗН 2023/20725



Система электродная электроэнцефалографическая MCScap® по ТУ 26.60.12-053-17635079-2020 в варианте исполнения «MCScap PROFESSIONAL light», производства ООО «МКС», Россия, РУ № РЗН 2023/20725

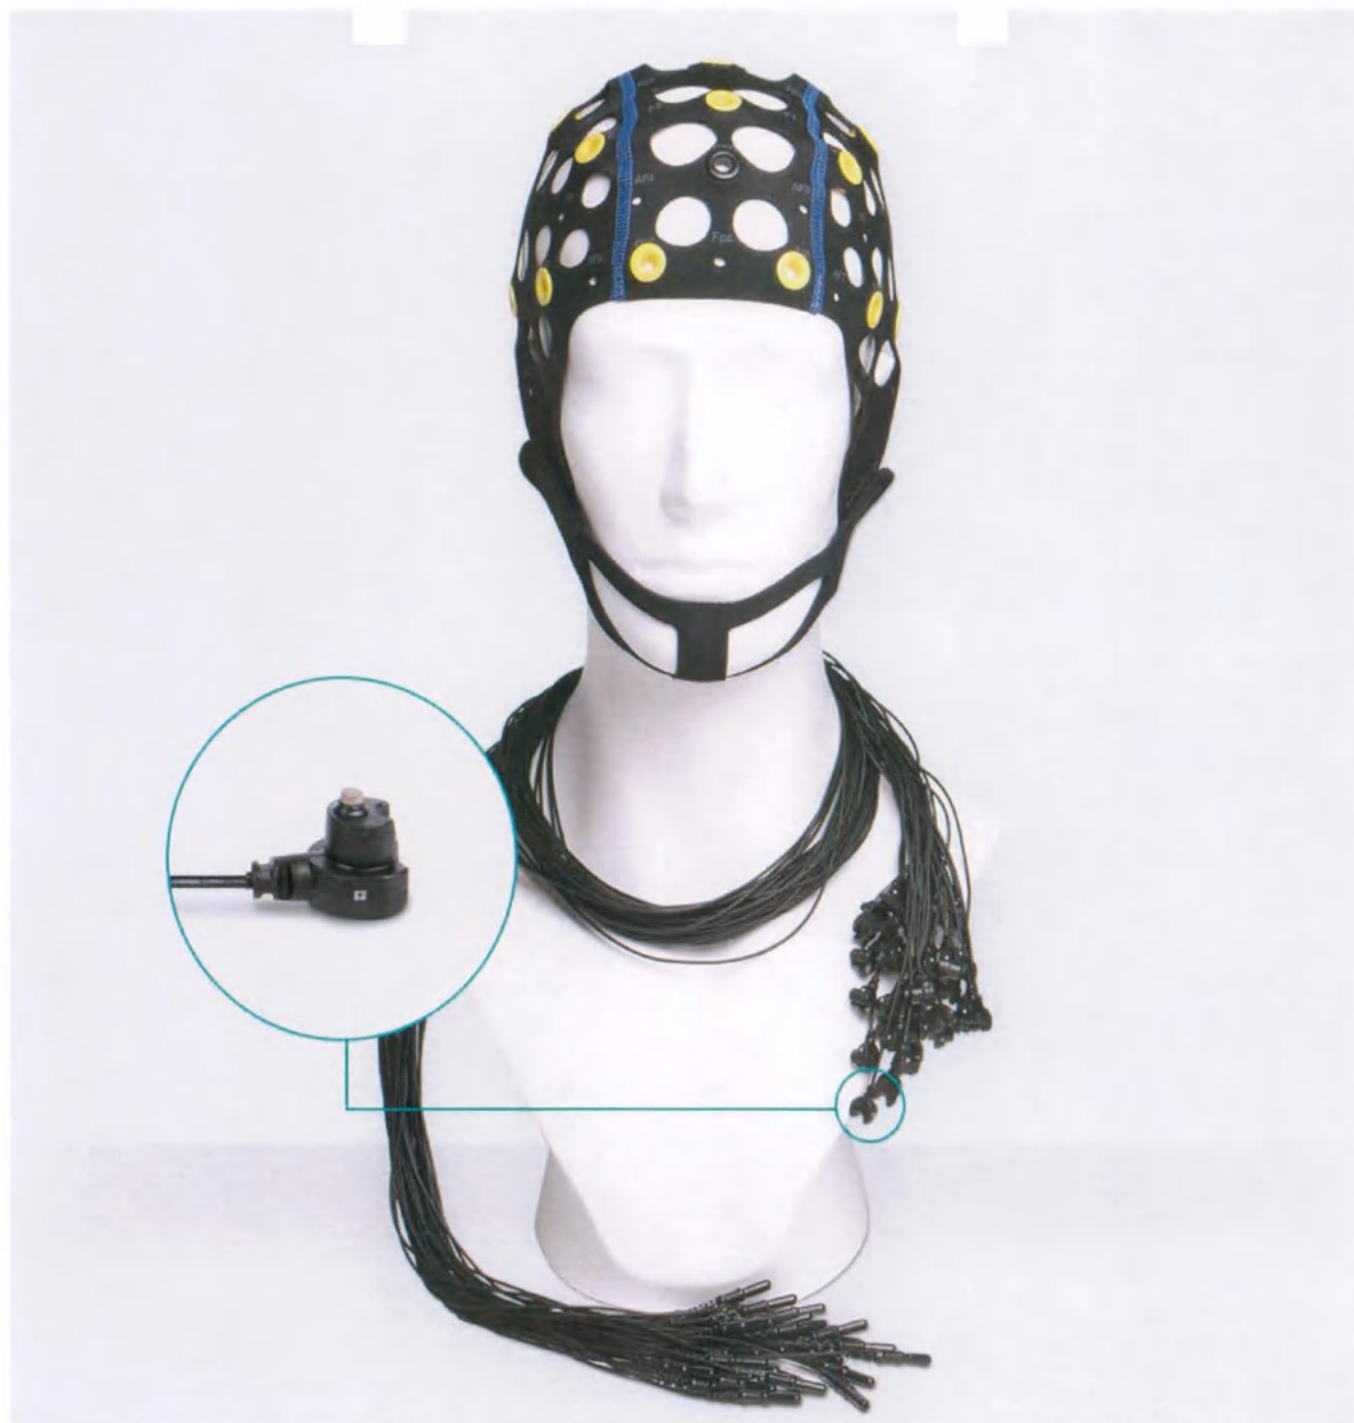

Система электродная электроэнцефалографическая MCScap® по ТУ 26.60.12-053-17635079-2020 в варианте исполнения «MCScap ELECTRODE SET», производства ООО «МКС», Россия, РУ № РЗН 2023/20725

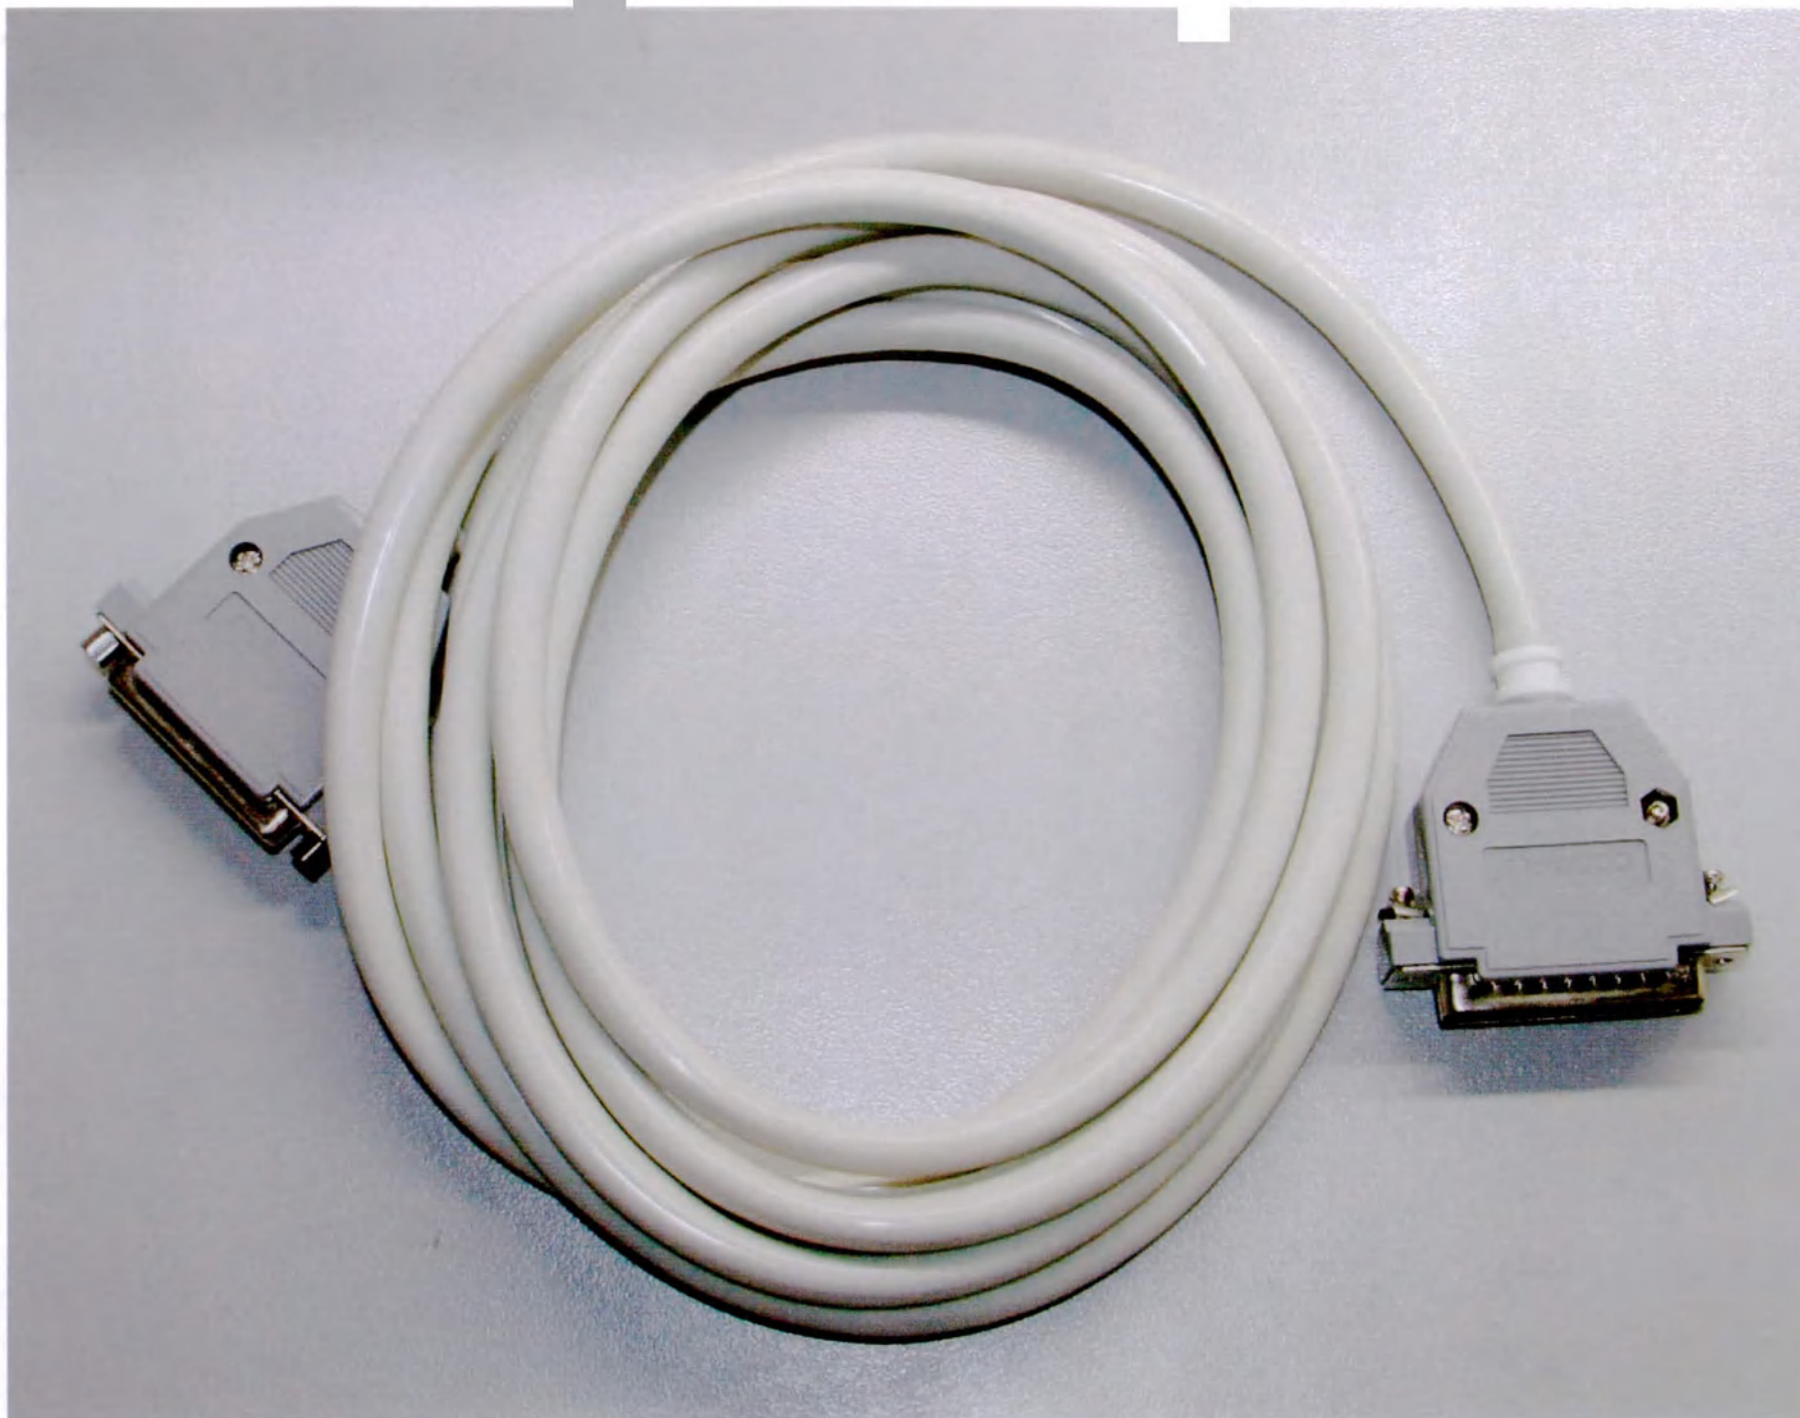

Удлинитель кабеля шапочки ЭЭГ

D-Link

**GIGABIT
SUPPORT**

Ideal for fast
data transfers

For maximum performance

DGS-1005D



5-port 10/100/1000 Unmanaged Switch

Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100/1000 Мбит/с

Gigabit speed for fast
data transfers

Скорость передачи данных до 1000 Мбит/с

Connect up to 5
Ethernet-enabled devices

Поддержка до 5 устройств с поддержкой Ethernet

Quality of Service support for
traffic prioritization

Поддержка QoS для приоритезации трафика

Коммутатор сетевой, 5 портов



Блок пациента для электроэнцефалографов «Нейрон-Спектр-БП/ПСГ» в составе:

блок электронный «Нейрон-Спектр-БП/ПСГ», кабель связи БП/ПСГ «К-5», ремень наплечный, датчик дыхания ДДТ-8/В-10, датчик дыхания ДДТ-8/Д-10, датчик воздушного потока "ДДП-1-05", датчик воздушного потока "ДДД-3-05", датчик храпа "ДХ-1-08", датчик дыхания пьезокерамический с комплектом ремней "ДДП-4-05", датчик индукционный экскурсии грудной клетки и брюшной стенки "ДДИ-1-05" в комплекте с индукционным ремнем и фиксирующей лентой, датчик положения тела "ДПТ-2-05"




Комплект электродов ВП чашечковых с кабелем отведения «ЭВП» (8 шт.): белый, 1 м, зеленый, 1 м, красный, 1 м, черный, 1 м, желтый, 1 м, синий, 1 м, коричневый, 1 м, фиолетовый, 1 м



Объединитель однополярных гнезд для регистрации ВП




Стимулятор зрительный (светодиодные очки)

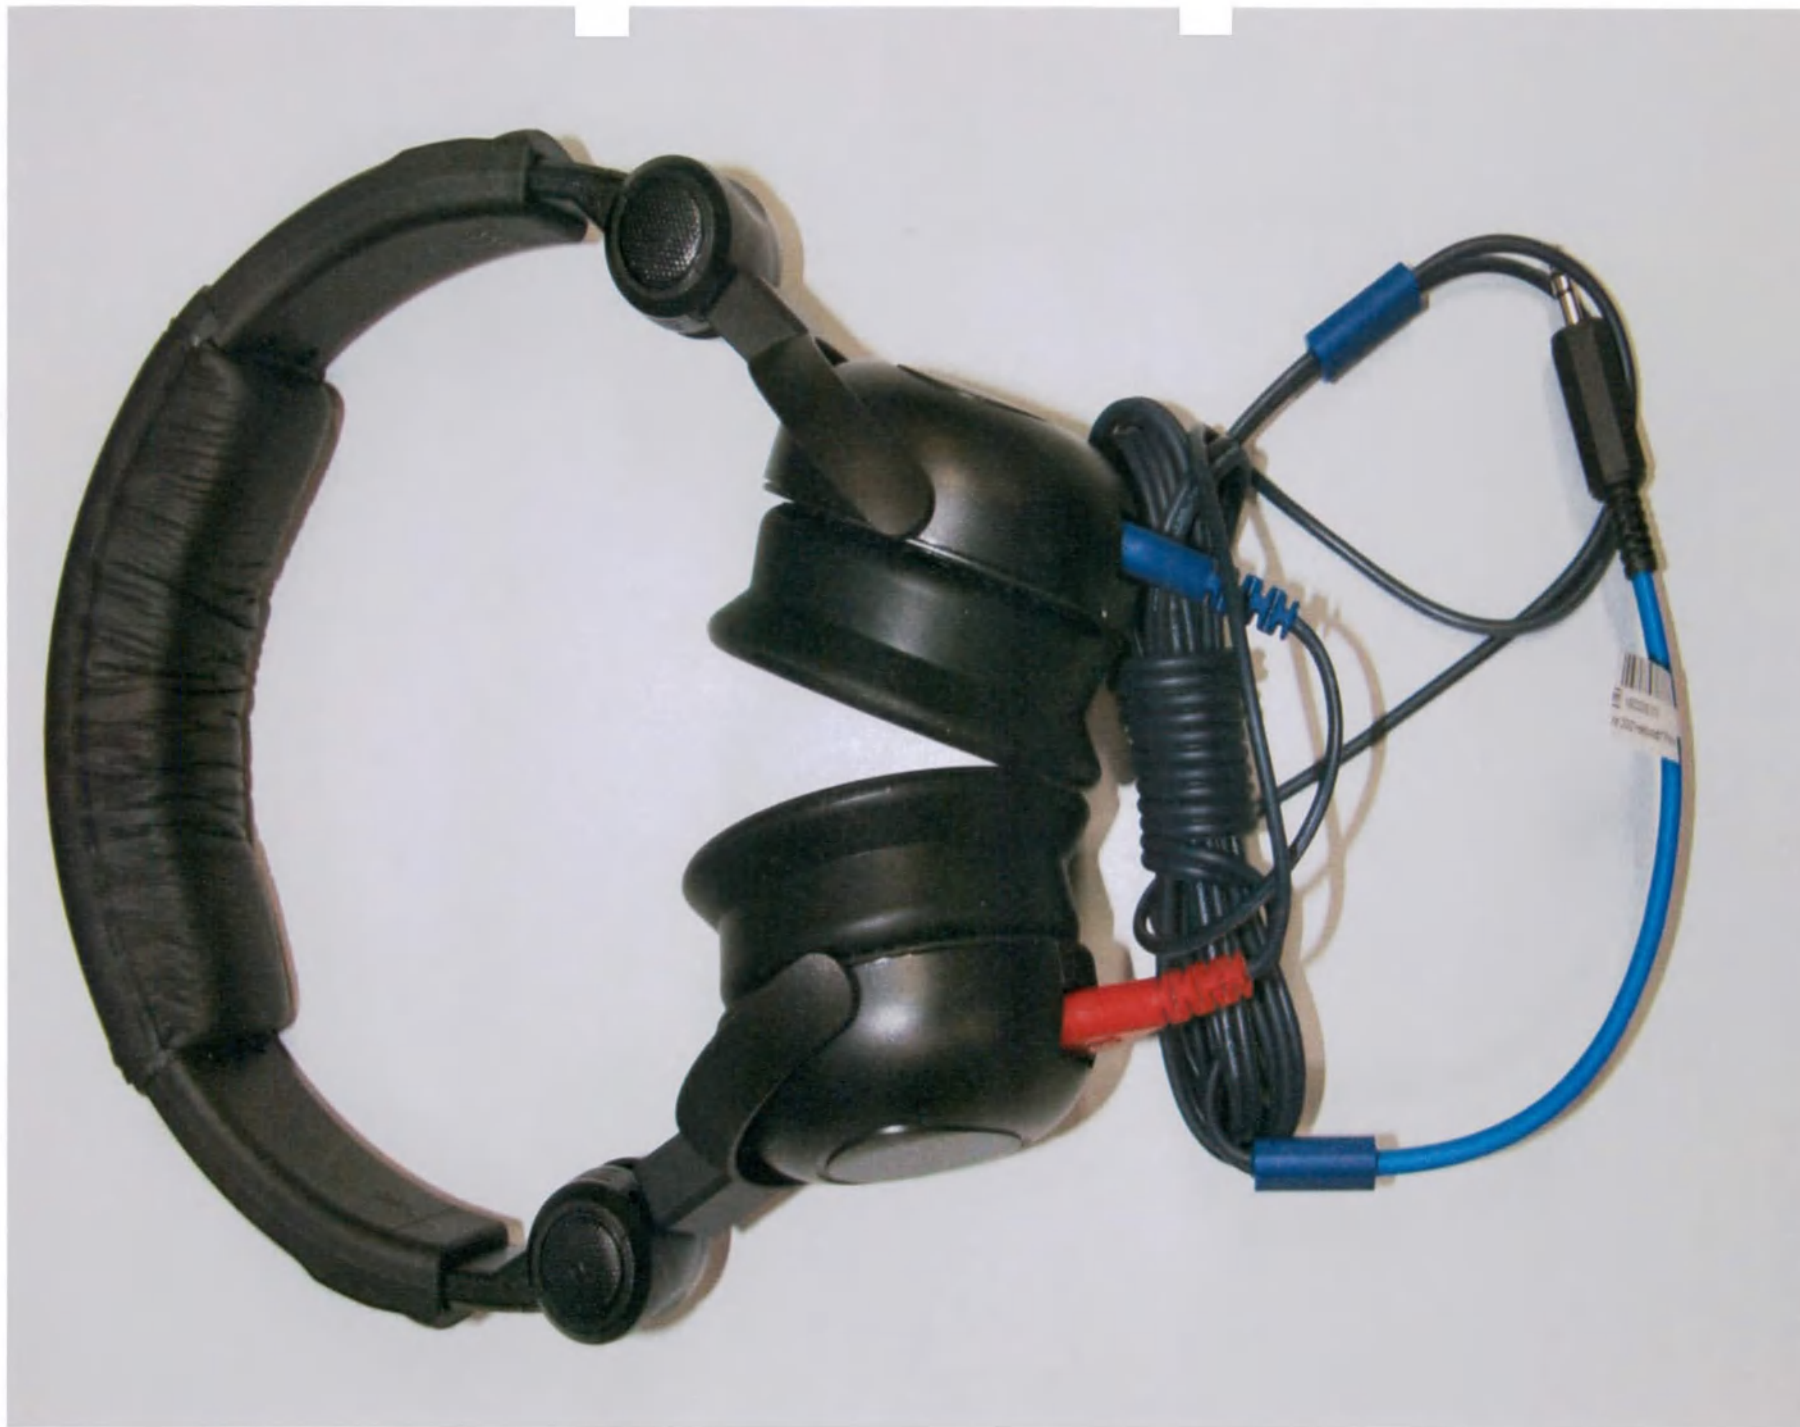

Слуховой стимулятор (аудиометрические наушники) «TDH-39» («HDA-280»)




Адаптер для подключения стандартного паттерн-стимулятора

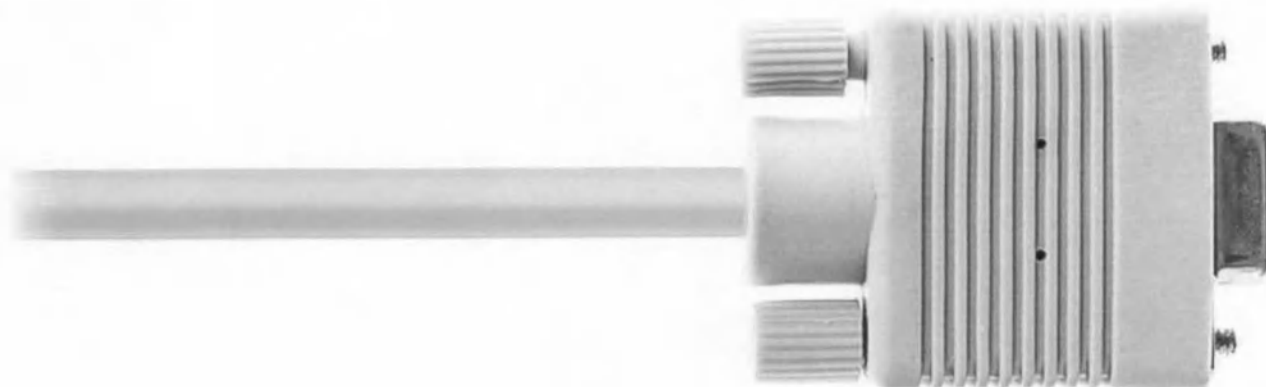

Удлинитель SVGA, 3 м




Кнопка регистрации реакции пациента

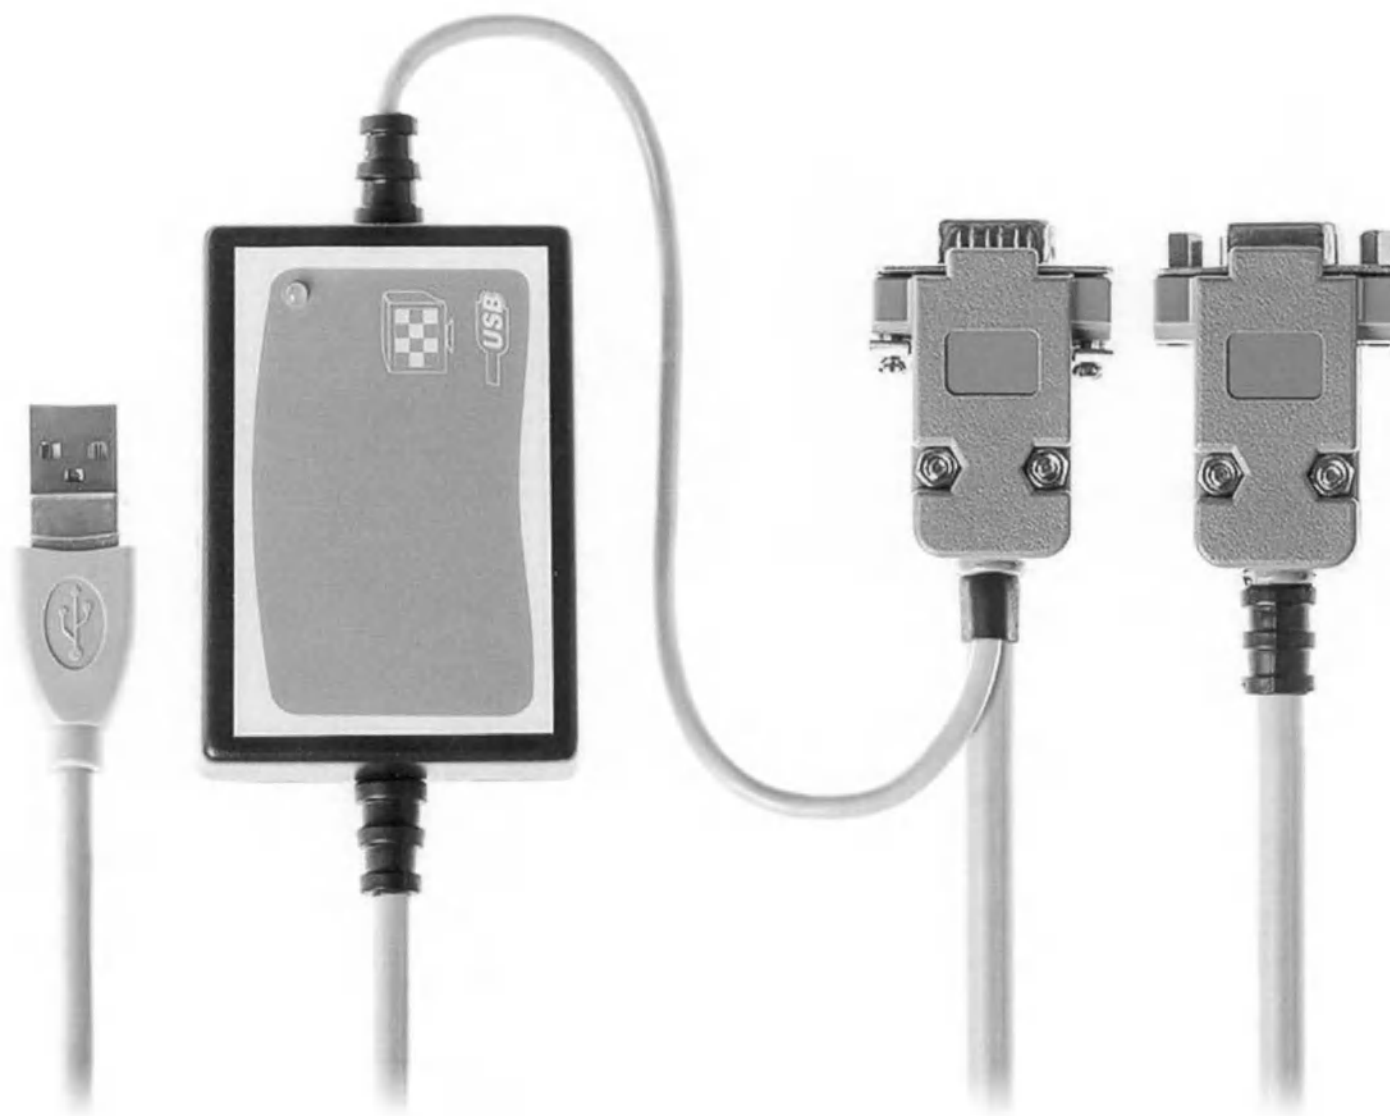


Адаптер для подключения паттерн-стимулятора высокого разрешения



Переходник

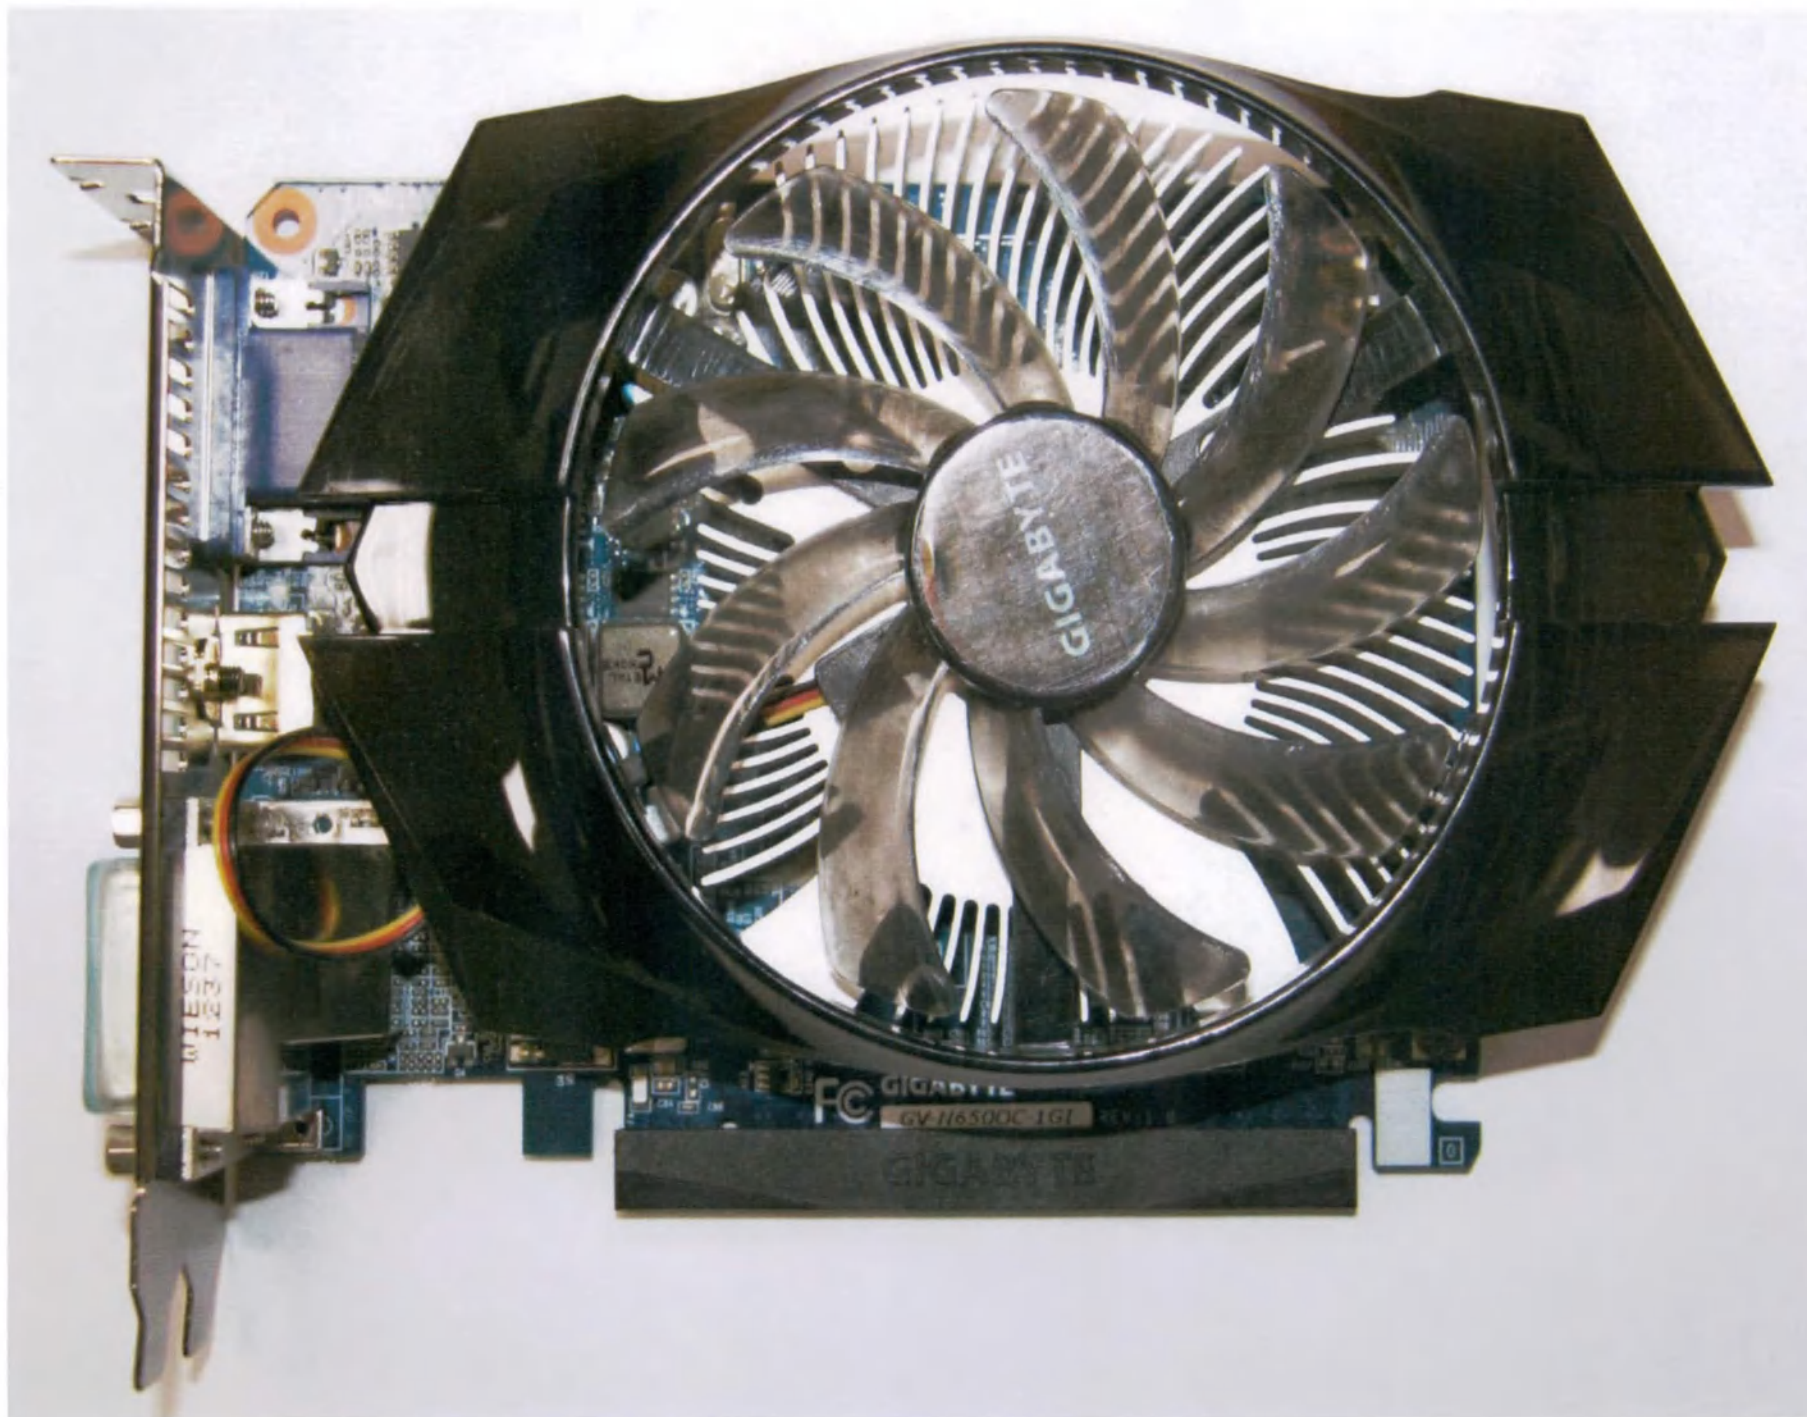

Видеокарта двухмониторная

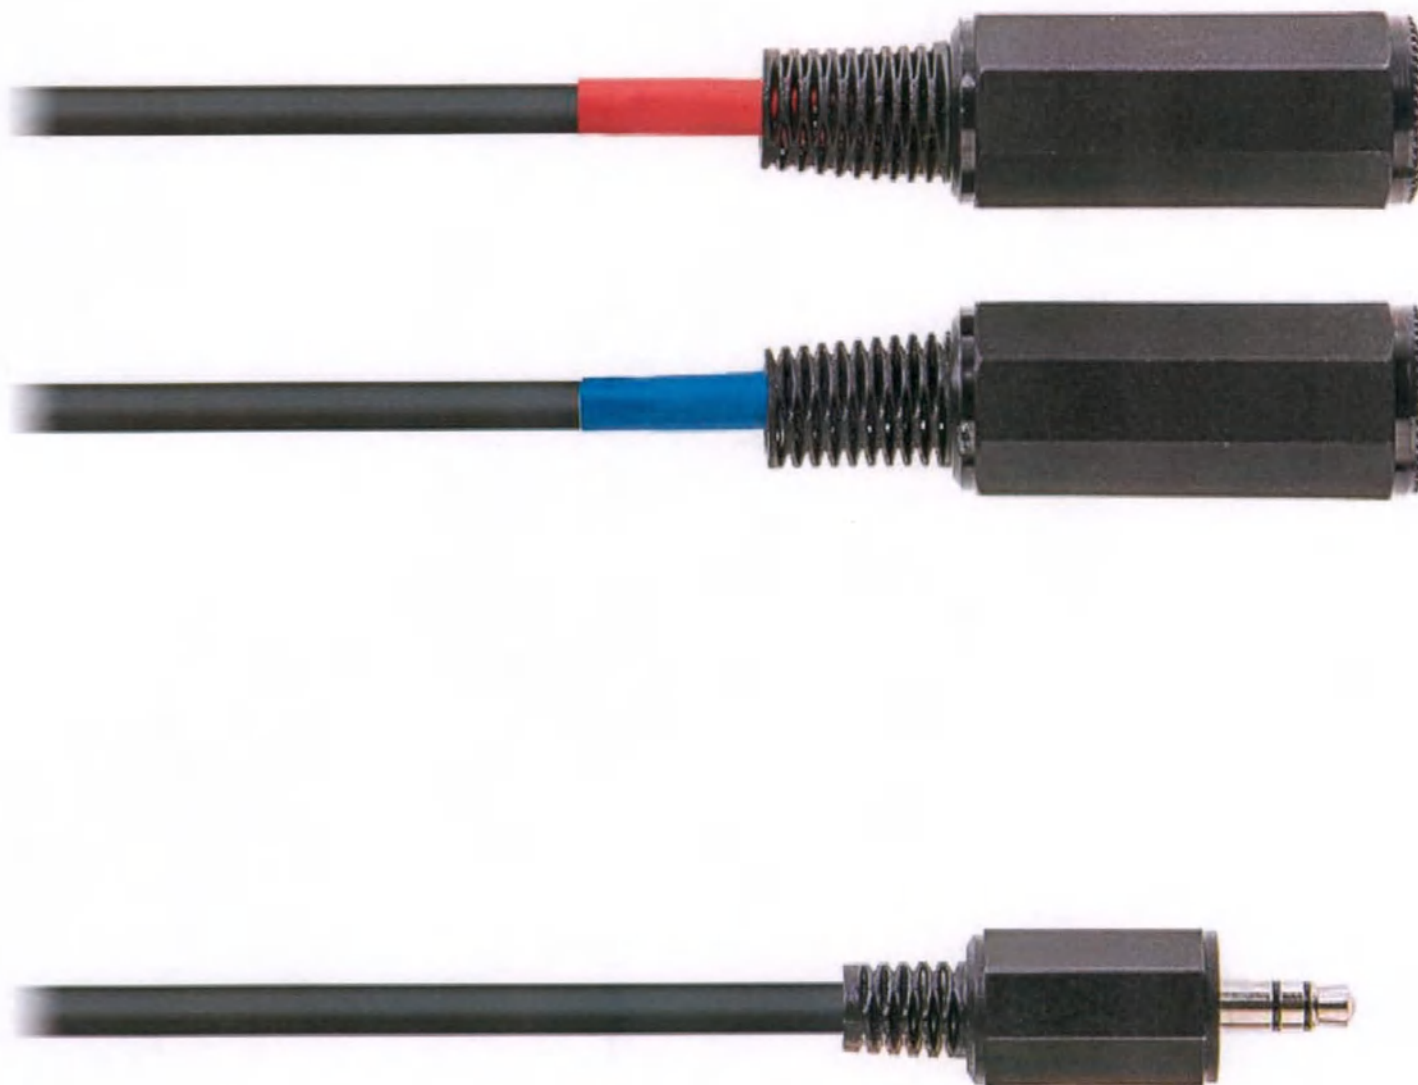

Переходник к телефонам аудиометрическим



Динамометр кистевой, с измерением усиления не менее 50 даН



Прибор для измерения
артериального давления
механический
MT-10



Тонометр механический, диапазон измерения АД от 20 до 300 мм.рт.ст.



Манометр с приставкой для проведения пробы Вальсальвы




Мундштук для проведения пробы Вальсальвы



Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения ЭВП «С1234»



Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, белый (1 м)

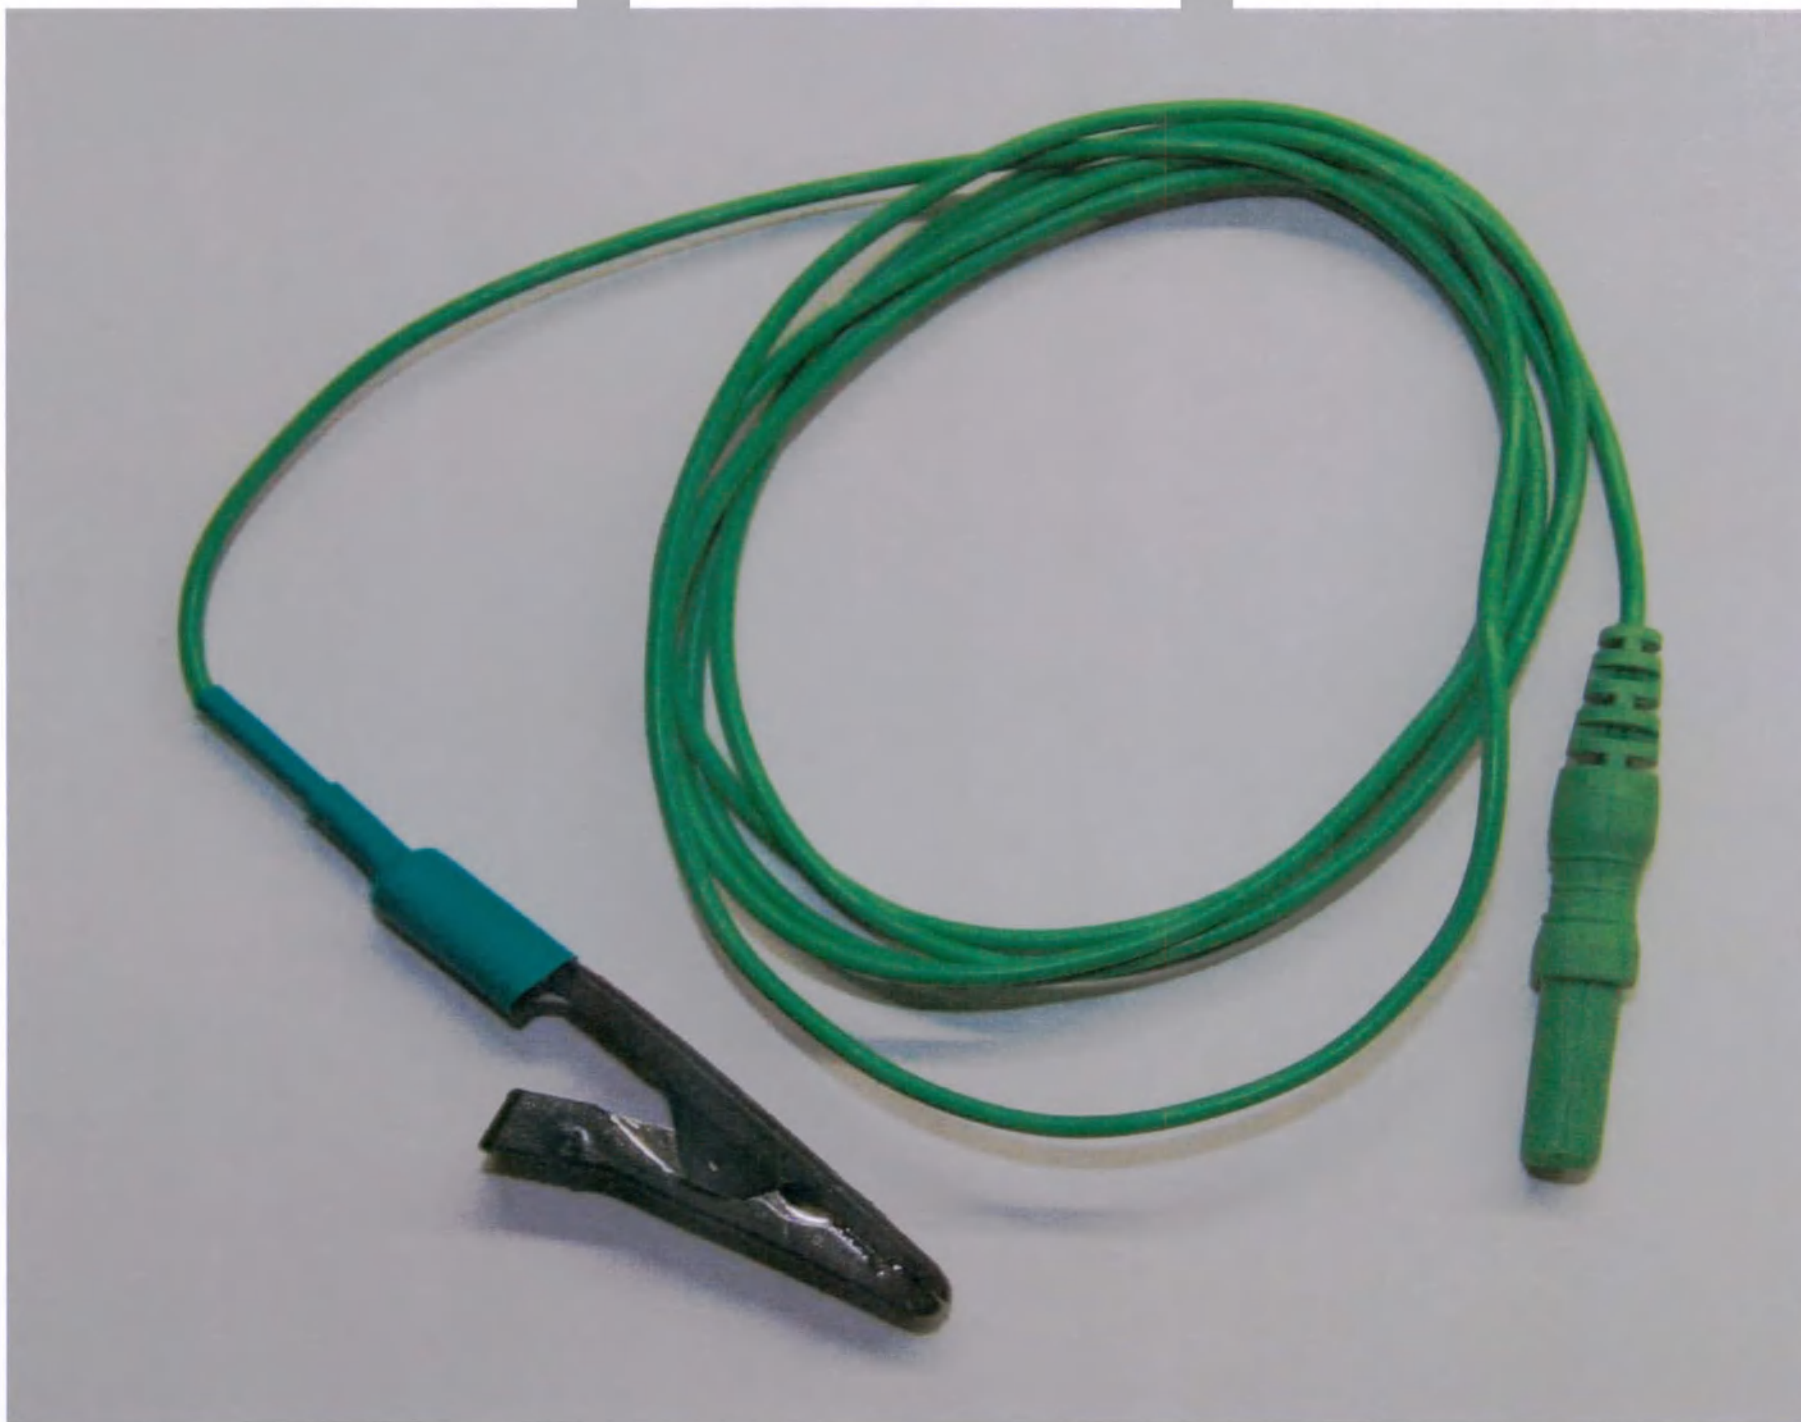

Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, зеленый (1 м)



Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, красный (1 м)



Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, черный (1 м)



Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, желтый (1 м)




Кабель для подключения одноразовых электродов с коннектором «аллигатор», touch-proof, синий (1 м)



Жидкость электродная, предназначенная для обеспечения контакта электрода с кожей пациента



Блок пациента для «Нейрон-Спектр-БП1»

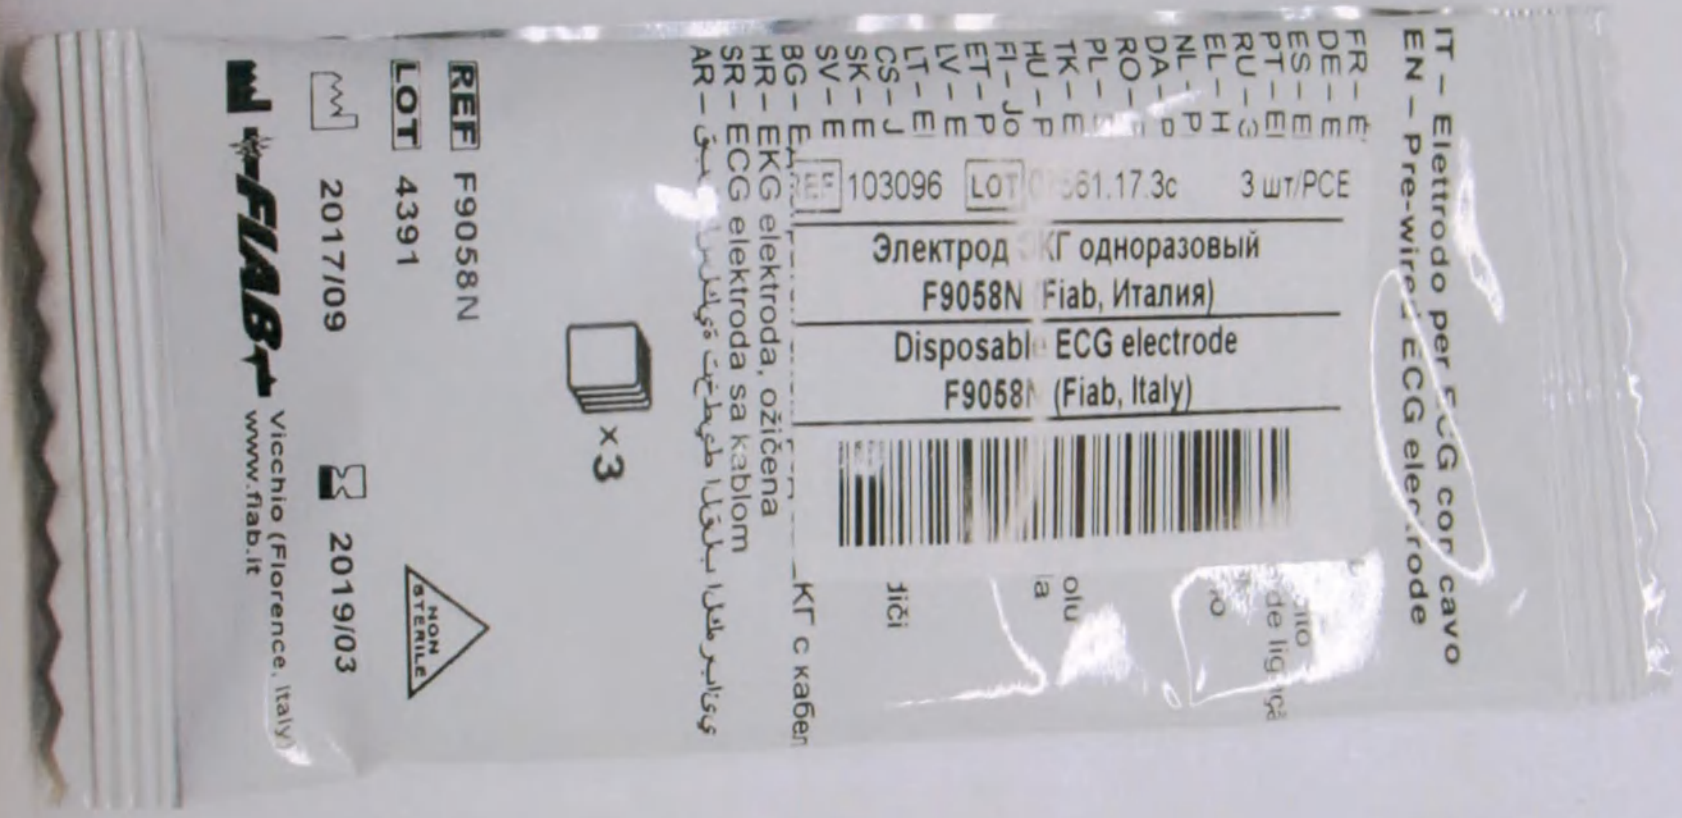


Электрод поверхностный отводящий одноразовый гидрогелевый, разноцветный, длина кабеля не менее 0.5 м, разъем touchproof



Электрод ВП чашечковый с кабелем отведения «ЭВП» (6 шт.) белый, 1 м, зеленый, 1 м, красный, 1 м, черный, 1 м, желтый, 1 м, синий, 1 м



Объединитель однополярных гнезд

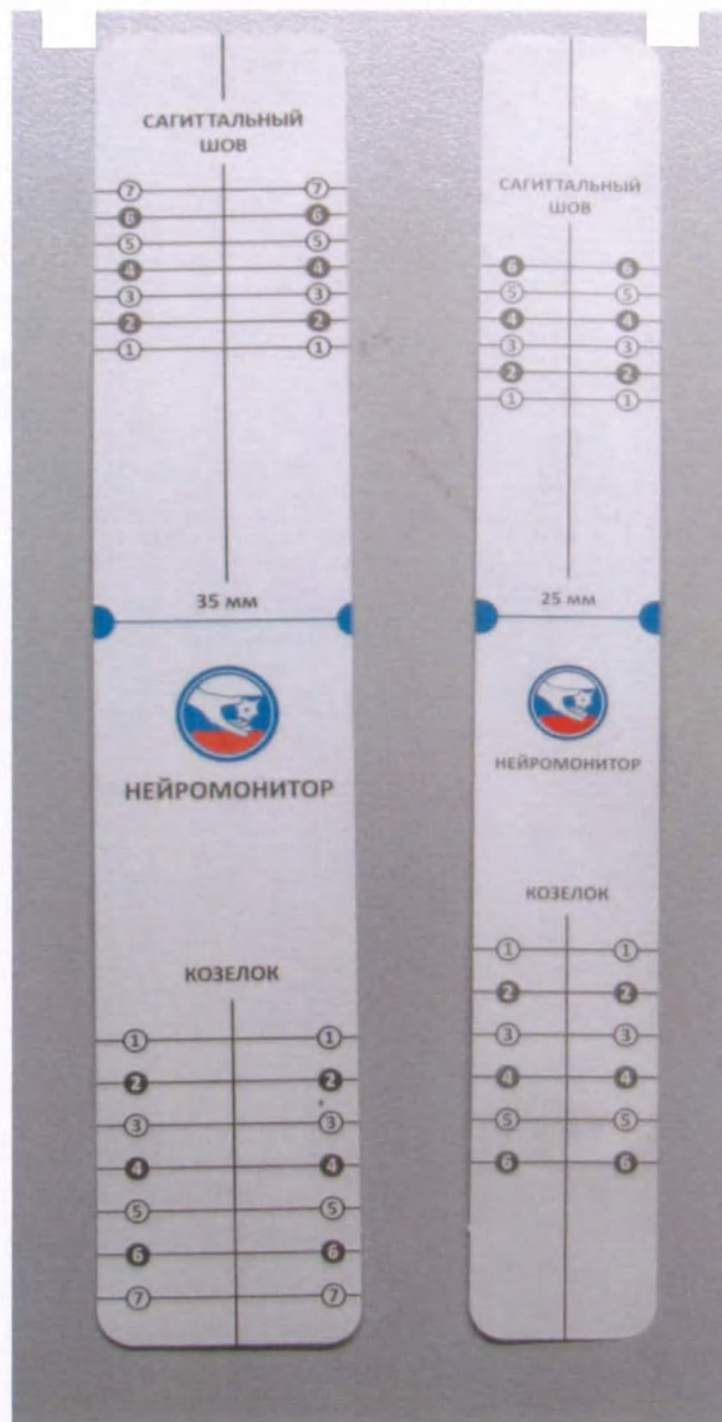

Линейка




Стол-тележка, на колесах с фиксаторами положения, наличие полок минимум в трех уровнях, с креплением

для монитора, тип крепления Vesa, наличие двух креплений для штатива настольного "ШН-5", грузоподъемность не менее 50 кг



Штатив настольный «ШН-5»

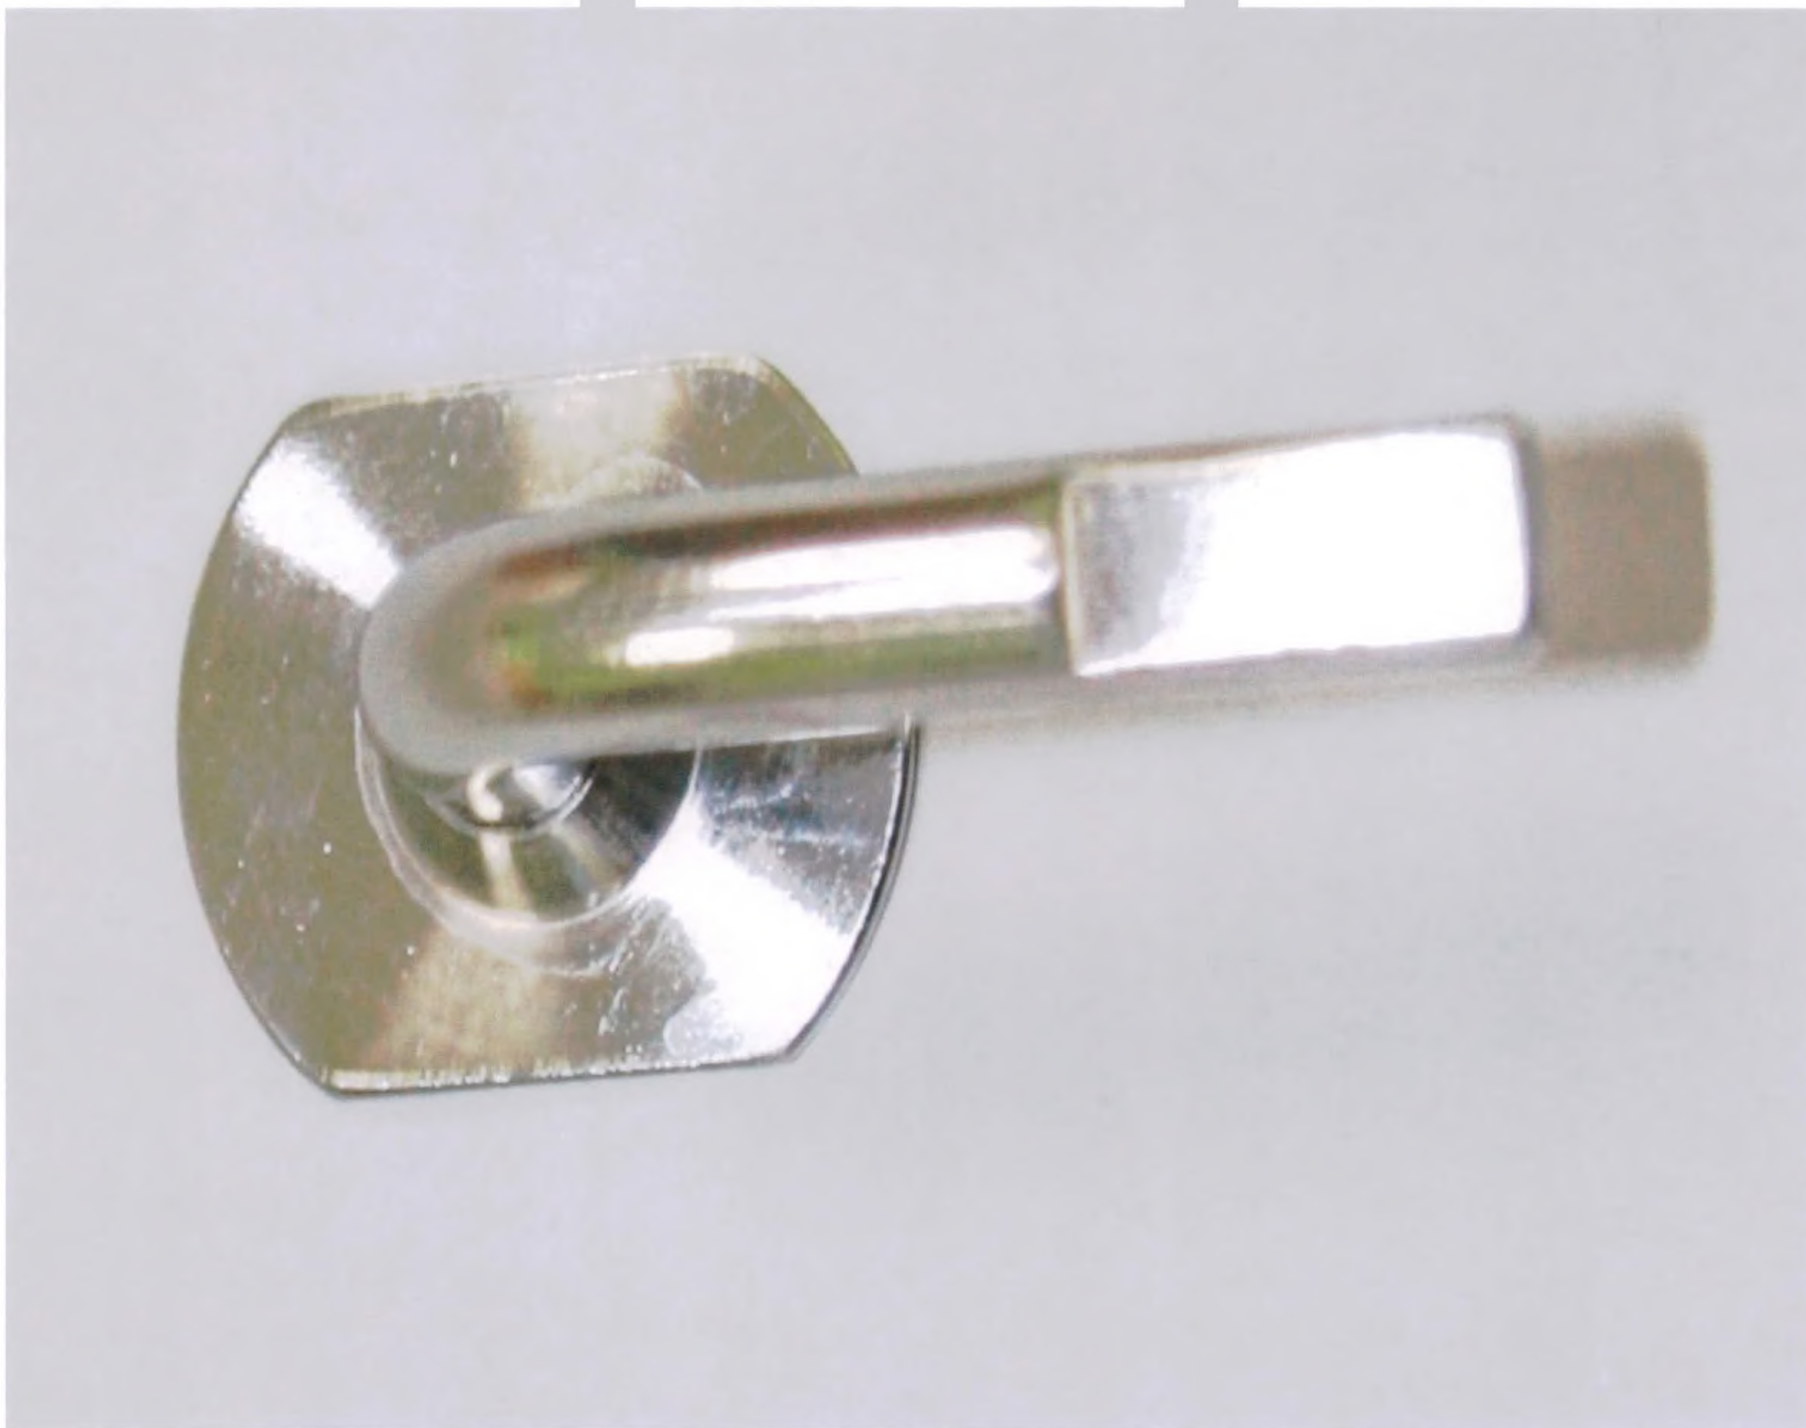

Крепление к штативу



Патч-корд UTP, cat.5E, 4×2, RJ45, длина не менее 5 м



Системный блок «Элитный»



Монитор, LCD 19" и более, наличие крепления VESA, встроенный блок питания, разрешение экрана не менее 1920x1080



Принтер, лазерная или струйная печать, скорость печати не менее 18 стр./мин, максимальный формат печати А4, интерфейс USB 2.0 и выше



Трансформатор сетевой развязывающий TM-630




Кабель питания IEC C14 – Schuko type F socket 220/230 В, 10 А, L не более 1 м, (3G×0,75 кв. мм)




Мобильная мини-стойка, на колесах с тормозами, с полкой и корзиной для принадлежностей, с возможностью изменять

000 ЦИРМИ  INFO@CIRMI.RU  WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU полки, с креплением для монитора или моноблочного компьютера, тип крепления Vesa

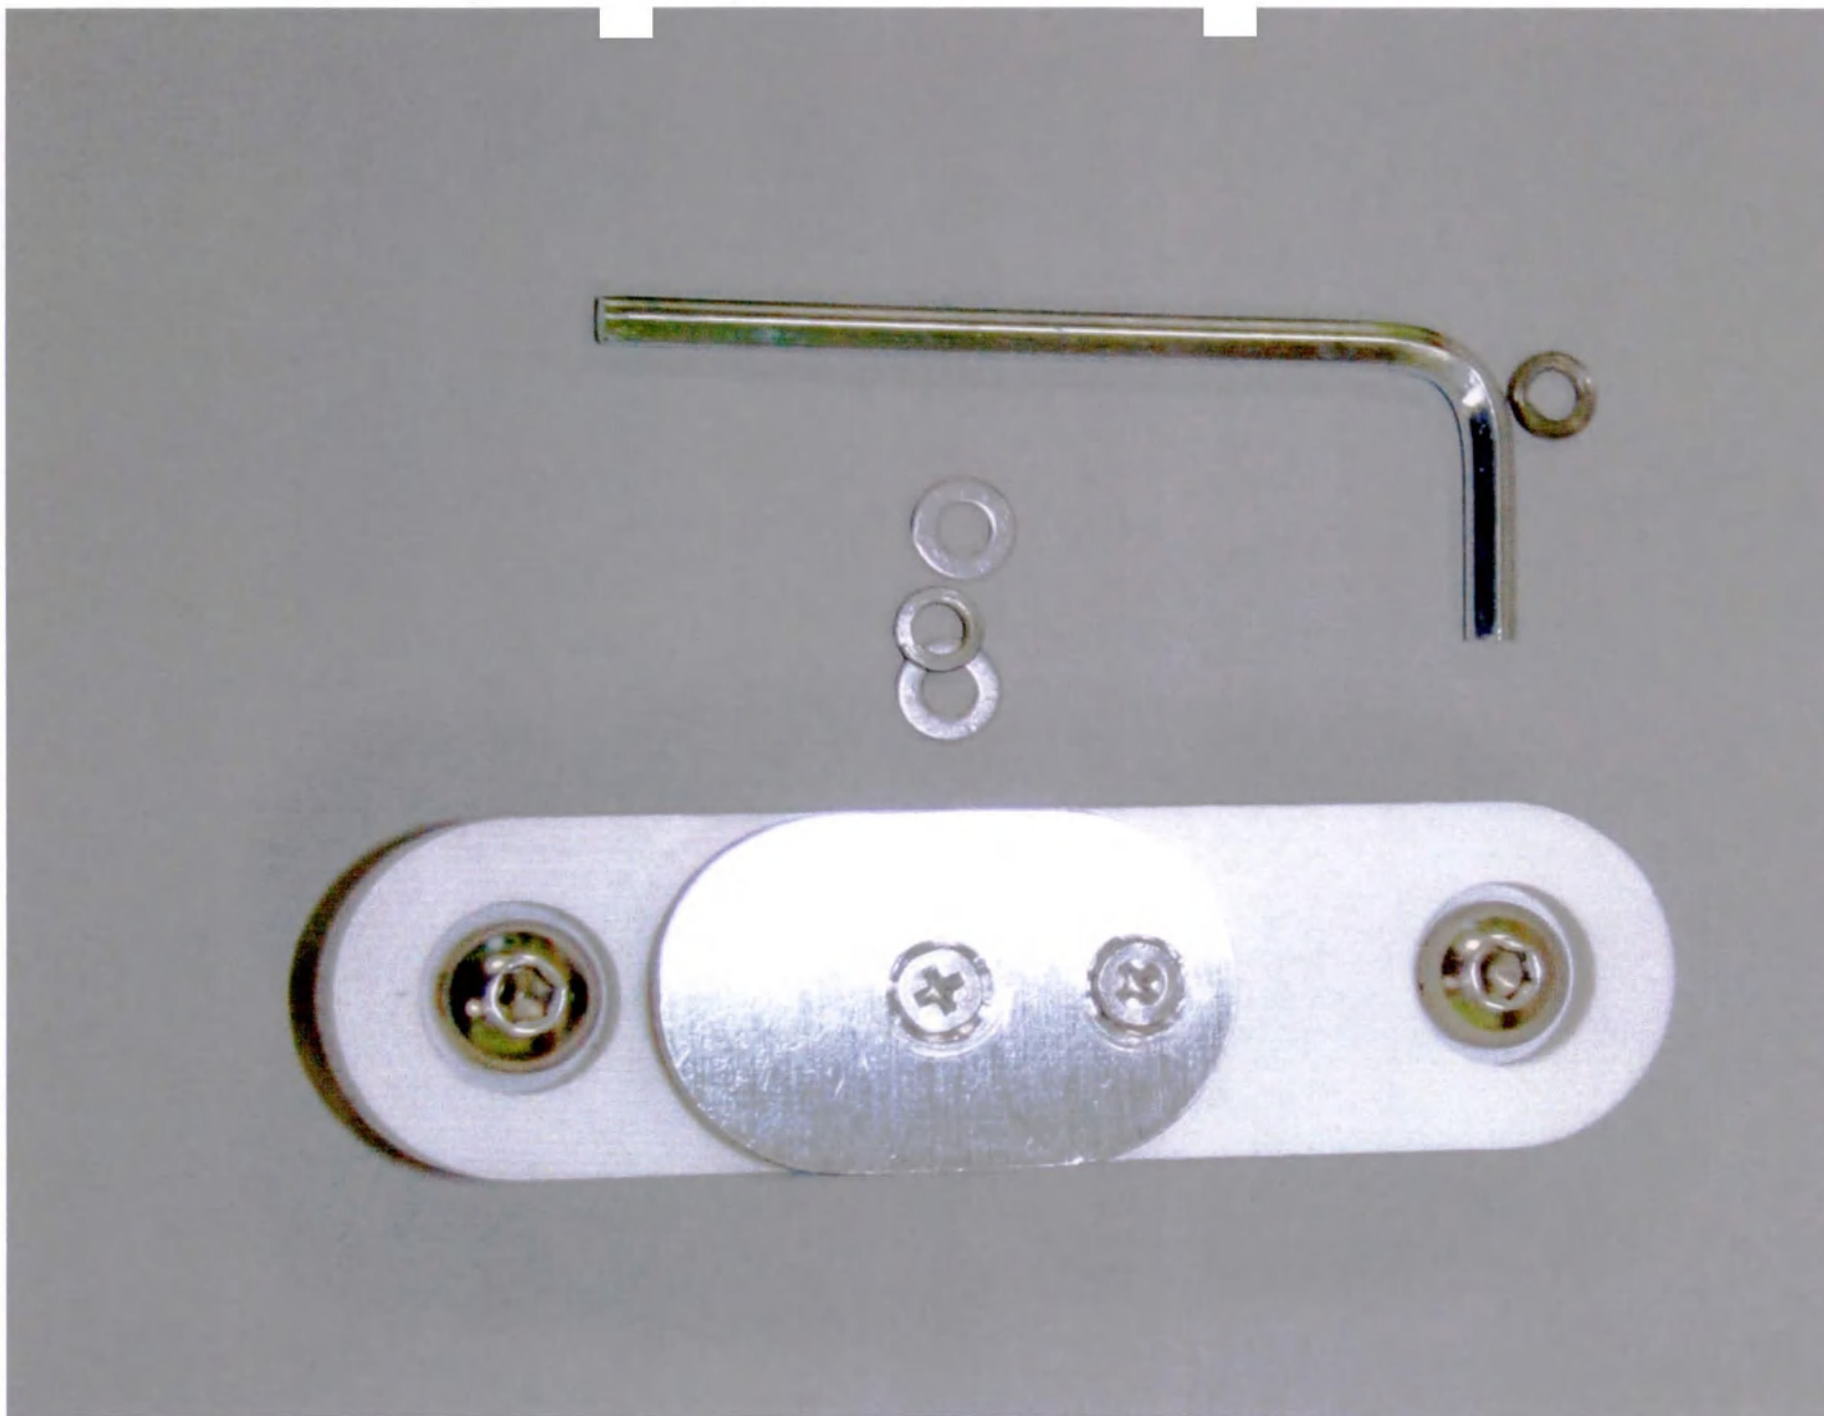

Крепление

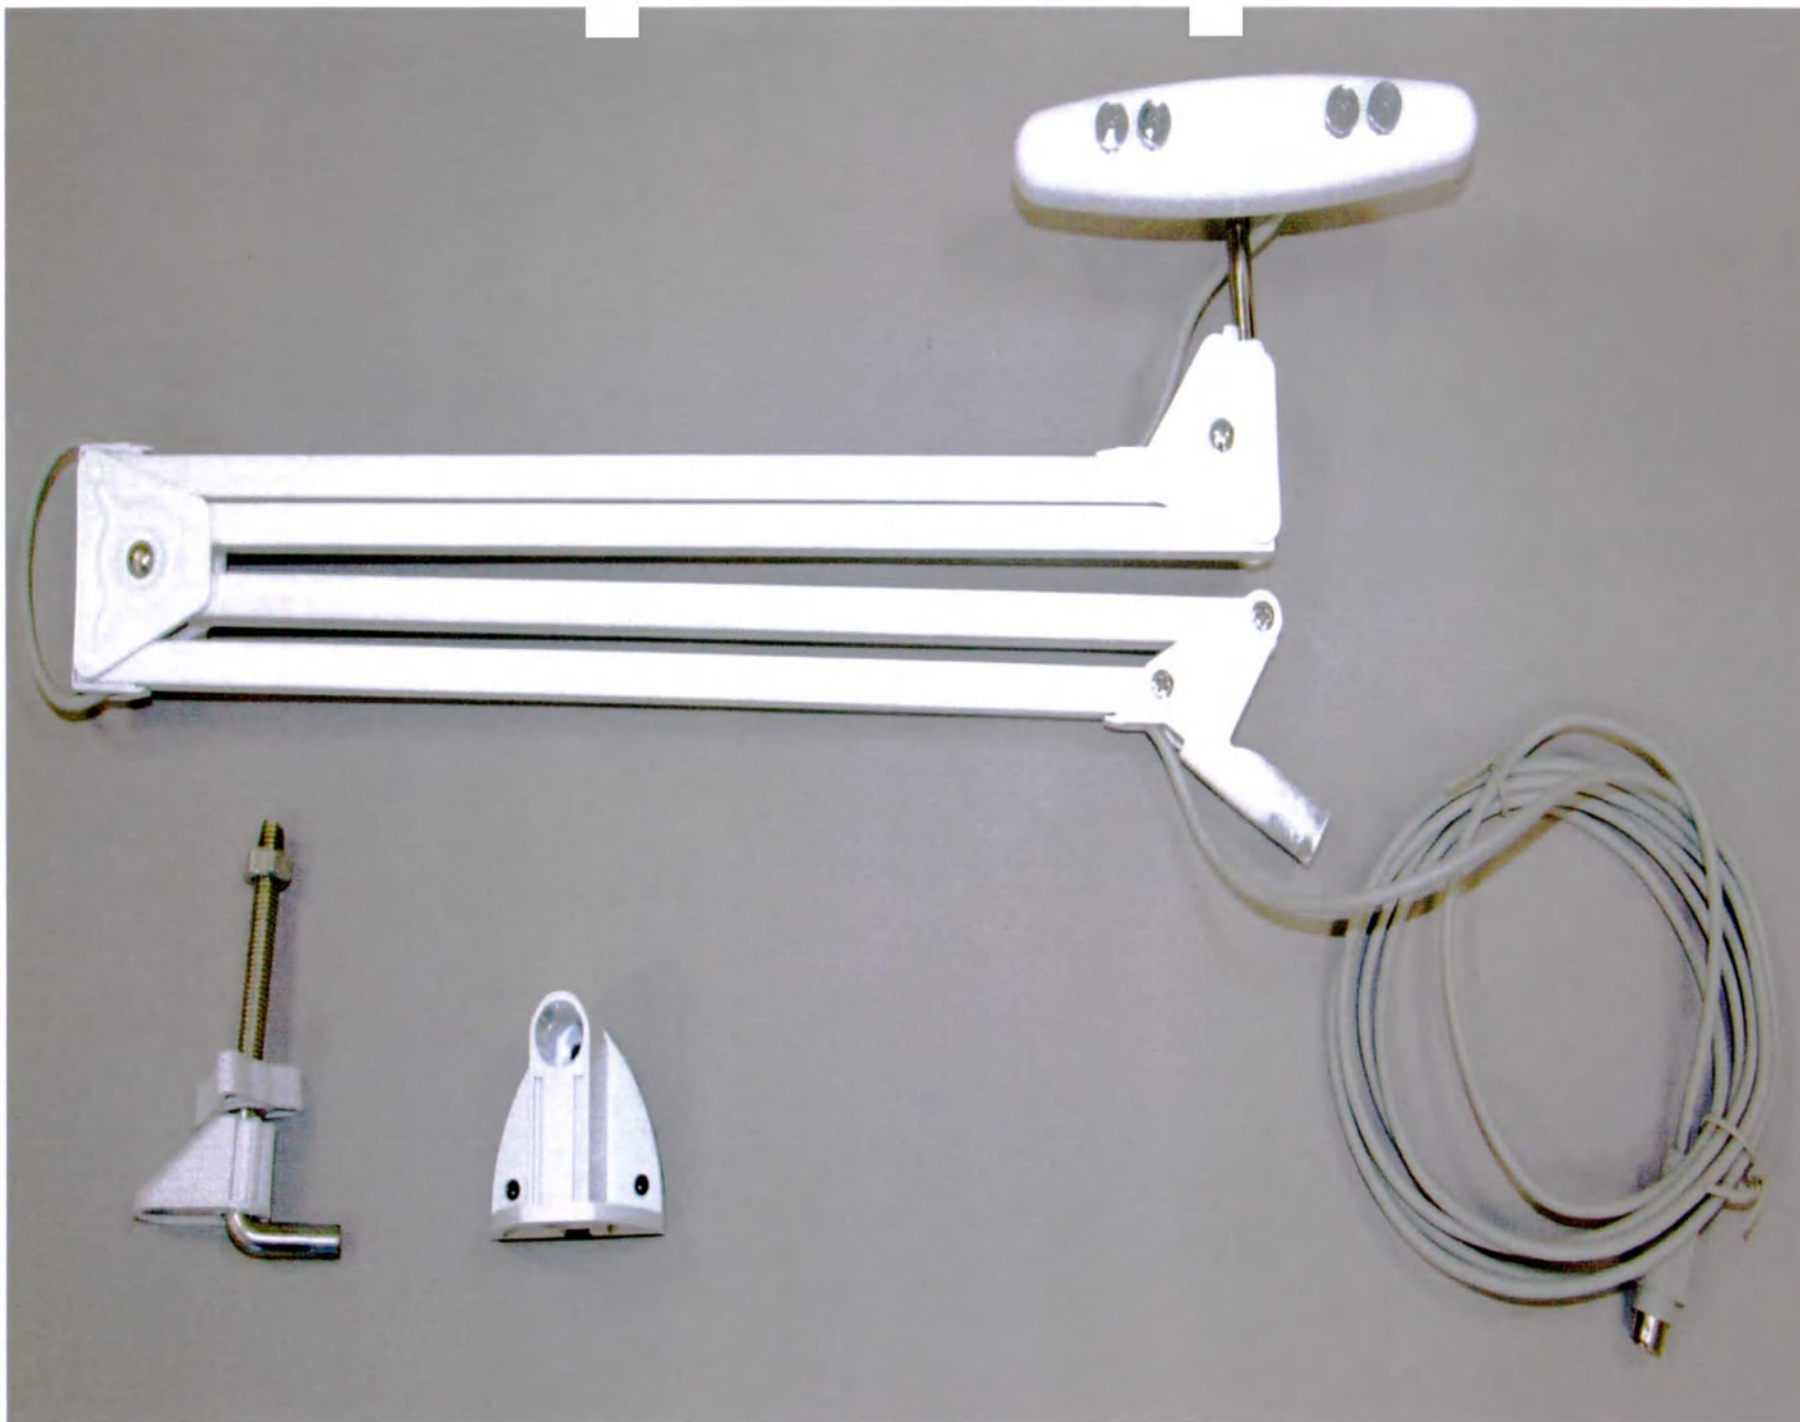

Фотостимулятор светодиодный на штативе «ФС-3»



Патч-корд UTP, cat.5E, 4×2, RJ45, длина не менее 5 м



Моноблок, LCD 17" и более, наличие крепления VESA, встроенный блок питания, разрешение экрана не менее 1920x1080



Кабель питания IEC C14 – Schuko type F socket 220/230 В, 10 А, L не более 1 м, (3G×0,75 кв. мм)



Блок управления токовым стимулятором «Нейро-МВП»



Блок аудиовидеостимулятора «Нейро-МВП»



Портативный компьютер, под управлением операционных систем семейства Microsoft Windows (Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Server 2008, Windows Vista Service Pack 1, Windows XP Service Pack 3), ОС Mac OS X (Mac OS X 10.7 Lion и выше), экран с разрешением не менее 1280×800, процессор не хуже Intel Core Duo с тактовой частотой 1.8 ГГц и выше, оперативная память: 1 Гб и более, свободное место на диске: не менее 1 Гб, наличие USB-порта




Монитор (для паттерн-стимуляции), LCD 18,5", наличие крепления VESA, встроенный блок питания




Специализированный блок питания портативного компьютера



Кабель для проверки параметров токового стимулятора

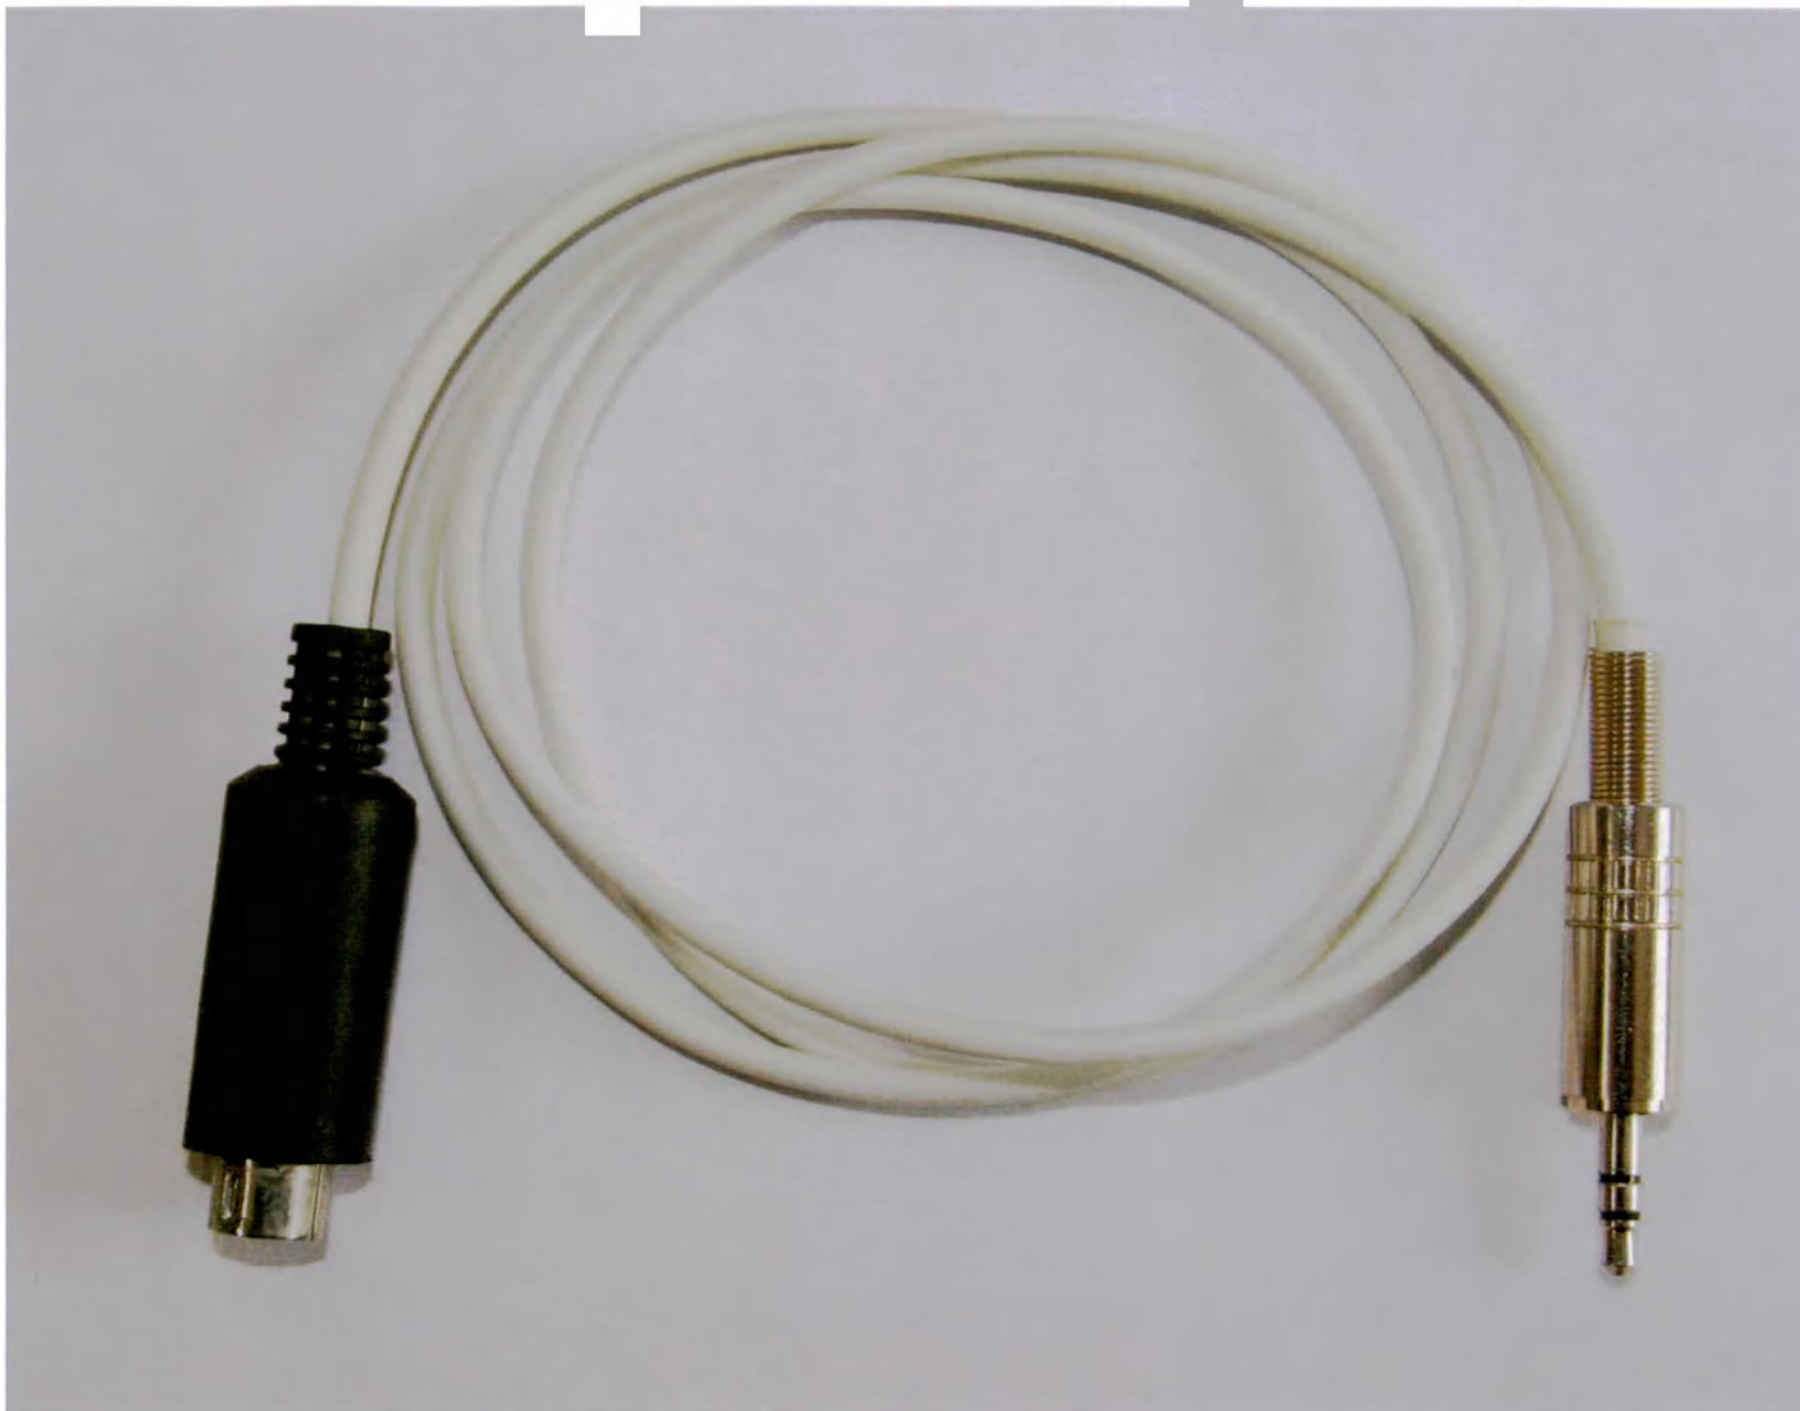


Кабель для проверки параметров фотостимулятора

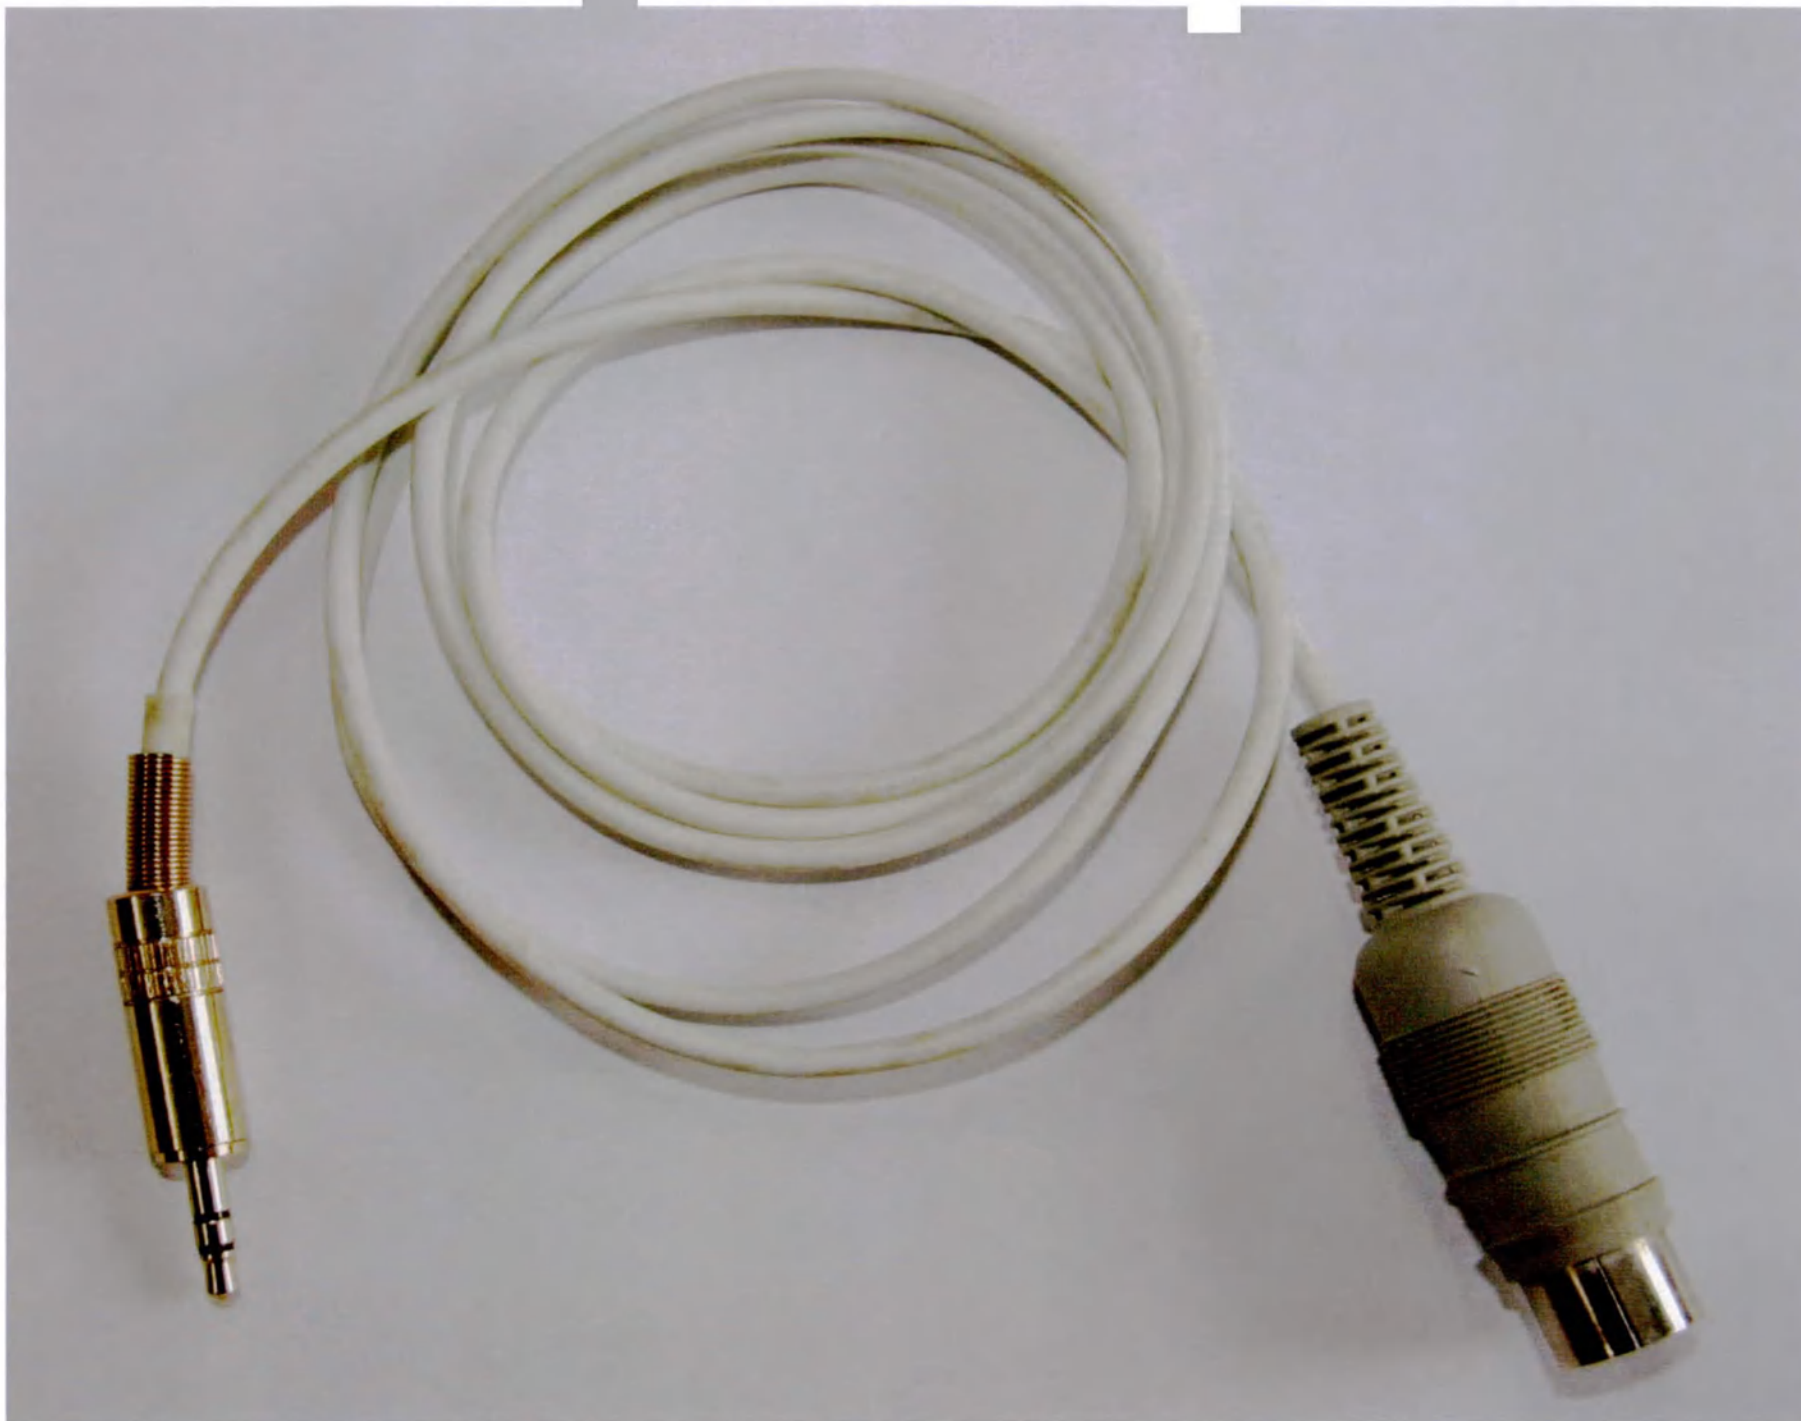

Кабель для проверки параметров слухового стимулятора



Коммутационное устройство для контроля канала SpO2

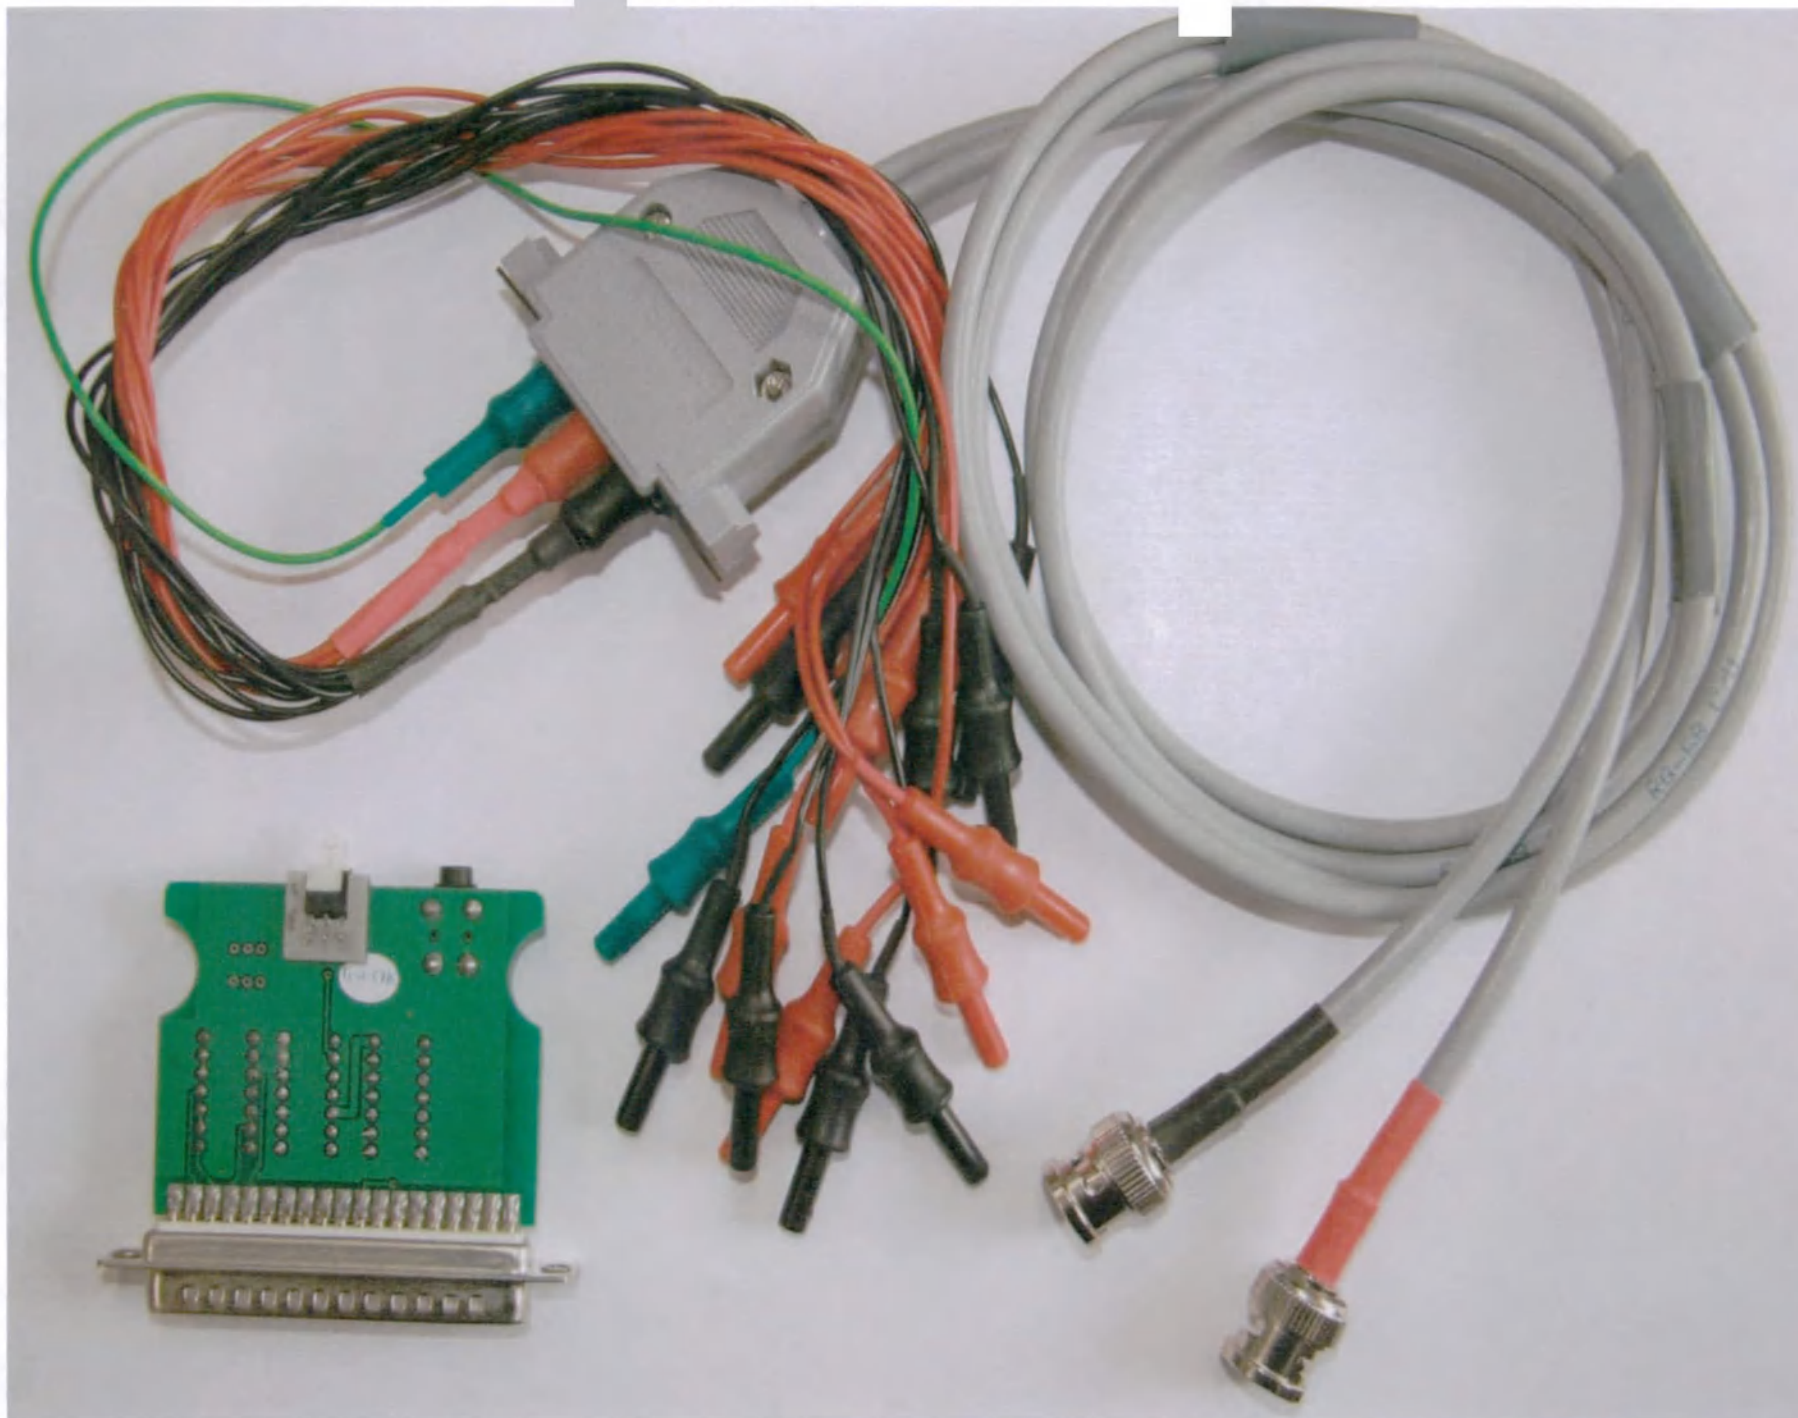

Поверочно-коммутационное устройство «ПКУ-ЭМГ-02»



Комплект упаковочной тары (с сумкой для переноски)



Комплект упаковочной тары (с сумкой для переноски)



Фотографическое изображение медицинского изделия «Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-5" по ТУ 26.60.12-044-13218158-2017» в упаковке.

Нейрон-Спектр-5
Neuron-Spectrum-5

ТУ 26.60.12-044-13218158-2017
РУ № ФСР 2008/03364

Piece #:

1 / 1

Место №

Net weight:

kg

Масса нетто

Gross weight:

kg

Масса брутто

Packed:

2024-07-16

Упаковано

Neurosoft LLC
ООО "Нейрософт"
S, Voronin str., Ivanovo, 153032, Russia
153032, Россия, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5
Pho / Тел.: +7 (4932) 24-04-34, 95-99-99
Fax / Факс: +7 (4932) 24-04-35
info@neurosoft.com, https://neurosoft.com

Only one order / Вложения отсутствуют

LOT 0540024
BN 1807NH



(01)04650075339992
(21)1807NH



Made in Russia
Сделано в России

Фотографическое изображение маркировки медицинского изделия «Комплекс компьютерный

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU. Юнальный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-5" по ТУ 26.60.12-044-13218158-2017».

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЮ НА 181 ЛИСТАХ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА

ООО «НЕЙРОСОФТ»

Н. К. МАЛАМАНТ

НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ

№59/2024 ОТ 12.01.2024





Нейрософт

www.neurosoft.com, info@neurosoft.com

Телефоны: +7 4932 24-04-34, +7 4932 95-99-99


Факс: +7 4932 24-04-35

Россия, 153032, г. Иваново, ул. Воронина, д. 5

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель президента
ООО "Нейрософт"



 И.К. Маламант

"06" сентября 2024 г.

**Комплекс компьютерный многофункциональный
для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-5"
по ТУ 26.60.12-044-13218158-2017**

Макеты маркировки

На рисунке 1 приведен актуальный макет маркировки медицинского изделия «Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-5" по ТУ 26.60.12-044-13218158-2017».

Нейрон-Спектр-5		LOT XXXXXXXX
Neuron-Spectrum-5		SN XXXXXXXX
ТУ 26.60.12-044-13218158-2017		
РУ № ФСР 2008/03364		
Piece #:	1 / 1	
Место №		
Net weight:	kg	(01)04650075339992
Масса нетто		(21)XXXXXXXXXX
Gross weight:	kg	
Масса брутто		
Packed:	20XX-XX-XX	
Упаковано		
 Neurosoft LLC ООО "Нейрософт"		
5, Voronin str., Ivanovo, 153032, Russia		
153032, Россия, г.Иваново, ул.Воронина, д. 5		
Pho / Тел.: +7 (4932) 24-04-34, 95-99-99		
Fax / Факс: +7 (4932) 24-04-35		
info@neurosoft.com, https://neurosoft.com		
Only one order / Вложения отсутствуют		Made in Russia Сделано в России

Рисунок 1 – Макет маркировки медицинского изделия «Комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ "Нейрон-Спектр-5" по ТУ 26.60.12-044-13218158-2017».

Расшифровка значений символов на маркировке:

-  – серийный номер
-  – код партии
-  – наименование и адрес производителя

ПРОШНУРОВАНО, ПРОНУМЕРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ НА 2 ЛИСТАХ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА
ООО - НЕЙРОСОФТ -
И. К. МАЛАМАНТ
НА ОСНОВАНИИ ДОВЕРЕННОСТИ
№59/2024 ОТ 12.01.2024

