

Утверждаю

Генеральный директор

ООО «РАПИД БИО»

А. Ц. Жимбиев

«15» августа 2024 г.



Образцы маркировки медицинского изделия


Набор реагентов

«Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического
стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека
методом иммунохроматографического анализа
«РАПИД-Стрептококк-А-ИХА»
для диагностики *in vitro*»
по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024

1) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА» для диагностики in vitro» по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024, Комплект №1:



2) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА» для диагностики *in vitro*» по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024, Комплект №2:

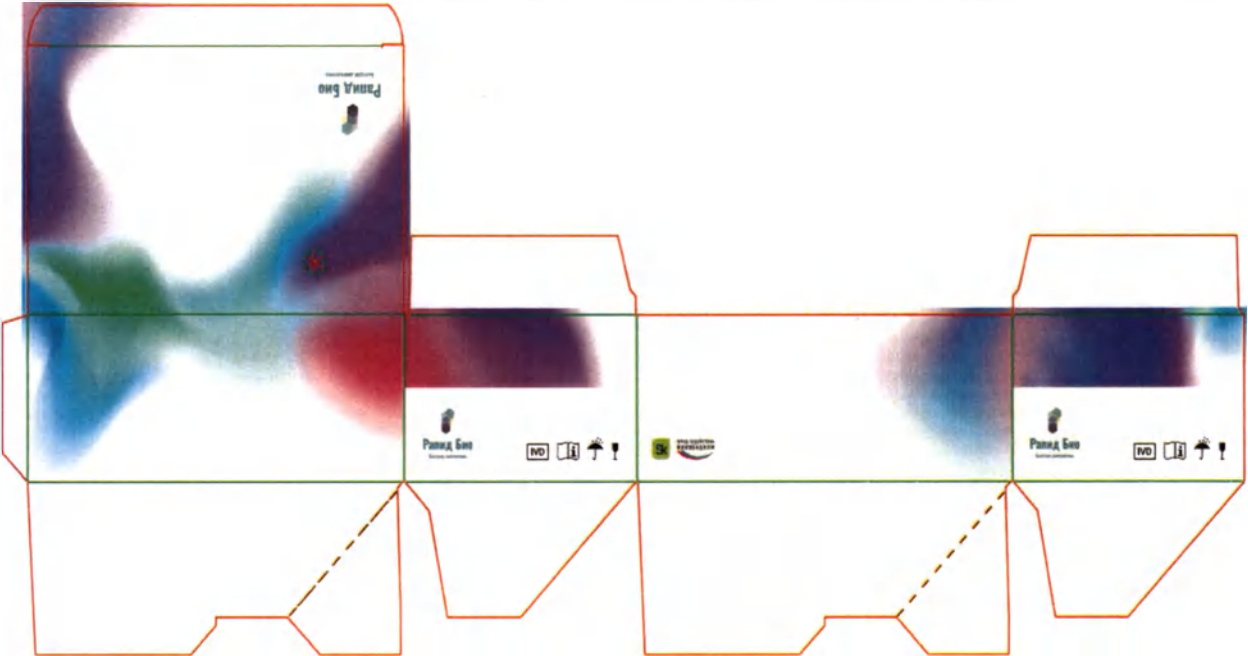

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

Набор реагентов
«Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА» для диагностики *in vitro*» по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024
Комплект №2

Состав набора:

- Тест-картридж с осушителем	20 шт.	ТЕСТ
- Флакон-капельница с раствором 1 (9,0 мл)	1 шт.	
- Флакон-капельница с раствором 2 (7,0 мл)	1 шт.	
- Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей	20 шт.	
- Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала (Зонд-тампон медицинский одноразовый, стерильный, РУ № ПЗН 2022/18561)	20 шт.	
- Подставка для пробирок	1 шт.	
- Положительный контроль (0,5 мл)	1 шт.	
- Отрицательный контроль (0,5 мл)	1 шт.	
- Инструкция по применению	1 шт.	

Для профессионального применения!

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

ТУ 21.20.23-021-44090553-2024 РУ № ПЗН XXX от XXX г.

Штрих-код продукта

REF

LFA001.02

LOT

LFAZ24B01


2024-02

2026-02

ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4, www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.

3) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА» для диагностики *in vitro*» по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024, Комплект №3:

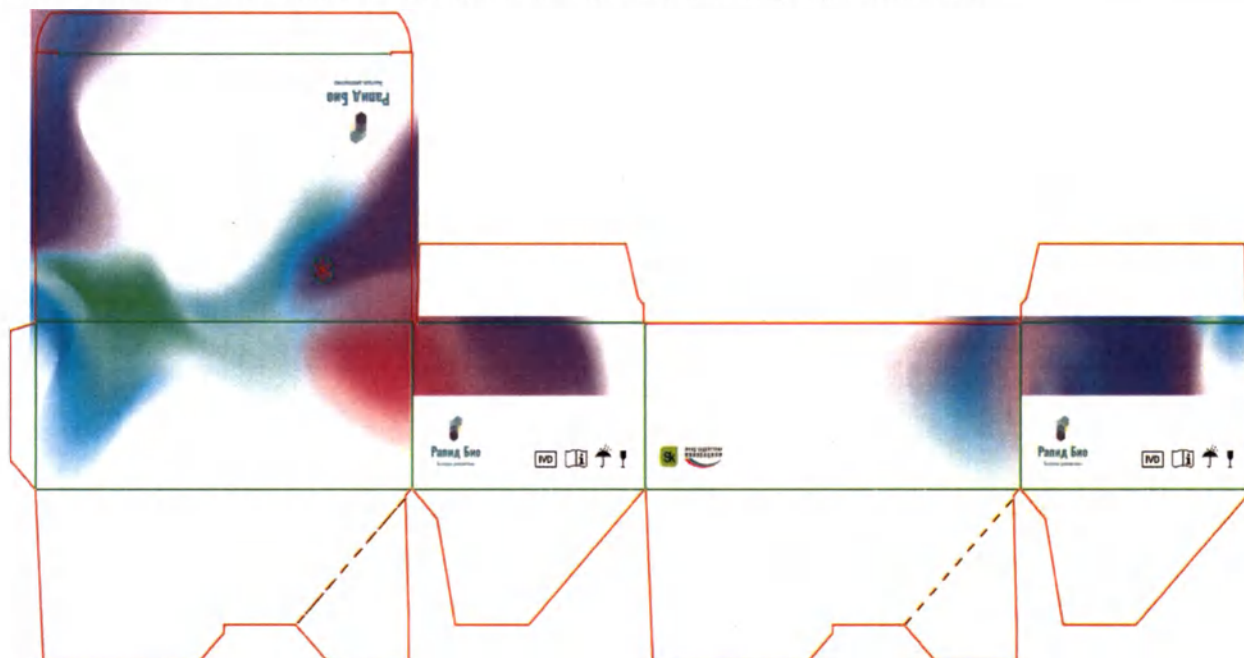

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

Набор реагентов
«Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА» для диагностики *in vitro*» по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024
Комплект №3


Состав набора:

- Тест-картридж с осушителем	20 шт.	ТЕСТ
- Флакон-капельница с раствором 1 (9,0 мл)	1 шт.	
- Флакон-капельница с раствором 2 (7,0 мл)	1 шт.	
- Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей	20 шт.	
- Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала (Зонд-тампон медицинский одноразовый, стерильный, РУ № РЗН 2022/18561)	20 шт.	
- Шпатель медицинский, стерильный (Шпатель медицинский деревянный, стерильный по ТУ 32.50.13.190-001-21345855-2017, РУ № РЗН 2017/5418)	20 шт.	
- Подставка для пробирок	1 шт.	
- Положительный контроль (0,5 мл)	1 шт.	
- Отрицательный контроль (0,5 мл)	1 шт.	
- Инструкция по применению	1 шт.	

Для профессионального применения!

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

ТУ 21.20.23-021-44090553-2024 РУ № РЗН XXX от XXX г.




REF LFA001.03

LOT LFAZ24B01

2024-02

2026-02



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4, www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.

5

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ СТРЕПТОКОКК А

Набор реагентов "Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа" к тест-системе "Стрептококк А-ИФА" для диагностики *in vitro* по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024

Количество: 1 шт.

Рapid Био

Быстрые инновации

Место производства:
ООО «РАПИД БИО», 121050, Ра. г. Москва, торговая марка моновалютного центра "Сколково", Большая Дубинка, д. 42, стр. 1

Комплект №5

Тест-картридж с осцилляцией
Валюта-картридж с расстоянием 1 (3,0 мм)
Валюта-картридж с расстоянием 2 (3,0 мм)
Тест-картридж с расстоянием 3 (3,0 мм)
Тест-картридж с расстоянием 4 (3,0 мм)
Тест-картридж с расстоянием 5 (3,0 мм)
Тест-картридж с расстоянием 6 (3,0 мм)
Тест-картридж с расстоянием 7 (3,0 мм)
Тест-картридж с расстоянием 8 (3,0 мм)
Тест-картридж с расстоянием 9 (3,0 мм)
Тест-картридж с расстоянием 10 (3,0 мм)

Место назначения:
Лаборатория

Место хранения:
Холодильник

Место упаковки:
Пластиковый контейнер

Место назначения:
Лаборатория

Место хранения:
Холодильник

Место упаковки:
Пластиковый контейнер

Место назначения:
Лаборатория

Место хранения:
Холодильник

Место упаковки:
Пластиковый контейнер

Место назначения:
Лаборатория

Место хранения:
Холодильник


Место упаковки:
Пластиковый контейнер

Место назначения:
Лаборатория

Место хранения:
Холодильник

Место упаковки:
Пластиковый контейнер

6) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА» для диагностики *in vitro*» по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024, Комплект №6:

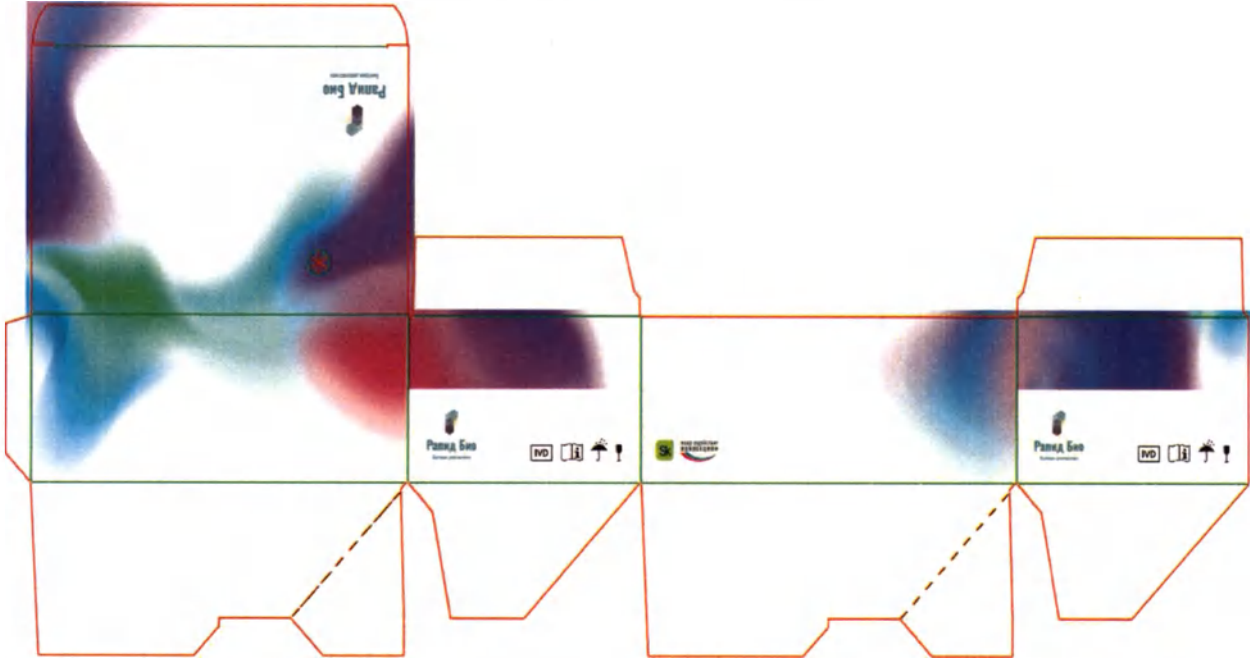

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

Набор реагентов
 «Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА» для диагностики *in vitro*» по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024
 Комплект №6

Состав набора:

- Тест-картридж с осушителем	20 шт.	ТЕСТ
- Флакон-капельница с раствором 1 (9,0 мл)	1 шт.	
- Флакон-капельница с раствором 2 (7,0 мл)	1 шт.	
- Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей	20 шт.	
- Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала (зонды медицинские по ТУ 9436-002-98349125-2016, РУ № РЗН 2018/7058)	20 шт.	
- Подставка для пробирок	1 шт.	
- Положительный контроль (0,5 мл)	1 шт.	
- Отрицательный контроль (0,5 мл)	1 шт.	
- Инструкция по применению	1 шт.	

Для профессионального применения!

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

ТУ 21.20.23-021-44090553-2024 РУ № РЗН XXX от XXX г.

Штрих-код продукта

REF

LOT

2024-02

2026-02

LFA001.06

LFAZ24B01

2024-02

2026-02

⚠

⚠


⚠

⚠

ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4; www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.

7) Образец маркировки набора реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА» для диагностики *in vitro*» по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024, Комплект №7:

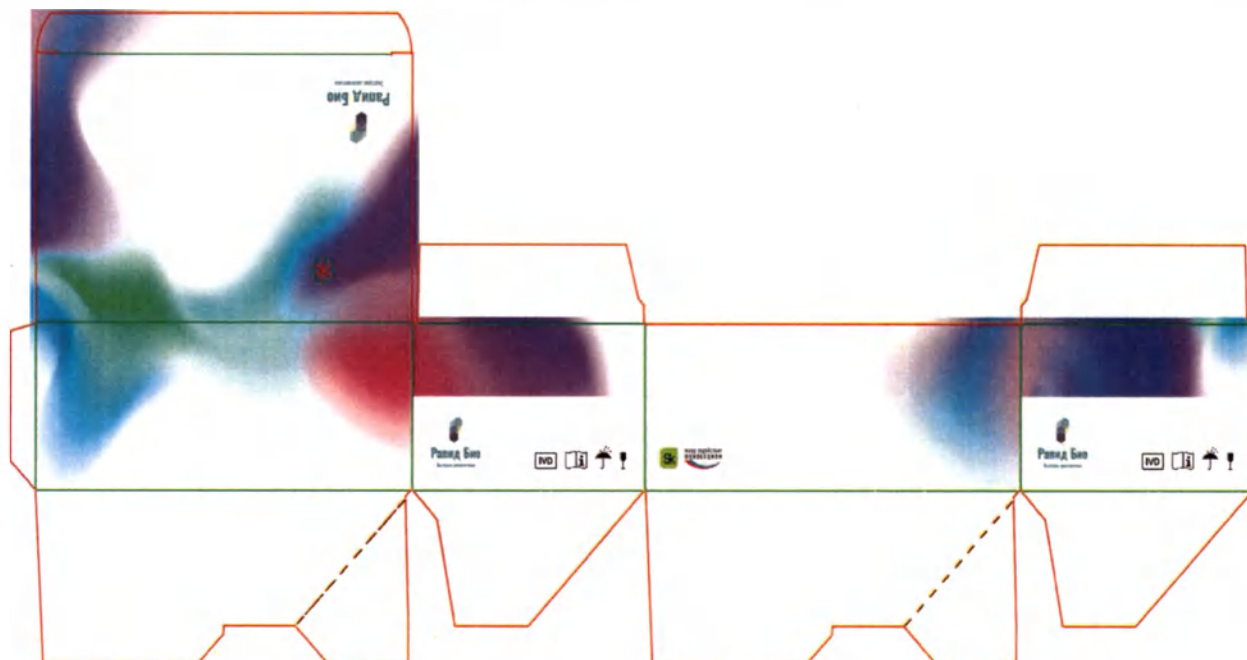

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

Набор реагентов
«Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА» для диагностики *in vitro*» по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024
Комплект №7

Состав набора:

- Тест-картридж с осушителем	25 шт.	ТЕСТ
- Флакон-капельница с раствором 1 (9,0 мл)	1 шт.	
- Флакон-капельница с раствором 2 (7,0 мл)	1 шт.	
- Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей	25 шт.	
- Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала (Зонды медицинские по ТУ 9436-002-98349125-2016, РУ № РЗН 2016/7058)	25 шт.	
- Подставка для пробирок	1 шт.	
- Положительный контроль (0,5 мл)	1 шт.	
- Отрицательный контроль (0,5 мл)	1 шт.	
- Инструкция по применению	1 шт.	

Для профессионального применения!

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

ТУ 21.20.23-021-44090553-2024 РУ № РЗН XXX от XXX г.


Штрих-код продукта

REF LFA001.07

LOT LFAZ24B01

2024-02

2026-02



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4, www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42С1.

8) Образец маркировки Тест-картриджа с осушителем:



РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 2024-02 2026-06

ТЕСТ

1 шт

LOT: LFAZ24B01

REF: LFA001.01

9) Образец маркировки флакона-капельницы с раствором 1 (1,0 мл, 9,0 мл):



РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

Флакон-капельница

с раствором 1 (1,0 мл)

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Rapid Bio



2024-02



2026-02

LOT

LFAZ24B01



+2°C +30°C

IVD



1

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА
Флакон-капельница
с раствором 1 (9,0 мл)

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Rapid Bio




2024-02



2026-02



LFAZ24B01



10) Образец маркировки флакона-капельницы с раствором 2 (1,0 мл, 7,0 мл):

2

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА
Флакон-капельница
с раствором 2 (1,0 мл)

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



Rapid Bio




2024-02



2026-02



LFAZ24B01



2

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

Флакон-капельница с раствором 2 (7,0 мл)

ГОТОВ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ




Rapid Bio



2024-02



2026-02



LOT

LFAZ24B01

IVD

11) Образец маркировки пластиковой пробирки с насадкой-капельницей:

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей

LOT

LFAZ24B01



Rapid Bio



2024-02




2026-04



IVD



12) Образец маркировки подставки для пробирок

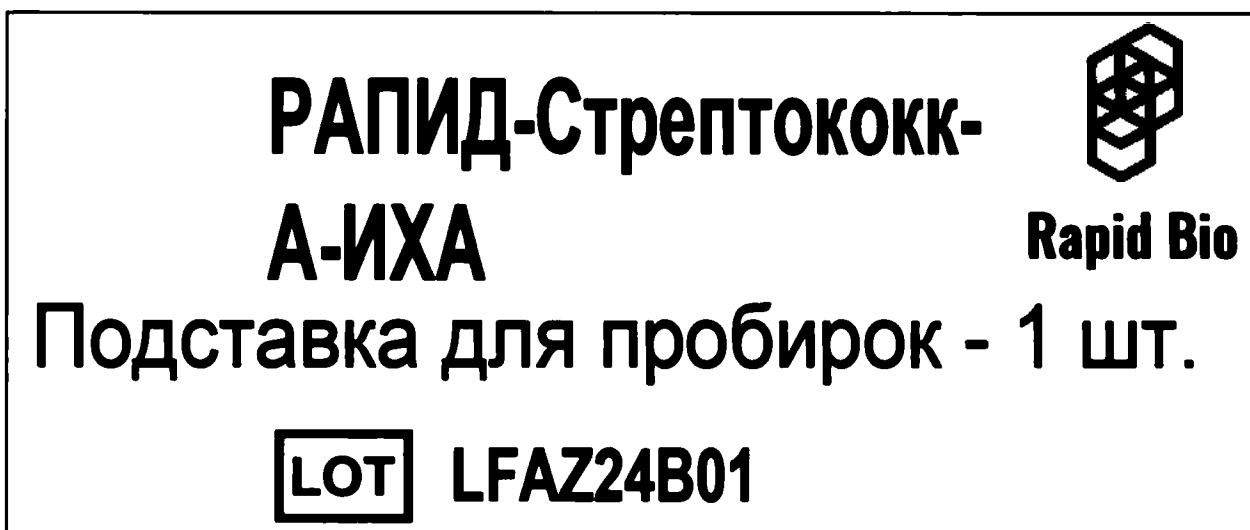


13) Образец маркировки положительного контроля (0,5 мл):



14) Образец маркировки отрицательного контроля (0,5 мл):



15) Образец маркировки транспортной тары:

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА	
 Рapid Био Быстрая диагностика	REF LFA001.XX  202X-XX
	LOT XXXXXXXX  202X-XX
	Комплект №X
Набор реагентов «Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА» для диагностики in vitro» по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024 РУ №XXX от XX.XX.XXXX	
Кол. наборов: XX шт Масса нетто: XX кг Масса брутто: XX кг Масса нетто: XX кг (потребительской упаковки)	Штрих-код продукта
 Возможно транспортирование не более 7 суток при температуре от -20°C до +30°C	
 ООО "РАПИД БИО" Россия, 670017, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, д.13а, оф.4	



Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор реагентов

**«Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А
в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа**

«РАПИД-Стрептококк-А-ИХА»

для диагностики in vitro»

по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024






ЭКСПРЕСС-ТЕСТ СТРЕПТОКОКК А

Комплект №1

Состав набора:

Тест-картридж с осушителем	1 шт.
Флакон-капельница с раствором 1 (1,0 мл)	1 шт.
Флакон-капельница с раствором 2 (1,0 мл)	1 шт.
Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей	1 шт.
Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала (Зонд-тампон медицинский одноразовый, стерильный, РУ № РЗН 2022/18561)	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

Для профессионального
применения.

Отрицательный результат:	Положительный результат:	Недействительный результат:
 Появление в тестовом окне только контрольной полосы «С»	 Появление в тестовом окне двух окрашенных полос: контрольной полосы «С» и тестовой полосы «Т»	 В тестовом окне контрольная полоса «С» не появляется независимо от наличия тестовой полосы «Т»



Место для пробирки



REF LFA001.01



ООО «РАПИД БИО»
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова 13а, офис 4
Тел. +7 495 105 99 16. info@rapidbio.ru, www.rapidbio.ru



13485:2016



+2°C / +30°C




ТУ 21.20.23-021-44090553-2024 РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Место производства:
ООО "РАПИД БИО", 121205, РФ, г. Москва, территория инновационного
центра "Сколково", Большой бульвар, д. 42, стр.1




Фонд содействия
ИННОВАЦИЯМ

Место для
штрих-кода

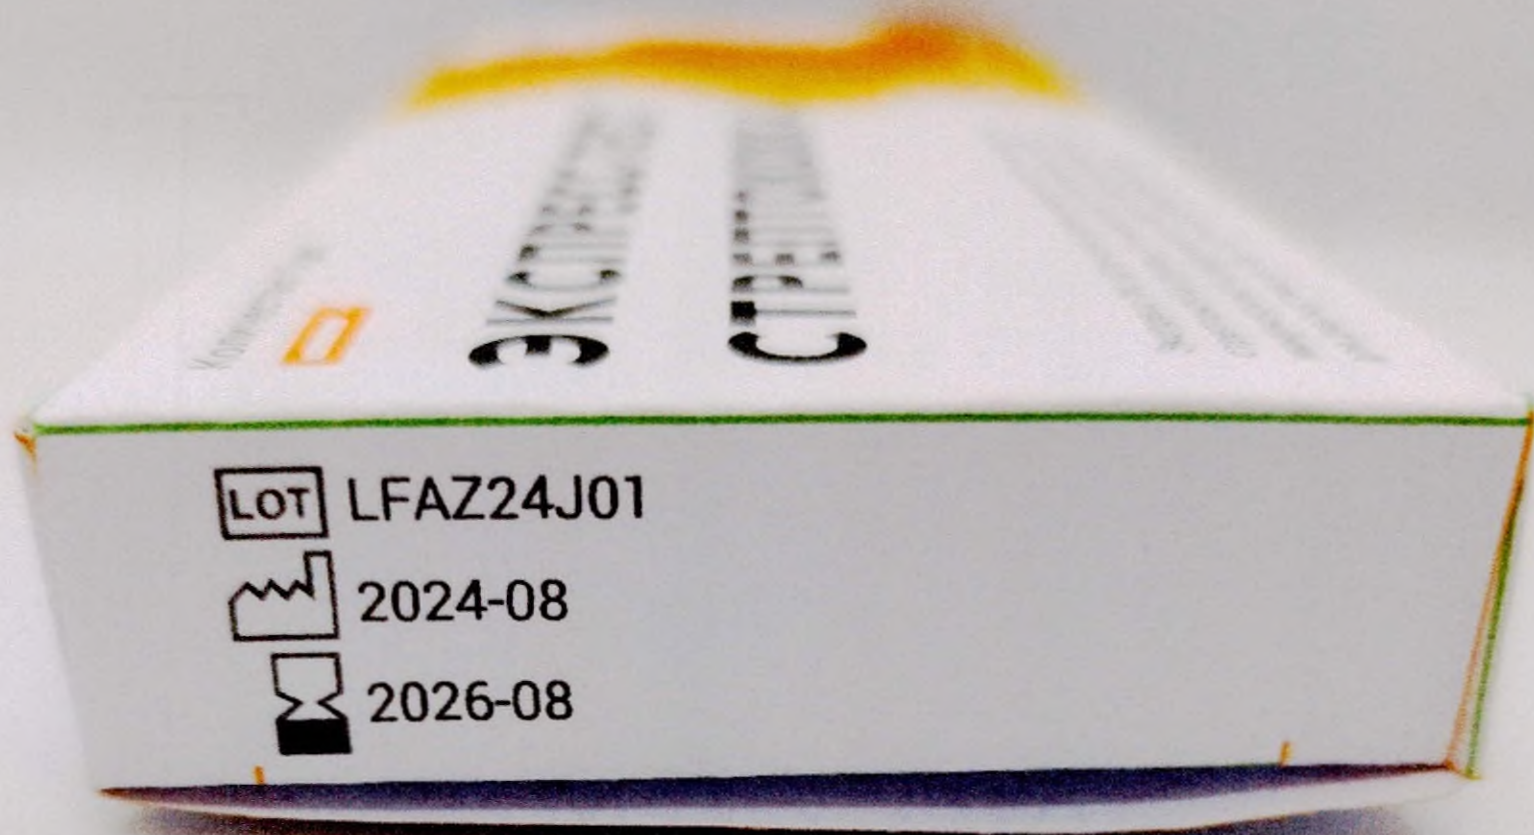


LOT LFAZ24J01


 2024-08

 2026-08

Фотографическое изображение 2. Состав Набора реагентов «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА», комплект №1

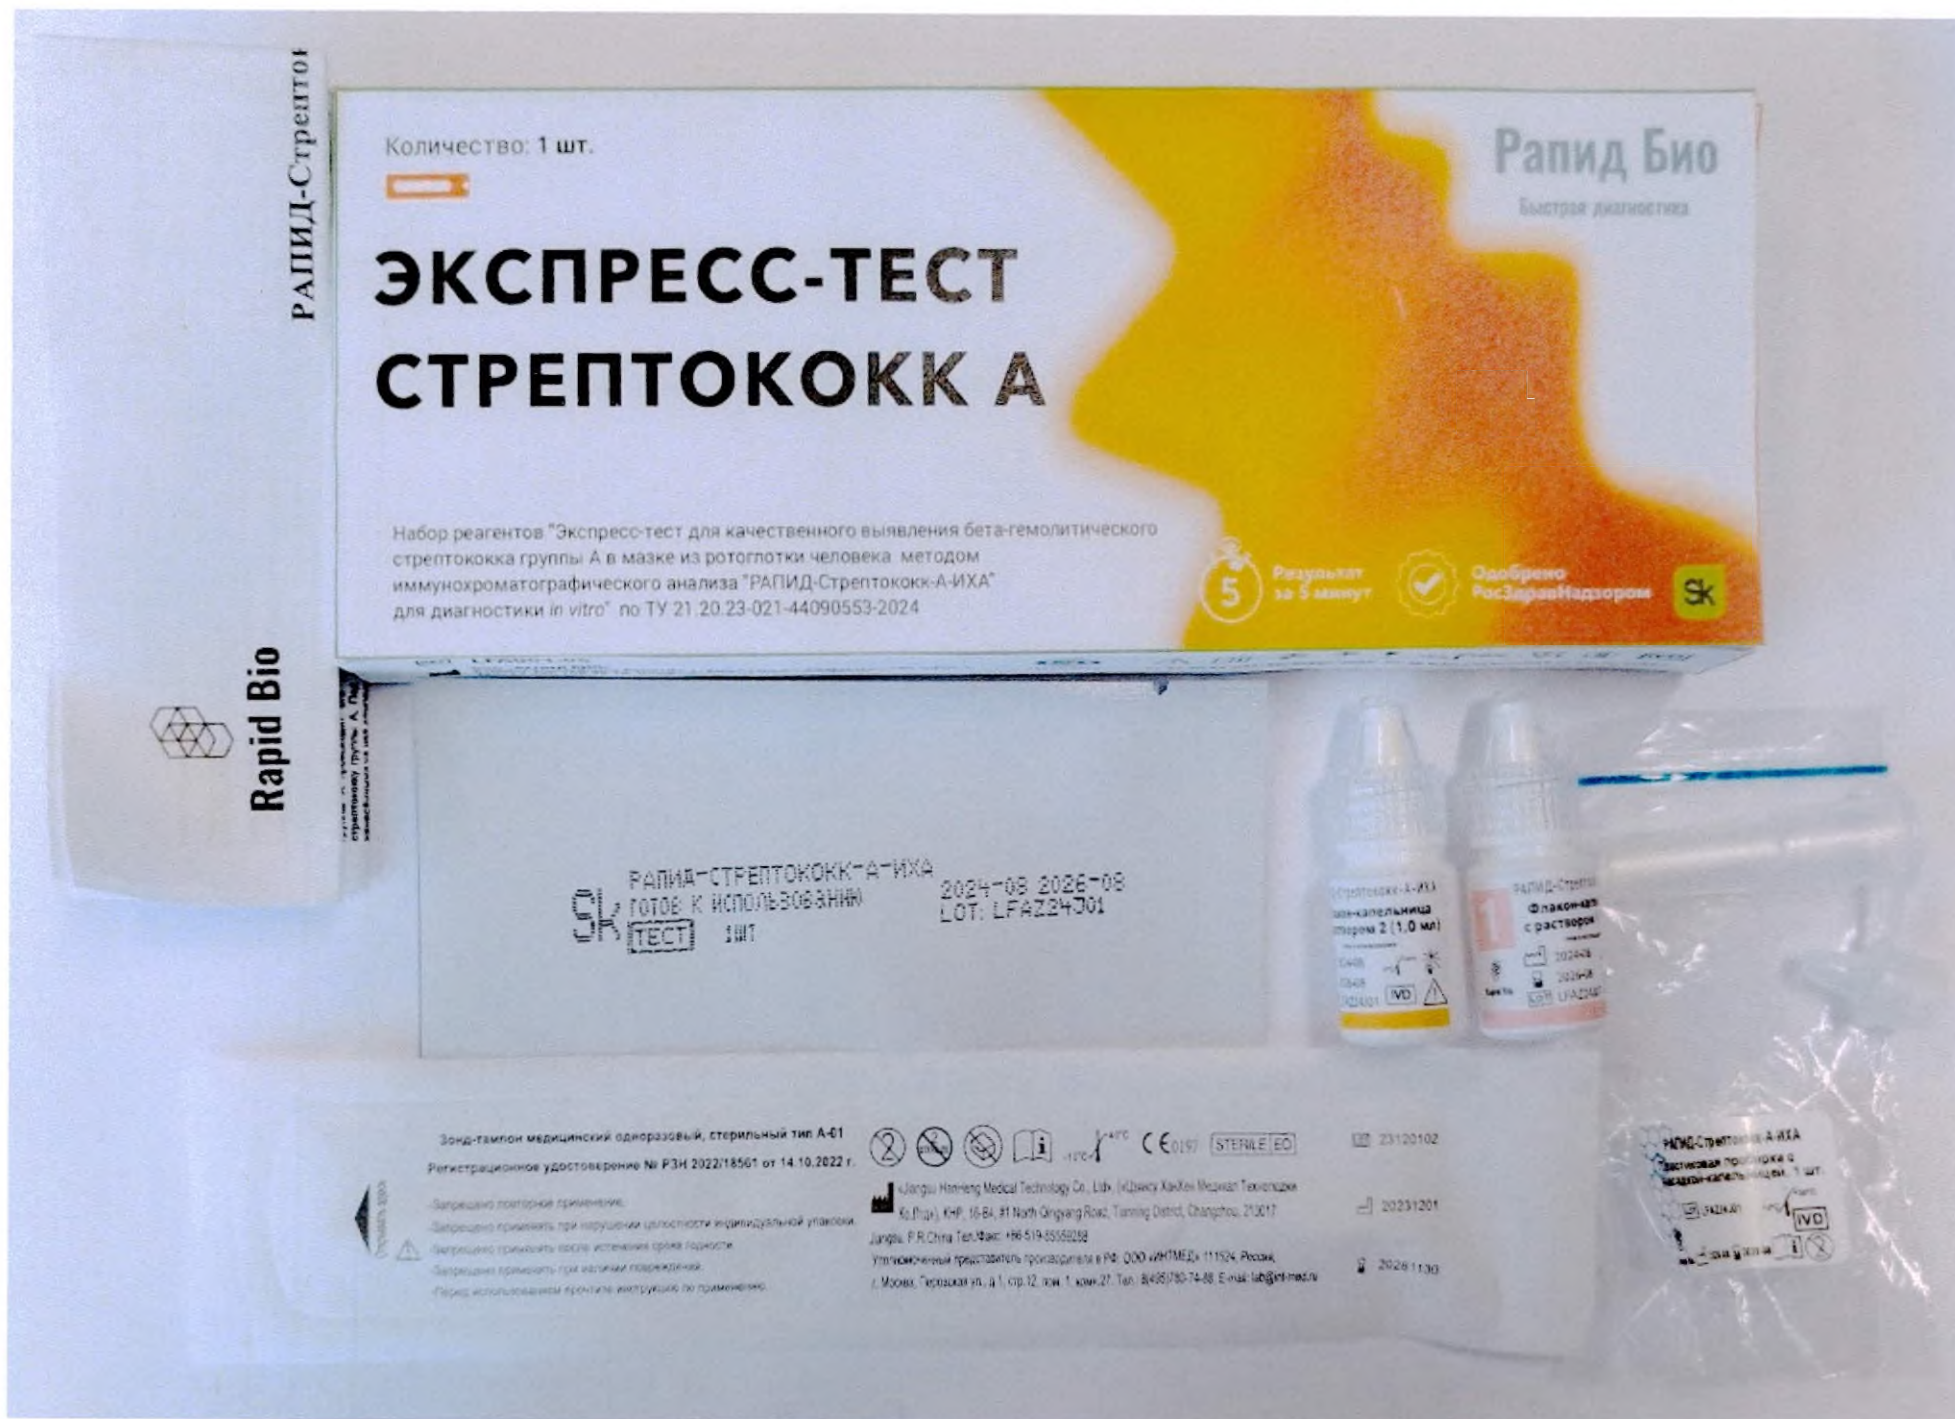

Фотографическое изображение 3. Набор реагентов «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА», внешний вид, комплект №2

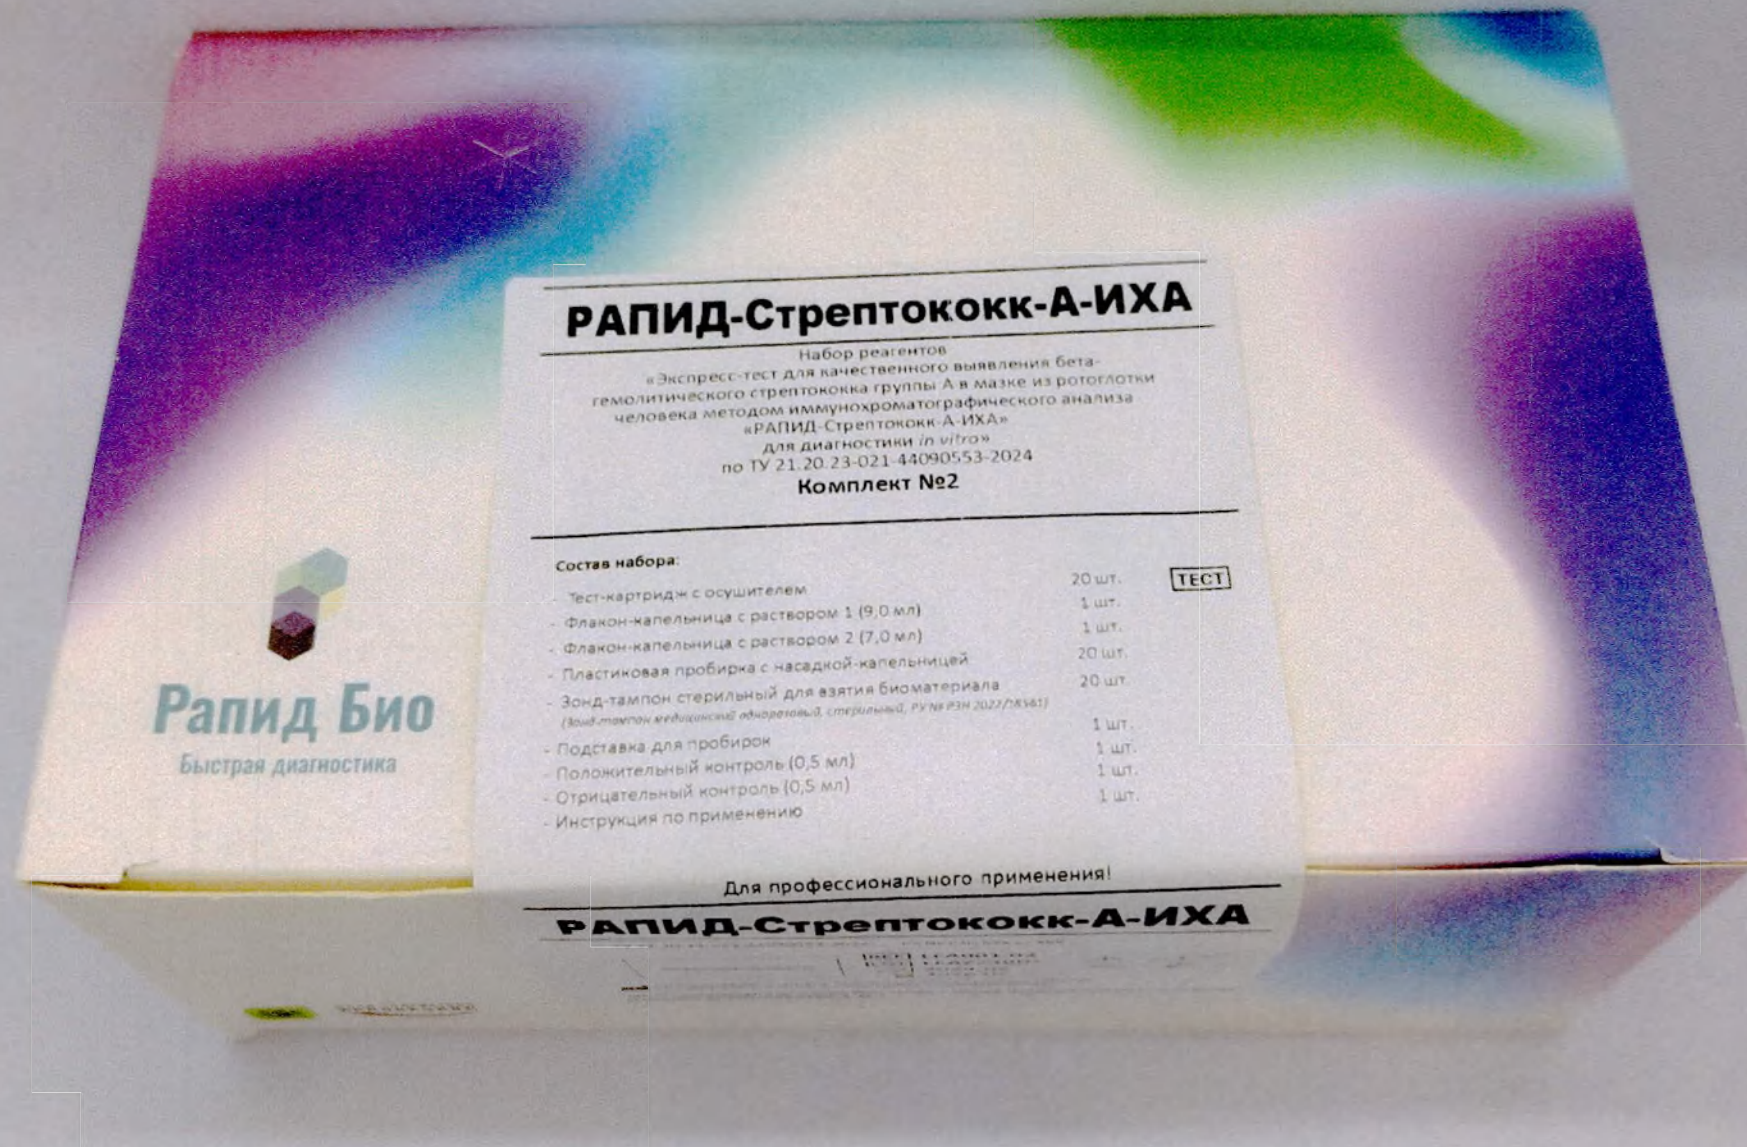

РАПИД БИО


Для профессионального применения!

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

ТУ 21.20.23-021-44090553-2024 РУ № РЗН XXX от XXX г.

Штрих-код продукта

REF LFA001.02
LOT LFAZ24B01
2024-02
2026-02



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4, www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.






Фотографическое изображение 4. Состав Набора реагентов «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА», комплект №2



Фотографическое изображение 5. Набор реагентов «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА», внешний вид, комплект №3

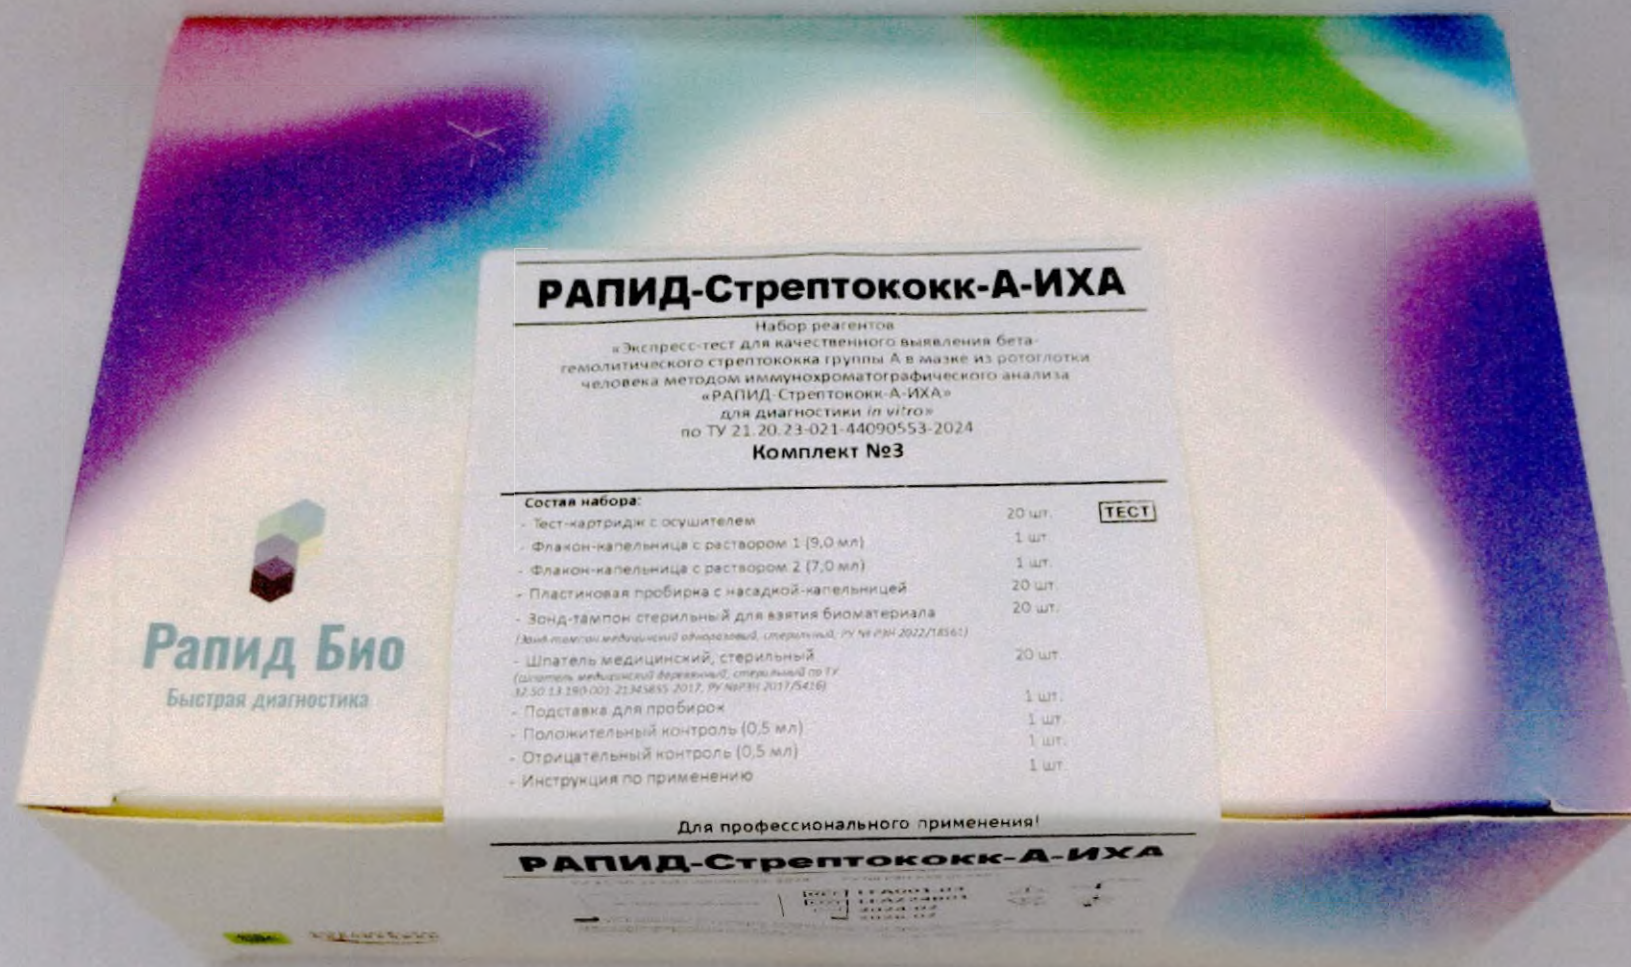

РАПИД БИО

Для профессионального применения!

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

ТУ 21.20.23-021-44090553-2024 РУ № РЗН XXX от XXX г.


Штрих-код продукта

REF LFA001.03

LOT LFAZ24B01

2024-02

2026-02



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4, www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.




ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ



Фотографическое изображение 6. Состав Набора реагентов «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА», комплект №3



Фотографическое изображение 7. Набор реагентов «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА», комплект №4

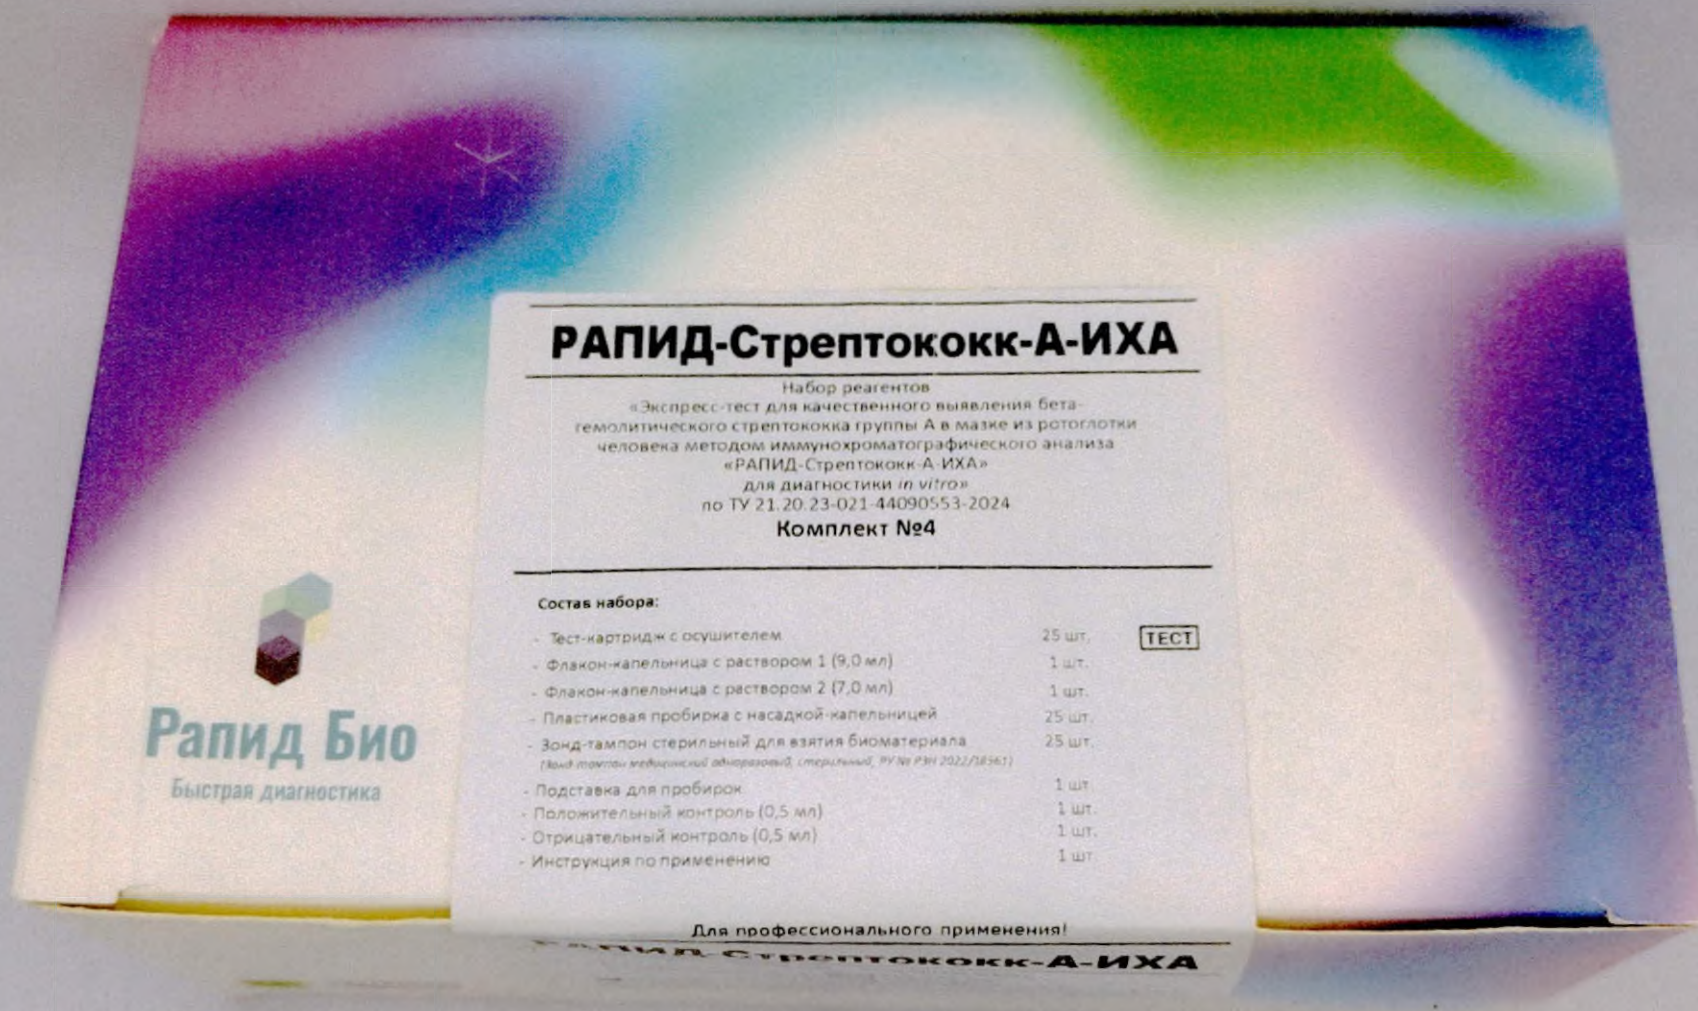

Рapid Био

Для профессионального применения!

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

ТУ 21.20.23-021-44090553-2024 РУ № РЭН XXX от XXX г.


Штрих-код продукта

REF LFA001.04

LOT LFAZ24B01

2024-02

2026-02



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4. www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru


Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.



Фонд содействия
ИННОВАЦИЯМ



Фотографическое изображение 8. Состав Набора реагентов «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА», комплект №4.

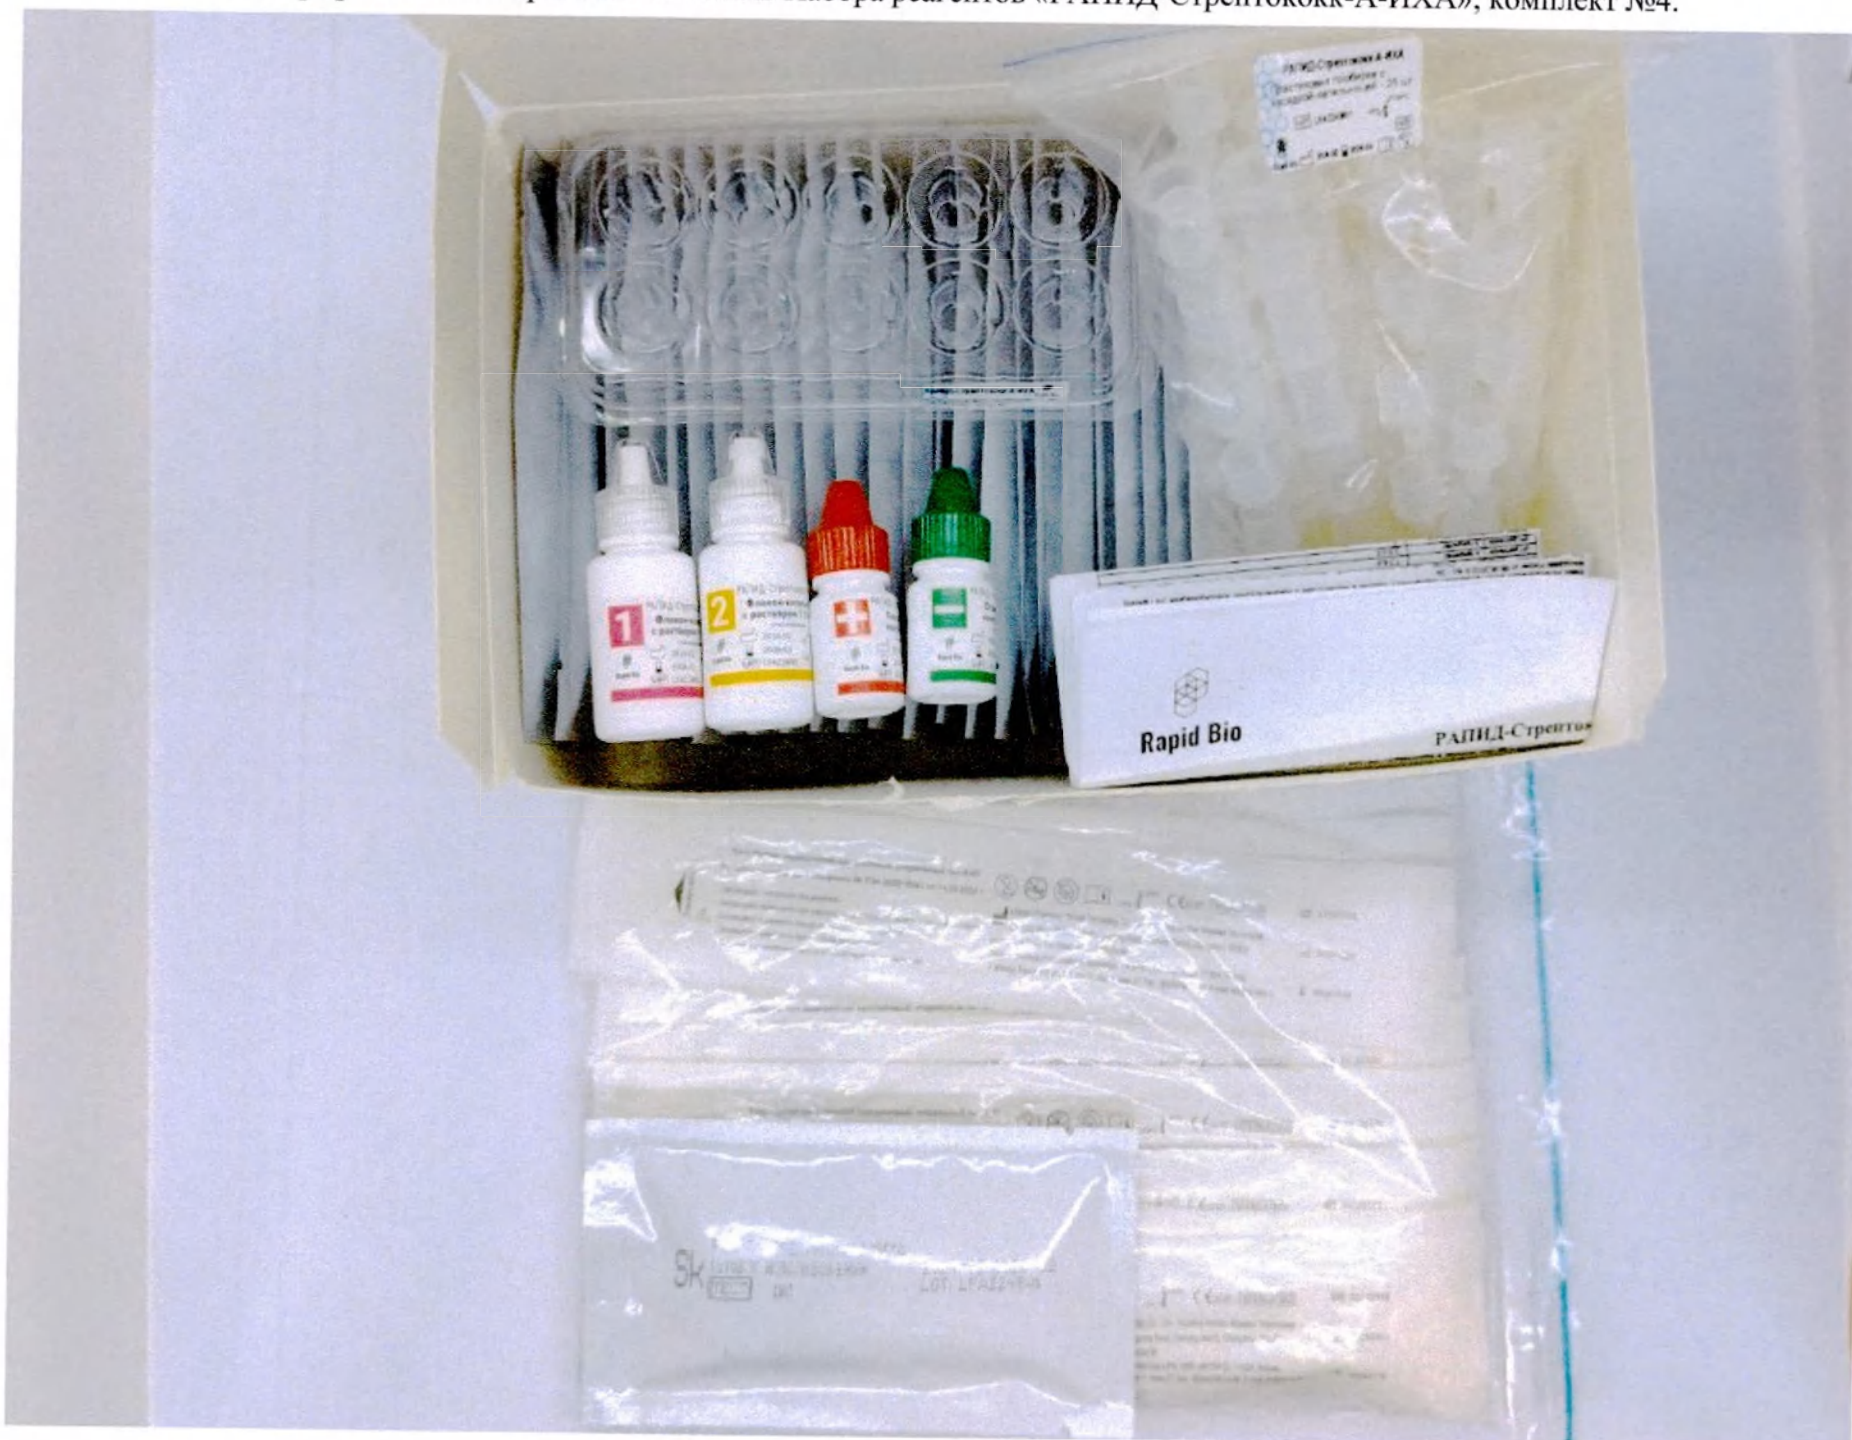

Количество: 1 шт.



ЭКСПРЕСС-ТЕСТ СТРЕПТОКОКК А

Набор реагентов "Экспресс-тест для качественного выявления бета-гемолитического стрептококка группы А в мазке из ротоглотки человека методом иммунохроматографического анализа "РАПИД-Стрептококк-А-ИХА" для диагностики *in vitro*" по ТУ 21.20.23-021-44090553-2024

Рapid Био

Быстрая диагностика



Результат
за 5 минут



Одобрено
РосЗдравНадзором






ЭКСПРЕСС-ТЕСТ СТРЕПТОКОКК А

Комплект №5

Состав набора:

Тест-картридж с осушителем	1 шт.
Флакон-капельница с раствором 1 (1,0 мл)	1 шт.
Флакон-капельница с раствором 2 (1,0 мл)	1 шт.
Пластиковая пробирка с насадкой-капельницей	1 шт.
Зонд-тампон стерильный для взятия биоматериала (Зонды медицинские по ТУ 9436-002-98349125-2016, РУ № РЗН 2018/7058)	1 шт.
Инструкция по применению	1 шт.

! Для профессионального
применения.

Отрицательный результат:	Положительный результат:	Недействительный результат:
 Появление в тестовом окне только контрольной полосы «С»	 Появление в тестовом окне двух окрашенных полос: контрольной полосы «С» и тестовой полосы «Т»	 В тестовом окне контрольная полоса «С» не появляется независимо от наличия тестовой полосы «Т»



Место для пробирки

REF LFA001.05

ООО «РАПИД БИО»
670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Свердлова 13а, офис 4
Тел. +7 495 105 99 16. info@rapidbio.ru, www.rapidbio.ru



13485:2016



+2°C / +30°C




ТУ 21.20.23-021-44090553-2024 РУ № РЗН XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX г.




Место производства:

ООО "РАПИД БИО", 121205, РФ, г. Москва, территория инновационного центра "Сколково", Большой бульвар, д. 42, стр.1



Место для
штрих-кода

LOT LFAZ24J01

 2024-08

 2026-08

Фотографическое изображение 10. Состав Набора реагентов «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА», комплект №5.



Фотографическое изображение 11. Набор реагентов «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА», комплект №6.



Рapid Био
Выпускаем лабораторные тест-системы

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

Для профессионального применения!

РАПИД-Стрептококк-А-ИХА

ТУ 21.20.23-021-44090553-2024 РУ № РЗН XXX от XXX г.


Штрих-код продукта

REF LFA001.06

LOT LFAZ24B01

2024-02

2026-02



ООО «РАПИД БИО», Россия, 670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ,
ул. Свердлова, д. 13а, оф. 4, www.rapidbio.ru, info@rapidbio.ru

Место производства: ООО «РАПИД БИО» 121205, г. Москва, территория инновационного центра
«Сколково», ул. Большой бульвар, д. 42с1.




ФОНД СОДЕЙСТВИЯ
ИННОВАЦИЯМ




Фотографическое изображение 13. Набор реагентов «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА», комплект №7.



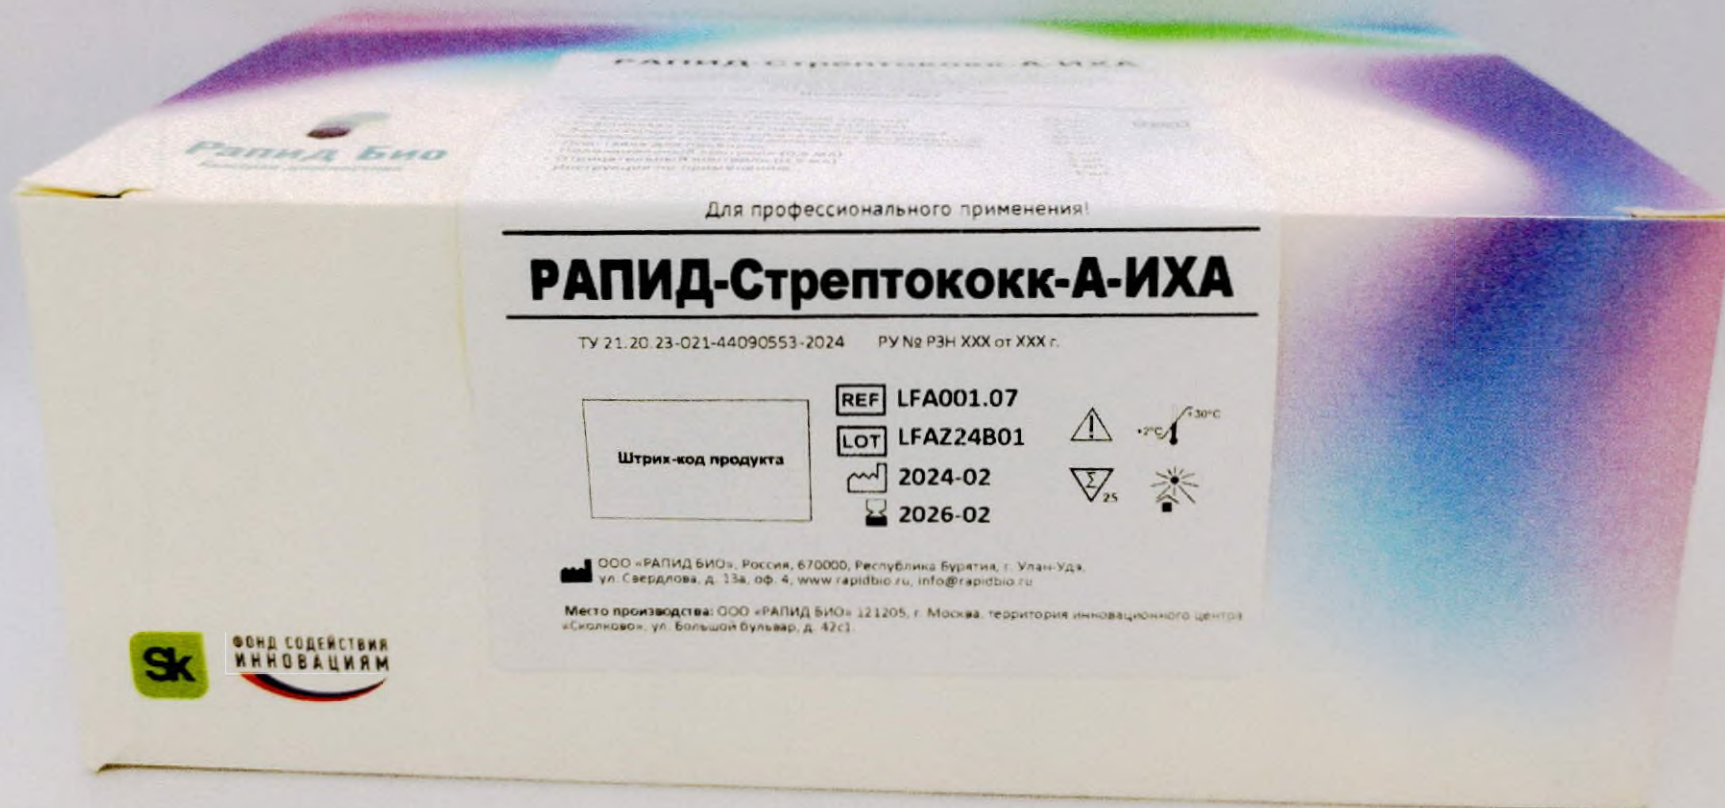




Фотографическое изображение 14. Состав Набора реагентов «РАПИД-Стрептококк-А-ИХА», комплект №7.

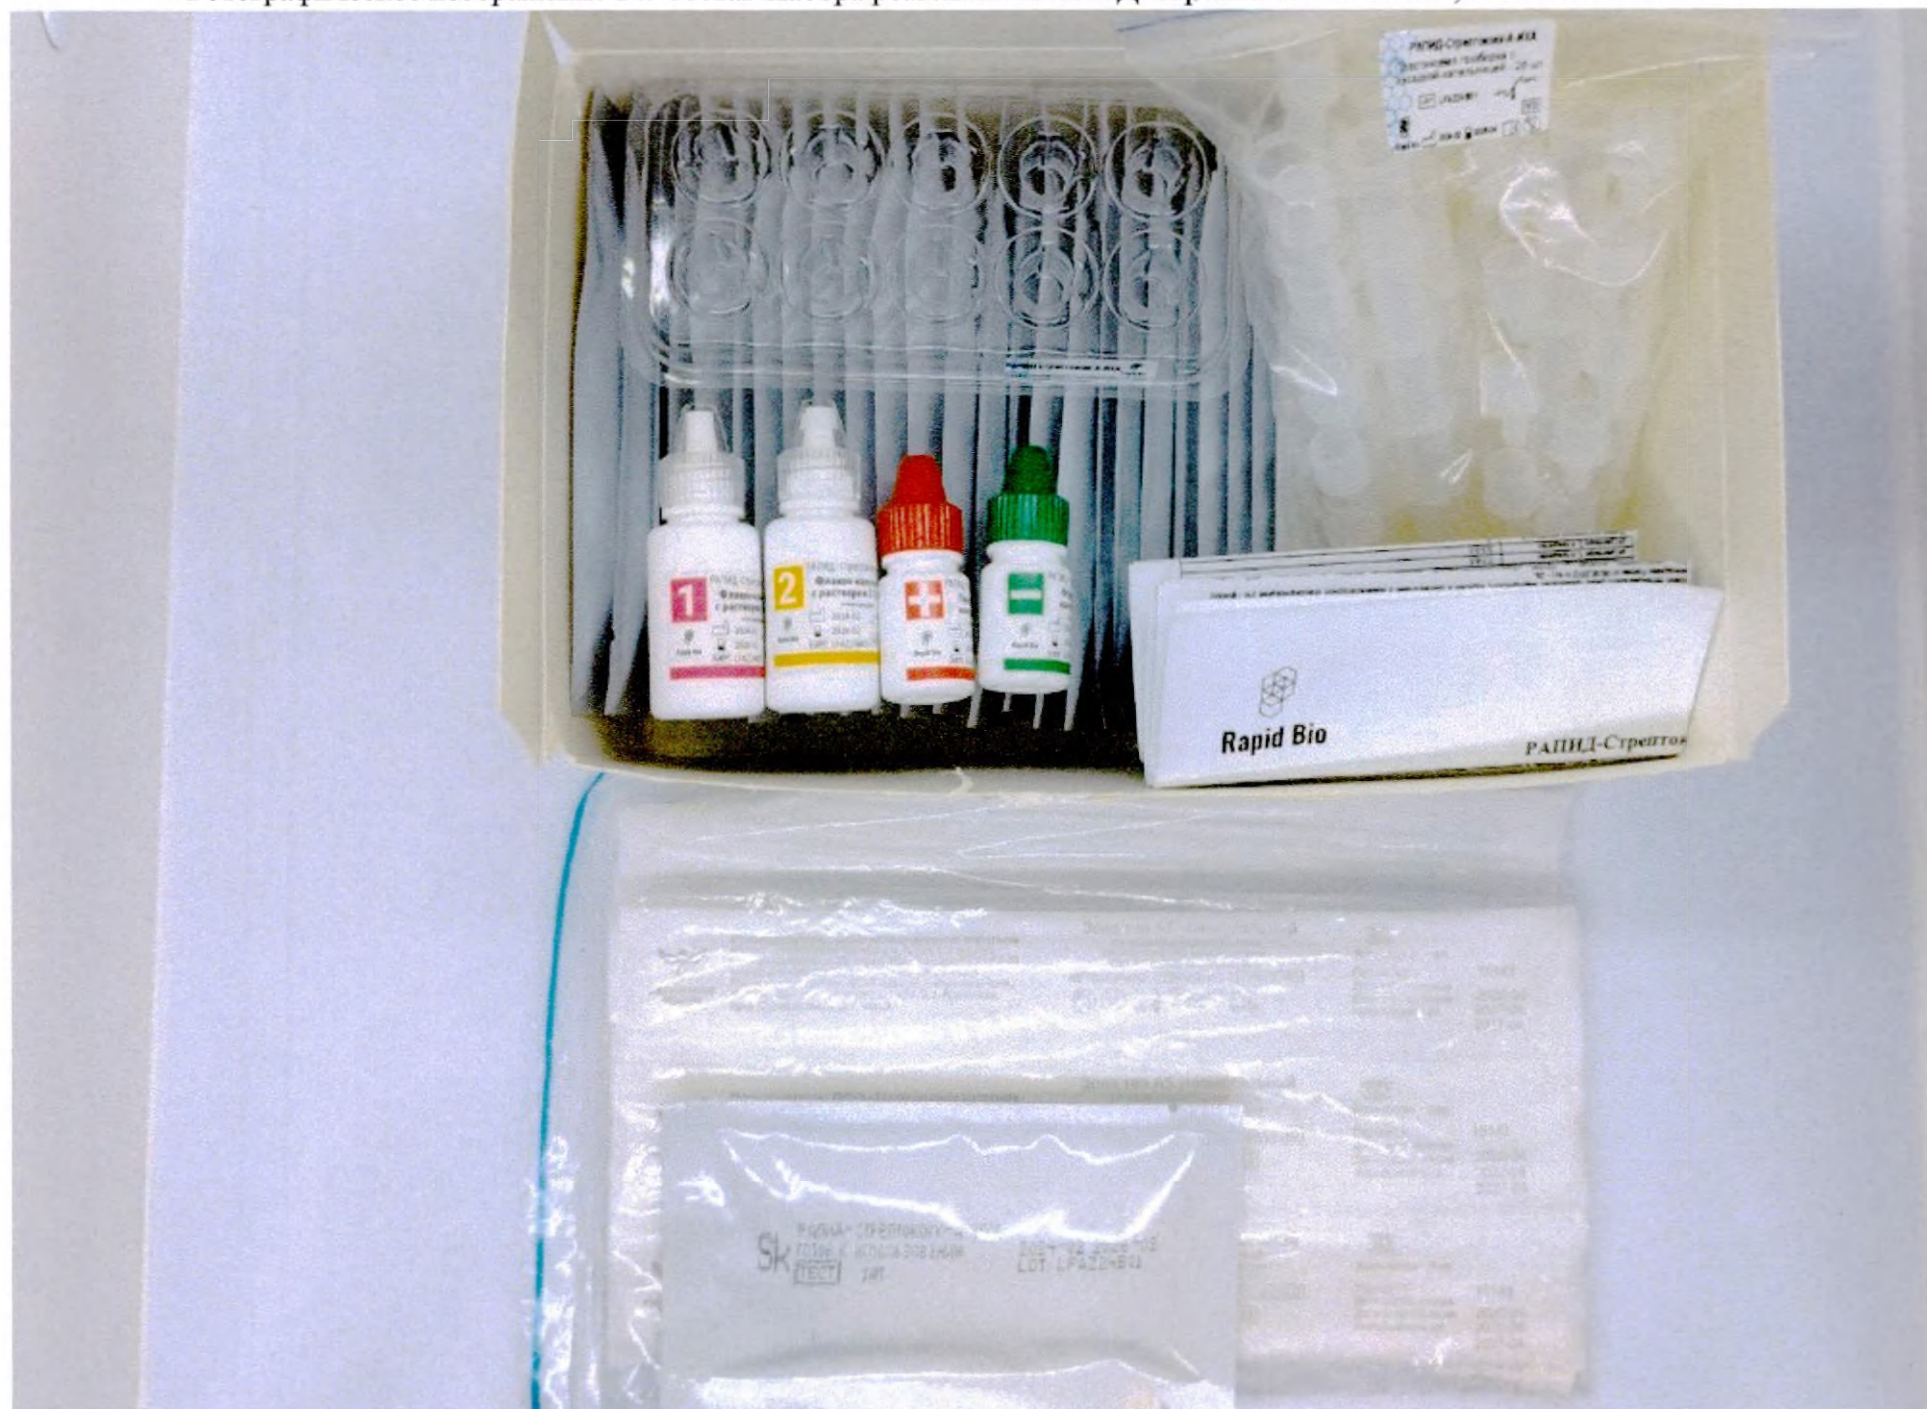

Фотографическое изображение 15. Флаконы-капельницы с раствором 1: 1,0 мл и 9,0 мл



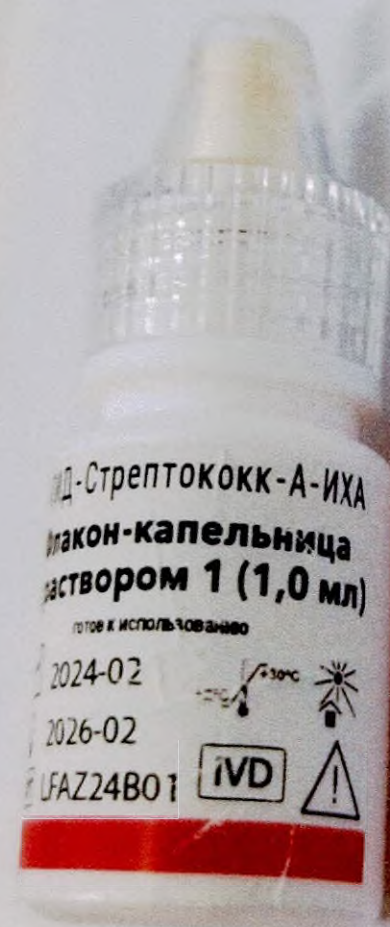




Стрептококк-А-ИХА
кон-капельница
стором 1 (9,0 мл)

Использовать


2024-02

2026-02

FAZ24B01



MD



Фотографическое изображение 16. Флаконы-капельницы с раствором 2: 1,0 мл и 7,0 мл



ИД-Стрептококк-А-ИХА
Капон-капельница
раствором 2 (7,0 мл)

готов к использованию

2024-02

+2°C / +30°C




2026-02

LFAZ24B01

IVD






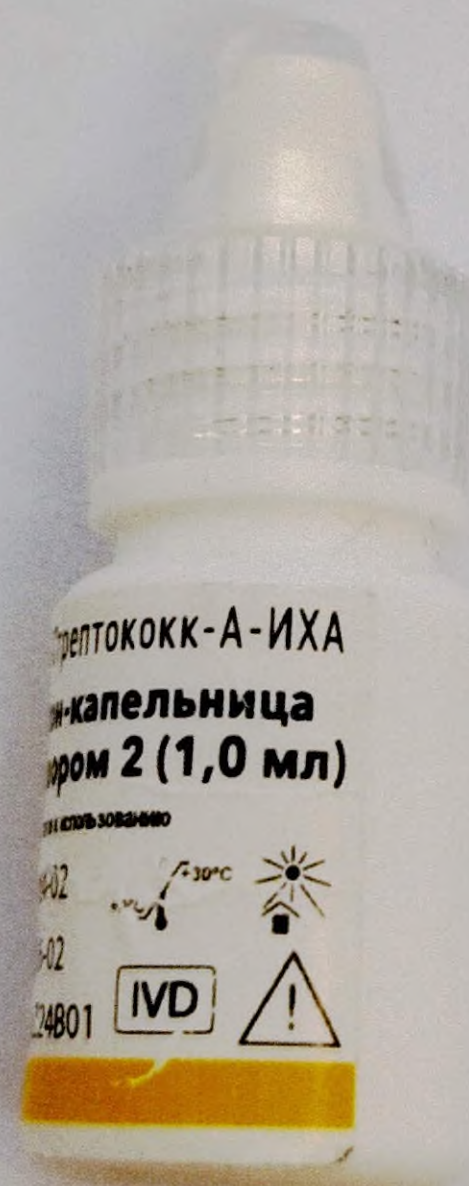


Фотографическое изображение 17. Индивидуальная/групповая упаковка Пластиковой пробирки с насадкой-капельницей



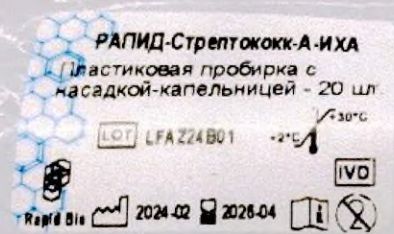




Фотографическое изображение 18. Подставки для пробирок

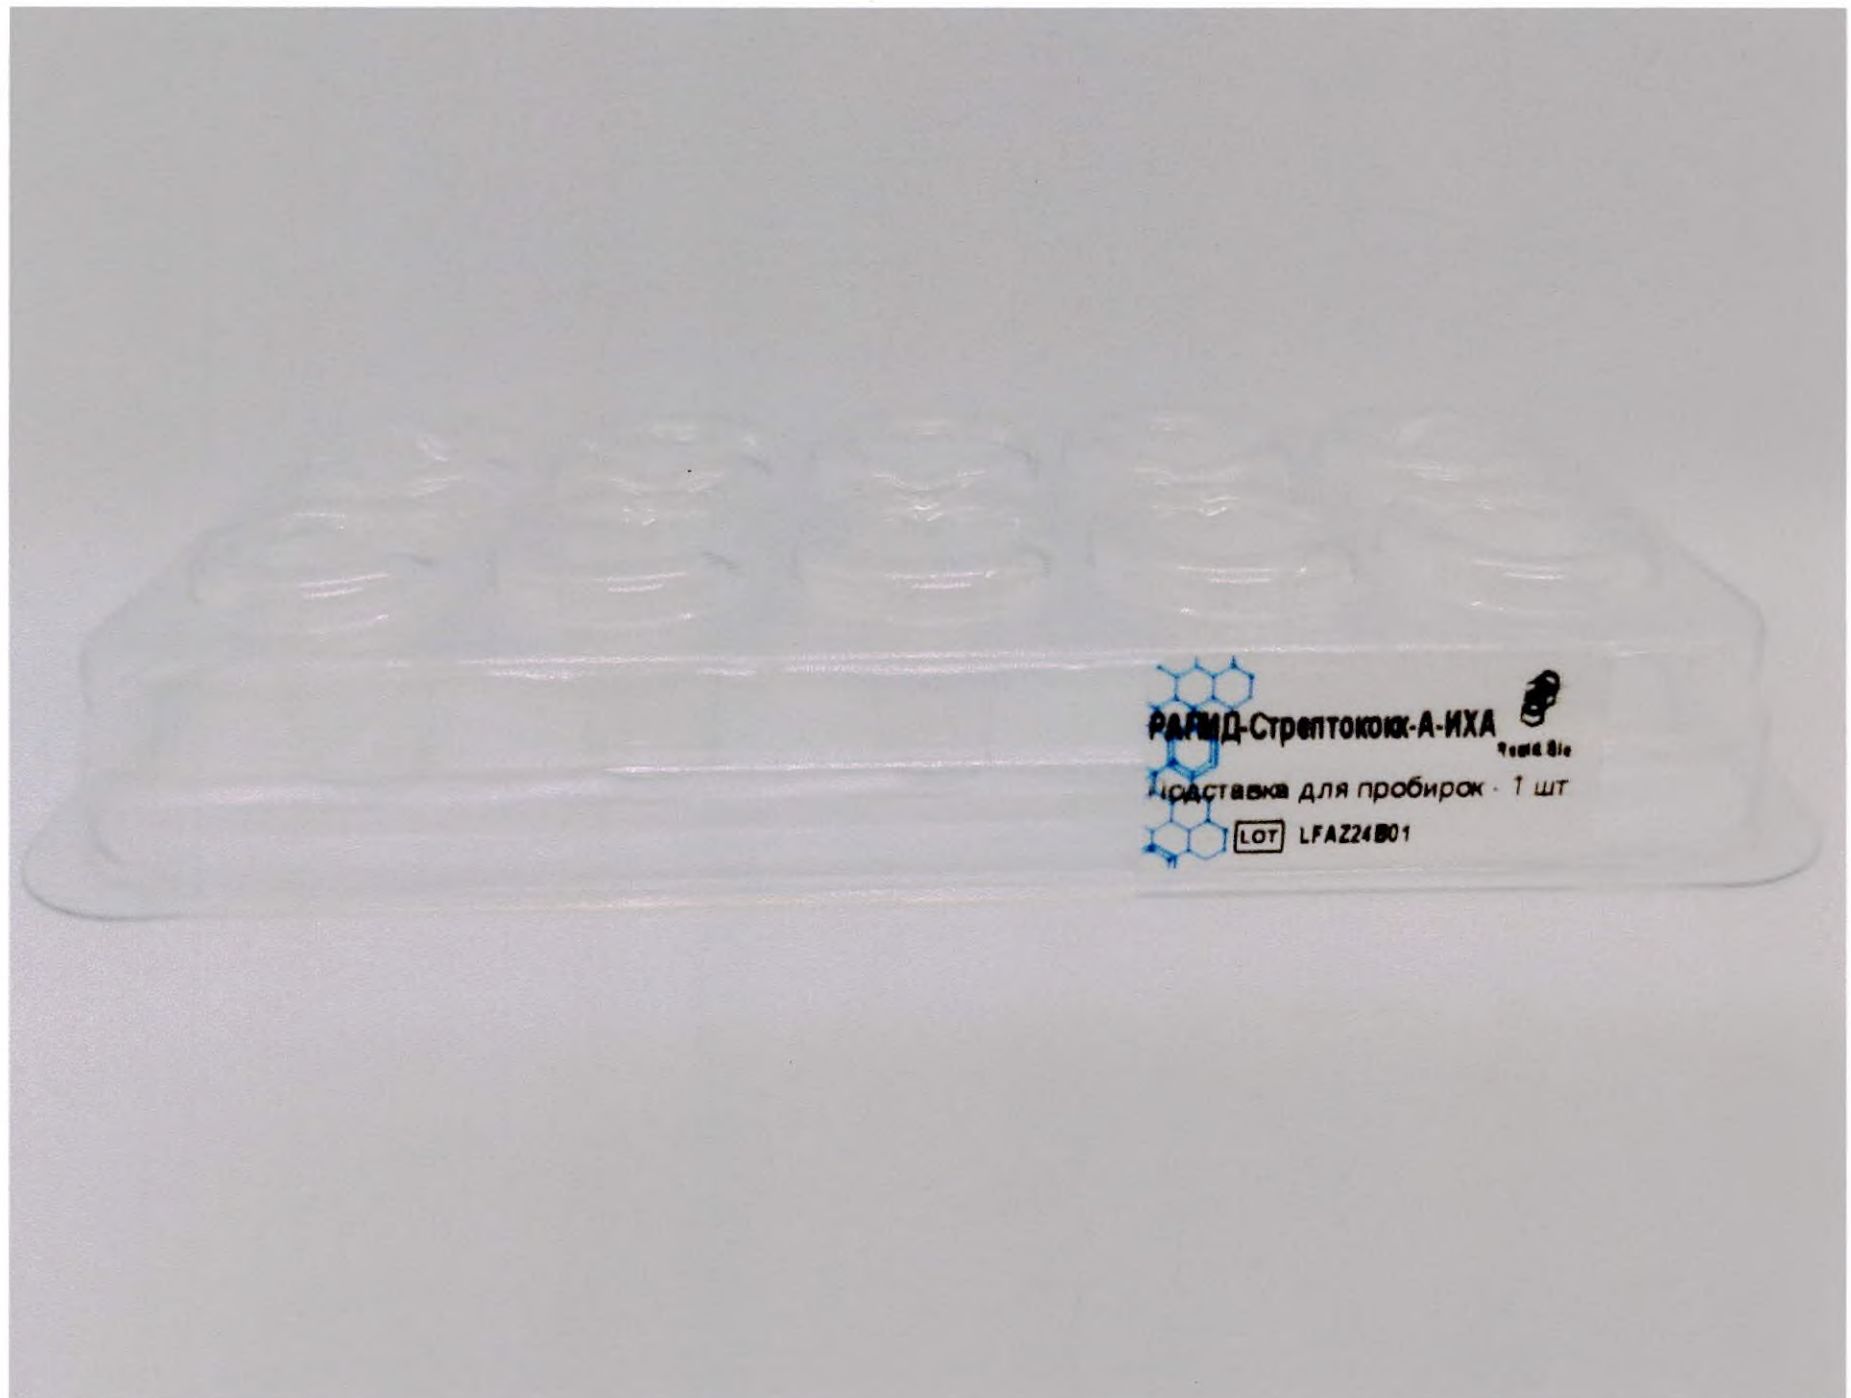


Фотографическое изображение 19. Положительный контроль



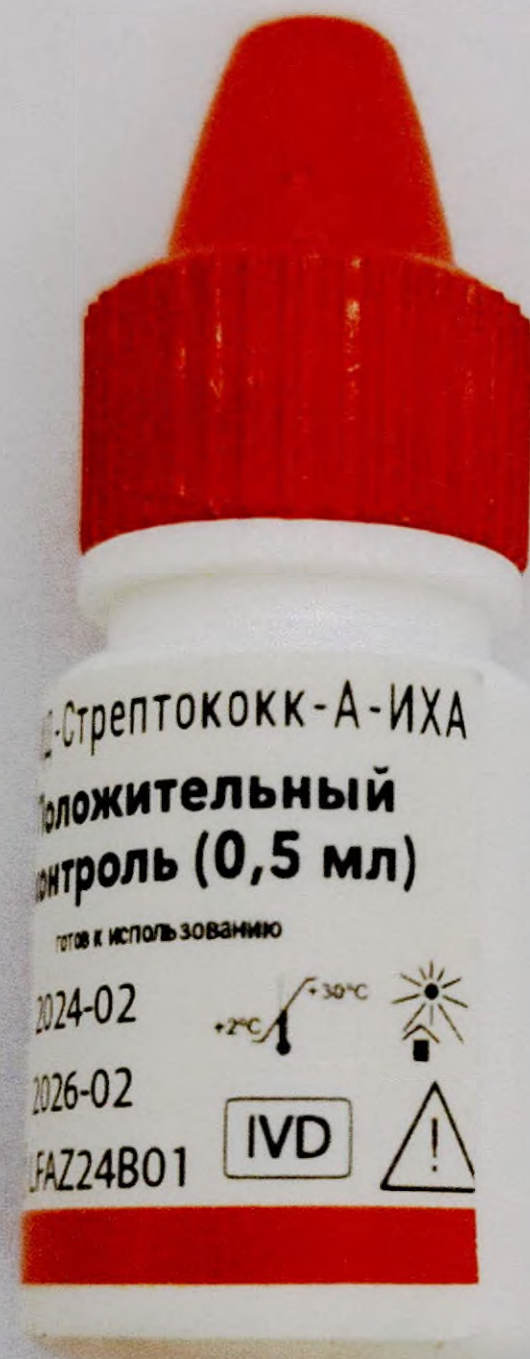


Фотографическое изображение 20. Отрицательный контроль



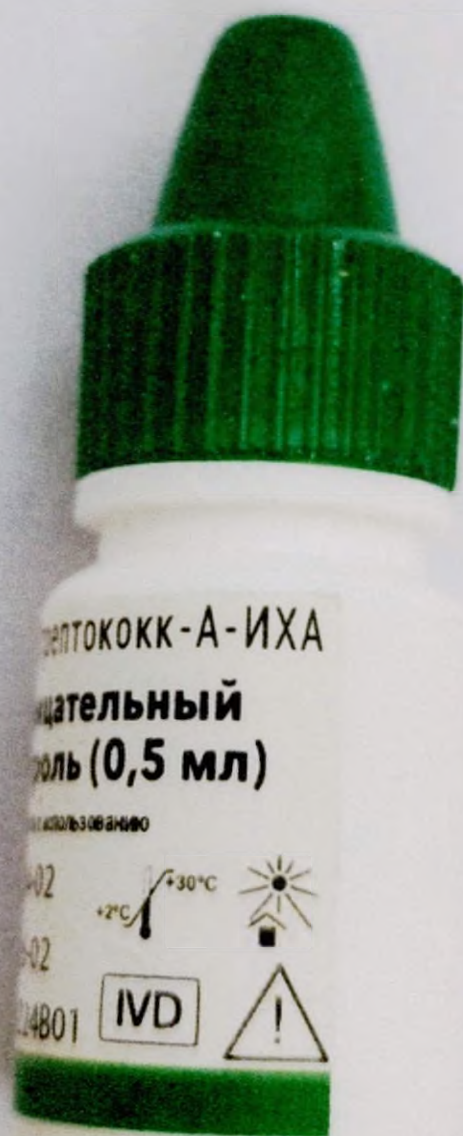

Фотографическое изображение 21. Индивидуальная/групповая упаковка Зонд-тампона стерильного для взятия биоматериала
(Зонд-тампон медицинский одноразовый, стерильный, РУ № РЗН 2022/18561)

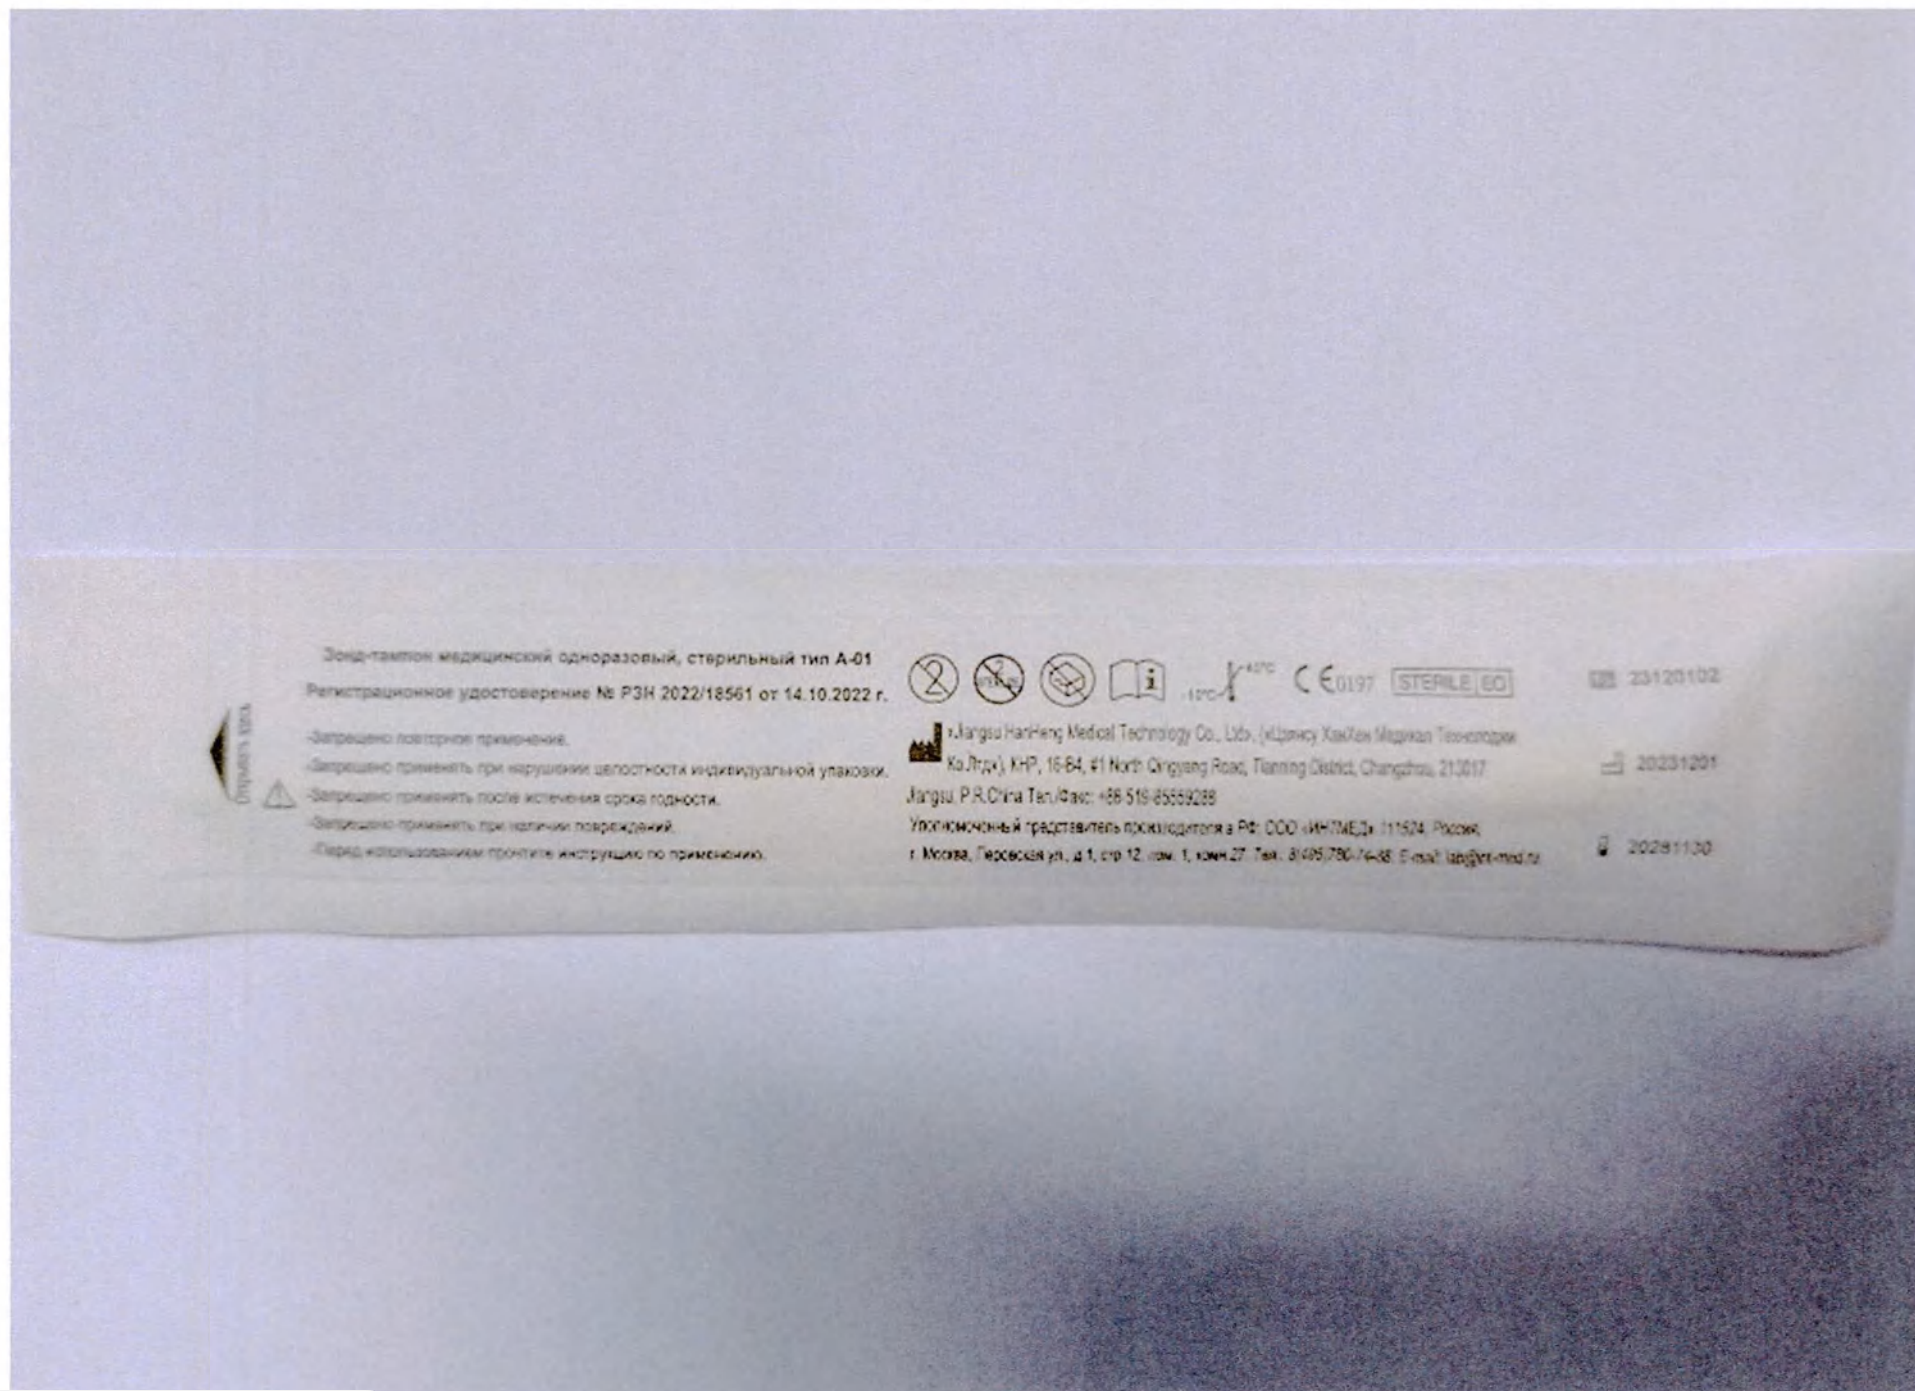

20231201

20231201

20231201

20231201

20231201

20231201

20231201

20231201

20231201

20231201

20231201

20231201

20231201


20231201

20231201


20231201


20231201


20231201

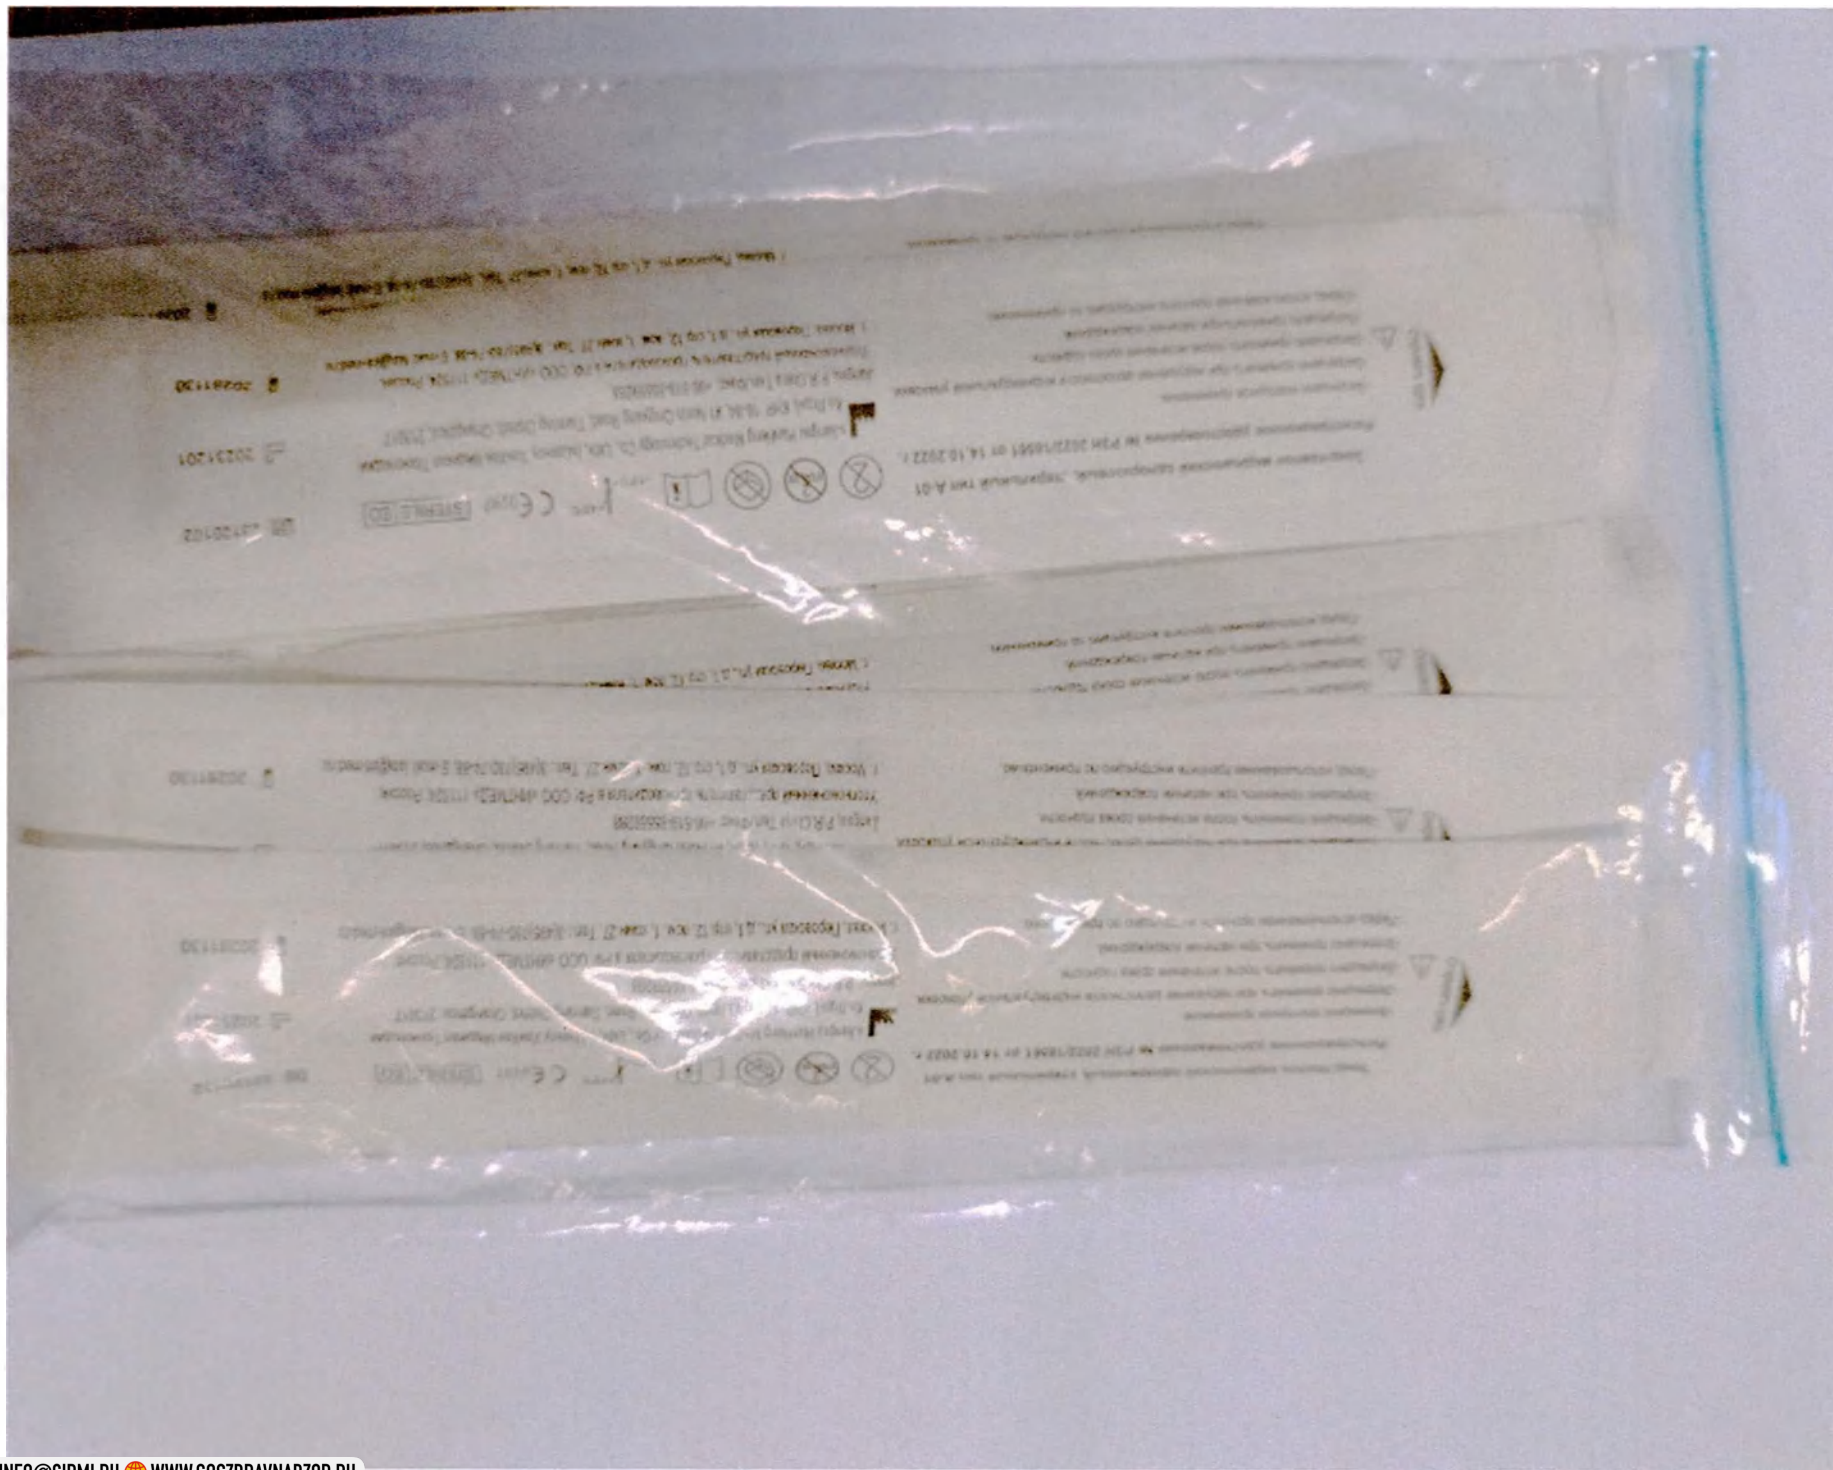


Фотографическое изображение 22. Индивидуальная/групповая упаковка Зонд-тампона стерильного для взятия биоматериала
(Зонды медицинские по ТУ 9436-002-98349125-2016, РУ № РЗН 2018/7058)

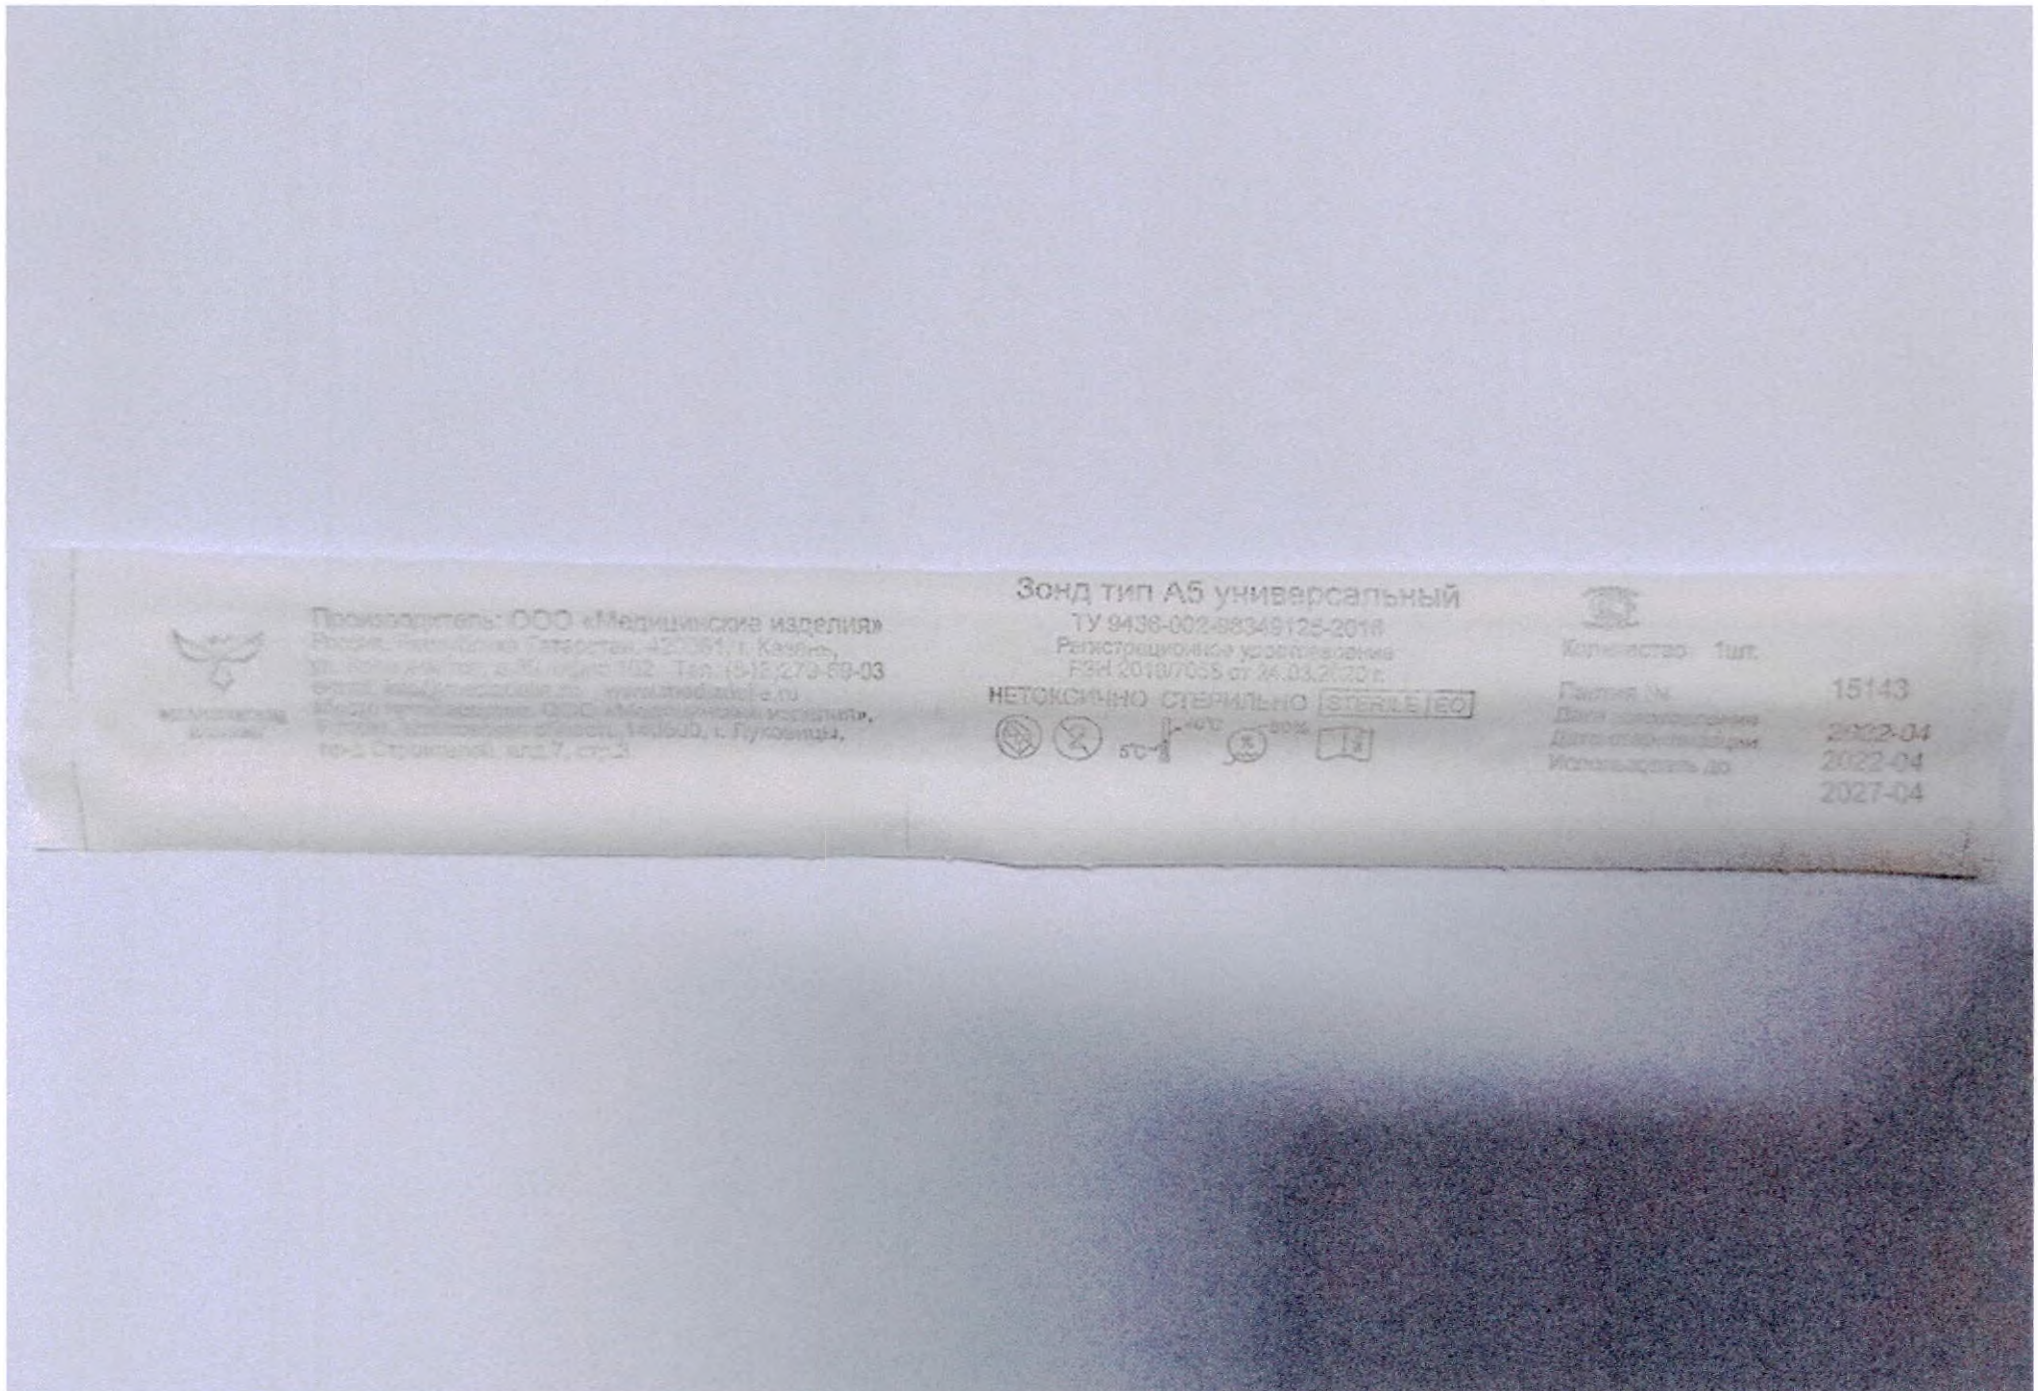

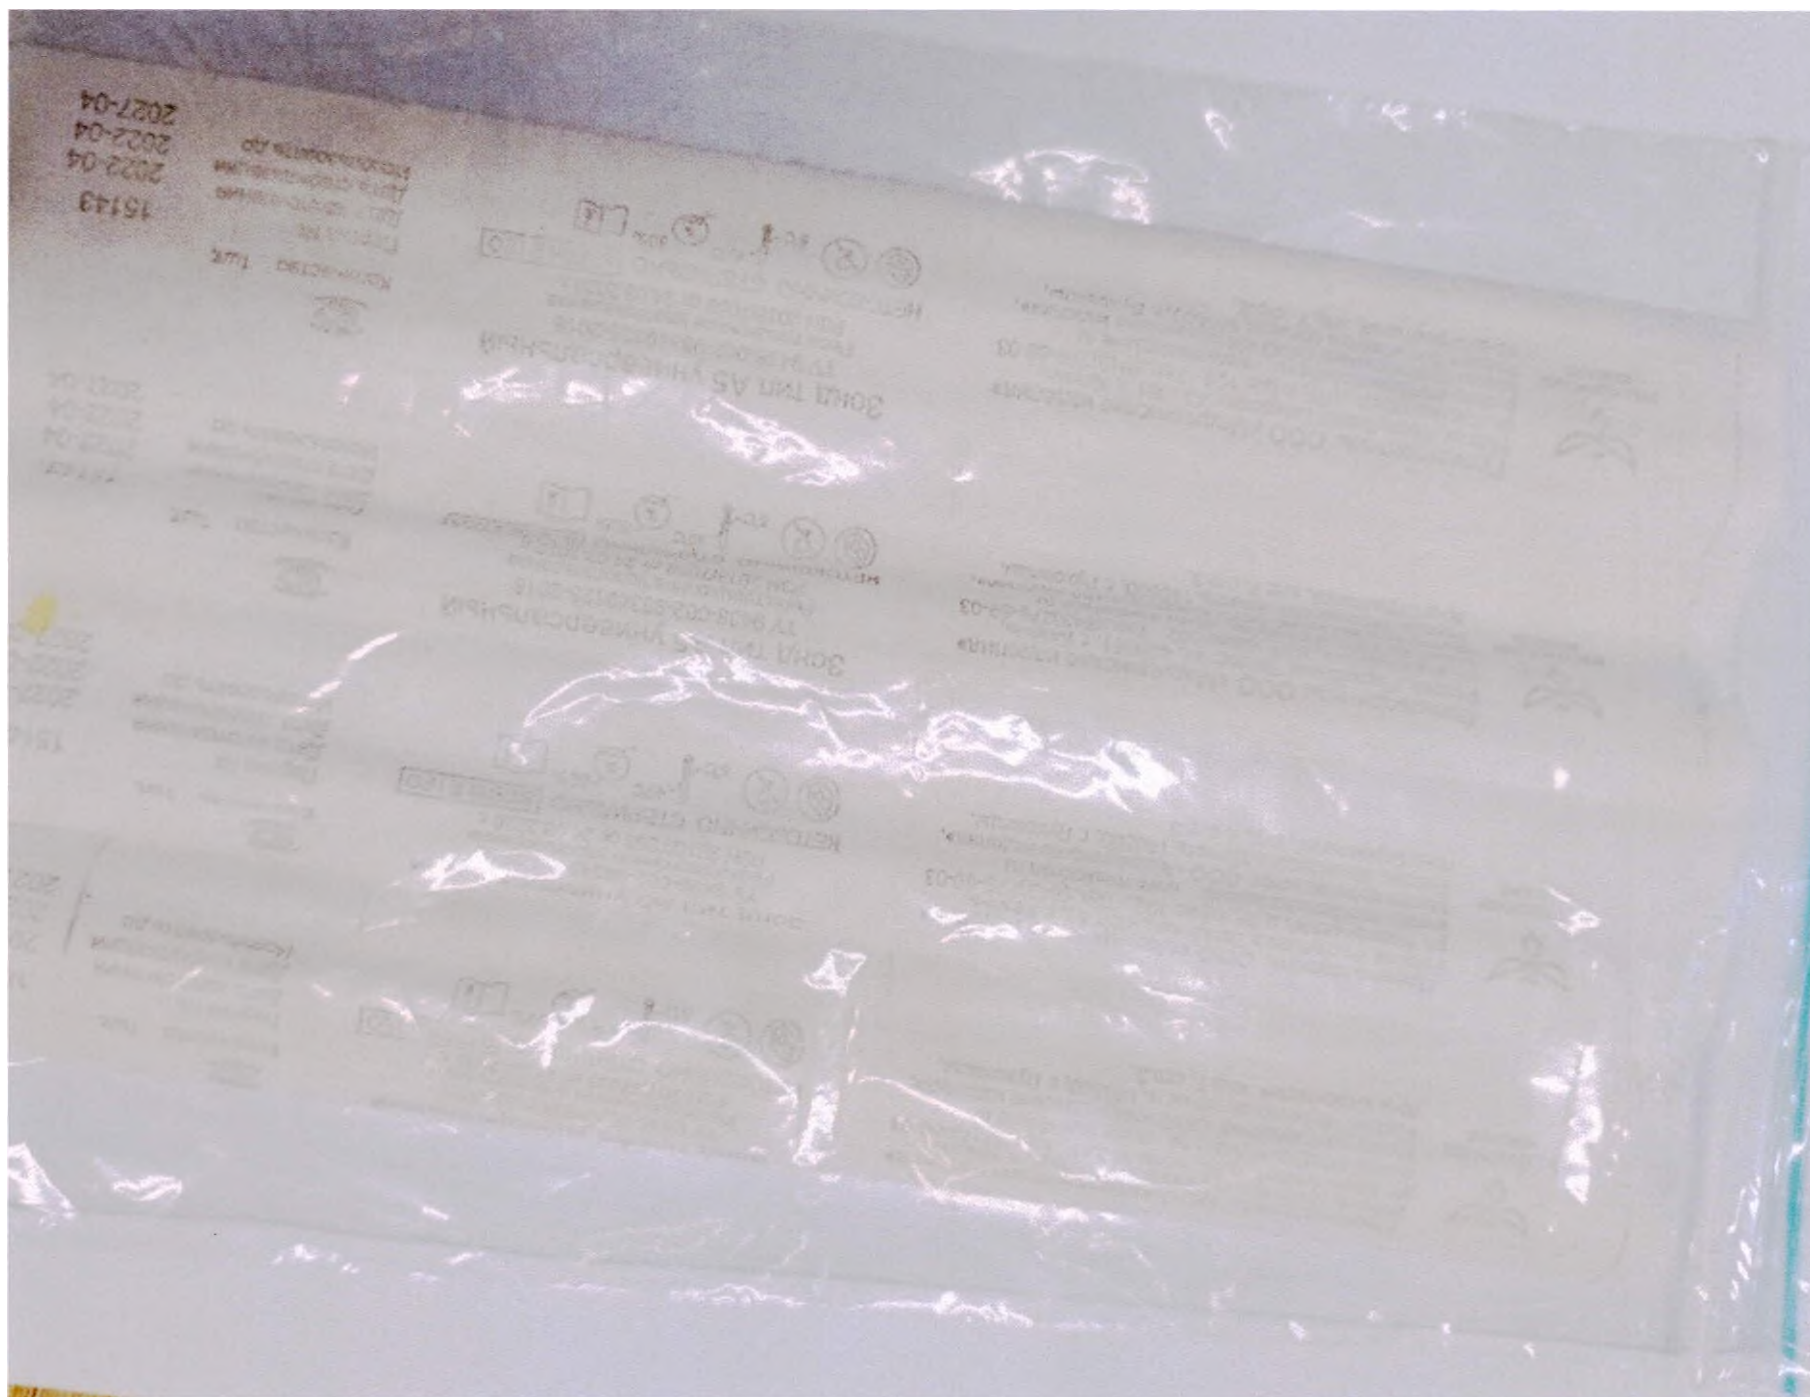

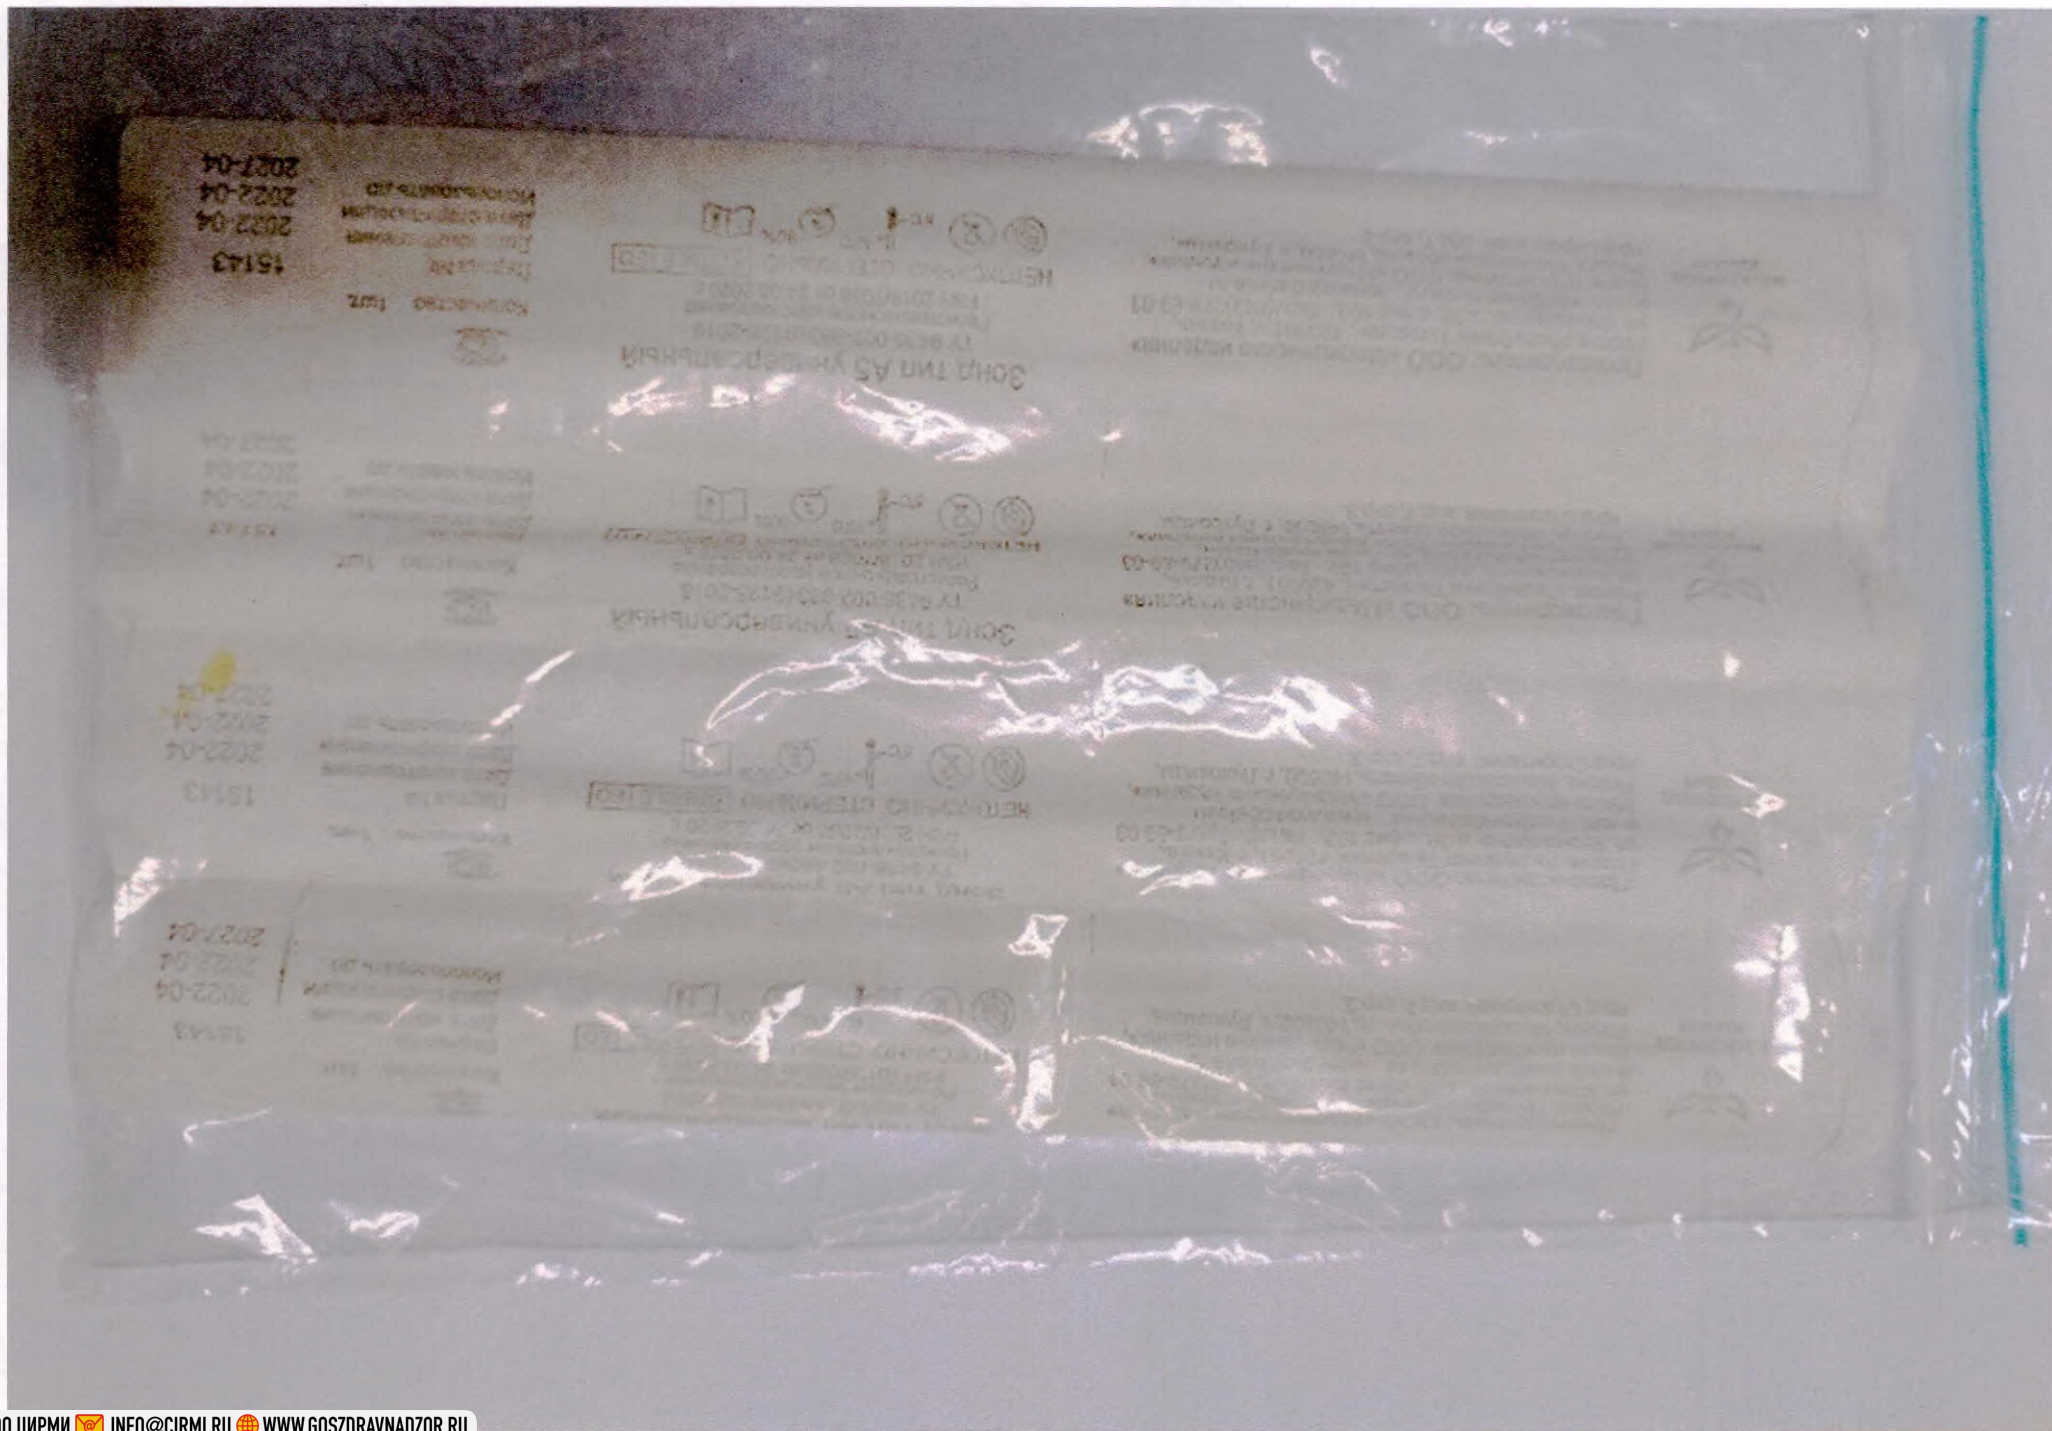

Фотографическое изображение 23. Шпатель медицинский, стерильный (Шпатель медицинский деревянный, стерильный по ТУ 32.50.13.190-001-21345855-2017, РУ №РЗН 2017/5416)

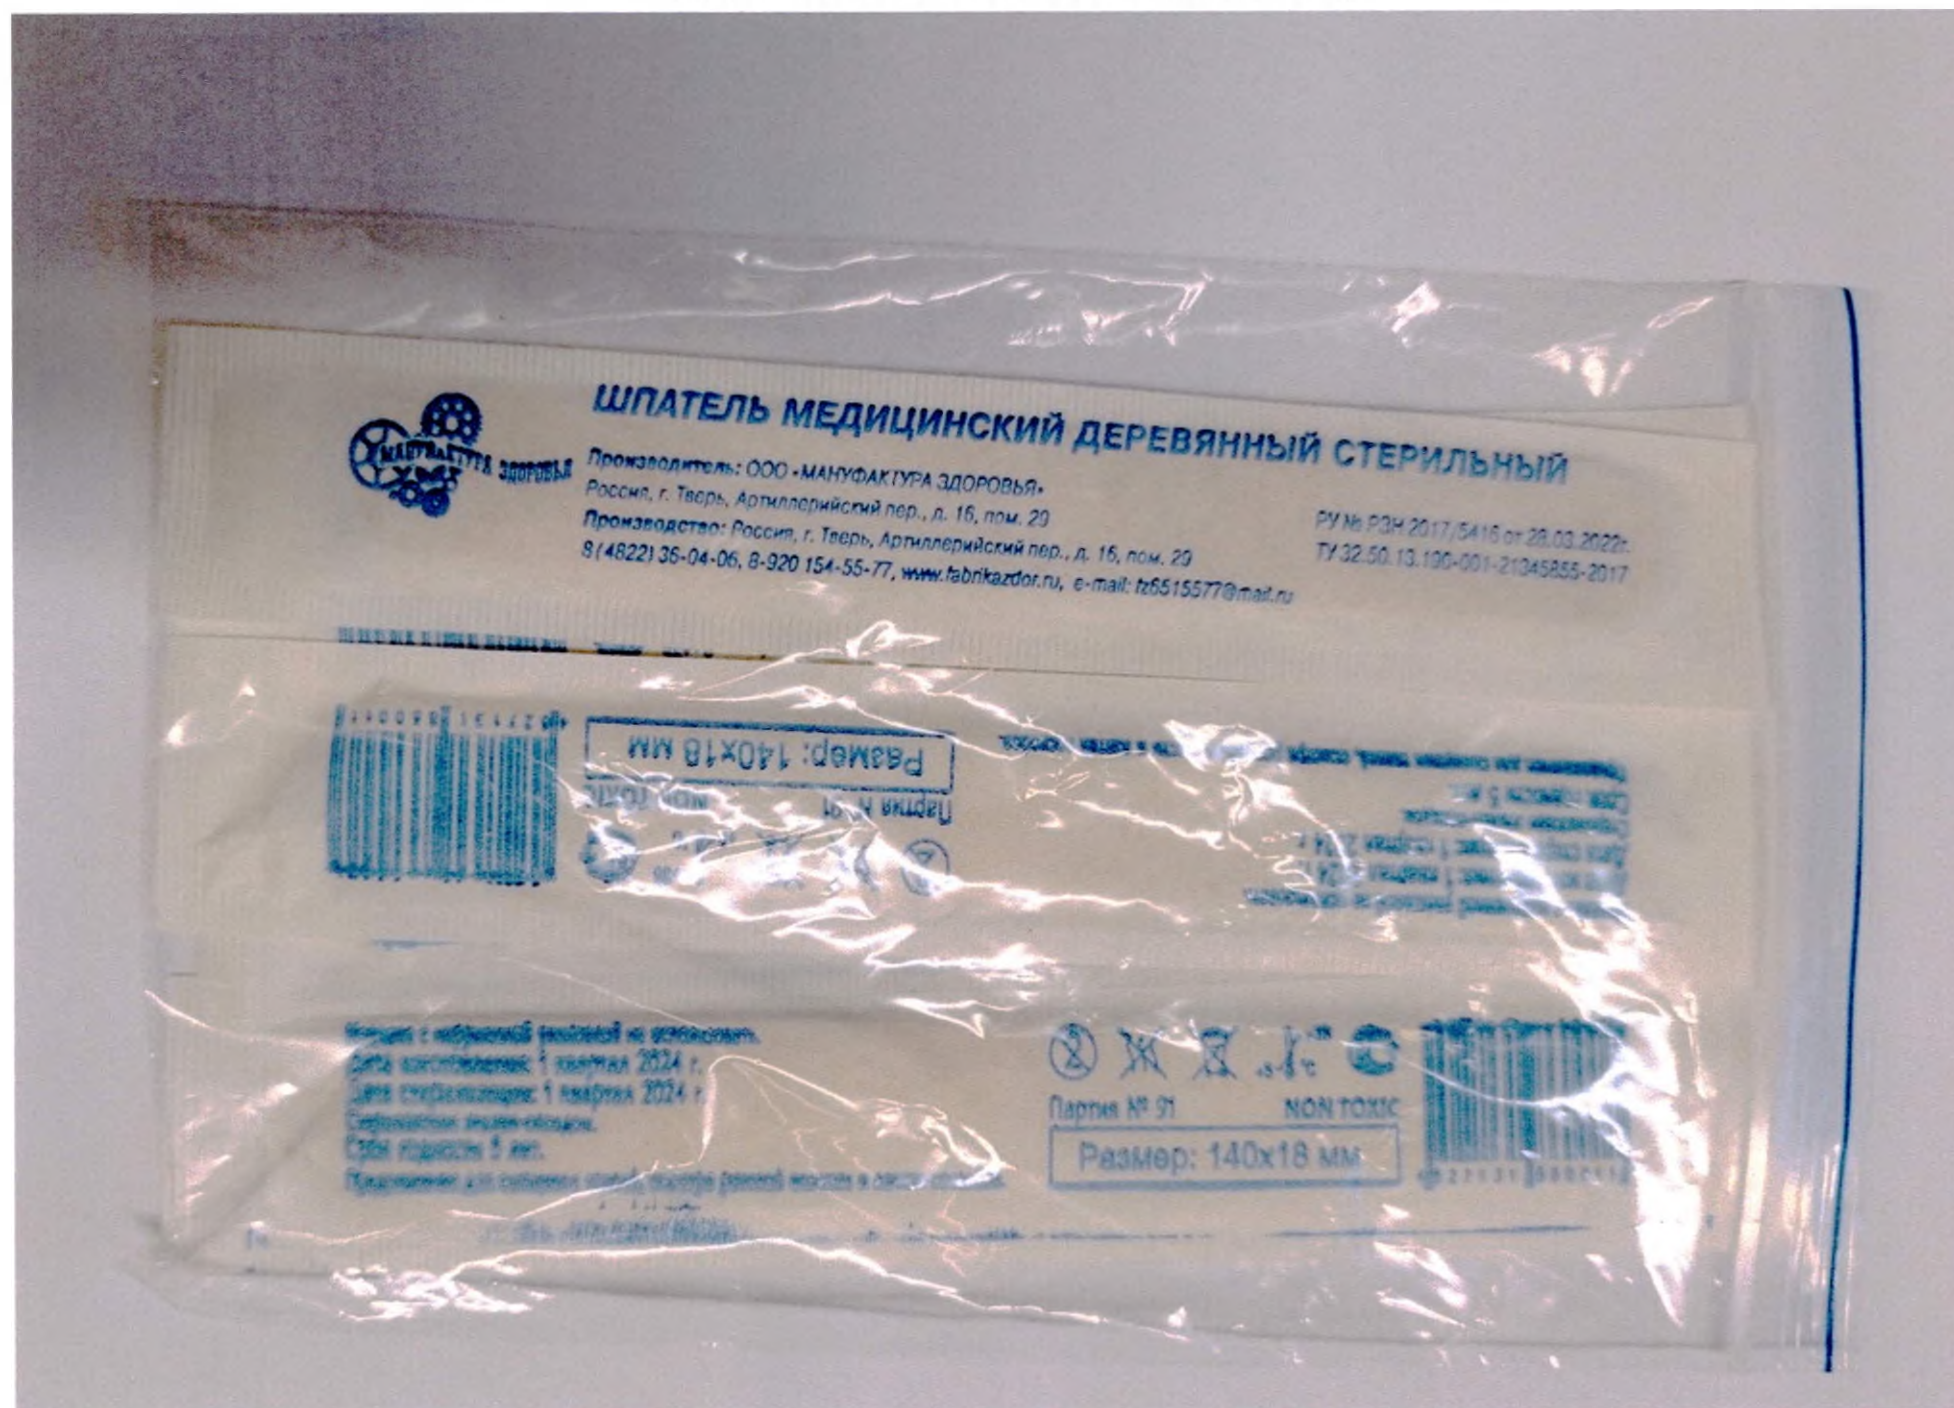

DO NOT EXPOSE
SILICA GEL
DESICCANT
DO NOT EXPOSE
SILICA GEL
DO NOT EXPOSE
SILICA GEL

SK РАПИД-СТРЕПТОКОКК-А-ИХА
ГОТОВЕ К ИСПОЛЗОВАНИЮ
ТЕСТ 1шт

2024-08 2026-08
LOT: LFAZ24001

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

57

лист (ов)

Подпись _____ Жимбиев А.Д.

М.П.

