

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»


М.Д. Хусаинов

«10» января 2024 г.



Образцы маркировки на Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом (ACT IFCC)

1. Образцы этикеток на компоненты набора «ACT IFCC»

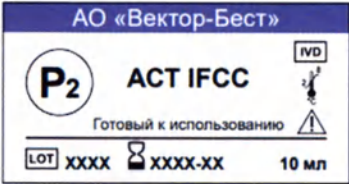Наименование компонента	Этикетка
«ACT IFCC», вариант комплектации 1	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	
«ACT IFCC», вариант комплектации 2	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	






Наименование компонента	Этикетка
«АСТ IFCC», вариант комплектации 3	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	
«АСТ IFCC», вариант комплектации 4	
Реагент 1 (P1)	

Наименование компонента	Этикетка
Реагент 2 (P2)	
«АСТ IFCC», вариант комплектации 5	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	
«АСТ IFCC», вариант комплектации 6	
Реагент 1 (P1)	

Наименование компонента	Этикетка
Реагент 2 (P2)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «ACT IFCC»

2.1. Верхняя этикетка.

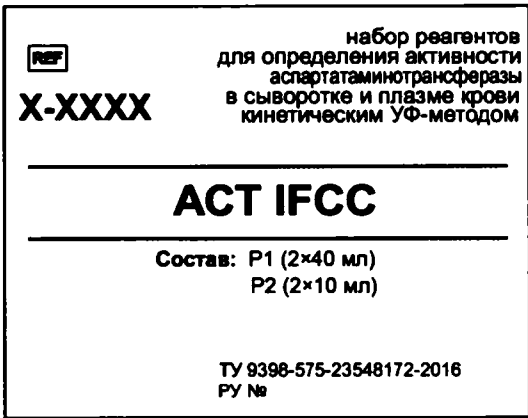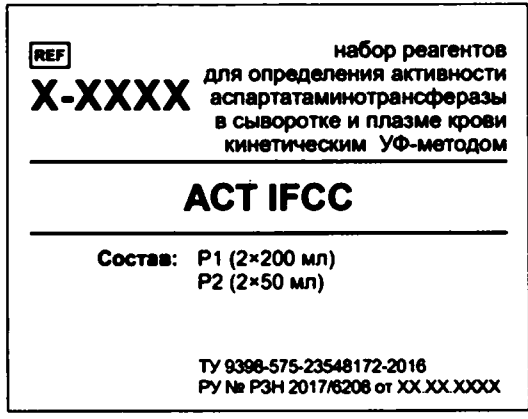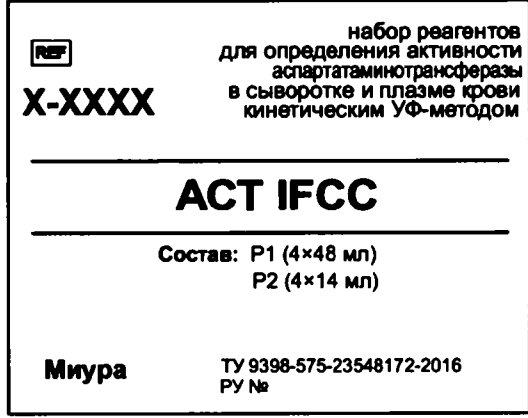
Вариант комплектации 1	
Вариант комплектации 2	
Вариант комплектации 3	

Вариант комплектации 4	REF набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом X-XXXX ACT IFCC Состав: P1 (10×78 мл) P2 (5×42 мл) Таурус ТУ 9398-575-23548172-2016 РУ №
Вариант комплектации 5	REF набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом X-XXXX ACT IFCC Состав: P1 (8×60 мл) P2 (6×20 мл) BA400 ТУ 9398-575-23548172-2016 РУ №
Вариант комплектации 6	REF набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом X-XXXX ACT IFCC Состав: P1 (12×52 мл) P2 (12×15 мл) Аспект ТУ 9398-575-23548172-2016 РУ №


2.2. Боковая этикетка

Вариант комплектации 1, 2	REF X-XXXX LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX ACT IFCC IVD ! ☞ ☞ XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения
---------------------------	--


Вариант комплектации 3

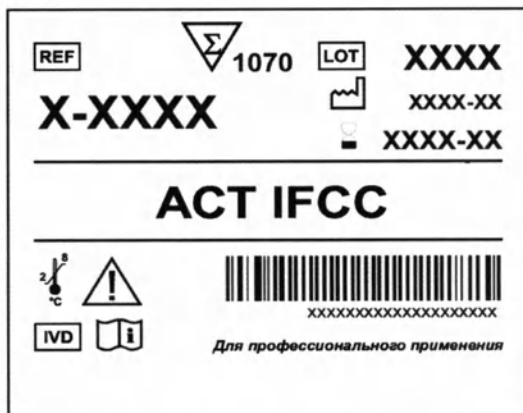


Вариант комплектации 4

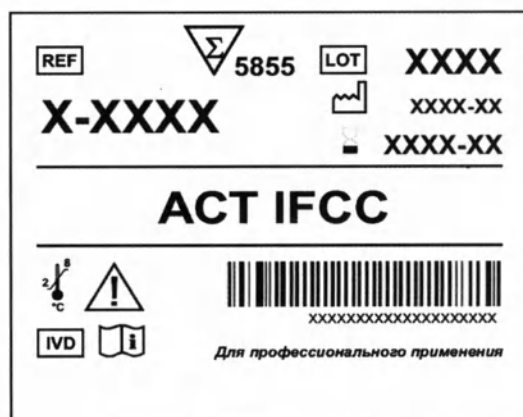

Вариант комплектации 5

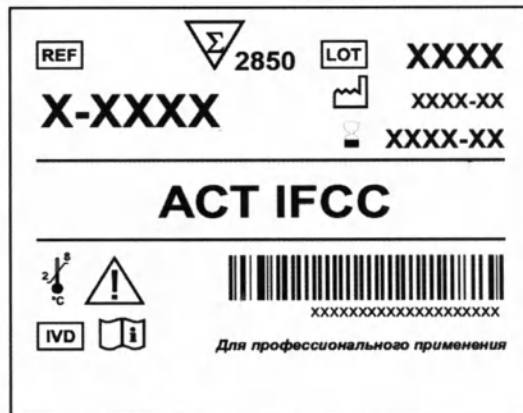

Вариант комплектации 6

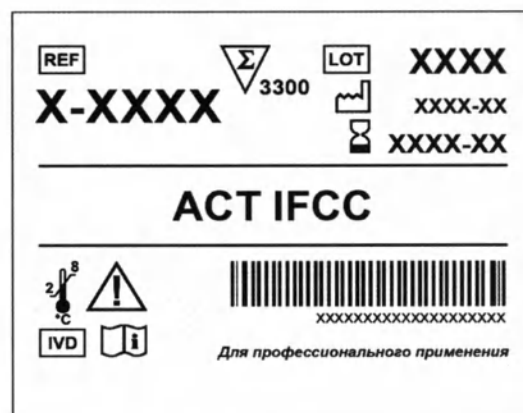

2.3. Боковая этикетка №2



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 белме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Примечание. Текст боковой этикетки №2 может быть нанесен непосредственно на коробку типографским способом

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»

В.К. Ткачев

«10» 01 2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 7 листов.

Директор по технологии и качеству

АО «Вектор-Бест»



Масяго Масяго А.В.

«15»

06

20 24 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




 Хусаинов М.Д.

«15» января 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АСПАРТАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ
В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ КИНЕТИЧЕСКИМ УФ-МЕТОДОМ
(АСТ IFCC)


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
 «ACT IFCC»
 Вариант комплектации 1, Серия 1

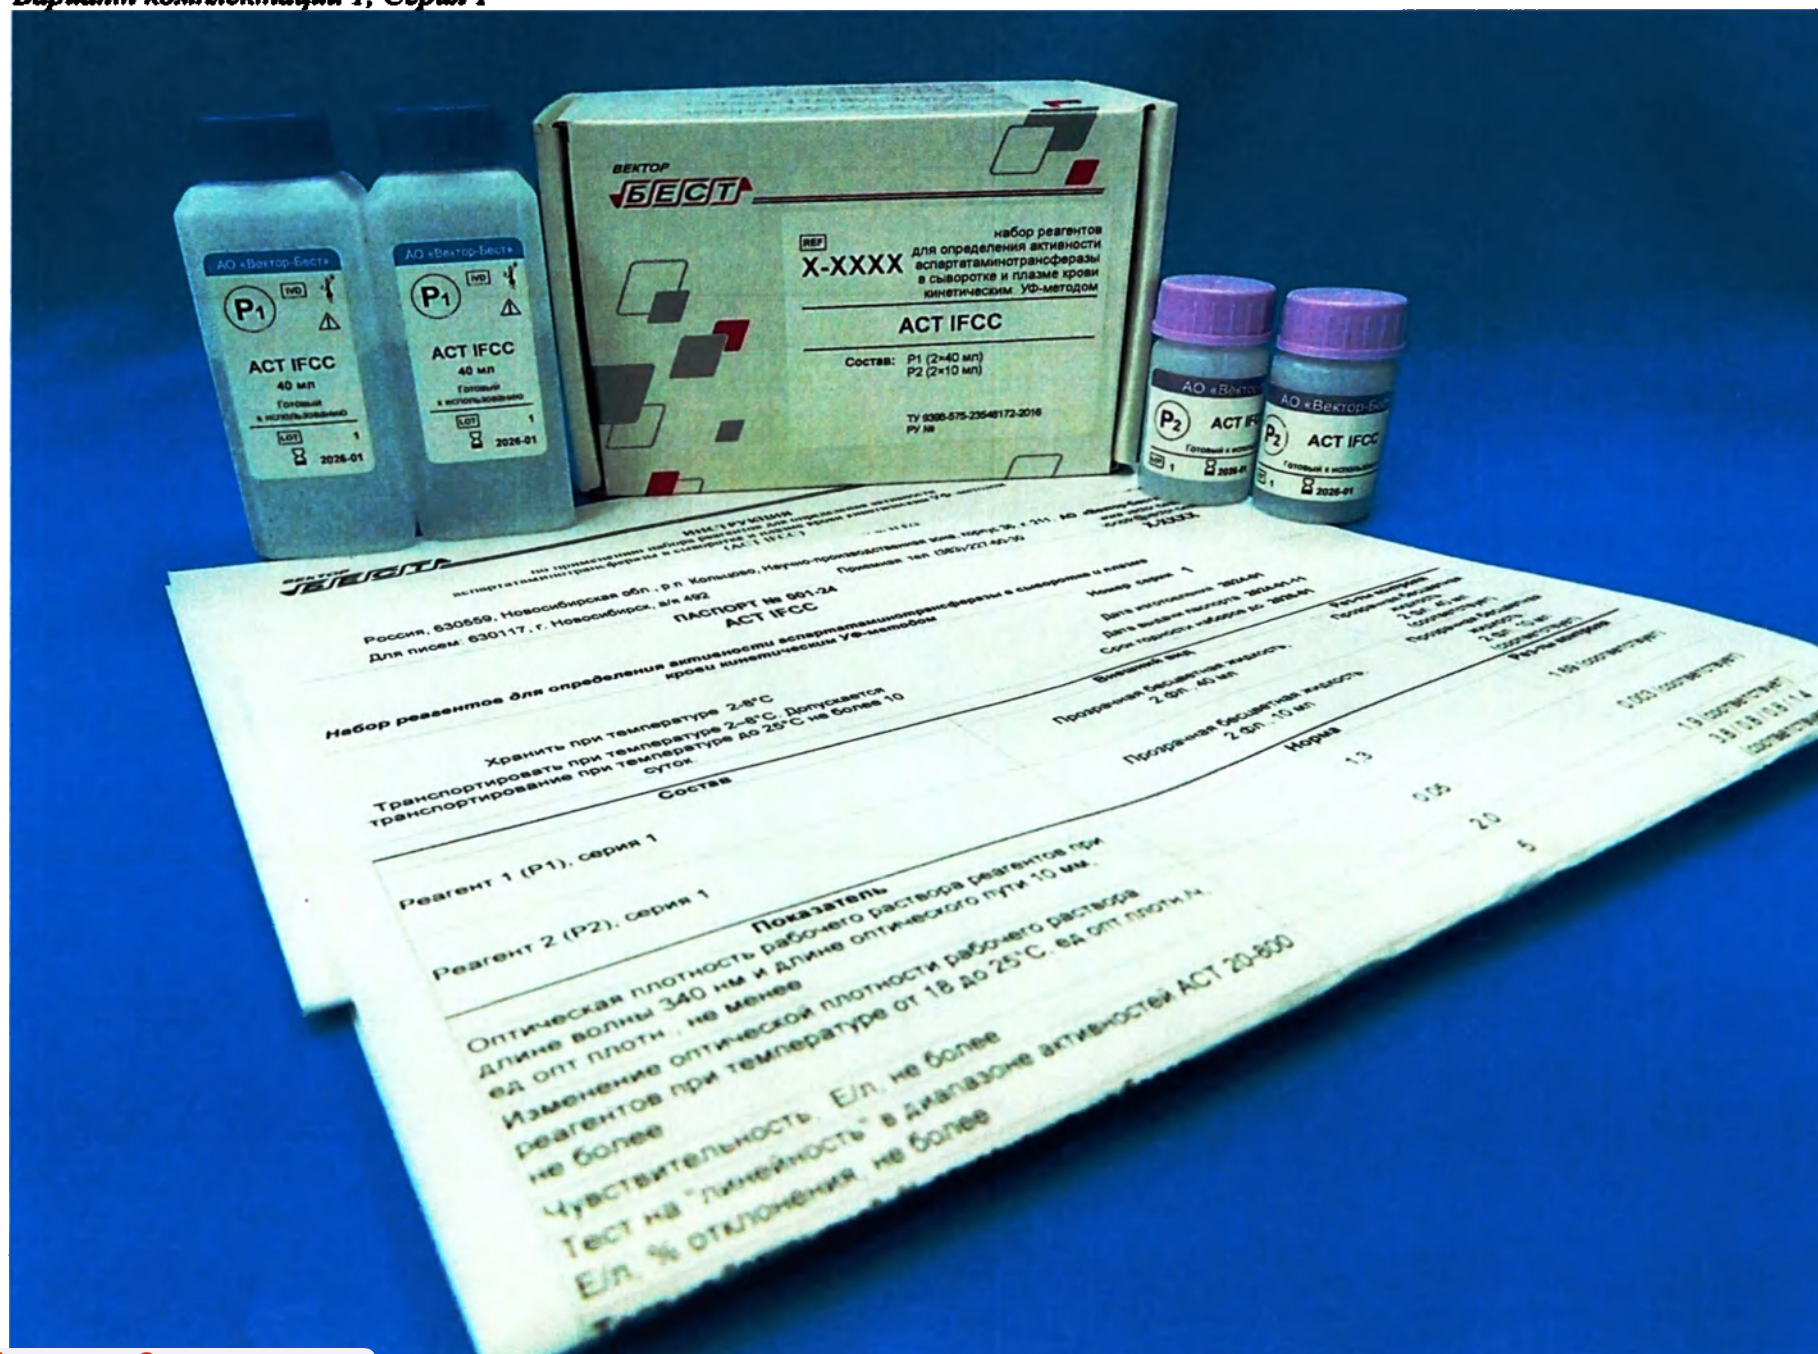

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АСТ IFCC» №1

Вариант комплектации 1, Серия 1

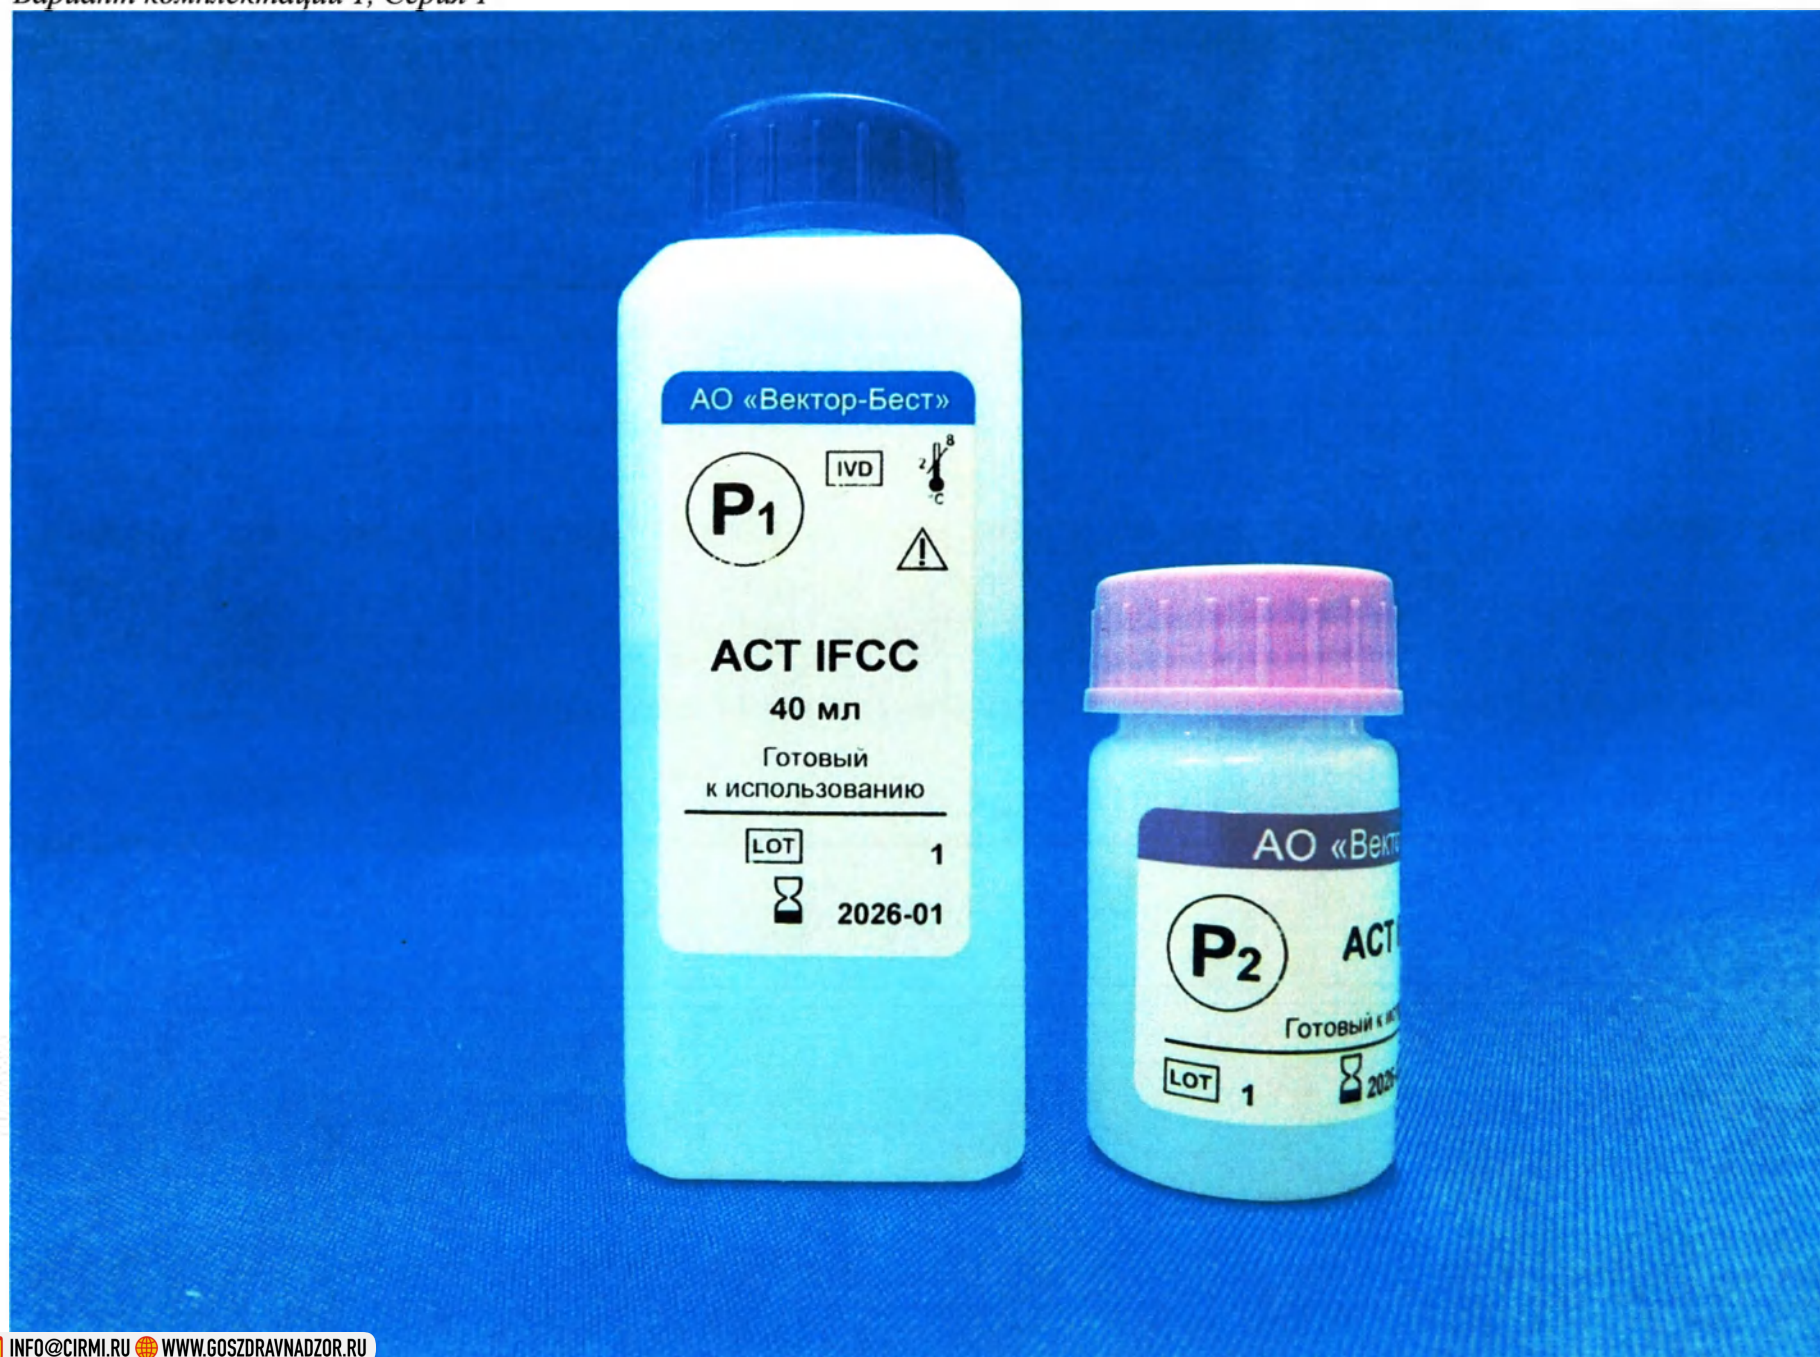


Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АСТ IFCC» №2

Вариант комплектации 1, Серия 1




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №3
Вариант комплектации 1, Серия 1

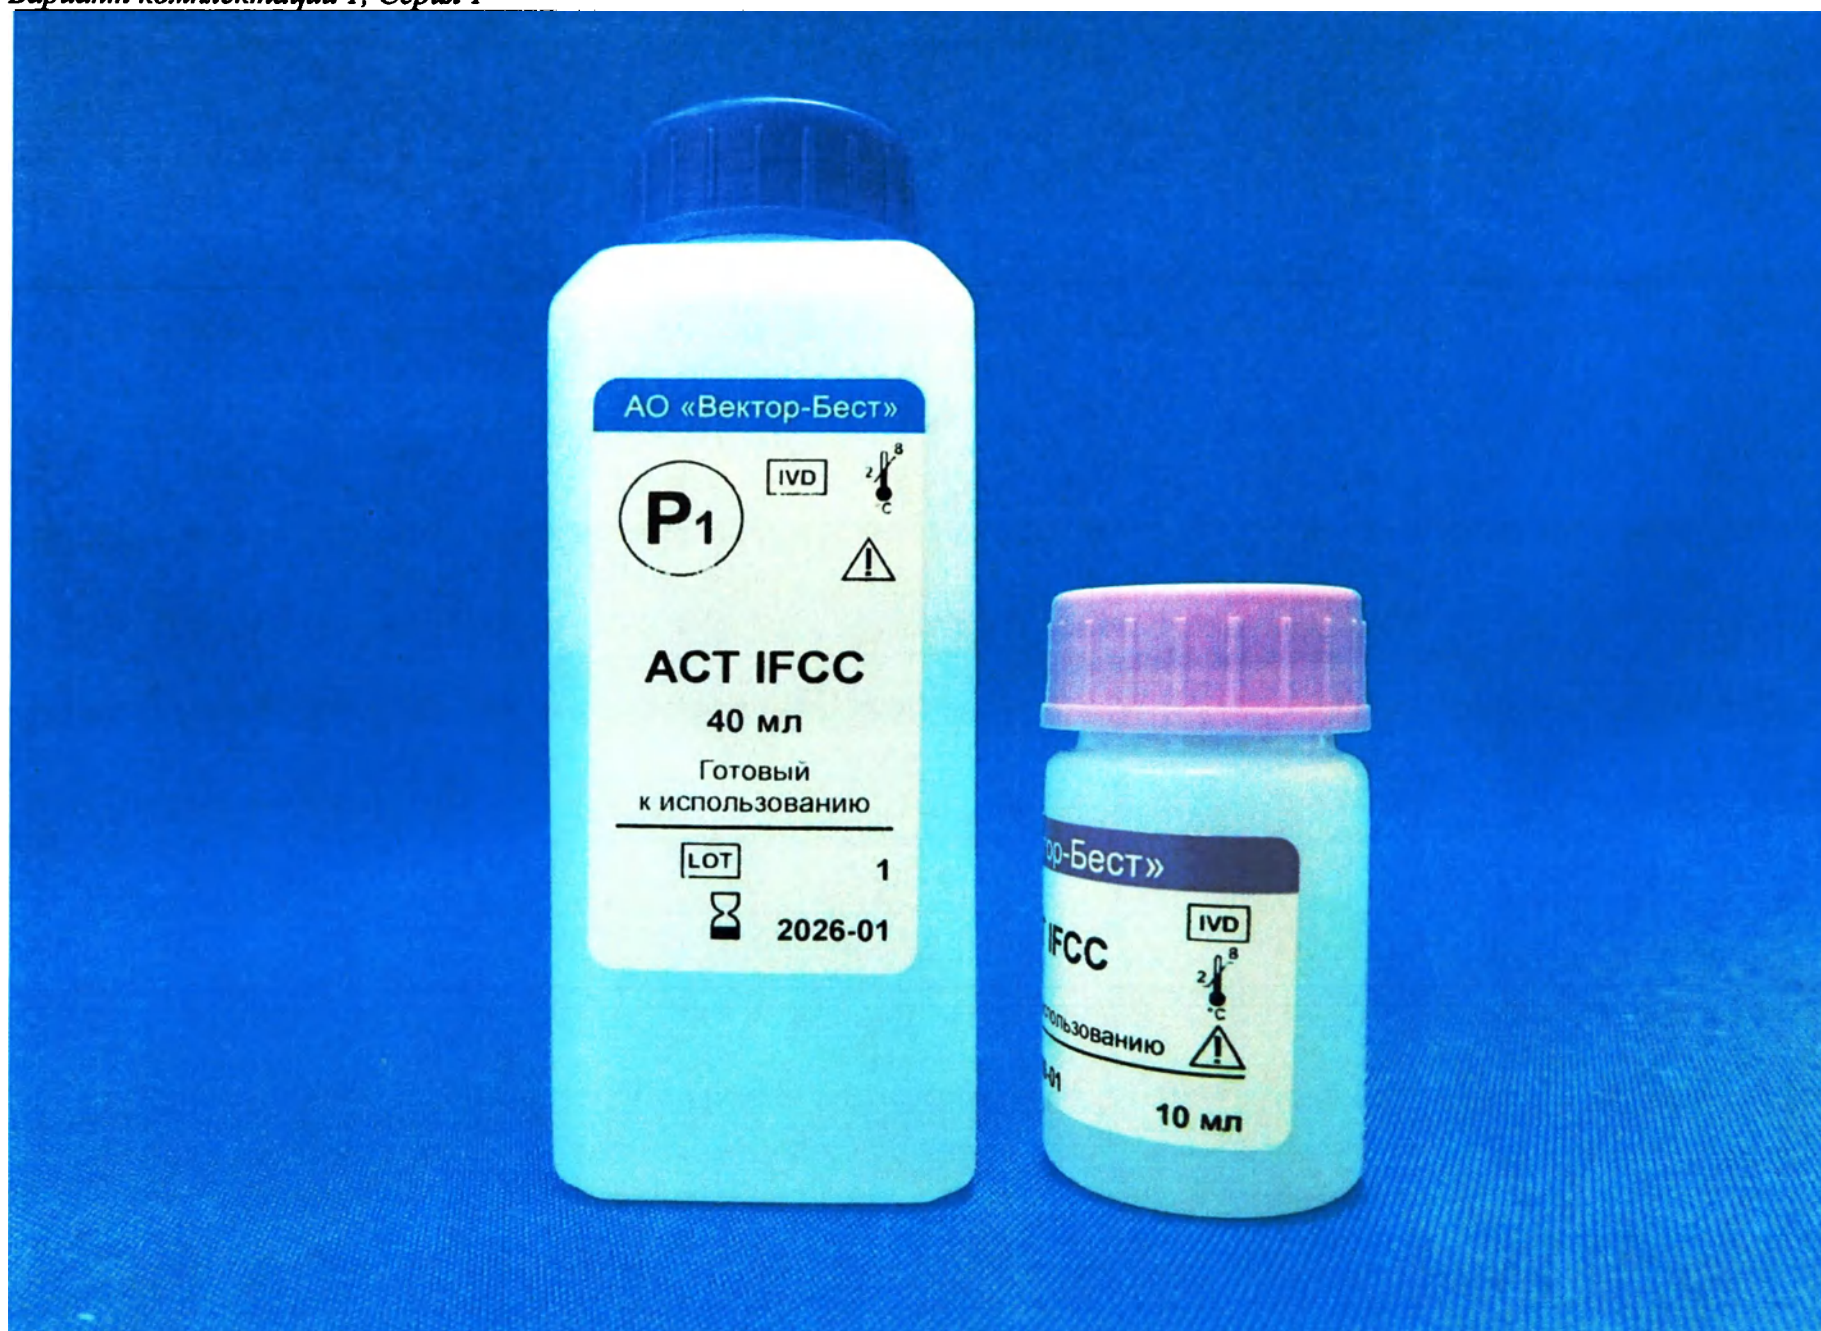

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №1

Вариант комплектации 1, Серия 1

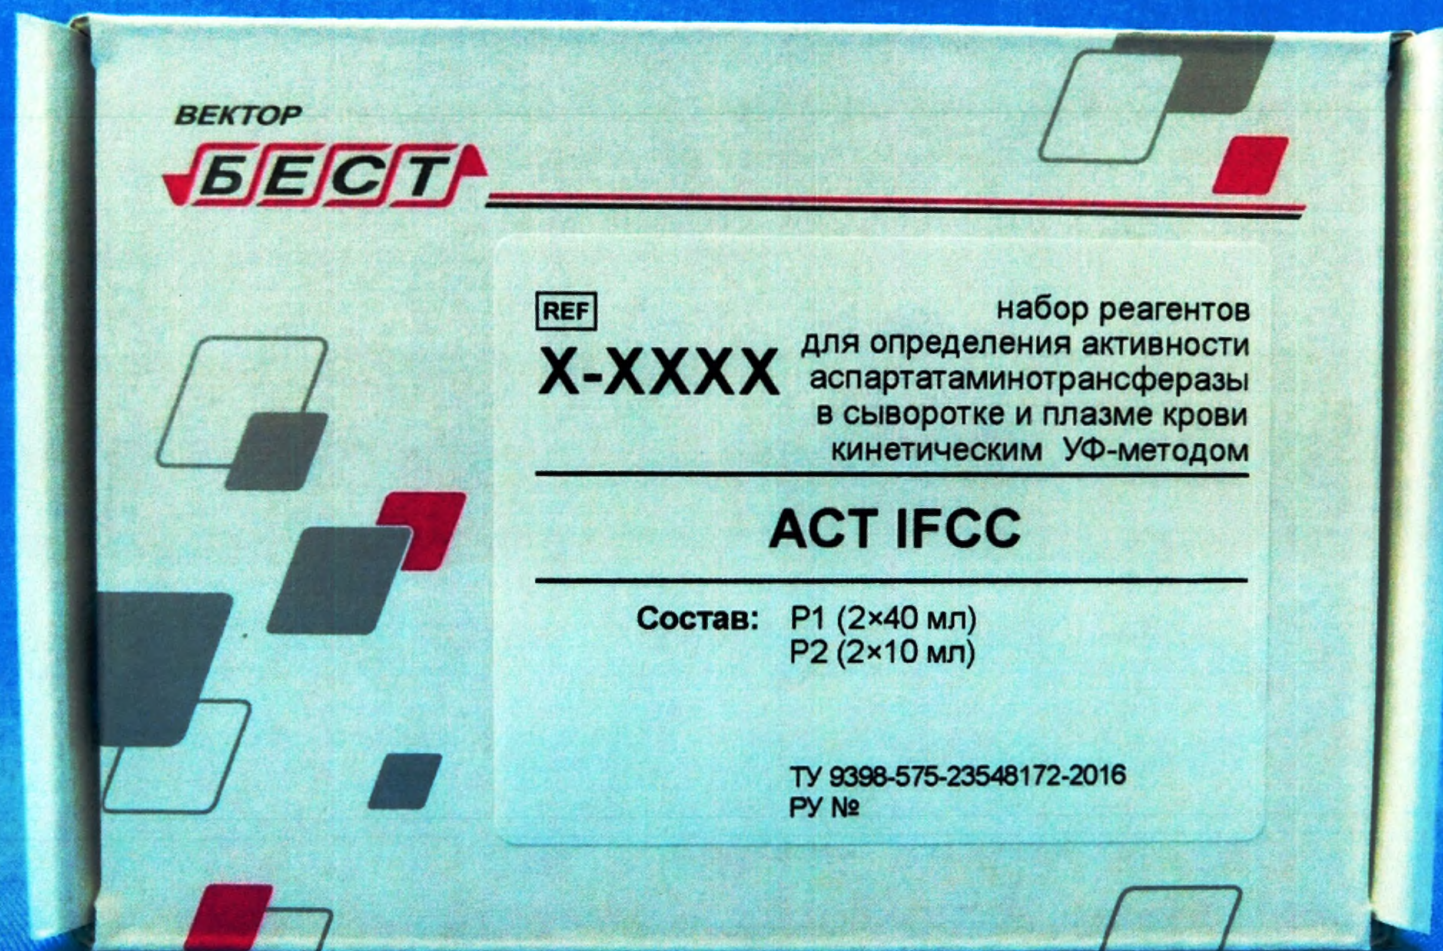

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №2

Вариант комплектации 1, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №3

Вариант комплектации 1, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«ACT IFCC»

Вариант комплектации 2, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №1


Вариант комплектации 2, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №1


Вариант комплектации 2, Серия 1

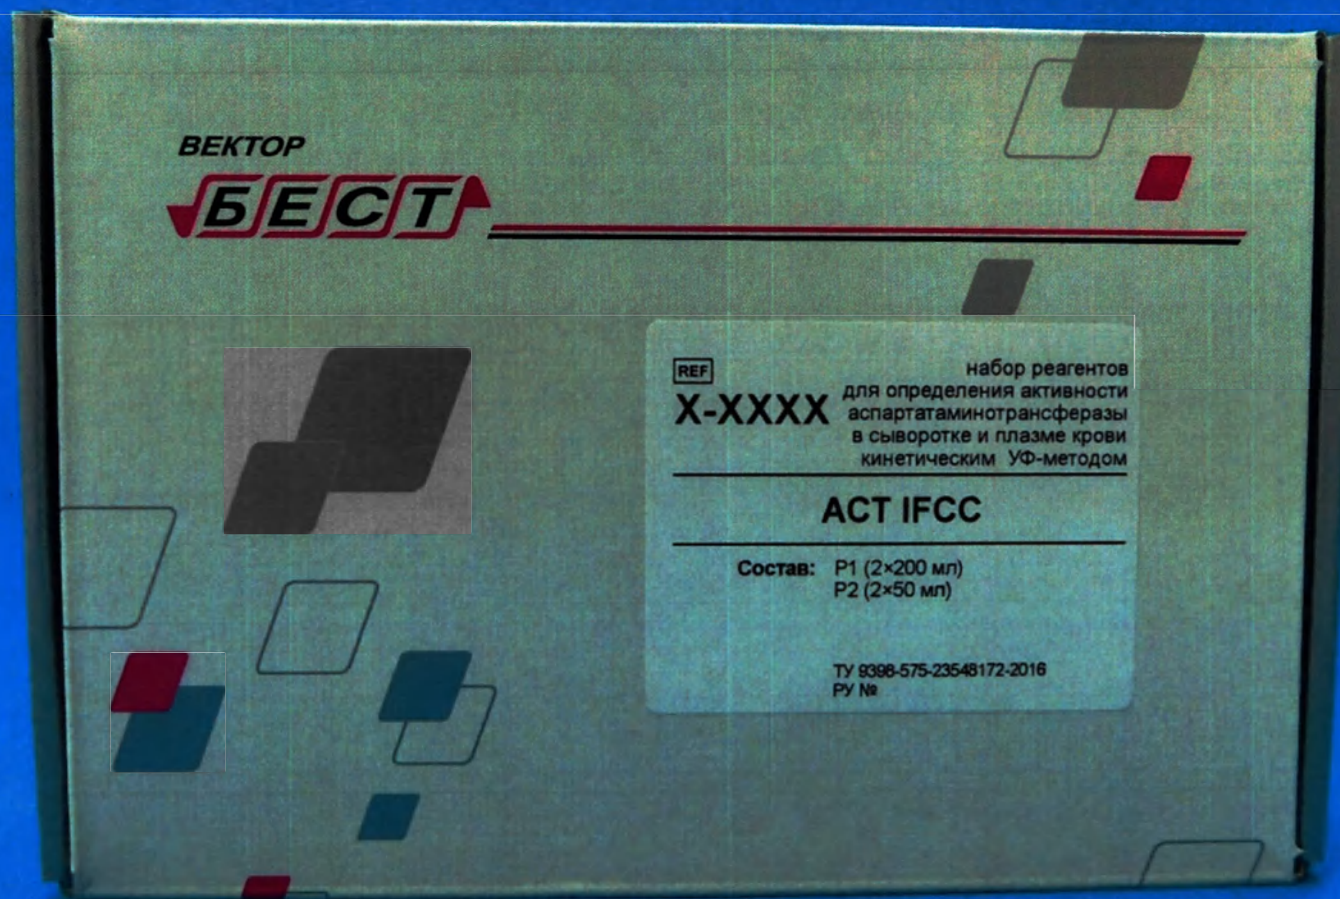

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №2

Вариант комплектации 2, Серия 1

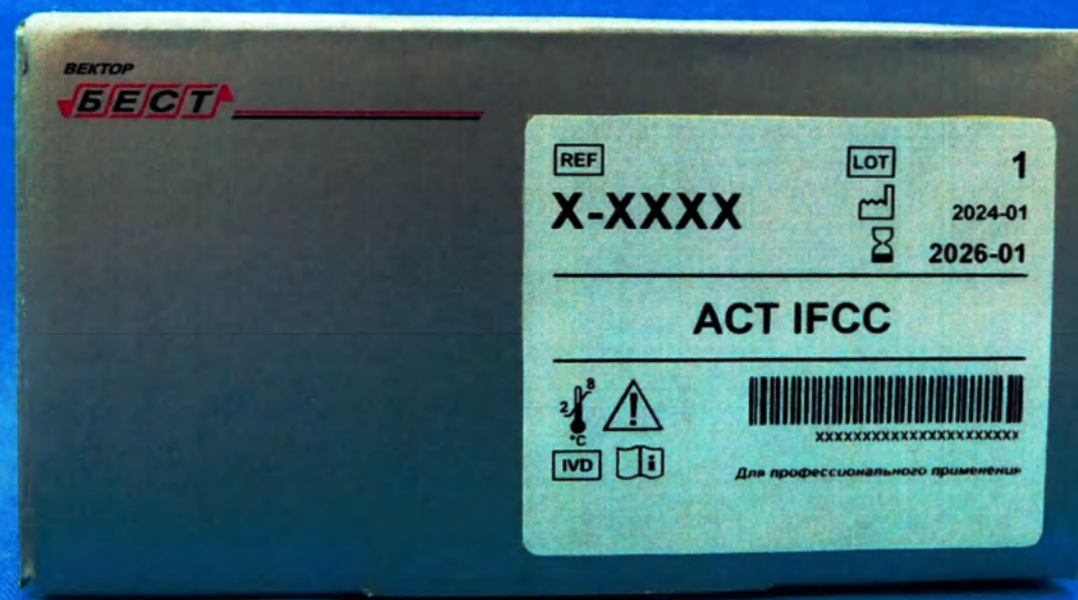


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом

«АСТ IFCC» №3

Вариант комплектации 2, Серия 1

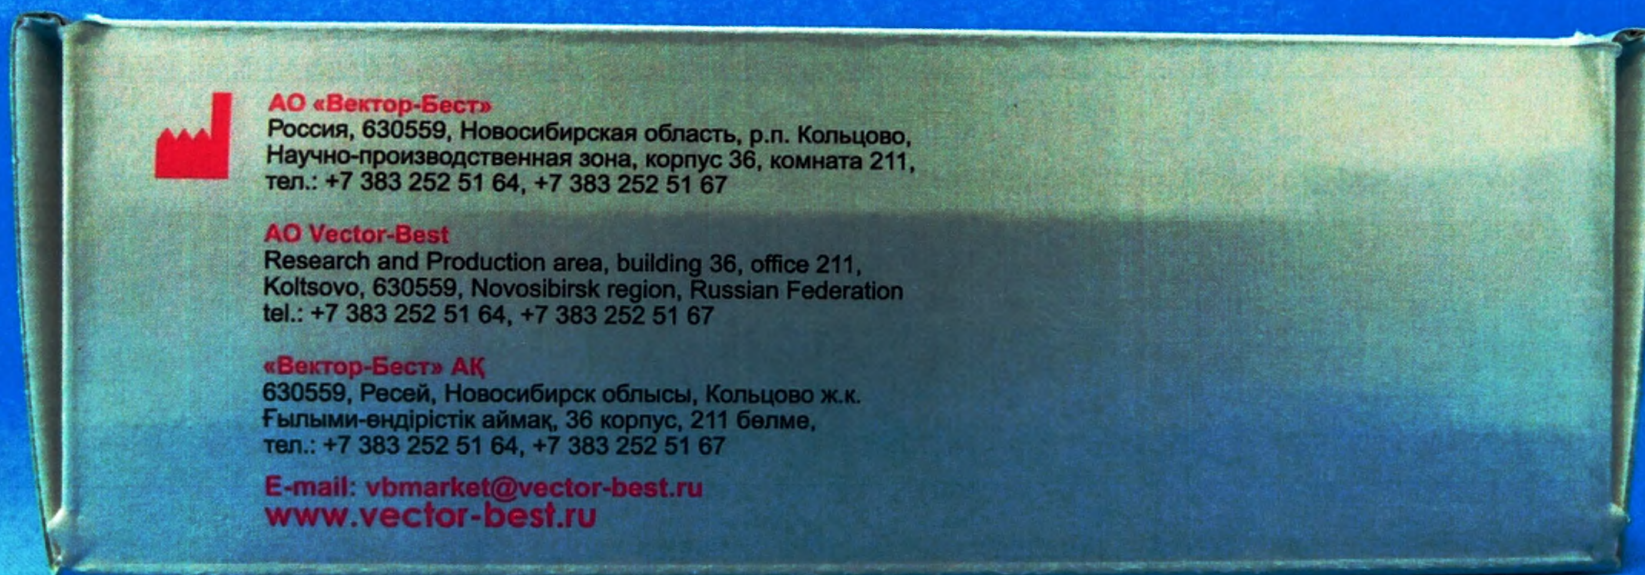


Вариант комплектации 3, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АСТ IFCC» №1

Вариант комплектации 3, Серия 1

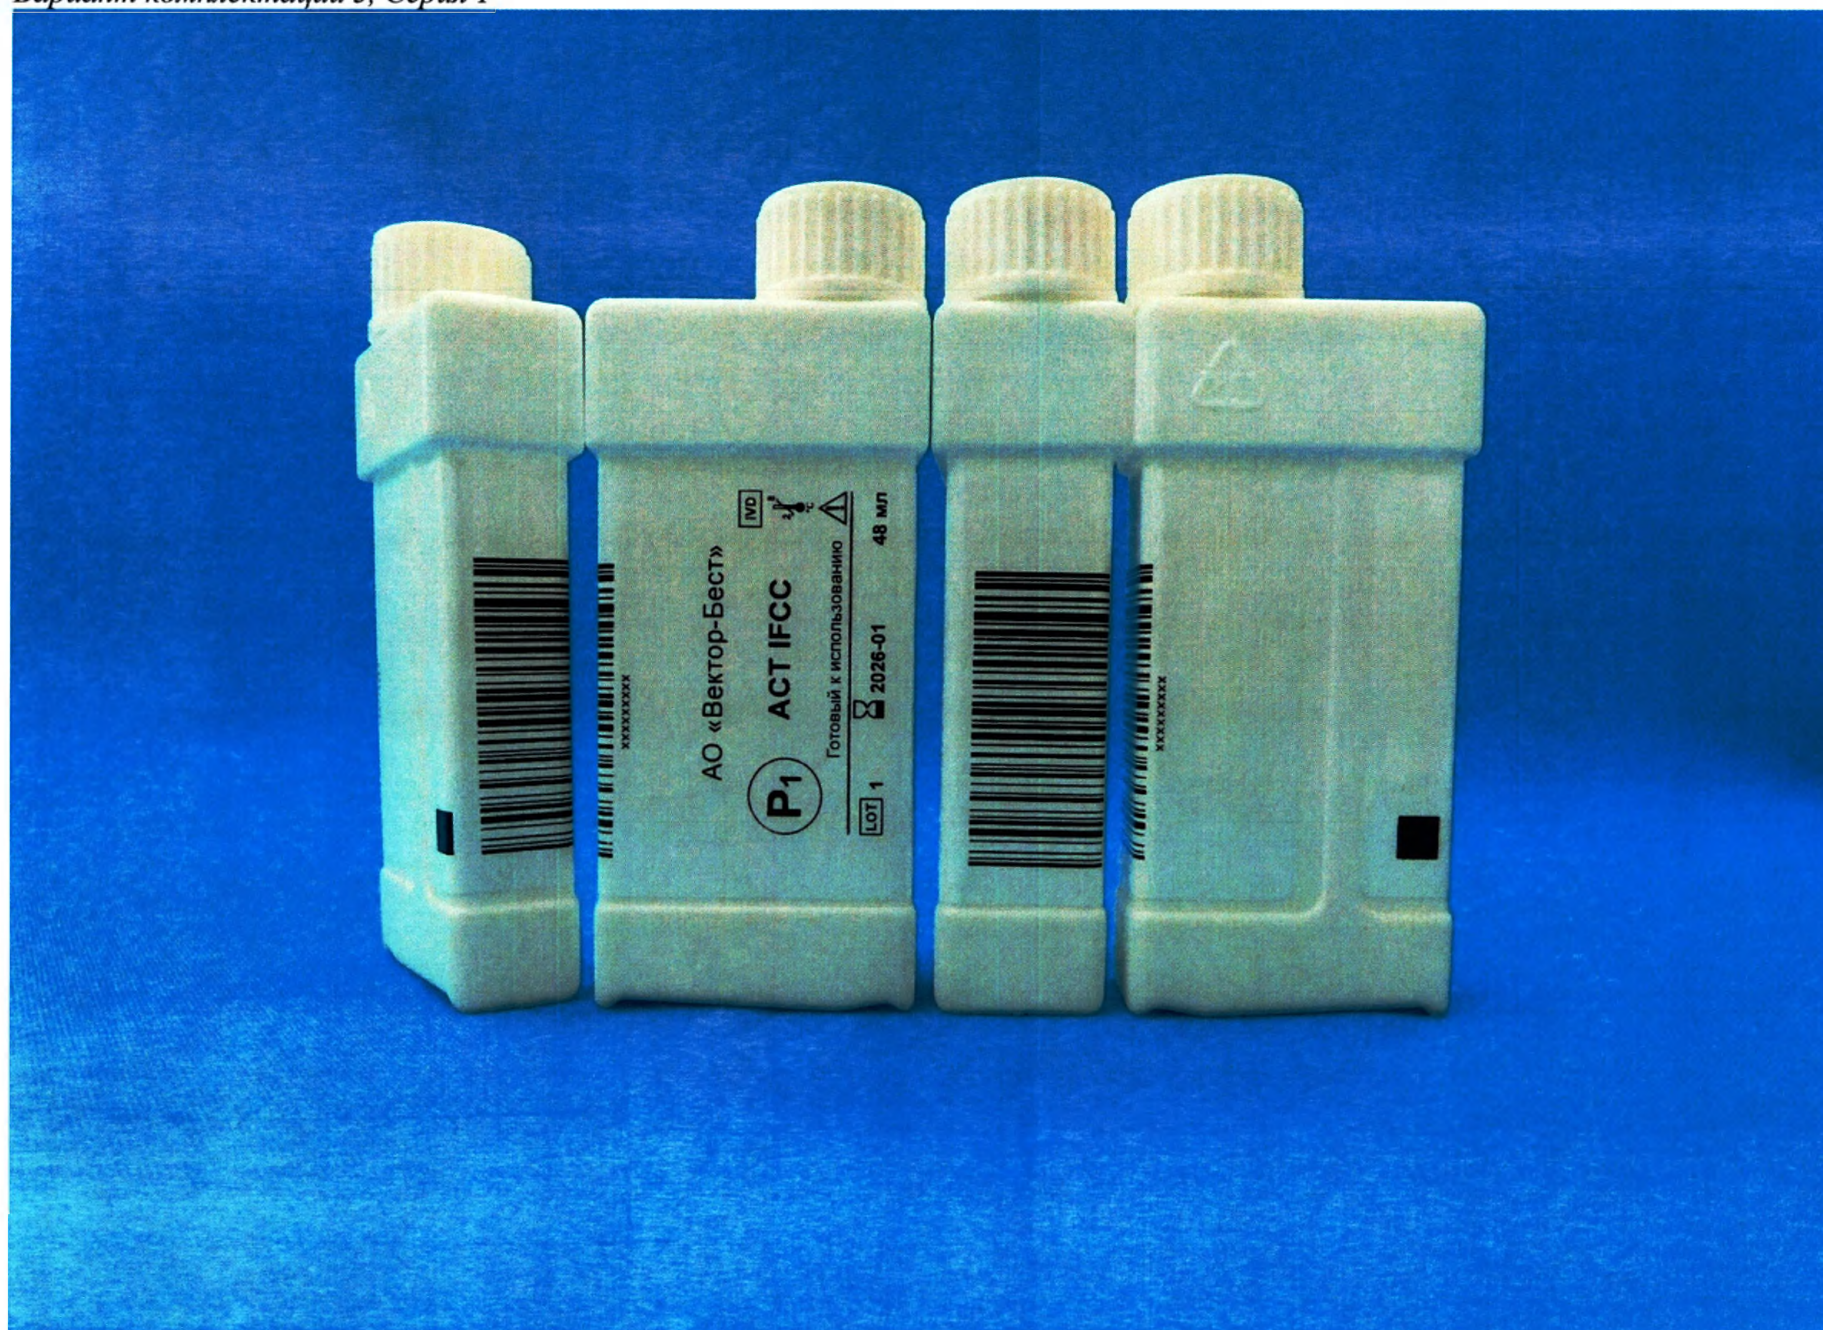

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АСТ IFCC» №2


Вариант комплектации 3, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №1

Вариант комплектации 3, Серия 1

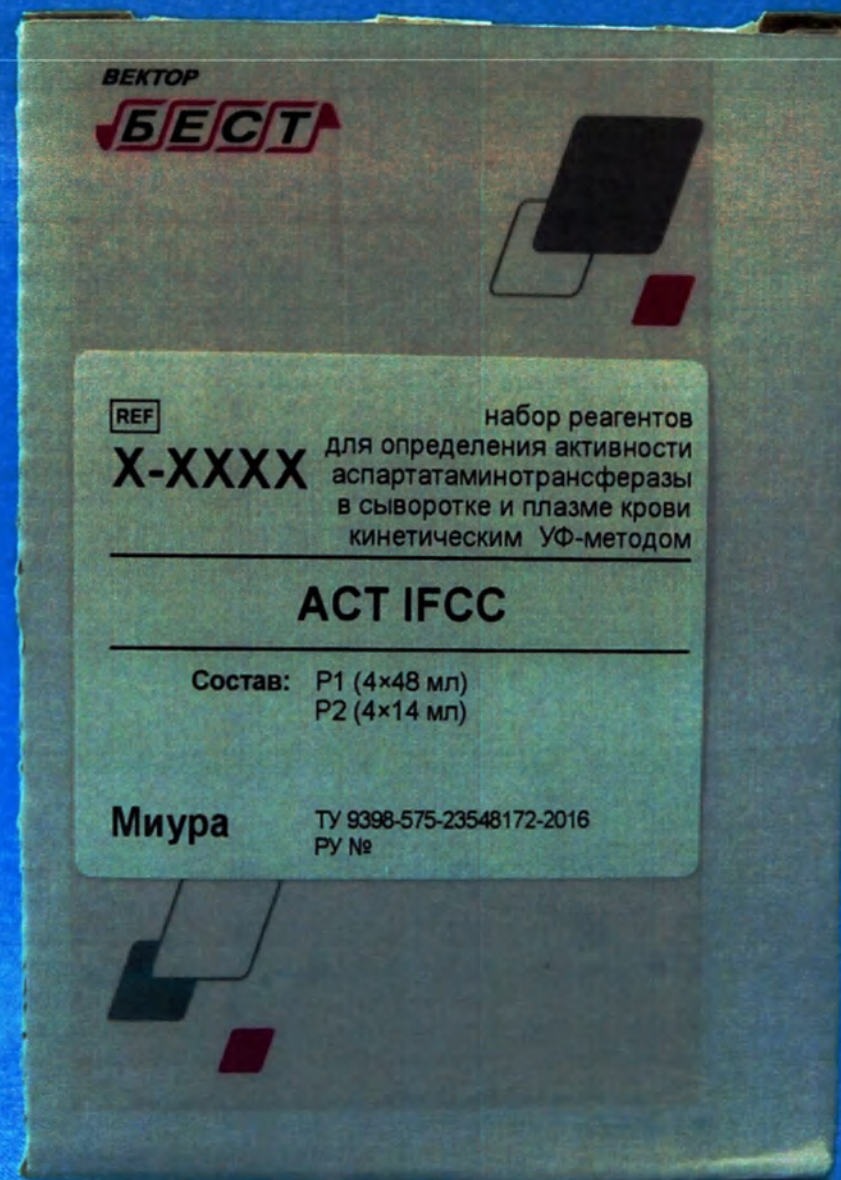

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №2

Вариант комплектации 3, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №3

Вариант комплектации 3, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

АО Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АСТ IFCC»


Вариант комплектации 4, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АСТ IFCC» №1


Вариант комплектации 4, Серия 1

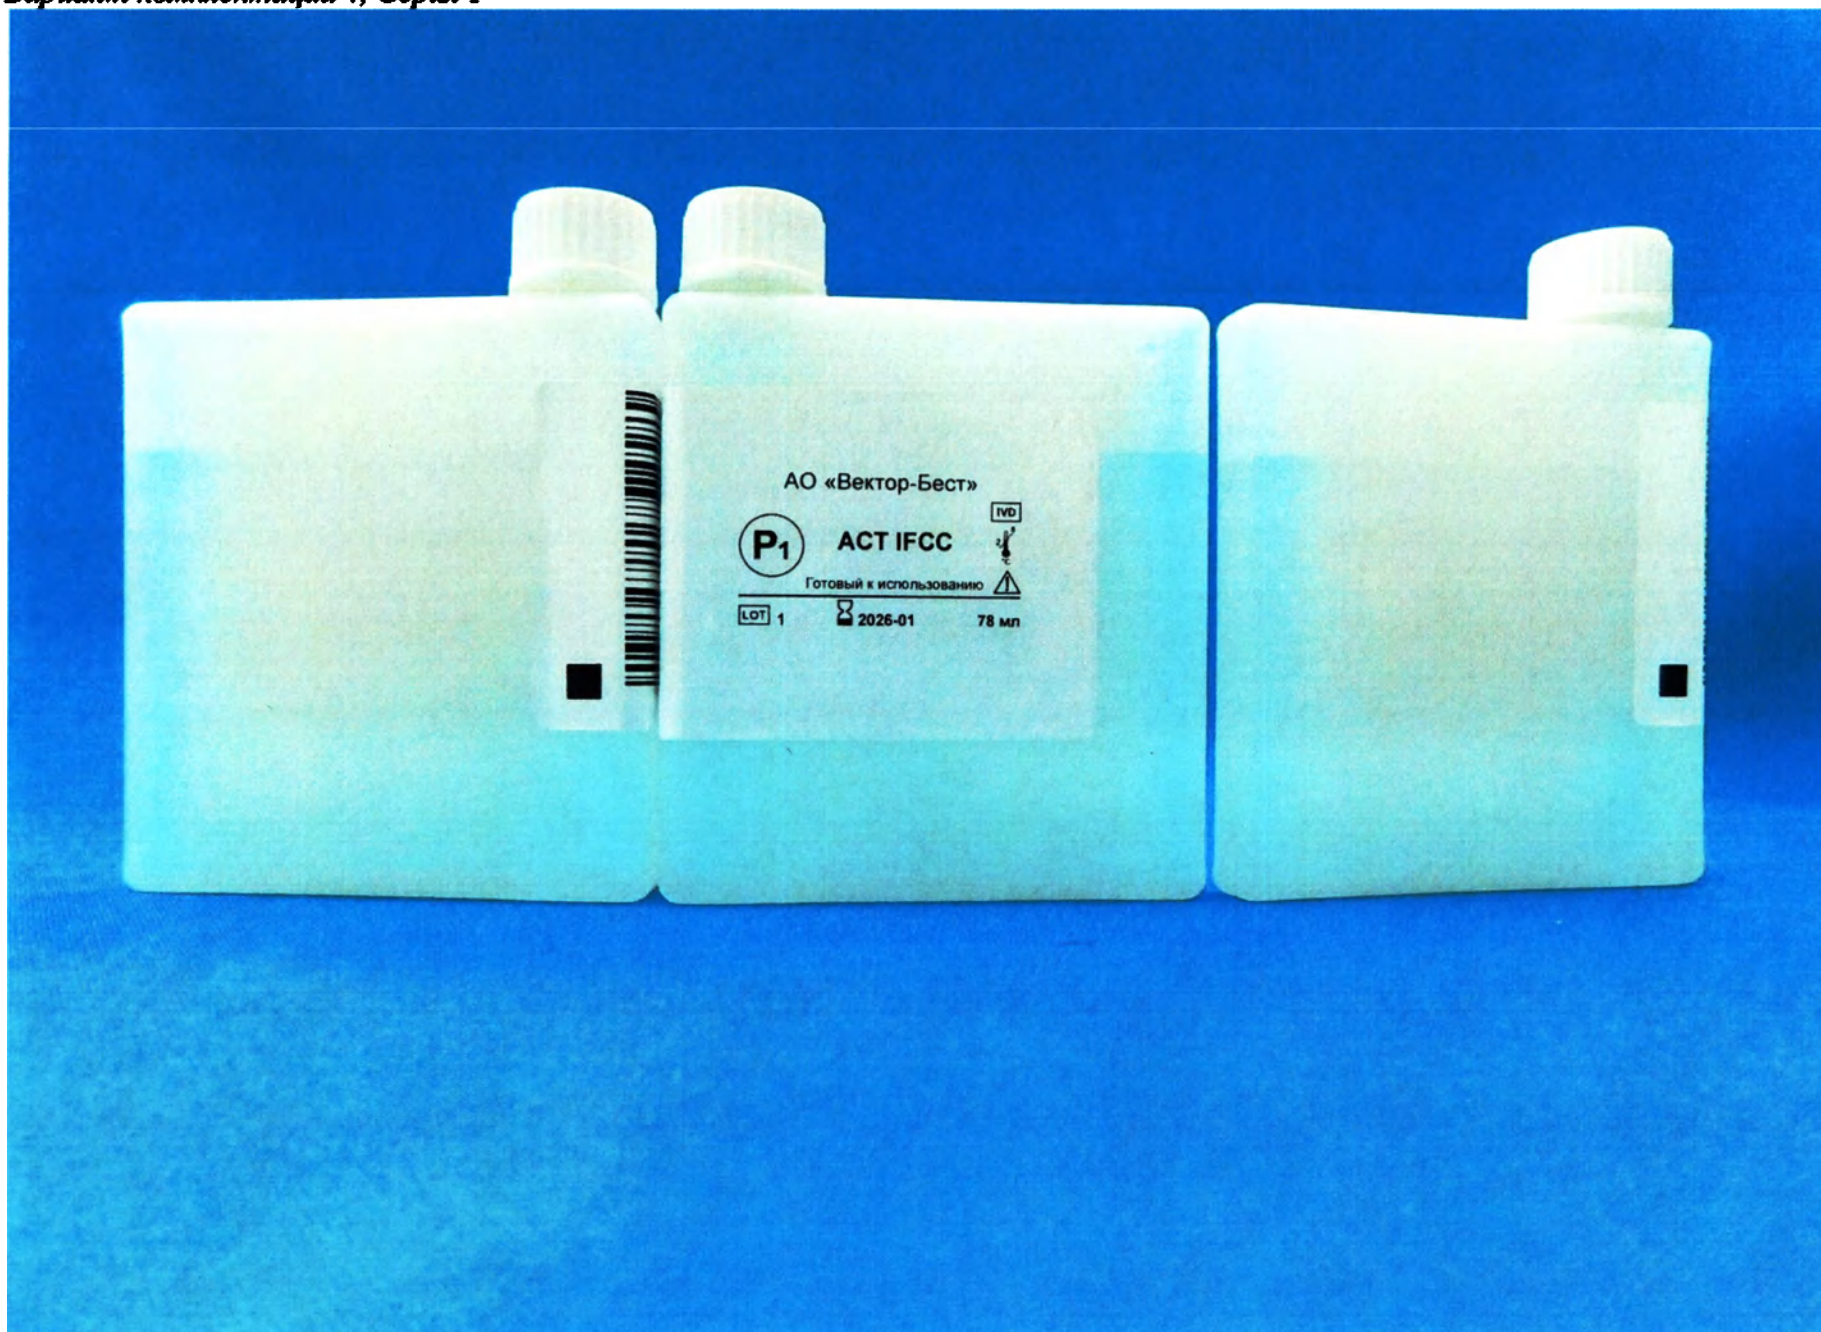

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АСТ IFCC» №2


Вариант комплектации 4, Серия 1

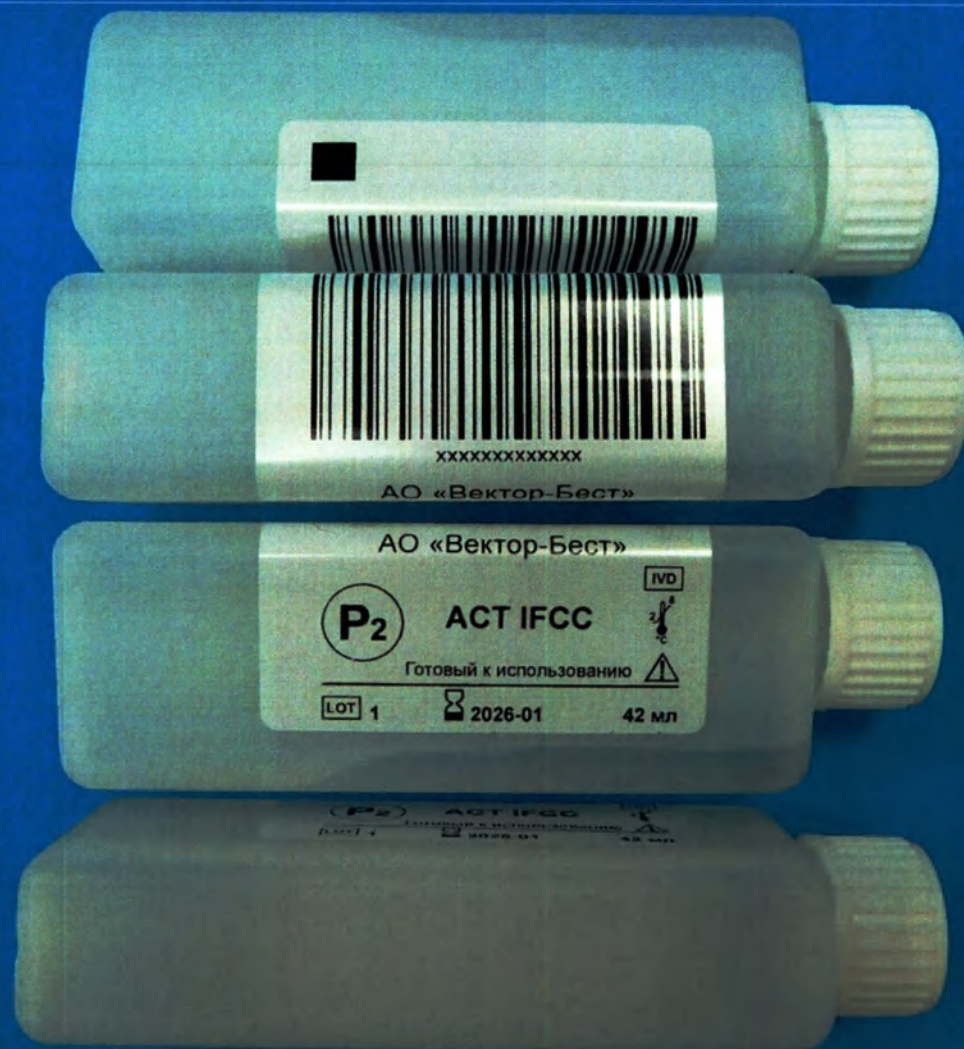

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АСТ IFCC» №1

Вариант комплектации 4, Серия 1

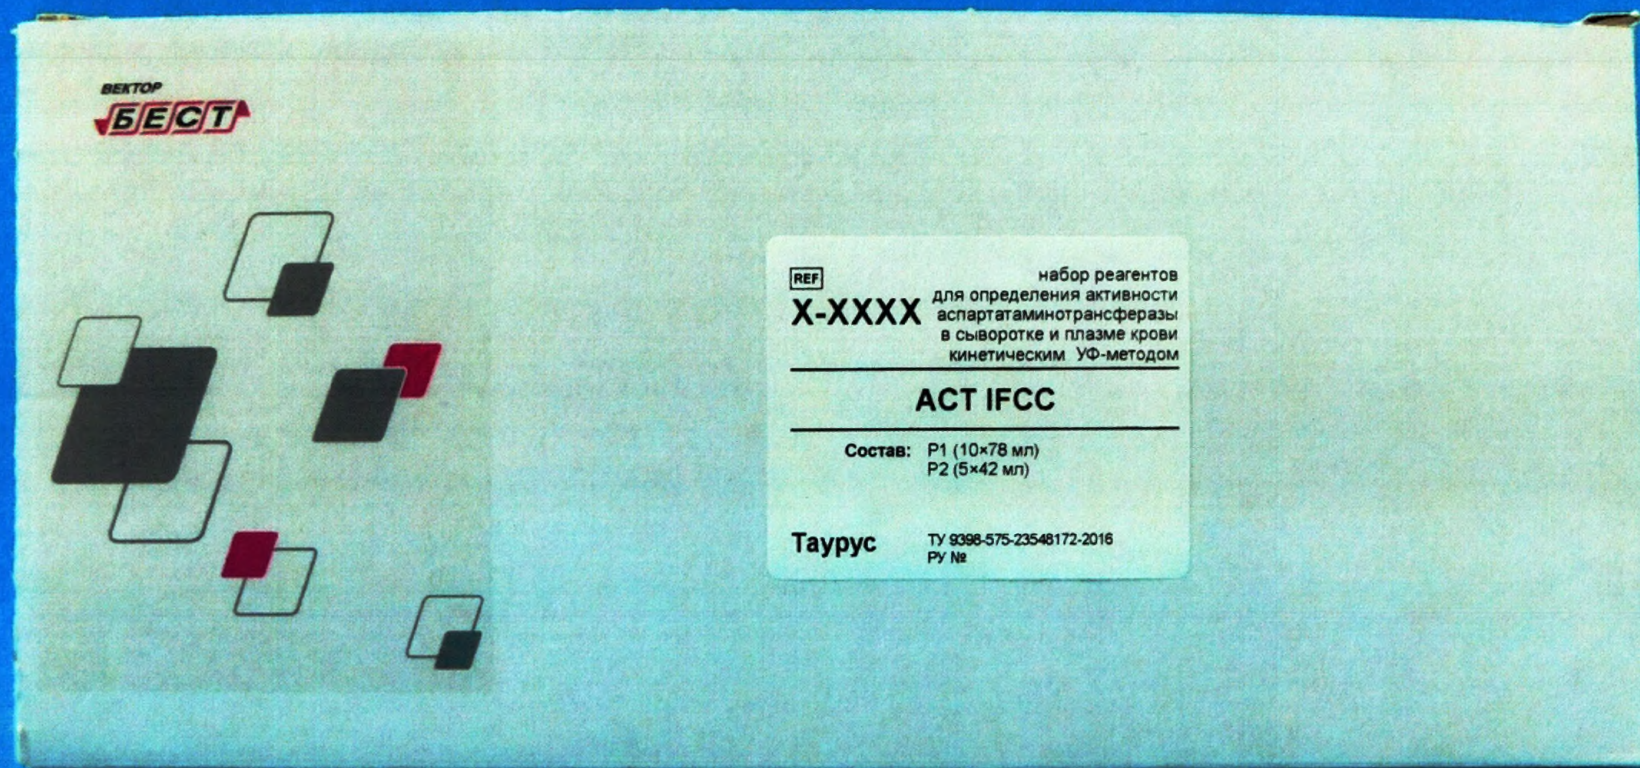

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «ACT IFCC» №2

Вариант комплектации 4, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №3

Вариант комплектации 4, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

АО Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**

Вариант комплектации 5, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №1

Вариант комплектации 5, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №2


Вариант комплектации 5, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №1

Вариант комплектации 5, Серия 1

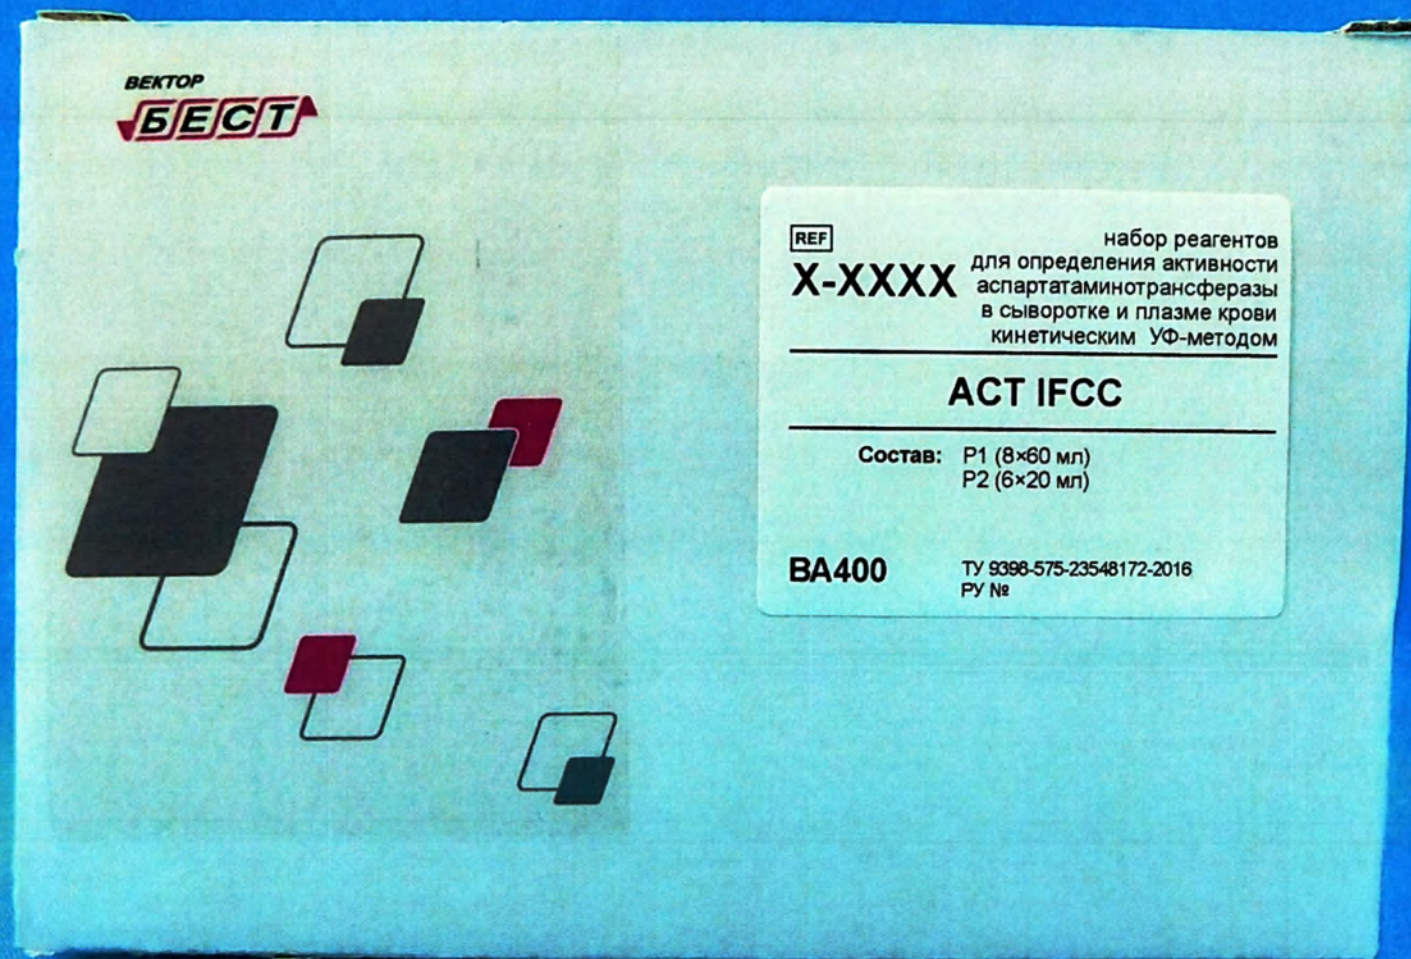

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №2

Вариант комплектации 5, Серия 1





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ


630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №1

Вариант комплектации 6, Серия 1

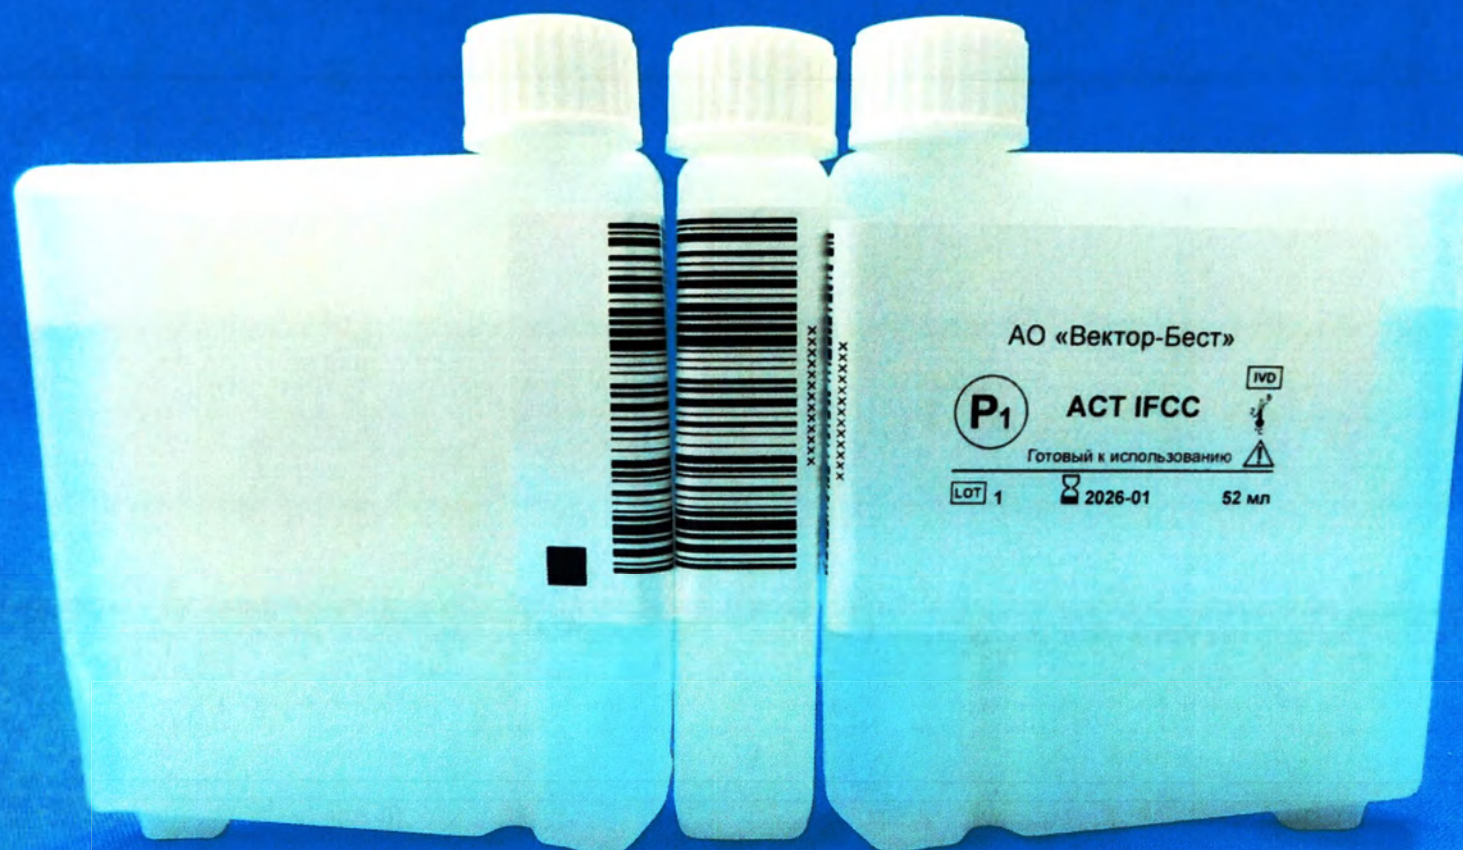

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АСТ IFCC» №2


Вариант комплектации 6, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспаратаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №1

Вариант комплектации 6, Серия 1

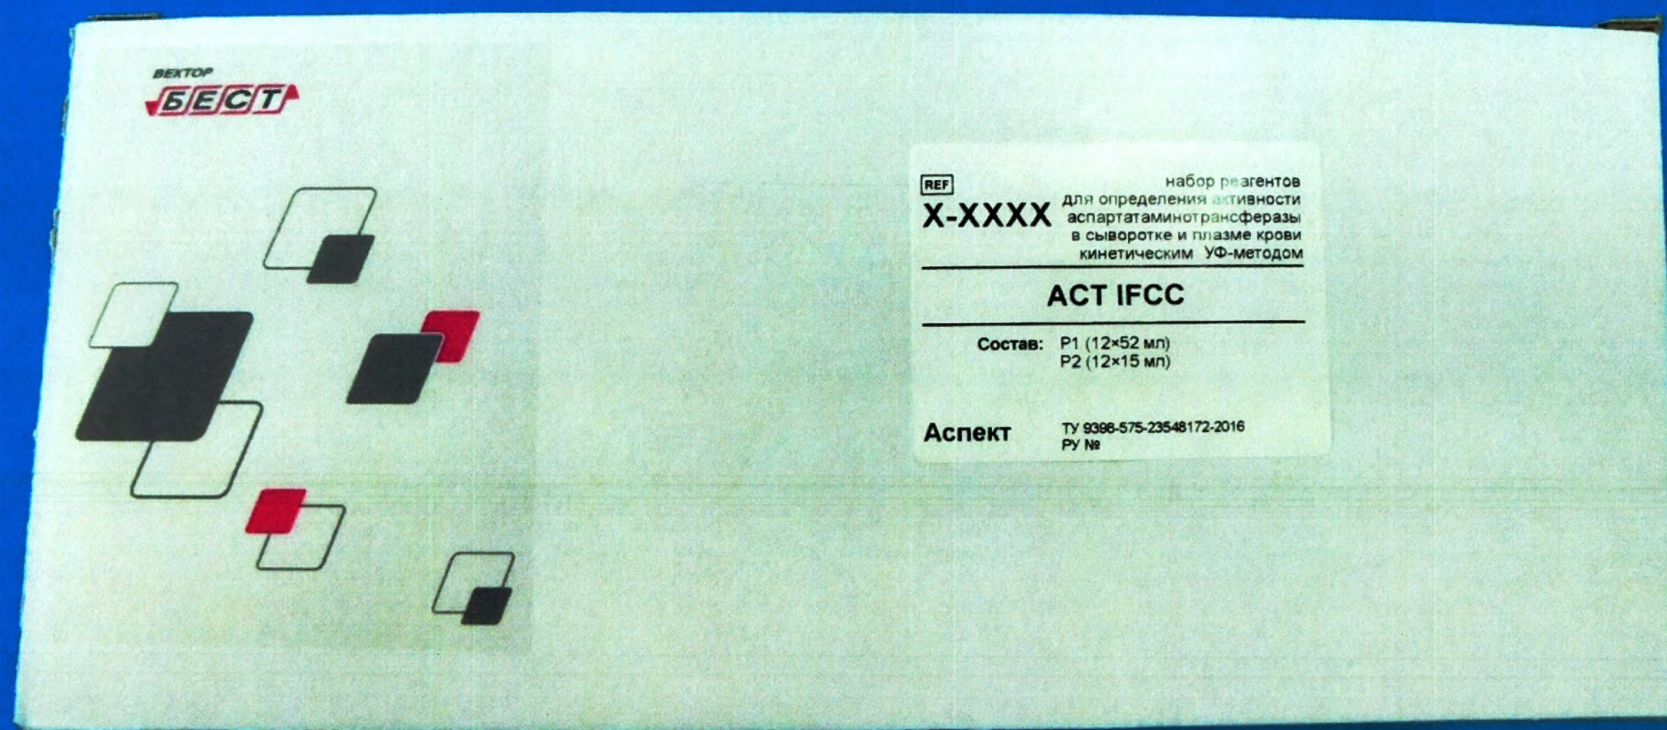

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аспартатаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АСТ IFCC» №2

Вариант комплектации 6, Серия 1





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 36 листов.
Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго А.В.
«15» 01 20 24 г.