

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

« 10 » января 2024 г.





Образцы маркировки на Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом (АЛТ IFCC)

1. Образцы этикеток на компоненты набора «АЛТ IFCC»

Наименование компонента	Этикетка
«АЛТ IFCC», вариант комплектации 1	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	
«АЛТ IFCC», вариант комплектации 2	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	

Наименование компонента	Этикетка
«АЛТ IFCC», вариант комплектации 3	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	
«АЛТ IFCC», вариант комплектации 4	
Реагент 1 (P1)	

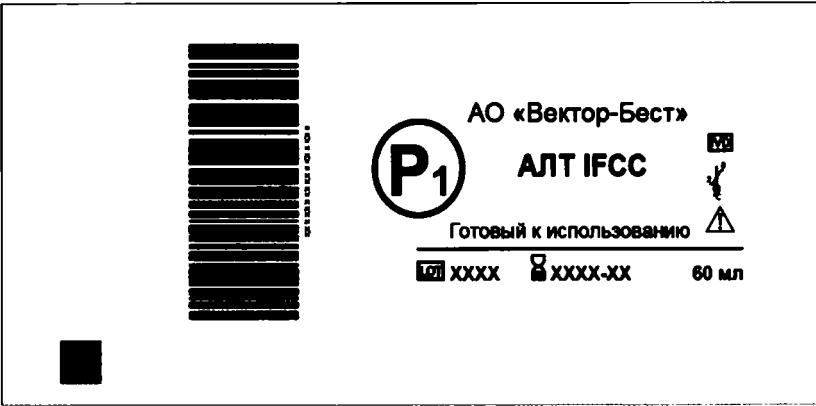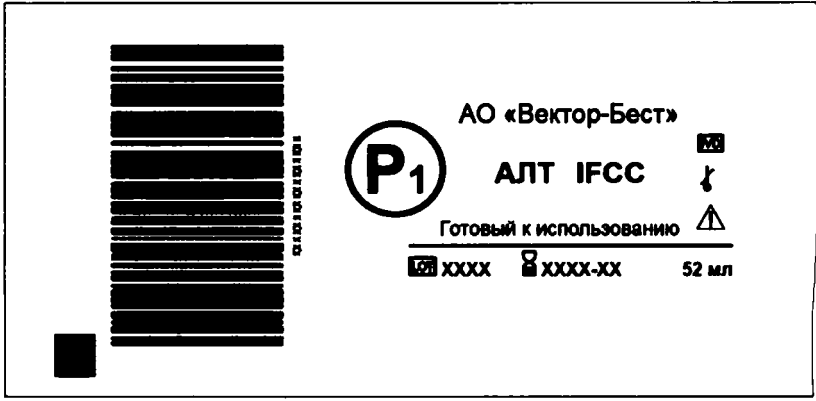Наименование компонента	Этикетка
Реагент 2 (P2)	
«АЛТ IFCC», вариант комплектации 5	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	
«АЛТ IFCC», вариант комплектации 6	
Реагент 1 (P1)	

Наименование компонента	Этикетка
Реагент 2 (P2)	 Label details: Barcode, xxxxxxxxxxxxxx, АО «Вектор-Бест», P2, ALT IFCC, Готовый к использованию, LOT XXXX, XXXX-XX, 15 мл.

2. Образцы этикеток на коробке набора «АЛТ IFCC»

2.1. Верхняя этикетка

Вариант комплектации 1	 Label details: REF, X-XXXX, набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом, АЛТ IFCC, Состав: P1 (2×40 мл), P2 (2×10 мл), ТУ 9398-574-23548172-2016, РУ №.
Вариант комплектации 2	 Label details: REF, X-XXXX, набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом, АЛТ IFCC, Состав: P1 (2×200 мл), P2 (2×50 мл), ТУ 9398-574-23548172-2016, РУ №.

Вариант комплектации 3	REF X-XXXX набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом АЛТ IFCC Состав: P1 (4×48 мл) P2 (4×14 мл) Миура ТУ 9398-574-23548172-2016 ПУ №
Вариант комплектации 4	REF X-XXXX набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом АЛТ IFCC Состав: P1 (10×78 мл) P2 (5×42 мл) Таурис ТУ 9398-574-23548172-2016 ПУ №
Вариант комплектации 5	REF X-XXXX набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом АЛТ IFCC Состав: P1 (8×60 мл) P2 (6×20 мл) BA400 ТУ 9398-574-23548172-2016 ПУ №
Вариант комплектации 6	REF X-XXXX набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом АЛТ IFCC Состав: P1 (12×52 мл) P2 (12×15 мл) Аспект ТУ 9398-574-23548172-2016 ПУ №

2.2. Боковая этикетка №1

Вариант комплектации 1, 2	REF X-XXXX LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX АЛТ IFCC   IVD   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения
Вариант комплектации 3	REF X-XXXX  1070 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX АЛТ IFCC   IVD   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения
Вариант комплектации 4	REF X-XXXX  5855 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX АЛТ IFCC   IVD   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения
Вариант комплектации 5	REF X-XXXX  2850 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX АЛТ IFCC   IVD   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 7 листов.

Директор по технологии и качеству

АО «Вектор-Бест»



Масяго

Масяго А.В.

«25»

06

20 29 г.

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



 Хусаинов М.Д.


«15» января 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКТИВНОСТИ АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗЫ
В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ КИНЕТИЧЕСКИМ УФ-МЕТОДОМ
(АЛТ IFCC)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC»

Вариант комплектации 1, Серия 1

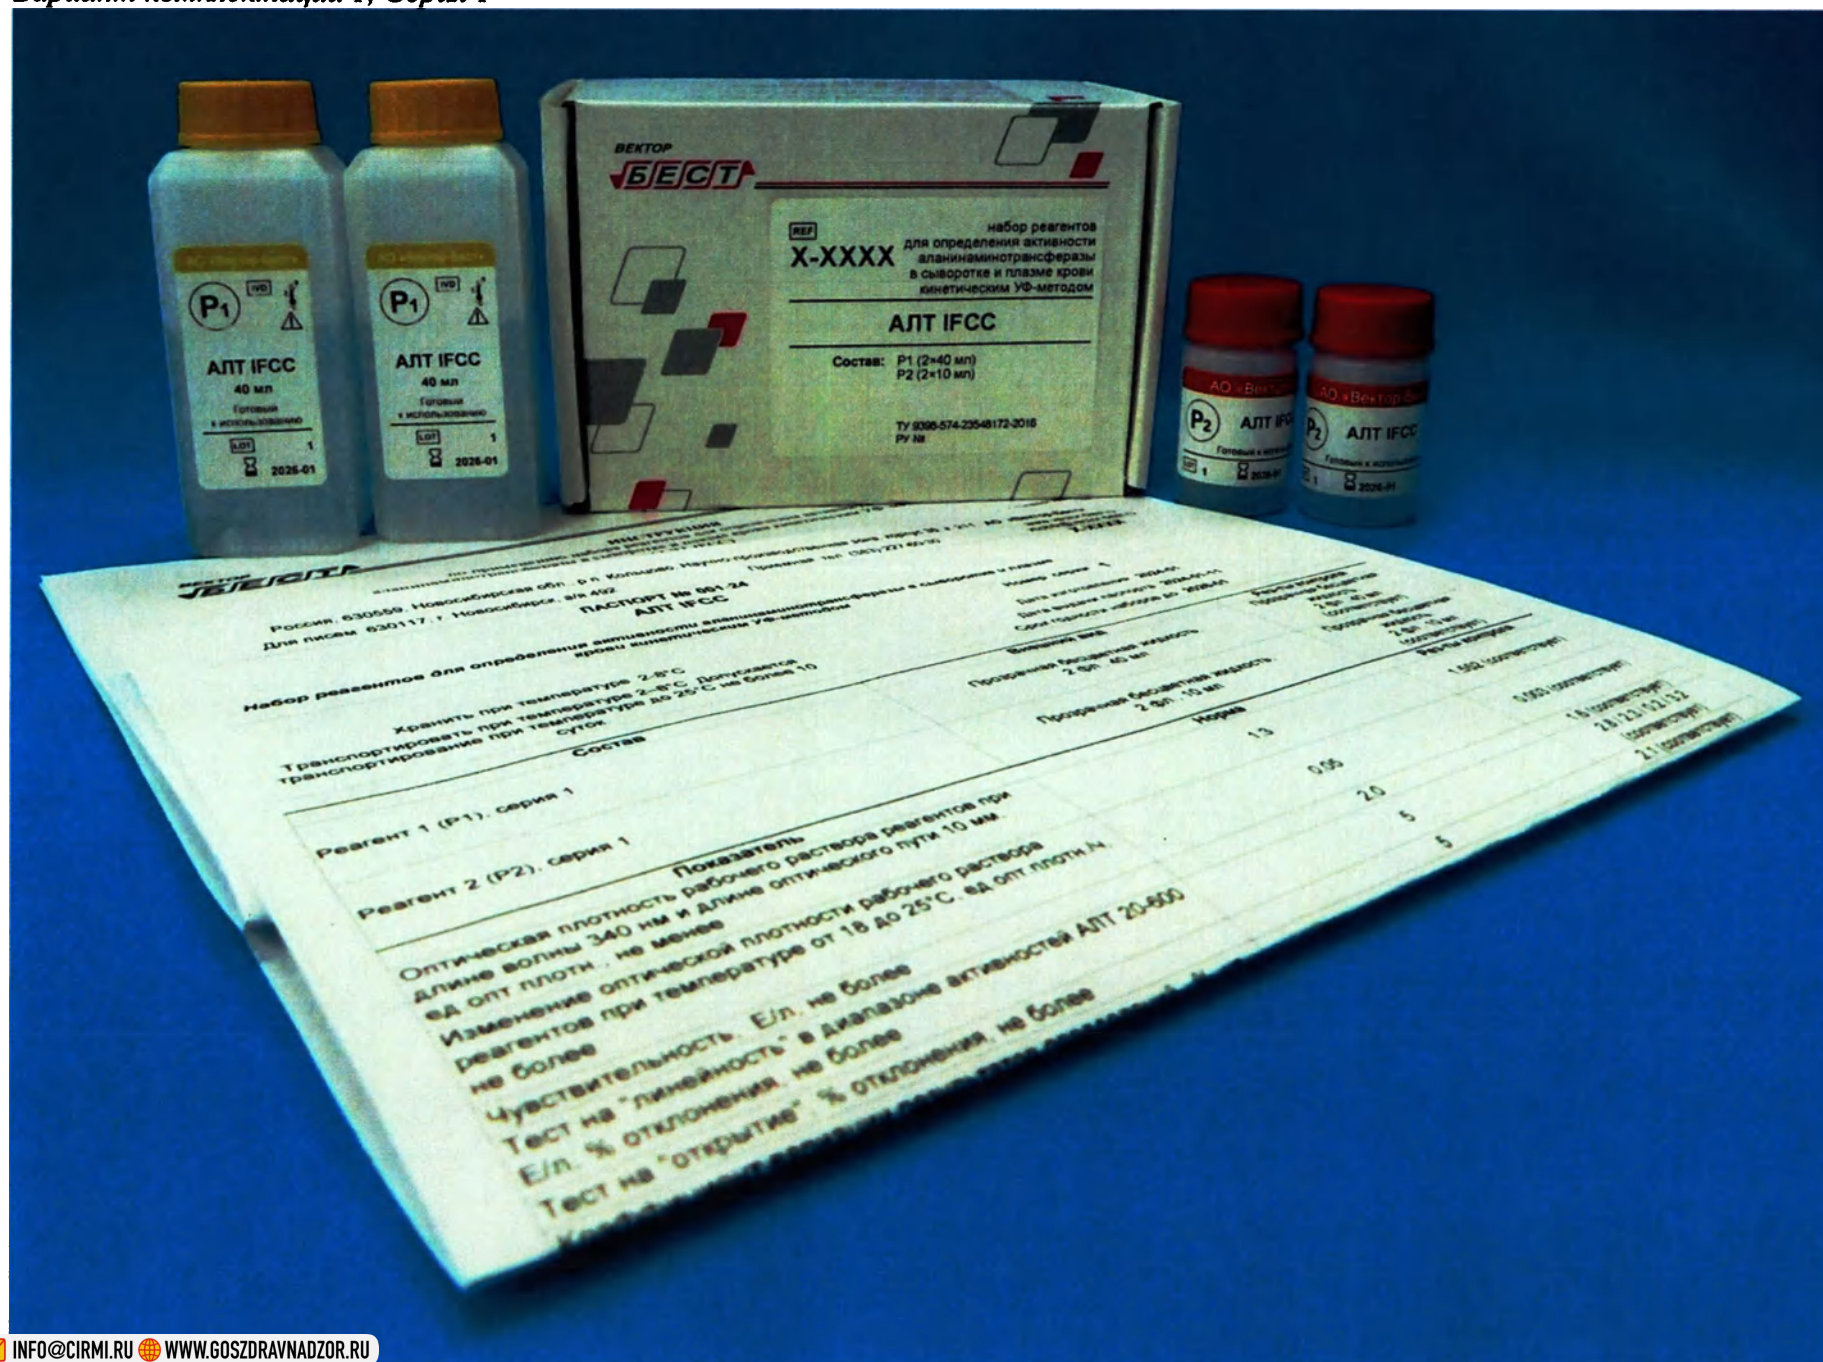

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №1

Вариант комплектации 1, Серия 1.



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №2


Вариант комплектации 1, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC» №3


Вариант комплектации 1, Серия 1

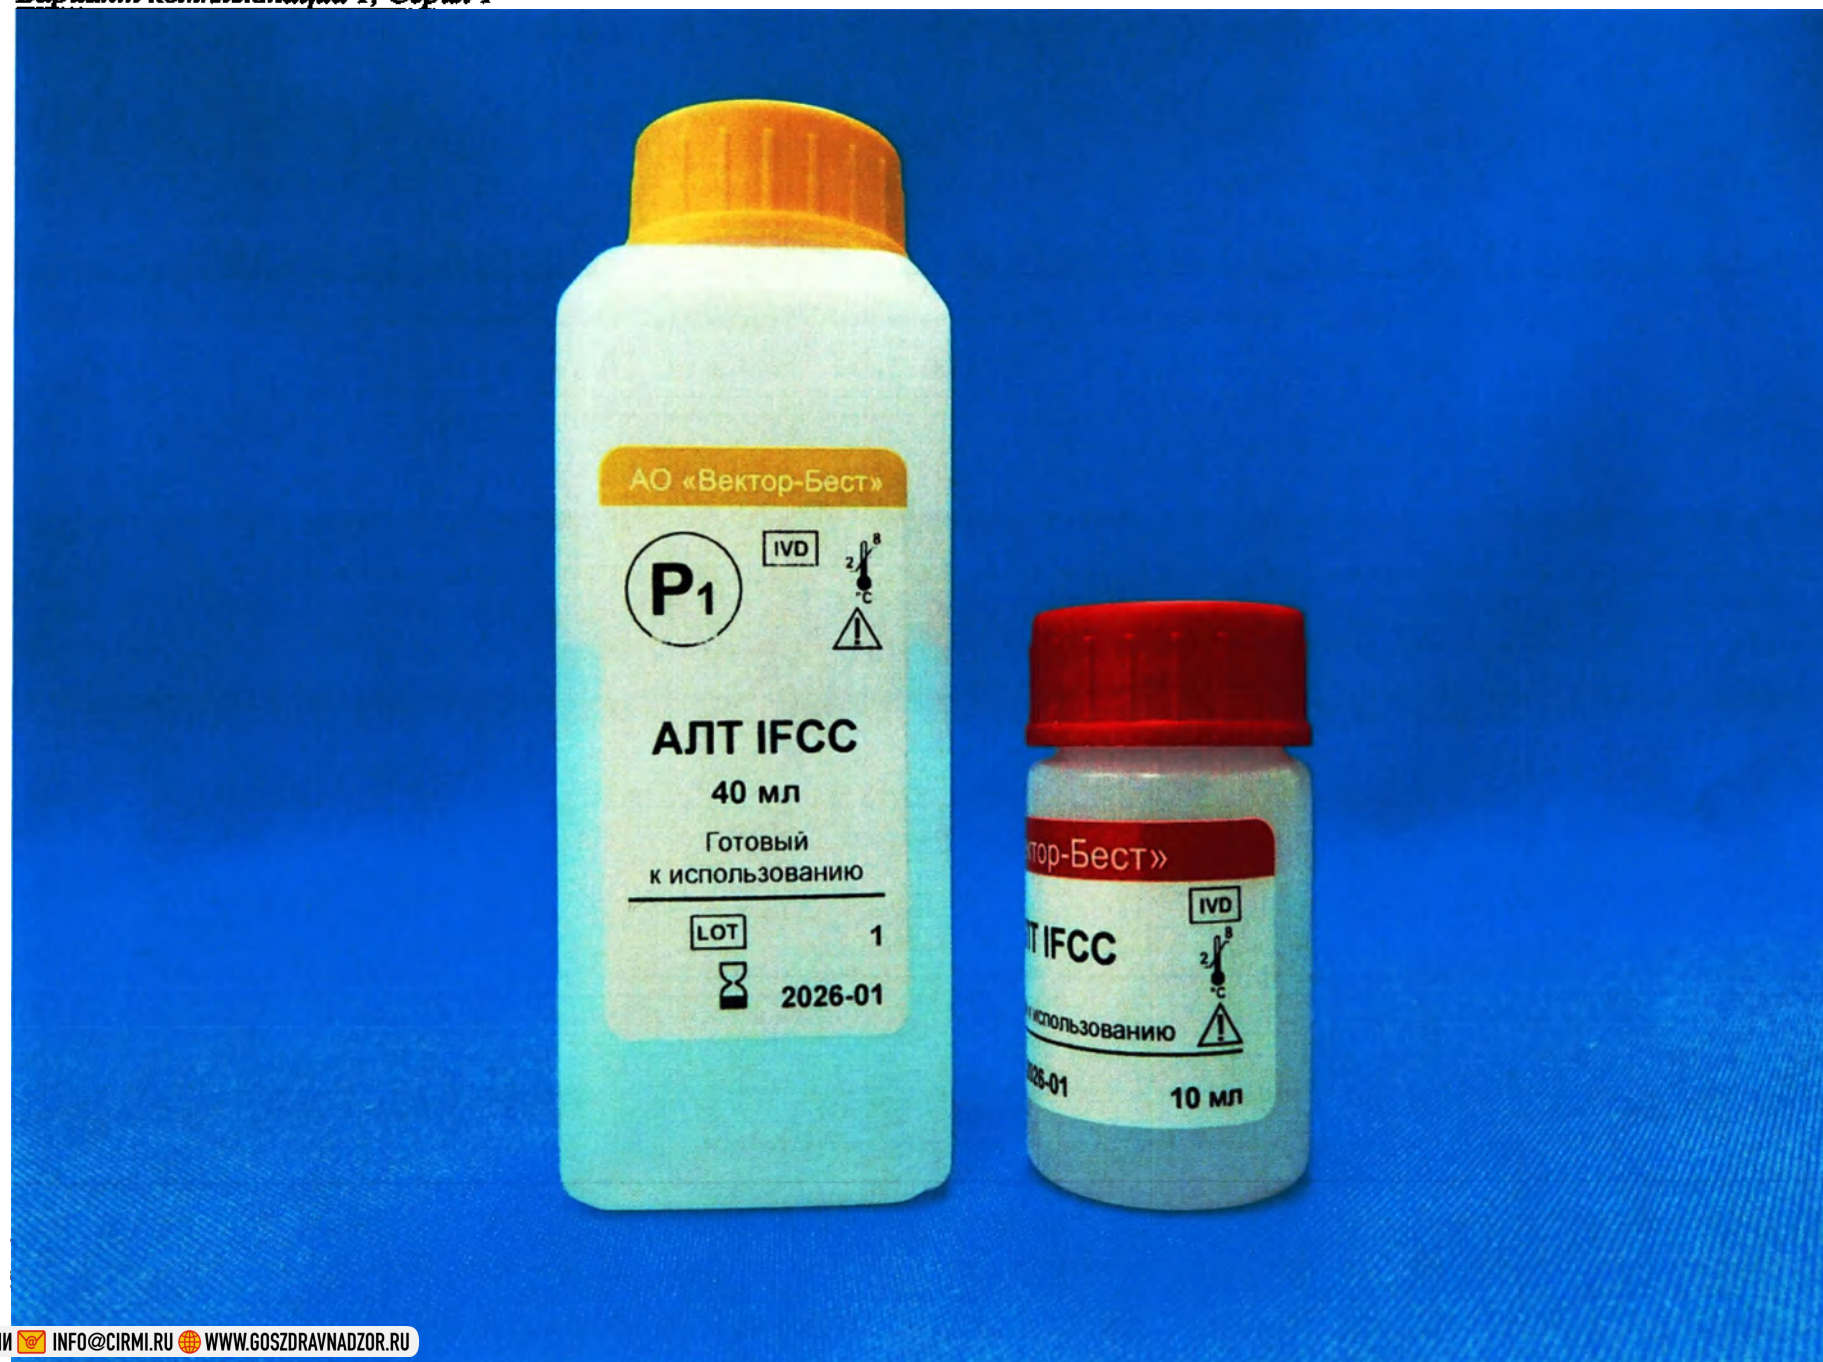

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №1

Вариант комплектации 1. Серия 1

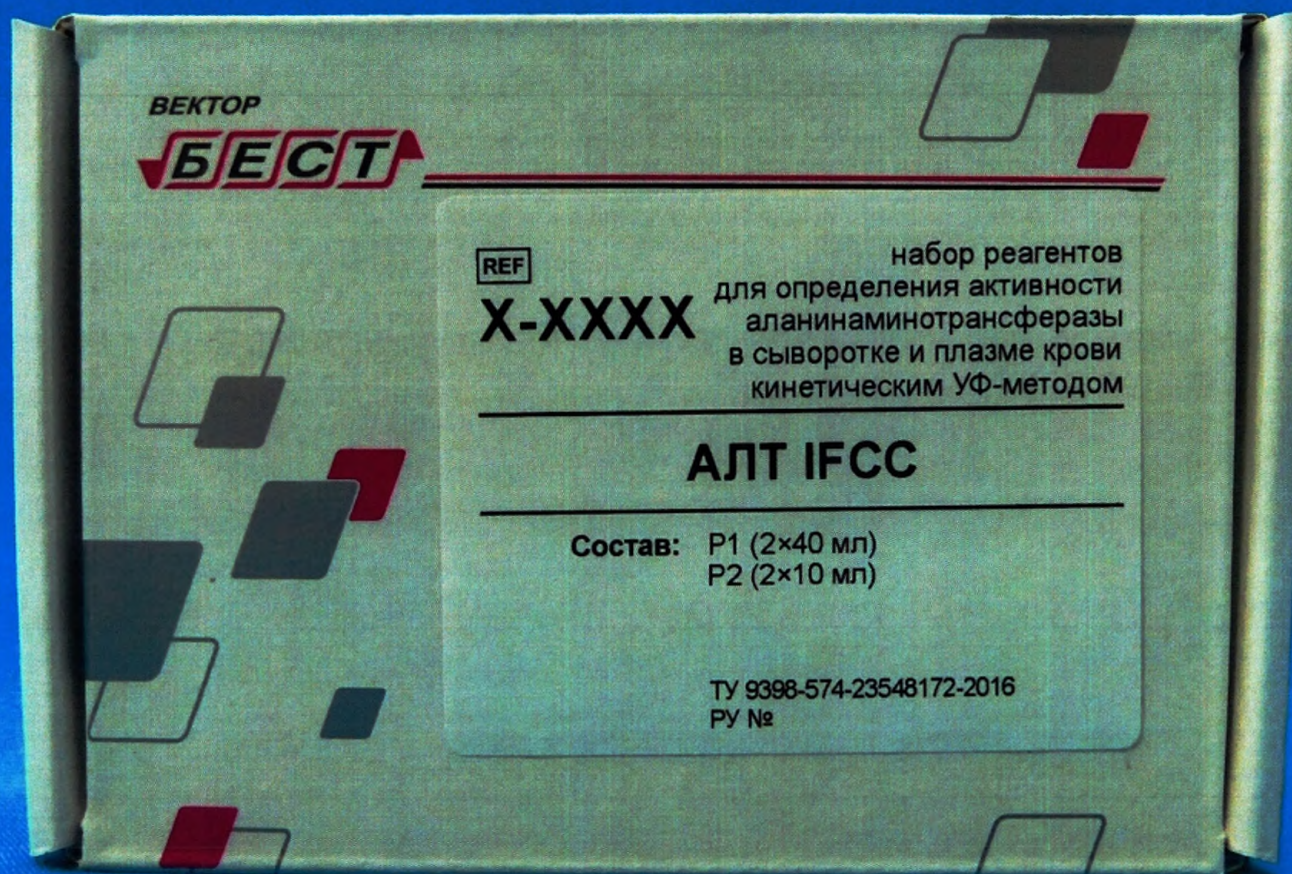

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №2

Вариант комплектации 1, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC» №3


Вариант комплектации 1, Серия 1



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC»

Вариант комплектации 2, Серия 1

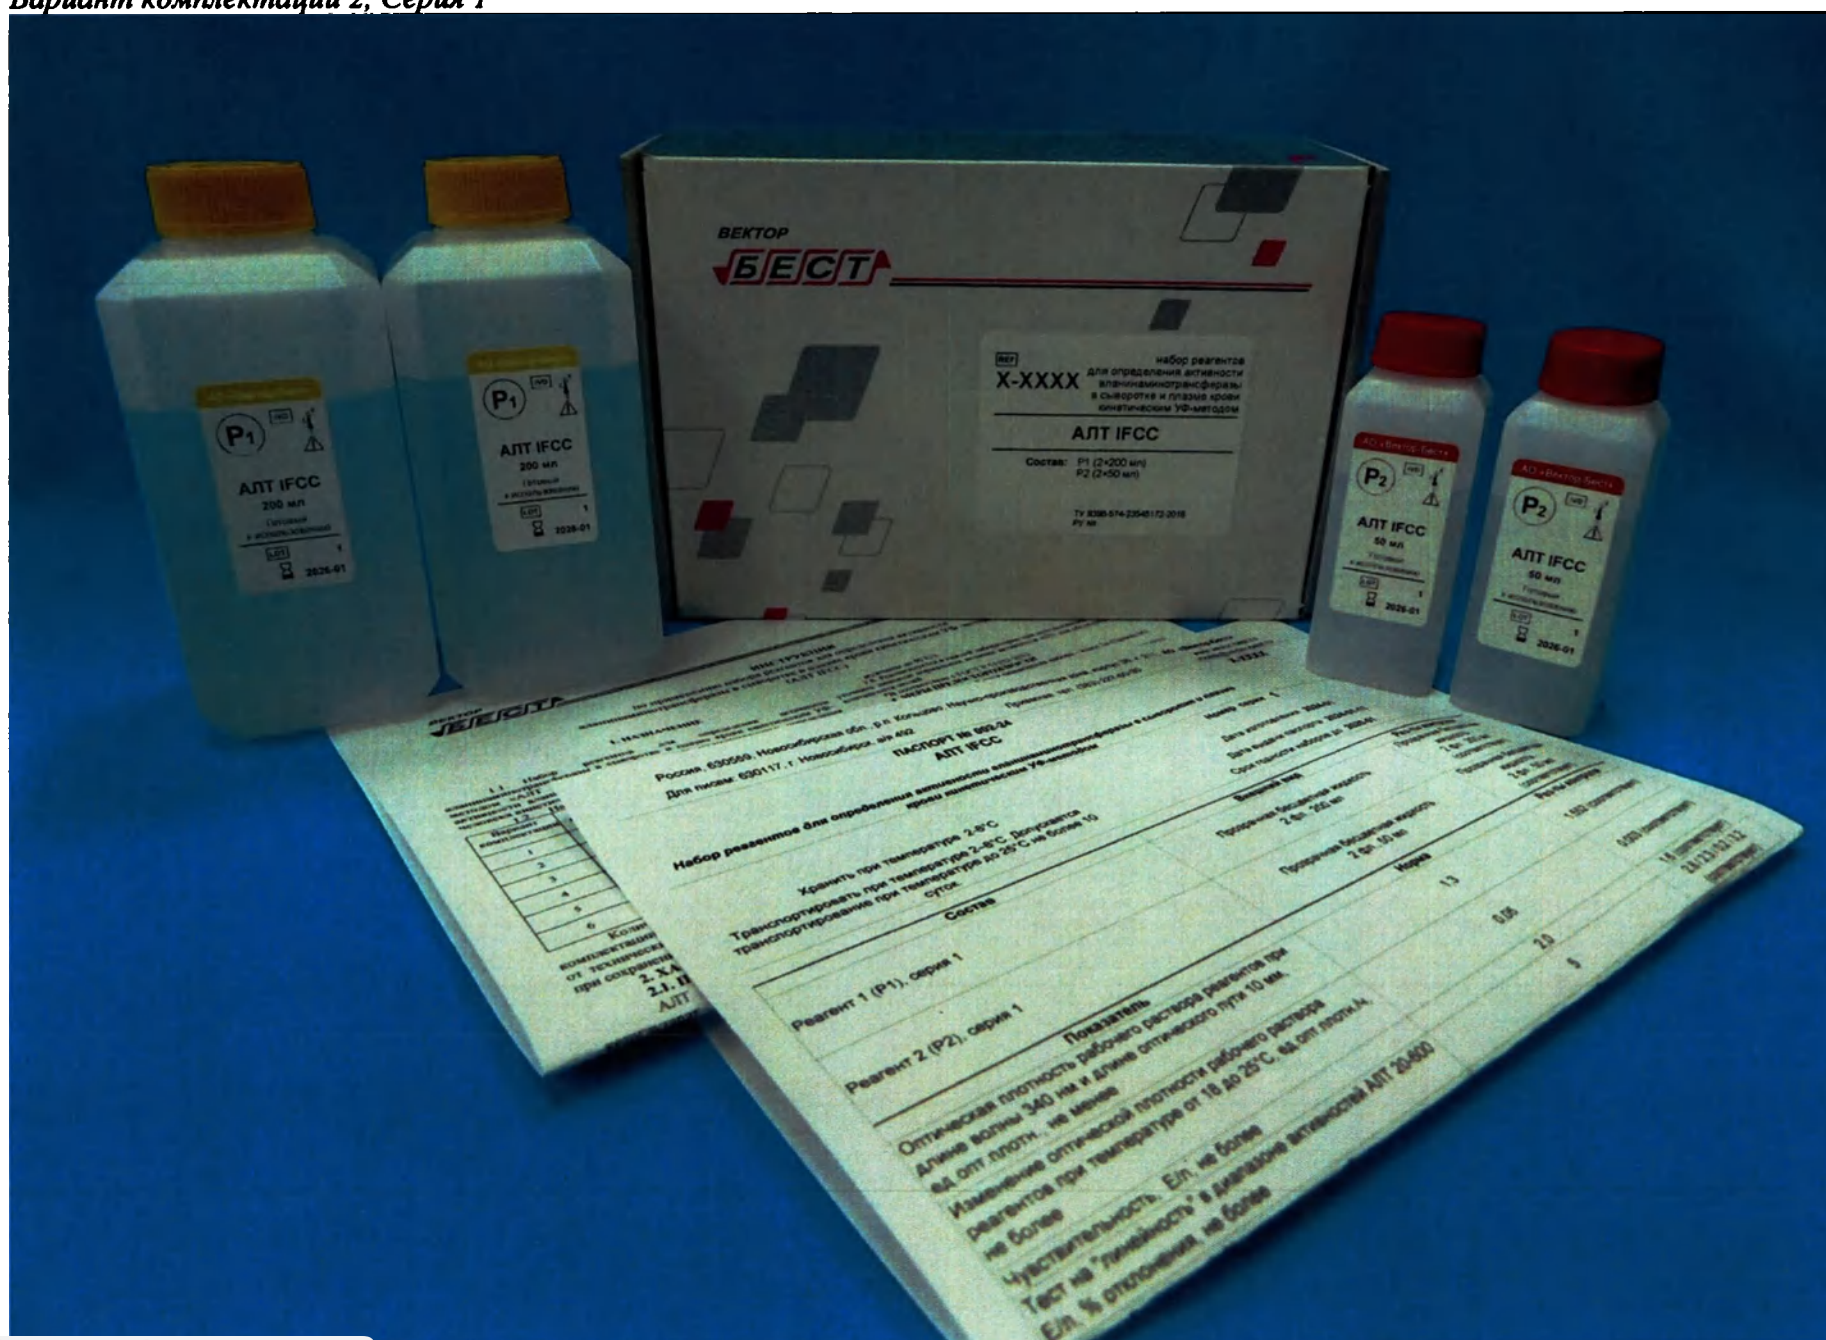

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC» №1


Вариант комплектации 2, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №1

Вариант комплектации 2, Серия 1

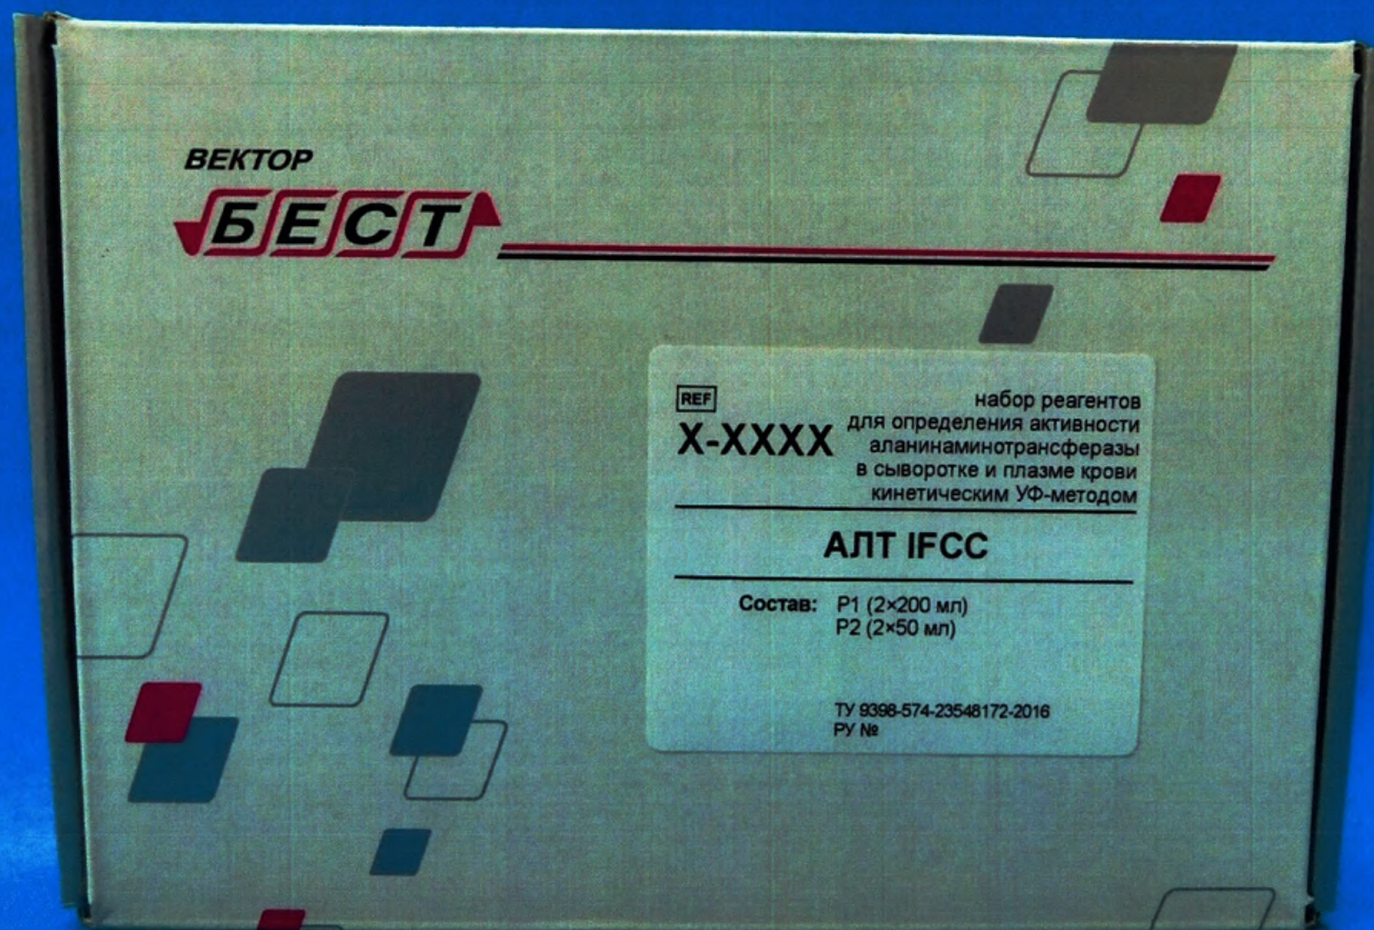

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC» №2

Вариант комплектации 2, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №3


Вариант комплектации 2, Серия 1



Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC»

Вариант комплектации 3, Серия 1

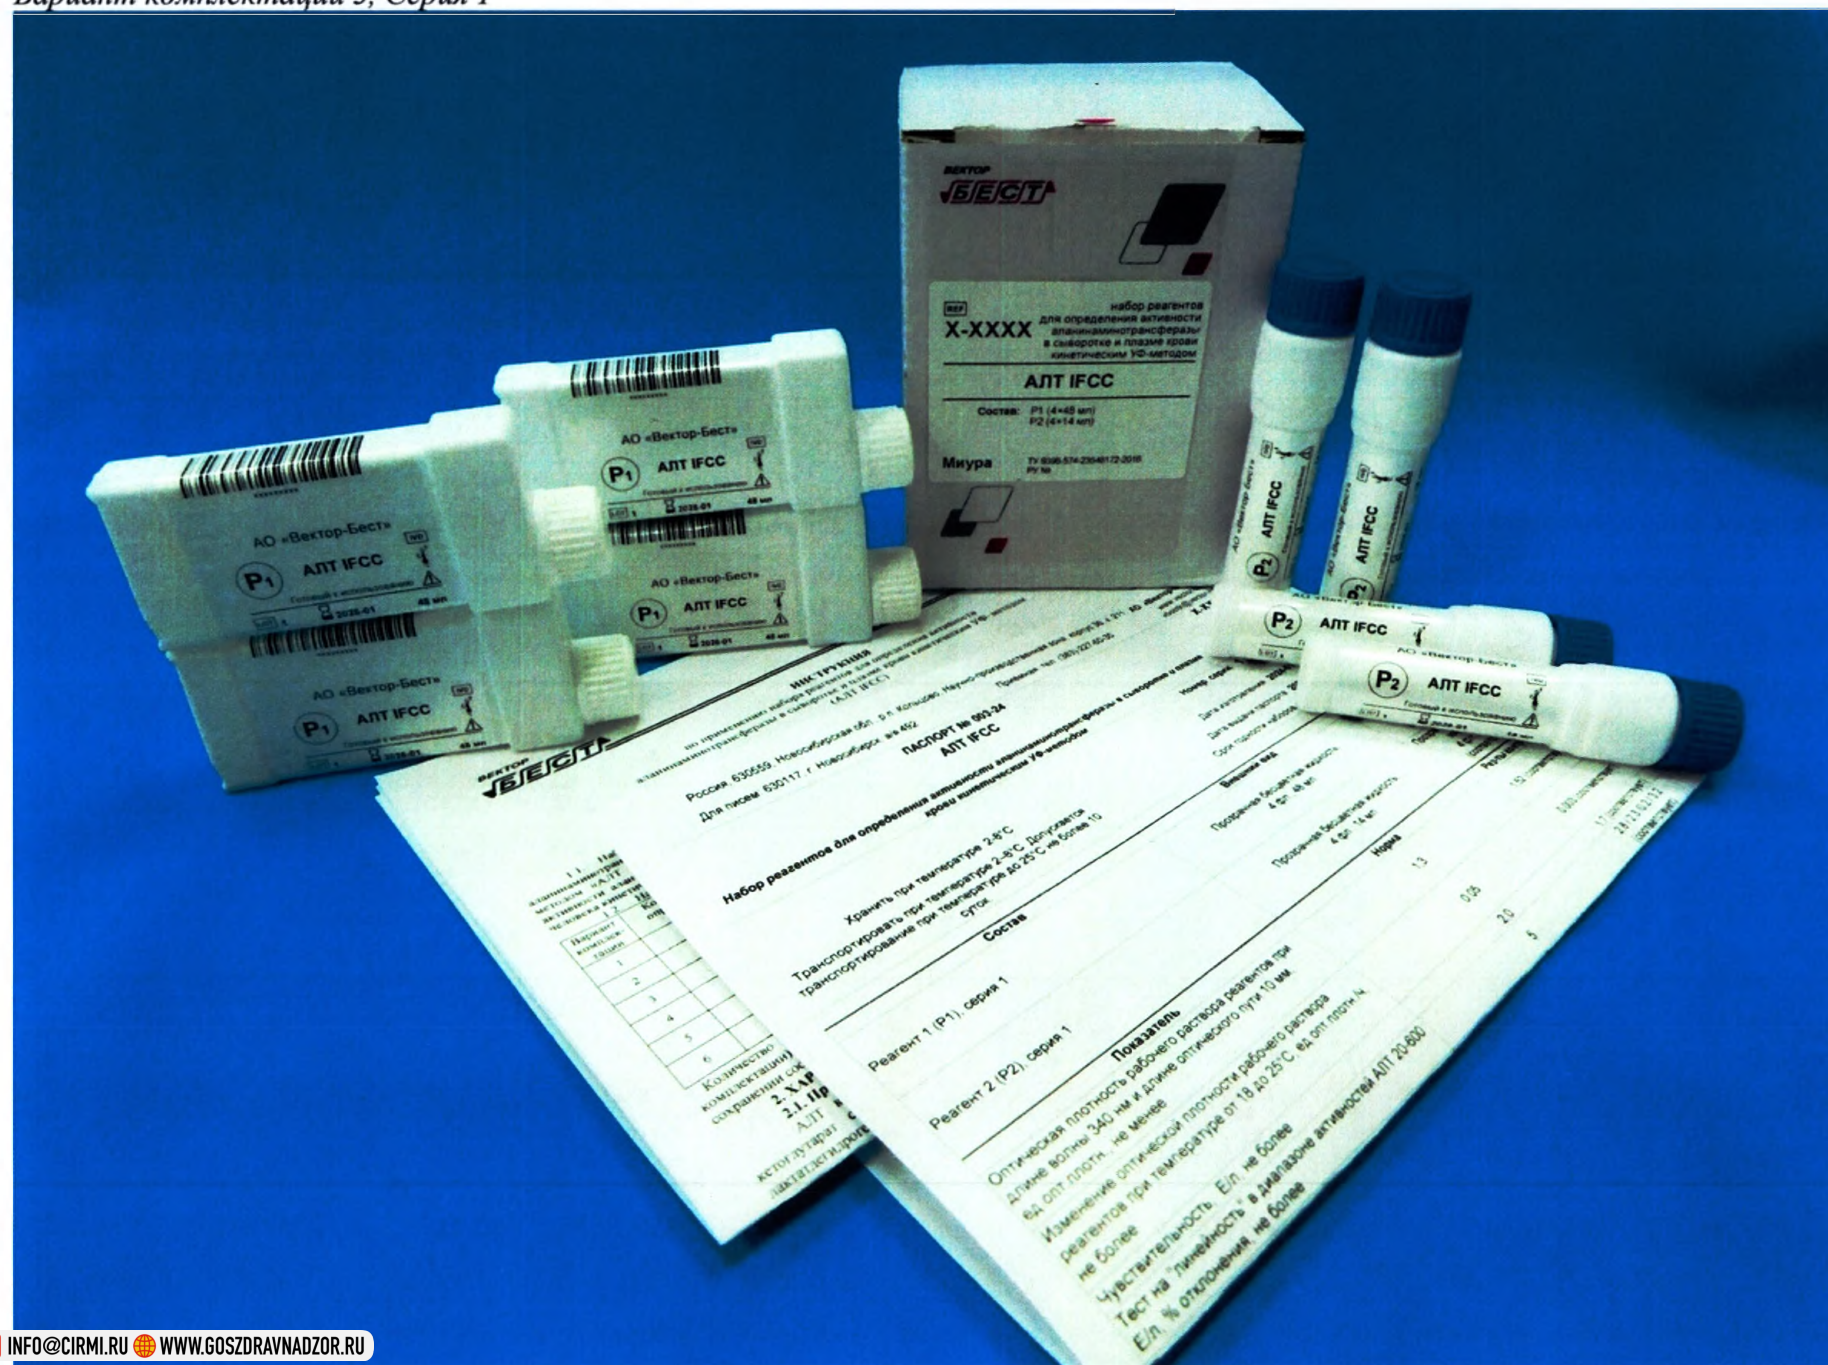

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC» №1


Вариант комплектации 3, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC» №2


Вариант комплектации 3, Серия 1

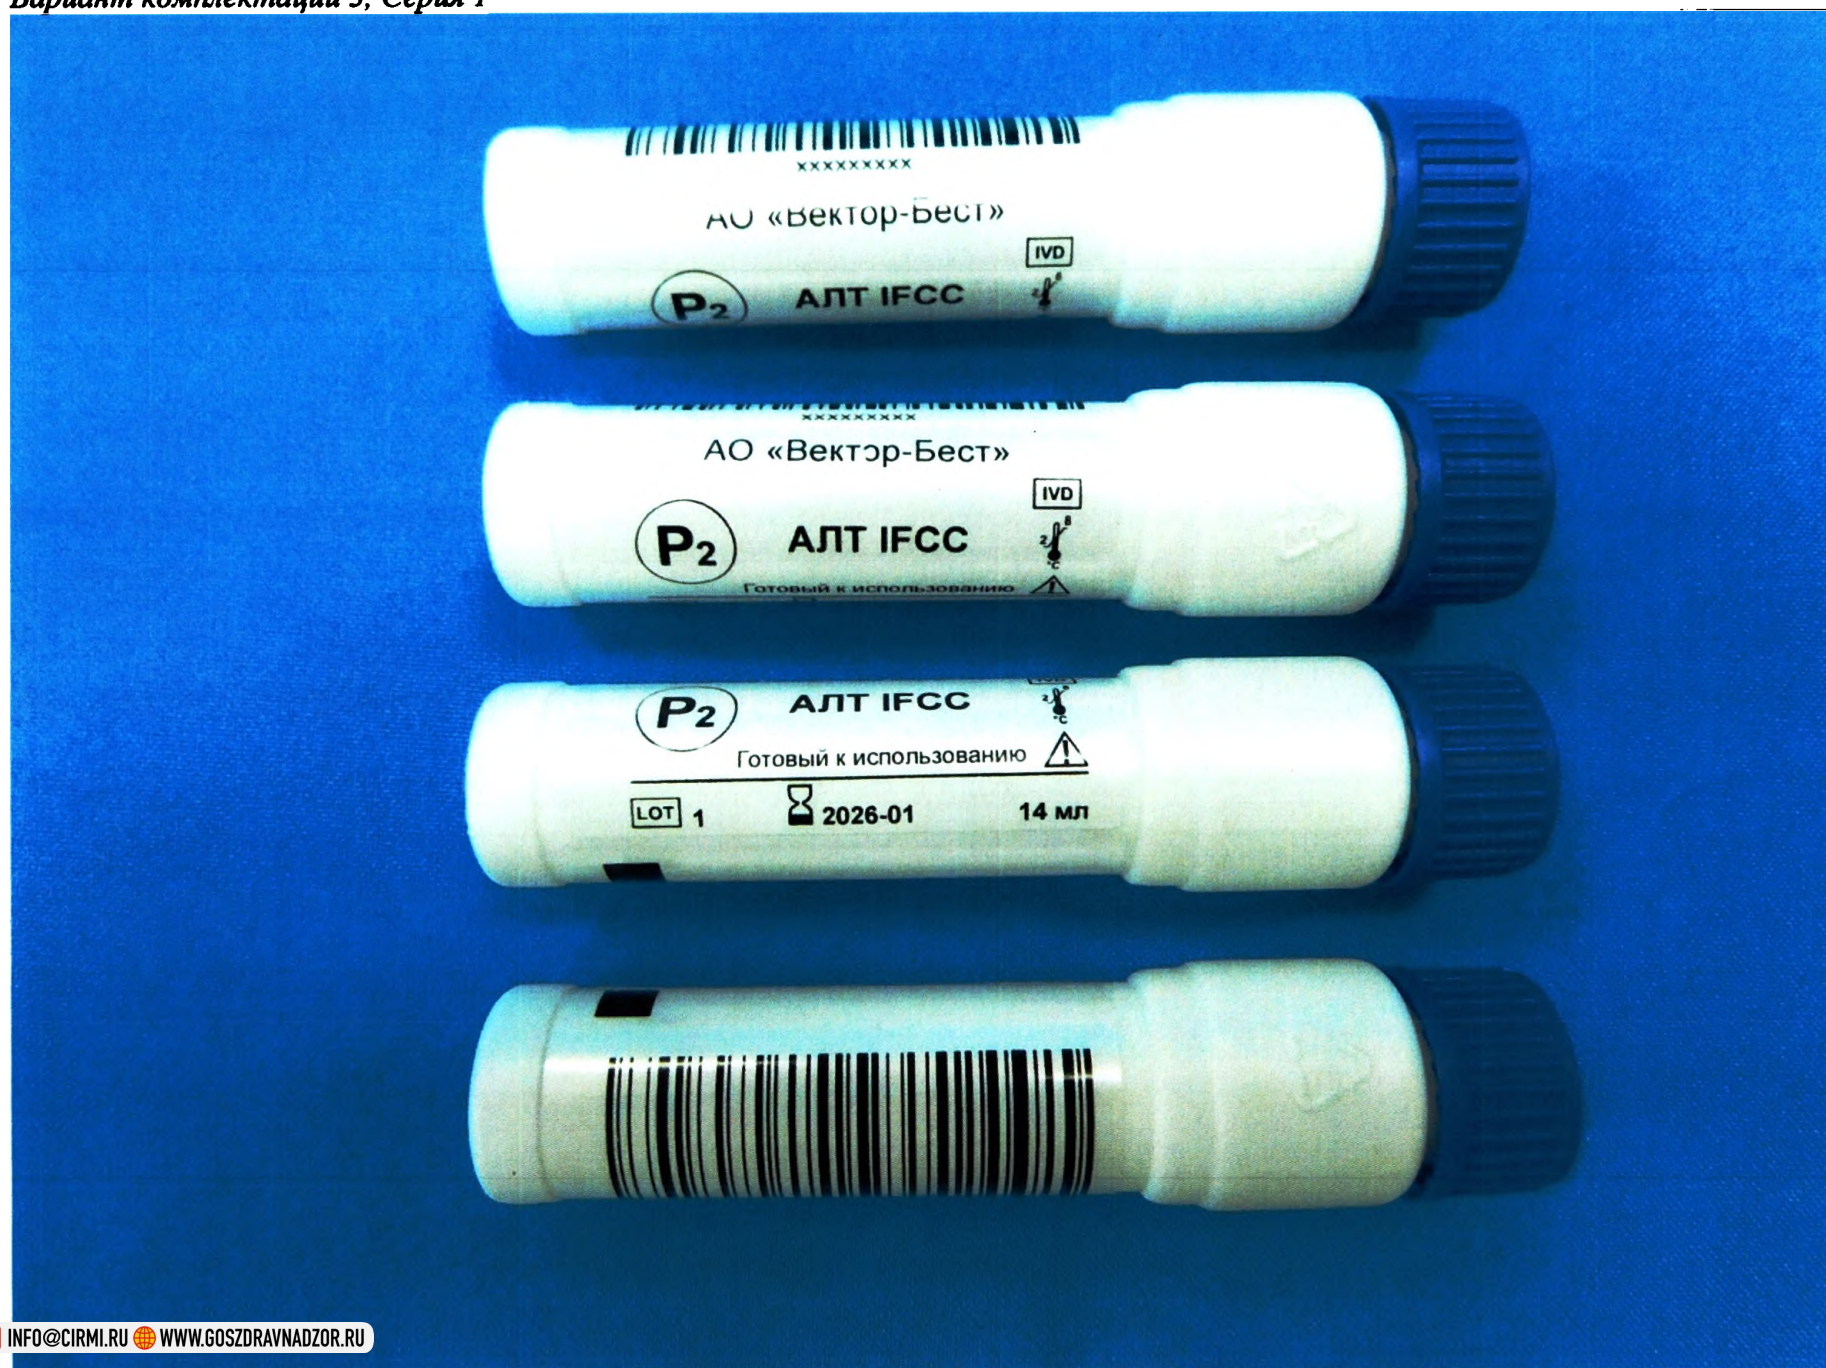

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC» №1

Вариант комплектации 3, Серия 1

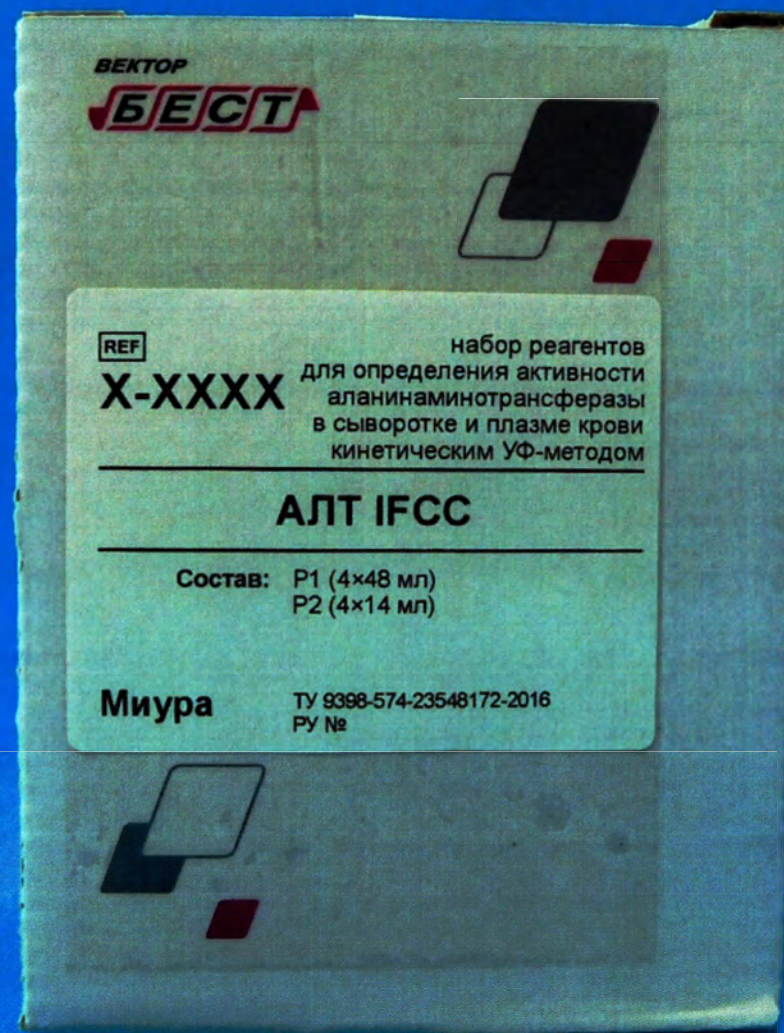

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ–методом
«АЛТ IFCC» №2

Вариант комплектации 3, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №3

Вариант комплектации 3, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC»


Вариант комплектации 4, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ–методом
«АЛТ IFCC» №1

Вариант комплектации 4, Серия 1

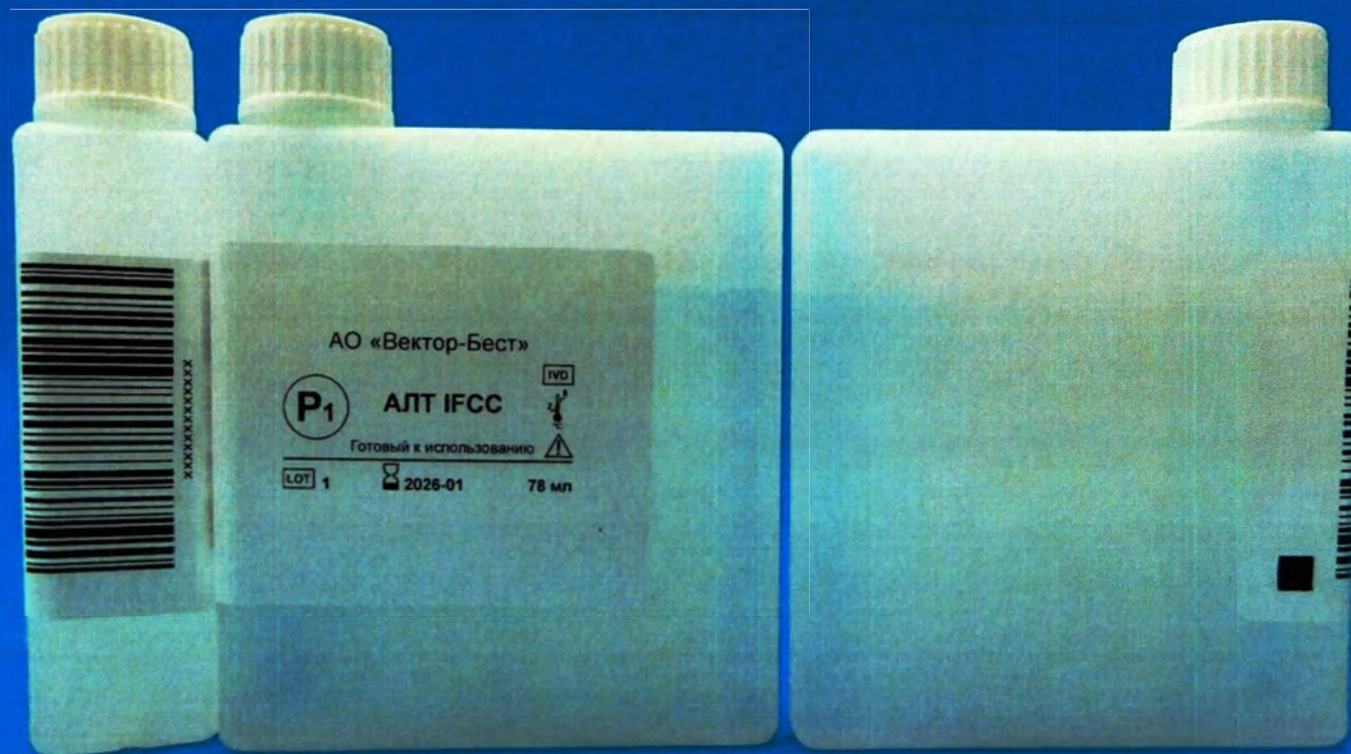

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №2

Вариант комплектации 4, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №1

Вариант комплектации 4, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC» №2

Вариант комплектации 4, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №3

Вариант комплектации 4, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC»


Вариант комплектации 5, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ–методом
«АЛТ IFCC» №1

Вариант комплектации 5, Серия 1

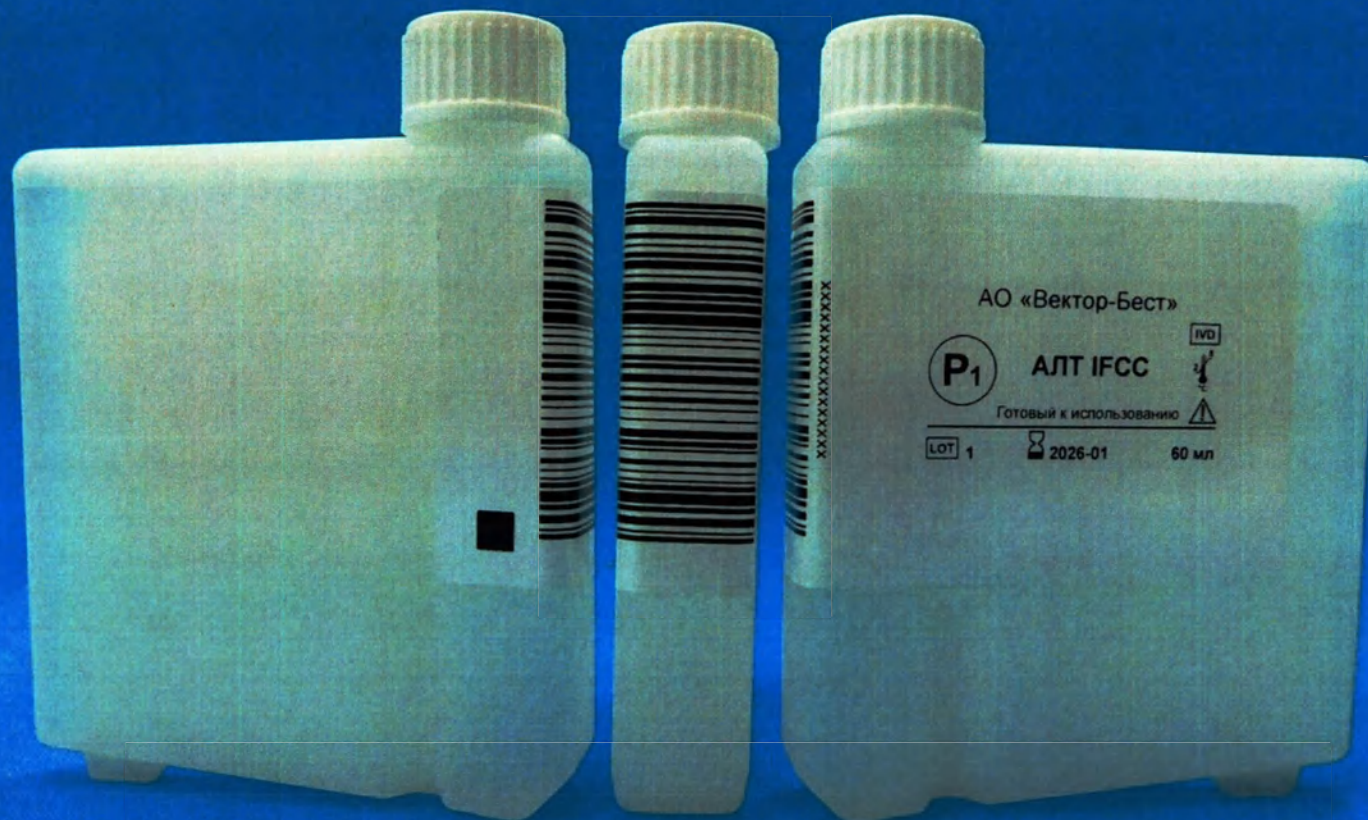

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ–методом
«АЛТ IFCC» №2


Вариант комплектации 5, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №1

Вариант комплектации 5, Серия 1

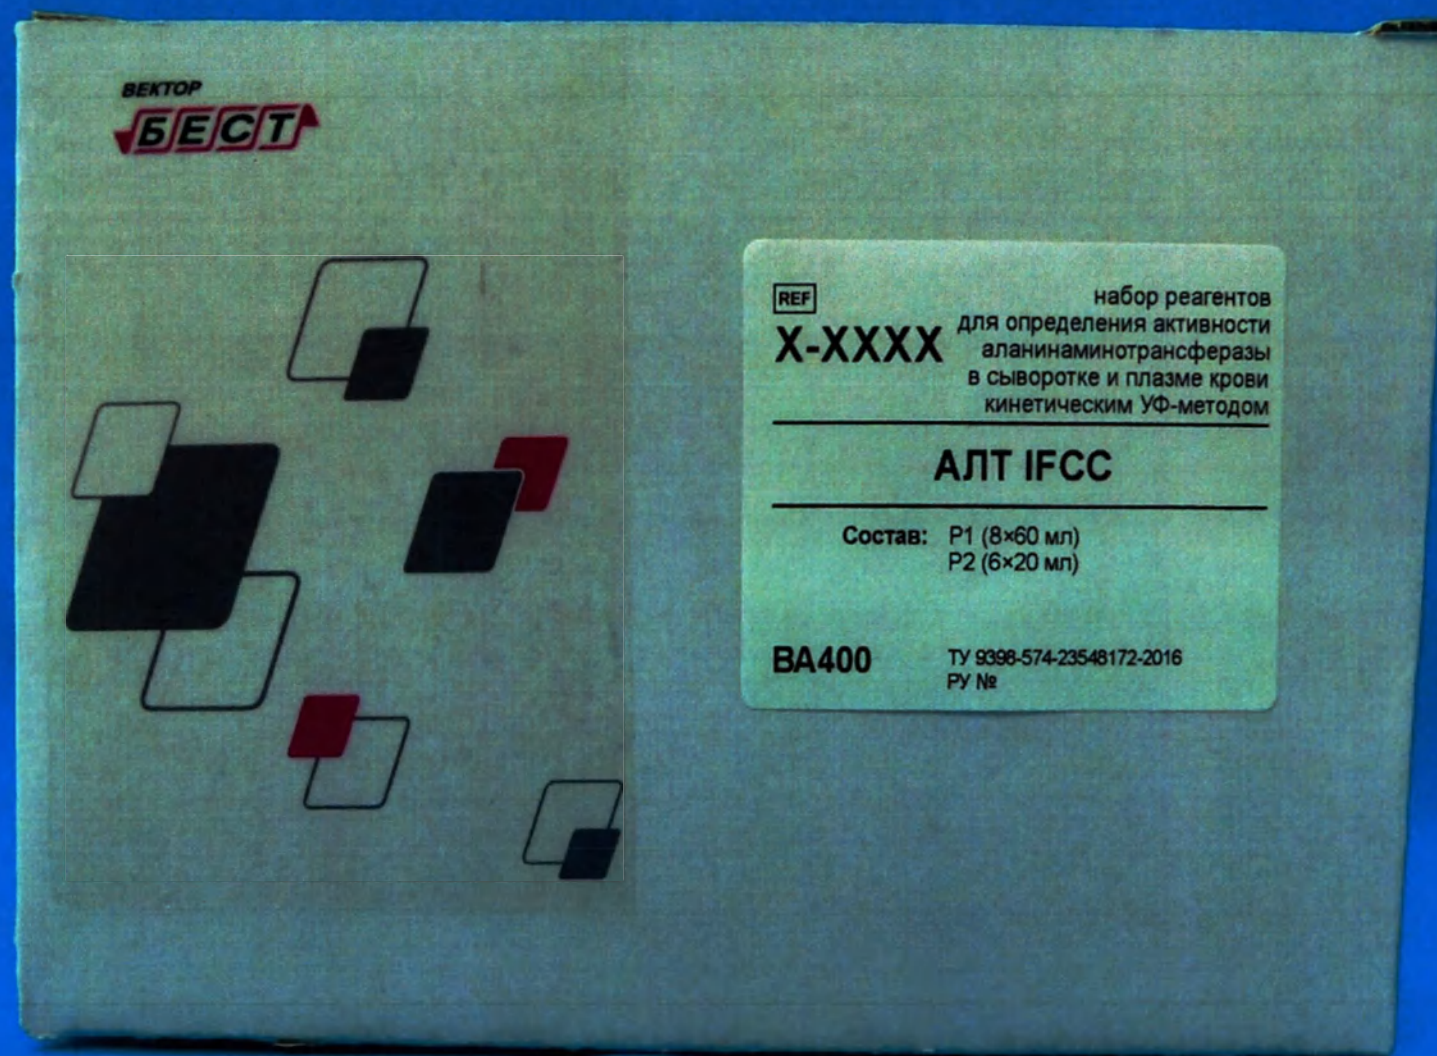

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №2

Вариант комплектации 5, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC» №3

Вариант комплектации 5, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC»

Вариант комплектации 6, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом «АЛТ IFCC» №1

Вариант комплектации 6, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ–методом
«АЛТ IFCC» №2


Вариант комплектации 6, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №1

Вариант комплектации 6, Серия 1

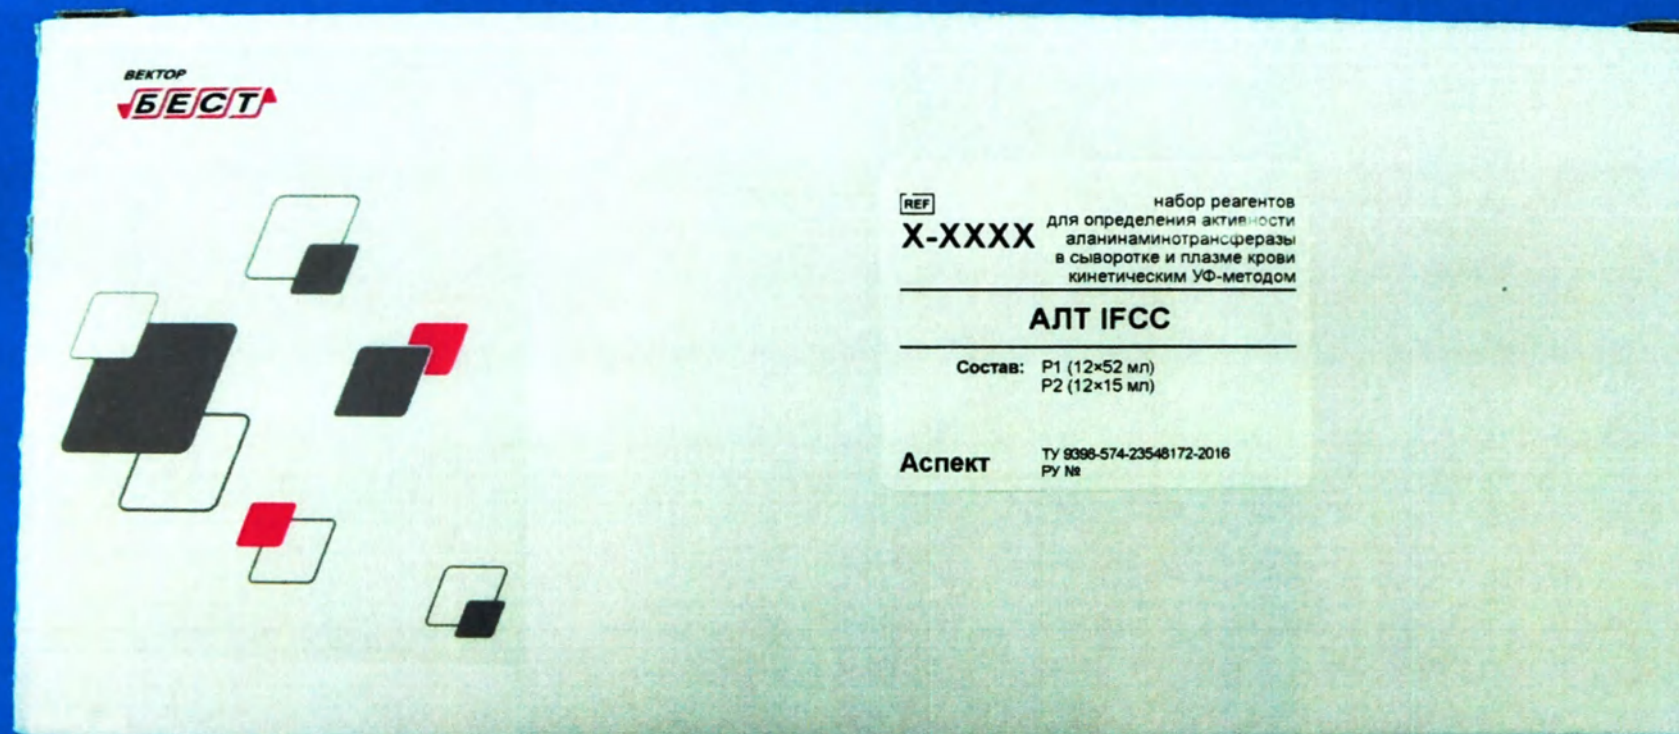

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия

Набор реагентов для определения активности аланинаминотрансферазы в сыворотке и плазме крови кинетическим УФ-методом
«АЛТ IFCC» №2

Вариант комплектации 6, Серия 1





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 37 листов.

Директор по технологии и качеству
АО «Вектор-Бест»



Масяго А.В.
20 24 г.