

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

« 30 » 2024 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче (Хлориды)

1. Образцы этикеток на флаконы набора «Хлориды»

Наименование компонента	Этикетка
«Хлориды», вариант комплектации 1	
Реагент (Р)	
Калибратор (К)	
«Хлориды», вариант комплектации 2	
Реагент (Р)	

«Хлориды», вариант комплектации 3	
Реагент (Р)	
«Хлориды», вариант комплектации 4	
Реагент (Р)	
«Хлориды», вариант комплектации 5	
Реагент (Р)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Хлориды»

2.1. Верхняя этикетка.

Вариант комплектации 1	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче Хлориды Состав: Р (1×200 мл) К (1×3 мл) ТУ 9398-626-23548172-2016 РУ №
Вариант комплектации 2	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче Хлориды Состав: Р (3×50 мл) Миура ТУ 9398-626-23548172-2016 РУ №
Вариант комплектации 3	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче Хлориды Состав: Р (5×42 мл) Таурус ТУ 9398-626-23548172-2016 РУ №
Вариант комплектации 4	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче Хлориды Состав: Р (3×60 мл) BA400 ТУ 9398-626-23548172-2016 РУ №

Вариант комплектации 4	REF X-XXXX Σ 900 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Хлориды 25 ! IVD i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения
Вариант комплектации 5	REF X-XXXX Σ 248 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Хлориды 25 ! IVD i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения

Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


AO Vector-Best
Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ
630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-ендірістік аймақ,
36 корпус, 211 белме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«10» 01 2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 5 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

"10" 09 сентября 2024 г. Масяго А.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

**Набор реагентов для определения концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
(Хлориды)**

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 1, Серия 1

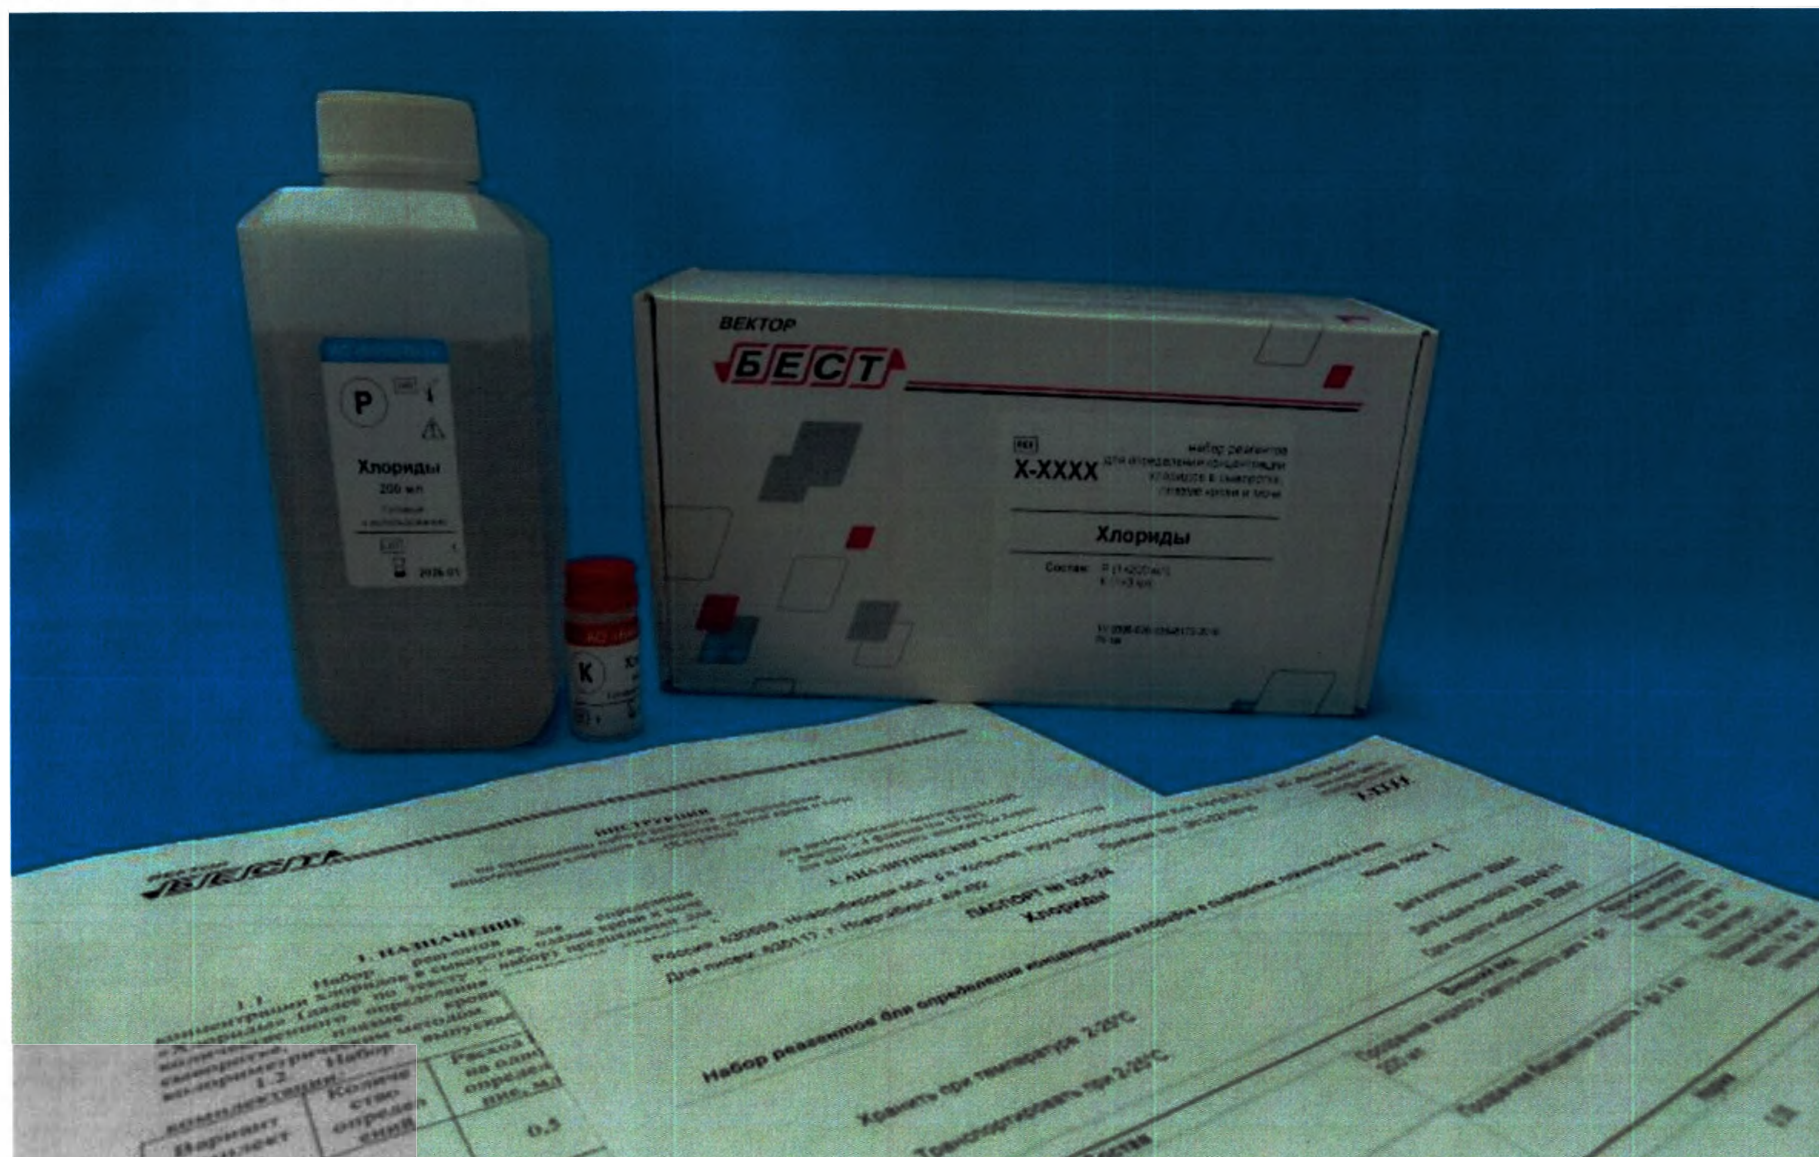

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 1, Серия 1




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №2
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 1, Серия 1




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №3
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 1, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №4
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 1, Серия 1

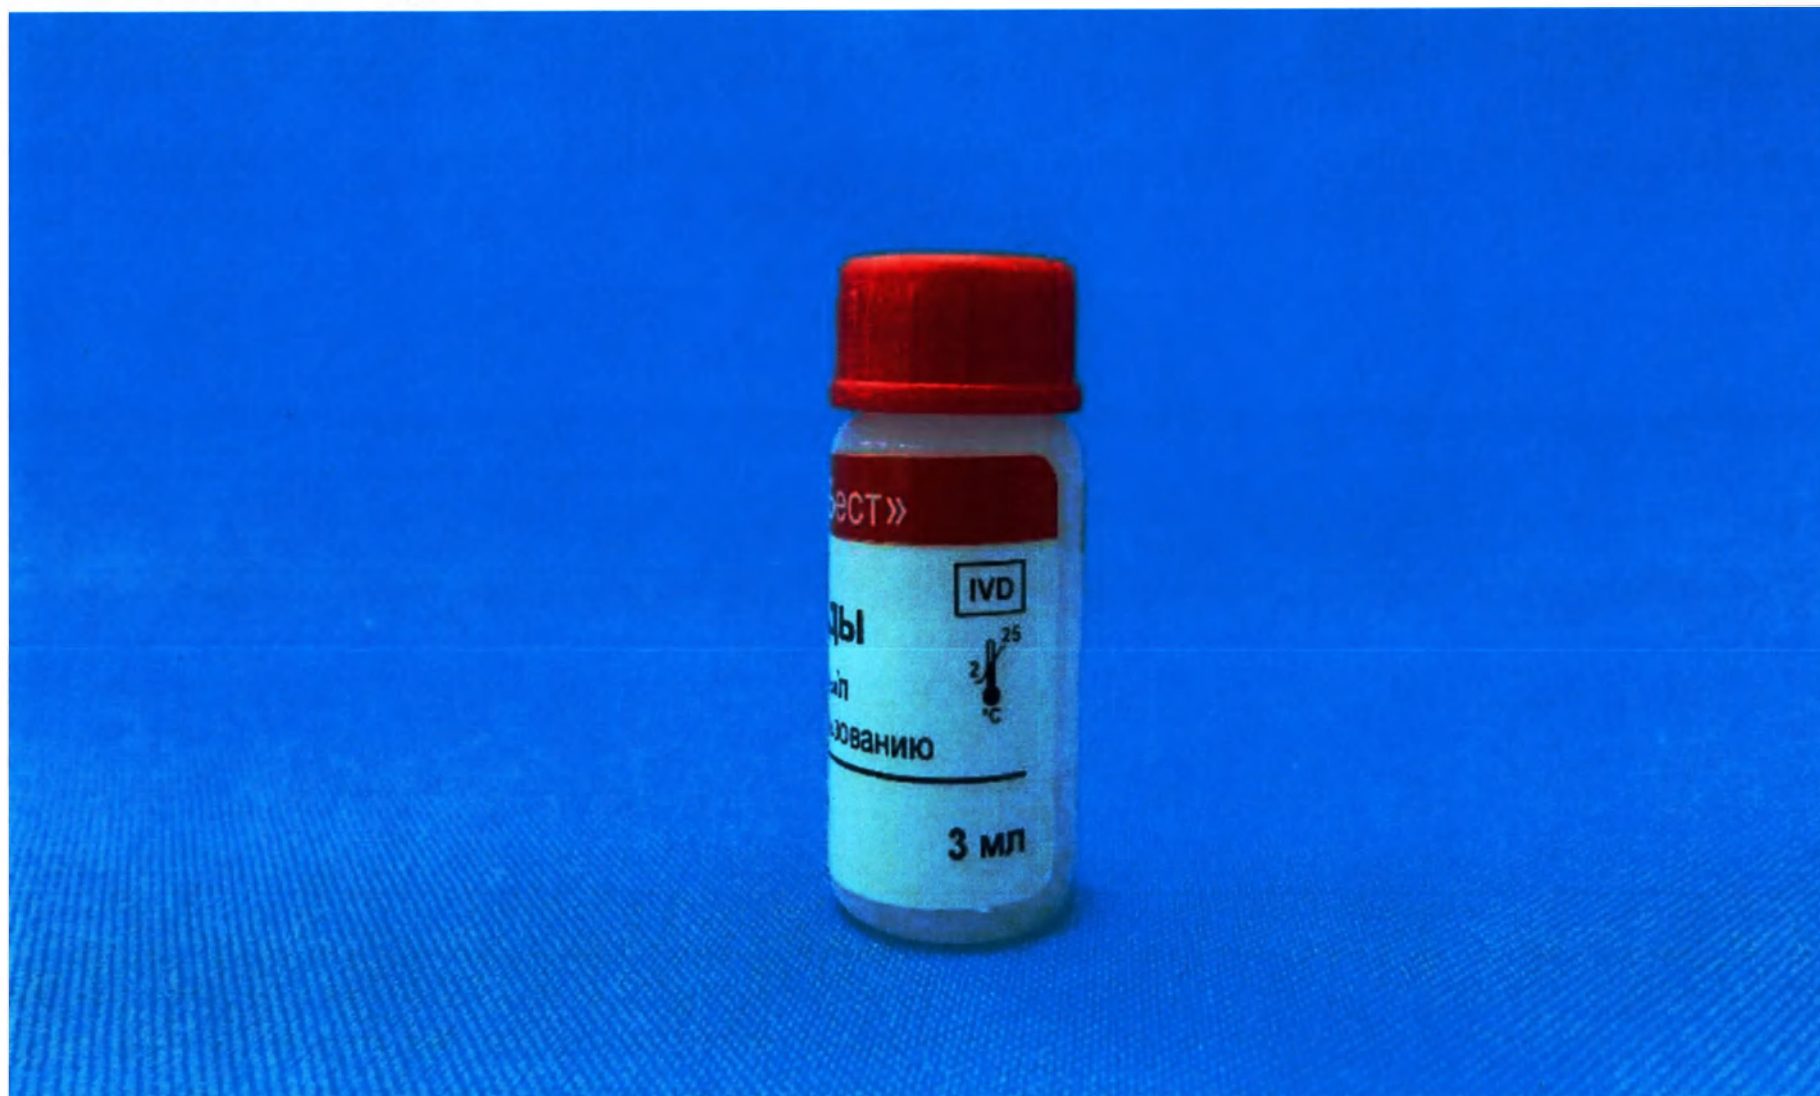


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 1, Серия 1

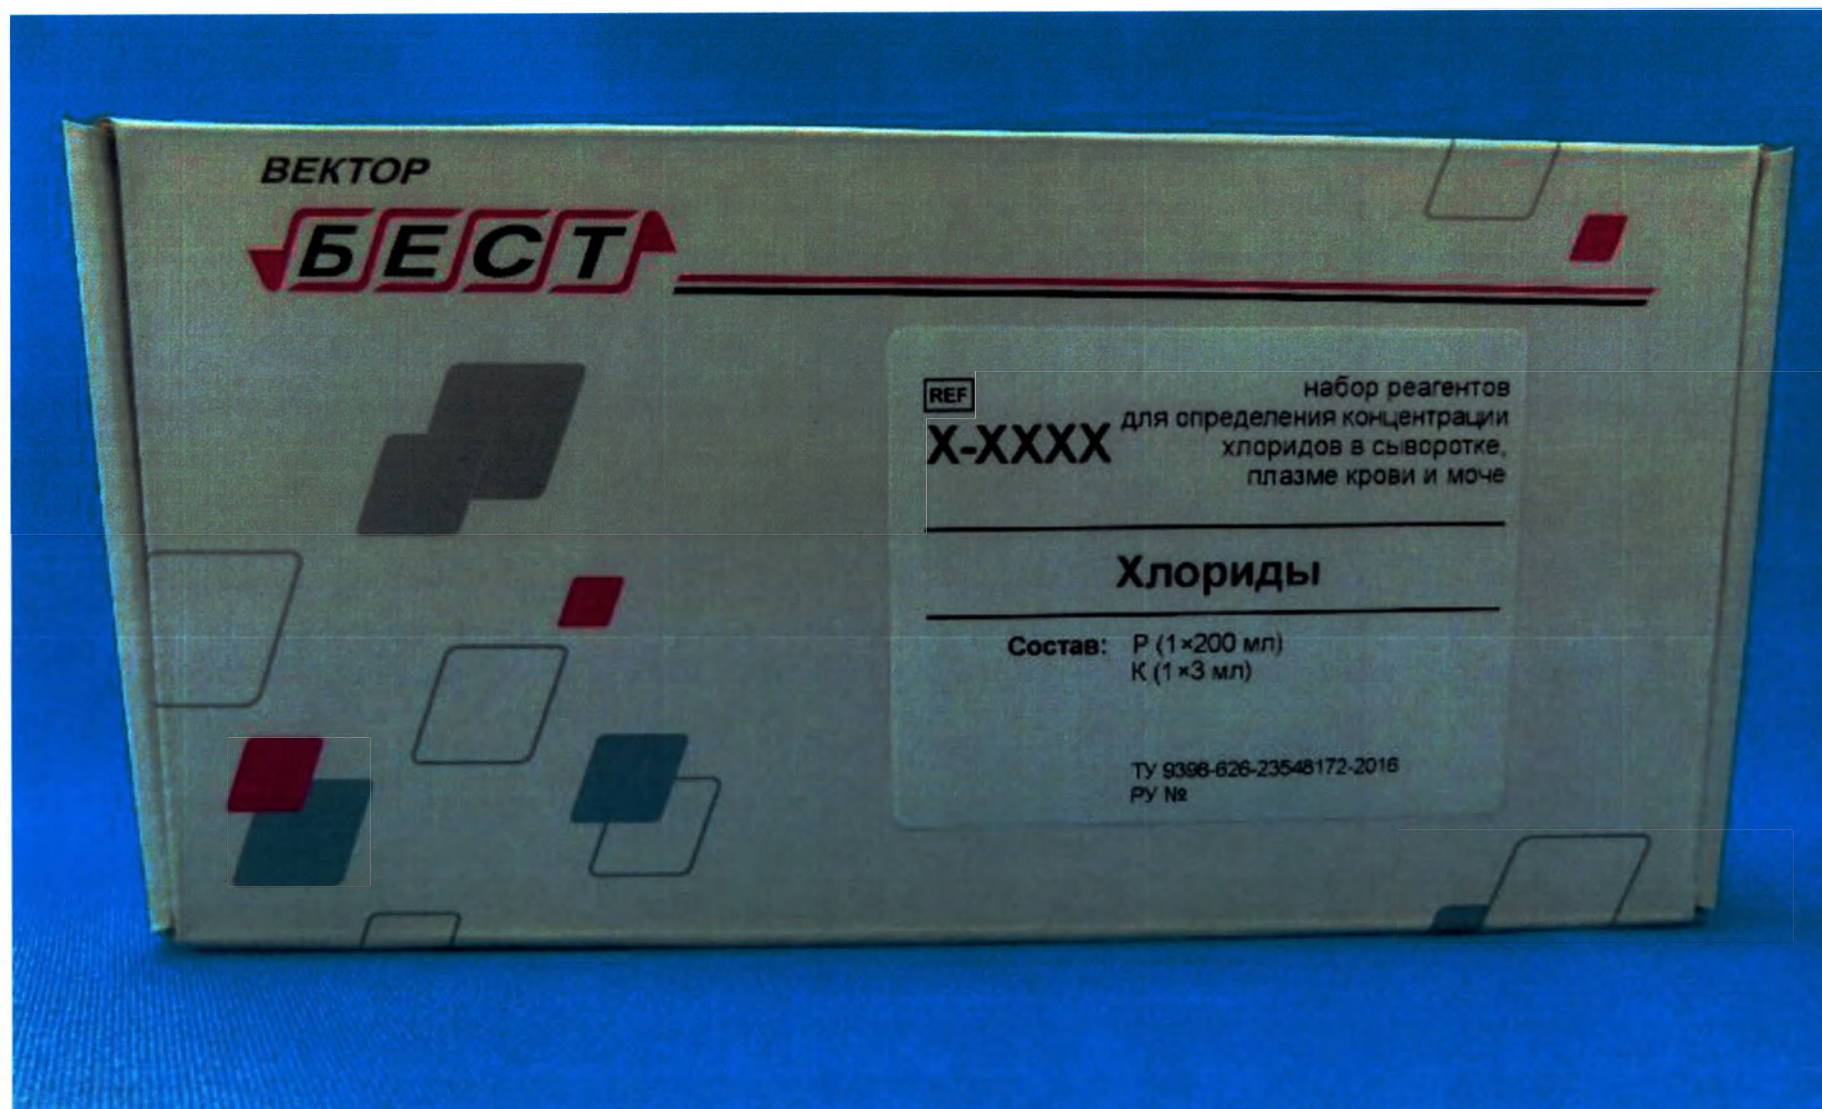


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 1, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 1, Серия 1

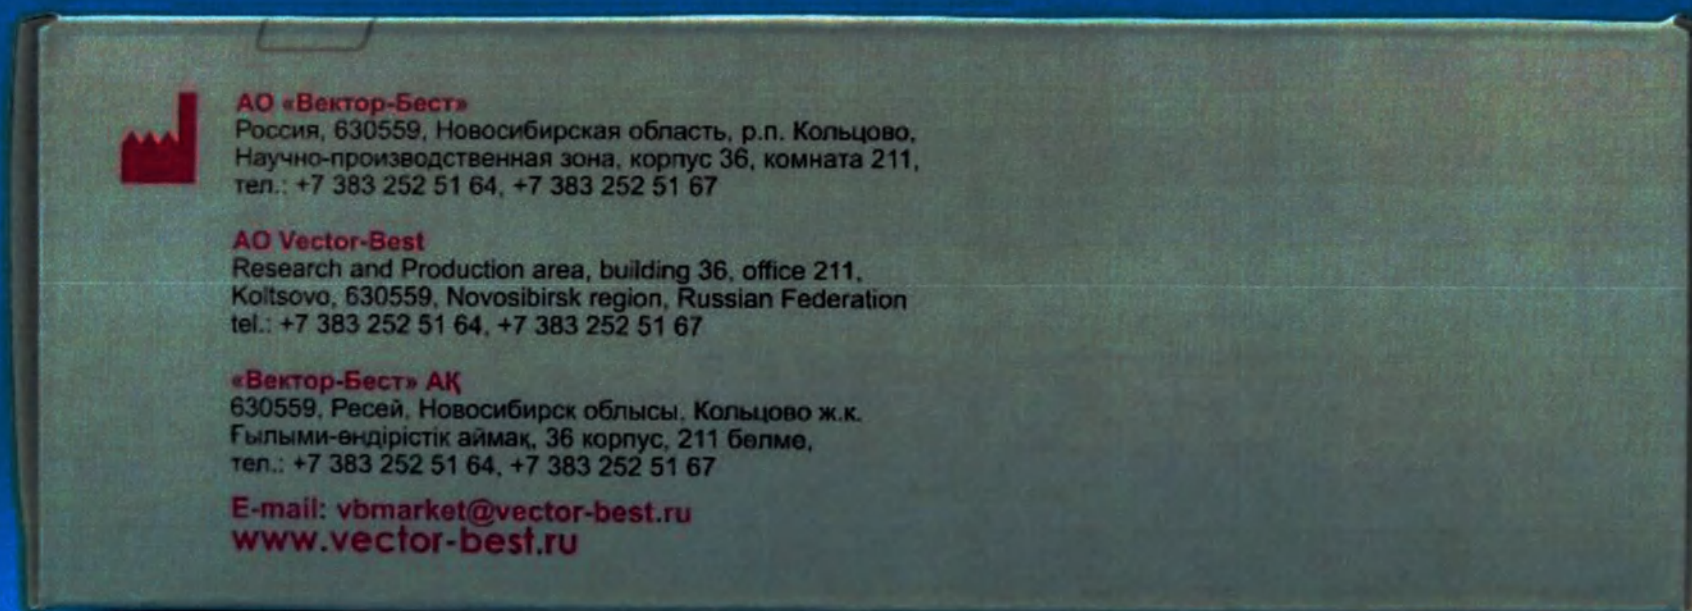

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 2, Серия 1

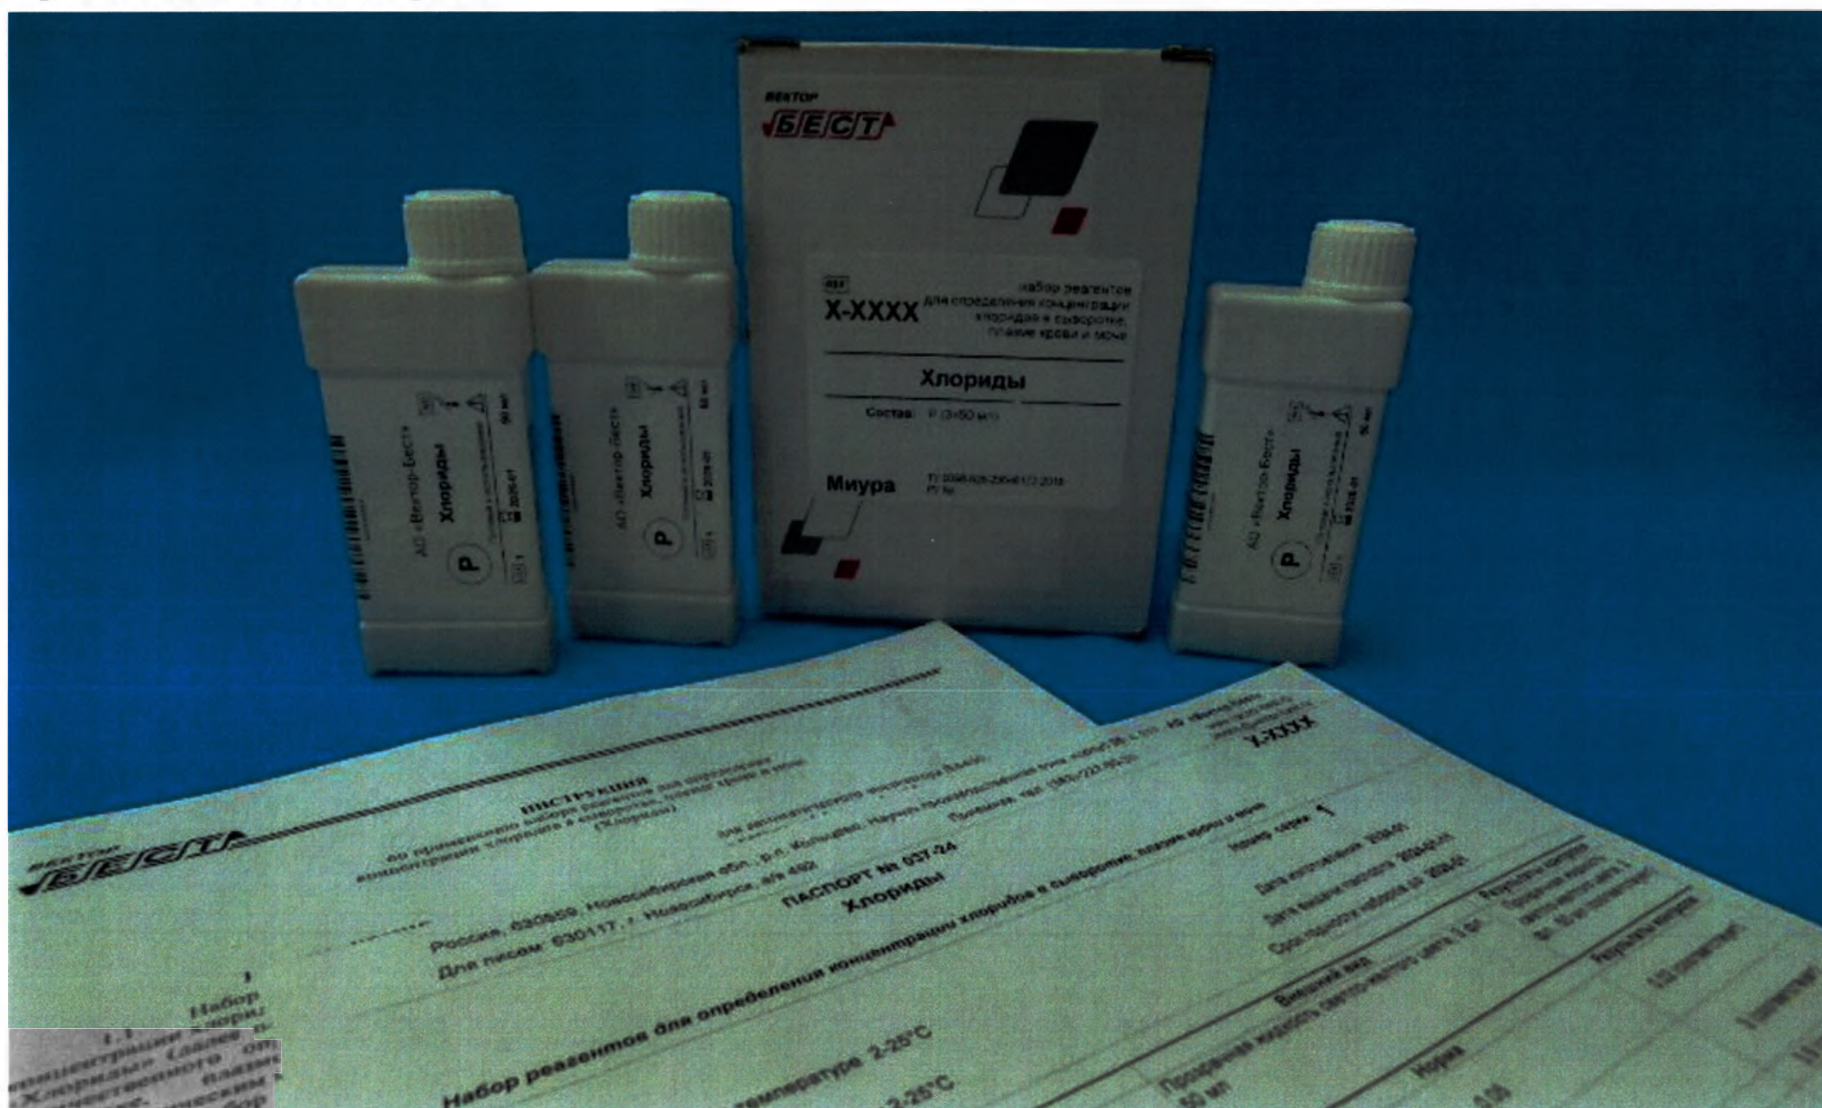

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 2, Серия 1




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 2, Серия 1




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 2, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 2, Серия 1

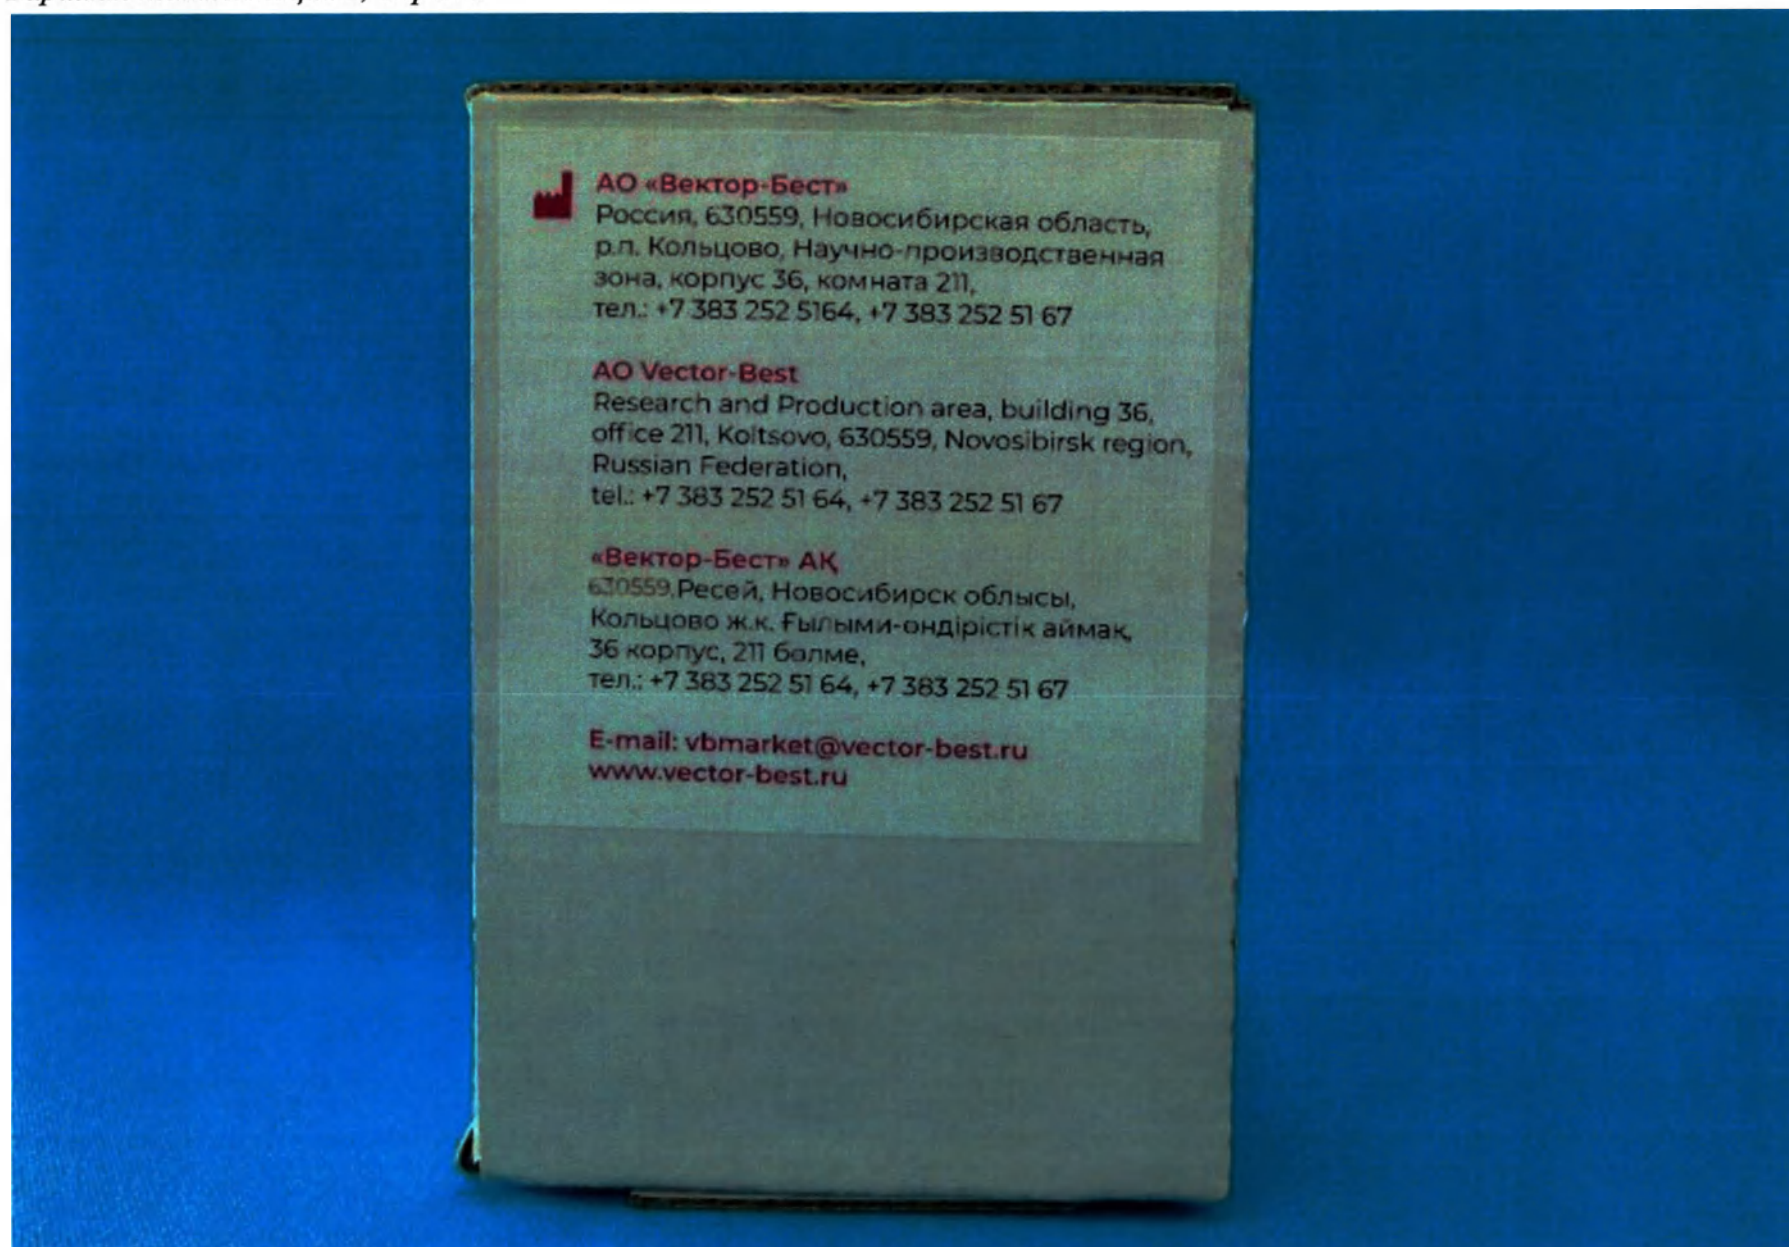

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
 «Хлориды»
 Вариант комплектации 3, Серия 1

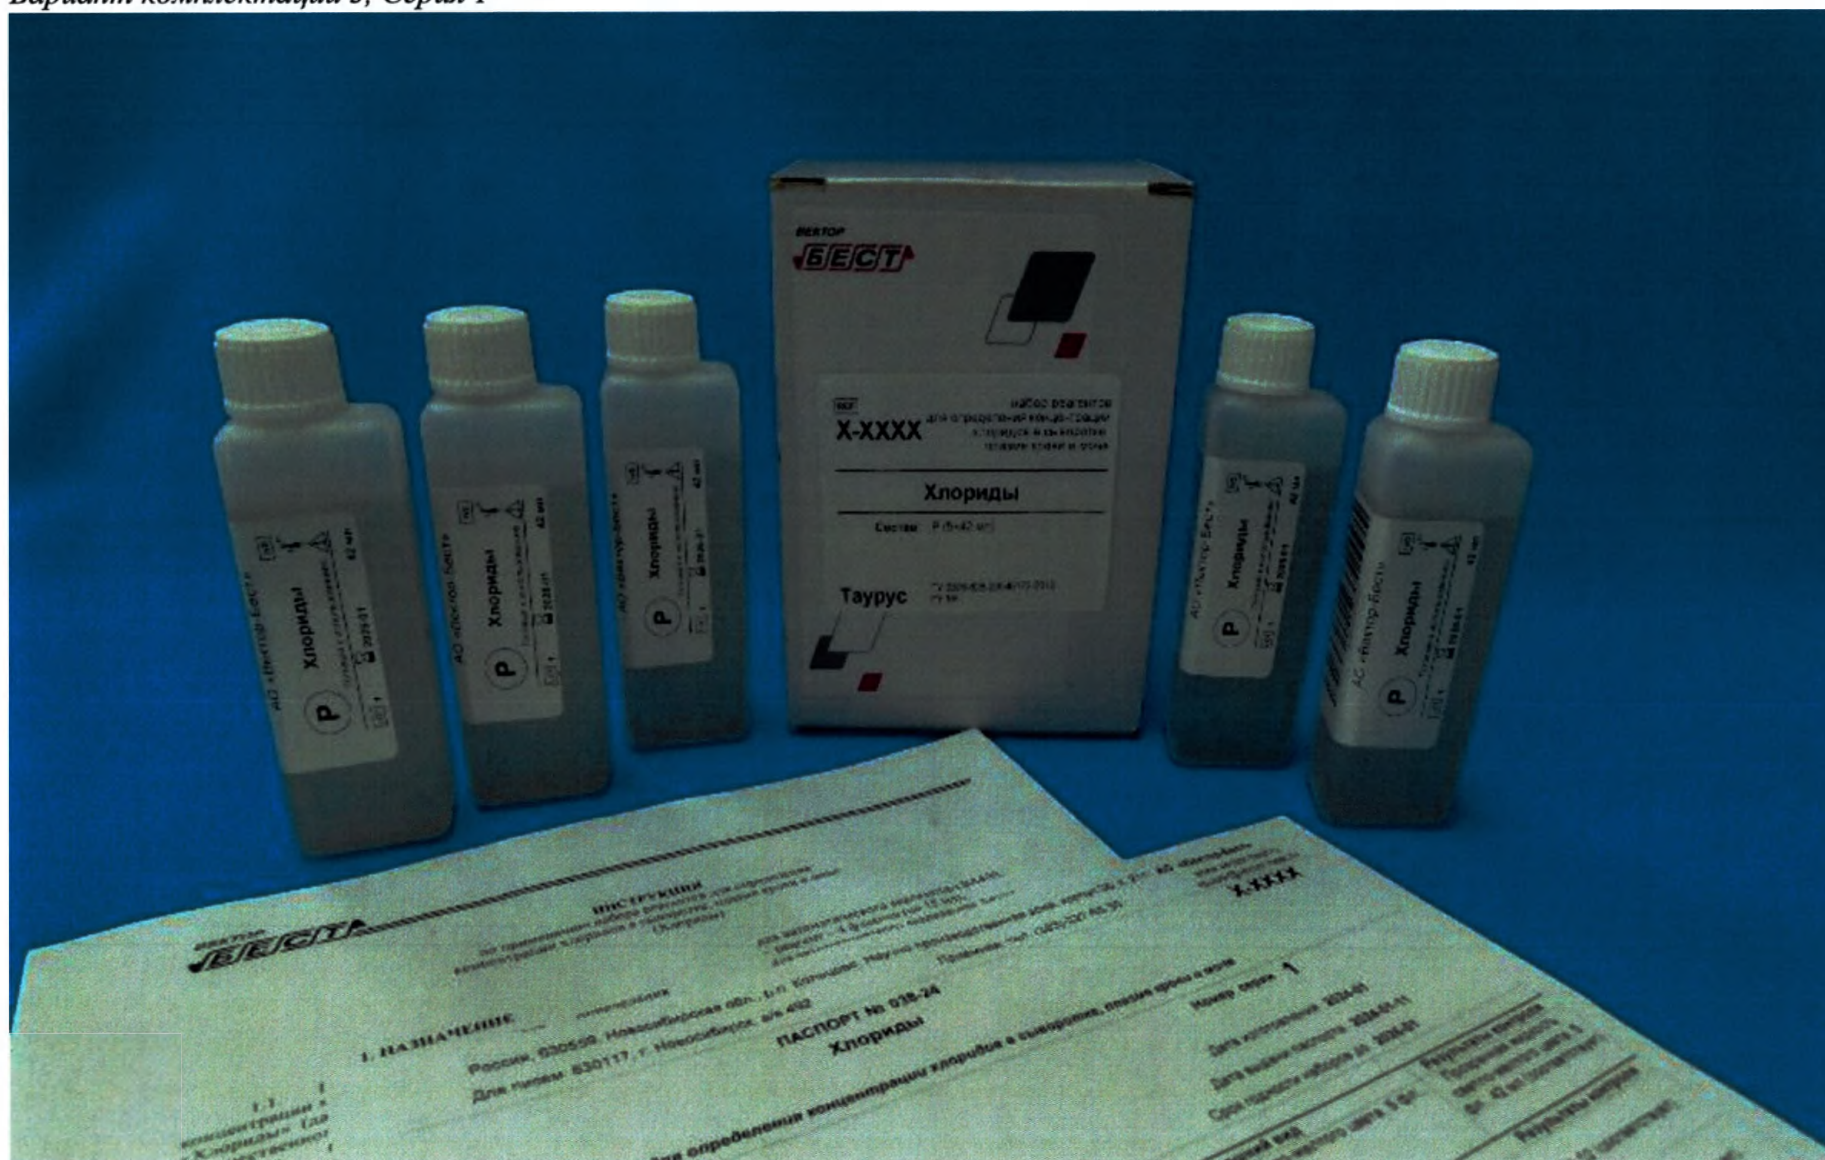

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»

Вариант комплектации 3, Серия 1




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 3, Серия 1




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 3, Серия 1




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 3, Серия 1

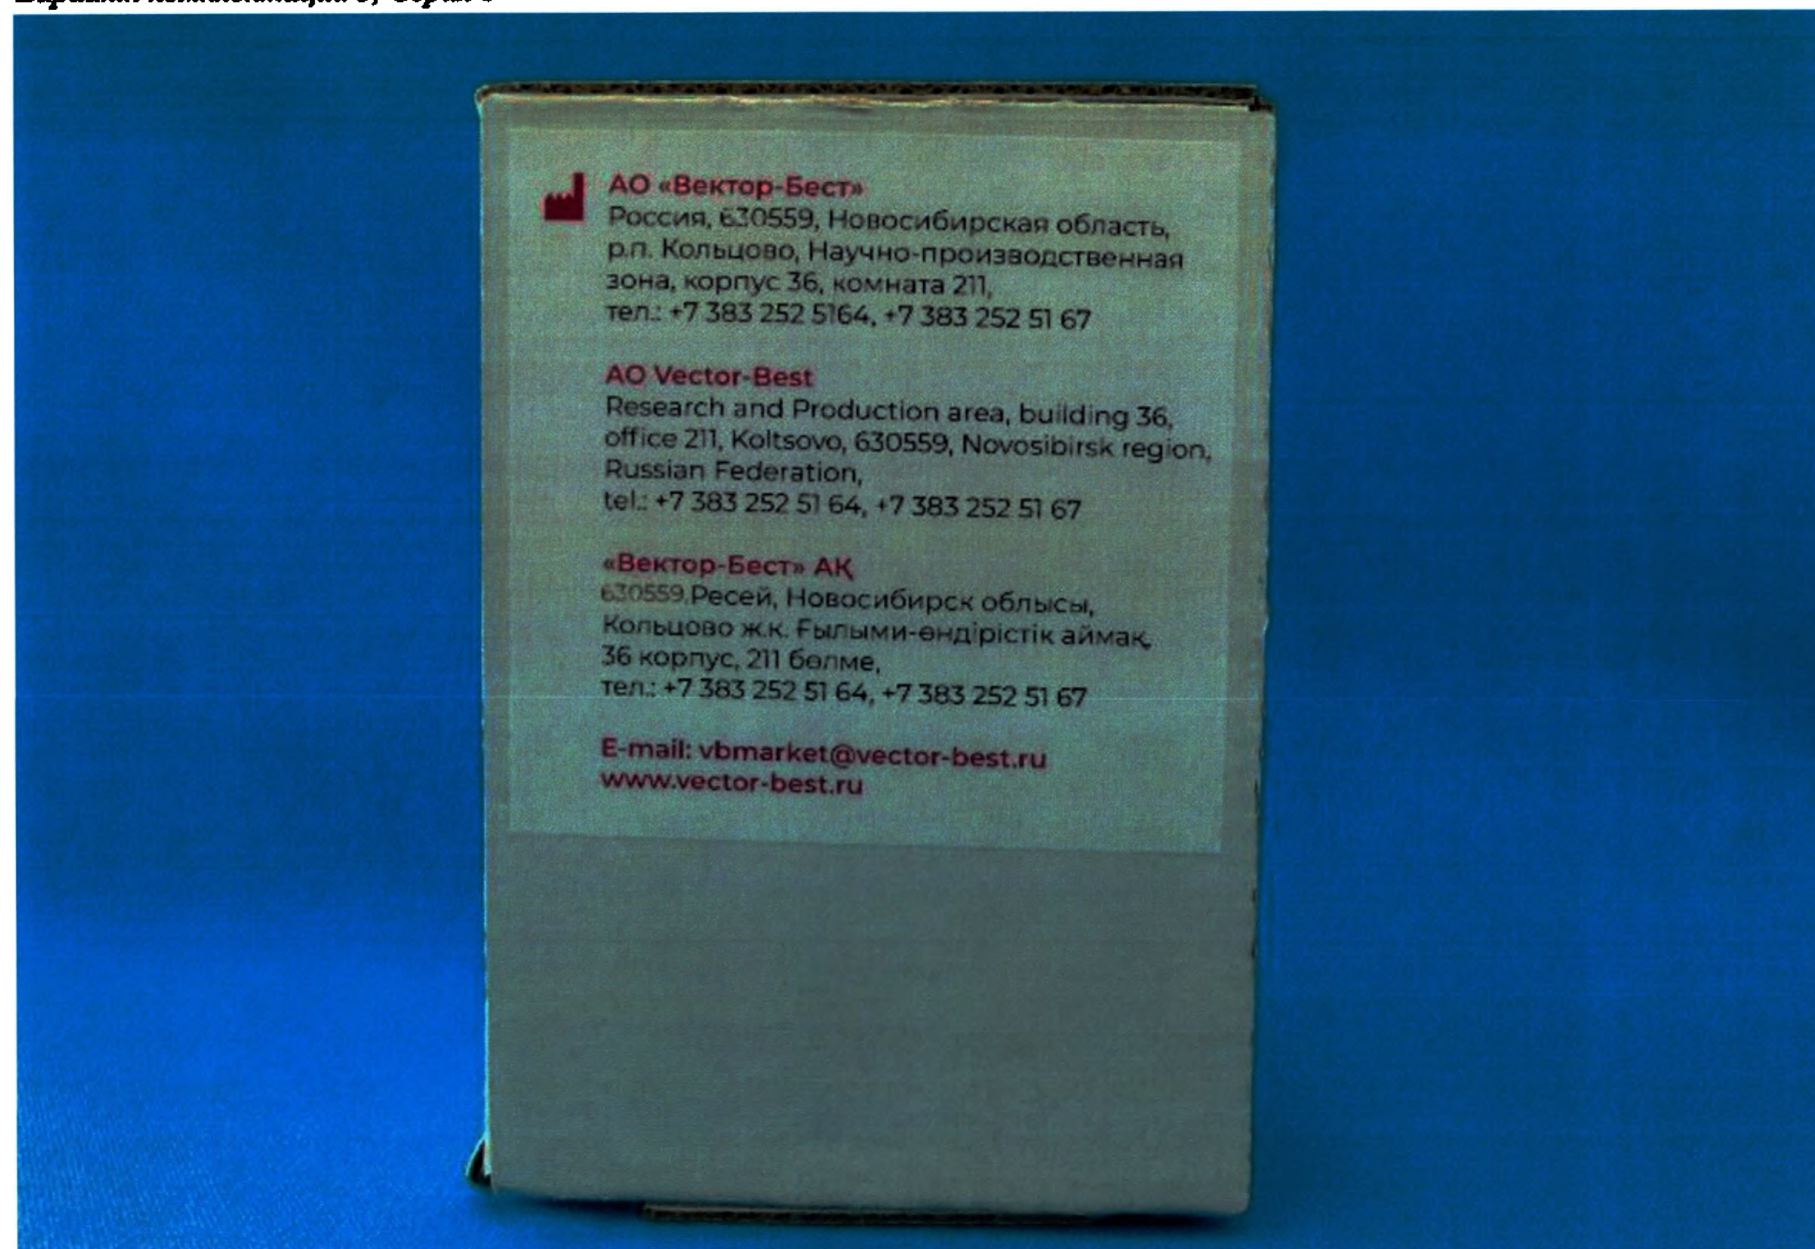


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
 «Хлориды»
 Вариант комплектации 4, Серия 1

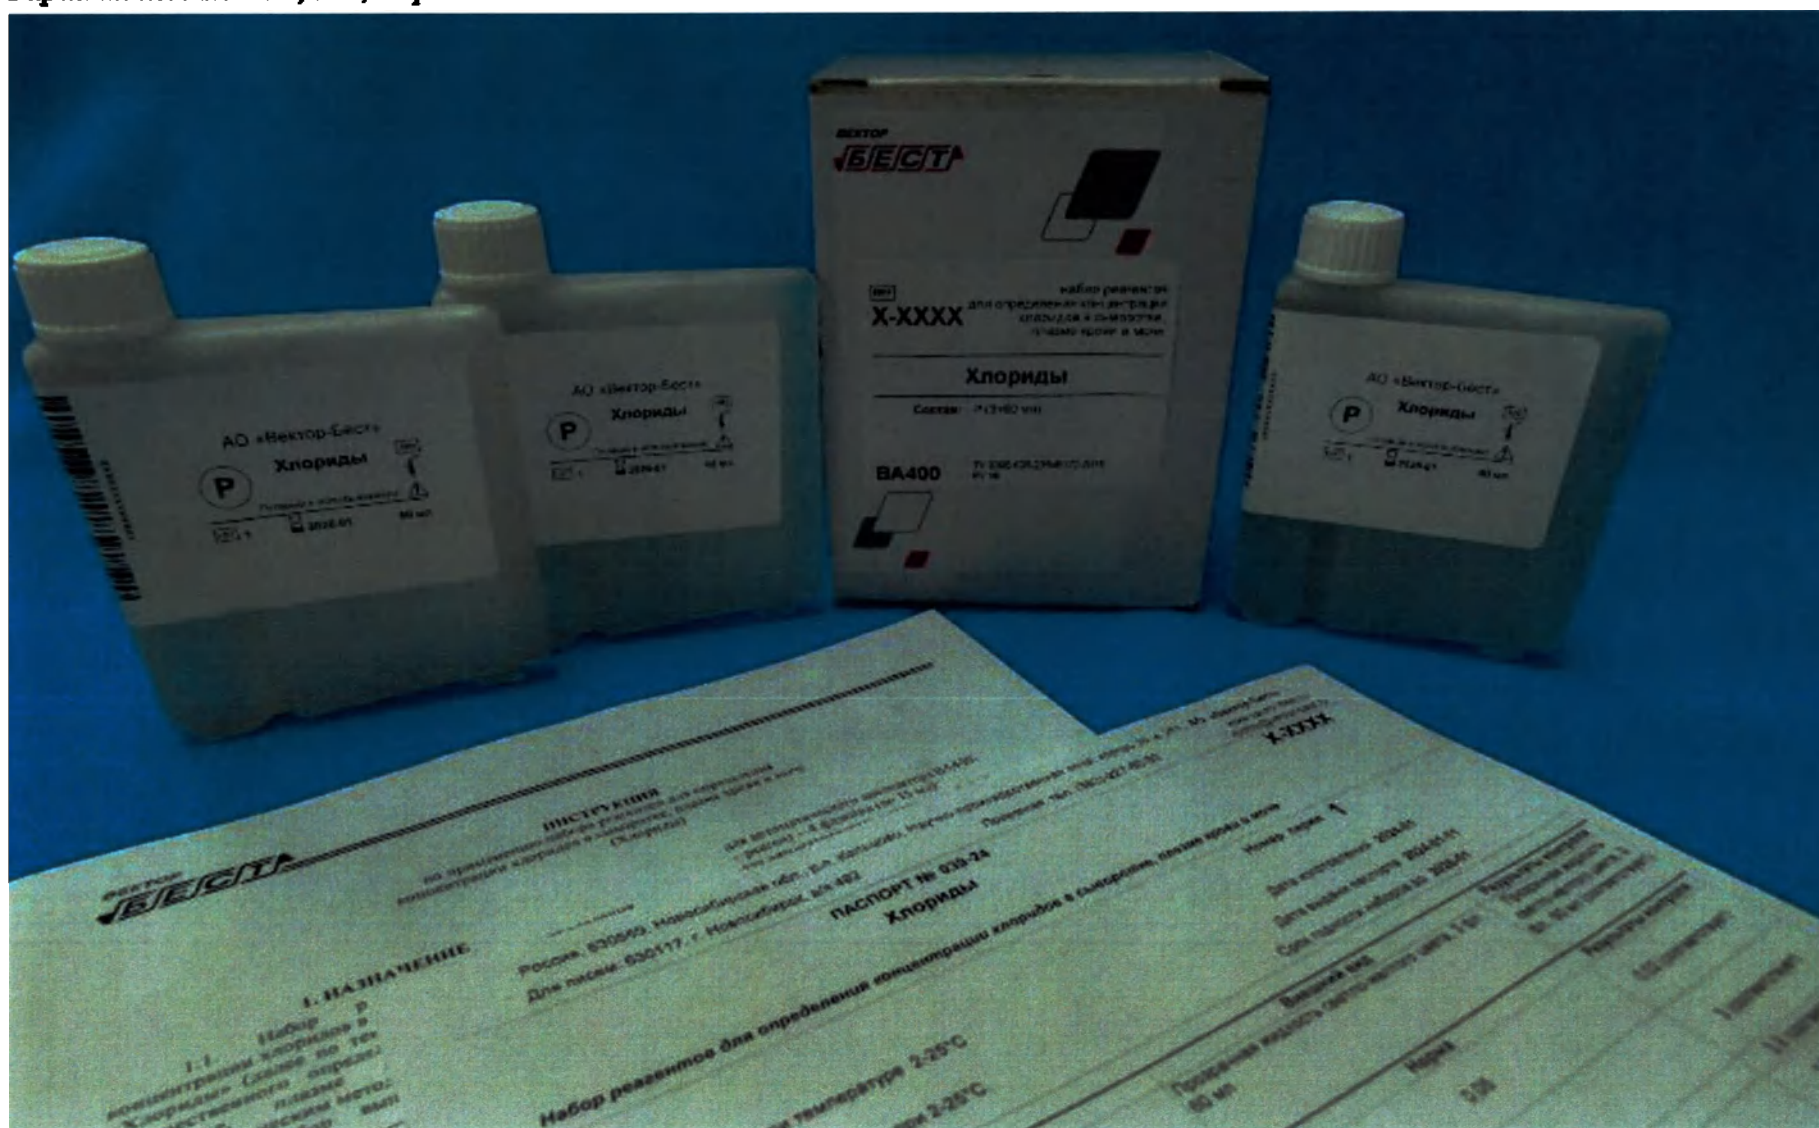

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 4, Серия 1

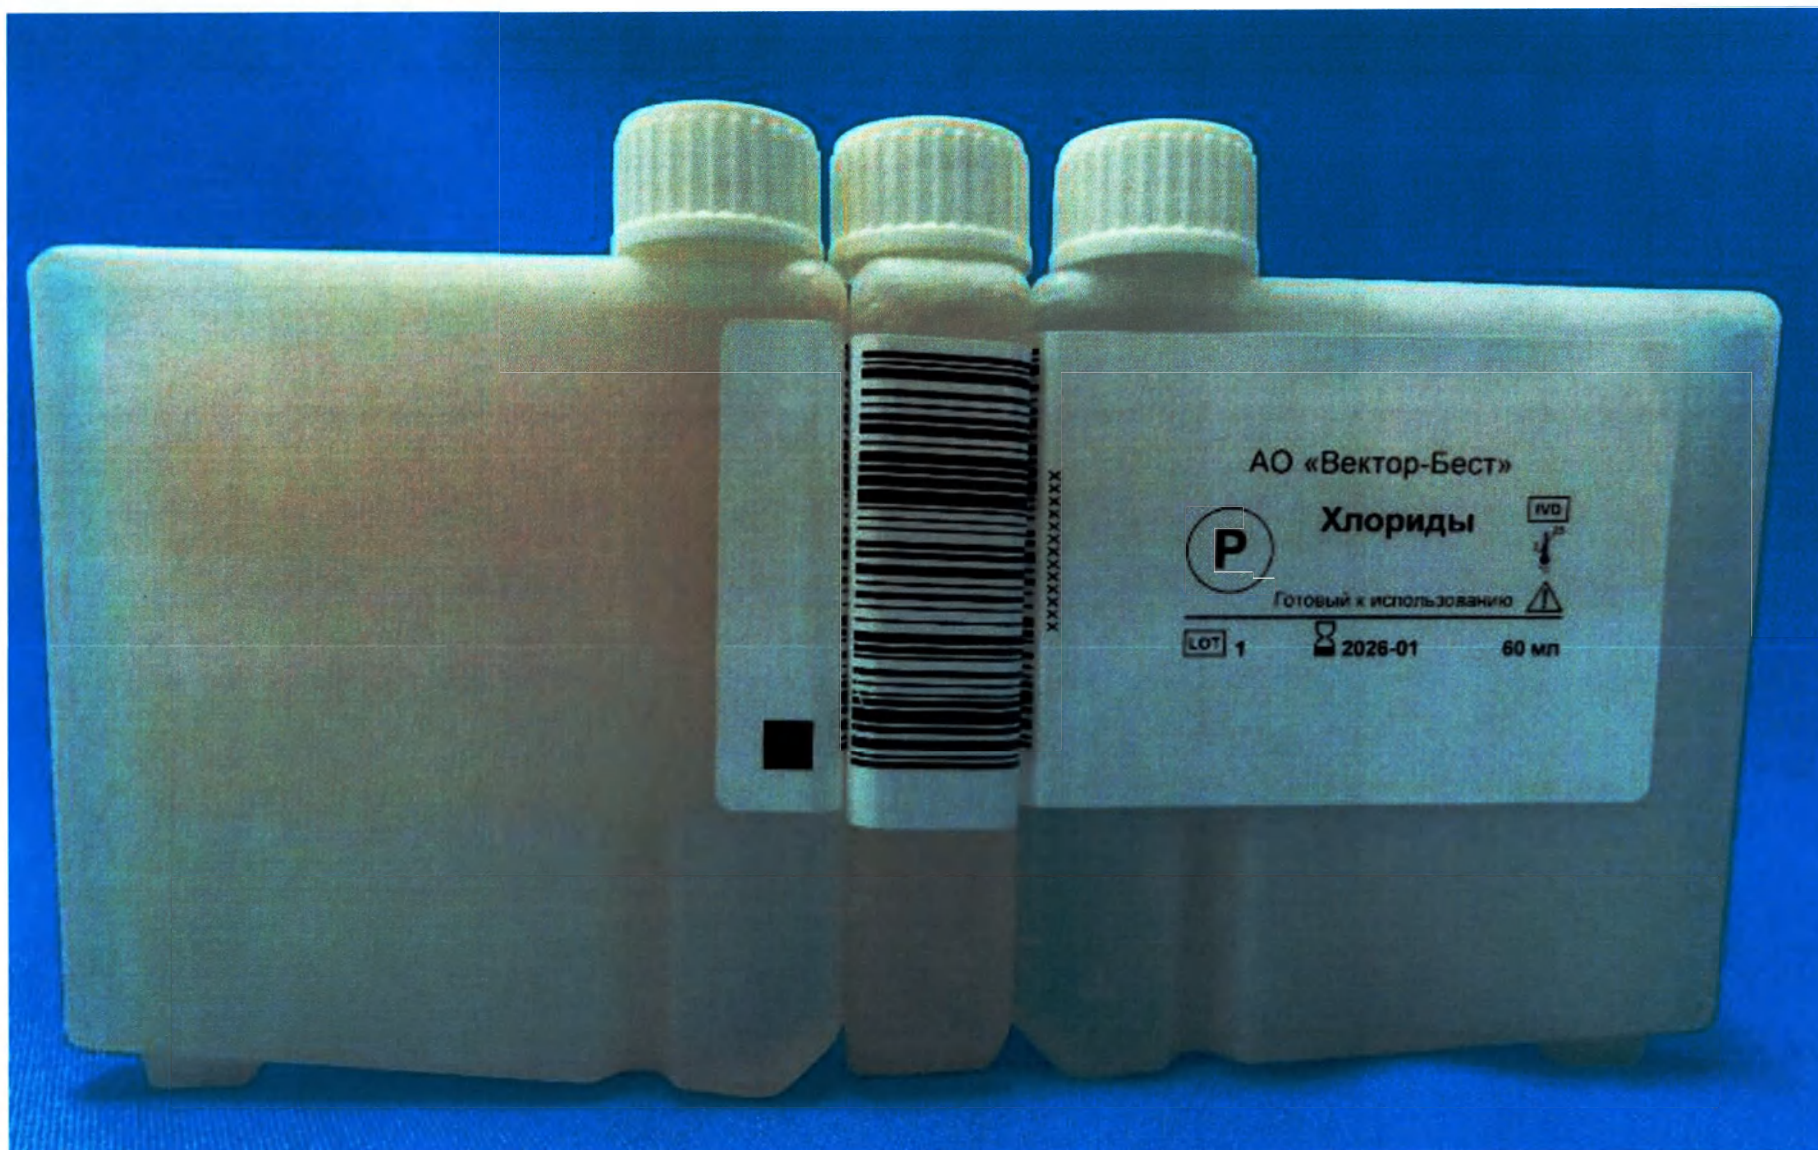


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 4, Серия 1

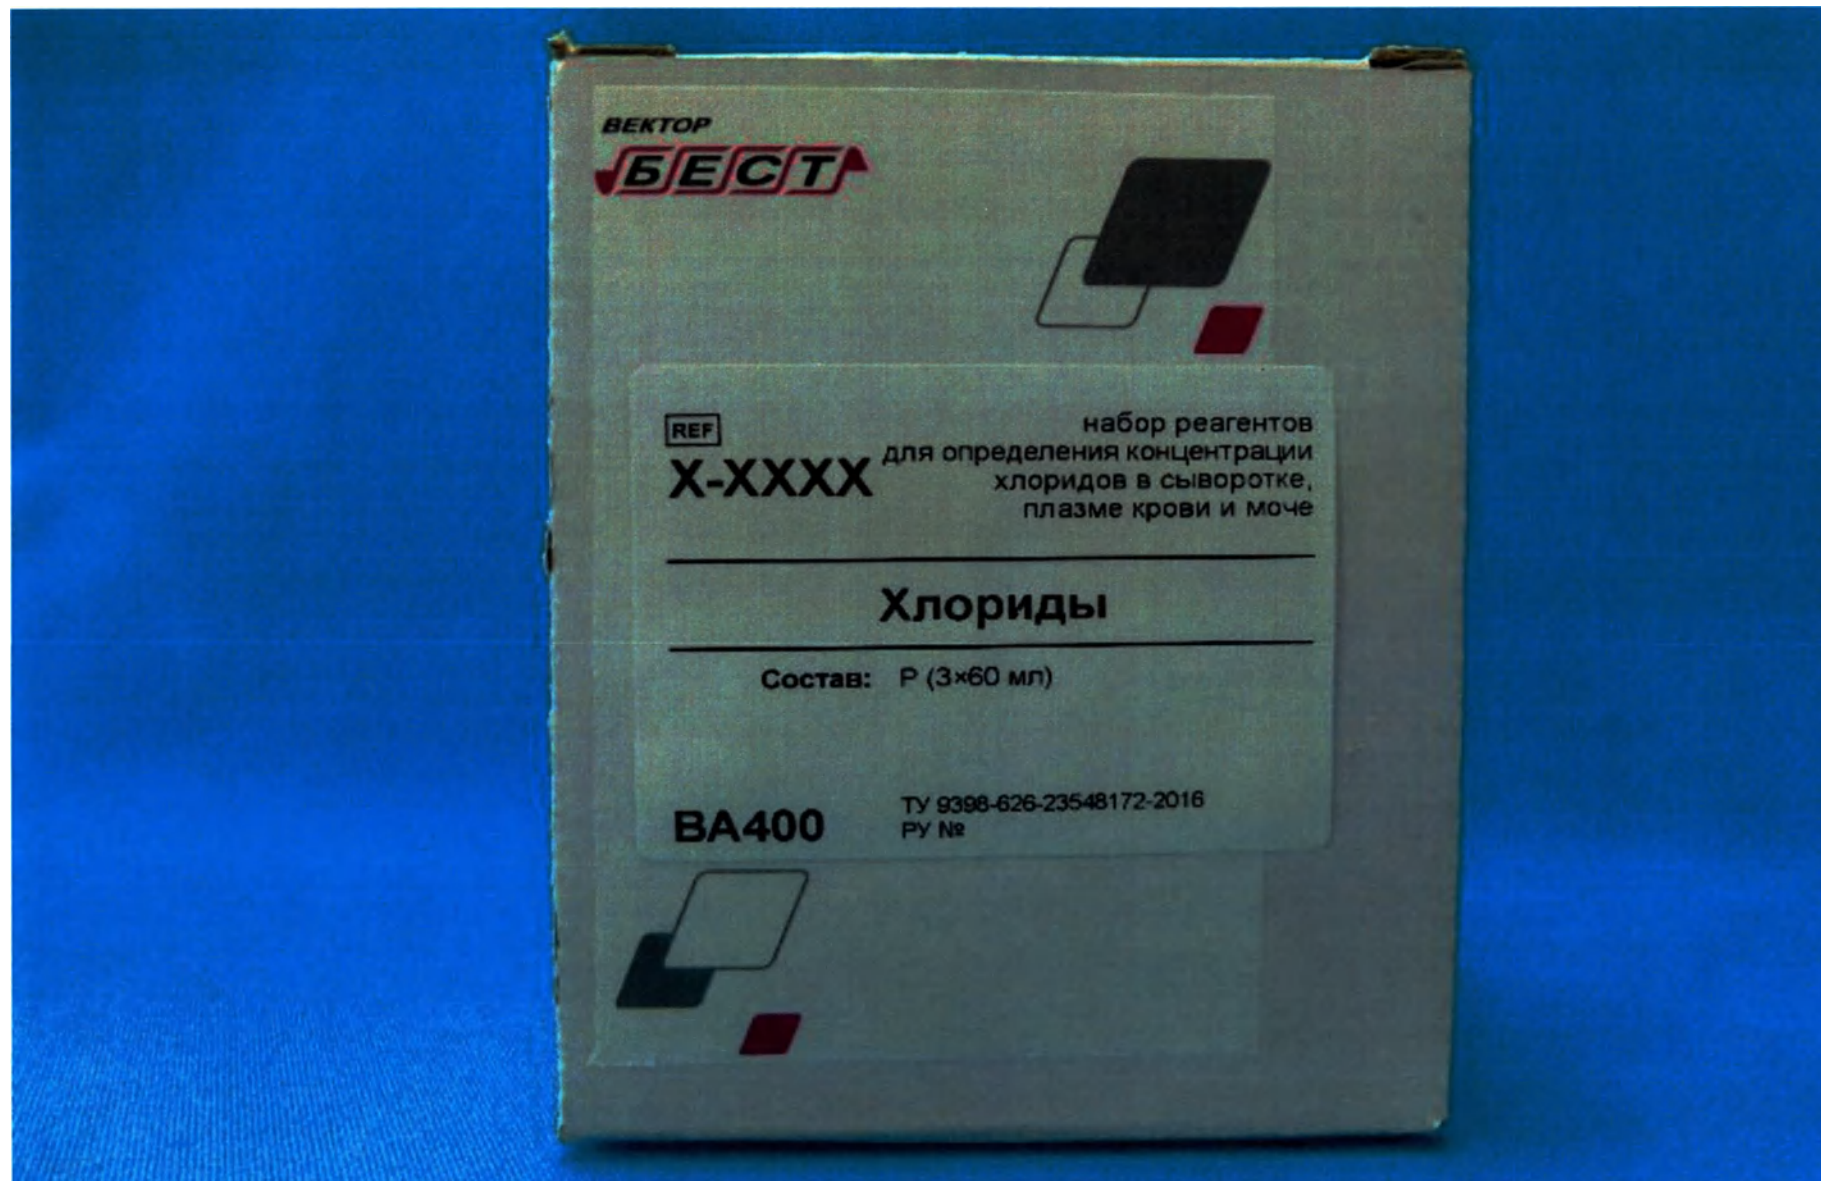


Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 4, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 4, Серия 1

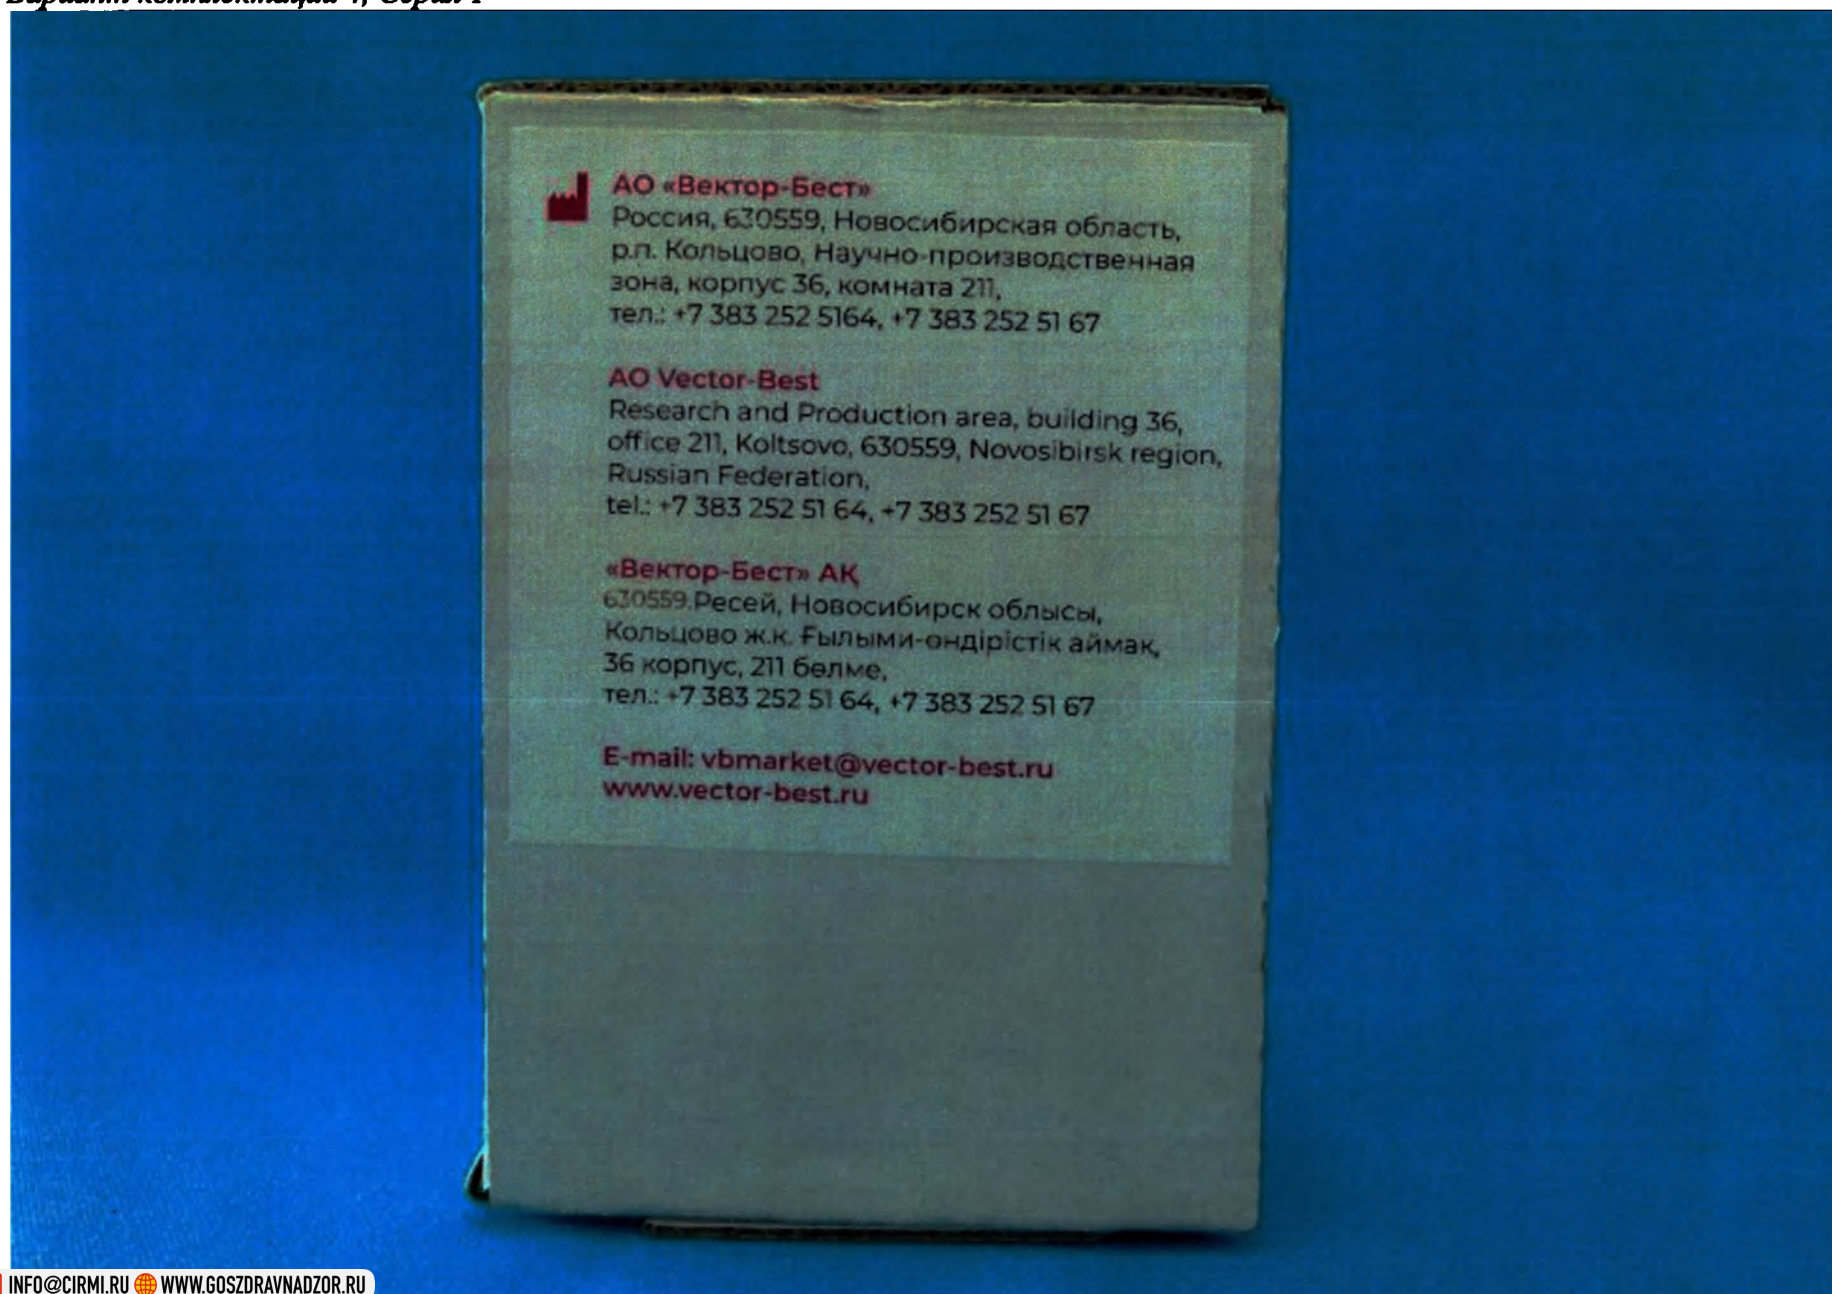


Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
 Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
 «Хлориды»
 Вариант комплектации 5, Серия 1

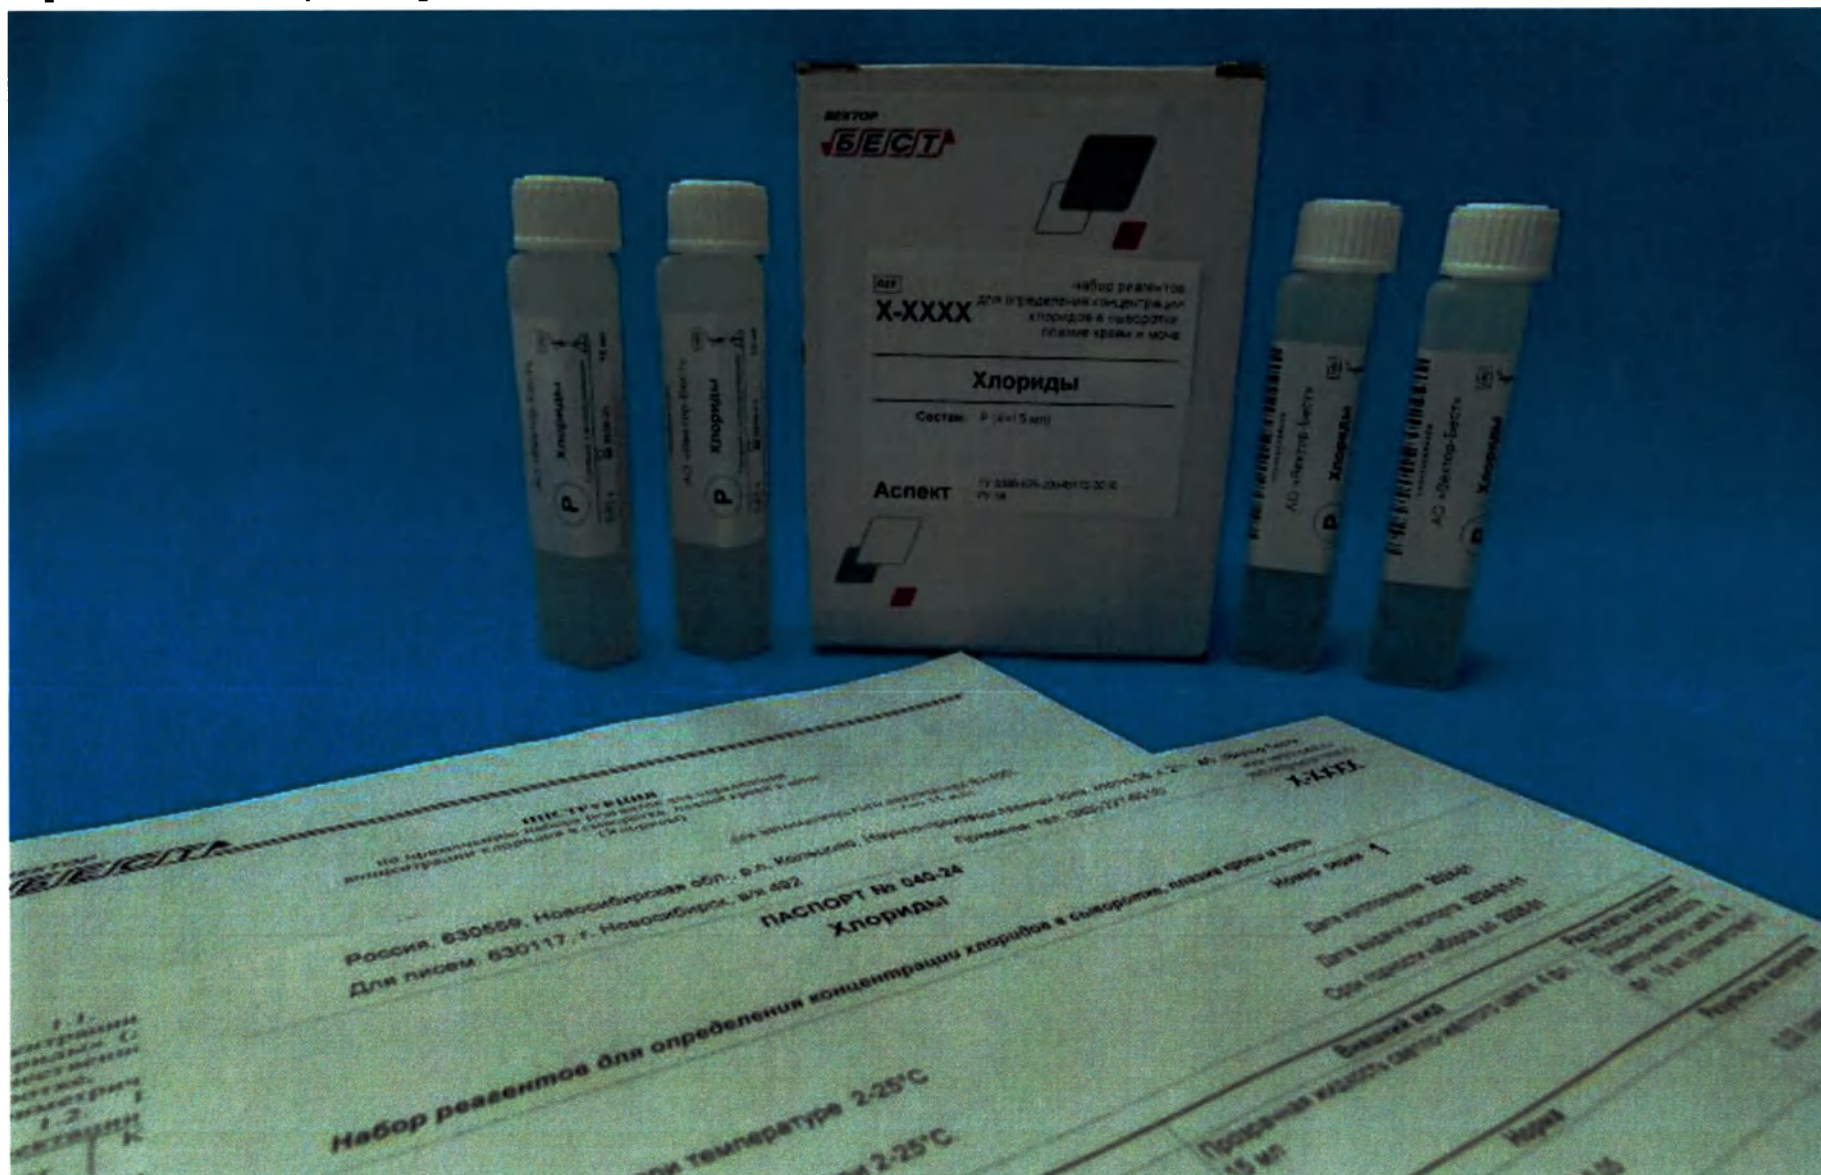

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 5, Серия 1




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 5, Серия 1

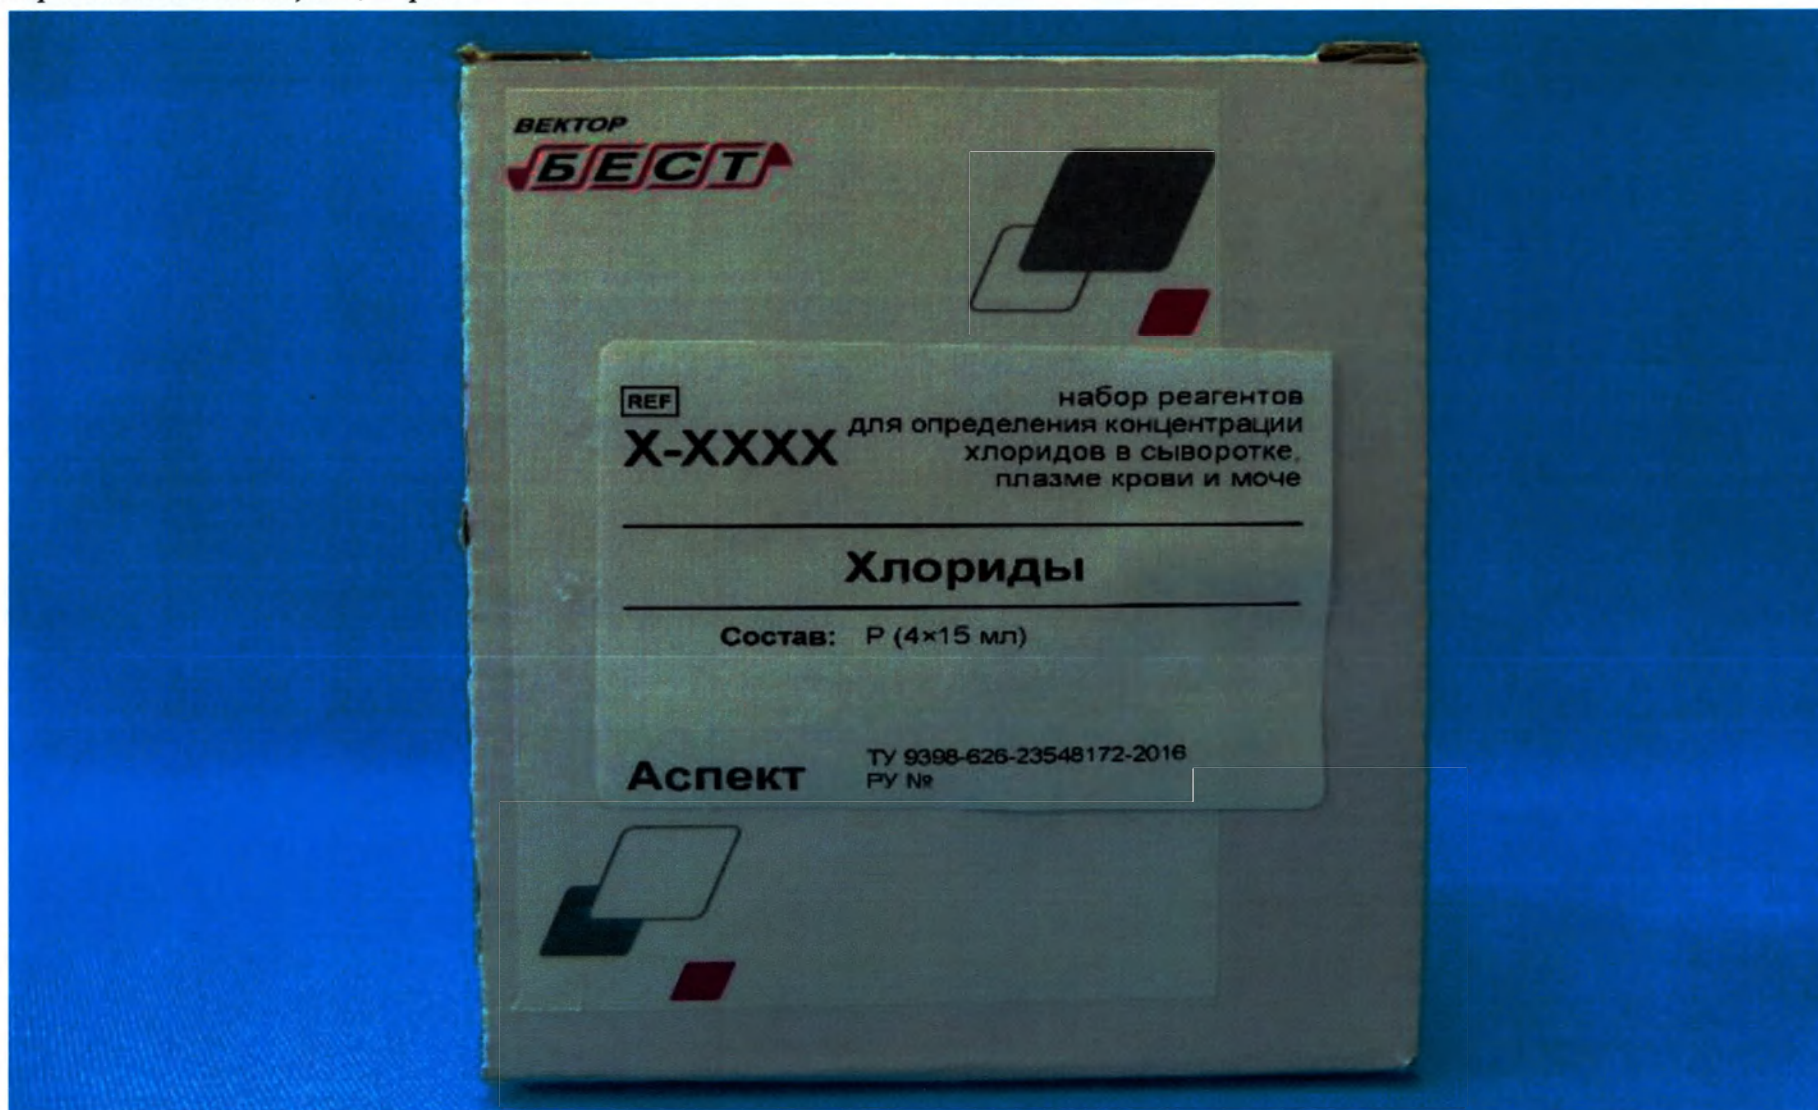

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлориды»
Вариант комплектации 5, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2
Набор реагентов для концентрации хлоридов в сыворотке, плазме крови и моче
«Хлоридь»
Вариант комплектации 5, Серия 1

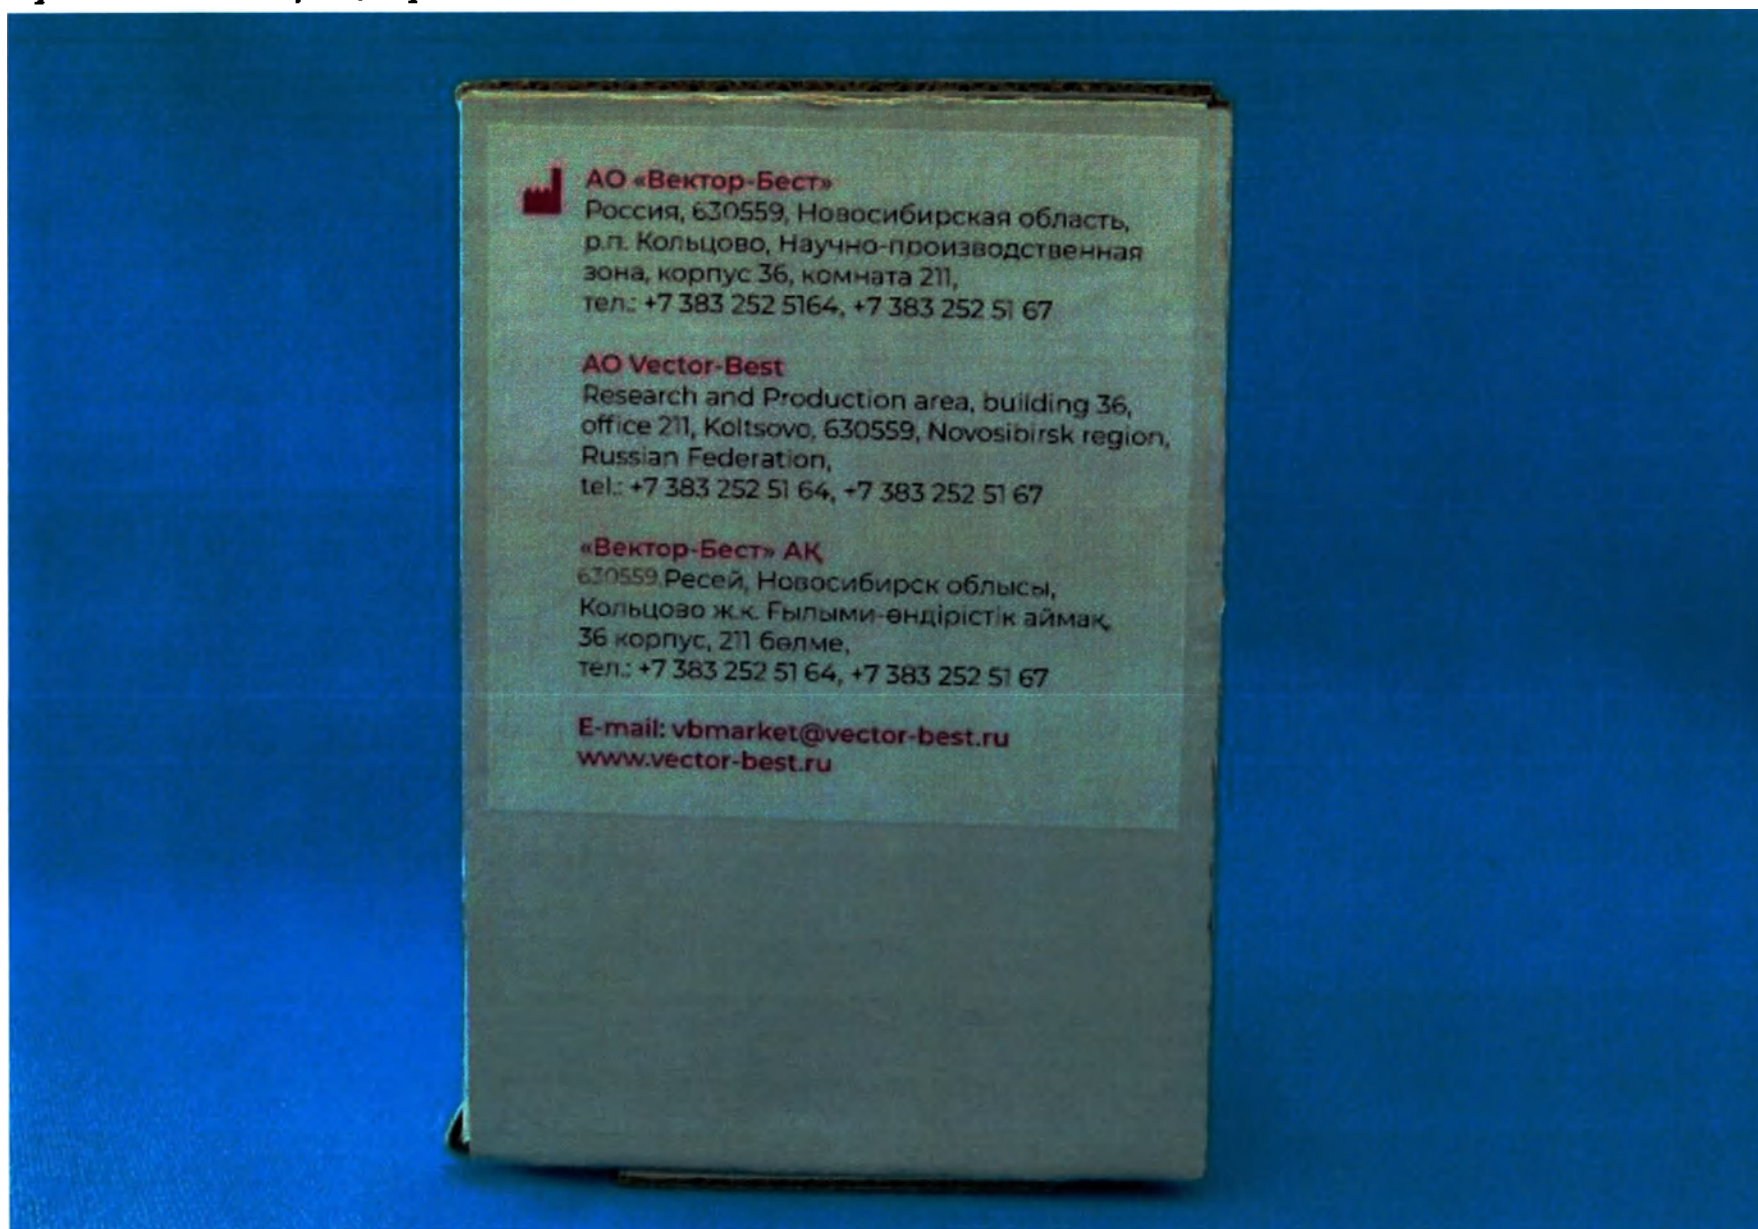

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 29 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"



"15." 01.12.2014 г. Масяго А.В.

