

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов

«10» сентября 2024 г.





Образцы маркировки на Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом (Мочевина УФ)

1. Образцы этикеток на флаконы набора «Мочевина УФ»

Наименование компонента	Этикетка
«Мочевина УФ», вариант комплектации 1	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	
Калибратор (K)	
«Мочевина УФ», вариант комплектации 2	
Реагент 1 (P1)	



Реагент 2 (P2)	
Калибратор (K)	
«Мочевина УФ», вариант комплектации 3	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	

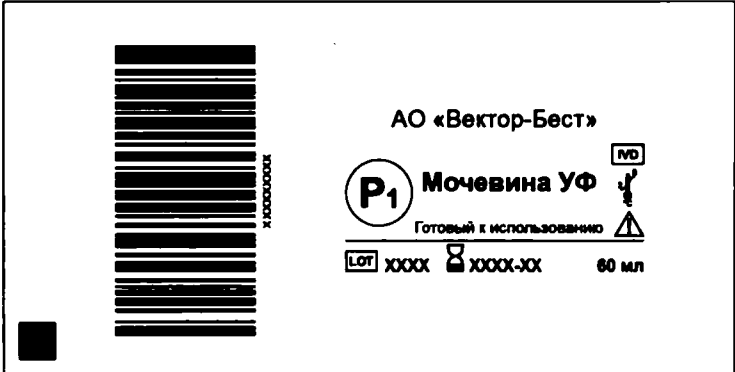«Мочевина УФ», вариант комплектации 4	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	
«Мочевина УФ», вариант комплектации 5	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	

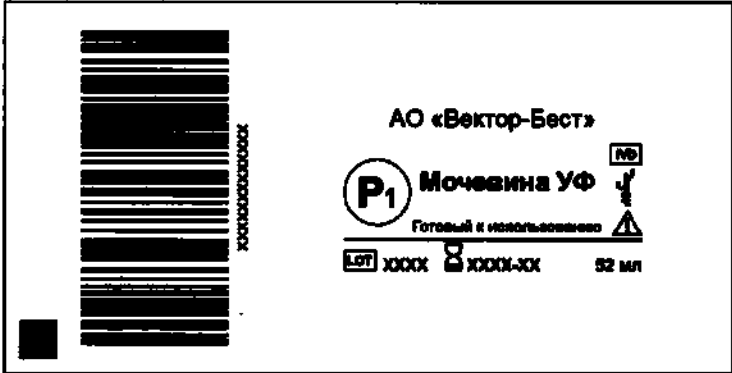«Мочевина УФ», вариант комплектации 6	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	

2. Образцы этикеток на коробке набора «Мочевина УФ»

2.1. Верхняя этикетка.

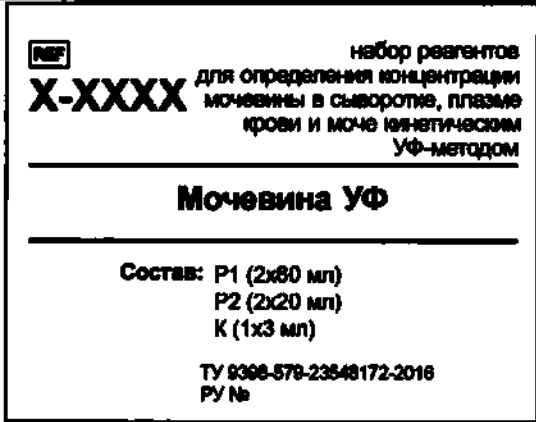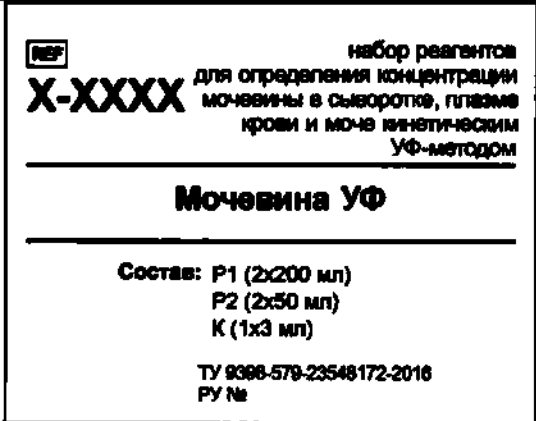Вариант комплектации 1	
Вариант комплектации 2	

Вариант комплектации 3	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом Мочевина УФ Состав: P1 (4x48 мл) P2 (4x14 мл) Миура ТУ 9398-579-23548172-2016 ПУ №
Вариант комплектации 4	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом Мочевина УФ Состав: P1 (10x78 мл) P2 (5x42 мл) Таурус ТУ 9398-579-23548172-2016 ПУ №
Вариант комплектации 5	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом Мочевина УФ Состав: P1 (8x80 мл) P2 (8x20 мл) BA 400 ТУ 9398-579-23548172-2016 ПУ №
Вариант комплектации 6	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом Мочевина УФ Состав: P1 (10x52 мл) P2 (10x15 мл) Аспект ТУ 9398-579-23548172-2016 ПУ №

2.2. Боковая этикетка

Варианты комплектации 1, 2	REF X-XXXX LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Мочевина УФ 2 3 4 ! IVD i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения
Вариант комплектации 3	REF X-XXXX Σ 1070 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Мочевина УФ 2 3 4 ! IVD i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения
Вариант комплектации 4	REF X-XXXX Σ 4520 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Мочевина УФ 2 3 4 ! IVD i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения
Вариант комплектации 5	REF X-XXXX Σ 2850 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Мочевина УФ 2 3 4 ! IVD i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения

Вариант комплектации 6	REF X-XXXX Σ 2750 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Мочевина УФ IVD ! XXXXXX XXXXXX Для профессионального применения
-------------------------------	---

Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


AO Vector-Best
Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ
630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-ендірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

« 10 » 01 2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В.

2017г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке,

плазме крови и моче кинетическим УФ-методом


(Мочевина УФ)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»


Вариант комплектации 1, Серия 1

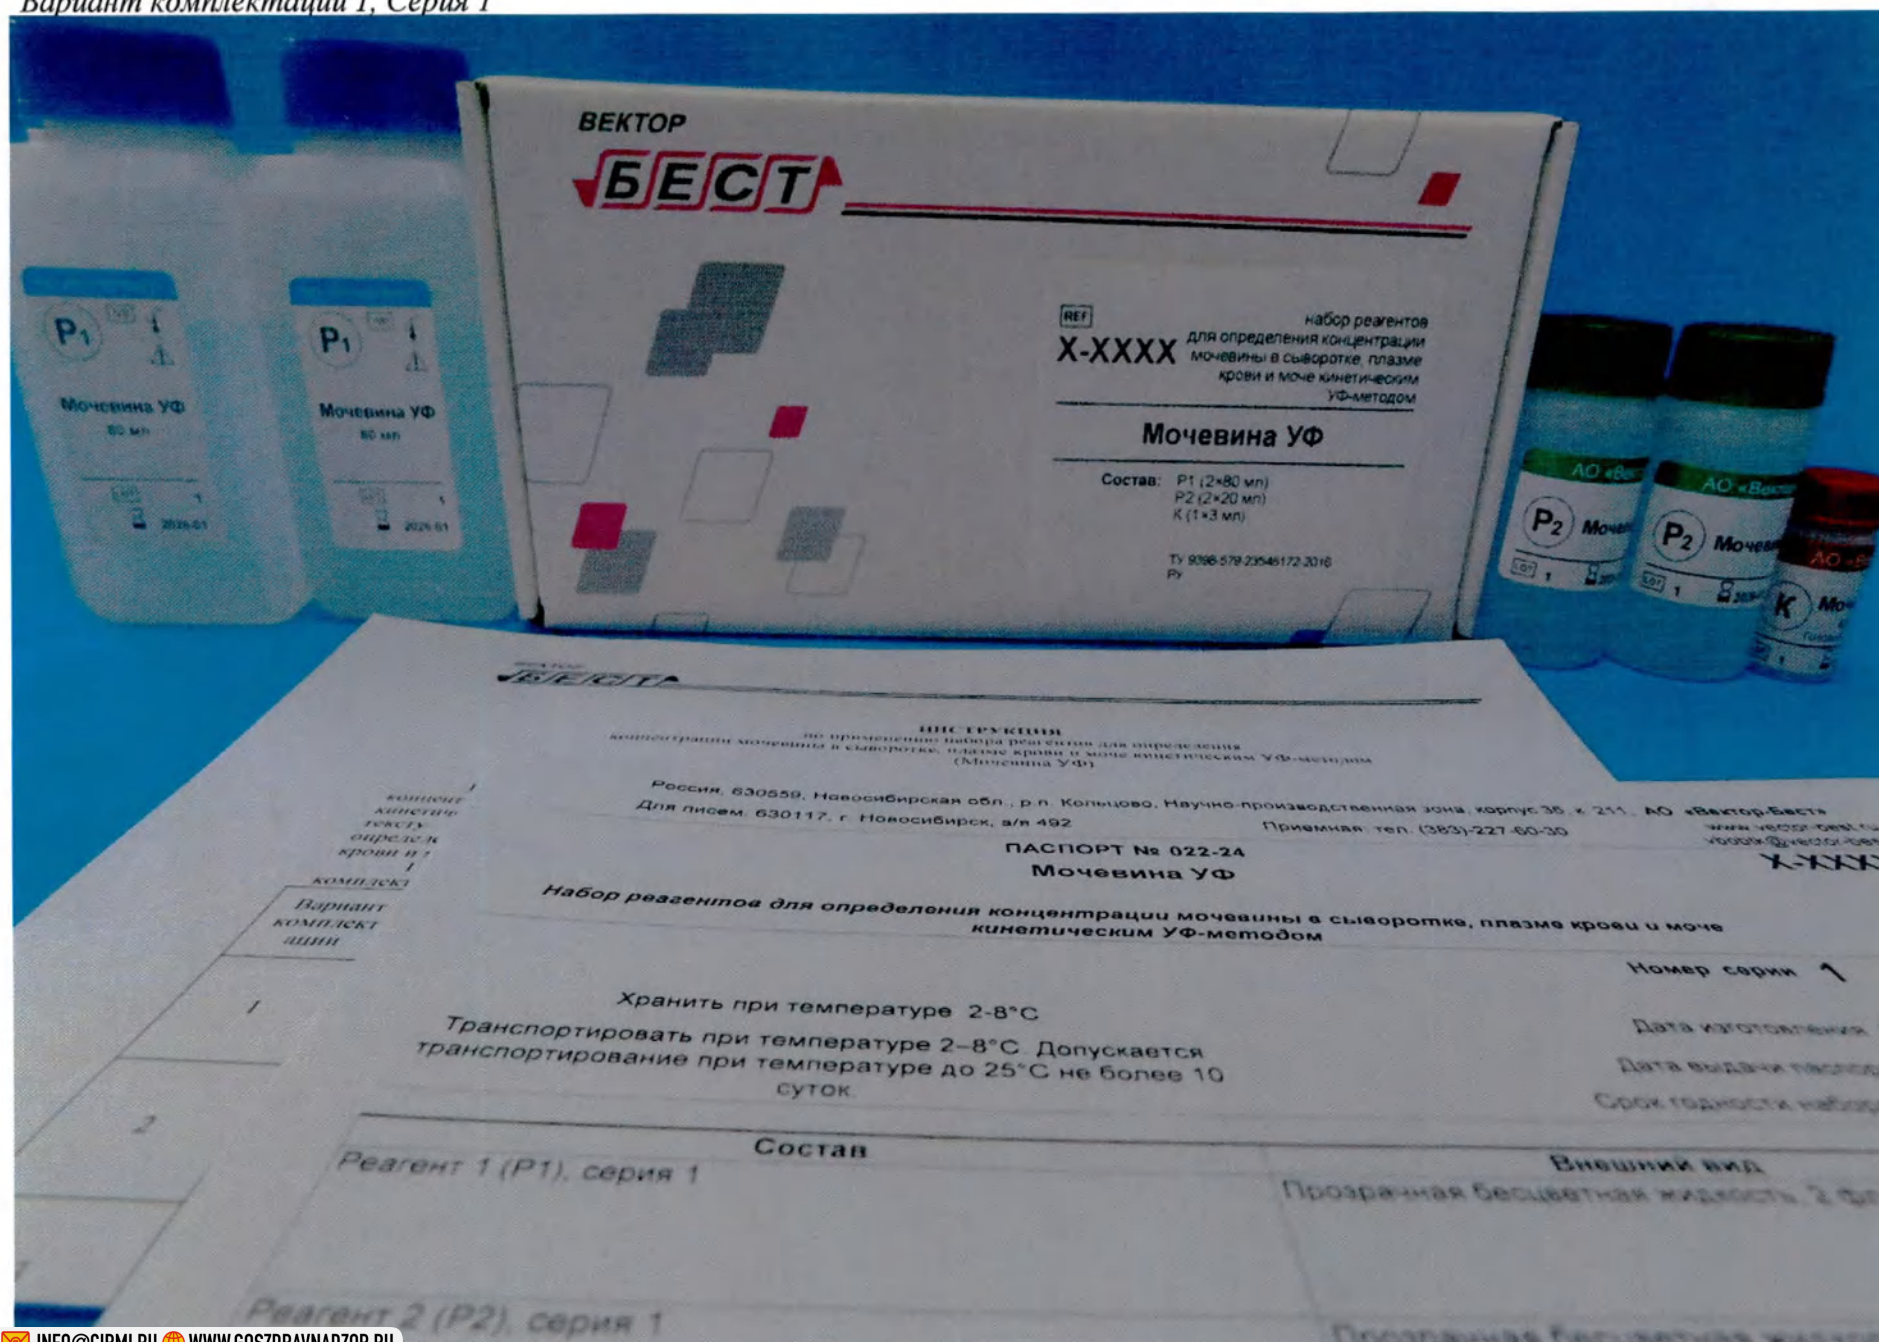

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»


Вариант комплектации 1, Серия 1

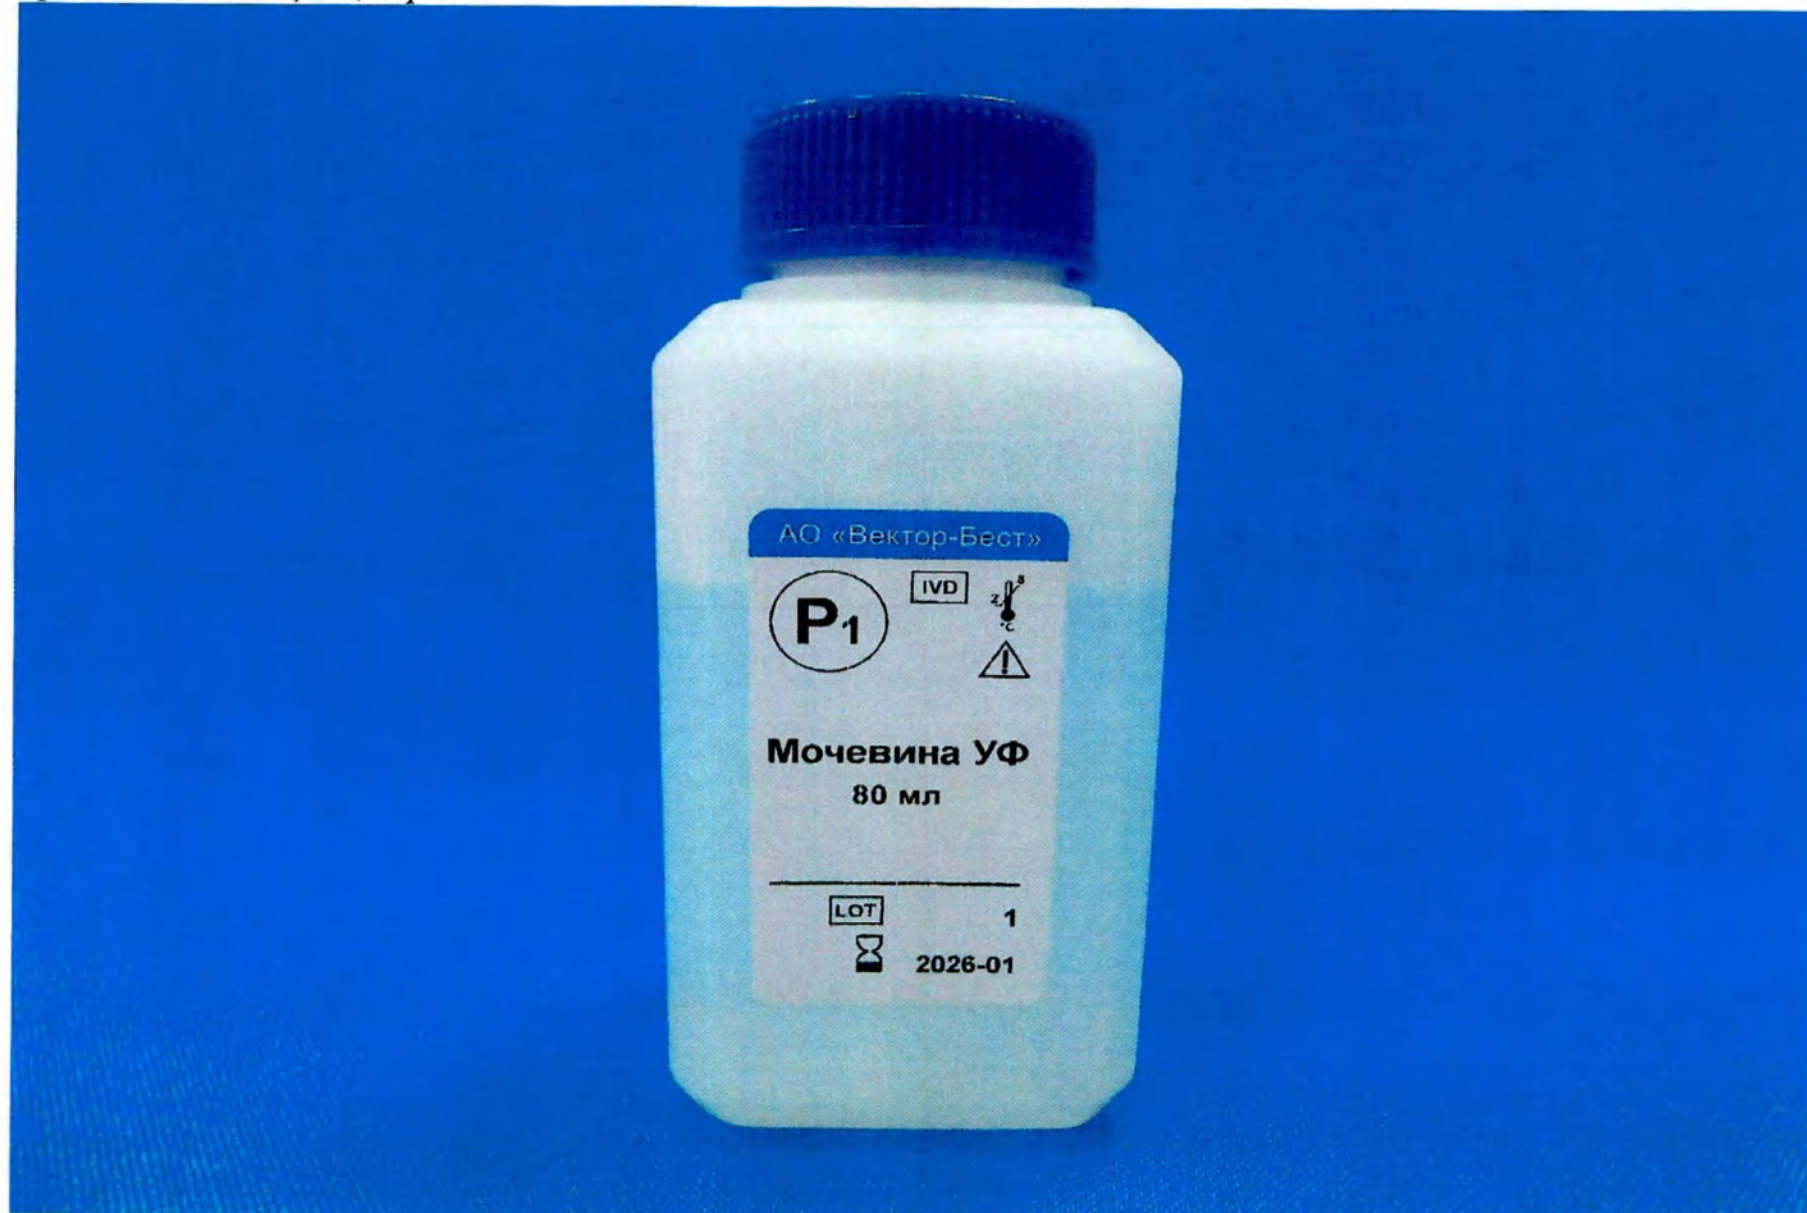

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №2

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 1, Серия 1

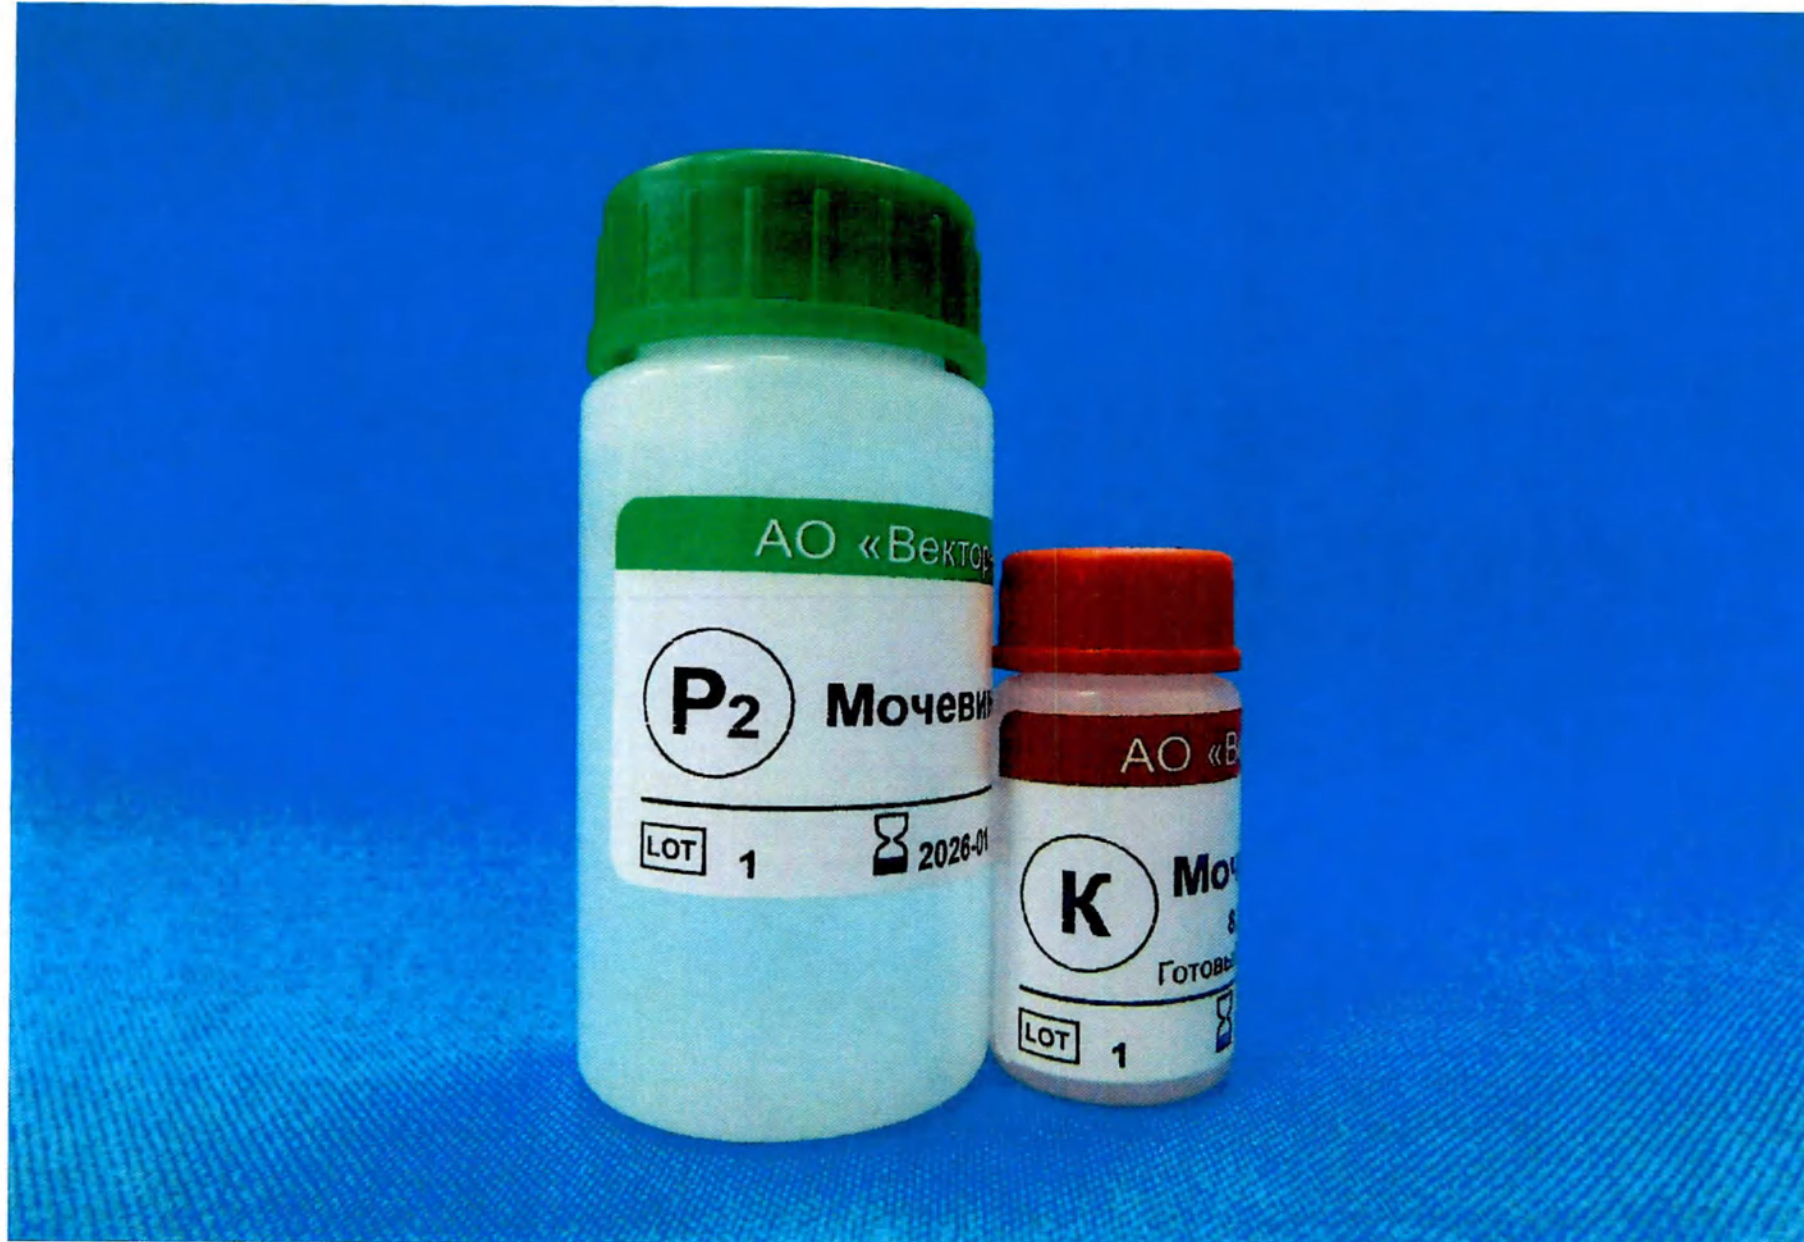

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №3

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 1, Серия 1




Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №4

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»


Вариант комплектации 1, Серия 1

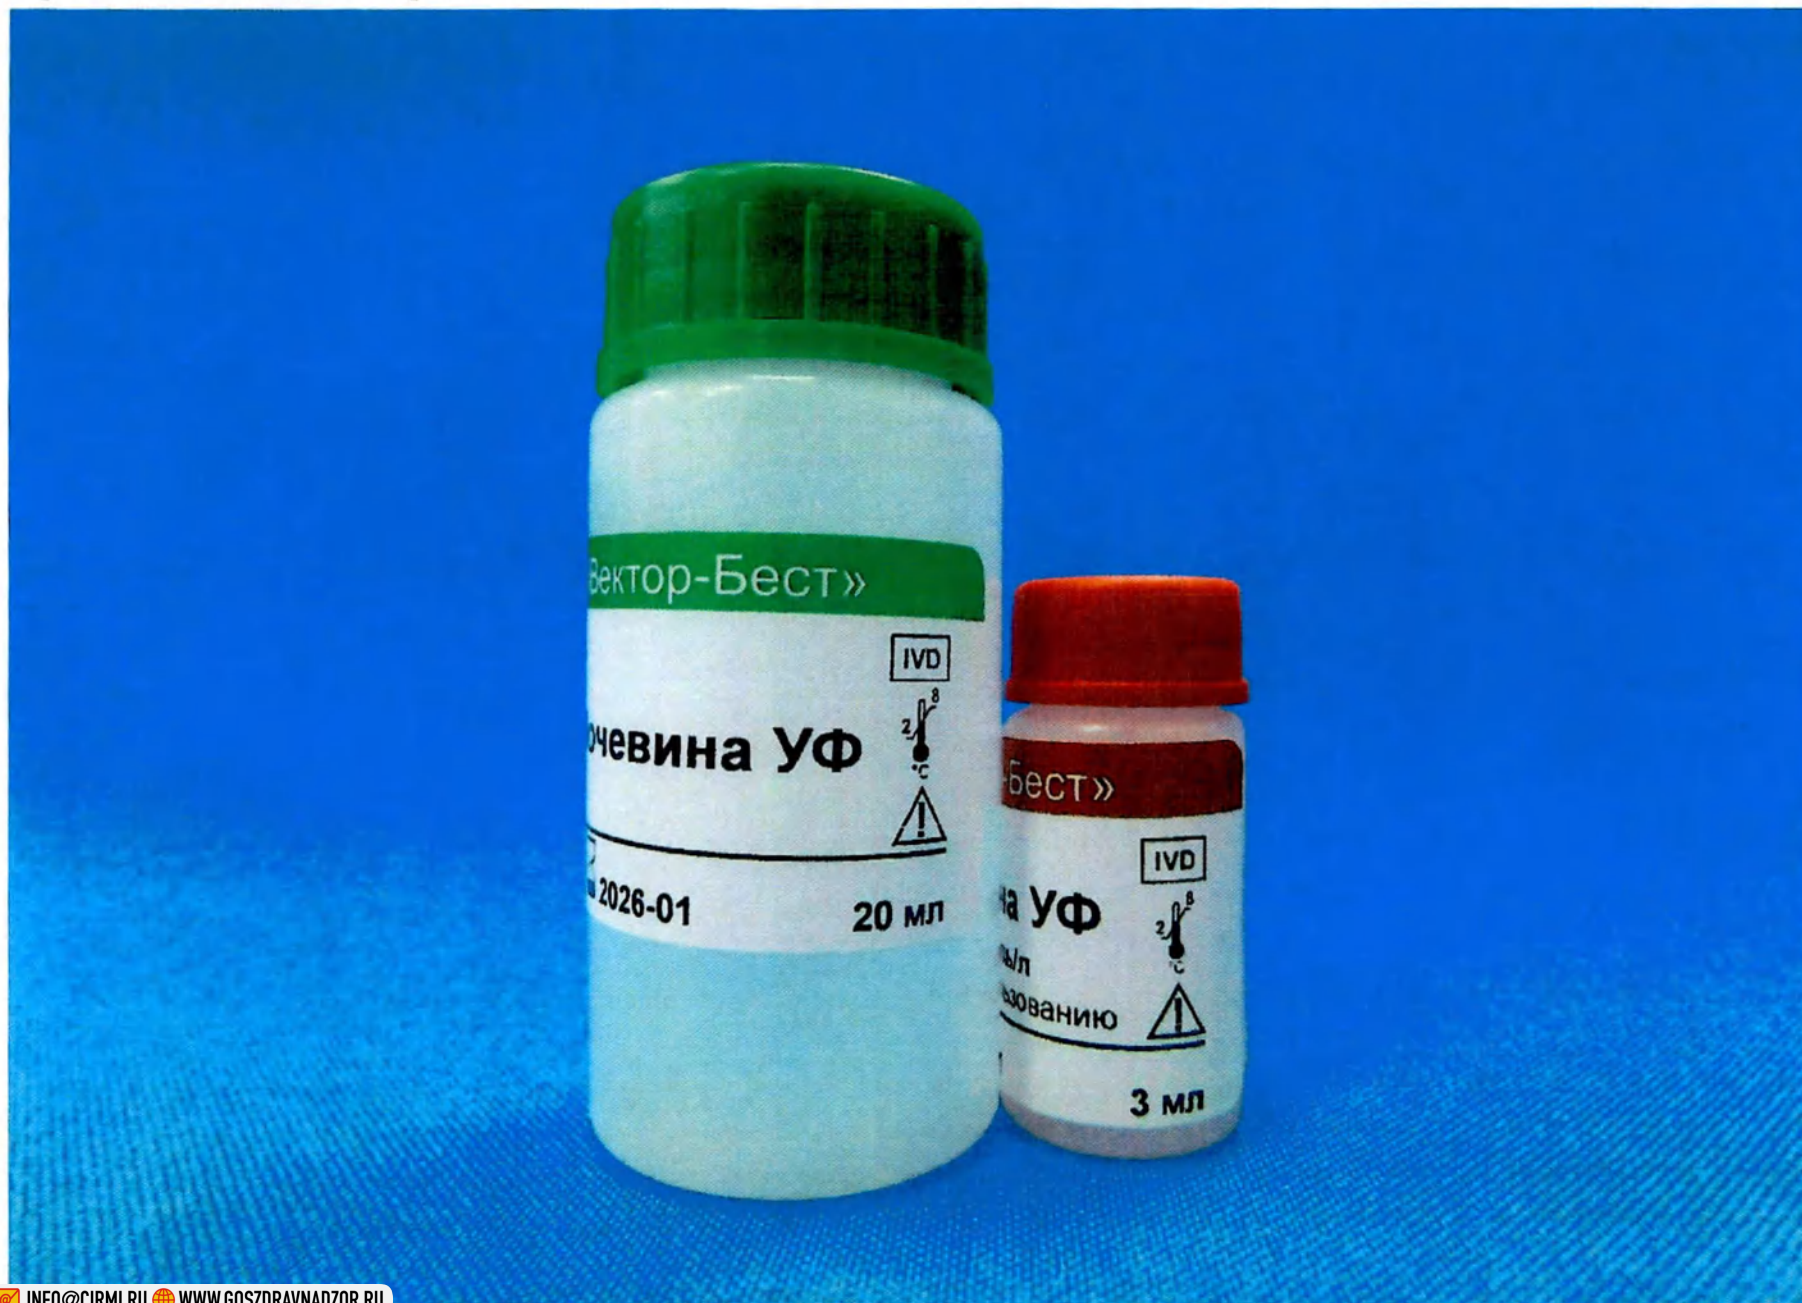

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»


Вариант комплектации 1, Серия 1

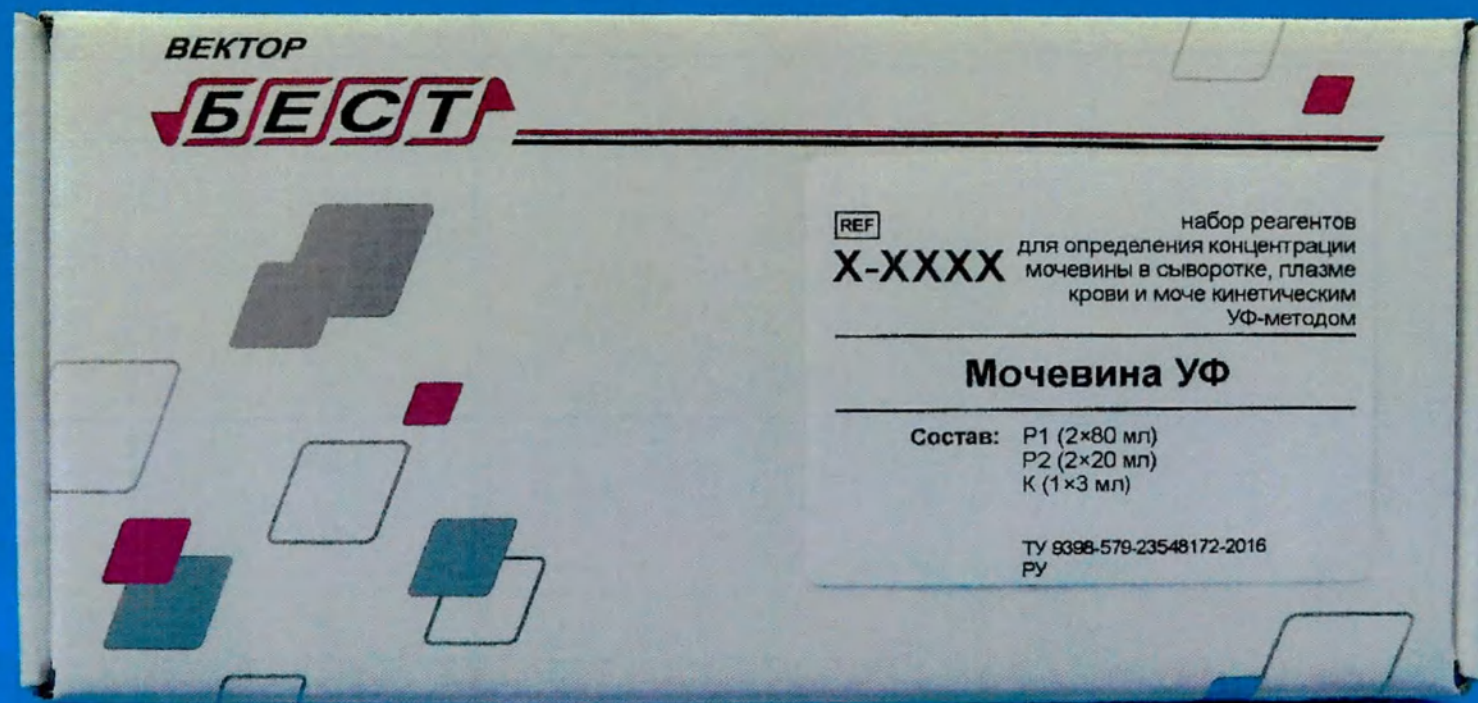

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 1, Серия 1

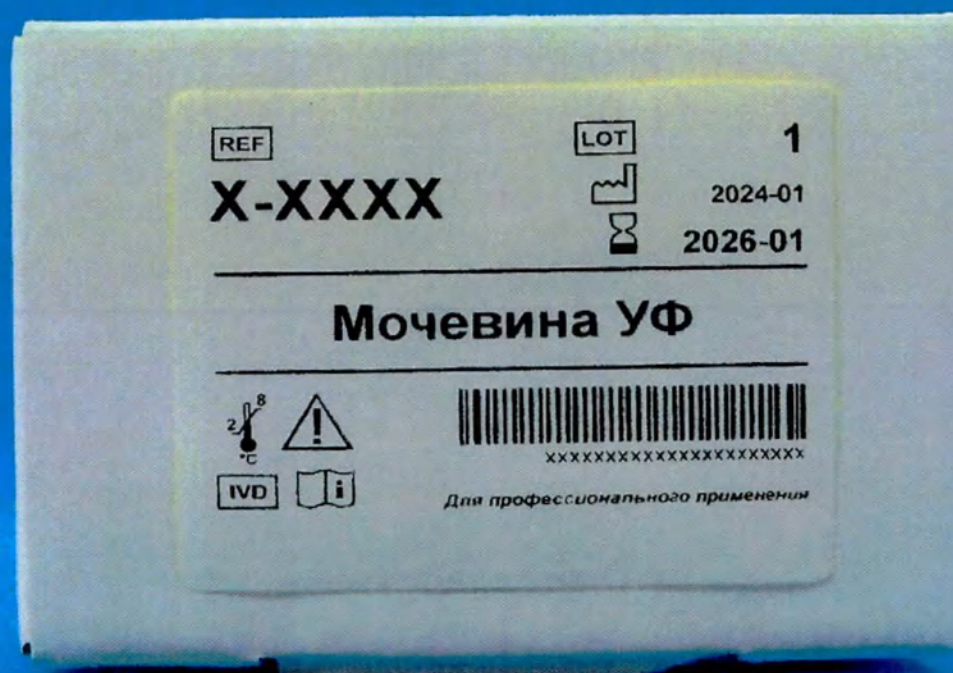

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 1, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

«Вектор-Бест» АҚ


630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 2, Серия 1

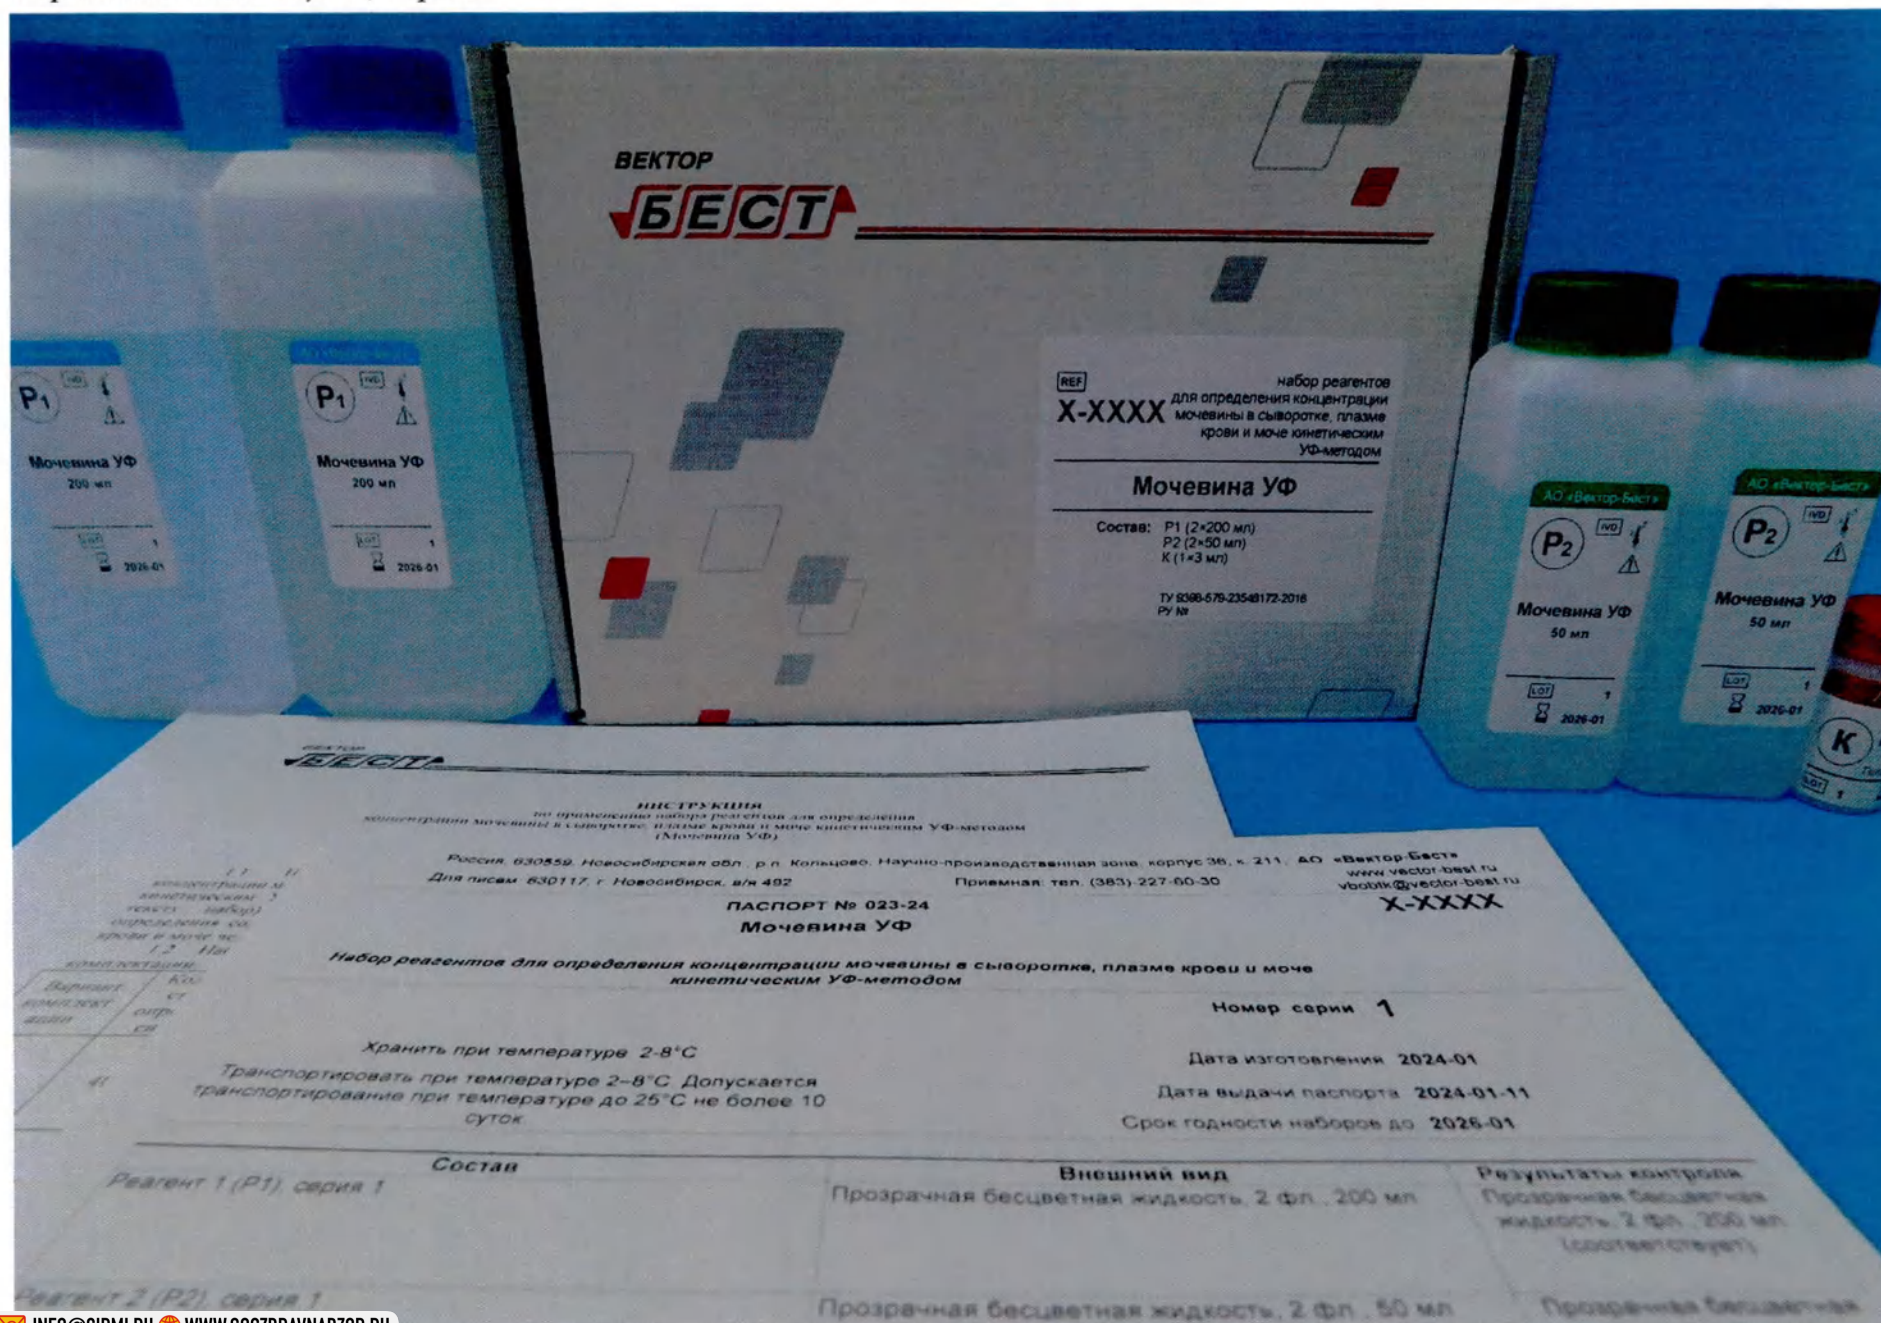

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1
Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №2


Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 2, Серия 1




Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»
Вариант комплектации 2, Серия 1

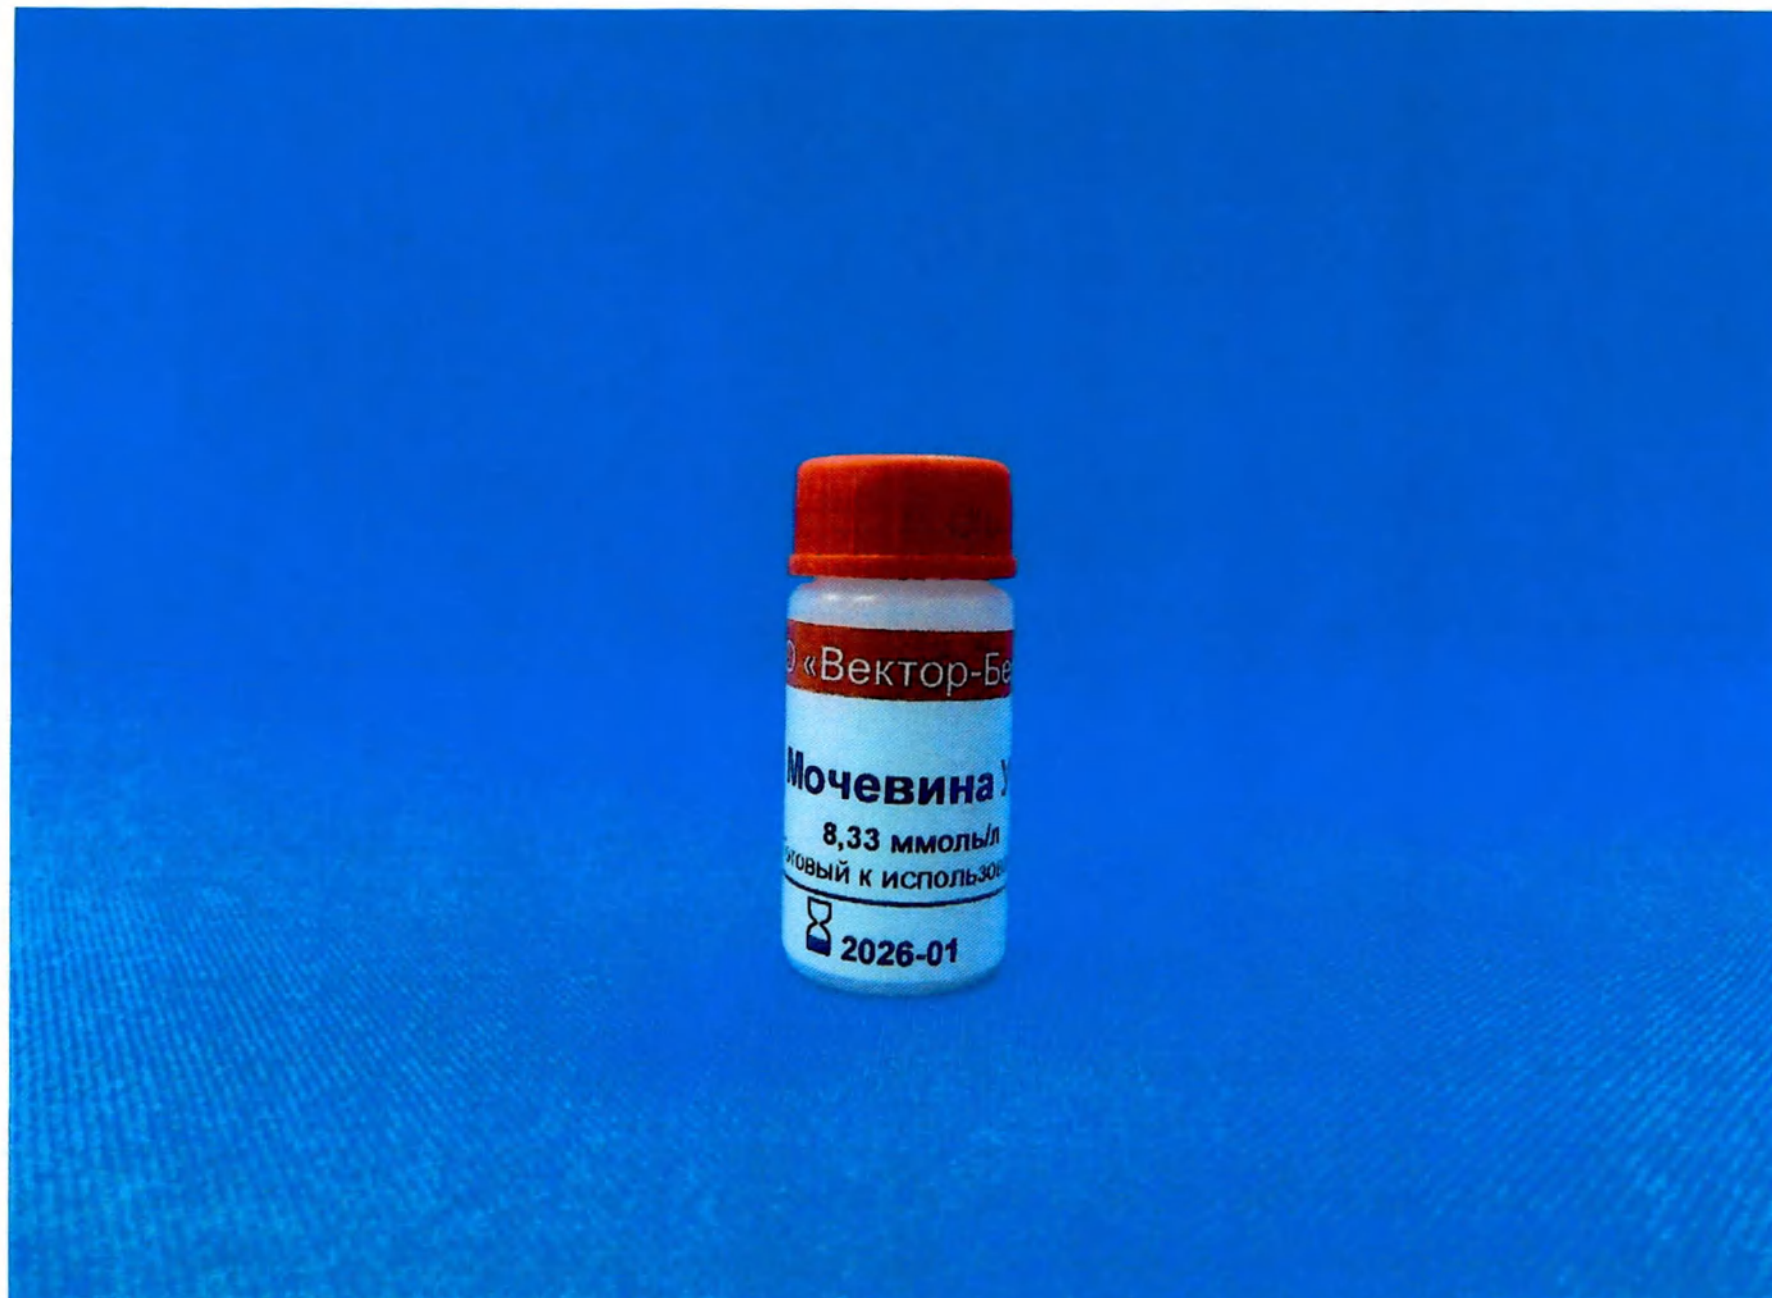

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №4

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»


Вариант комплектации 2, Серия 1

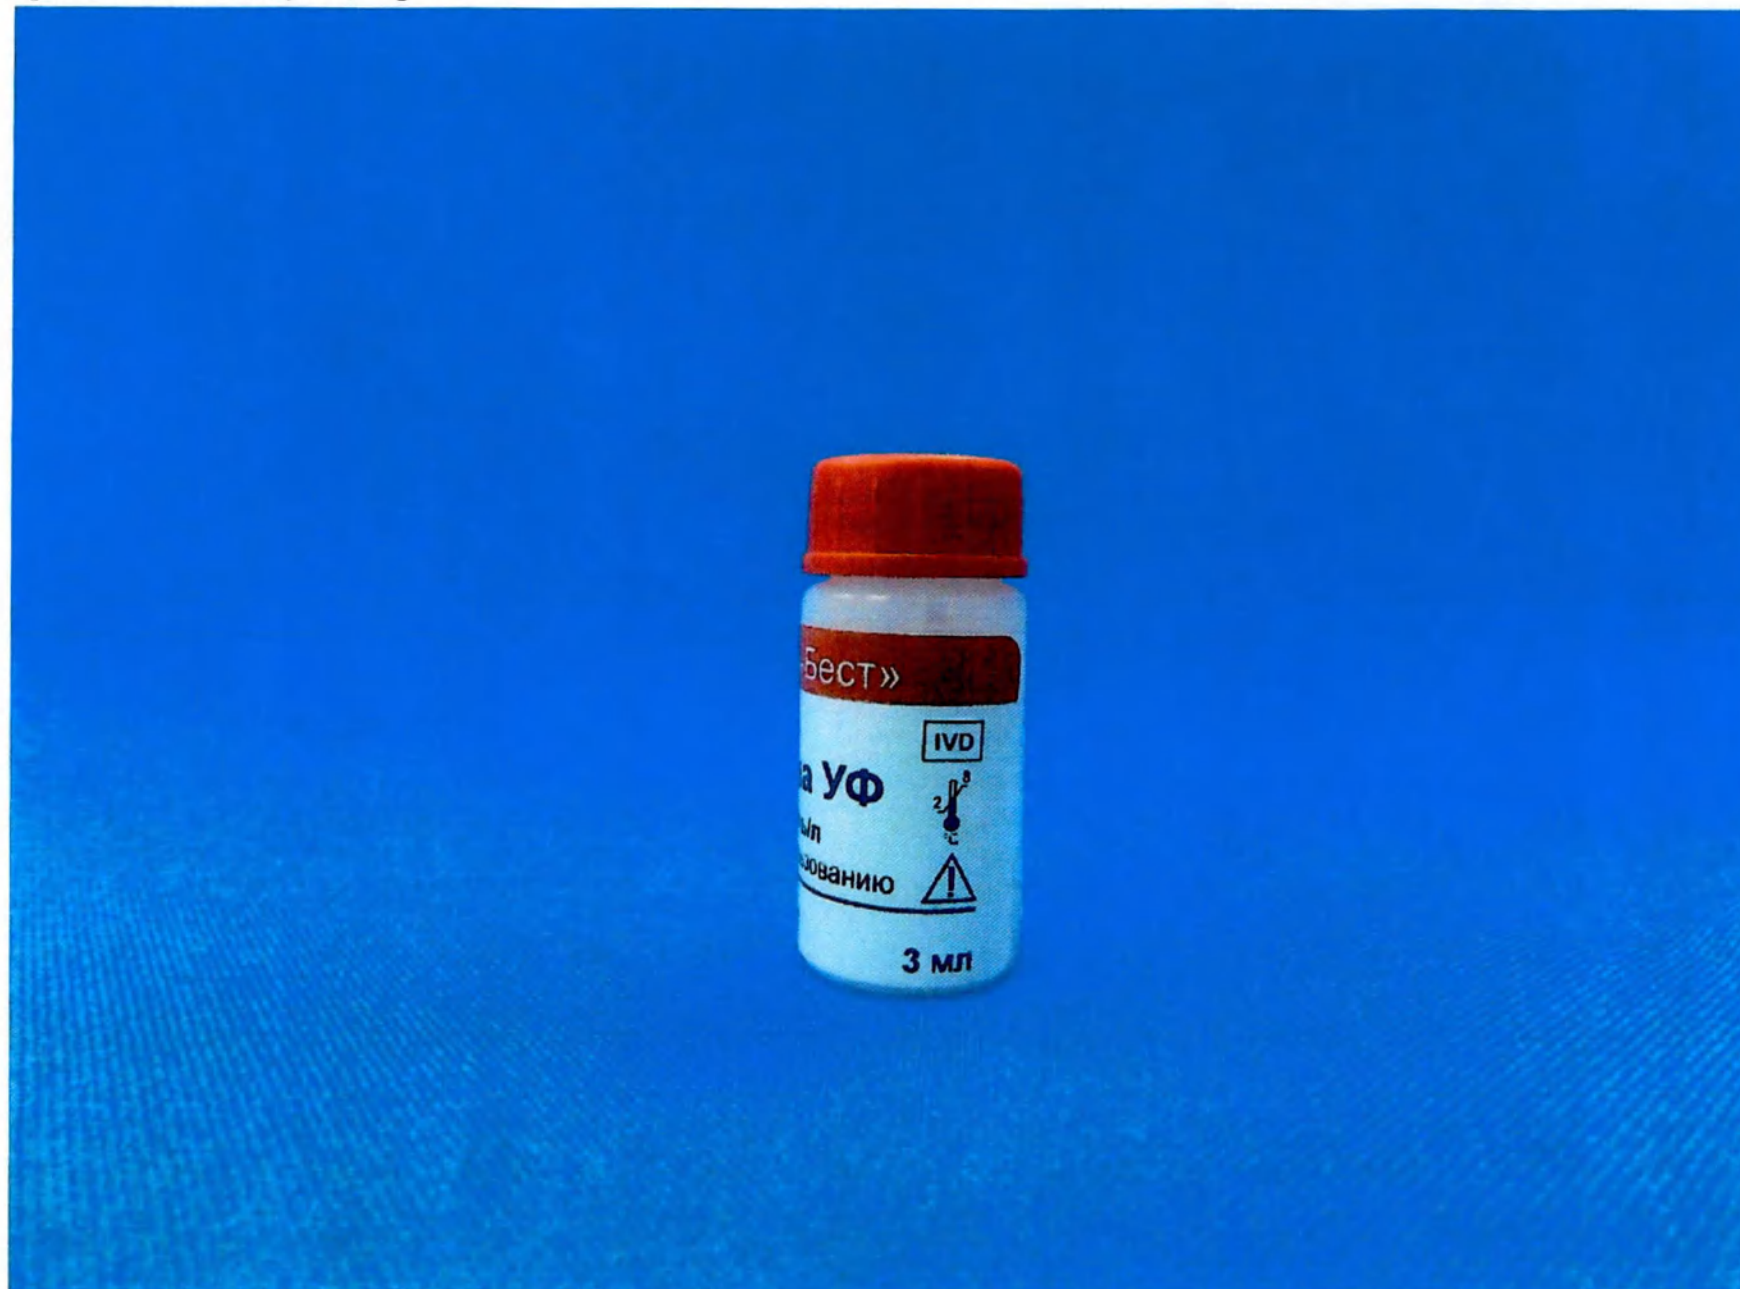

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 2, Серия 1

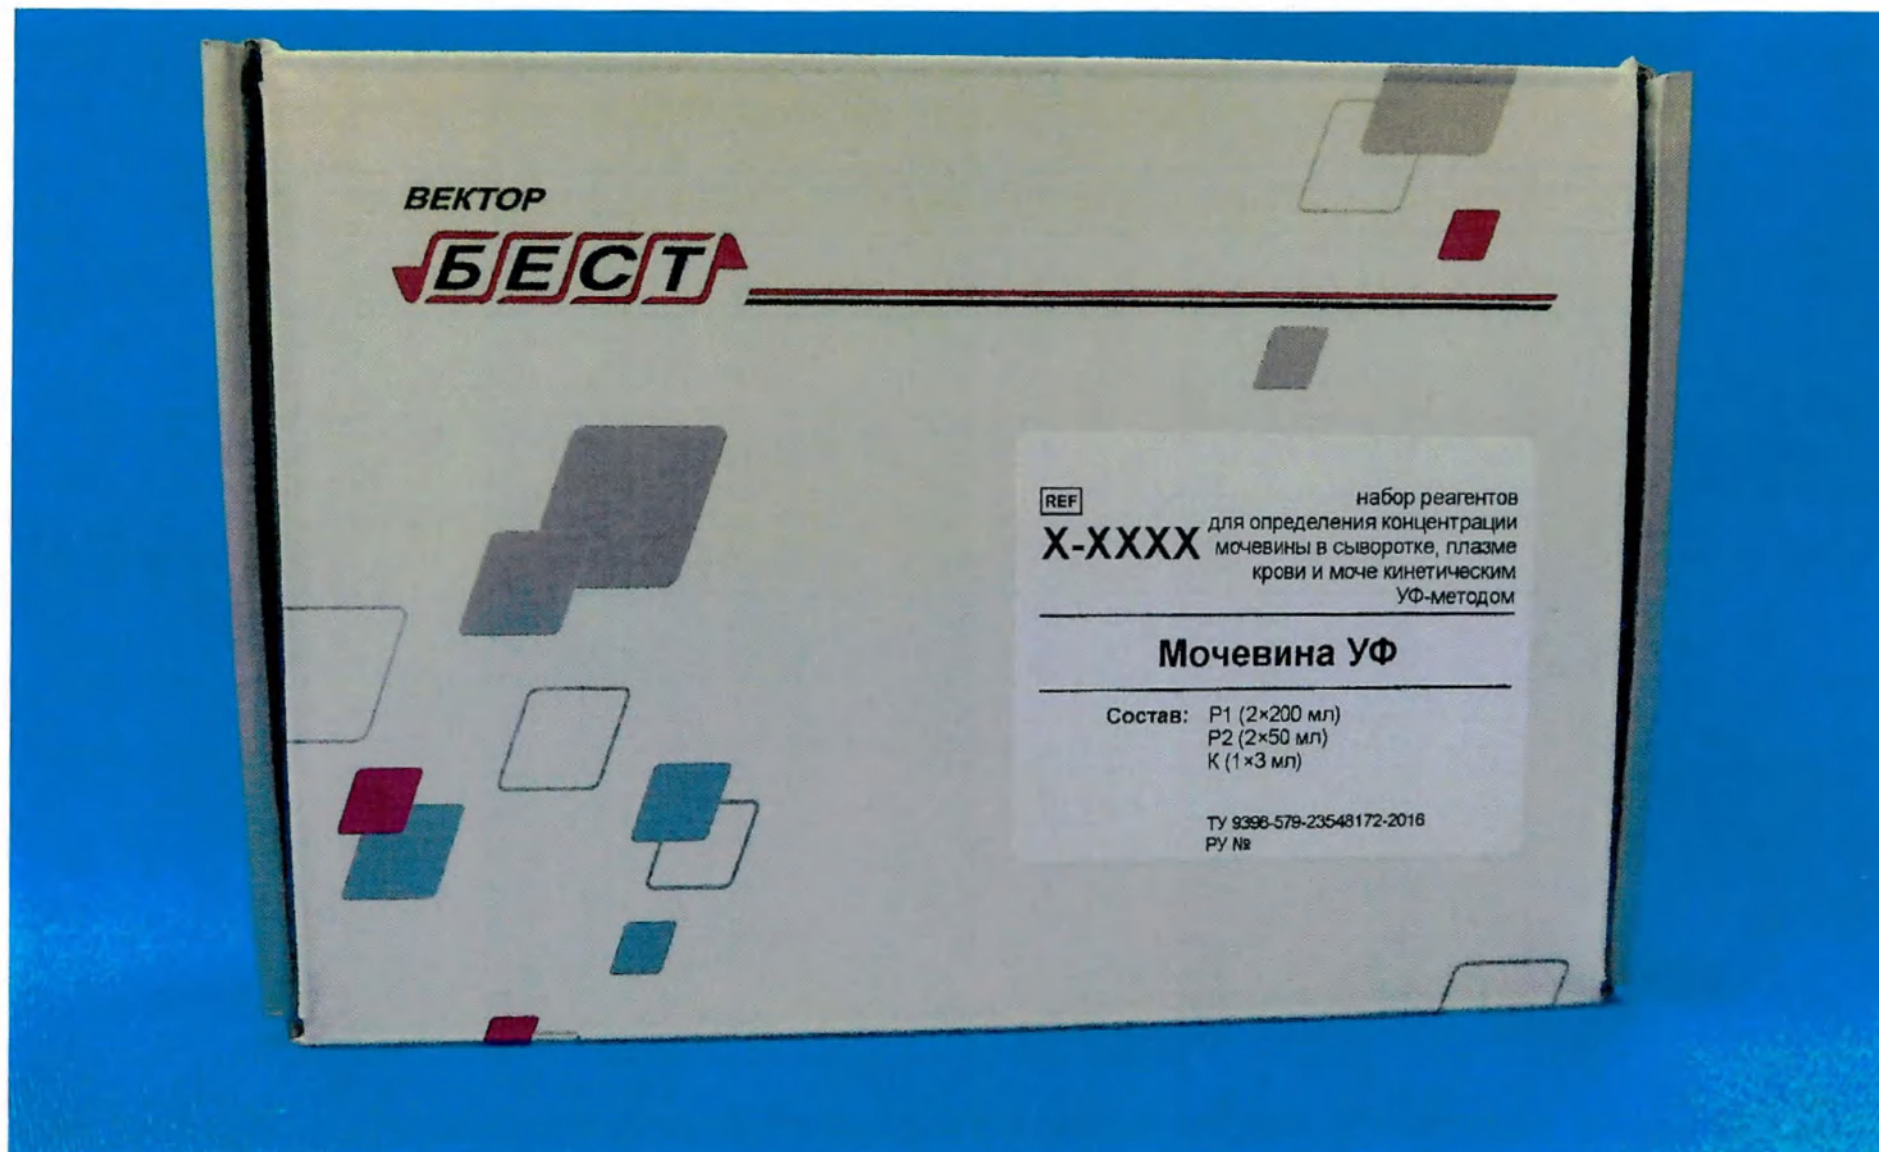

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 2, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 2, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel./fax: (383) 332-67-49, 332-67-52

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел./факс: (383) 332-67-49, 332-67-52

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 3, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 3, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №2

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 3, Серия 1




Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 3, Серия 1

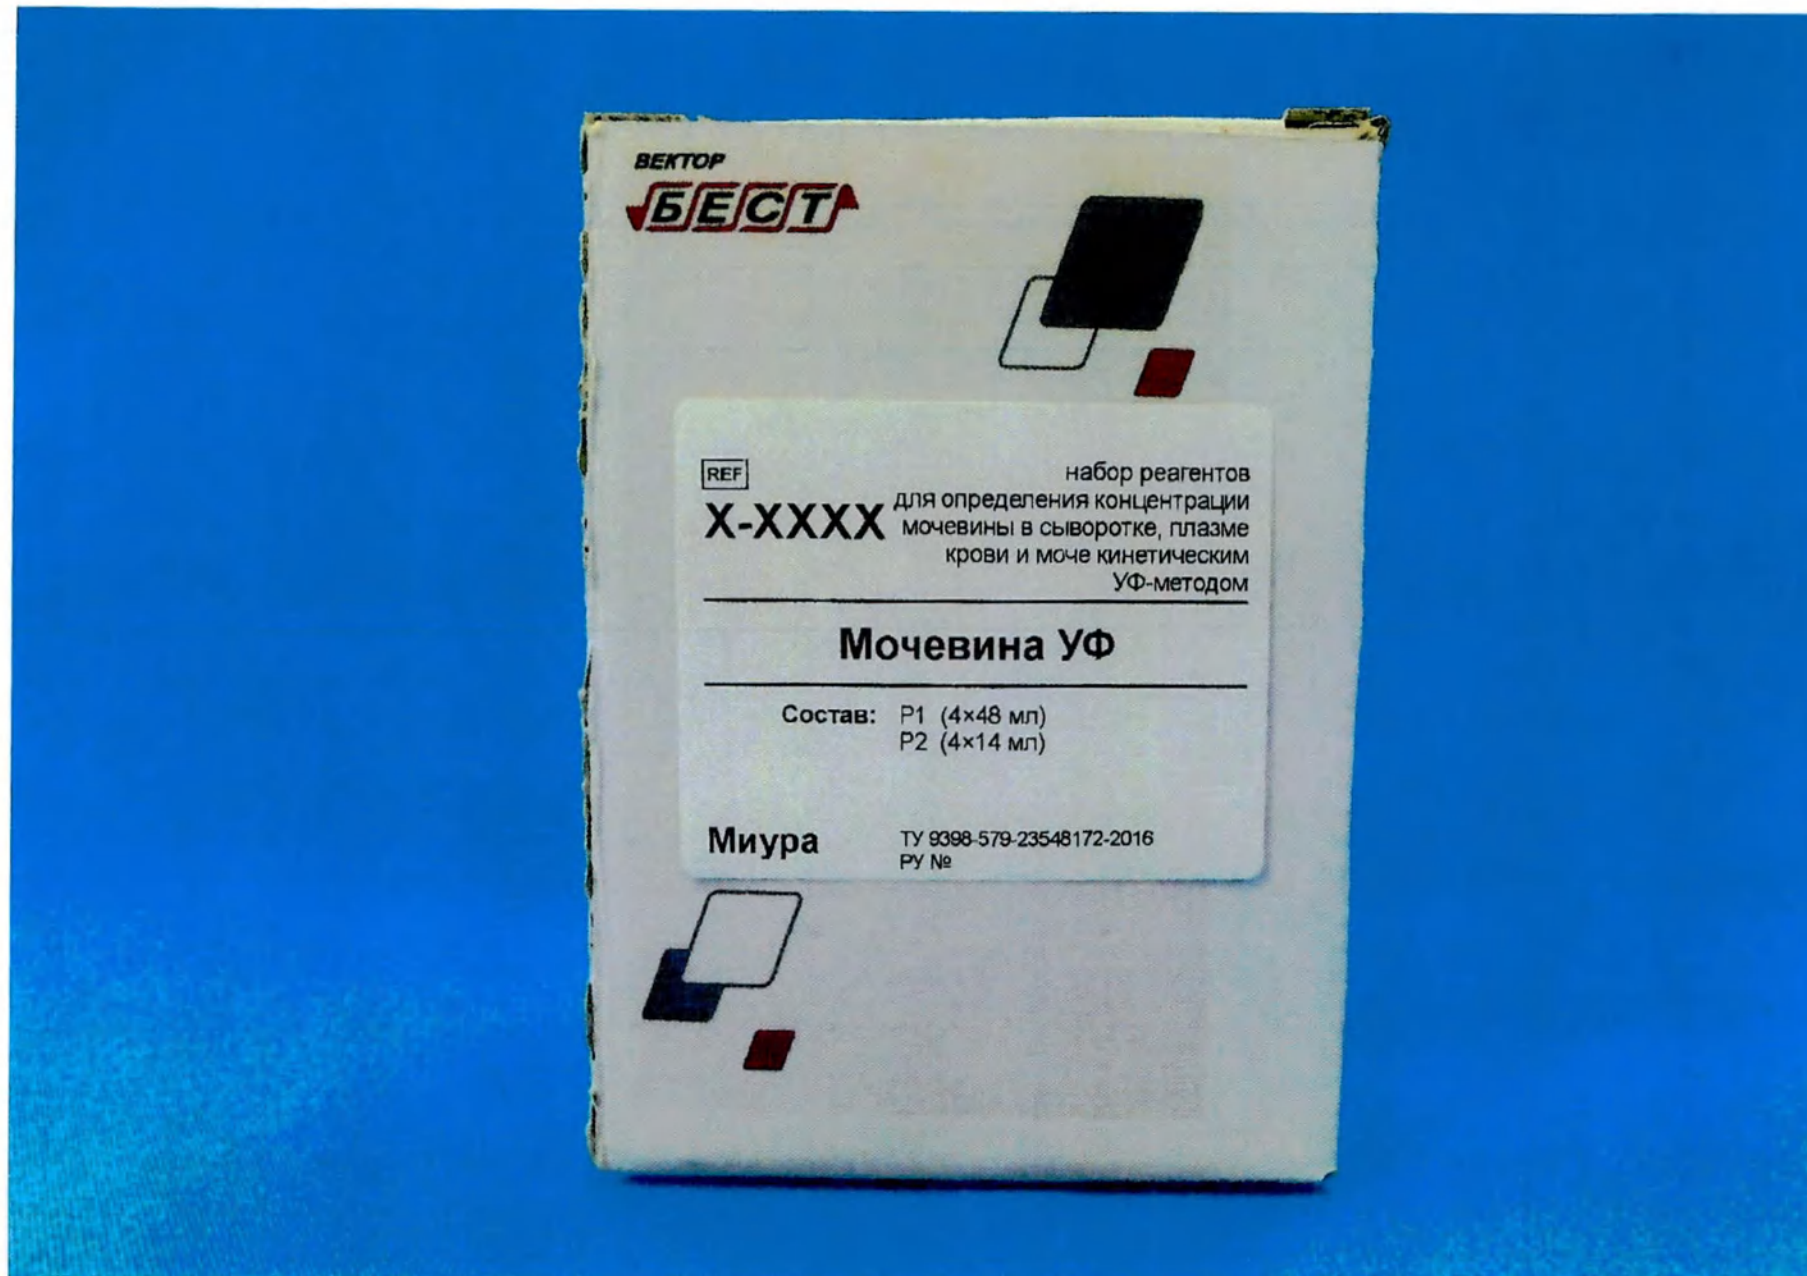

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 3, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 3, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559.Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 4, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 4, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №2

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»


Вариант комплектации 4, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 4, Серия 1

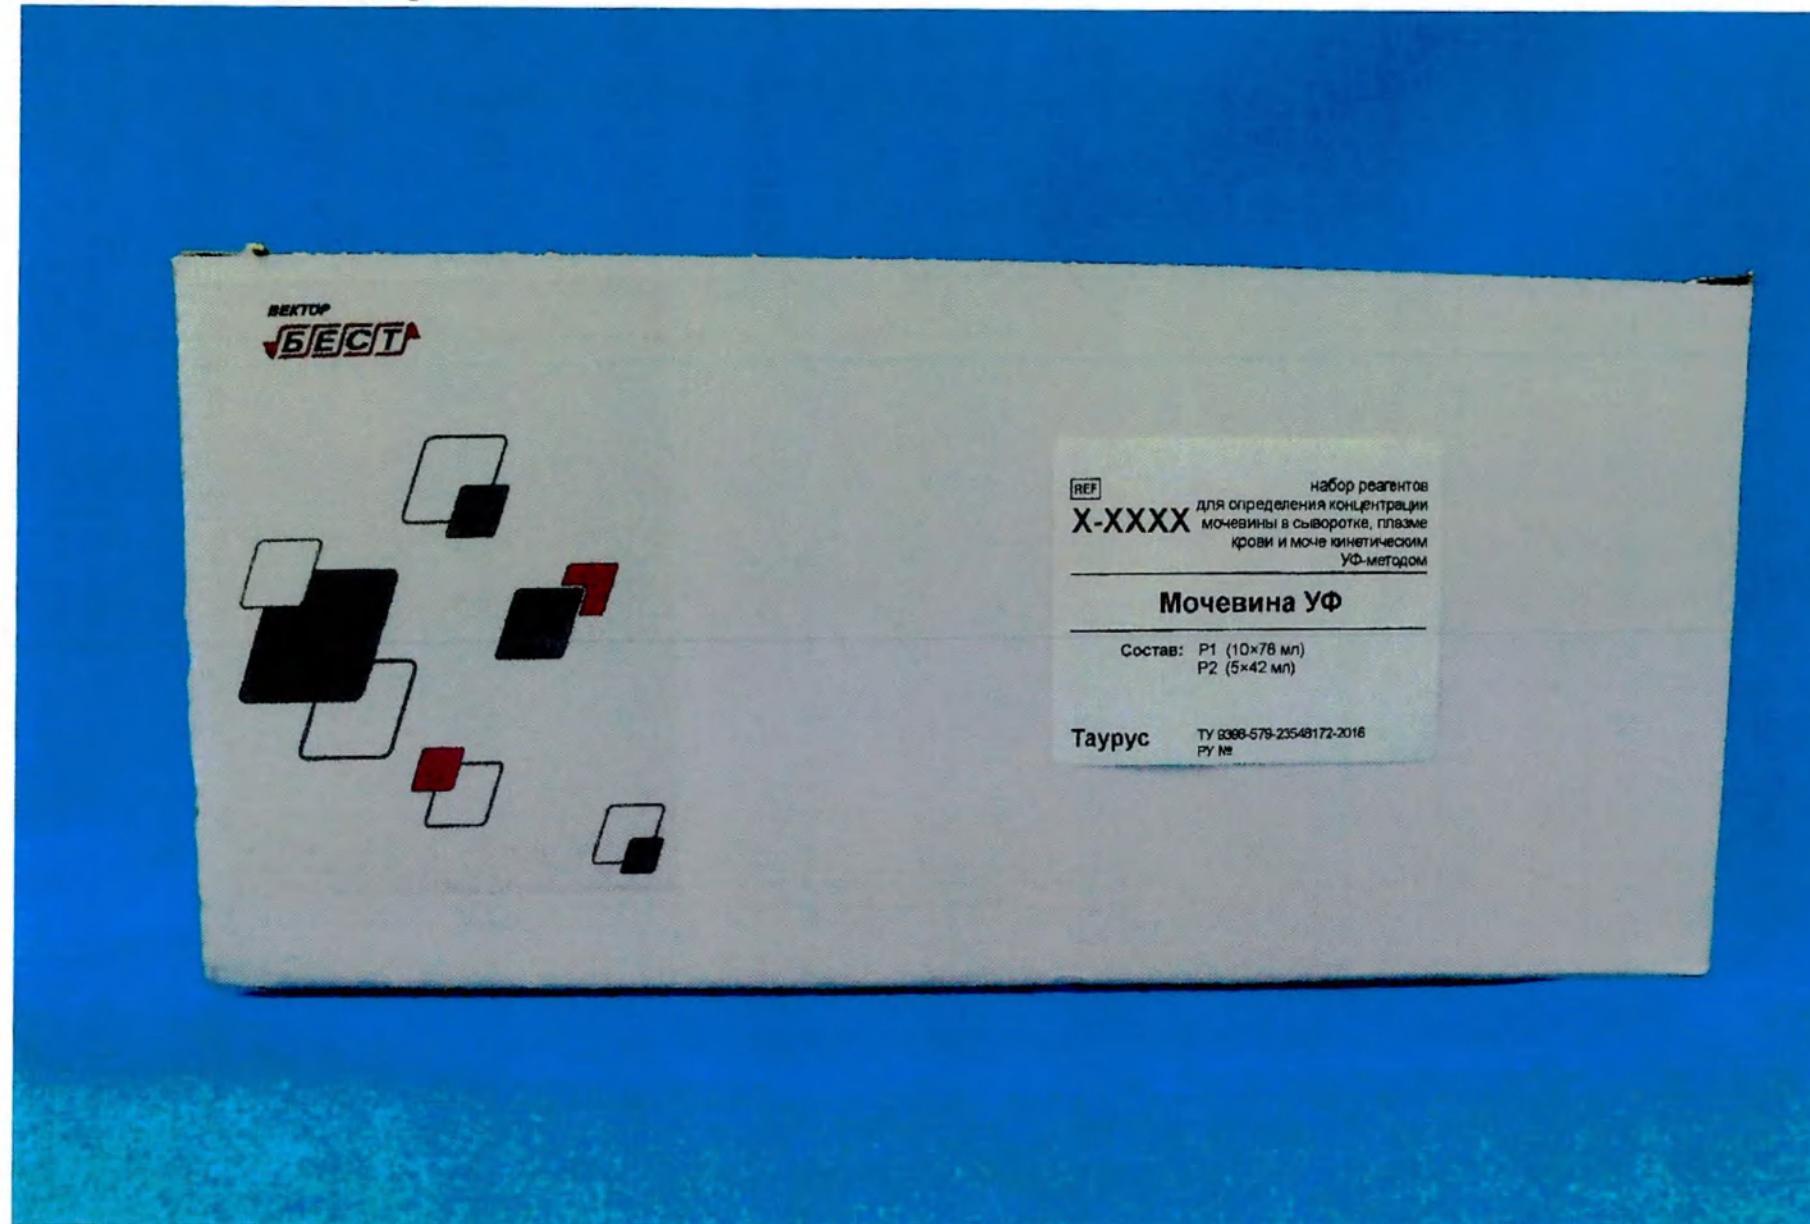

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 4, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 4, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559.Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 5, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1
Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»
Вариант комплектации 5, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №2

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»


Вариант комплектации 5, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 5, Серия 1

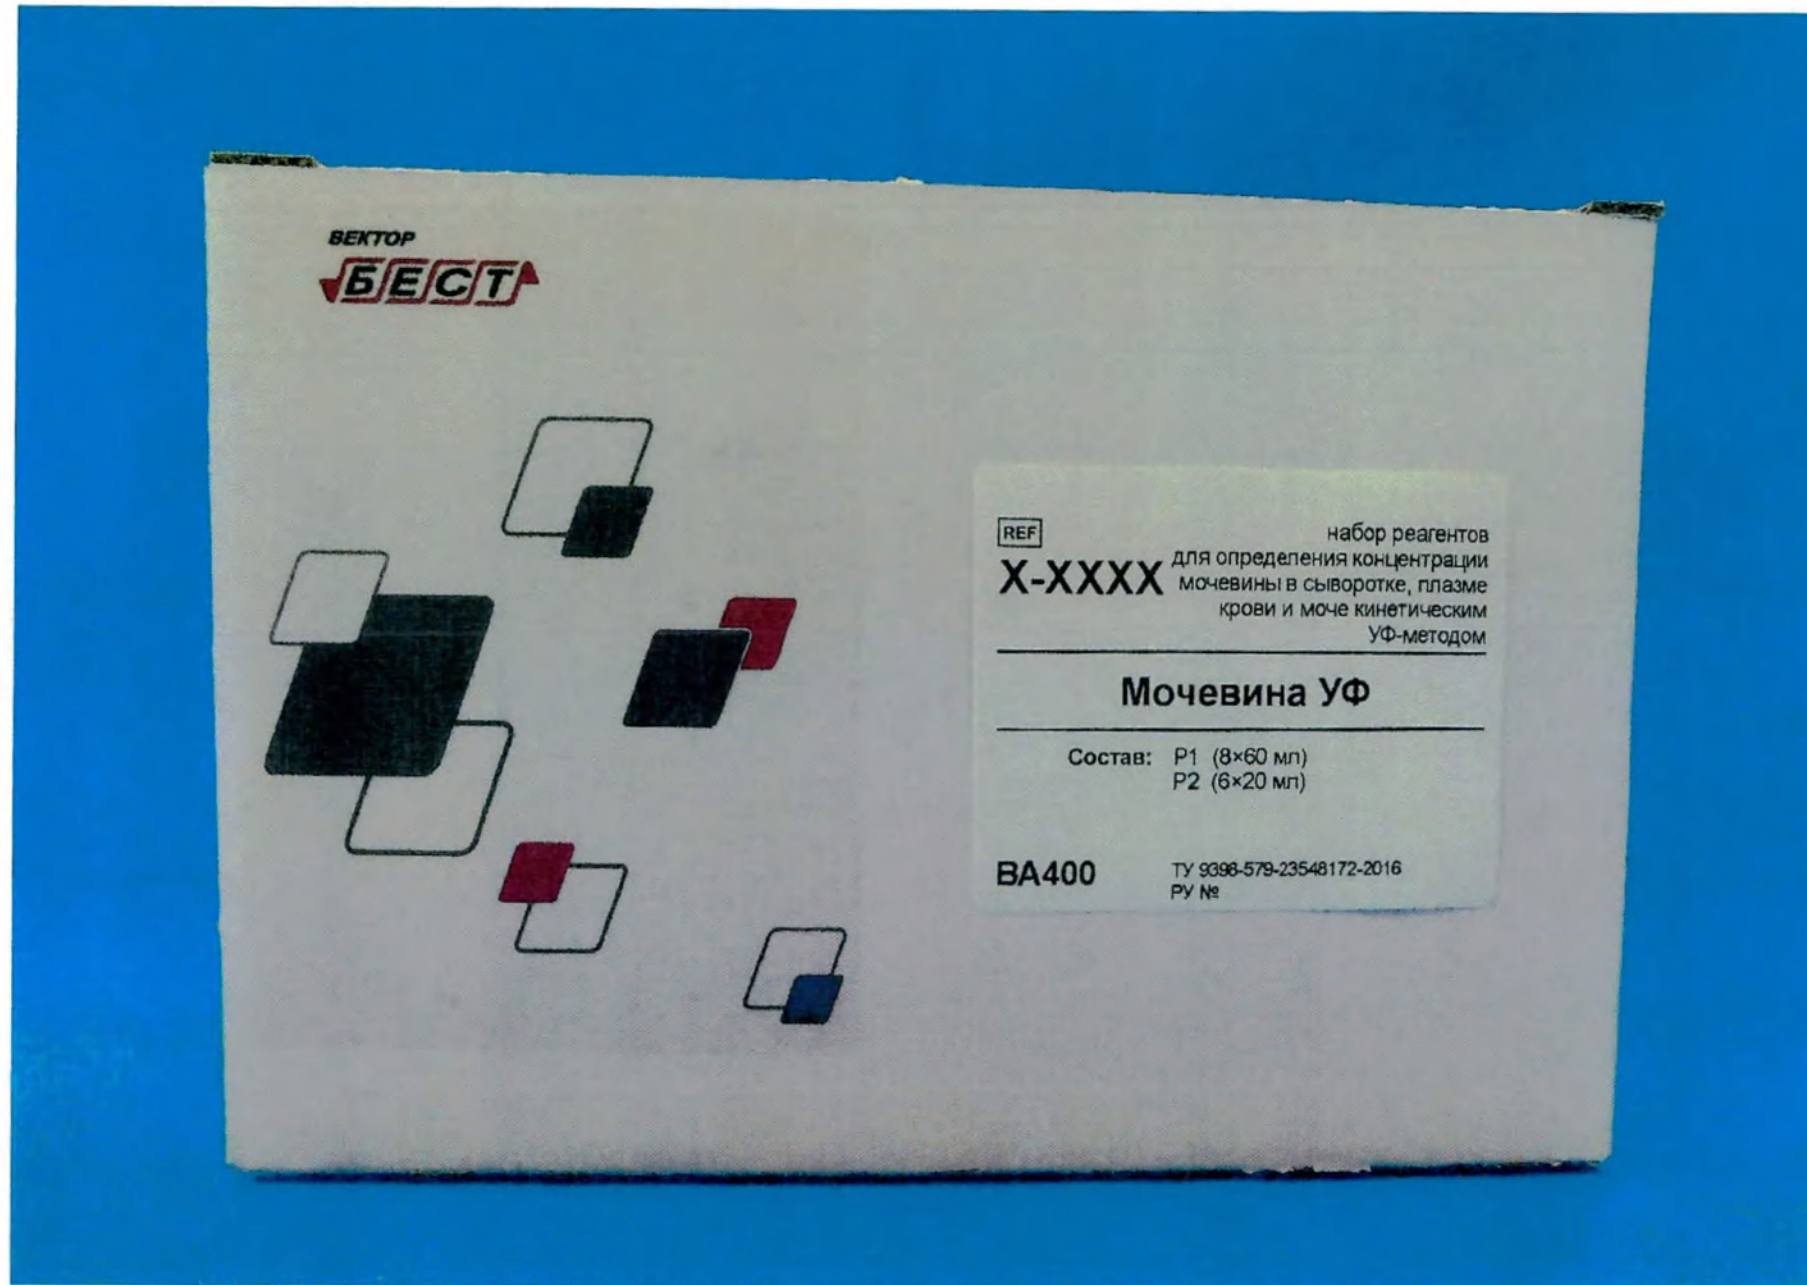

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 5, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 5, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559 Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 6, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №1

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 6, Серия 1



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия №2

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»


Вариант комплектации 6, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №1

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 6, Серия 1

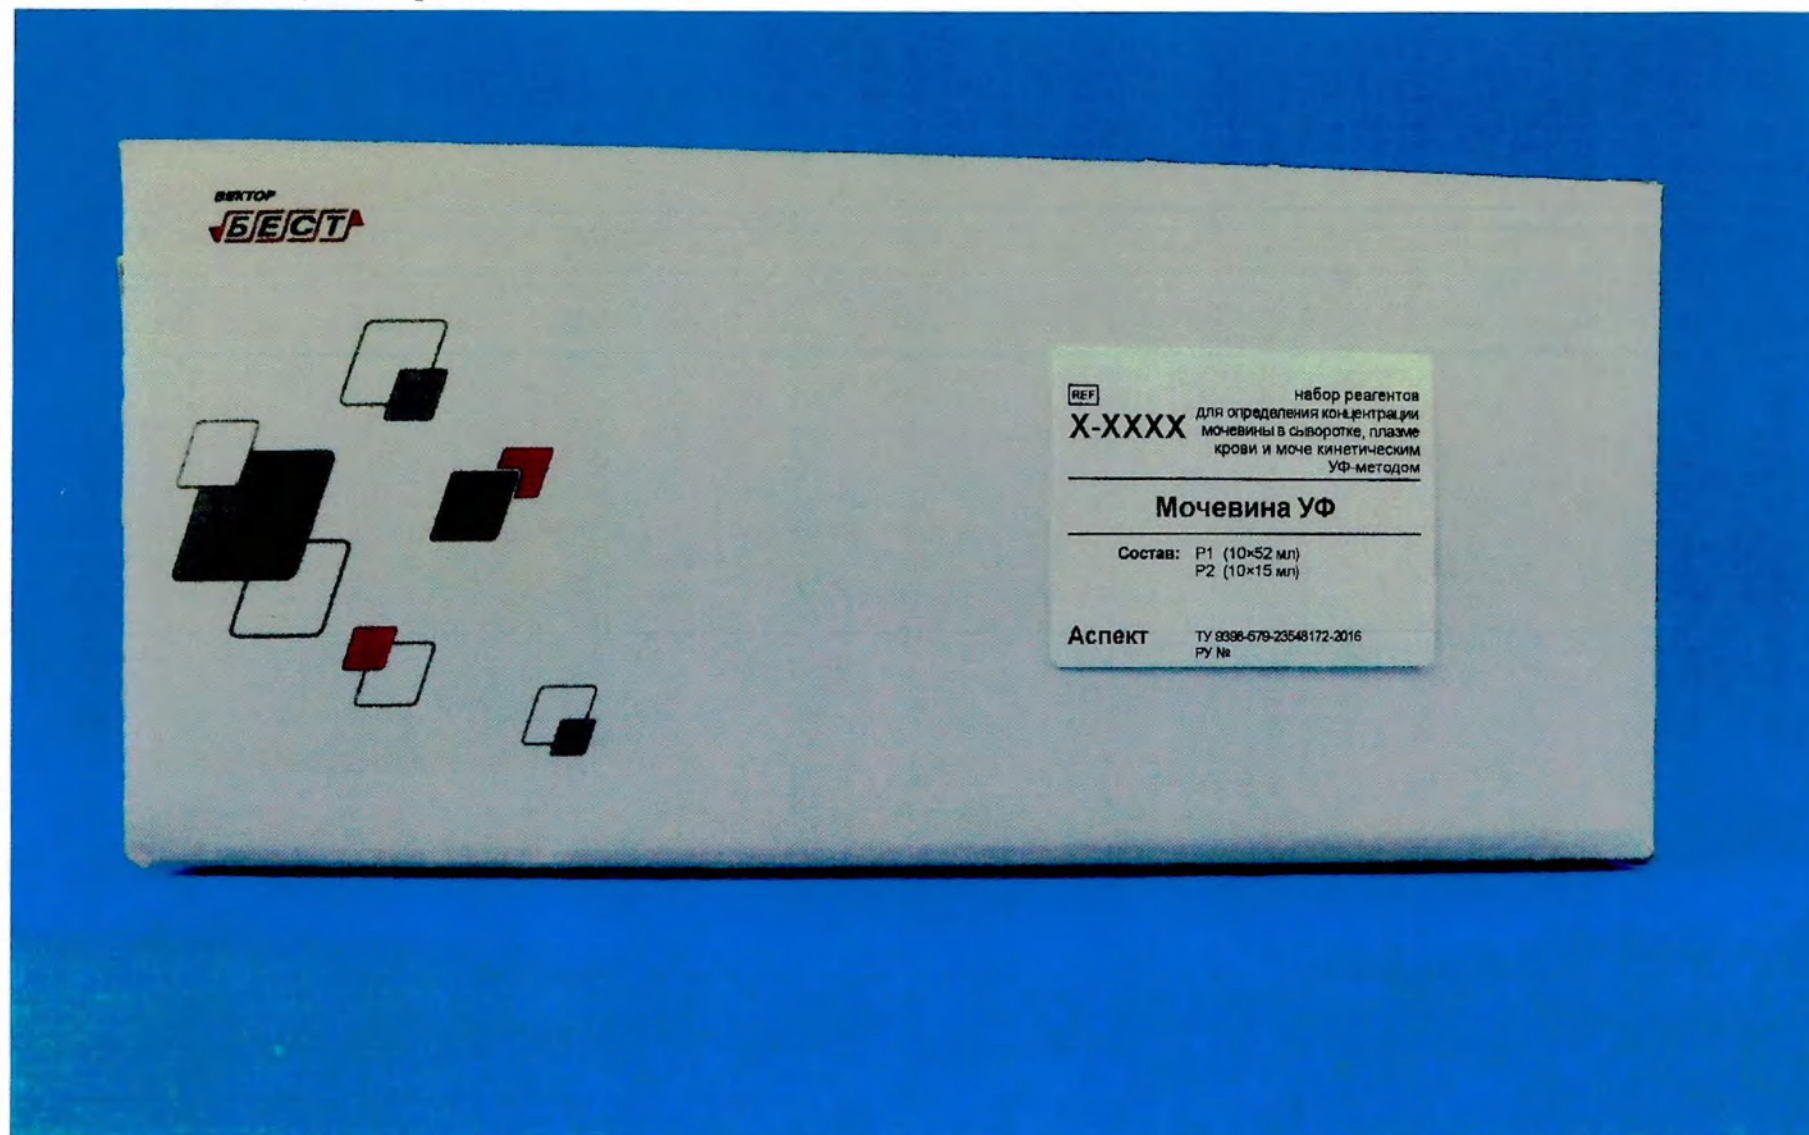

Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №2

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом
«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 6, Серия 1



Фотографическое изображение упаковки медицинского изделия №3

Набор реагентов для определения концентрации мочевины в сыворотке, плазме крови и моче кинетическим УФ-методом

«Мочевина УФ»

Вариант комплектации 6, Серия 1



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best


Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559 Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 41 листов.
Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

" 15 "  Масяго А.В.
2024 г.

