

142530, Московская область, г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1
e-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, сайт: www.ekolab.ru
тел: 8-800-333-33-47
АО «ЭКОлаб»
ИНН: 5035025076, КПП: 503501001
р/с 40702810040310124002
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225




"УТВЕРЖДАЮ"
Генеральный директор
АО "ЭКОлаб"
Т.Ю. Гашенко
"06" мая 2024 г.



ОБРАЗЦЫ МАРКИРОВКИ

**Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления
антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2
методом иммунного блоттинга
с использованием рекомбинантных антигенов
«ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2» по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022»**



АО "ЭКОлаб"

Для учреждений здравоохранения

Набор реагентов

Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов

"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2"

по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022

Комплект №1

Состав набора

Иммуносорбент	24 стрипа
K-, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
K+, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
ОР(x25)	1 фл. (30 мл)
PPO	1 фл. (30 мл)
РРК	1 фл. (40 мл)
Конъюгат	1 фл. (2,5 мл)
СР	1 фл. (40 мл)
Пинцет пластиковый	1 шт.
Принадлежности:	
Планшеты пластмассовые с	
6 или 8 канавками	3 или 4 шт.
Клейкая пленка для планшетов	3 или 4 шт.



HBsAg, антитела ВГС отсутствуют

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гашенко

2024 г.



Для профессионального применения

Набор реагентов

Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов

"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2" по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022

ТУ 21.20.23-040-70423725-2022


РУ №

Количество: _____ шт.

Комплект № 1

REF 01.19 LOT 01

Контрольный № 24



2022.05.26

2023.11.26



Для профессионального применения

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

ТУ 21.20.23-040-70423725-2022

РУ №

Комплект № 1

LOT 01


REF 01.19

Контрольный № 24

2022.05.26

2023.11.26

АО "ЭКОлаб"



ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

PPO

LOT 01

REF 01.19

2023.11

40 мл

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

СР

LOT 01

REF 01.19

2023.11

40 мл

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



АО "ЭКОлаб"


Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов"Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам
вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного
блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов"**"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2"**

по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022"

Комплект №2

Состав набора

Иммунсорбент	36 стрипов
K-, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
K+, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
OP(x25)	1 фл. (30 мл)
PPO	1 фл. (40 мл)
PPK	2 фл. (по 30 мл)
Конъюгат	1 фл. (2,5 мл)
CP	1 фл. (40 мл)
Пинцет пластиковый	1 шт.
Принадлежности:	
Планшеты пластмассовые с 6 или 8 канавками	5 или 6 шт.
Клейкая пленка для планшетов	5 или 6 шт.



HBsAg, антитела ВГС отсутствуют

Для профессионального
примененияЮридический адрес: 142530, Московская обл., г.о.
Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1.
Место производства: 142530, Московская обл., г.о.
Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1а.

Набор реагентов

"Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам
вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного
блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов"**"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2"** по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022"

ТУ 21.20.23-040-70423725-2022


РУ №

Количество: _____ шт.

Комплект № 2

REF 01.19.1 LOT 02

Контрольный № 25



Для профессионального применения

АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

ТУ 21.20.23-040-70423725-2022



РУ №

Комплект № 2

LOT 02

REF 01.19.1

Контрольный № 25










УТВЕРЖДАЮ


Генеральный директор АО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

2024 г.

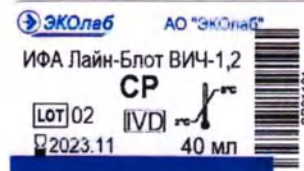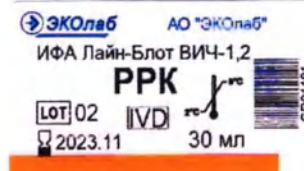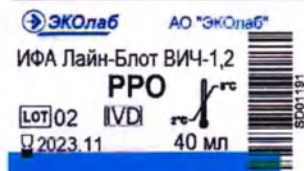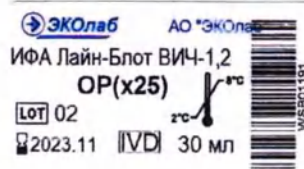

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



АО "ЭКОлаб"

Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов

"Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам
вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного
блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов

"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2"

по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022"

Комплект №3


Состав набора

Иммуносорбент
К-, инактивированный
К+, инактивированный
ОР(x25)
PPO
PPK
Конъюгат
СР
Пинцет пластиковый
Принадлежности:
Планшеты пластмассовые с
6 или 8 канавками
Клейкая пленка для планшетов

48 стрипов
1 фл. (0,2 мл)
1 фл. (0,2 мл)
2 фл. (по 30 мл)
2 фл. (по 30 мл)
2 фл. (по 40 мл)
2 фл. (по 2,5 мл)
2 фл. (по 40 мл)
1 шт.



HBsAg, антитела ВГС отсутствуют



Для профессионального применения

Набор реагентов

"Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам
вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного
блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов

"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2" по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022"

ТУ 21.20.23-040-70423725-2022


РУ №

Количество: _____ шт.

Комплект № 3

REF 01.19.3 LOT 03

Контрольный № 26



Для профессионального применения

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

ТУ 21.20.23-040-70423725-2022


РУ №

Комплект № 3

LOT 03

REF 01.19.3

Контрольный № 26




АО "ЭКОлаб"



ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2


Иммуносорбент

LOT 03 24 стрипа
2023.11 IVD

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

Иммуносорбент

LOT 03 24 стрипа
2023.11 IVD

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2


ОР(x25)

LOT 03 30 мл
2023.11 IVD

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2


PPO

LOT 03 30 мл
2023.11 IVD

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2


PPK

LOT 03 40 мл
2023.11 IVD

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

СР

LOT 03 40 мл
2023.11 IVD

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

« 06 » _____ 2024 г.

Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2"

по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022"

Комплект №1

Состав набора

Иммуносорбент	24 стрипа
К-, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
ОР(x25)	1 фл. (30 мл)
РРО	1 фл. (30 мл)
РРК	1 фл. (40 мл)
Конъюгат	1 фл. (2,5 мл)
СР	1 фл. (40 мл)
Пинцет пластиковый	1 шт.
Принадлежности:	
Планшеты пластмассовые с	
6 или 8 канавками	3 или 4 шт.
Клейкая пленка для планшеты	3 или 4 шт.



НВсAg, антитела ВГС отсутствуют

"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2"

ТУ 21.20.23-040-70423725-2022


РУ №

Количество: _____ шт.

Комплект № 1

REF 01.19 LOT 04

Контрольный № 27



ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

ТУ 21.20.23-040-70423725-2022



РУ №

Комплект № 1

LOT 04

REF 01.19

Контрольный № 27









УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

2024 г.



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



АО "ЭКОлаб"


Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов"Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам
вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного
блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов"**"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2"**

по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022"

Комплект №2

Состав набора

Иммуносорбент	36 стрипов
К-, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
ОР(x25)	1 фл. (30 мл)
РРО	1 фл. (40 мл)
РРК	2 фл. (по 30 мл)
Конъюгат	1 фл. (2,5 мл)
СР	1 фл. (40 мл)
Пинцет пластиковый	1 шт.
Принадлежности:	
Планшеты пластмассовые с 6 или 8 канавками	5 или 6 шт.
Клейкая пленка для планшетов	5 или 6 шт.



HBsAg, антитела ВГС отсутствуют

Для профессионального
применения

Набор реагентов

"Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам
вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного
блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов"**"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2"**

ТУ 21.20.23-040-70423725-2022



РУ №

Количество: _____ шт.

Комплект № 2

REF 01.19.1 LOT 05

Контрольный № 28



Для профессионального применения

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

ТУ 21.20.23-040-70423725-2022


РУ №

Комплект № 2

LOT 05

REF 01.19.1

Контрольный № 28



АО "ЭКОлаб"



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО "ЭКОлаб"

Т.Ю. Гашенко

2024 г.







ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

Иммуносорбент

LOT 05 36 стрипов

2023.11 IVD




ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

ОР(x25)

LOT 05

2023.11 IVD 30 мл




ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

РРО

LOT 05

2023.11 IVD 40 мл




ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

РРК

LOT 05

2023.11 IVD 30 мл




ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

СР

LOT 05

2023.11 IVD 40 мл



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке



АО "ЭКОлаб"


Для учреждений здравоохранения
Набор реагентов"Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам
вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного
блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов**"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2"**

по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022"


Комплект №3

Состав набора

Иммуносорбент	48 стрипов
К-, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
К+, инактивированный	1 фл. (0,2 мл)
ОР(x25)	2 фл. (по 30 мл)
РРО	2 фл. (по 30 мл)
РРК	2 фл. (по 40 мл)
Конъюгат	2 фл. (по 2,5 мл)
СР	2 фл. (по 40 мл)
Пинцет пластиковый	1 шт.
Принадлежности:	
Планшеты пластмассовые с	6 или 8 шт.
6 или 8 канавками	6 или 8 шт.
Клейкая пленка для планшетов	6 или 8 шт.



HBsAg, антитела ВГС отсутствуют

Для профессионального
примененияЮридический адрес: 142530, Московская обл., г.о.
Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1.
Место производства: 142530, Московская обл., г.о.
Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1а.

Набор реагентов

"Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам
вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного
блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов**"ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2"** по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022"


ТУ 21.20.23-040-70423725-2022

РУ №

Количество: _____ шт.

Комплект № 3

REF 01.19.3 LOT 06



Контрольный № 29



Для профессионального применения


ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

ТУ 21.20.23-040-70423725-2022


РУ №

Комплект № 3

LOT 06



REF 01.19.3



Контрольный № 29

АО "ЭКОлаб"



01.19.3



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ЭКОлаб»

Т.Ю. Гащенко

« 06 » _____ 2024 г.

ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

Иммуносорбент

LOT 06 24 стрипа

2023.11 IVD



ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

Иммуносорбент

LOT 06 24 стрипа

2023.11 IVD



ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

ОР(x25)

LOT 06 30 мл

2023.11 IVD



ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

РРО

LOT 06 30 мл

2023.11 IVD



ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

РРК

LOT 06 40 мл

2023.11 IVD






ЭКОлаб АО "ЭКОлаб"

ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2

СР

LOT 06 40 мл

2023.11 IVD



Товарный знак, наименование предприятия-изготовителя, его адрес, телефоны, условия хранения, «только для in vitro диагностики» указаны непосредственно на коробке

Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 06

Ген. директор АО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

07 2024 г.



142530, Московская область, г.о. Павлово-Посадский, г. Электрогорск, ул. Буденного, д.1
e-mail: ekolab-sekretar@mail.ru, сайт: www.ekolab.ru
тел: 8-800-333-33-47
АО «ЭКОлаб»
ИНН: 5035025076, КПП: 503501001
р/с 40702810040310124002
Банк получателя: ПАО «Сбербанк России» г. Москва
БИК 044525225
к/с 30101810400000000225



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
АО «ЭКОлаб»


Г.Ю. Гашенко

"13"05.2024 г.


**Фотографические изображения
Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления
антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2
методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных
антигенов «ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2»
по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022»**

Фотографические изображения общего вида
Набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления антител к
антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного
блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов «ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2»
по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022»


Комплект №1 код партии (серии) 01 от 26.05.2022г

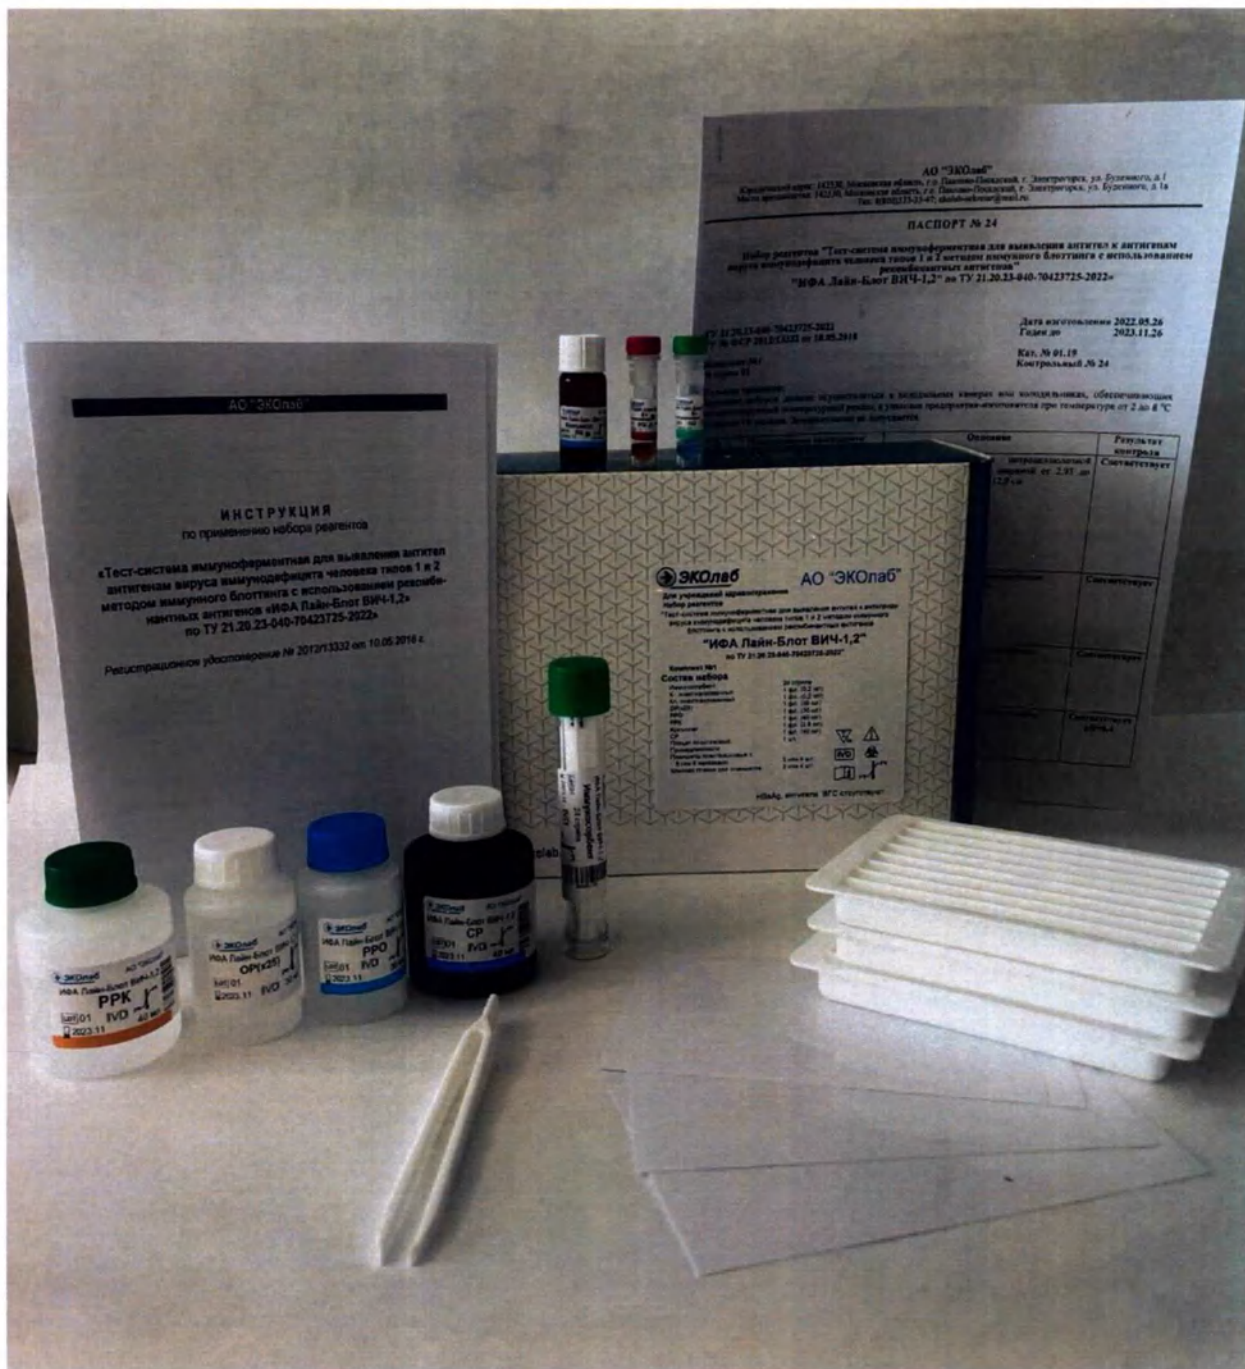


Комплект №2 код партии (серии) 02 от 26.05.2022г

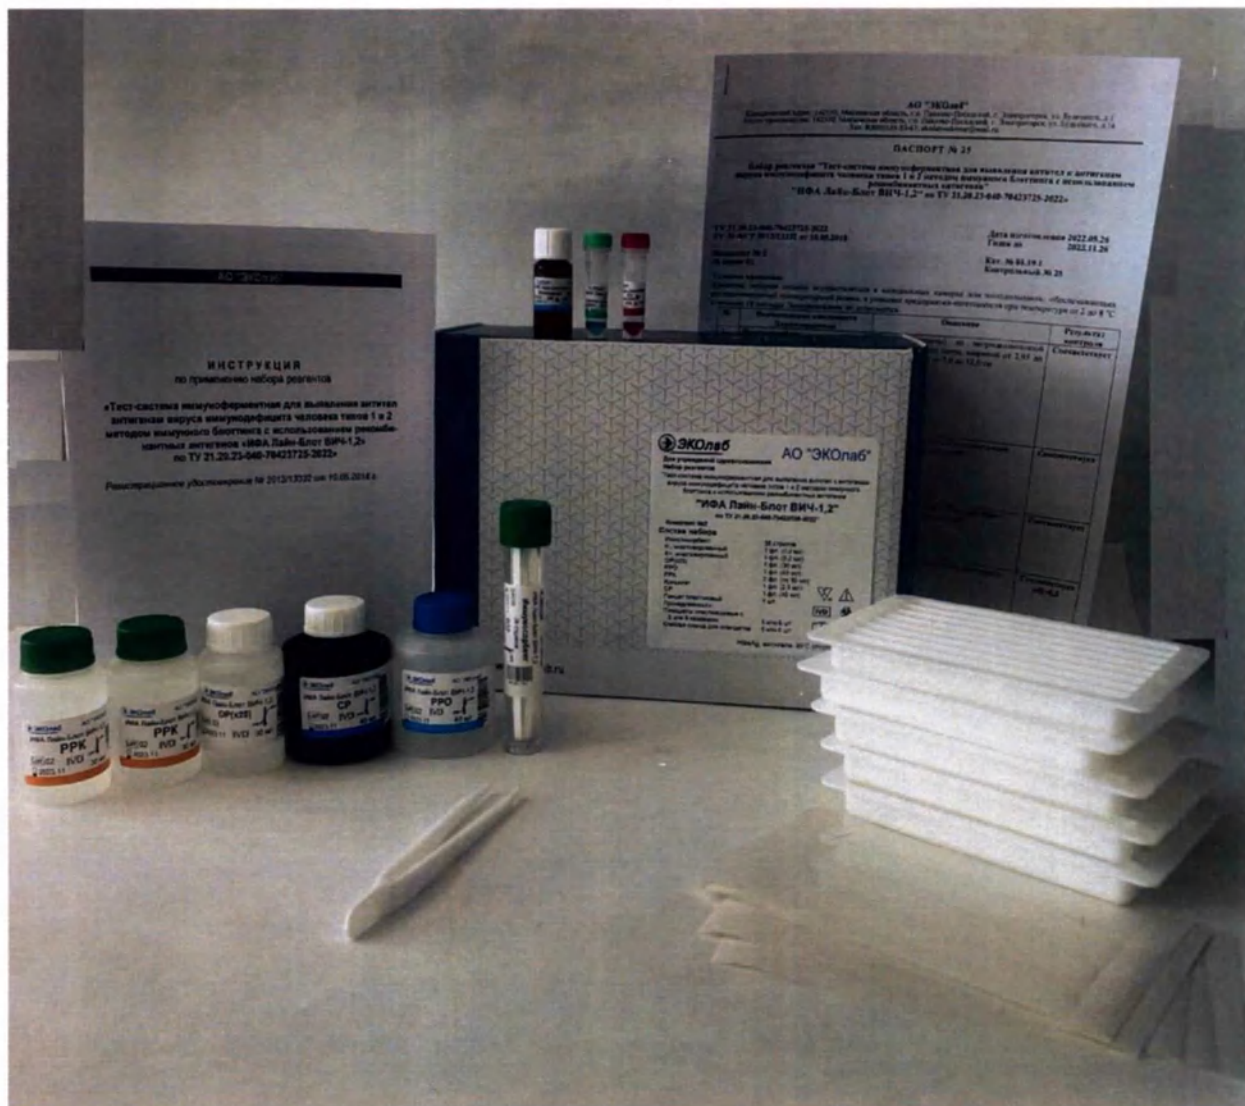


Комплект №3 код партии (серии) 03 от 26.05.2022г

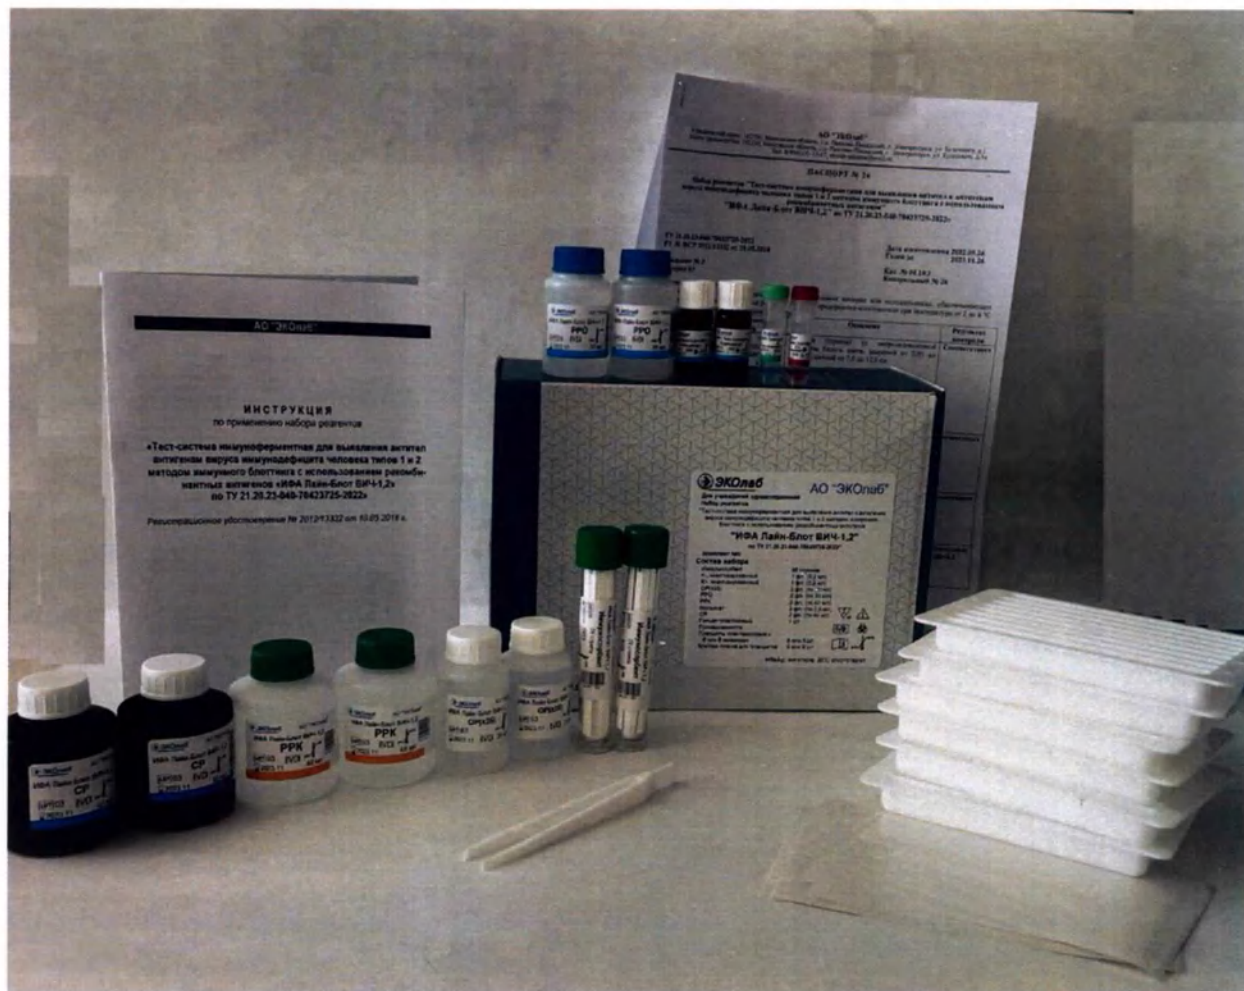

Комплект №1 код партии (серии) 04 от 27.05.2022г

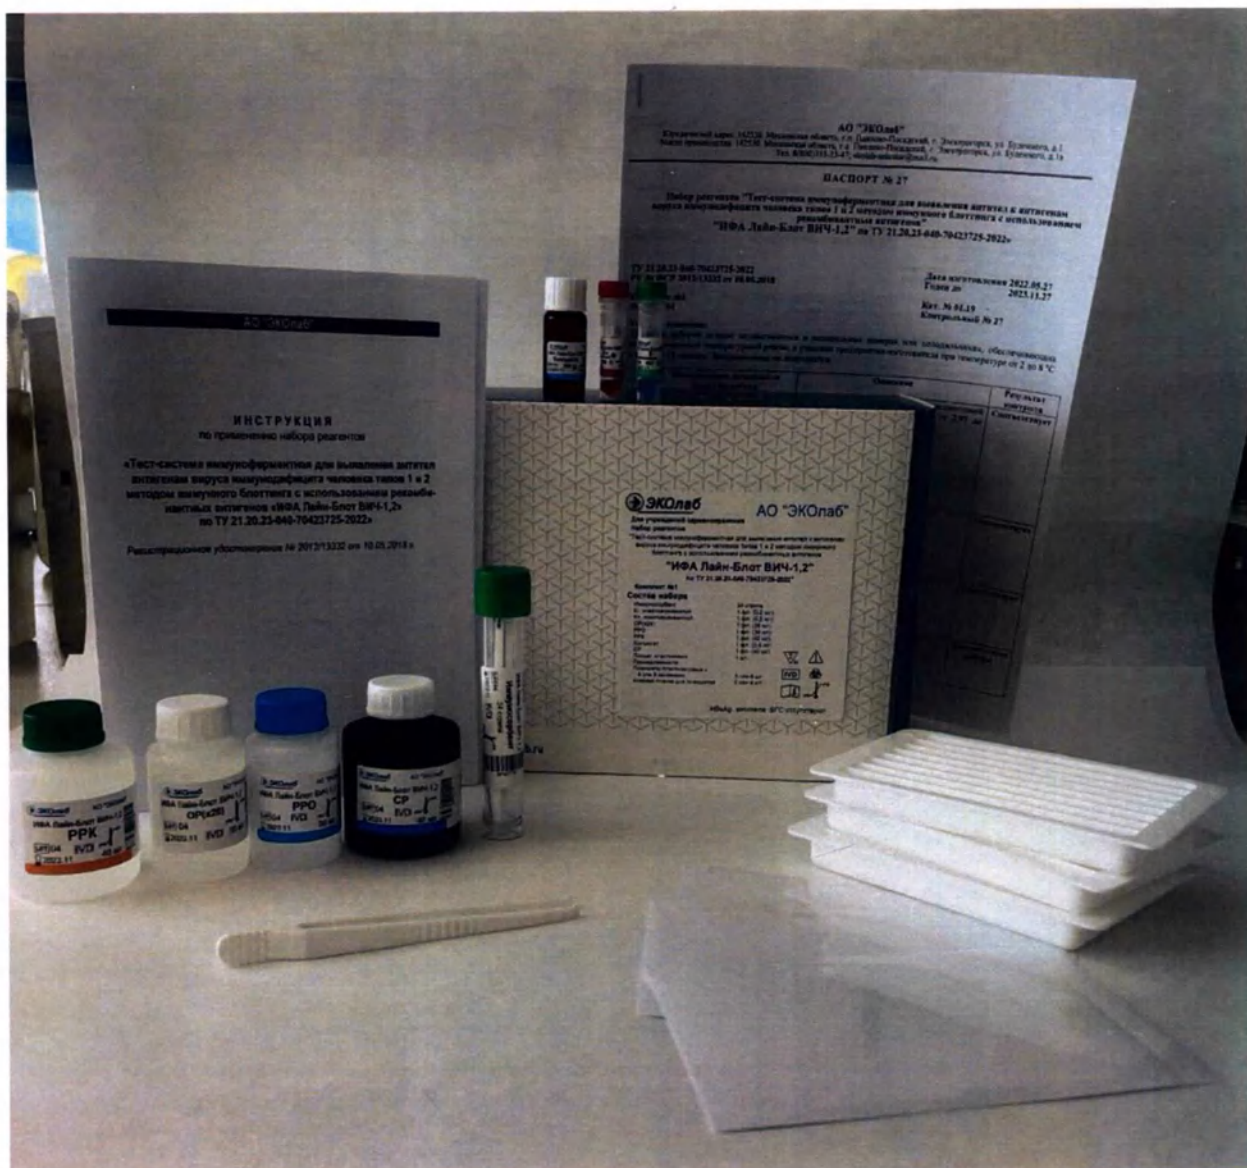

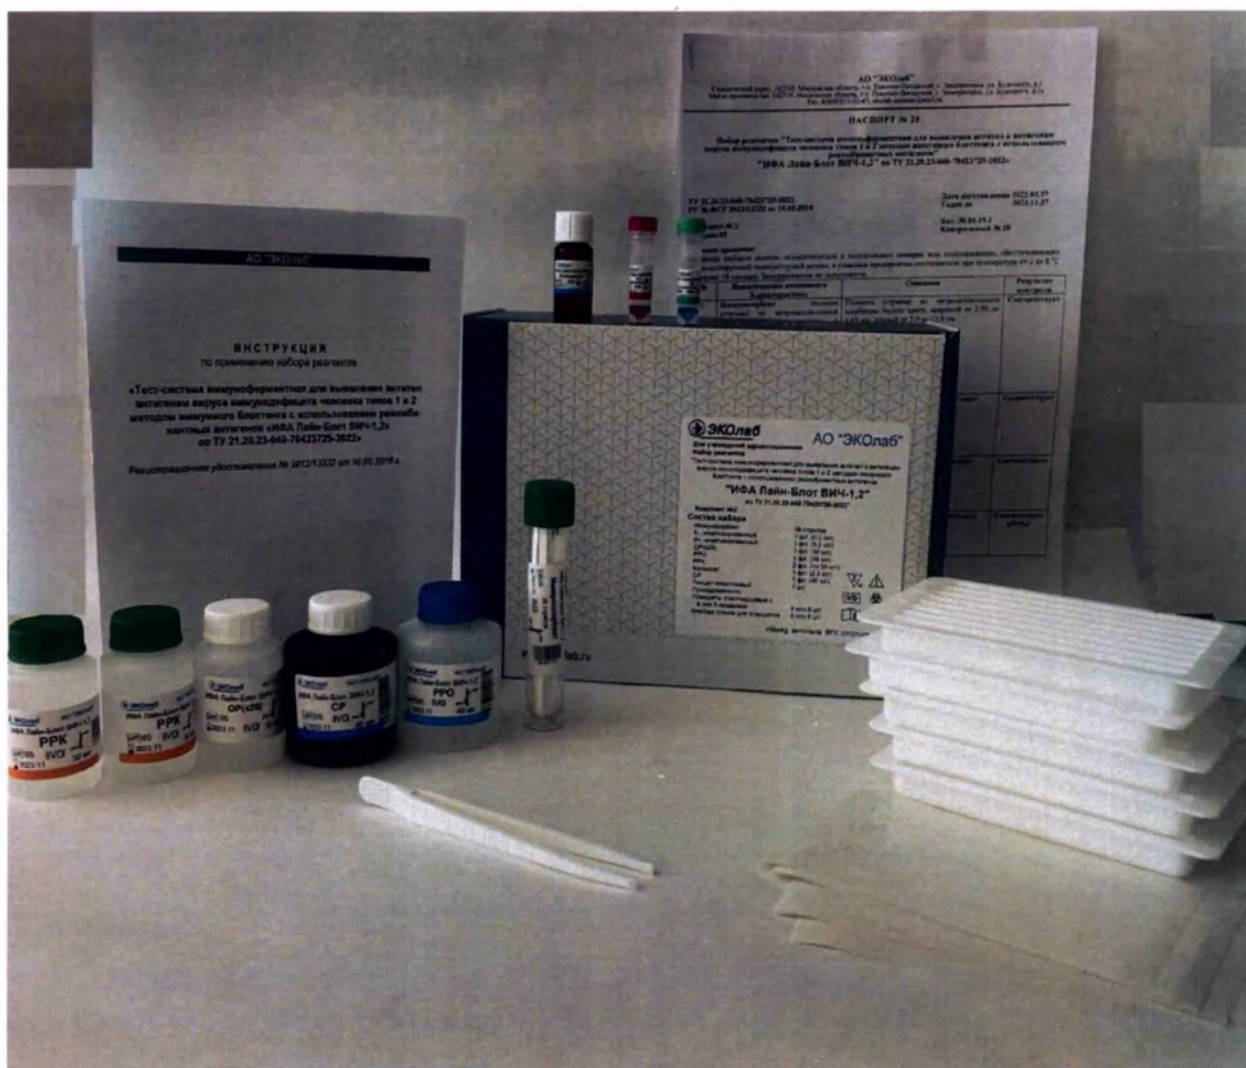

Комплект №3 код партии (серии) 06 от 27.05.2022г



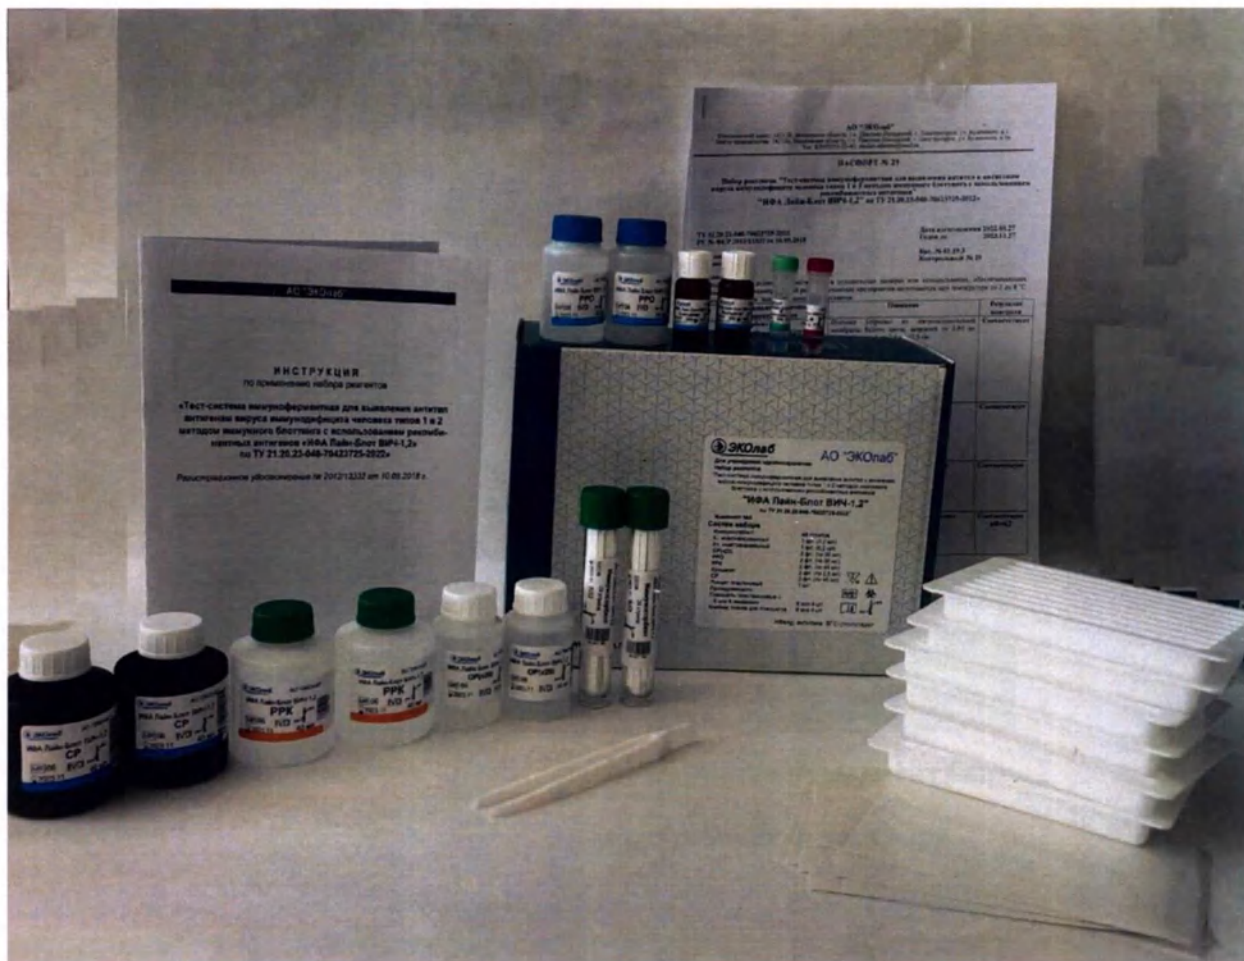


Фото компонентов набора реагентов Набор реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов «ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2» по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022»

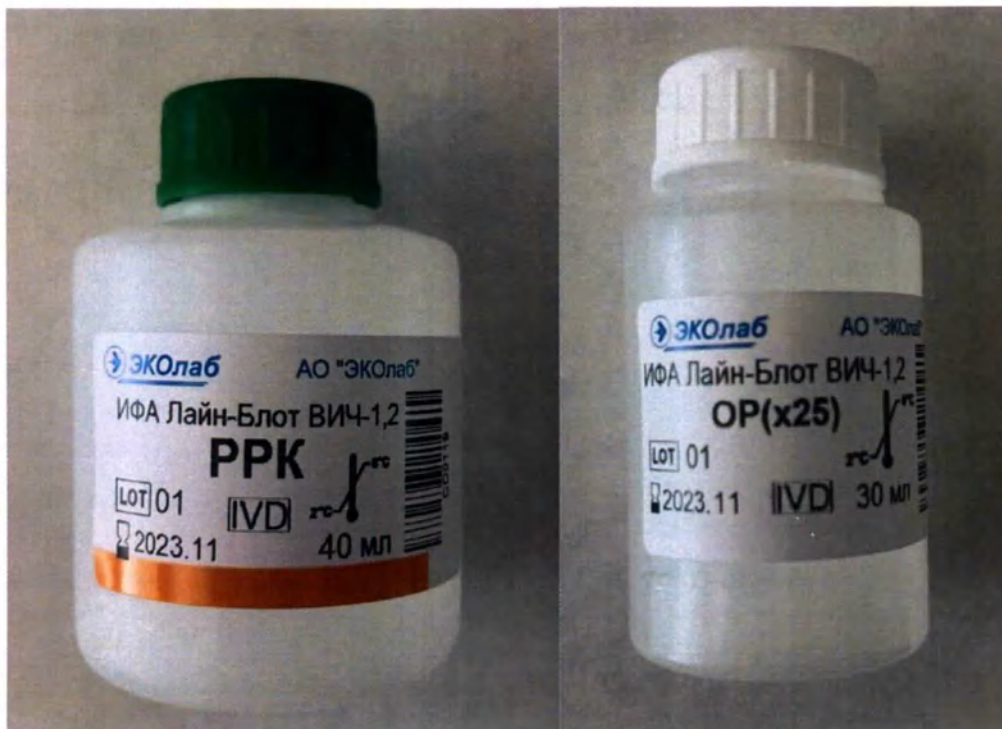


**Раствор для разведения
конъюгата**


**25-кратный концентрат
отмывающего раствора**

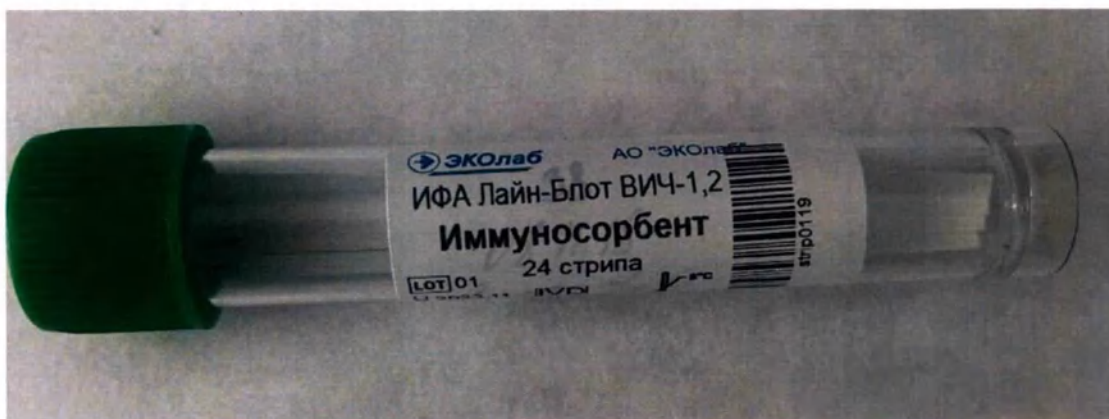


Иммуносорбент

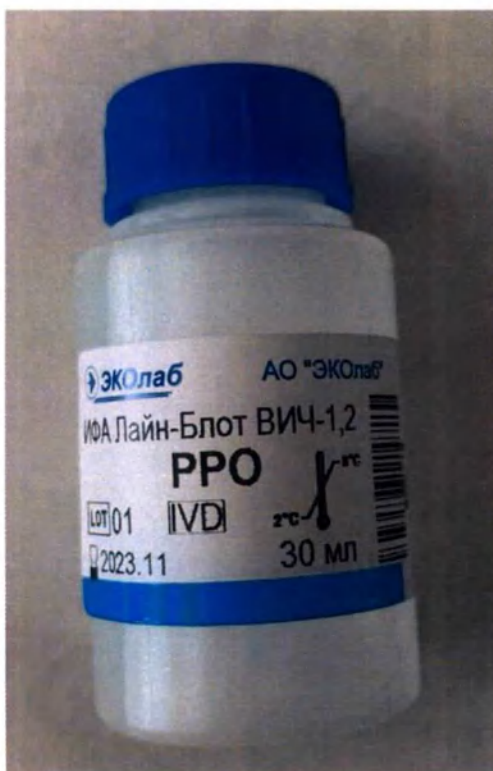


Раствор для разведения образцов

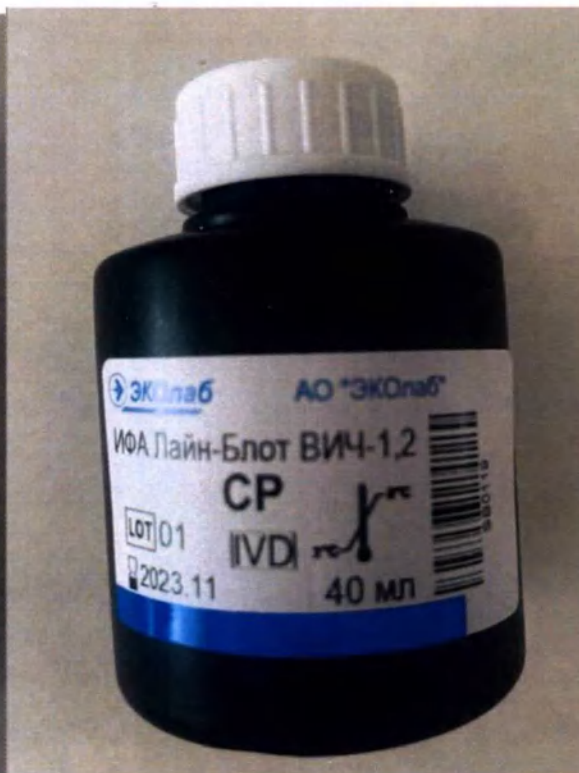

Субстратный раствор

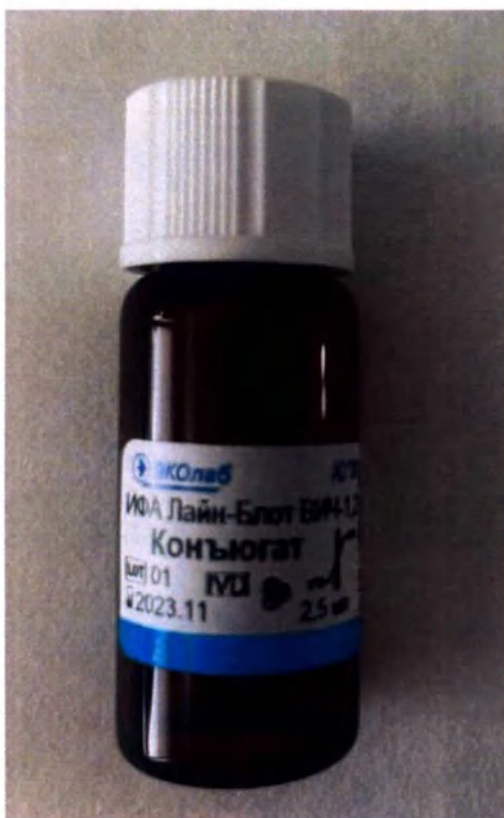


Конъюгат

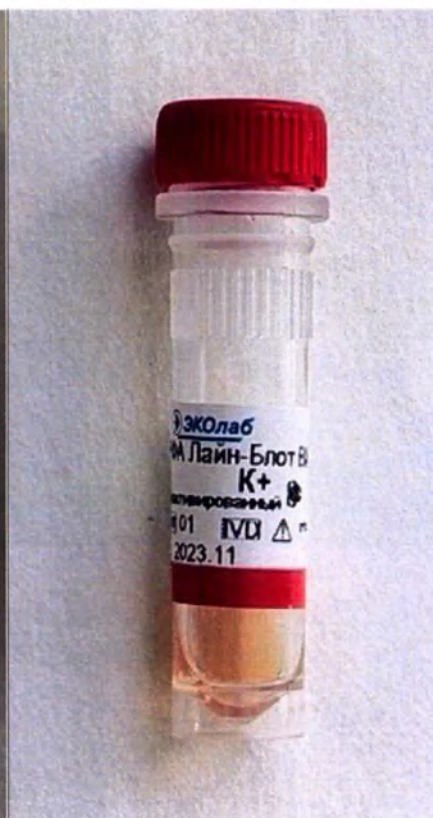


Контрольный положительный
образец




**Контрольный отрицательный
образец**

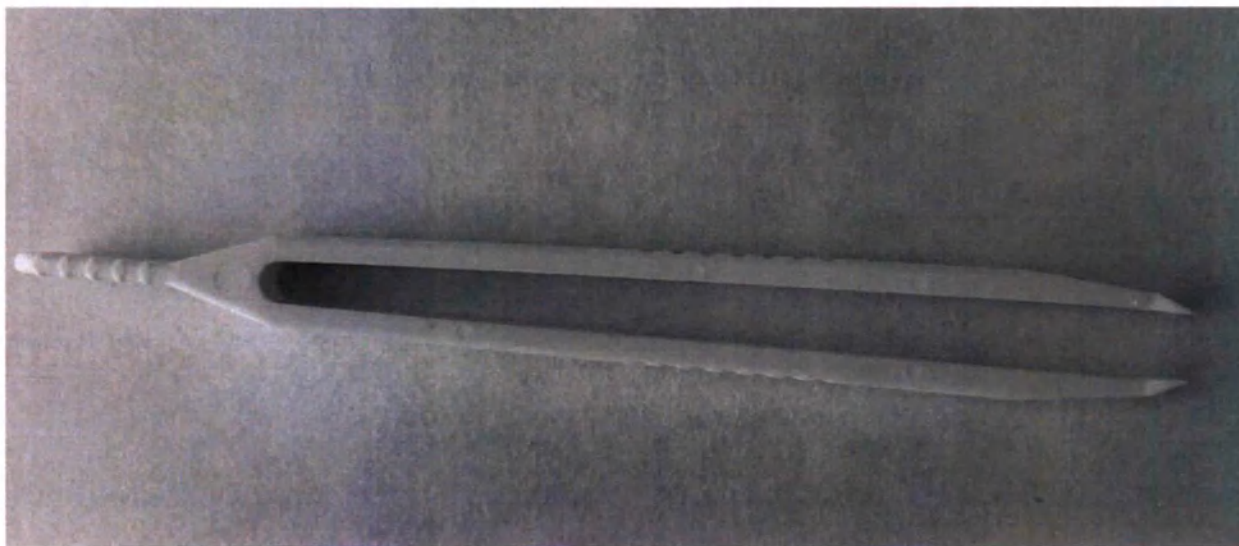

Пинцет пластиковый

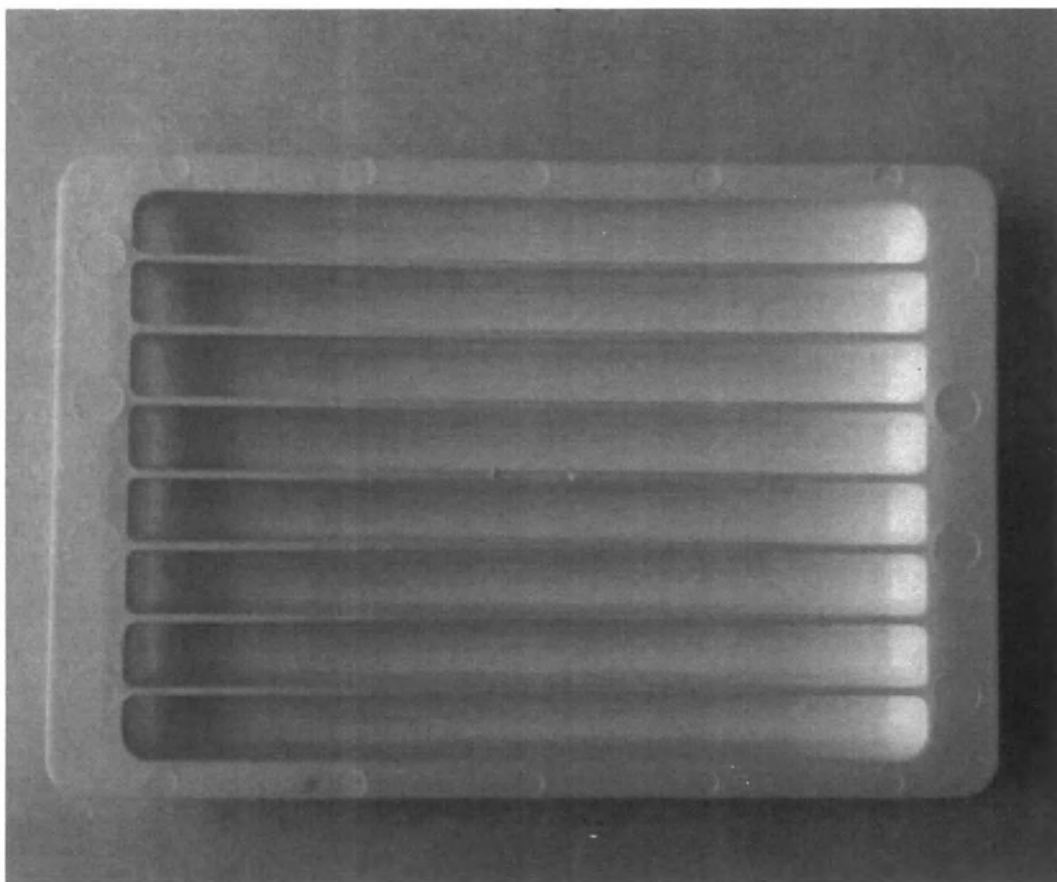

Планшет пластмассовый с 8 канавками

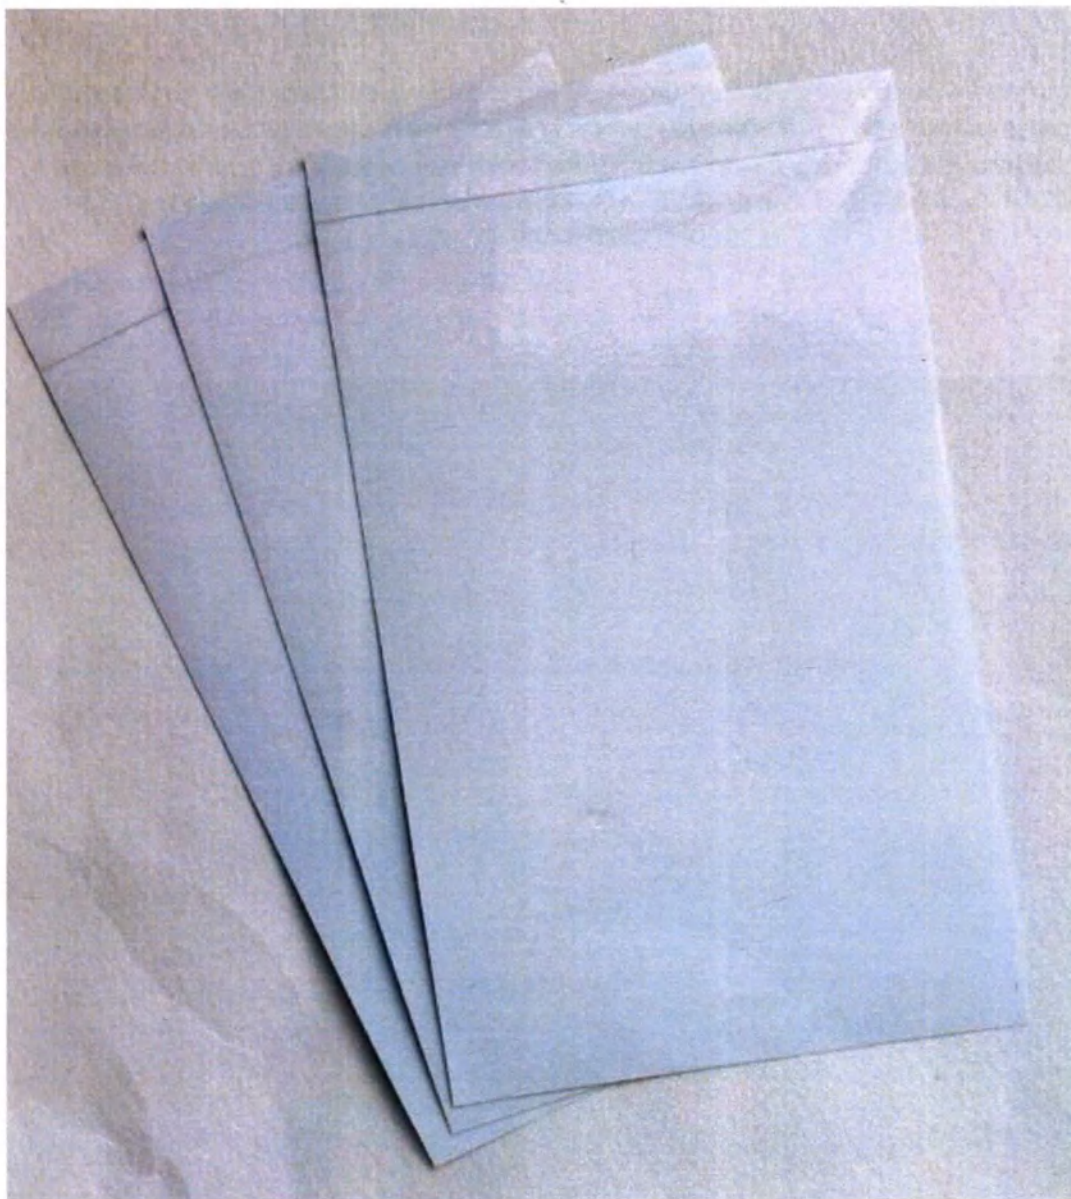


Клейкая пленка для планшетов

Фотографическое изображение коробки (не в сборе) набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов «ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2» по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022»



Фотографическое изображение транспортной тары набора реагентов «Тест-система иммуноферментная для выявления антител к антигенам вируса иммунодефицита человека типов 1 и 2 методом иммунного блоттинга с использованием рекомбинантных антигенов «ИФА Лайн-Блот ВИЧ-1,2» по ТУ 21.20.23-040-70423725-2022»

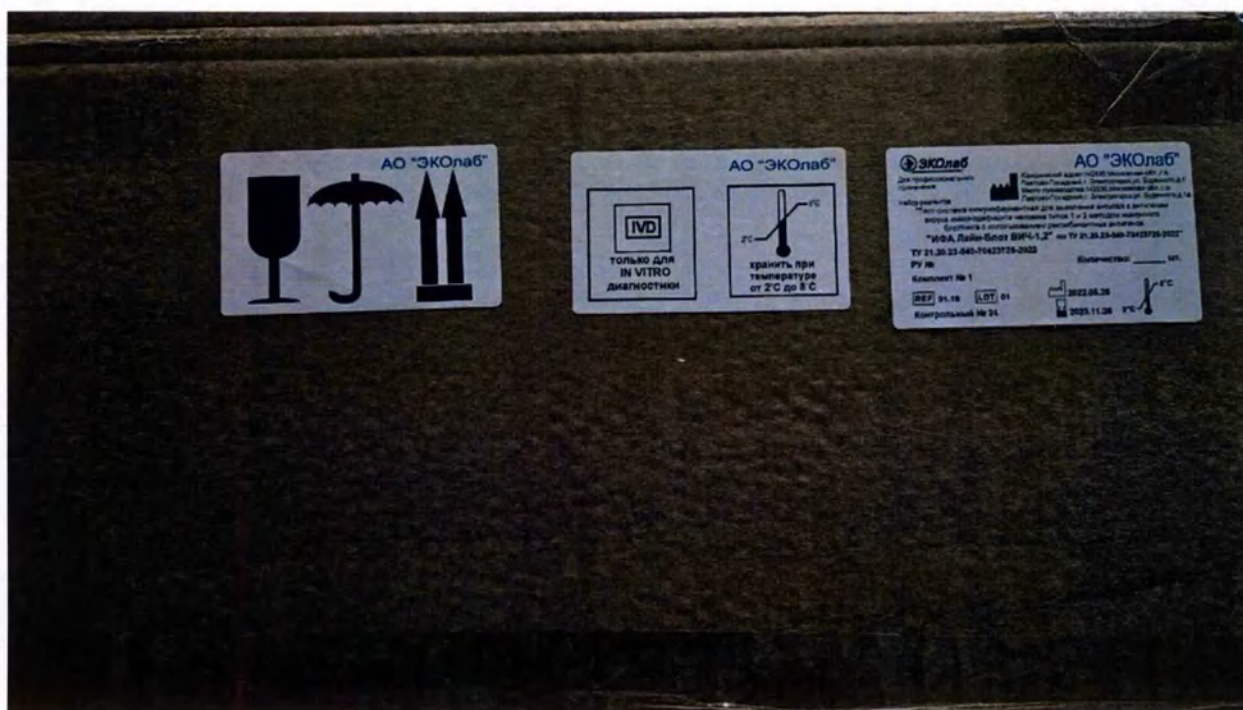



Пронумеровано, пронумеровано
и скреплено печатью

лист 06

Ген. директор АО "ЭКОлаб"

Гашенко Т.Ю.

07 04 2024 г.