

ПОДТВЕРЖДАЮ


Директор по развитию
ООО «АМК»



Н. Н. Перцева
«10» октября 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Набор реагентов для количественного определения антител класса IgG к
Toxoplasma gondii в сыворотке и плазме крови человека (Toxo IgG CLIA
Microparticles (Toxo IgG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии
AutoLumo

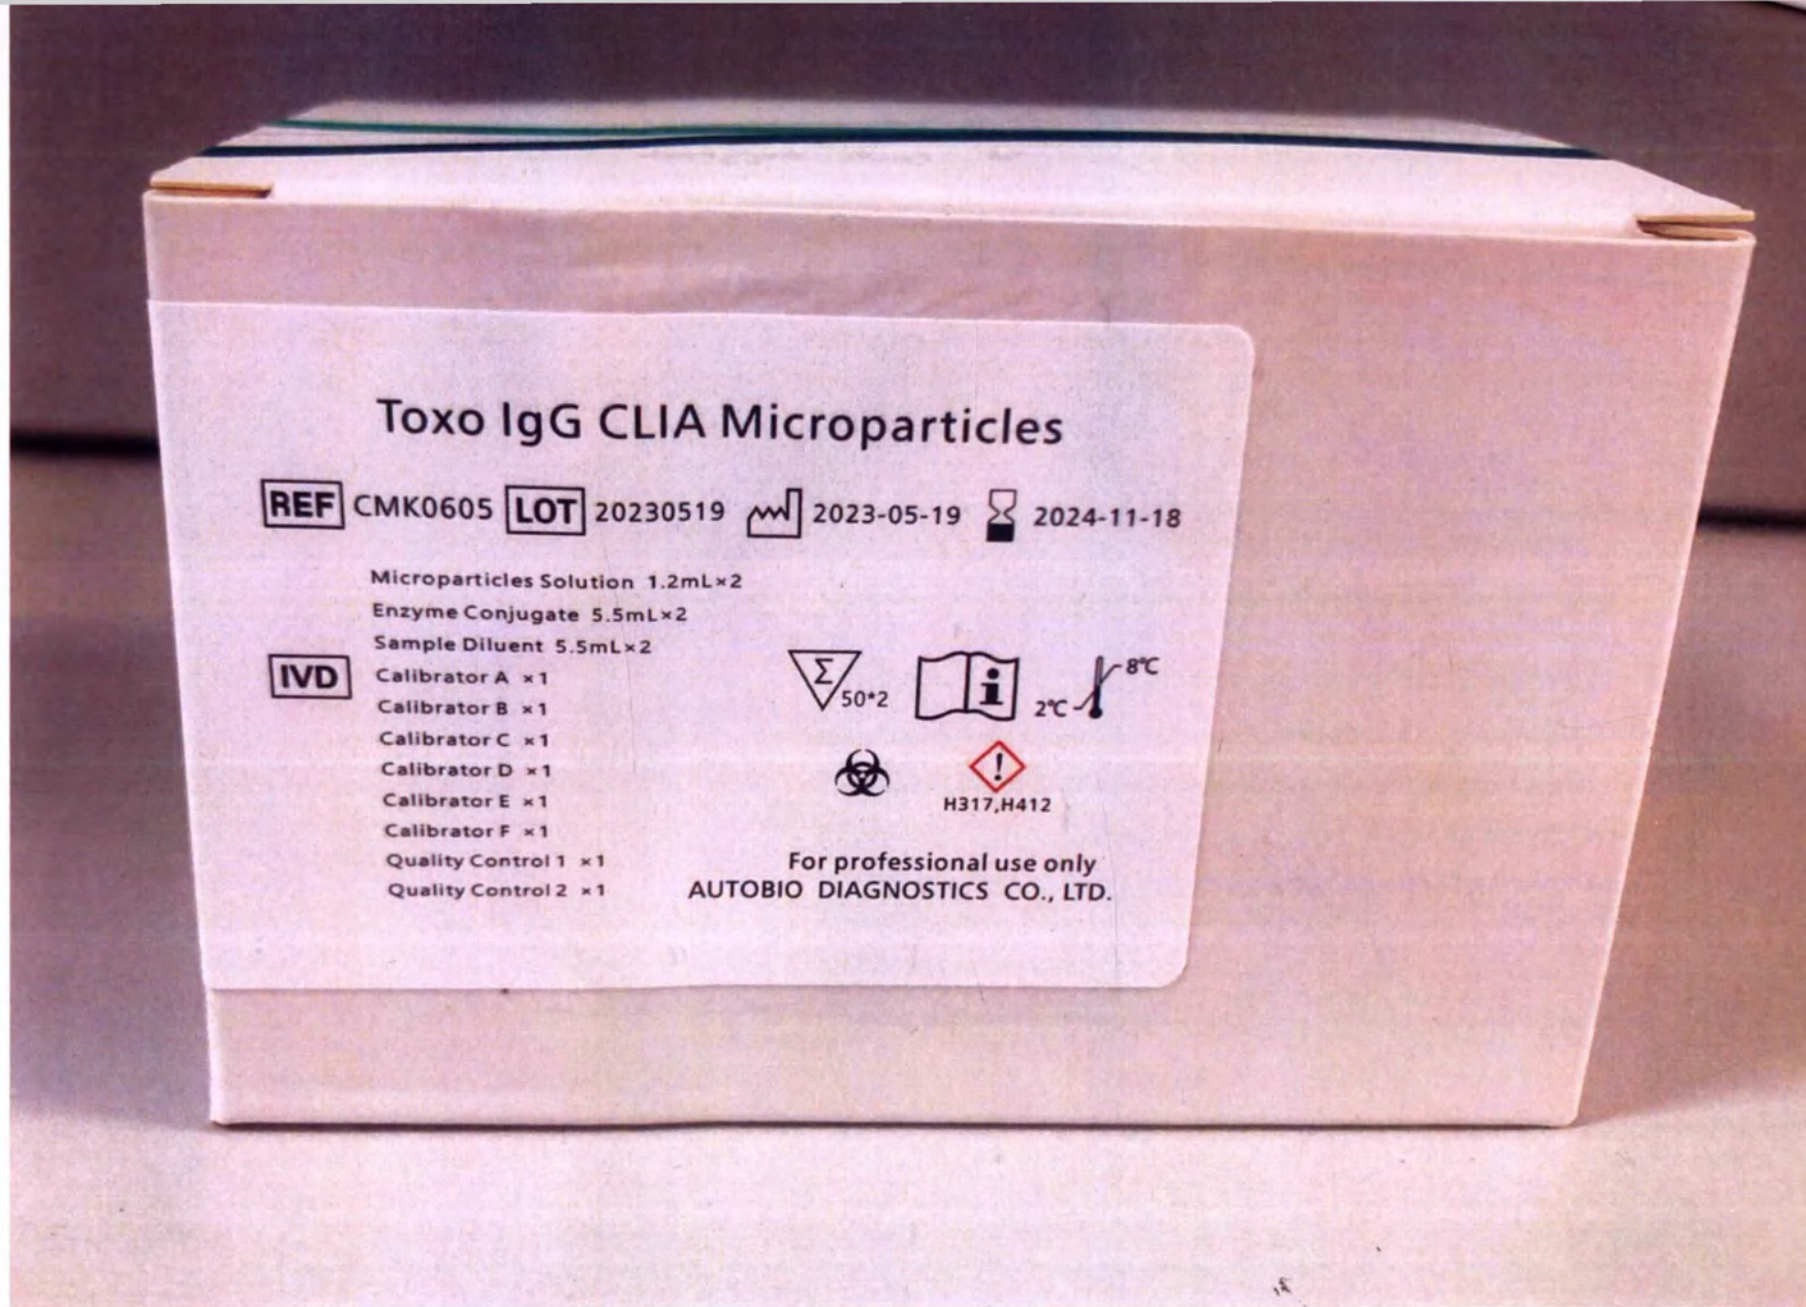

1. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов.

Набор реагентов для количественного определения антител класса IgG к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека (Toxo IgG CLIA Microparticles (Toxo IgG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ


Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10


2. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов.

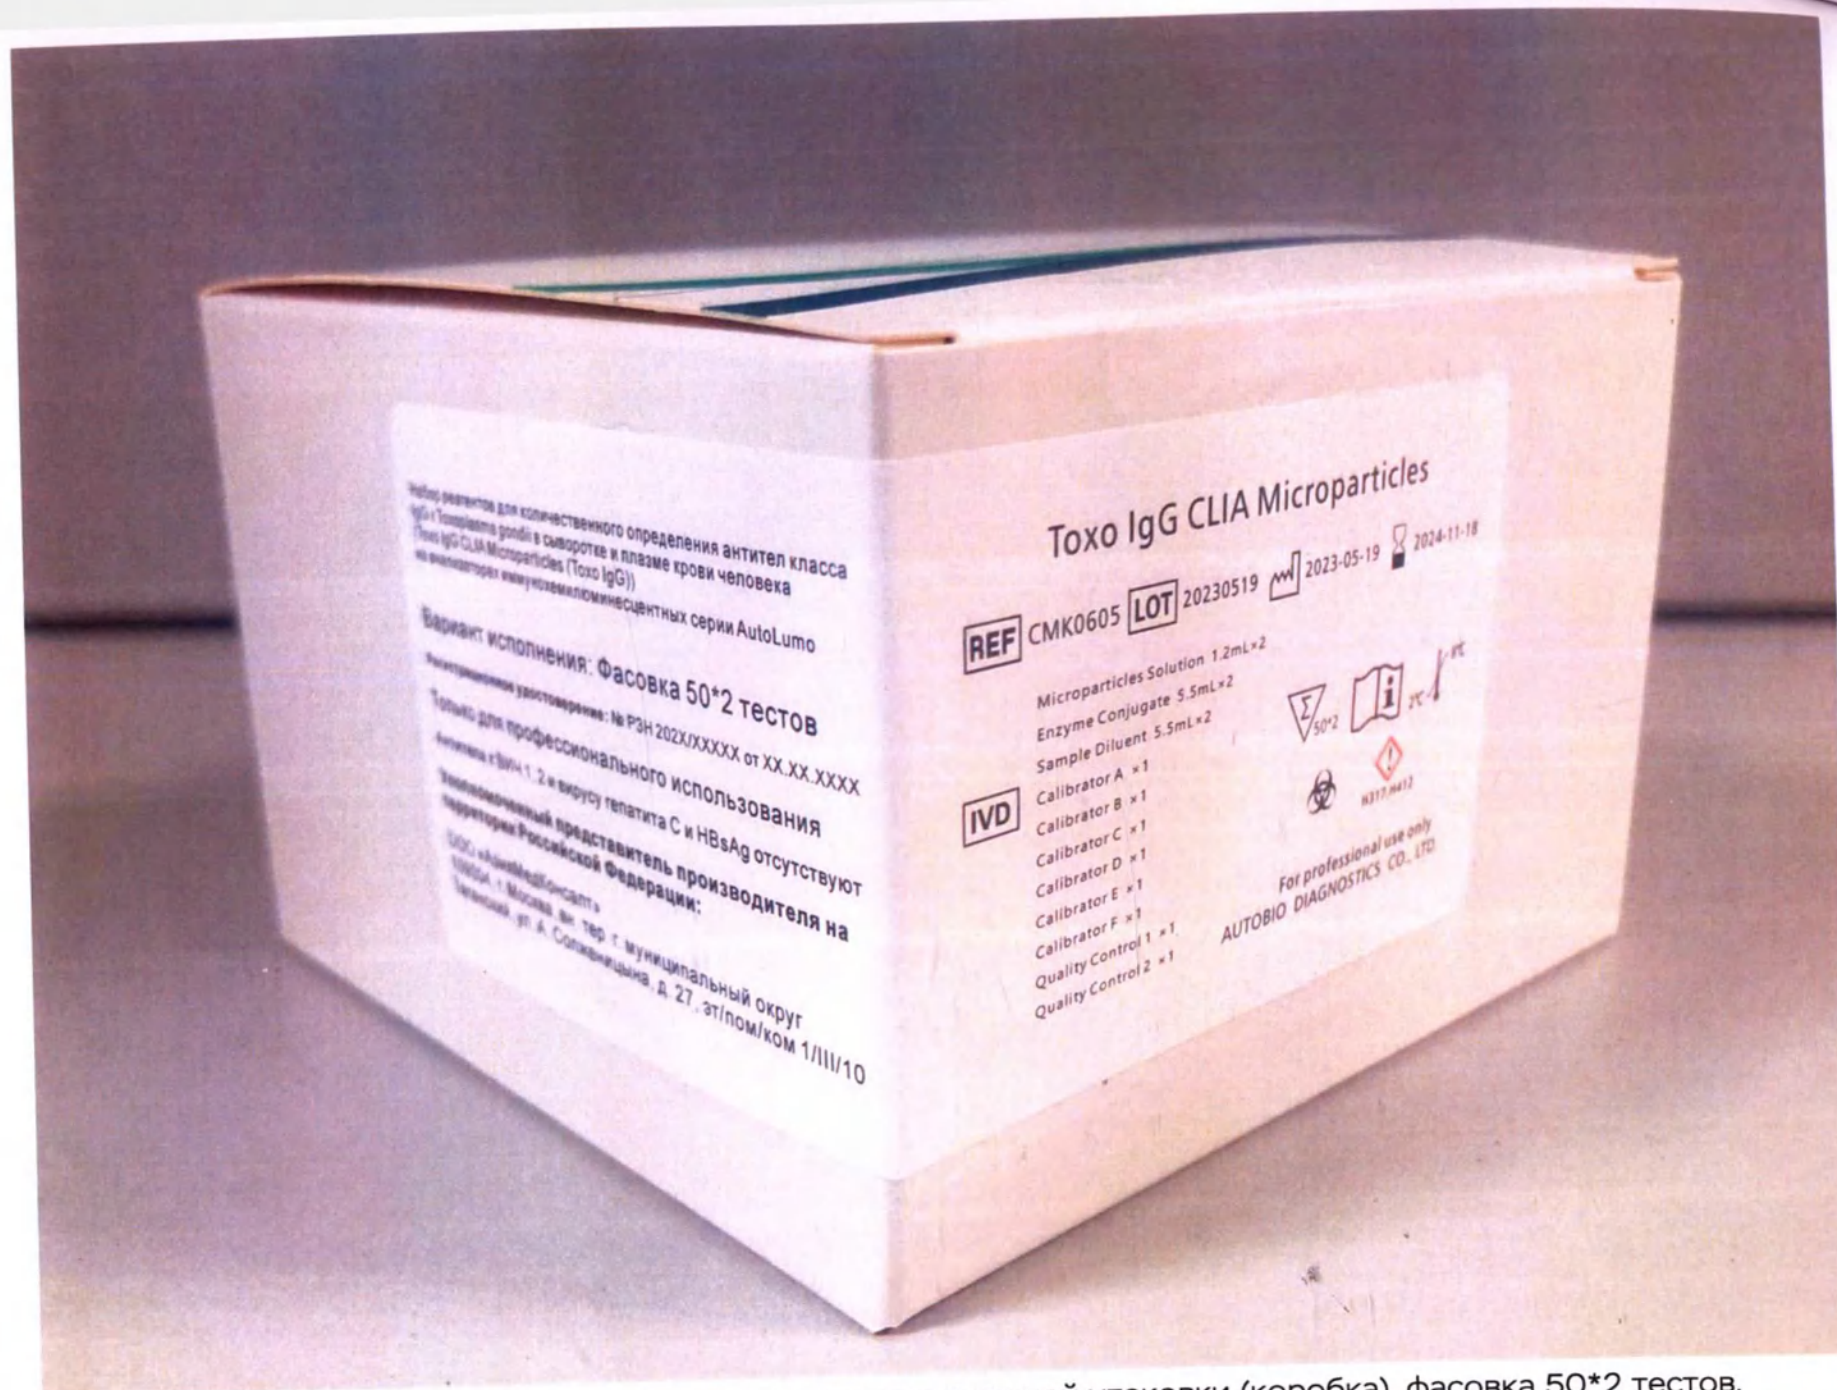

3. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов.

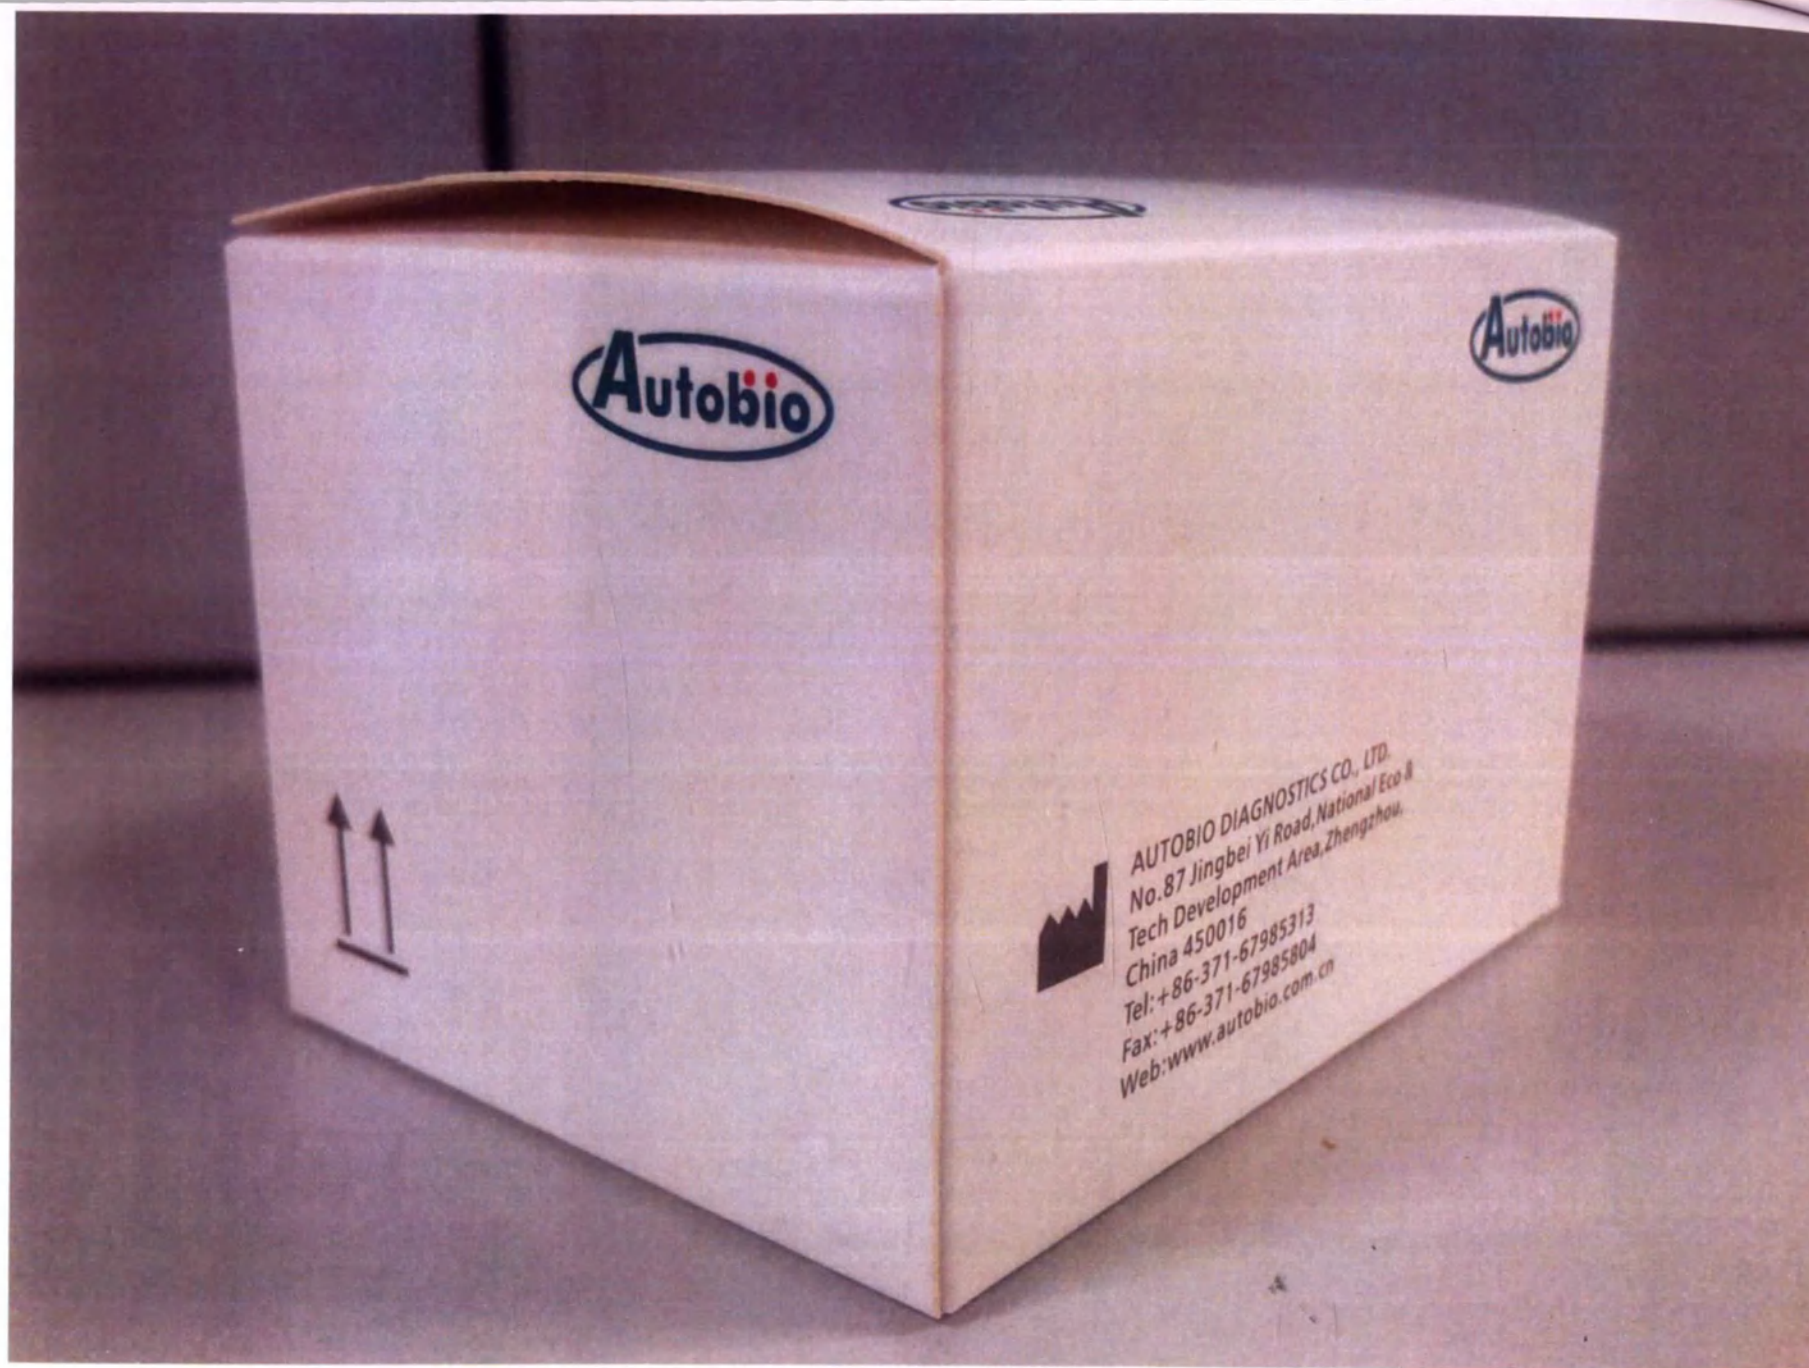

4. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов.

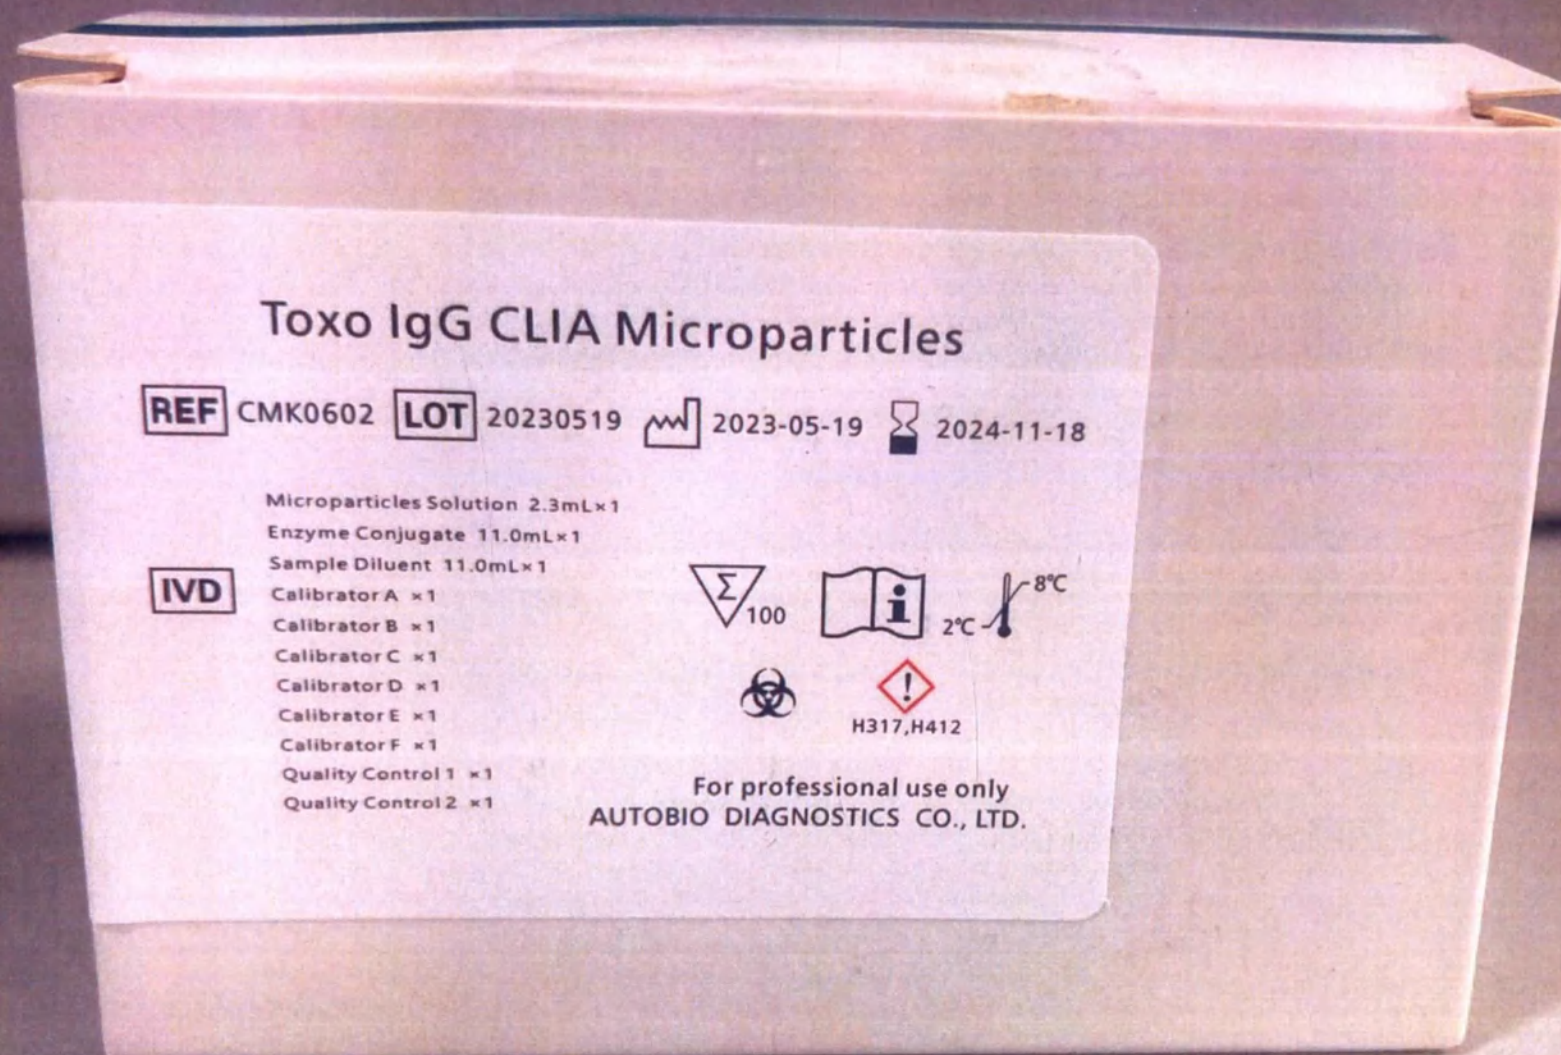

5. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов.

Набор реагентов для количественного определения антител класса IgG к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека (Toxo IgG CLIA Microparticles (Toxo IgG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXXX от XX.XX.XXXX


Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют


Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

6. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов.

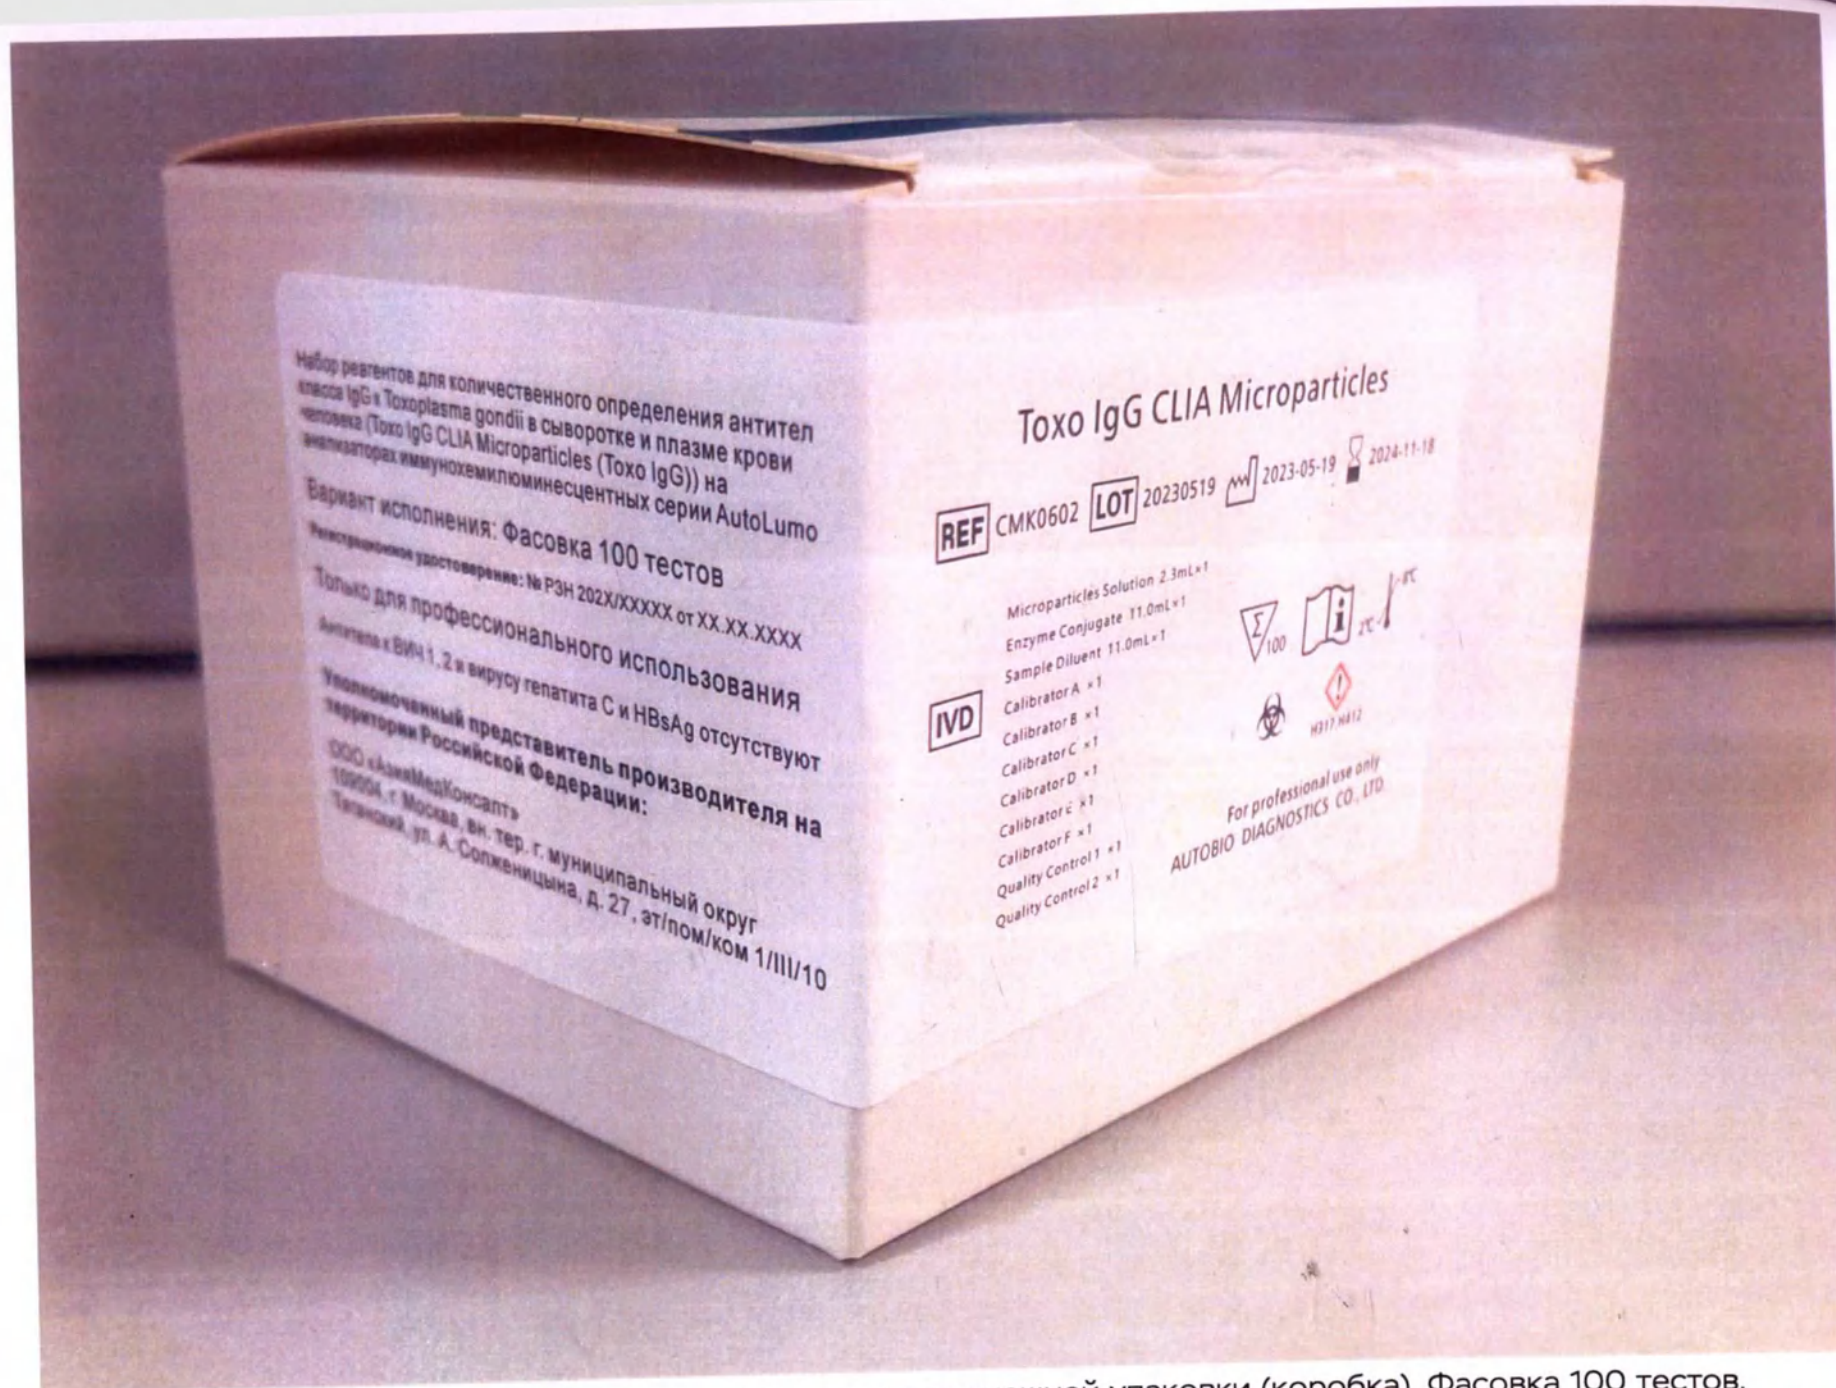


7. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов.

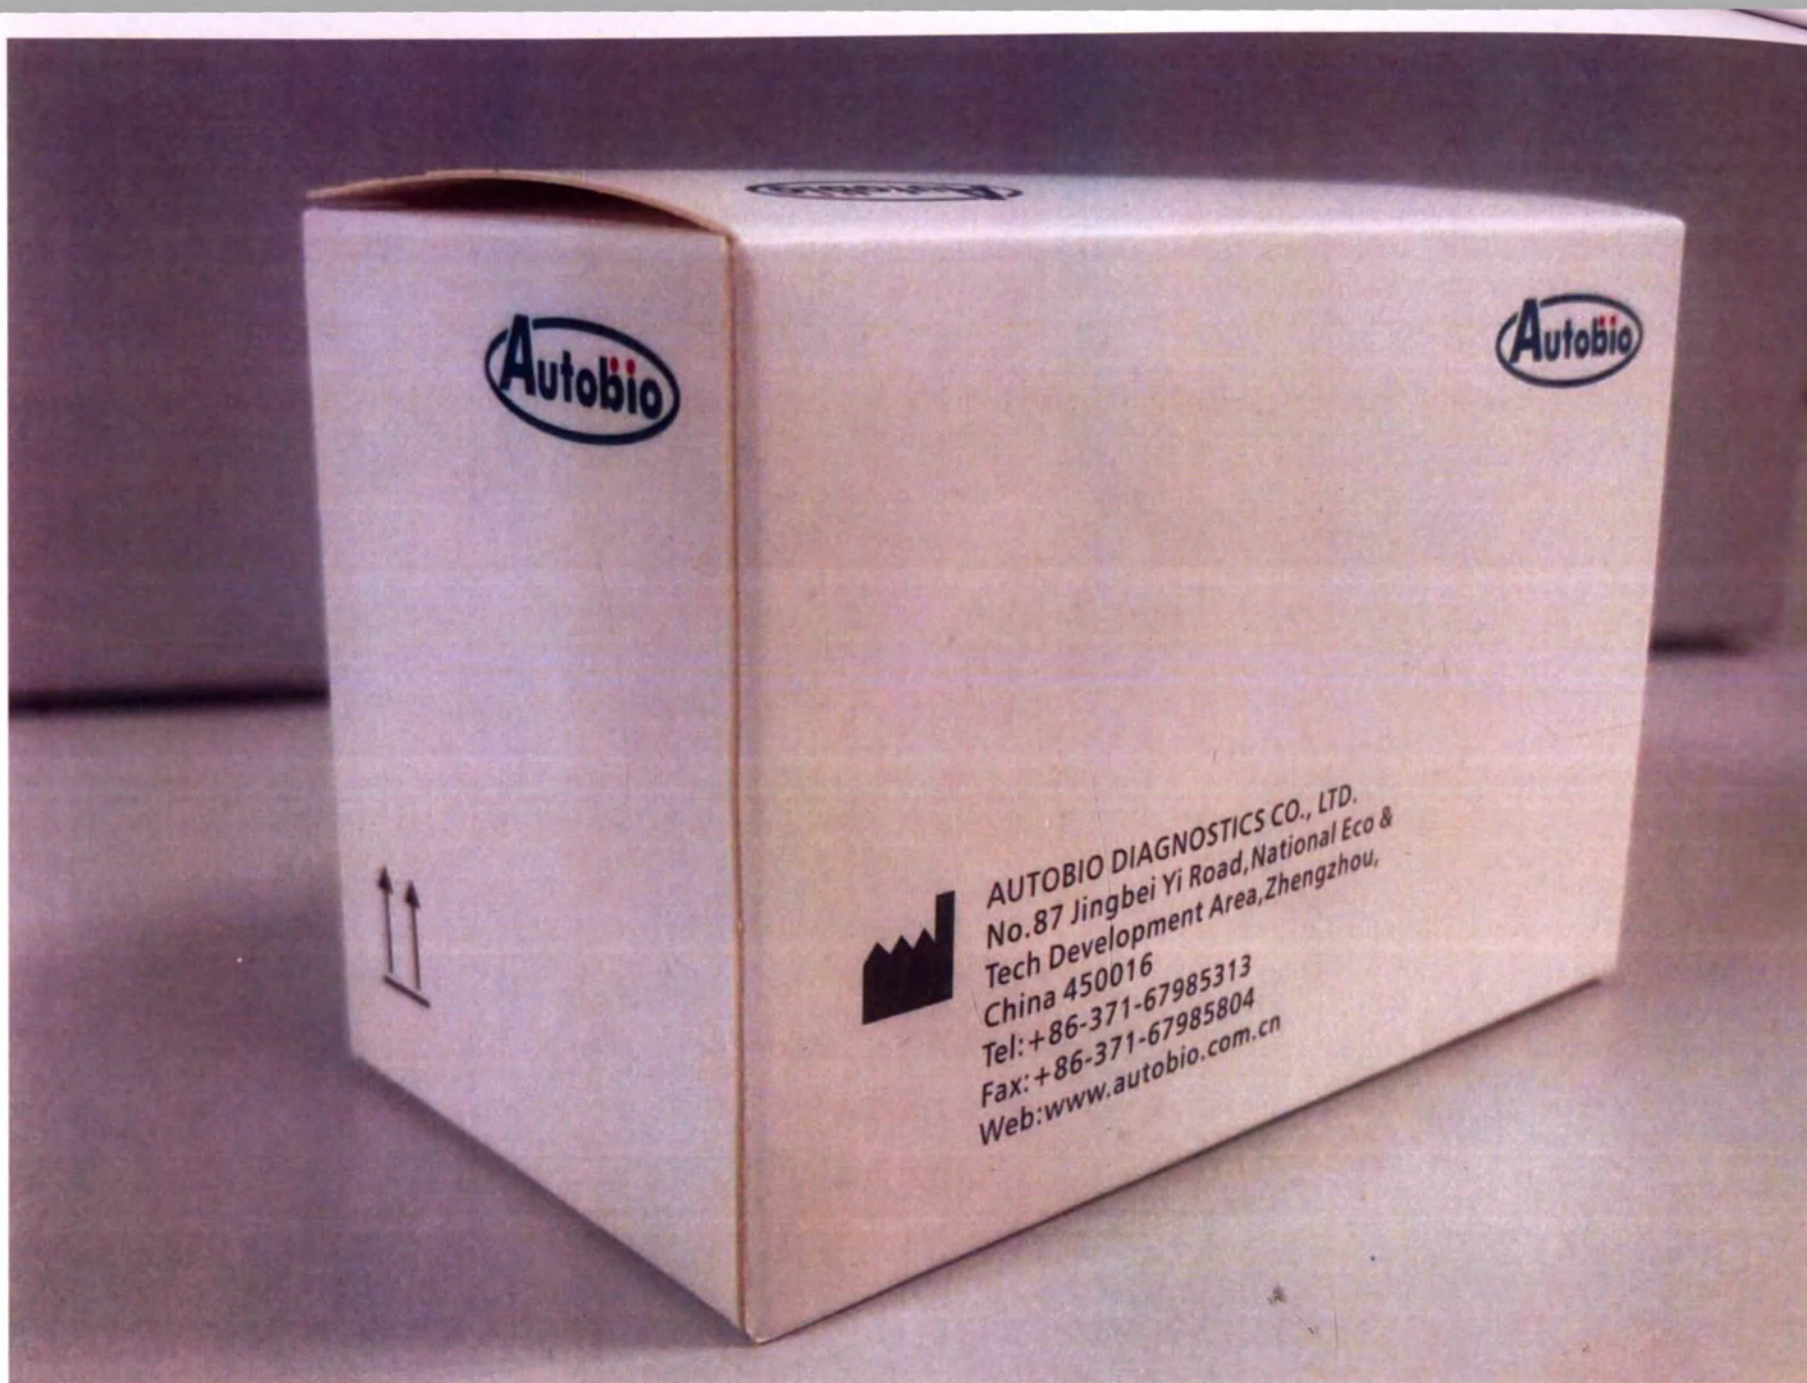

8. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов.




9. Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 50*2 тестов.

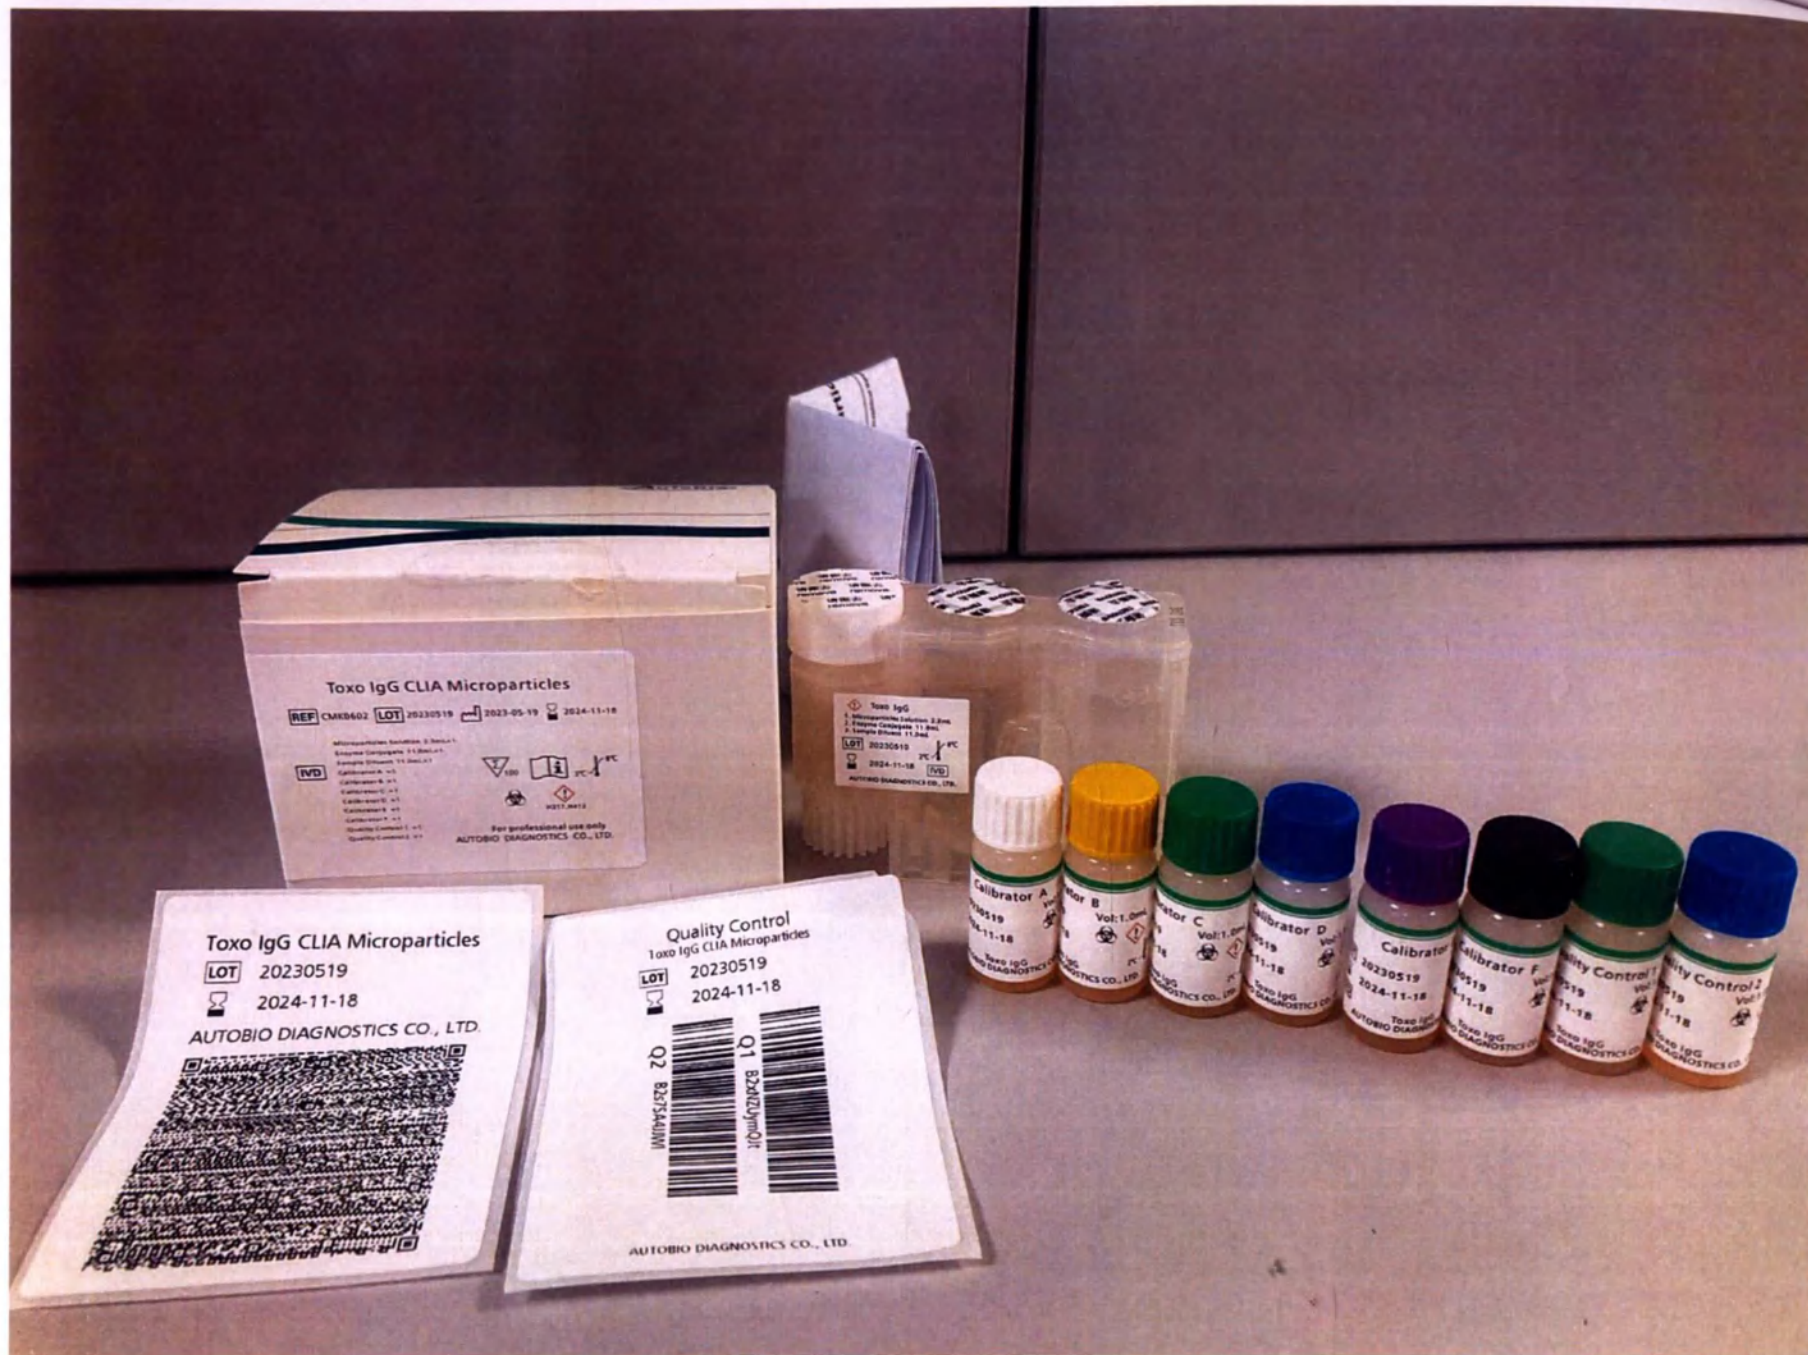


10. Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки (коробка). Фасовка 100 тестов.




11. Фотография картриджа, вариант №1.

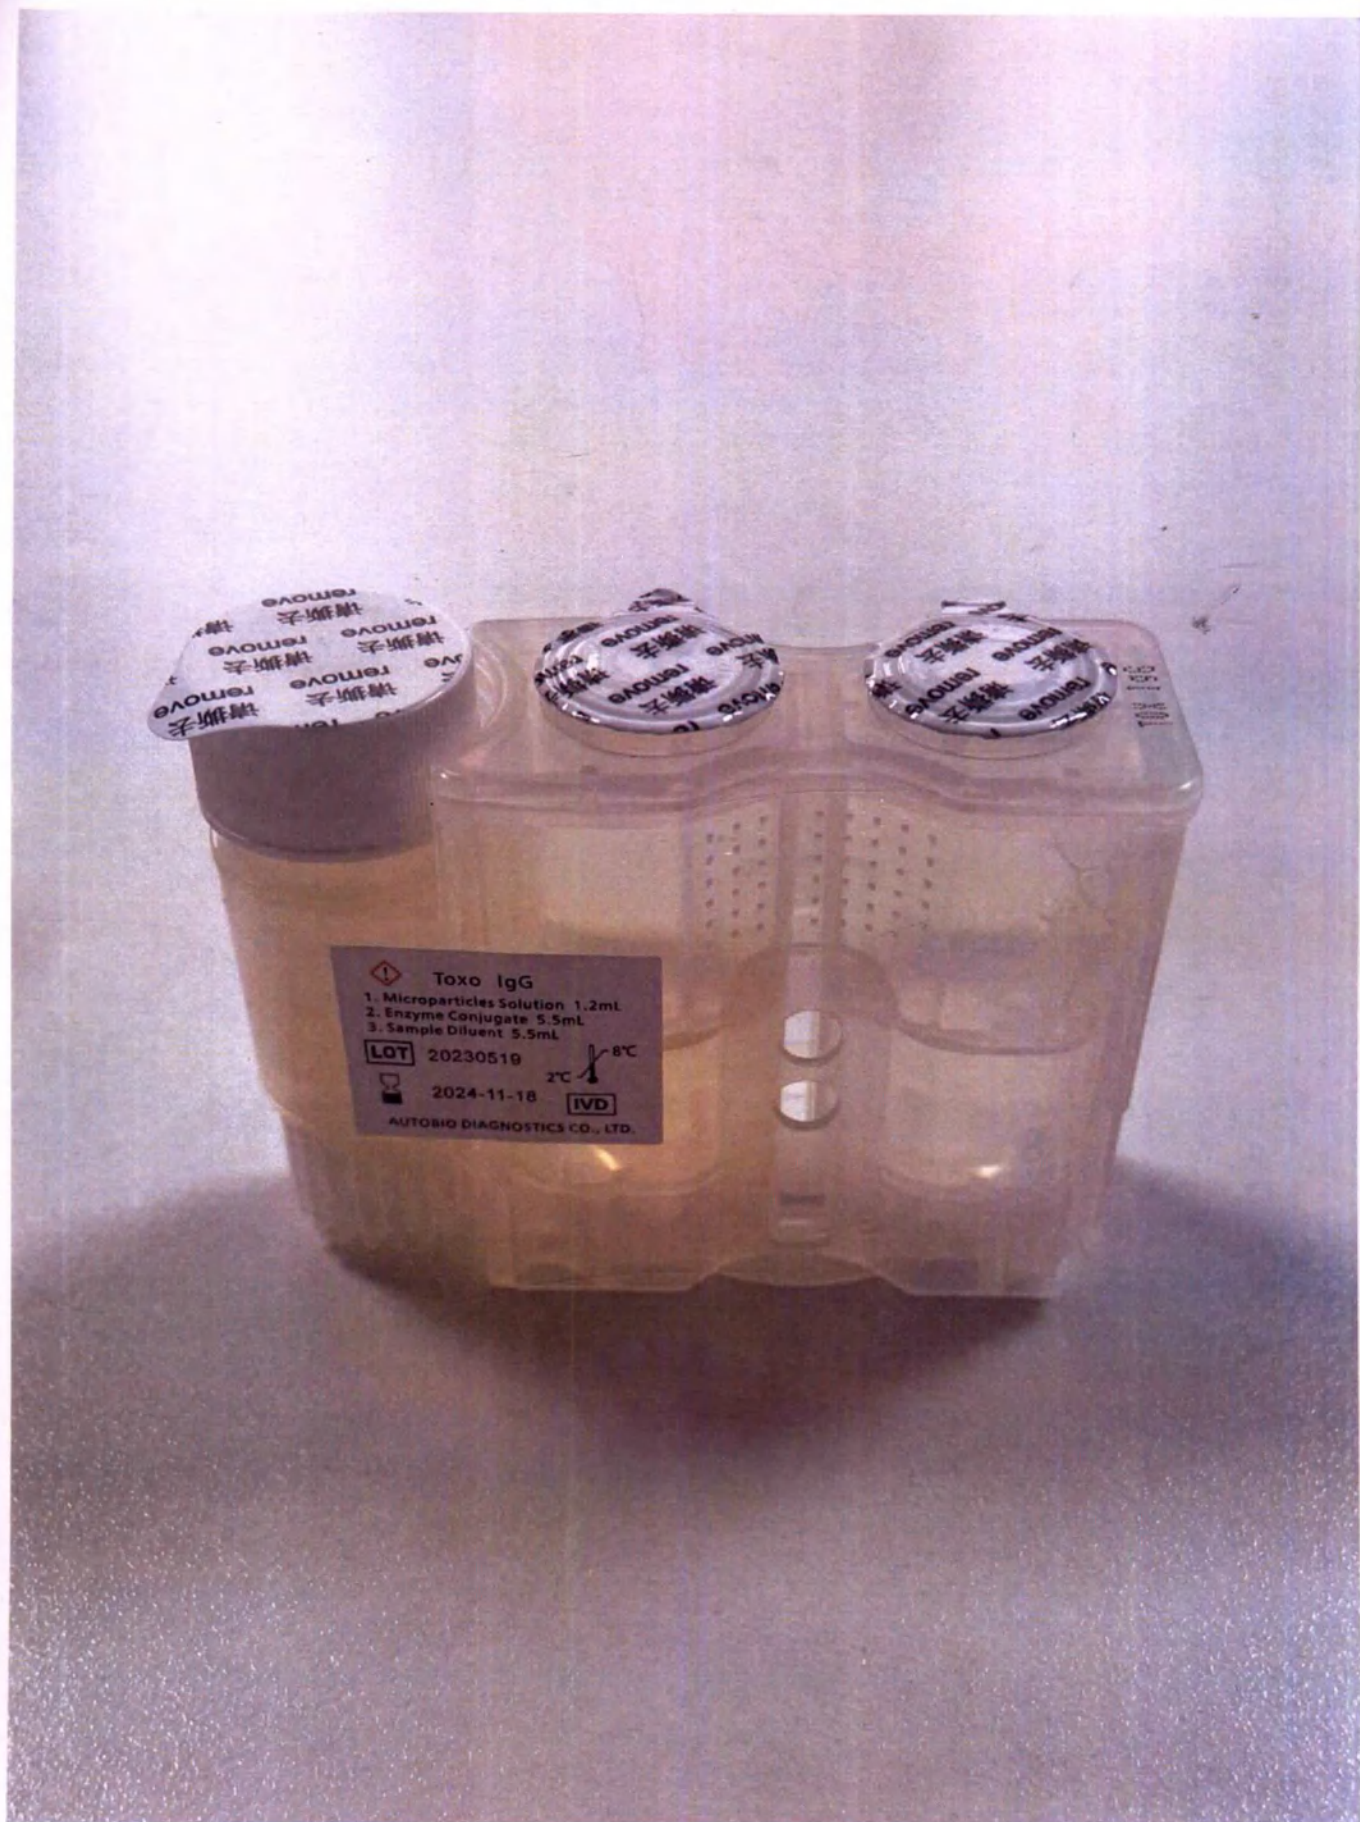


12. Фотография картриджа, вариант №2.

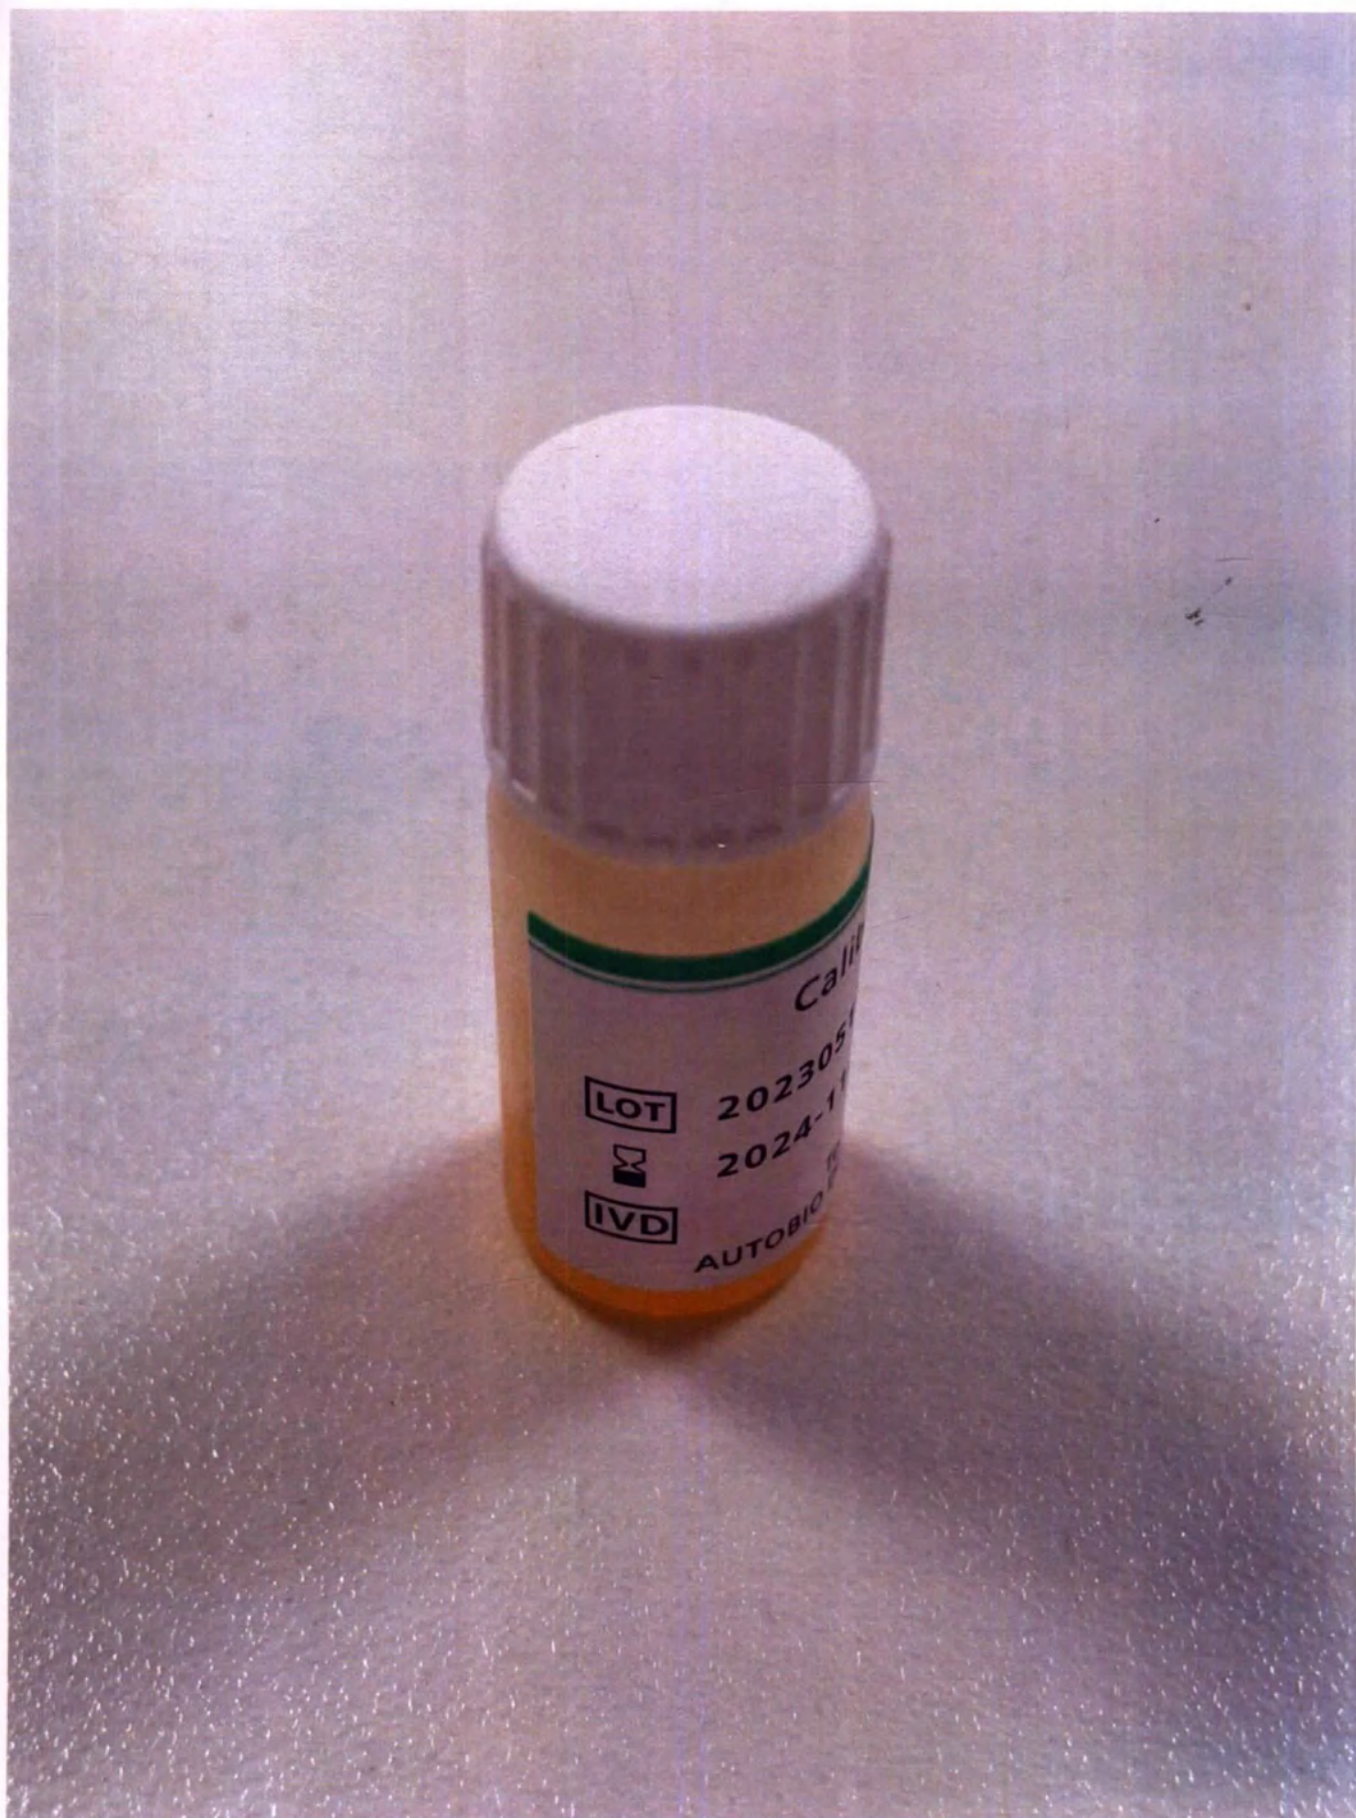

13. Фотография калибратора А (Calibrator A).

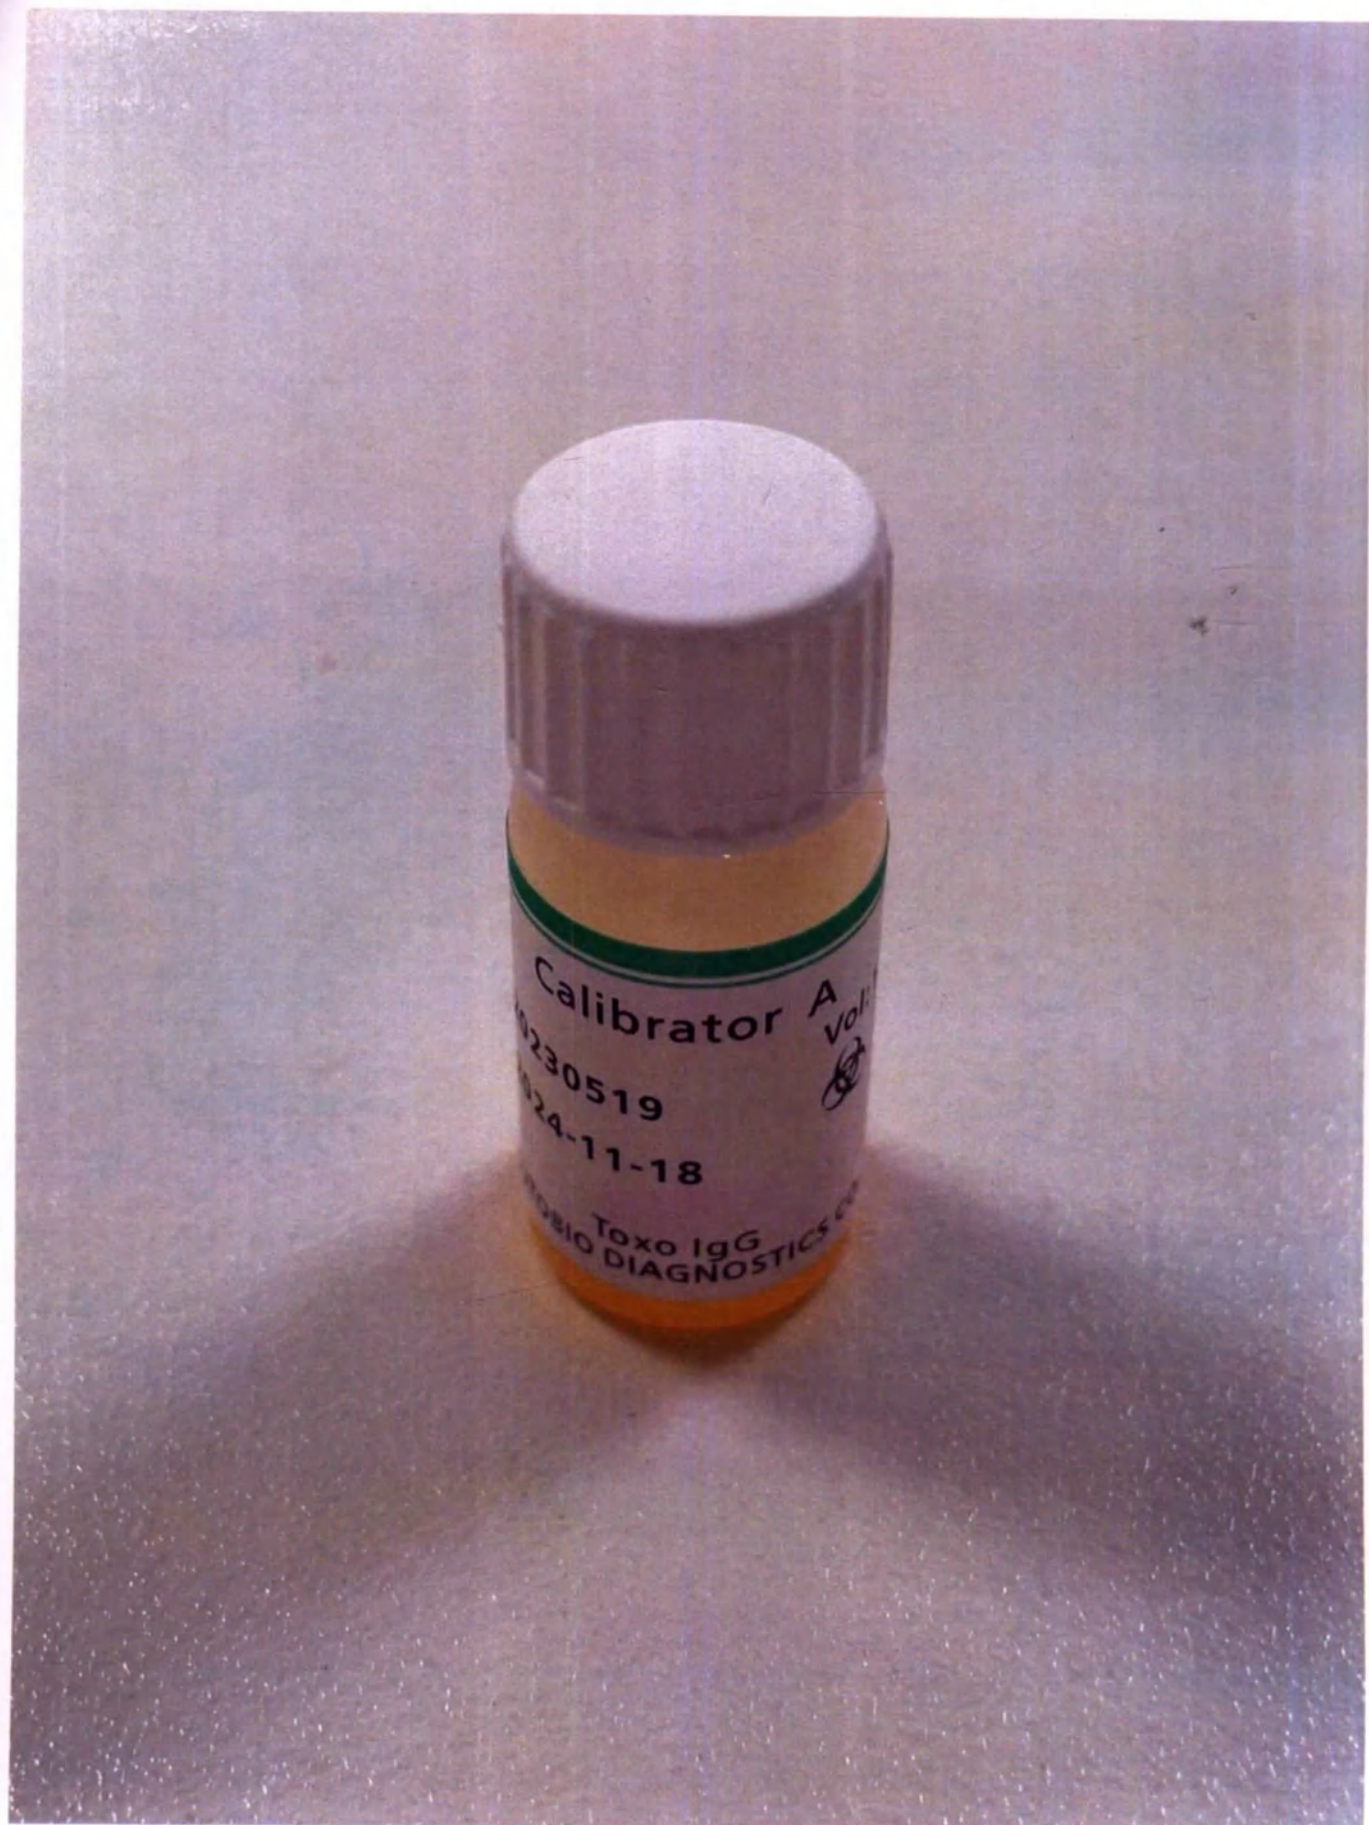


14. Фотография калибратора А (Calibrator A).

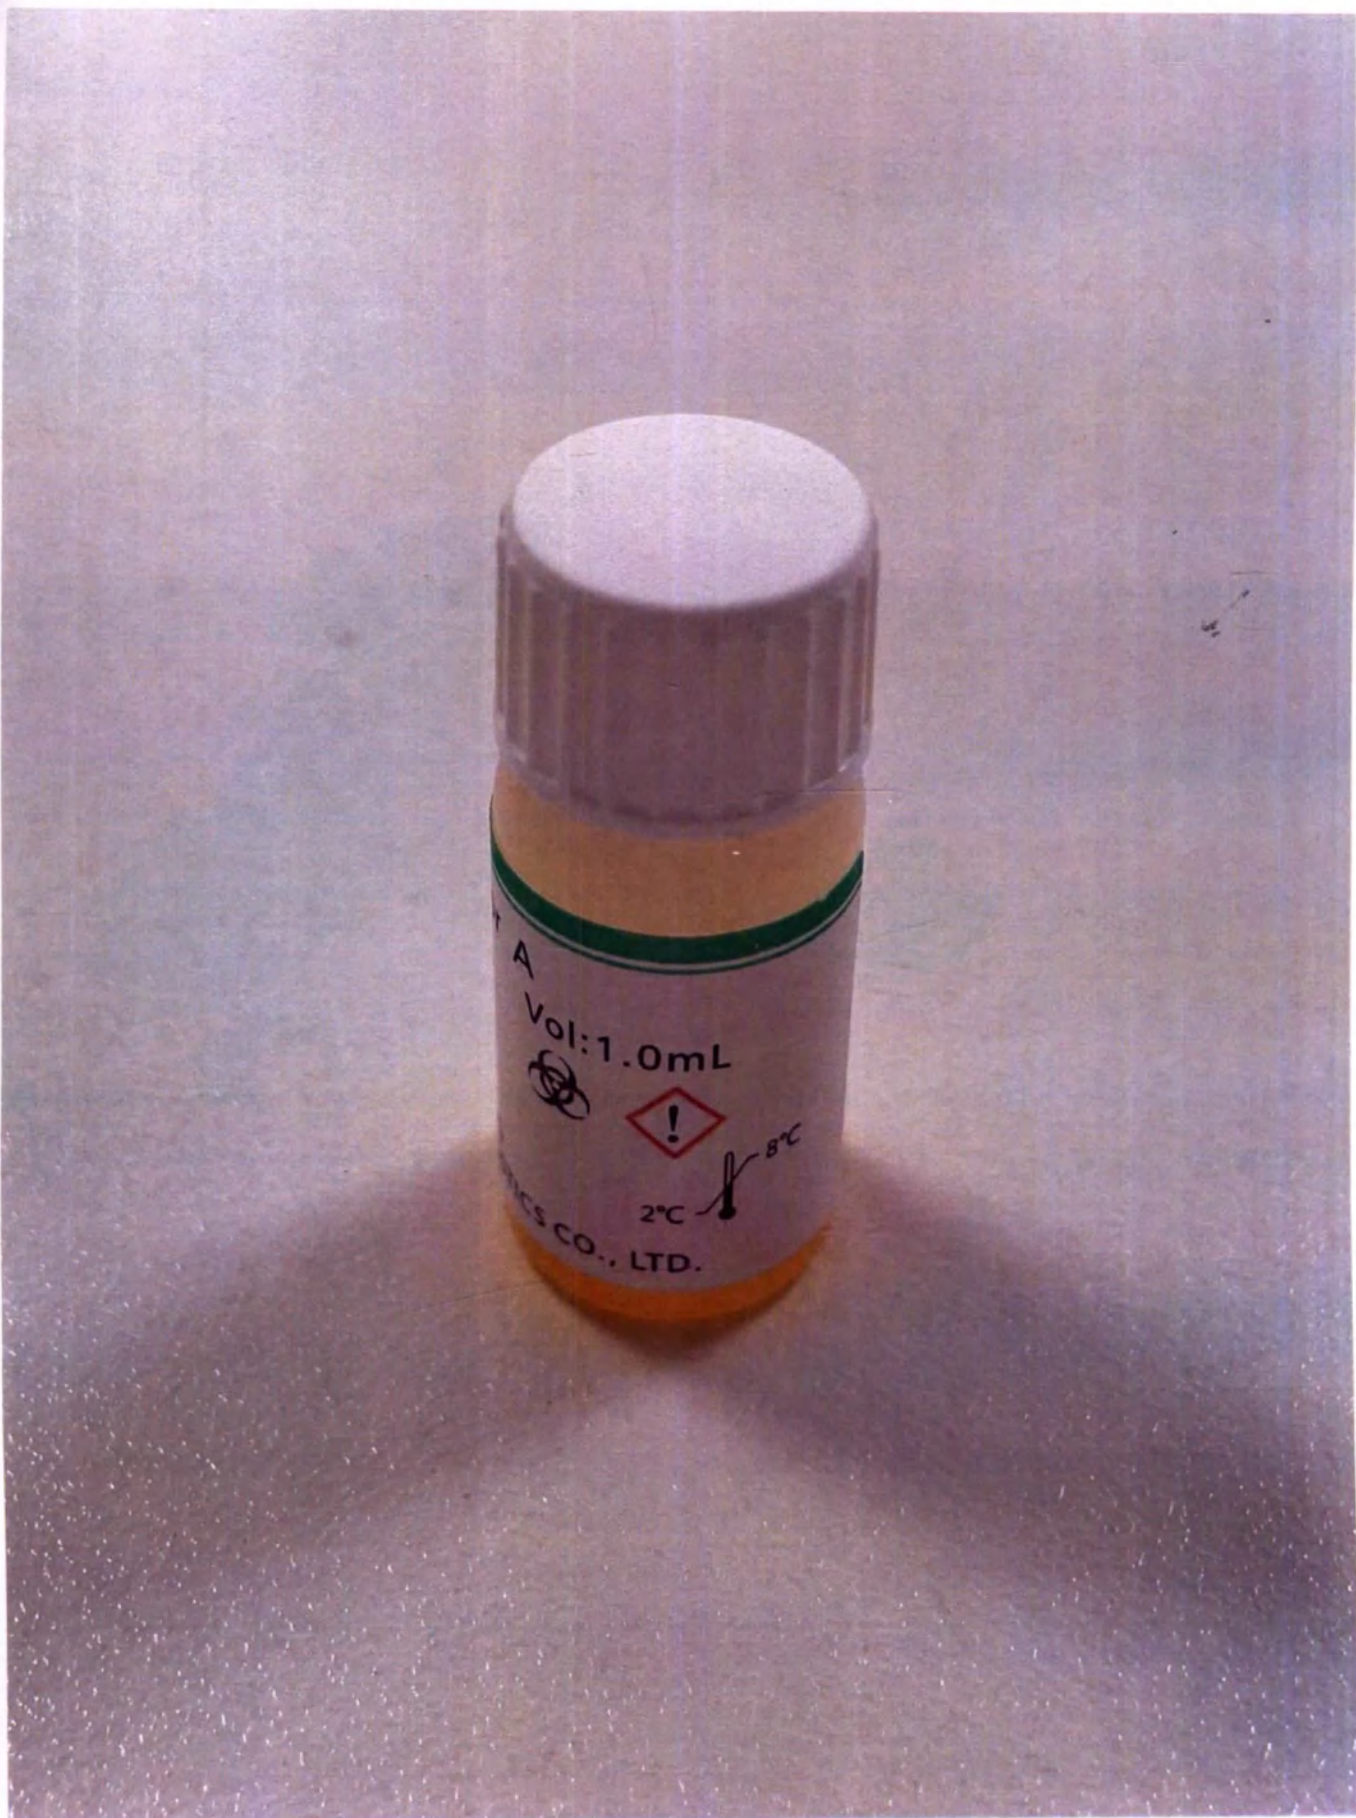


15. Фотография калибратора А (Calibrator A).




16. Фотография калибратора В (Calibrator B).

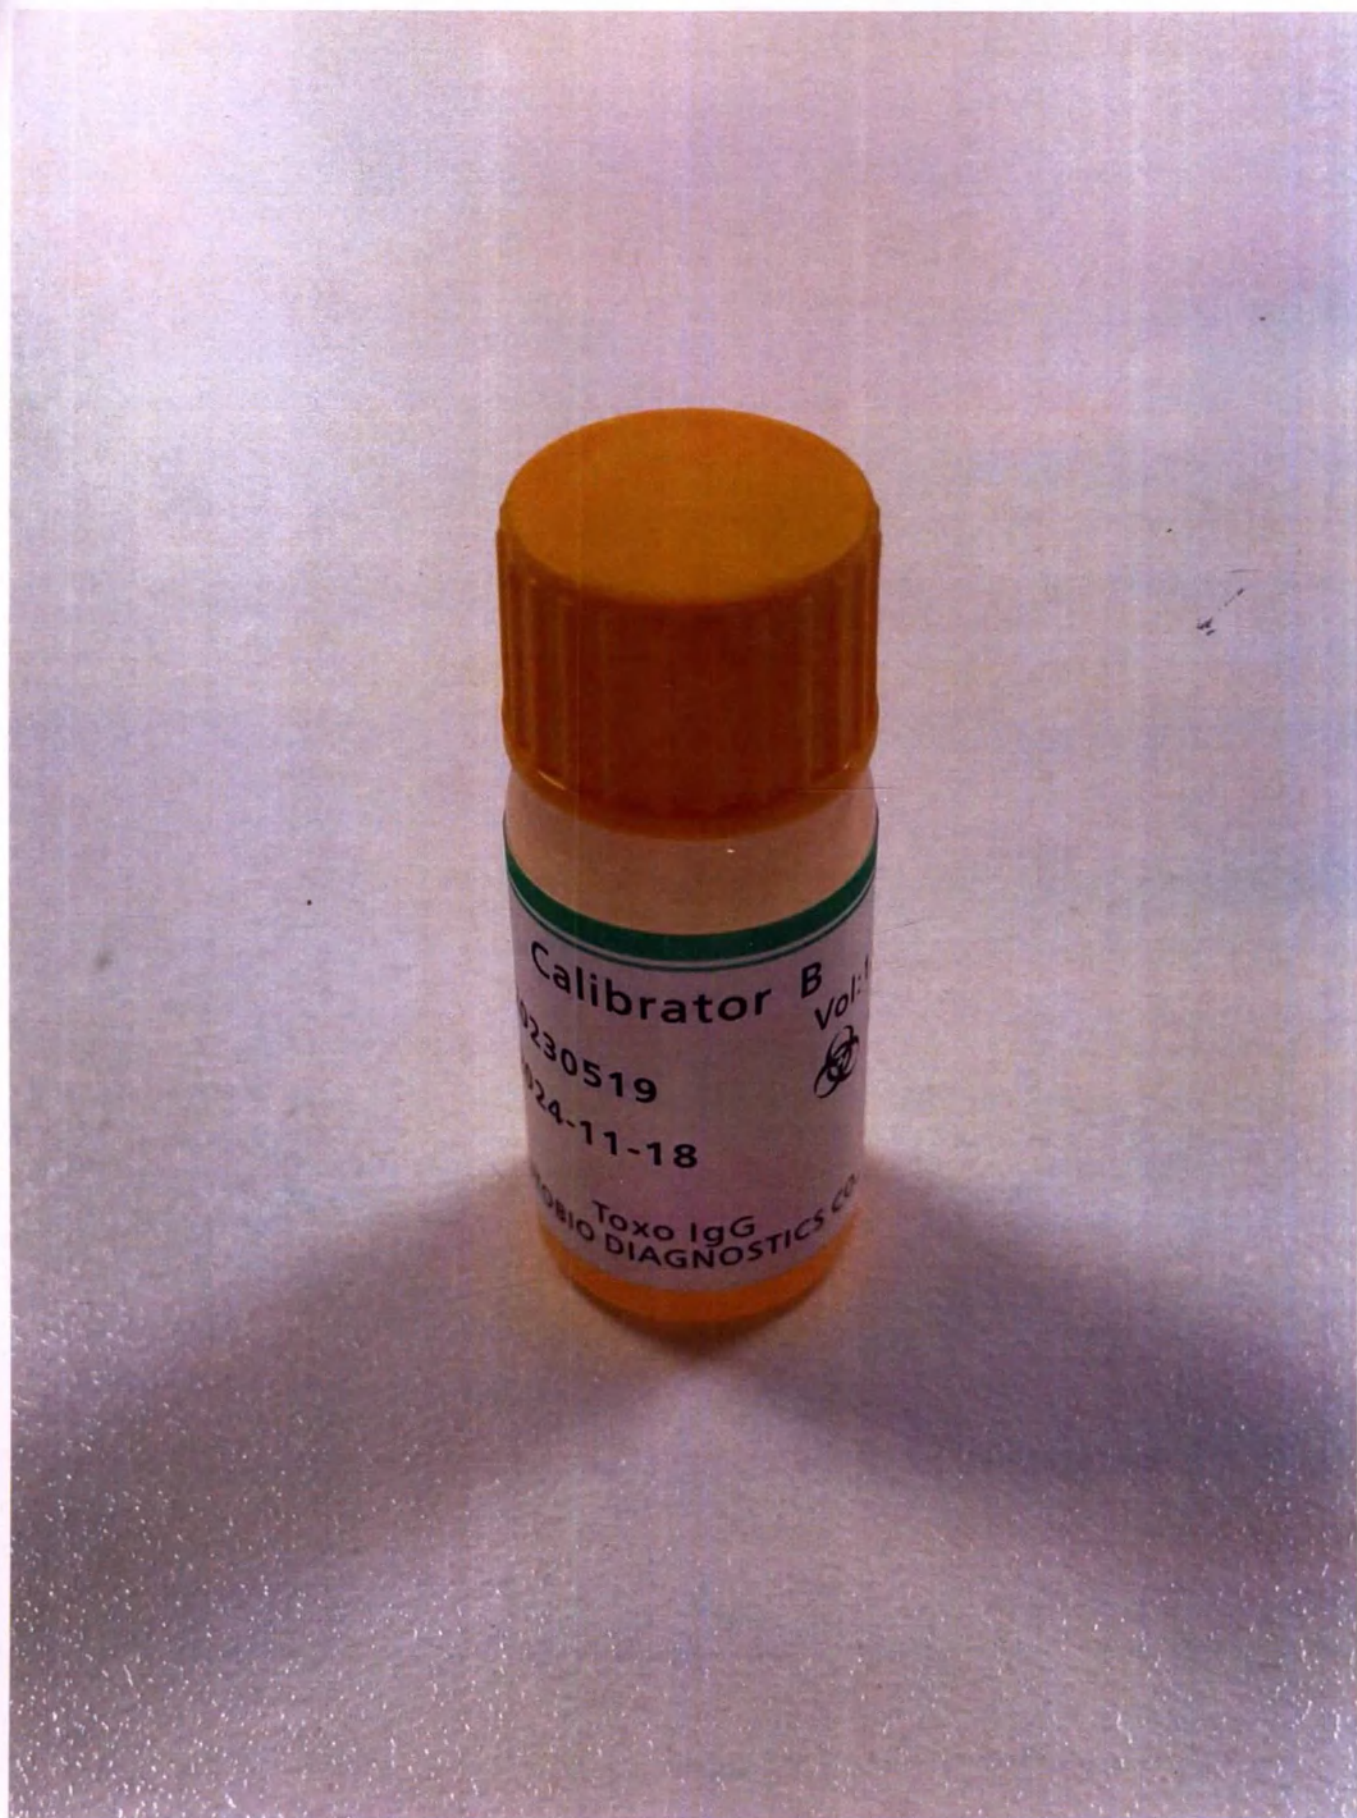


17. Фотография калибратора В (Calibrator B).

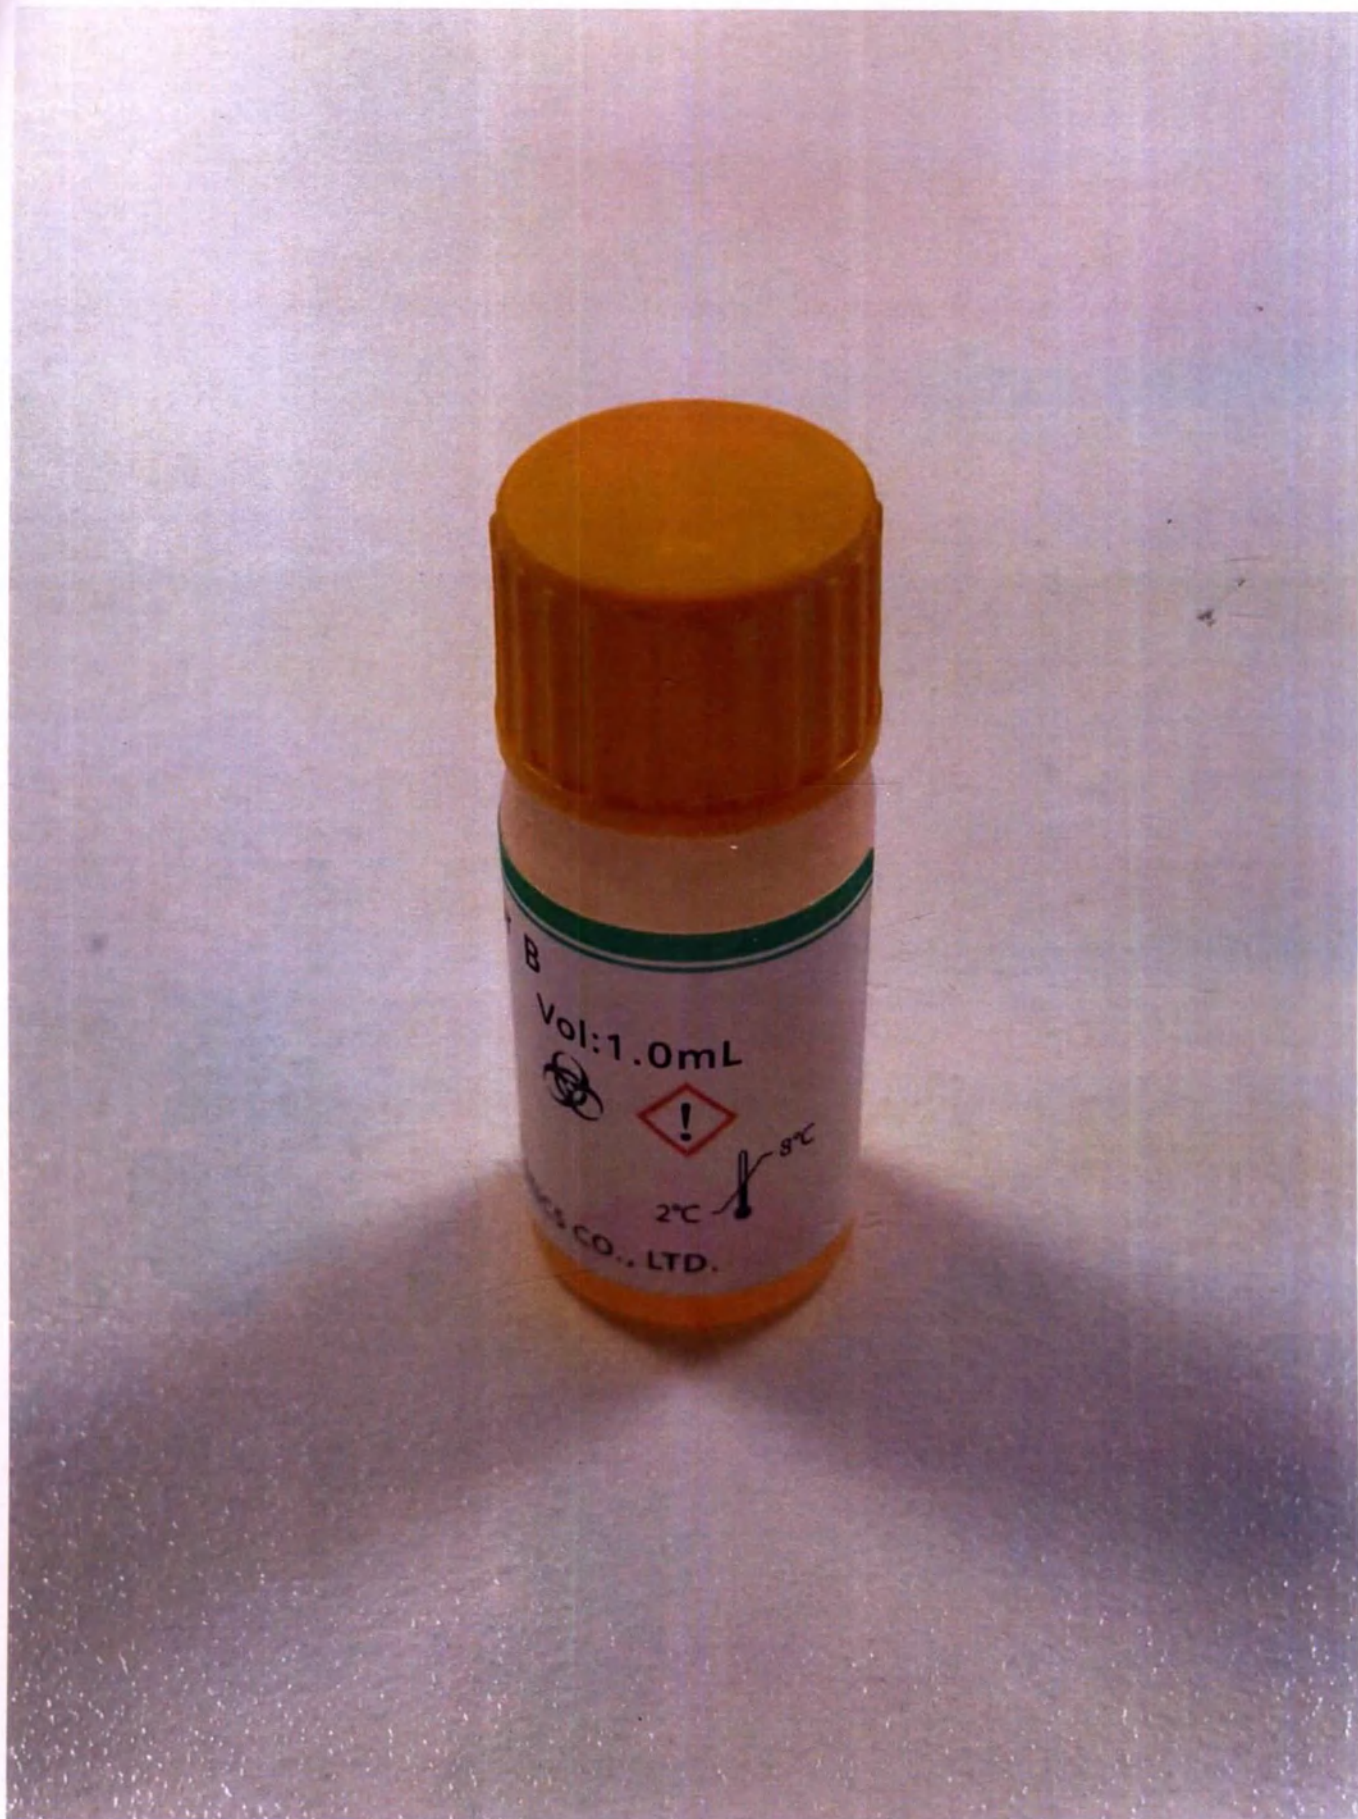


18. Фотография калибратора В (Calibrator В).

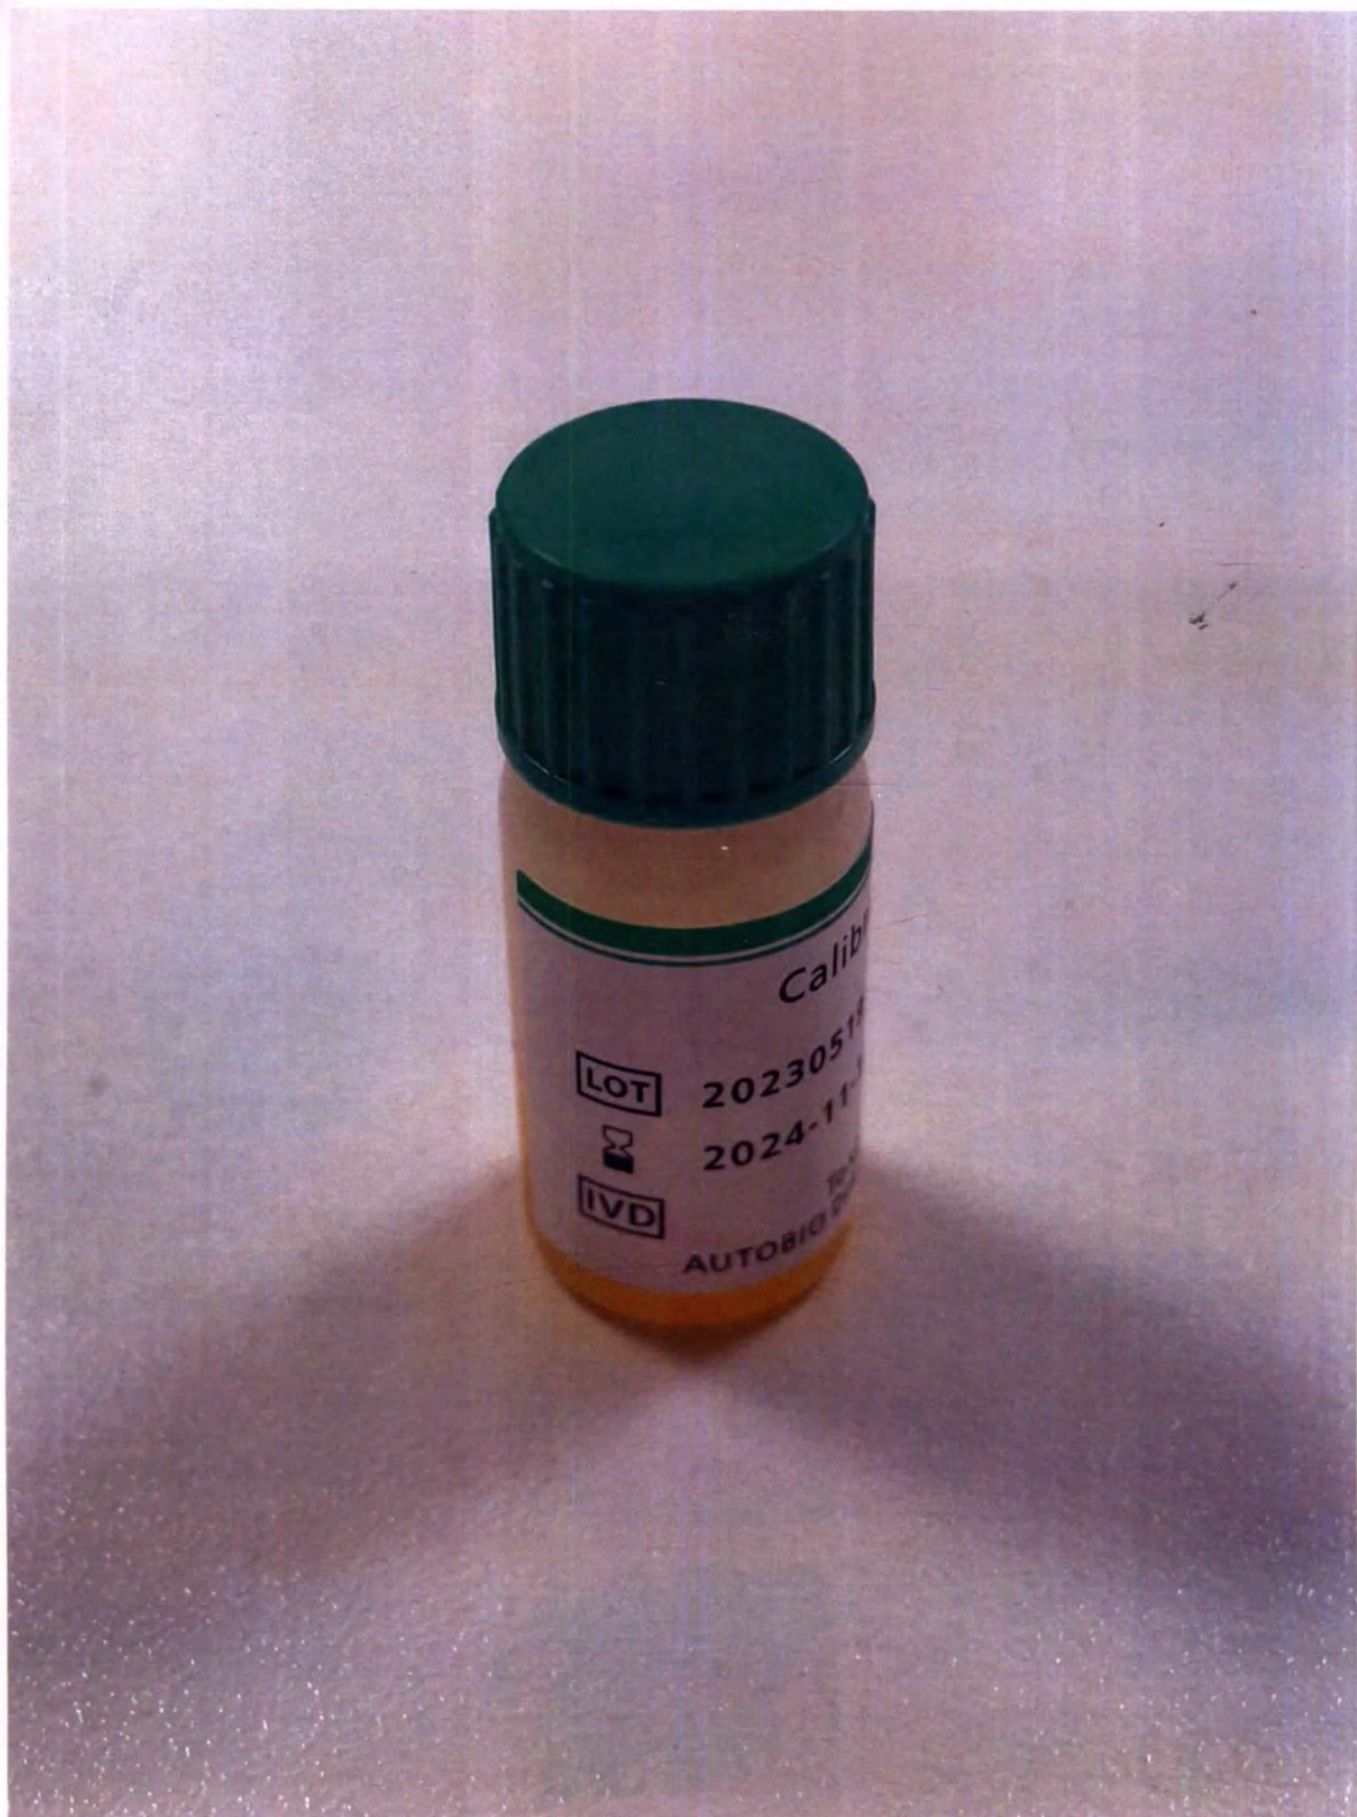


19. Фотография калибратора С (Calibrator C).

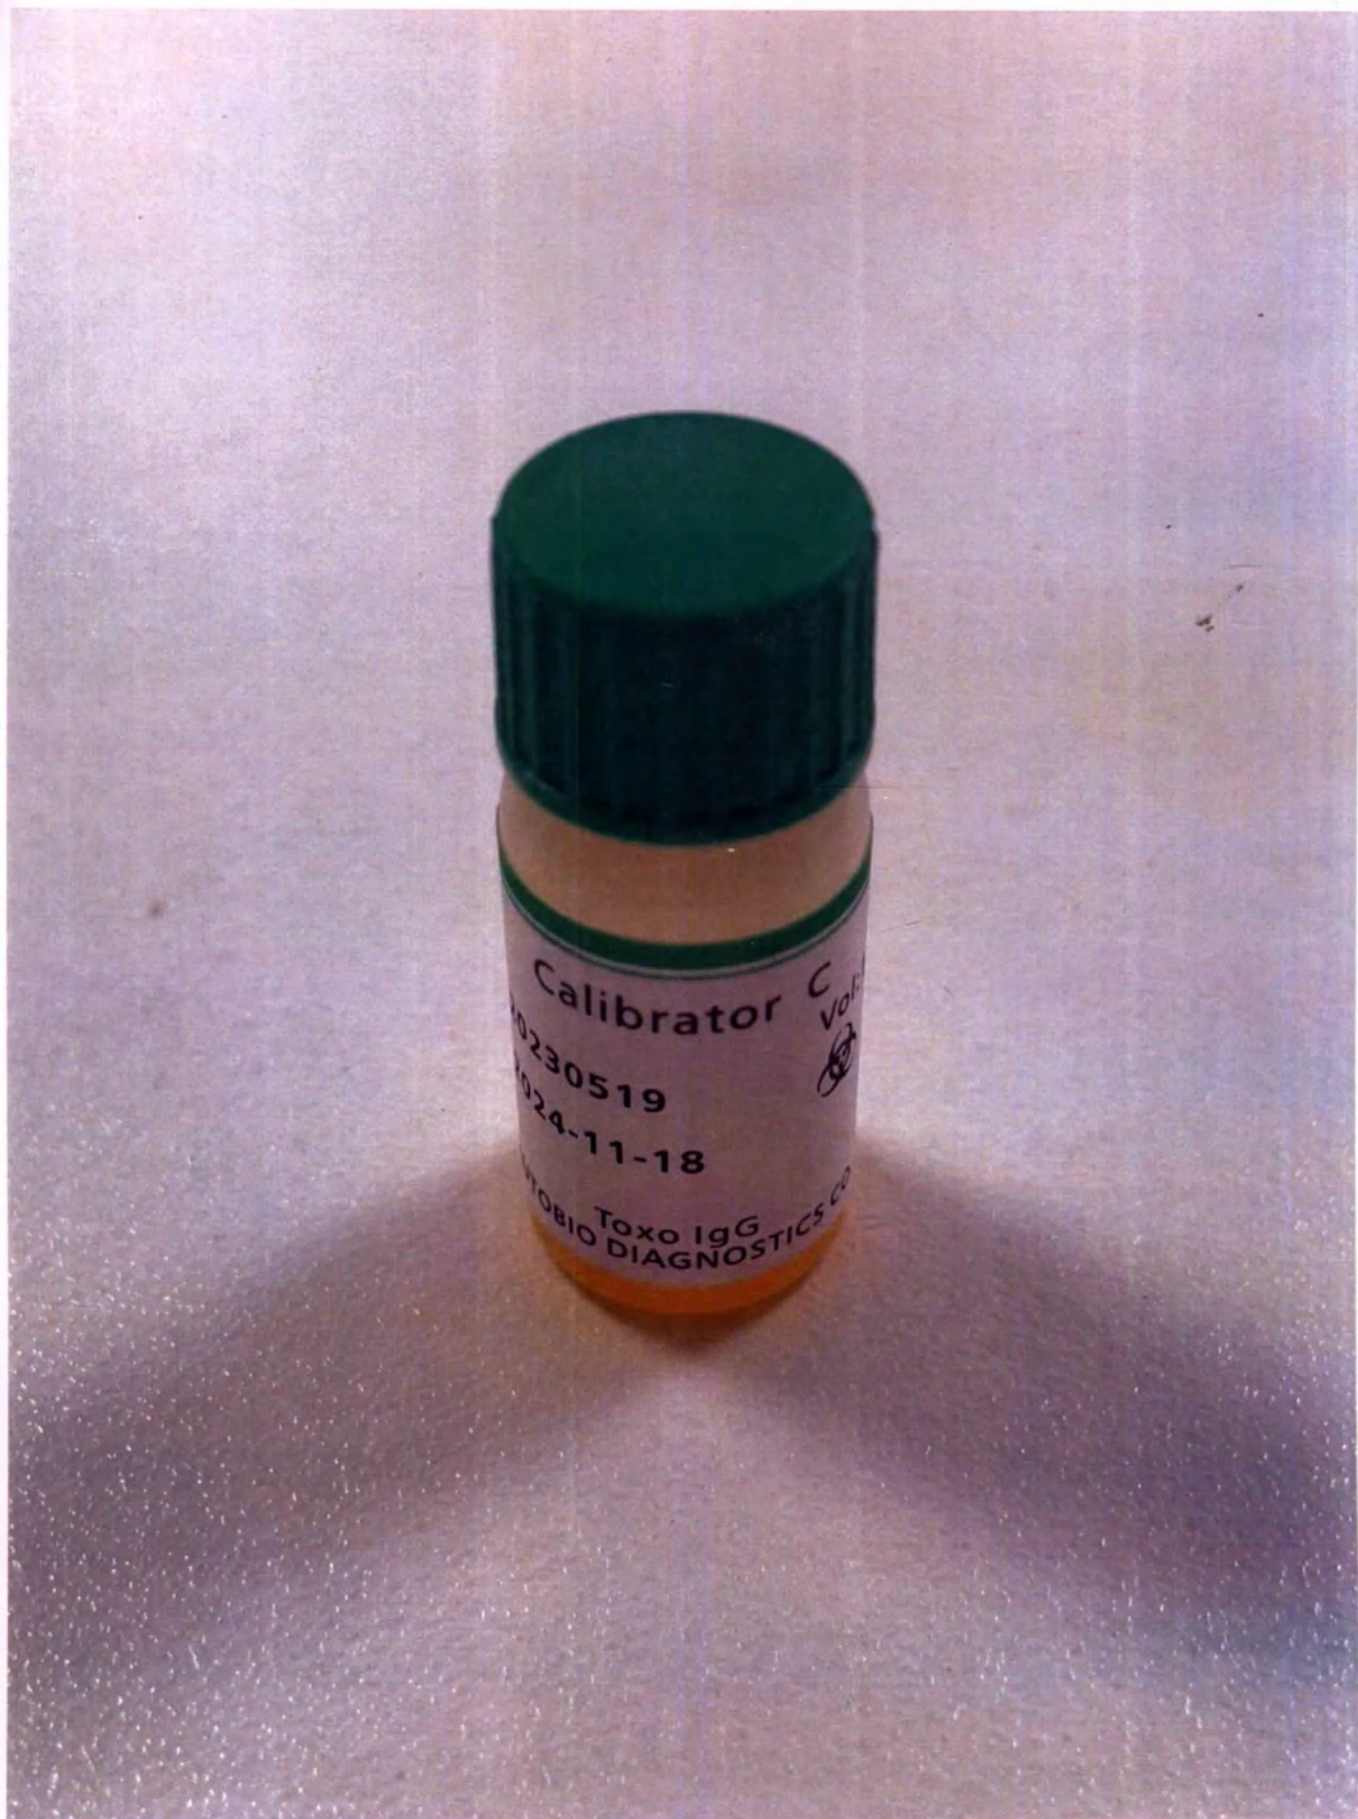


20. Фотография калибратора С (Calibrator C).

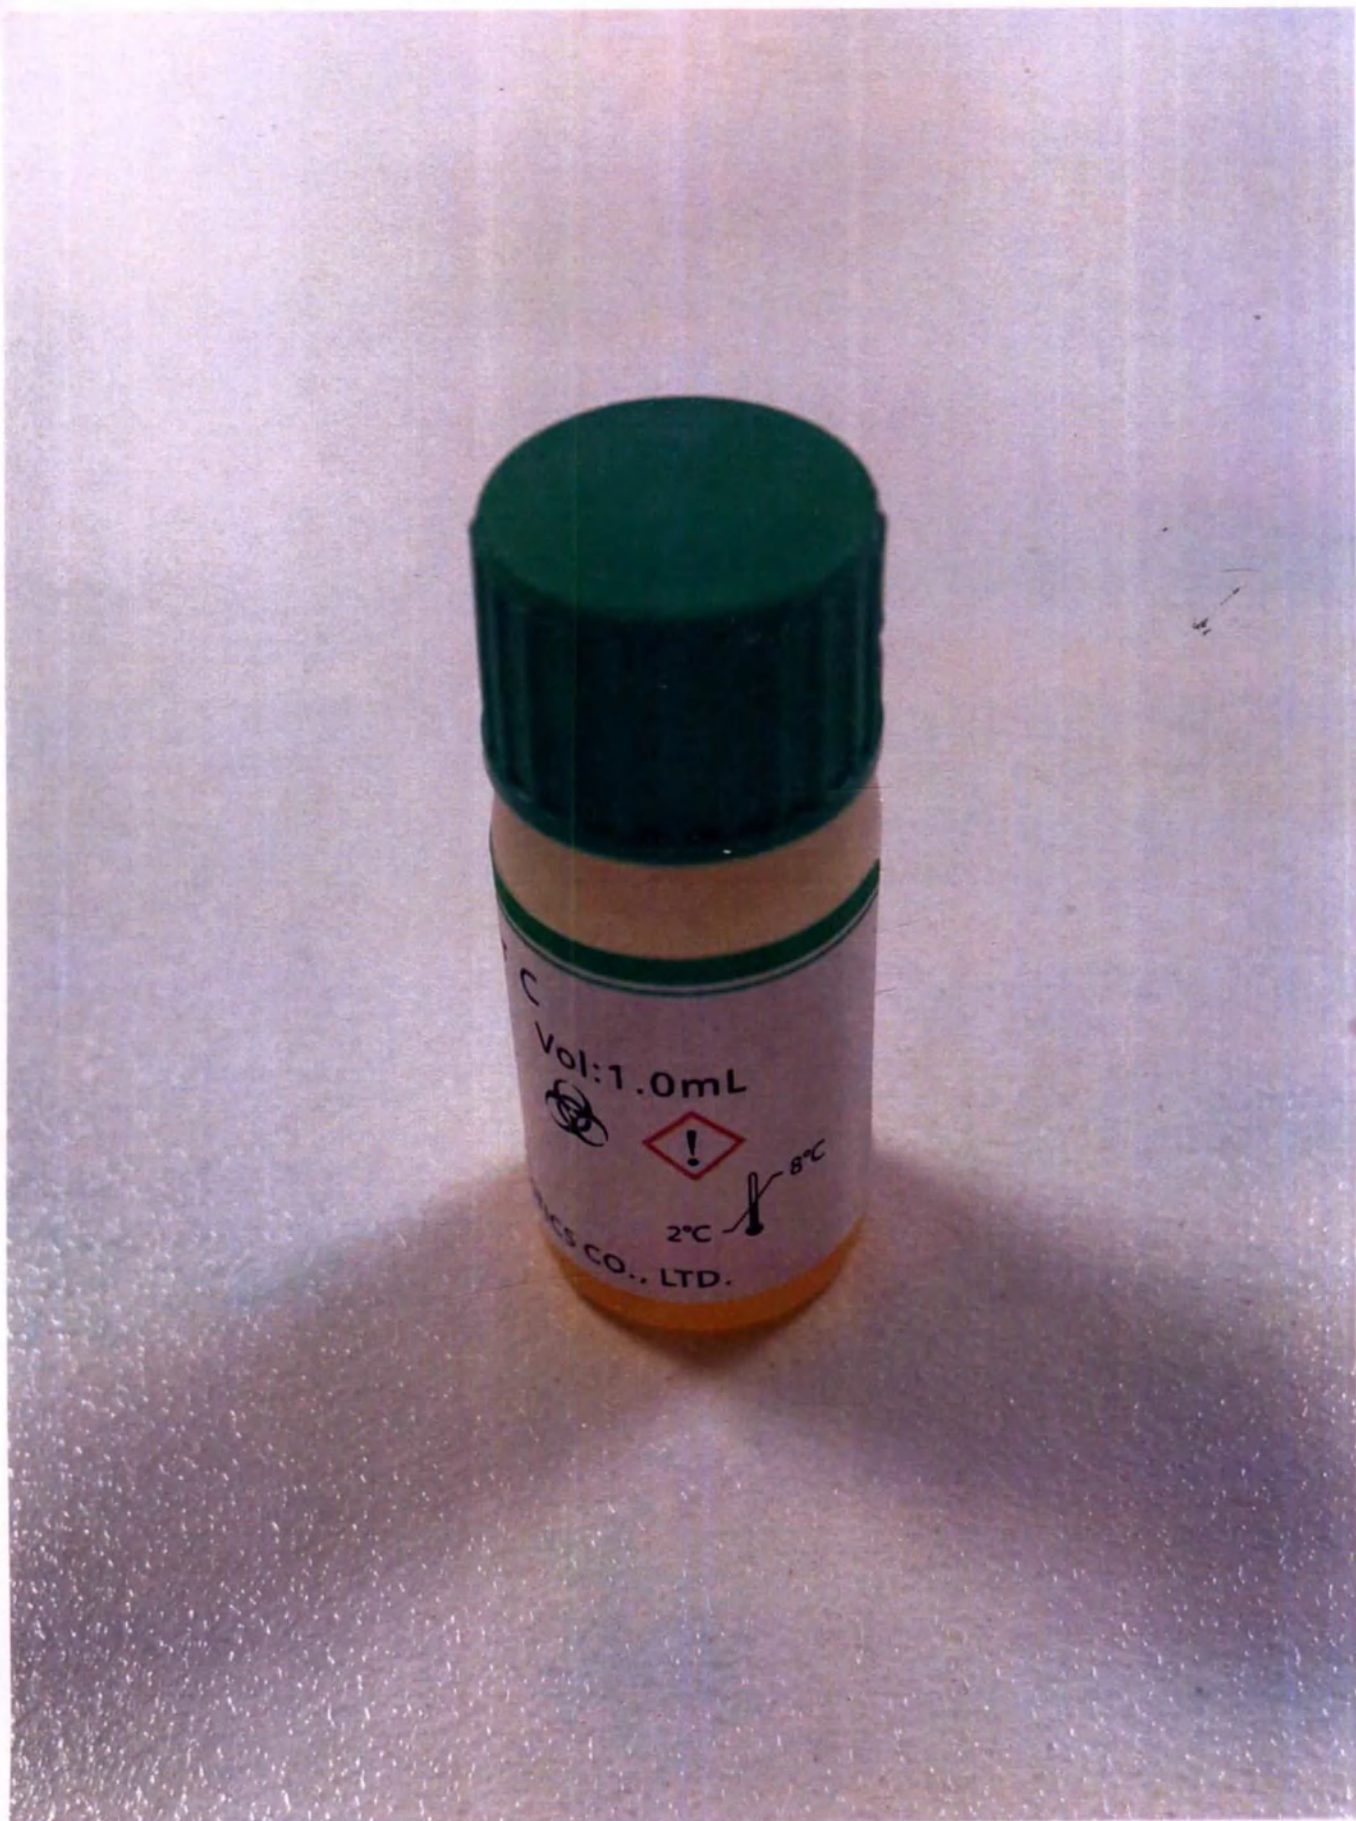


21. Фотография калибратора С (Calibrator C).

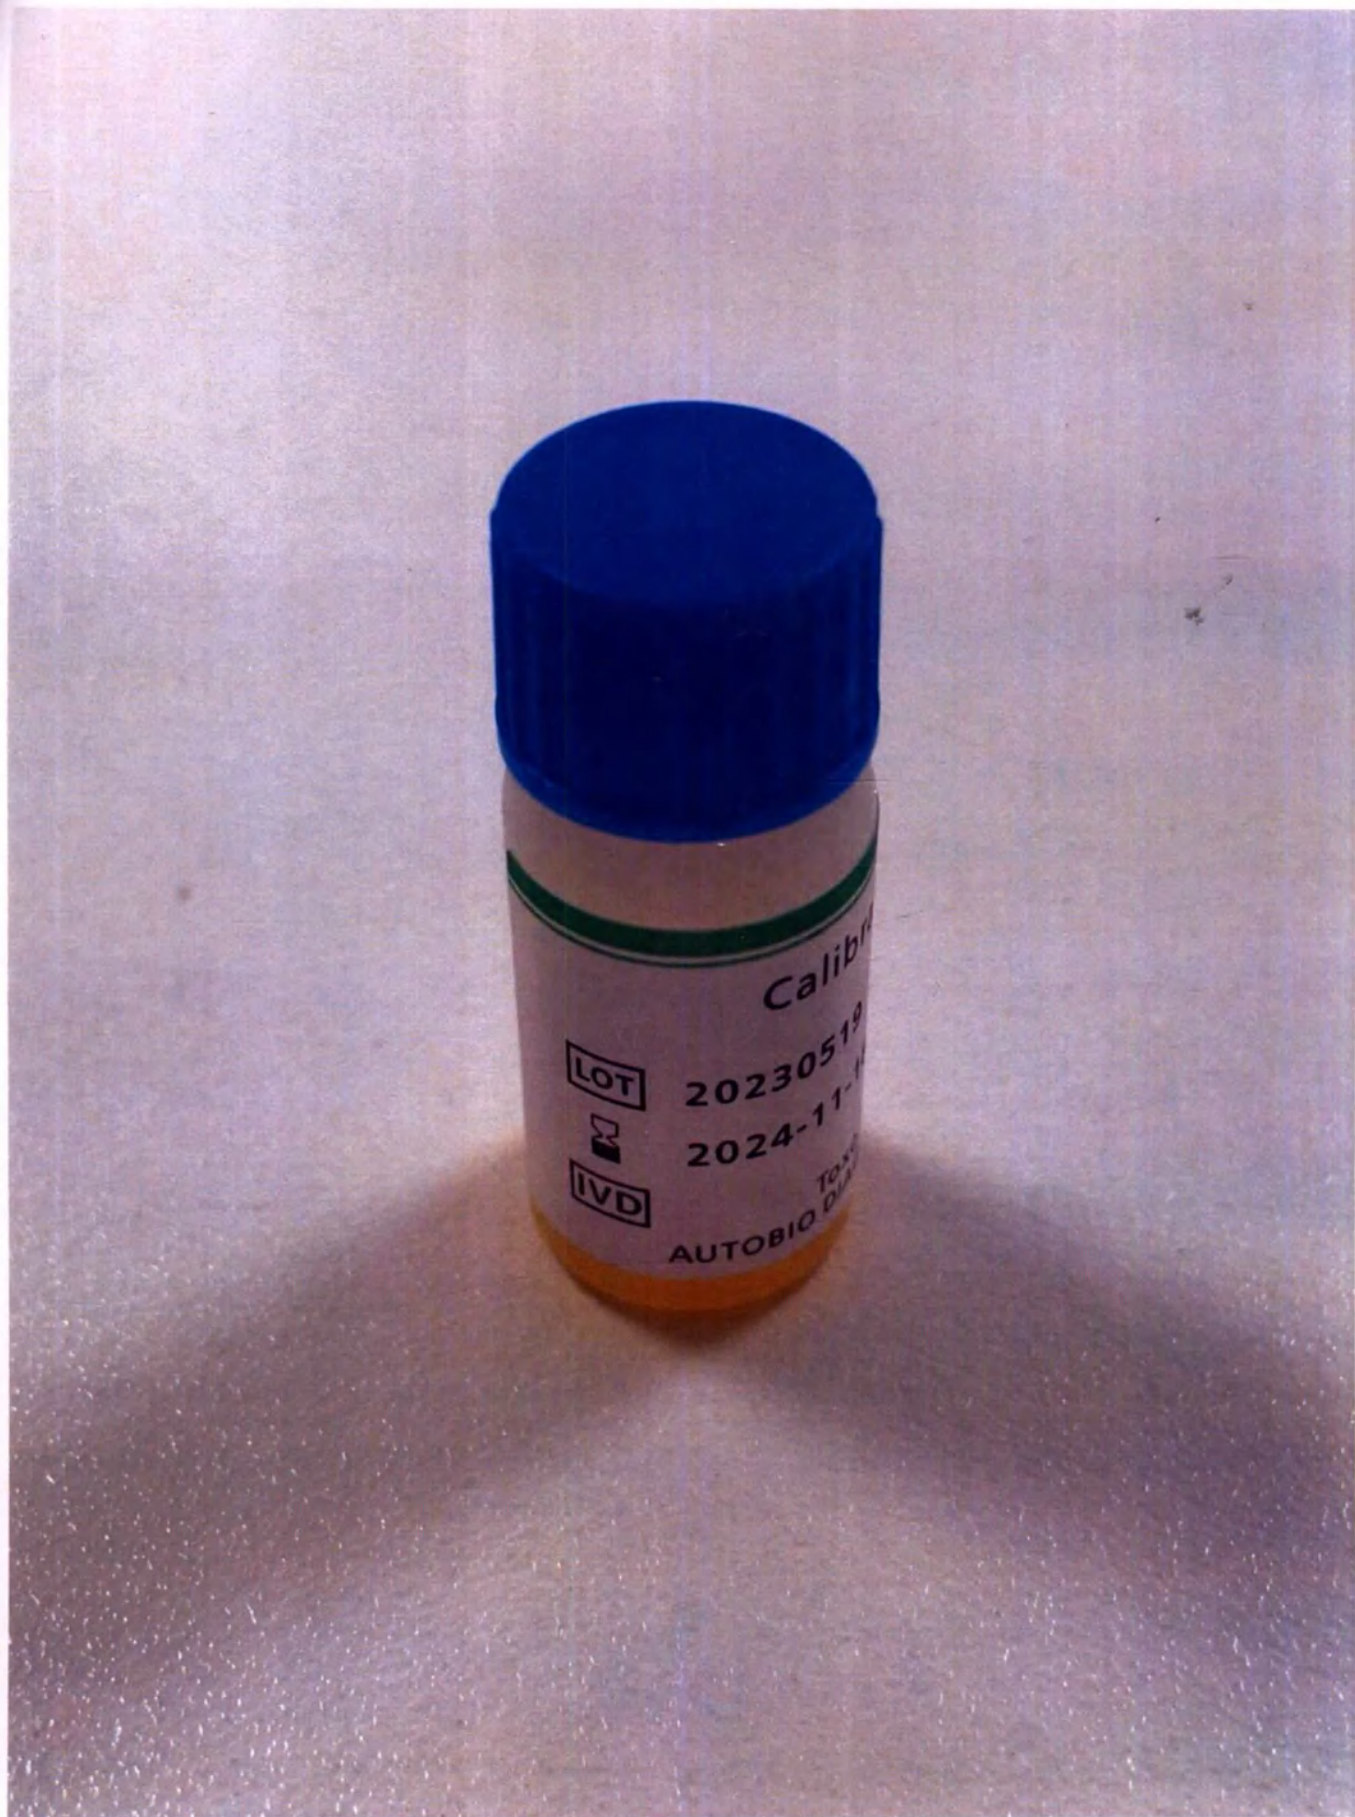


22. Фотография калибратора D (Calibrator D).

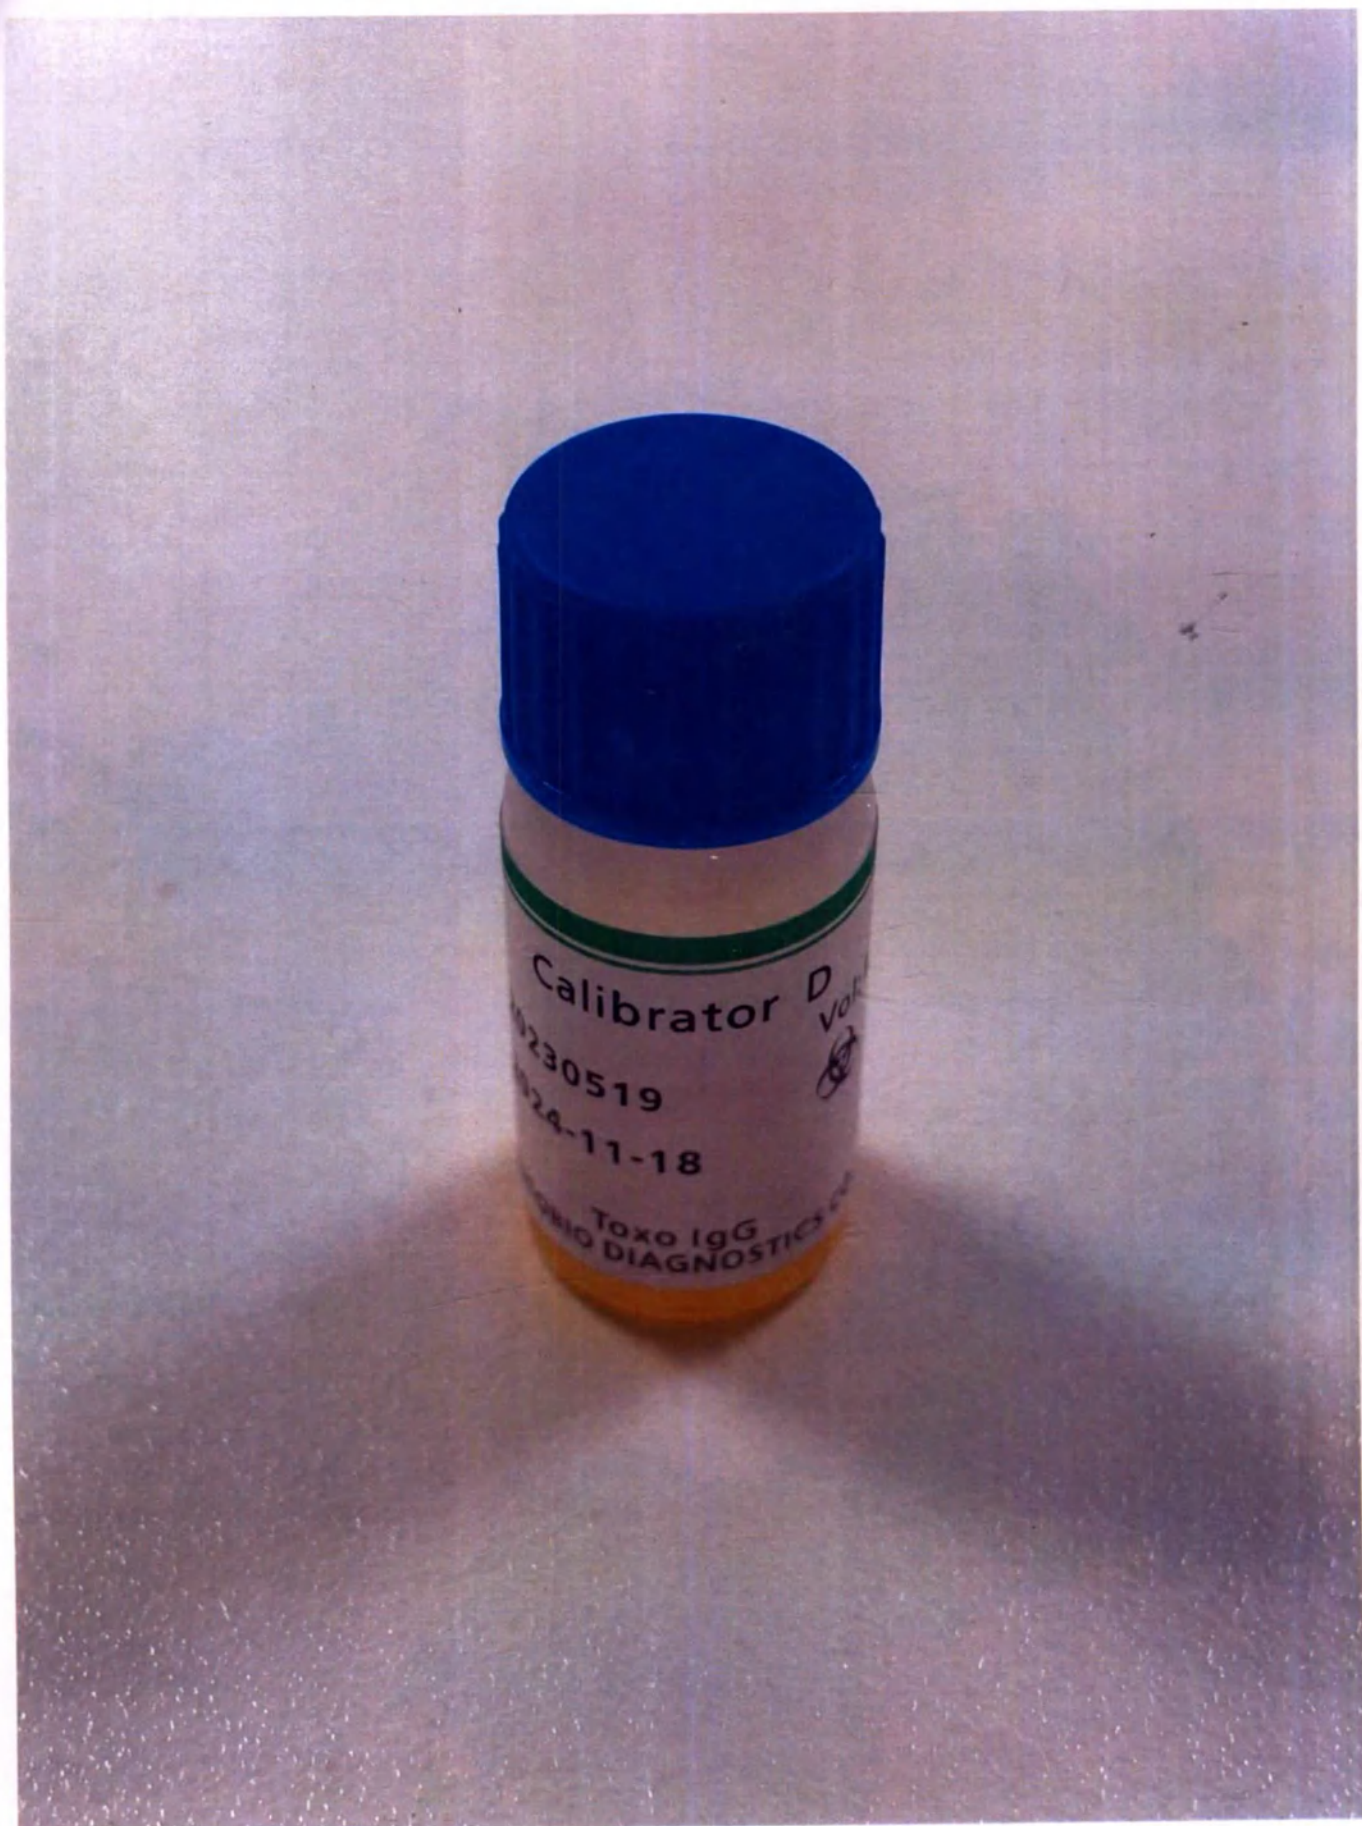

23. Фотография калибратора D (Calibrator D).

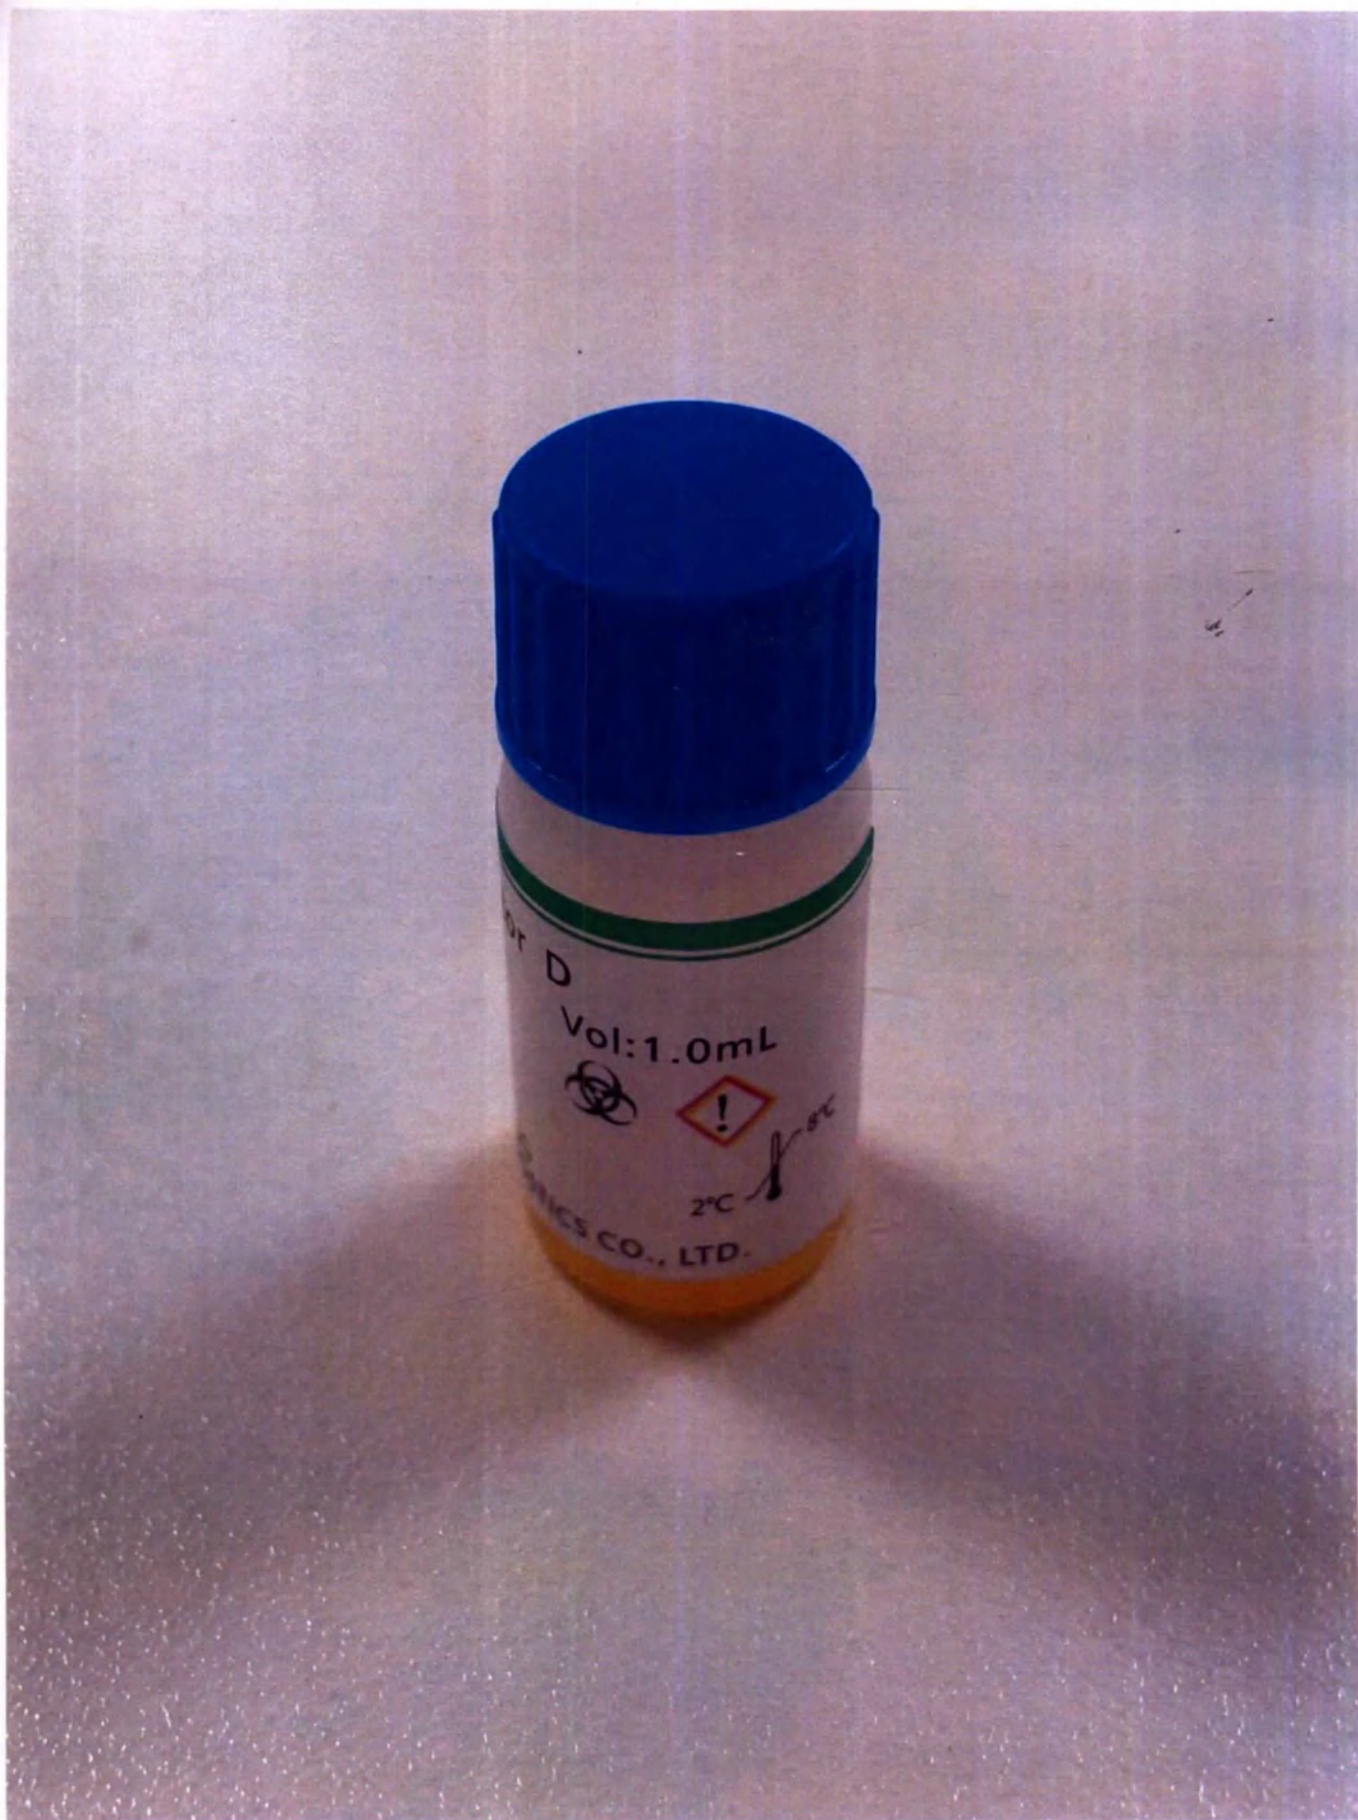

24. Фотография калибратора D (Calibrator D).

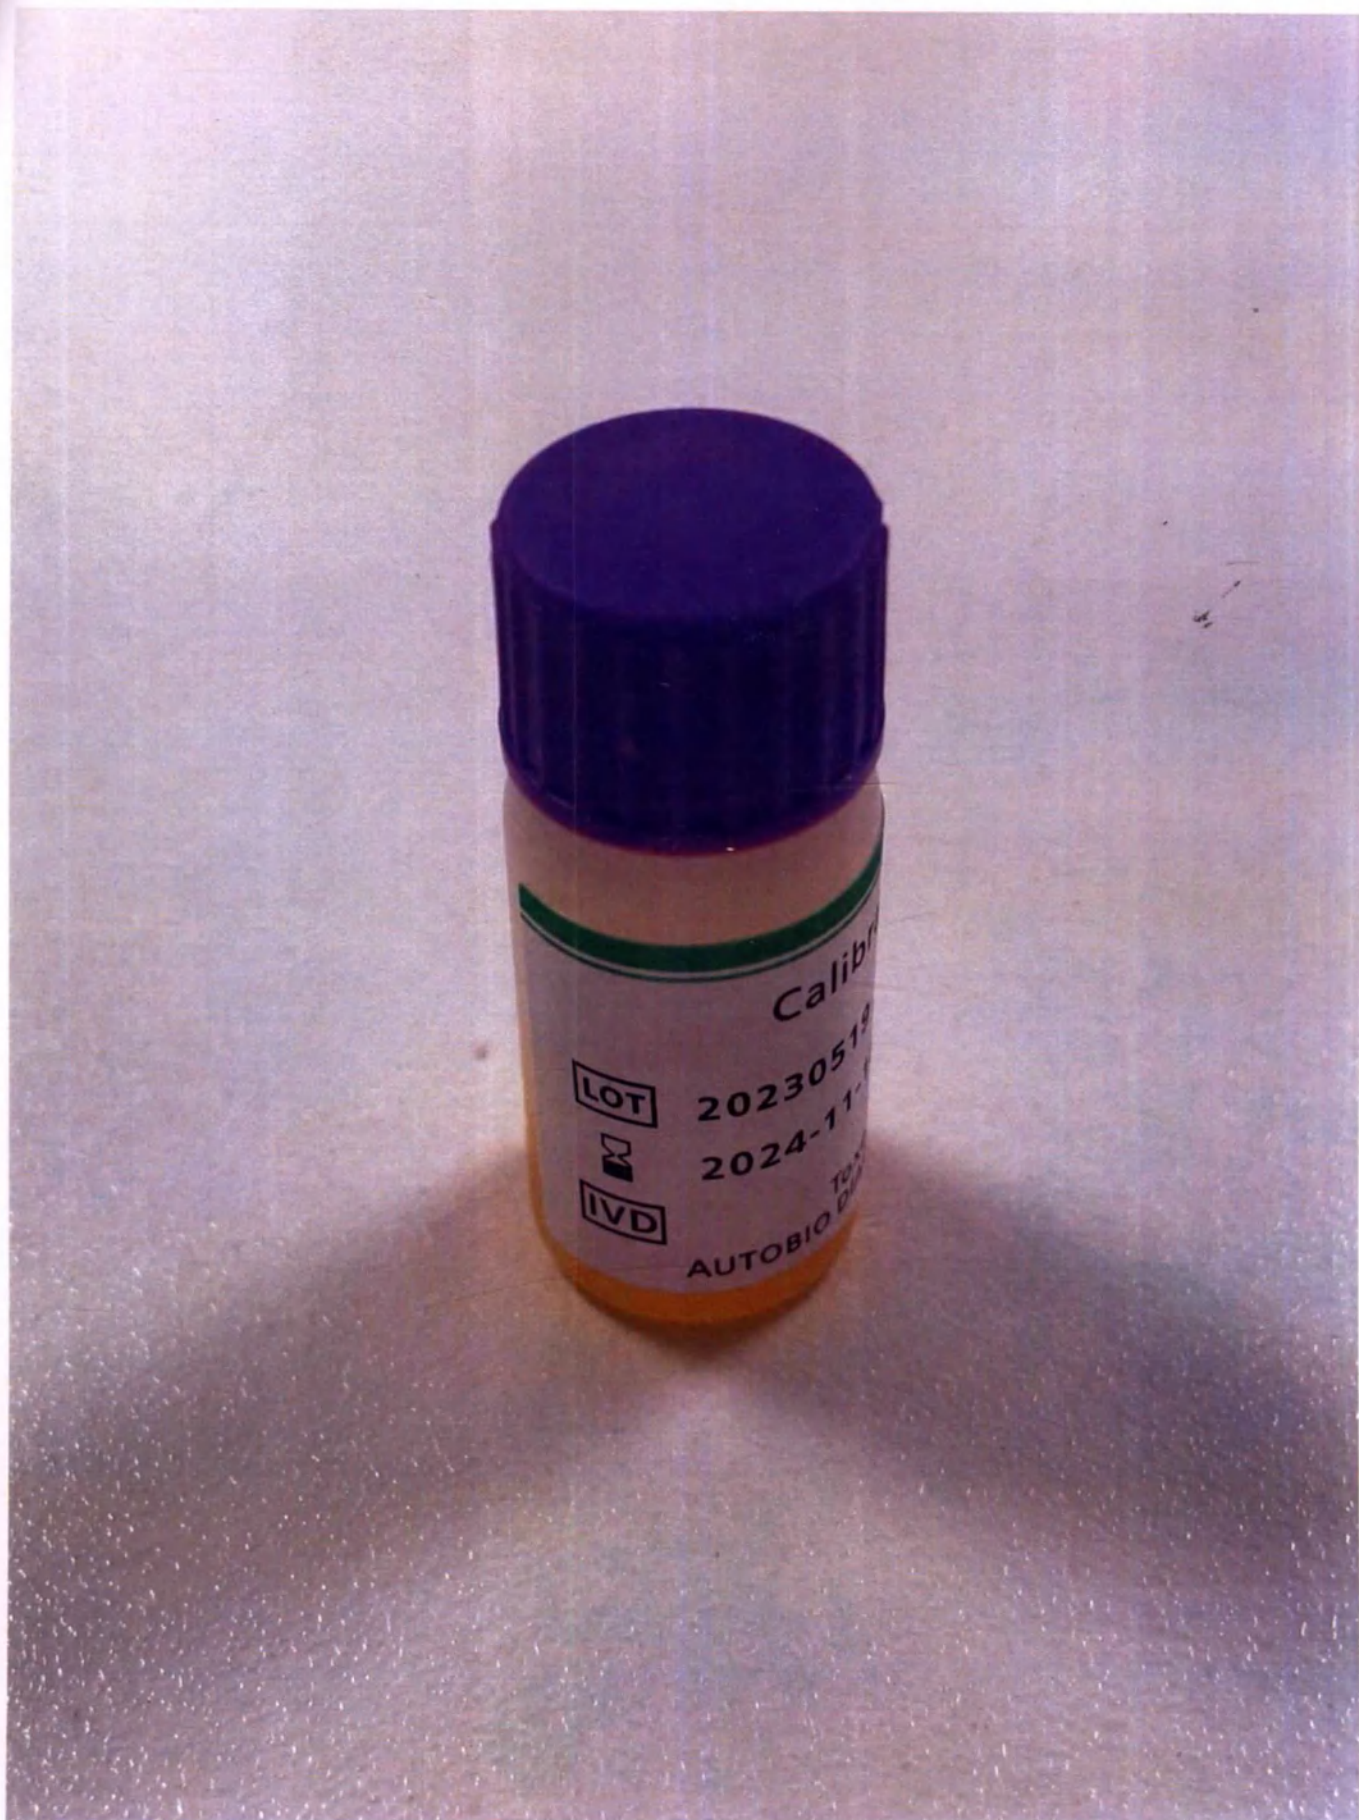


25.Фотография калибратора Е (Calibrator E).




26. Фотография калибратора Е (Calibrator E).



27. Фотография калибратора E (Calibrator E).

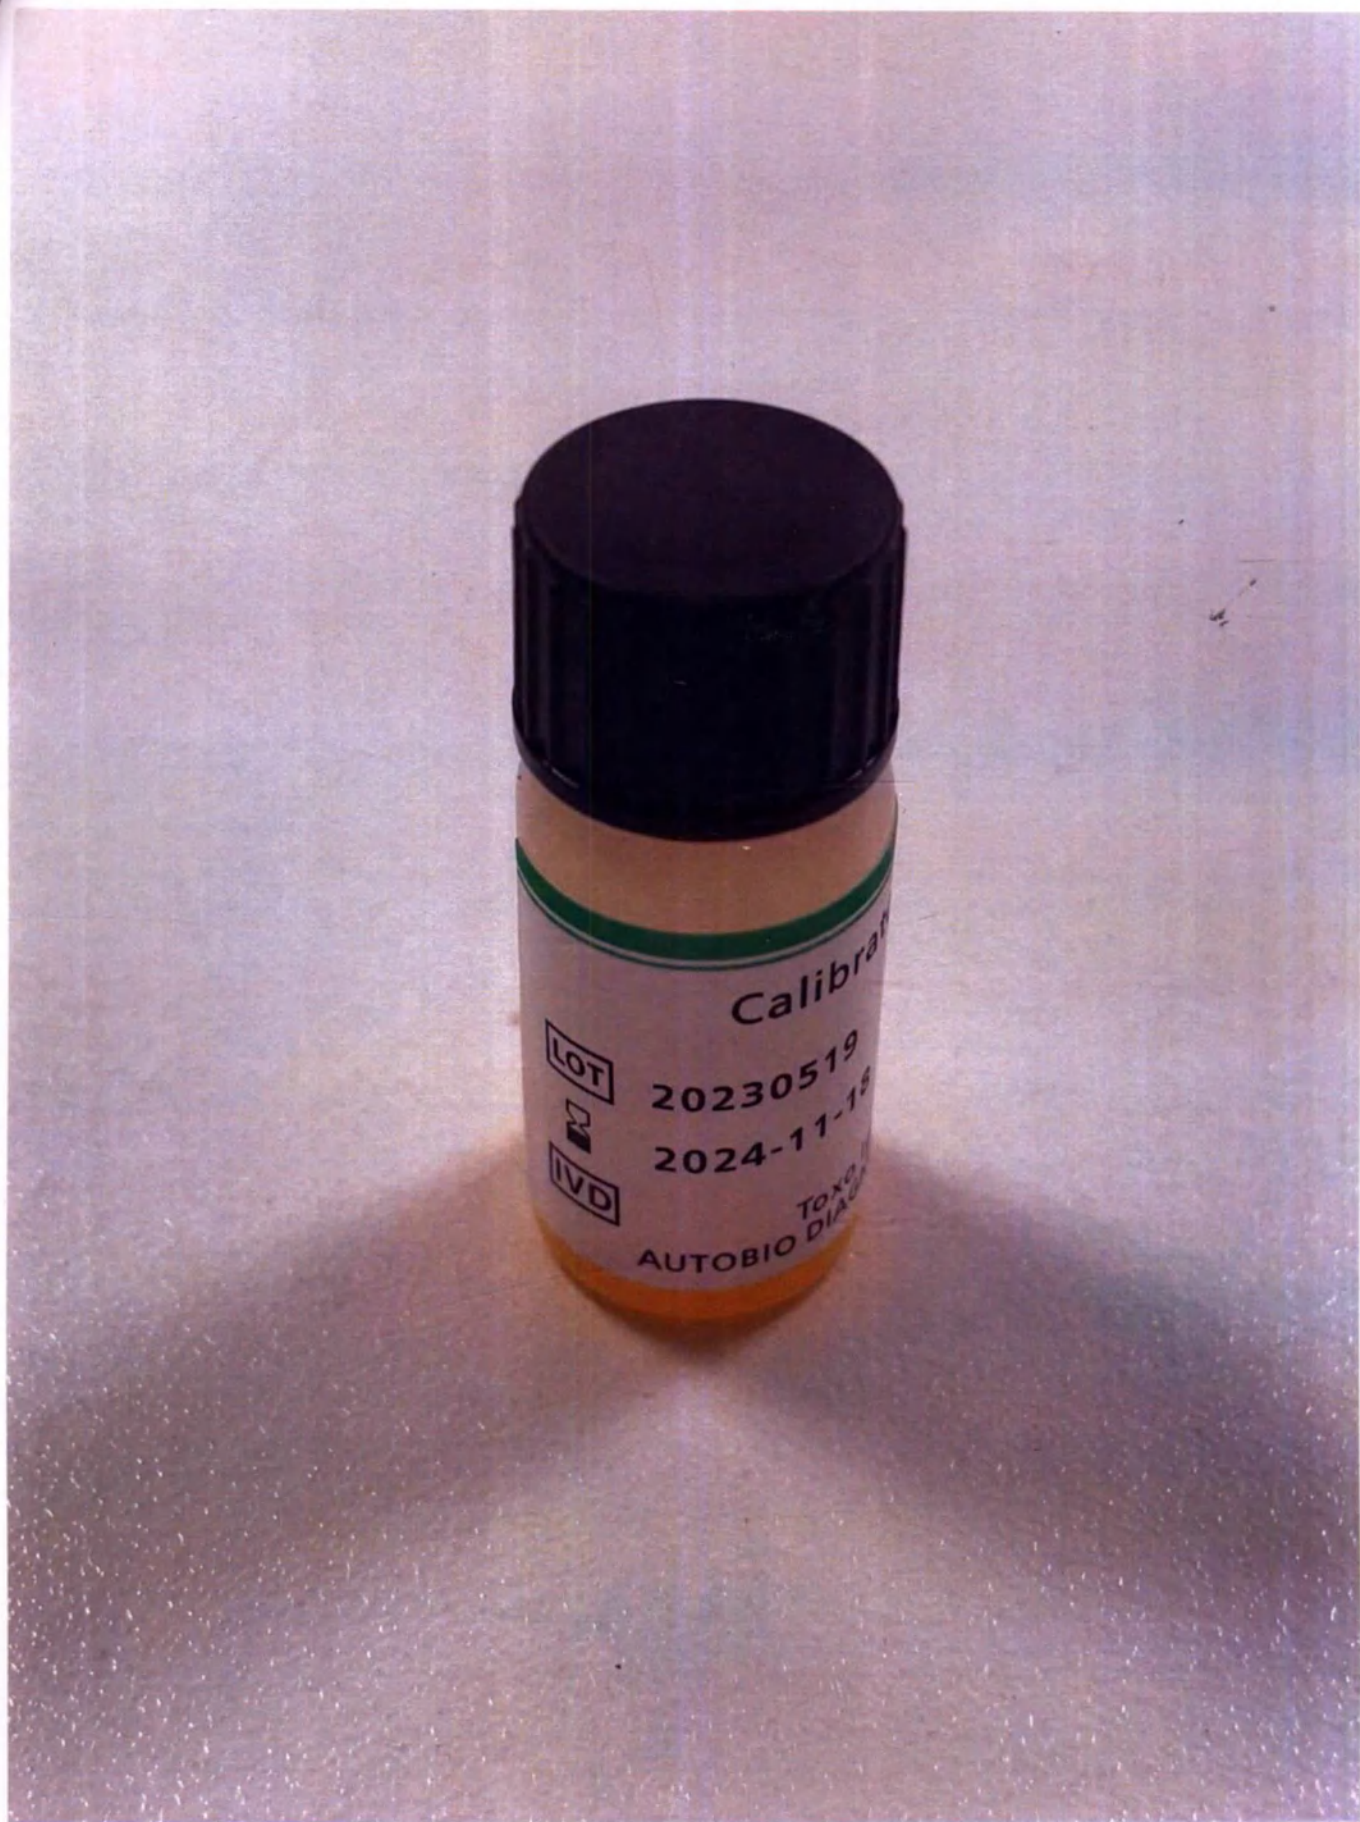


28.Фотография калибратора F (Calibrator F).

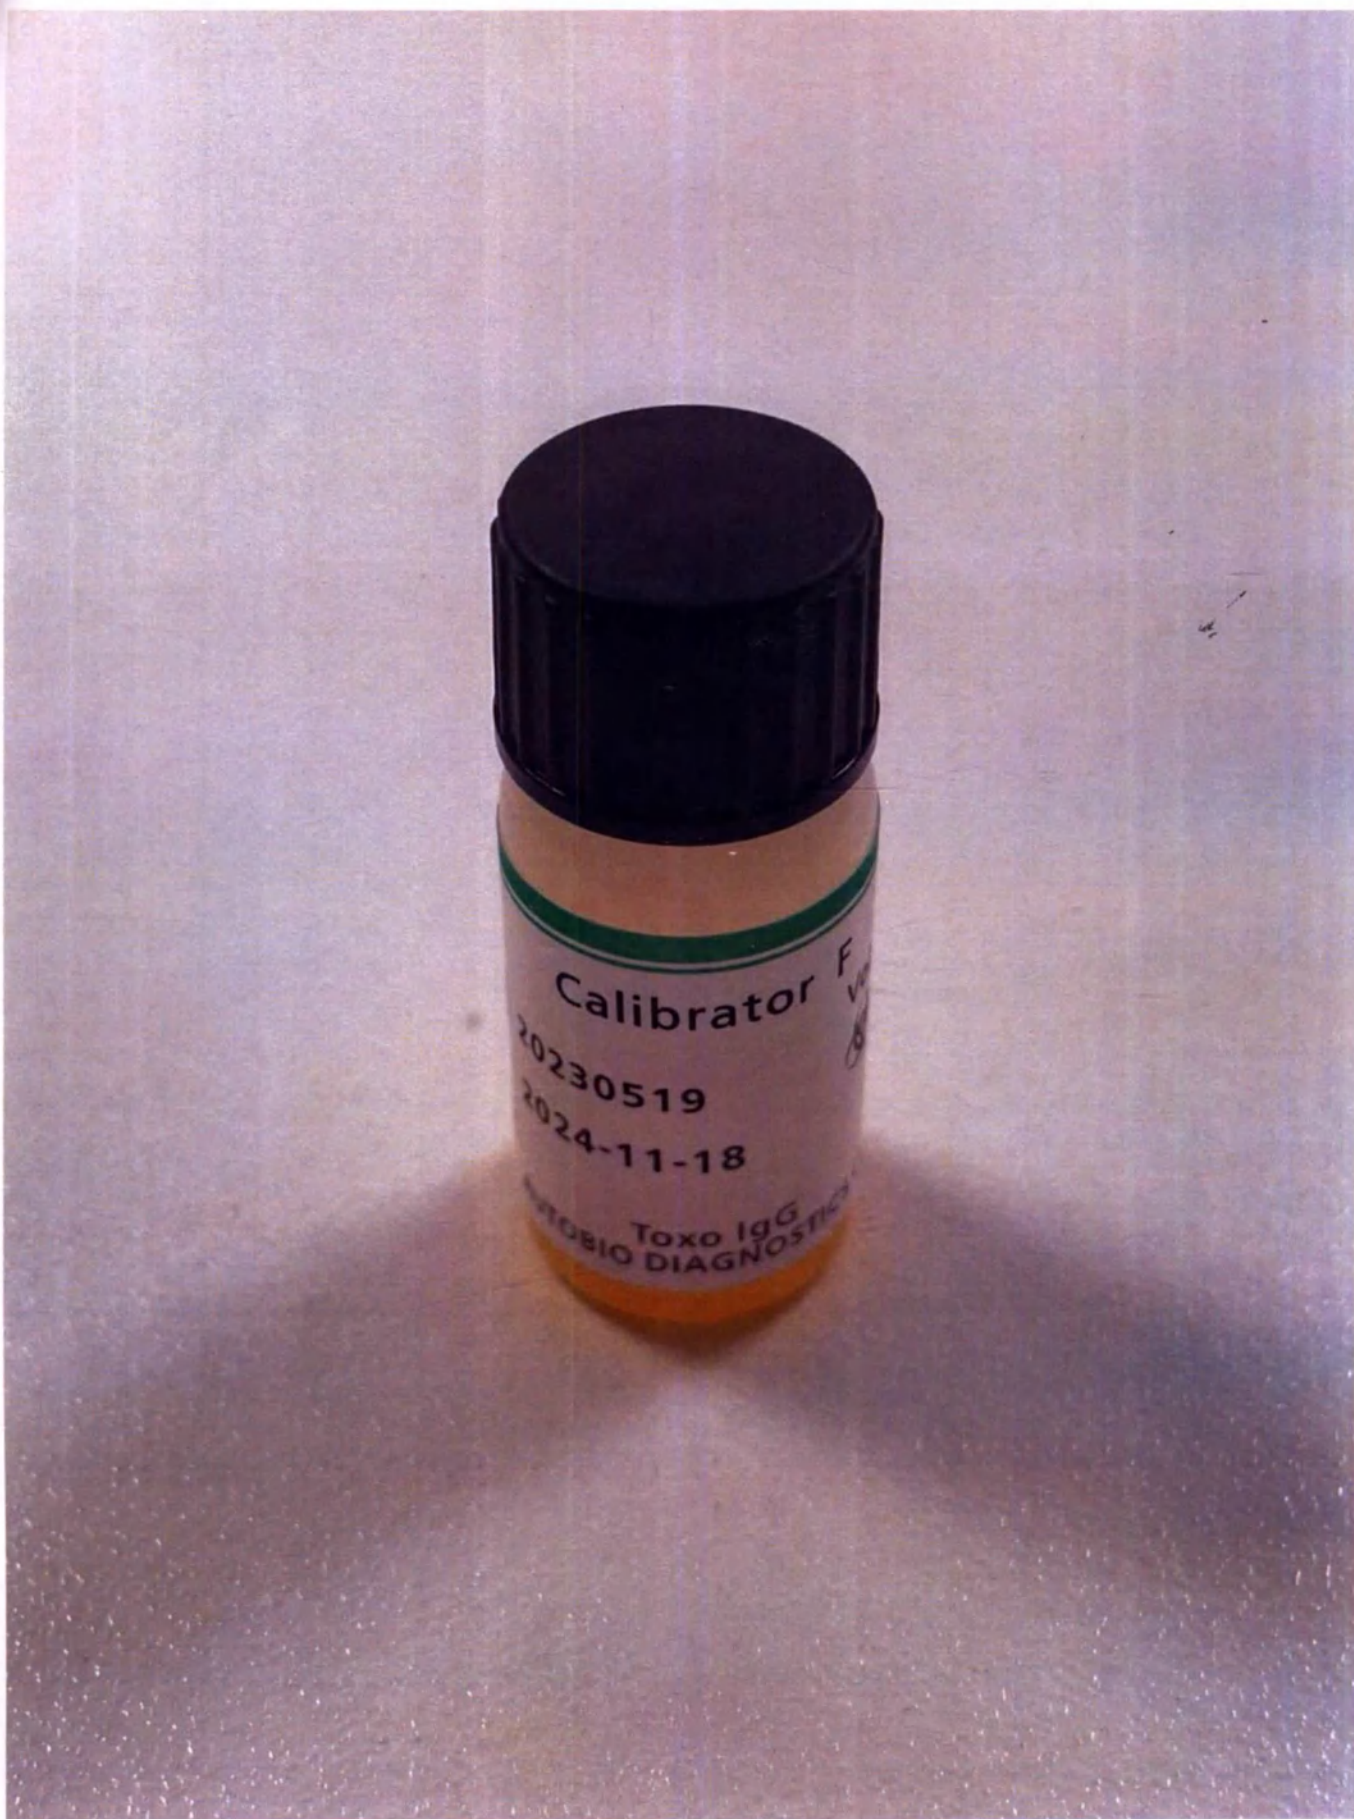


29. Фотография калибратора F (Calibrator F).



30. Фотография калибратора F (Calibrator F).

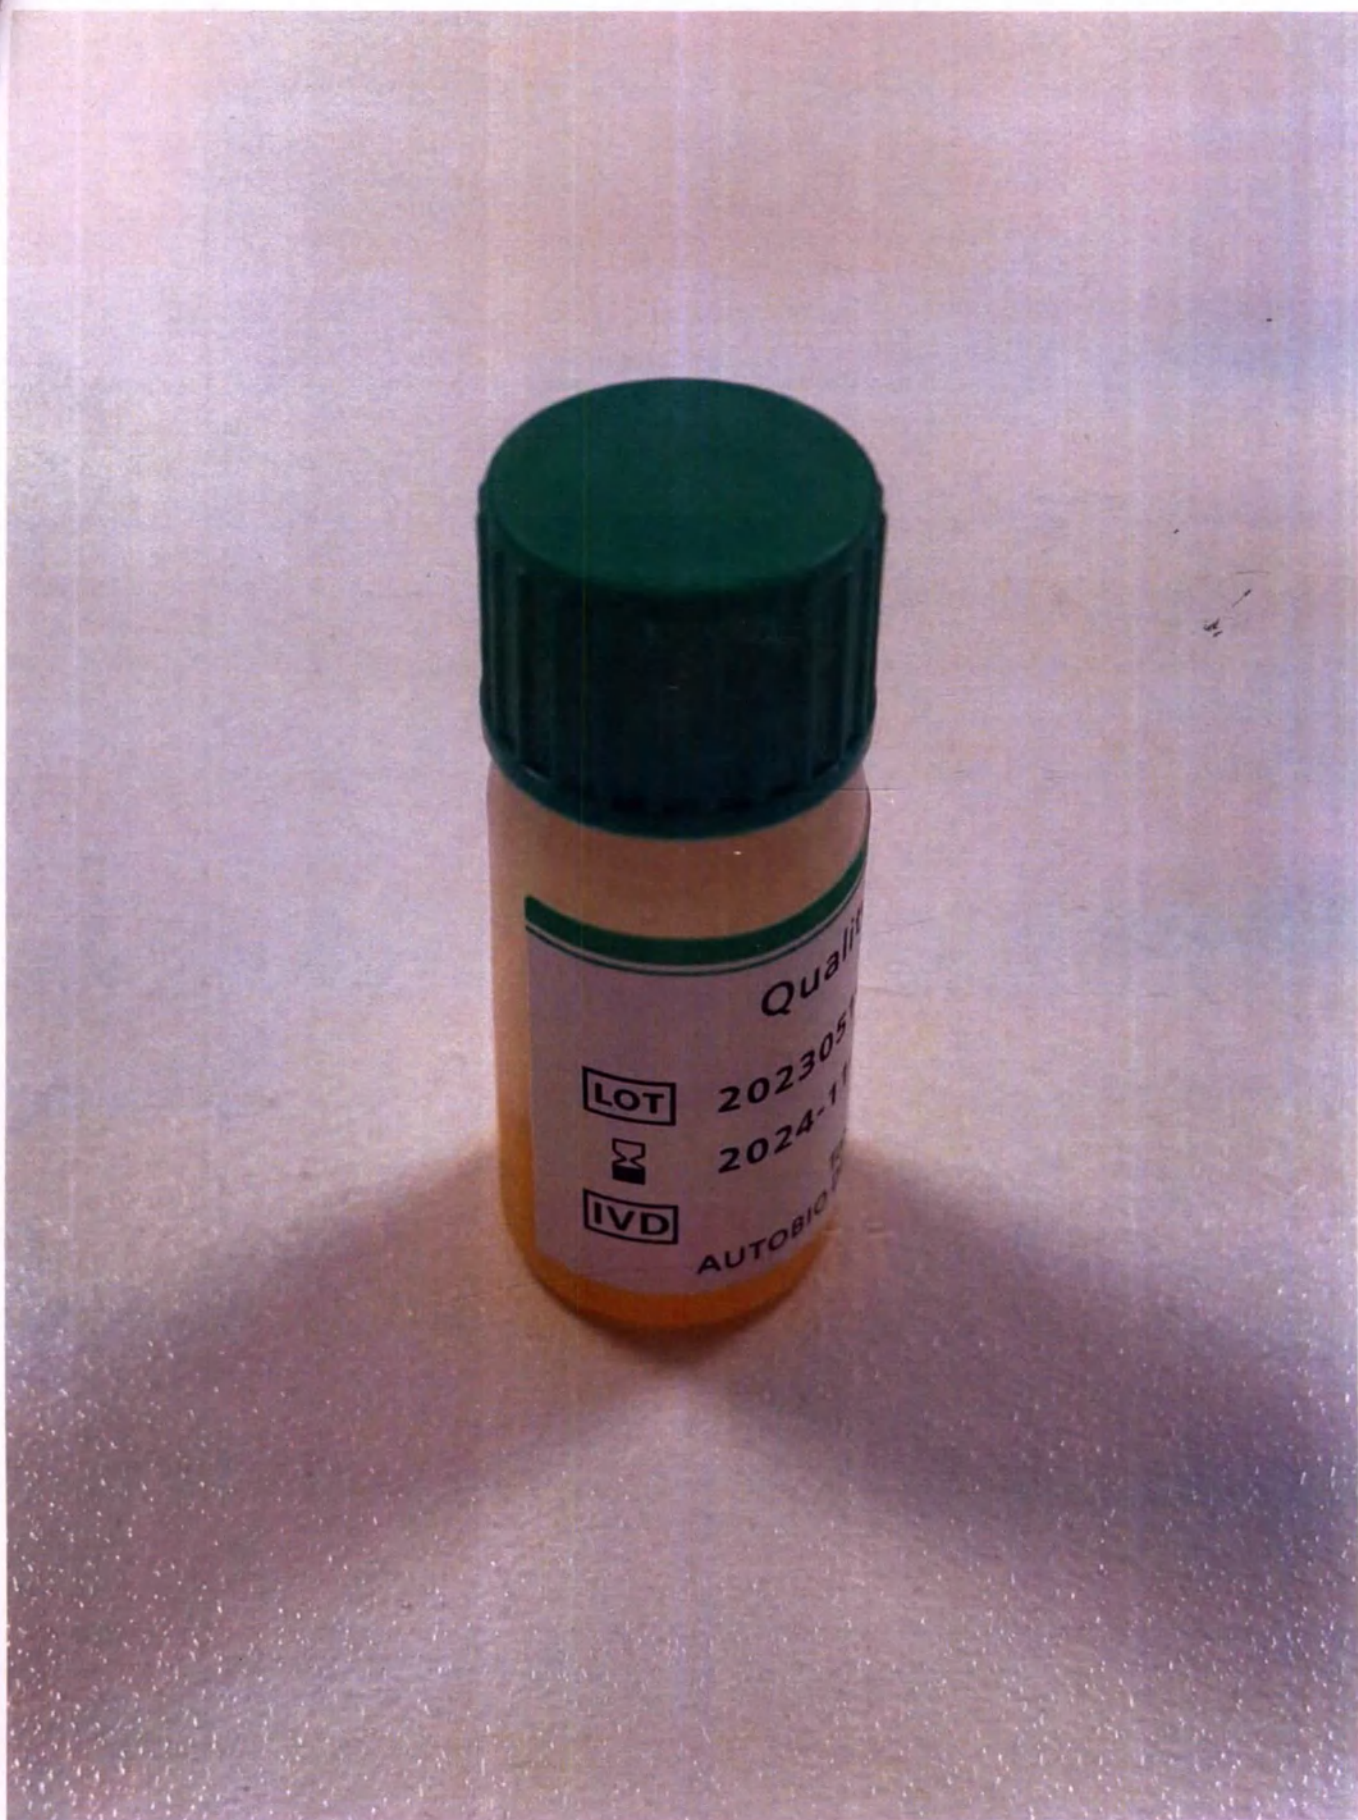


31. Фотография контроля низкого уровня (Quality Control 1).

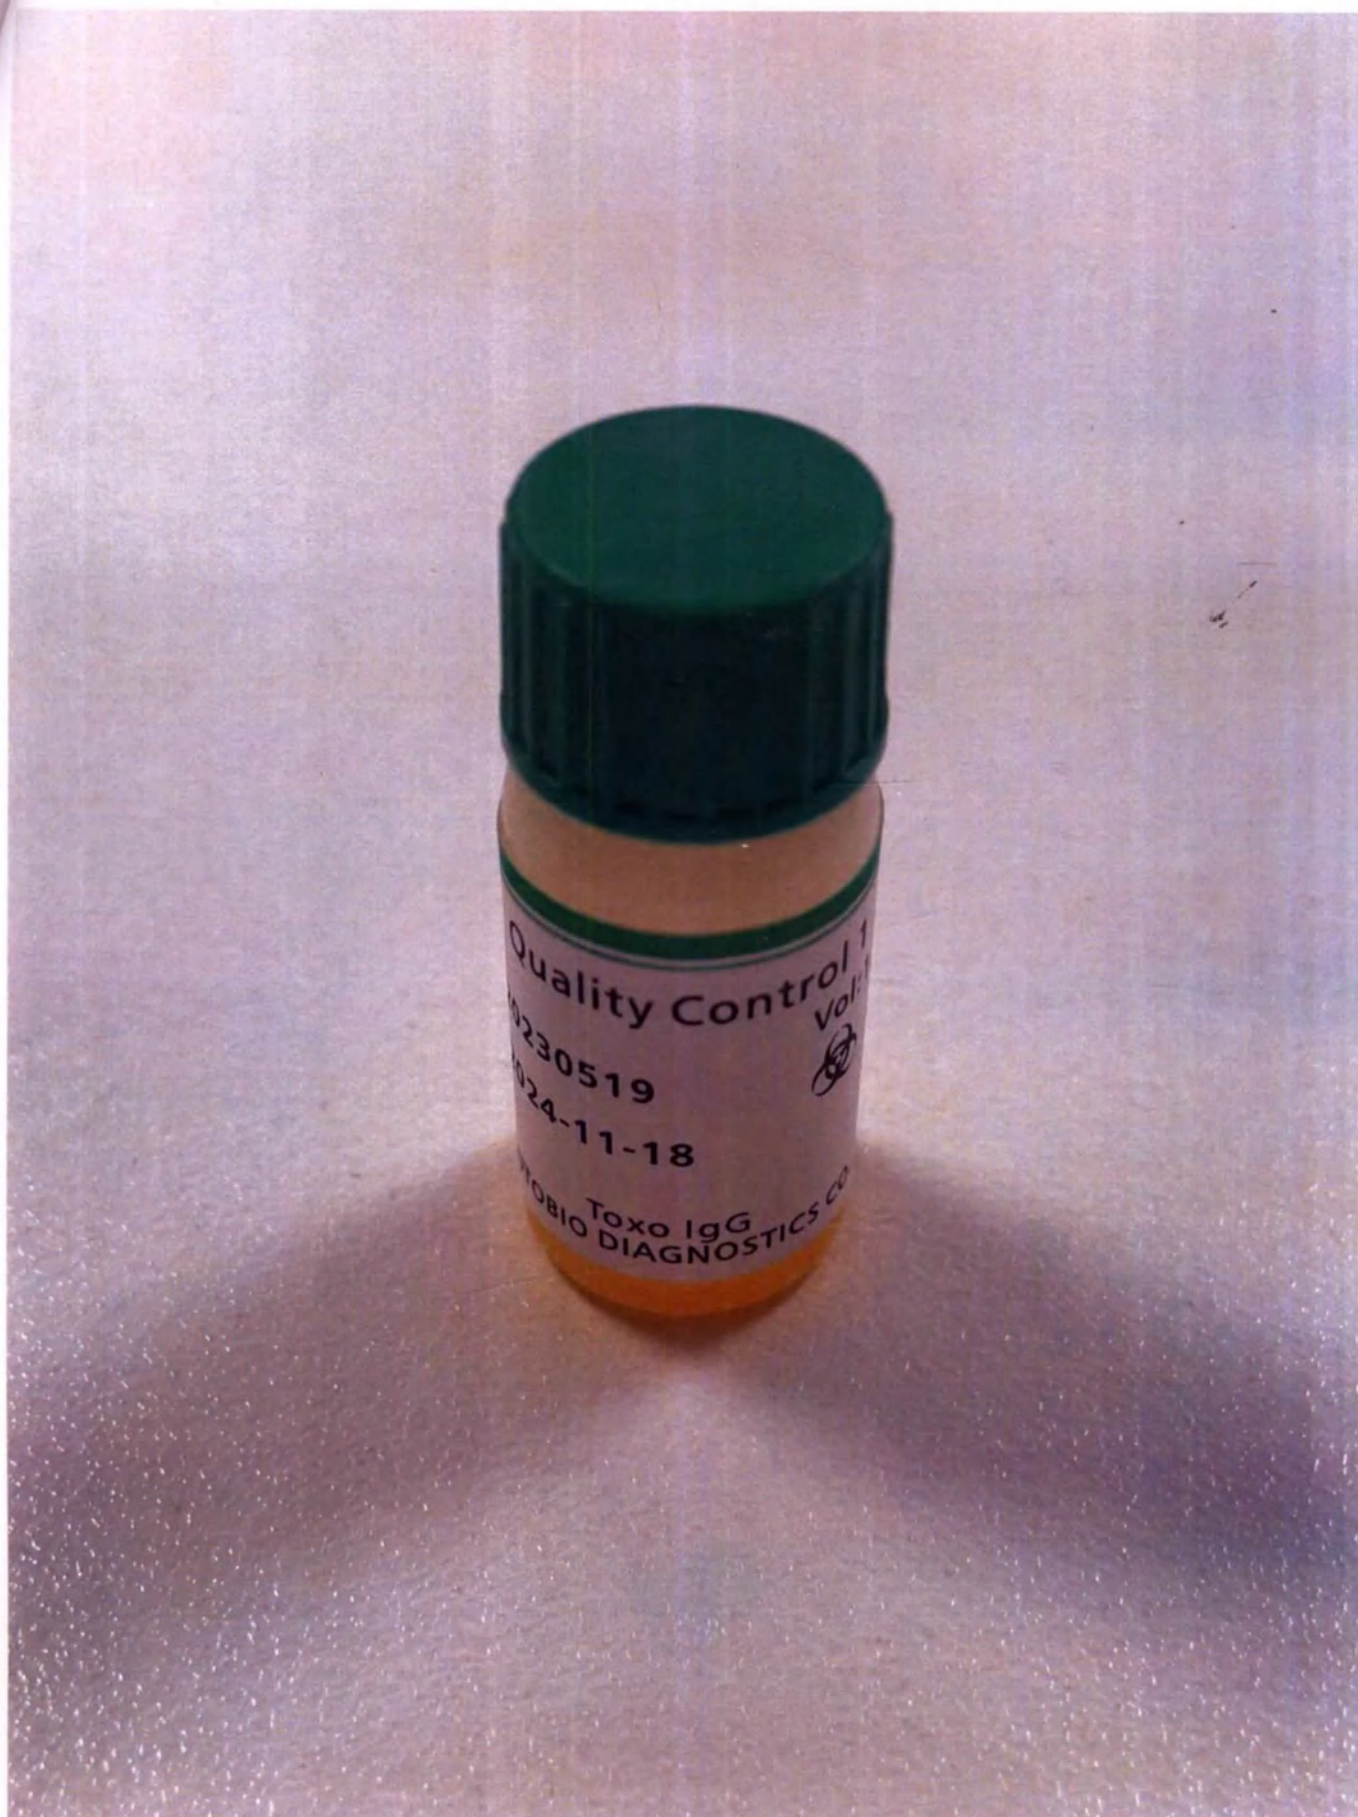

32. Фотография контроля низкого уровня (Quality Control 1)



33. Фотография контроля низкого уровня (Quality Control 1).

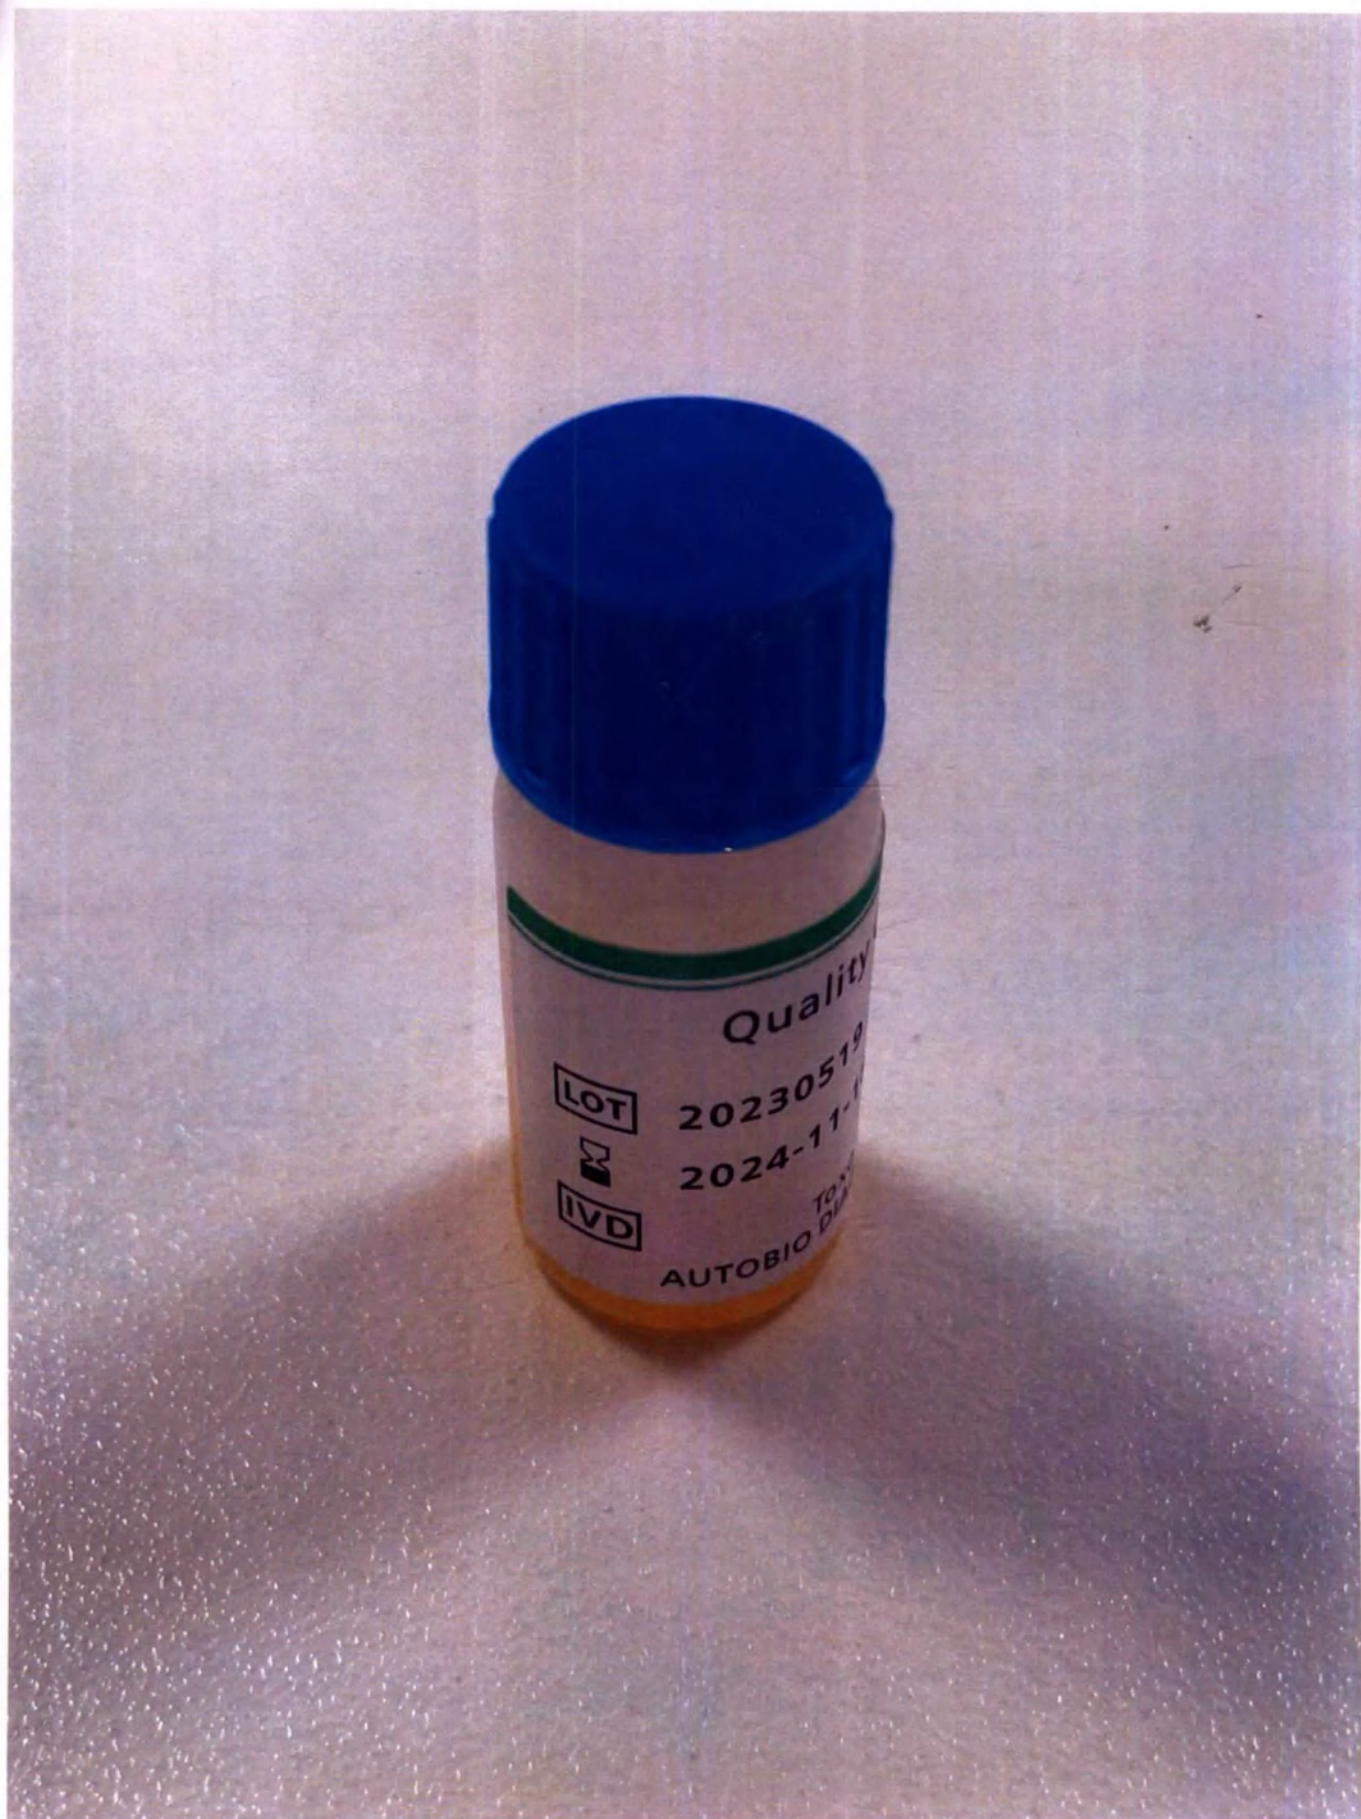

34. Фотография контроля высокого уровня (Quality Control 2).



35. Фотография контроля высокого уровня (Quality Control 2).



36. Фотография контроля высокого уровня (Quality Control 2).



37. Фотография транспортной упаковки.

Набор реагентов для количественного определения антител класса IgG к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека (Toxo IgG CLIA Microparticles (Toxo IgG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Toxo IgG CLIA Microparticles

REF

CMK0605

LOT

IVD

Microparticles Solution 1.2mL×2

Enzyme Conjugate 5.5mL×2

Sample Diluent 5.5mL×2

Calibrator A ×1

Calibrator B ×1

Calibrator C ×1

Calibrator D ×1

Calibrator E ×1

Calibrator F ×1

Quality Control 1 ×1

Quality Control 2 ×1

H317, H412

For professional use only

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

38. Макеты русскоязычной маркировки для фасовки 50*2 тестов.

Набор реагентов для количественного определения антител класса IgG к *Toxoplasma gondii* в сыворотке и плазме крови человека (Toxo IgG CLIA Microparticles (Toxo IgG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/ХХХХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Toxo IgG CLIA Microparticles

REF

CMK0602

LOT

IVD

Microparticles Solution 2.3mL×1

Enzyme Conjugate 11.0mL×1

Sample Diluent 11.0mL×1

Calibrator A ×1

Calibrator B ×1

Calibrator C ×1

Calibrator D ×1

Calibrator E ×1

Calibrator F ×1

Quality Control 1 ×1

Quality Control 2 ×1

H317, H412

For professional use only

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

39. Макеты русскоязычной маркировки для фасовки 100 тестов.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 39

(Тридцати девяти) листах