



Общество с ограниченной ответственностью
«АзияМедКонсалт»
Россия, 109004, Москва, ул. А. Солженицына, д. 27
Тел.: +7 495 988 47 44
ОГРН: 1137746433879
ИНН: 7709929540

ПОДТВЕРЖДАЮ


Директор по развитию
ООО «АМК»



Н. Н. Перцева
«30» сентября 2024г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Набор реагентов для количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека (Rubella IgG CLIA Microparticles (Rubella IgG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

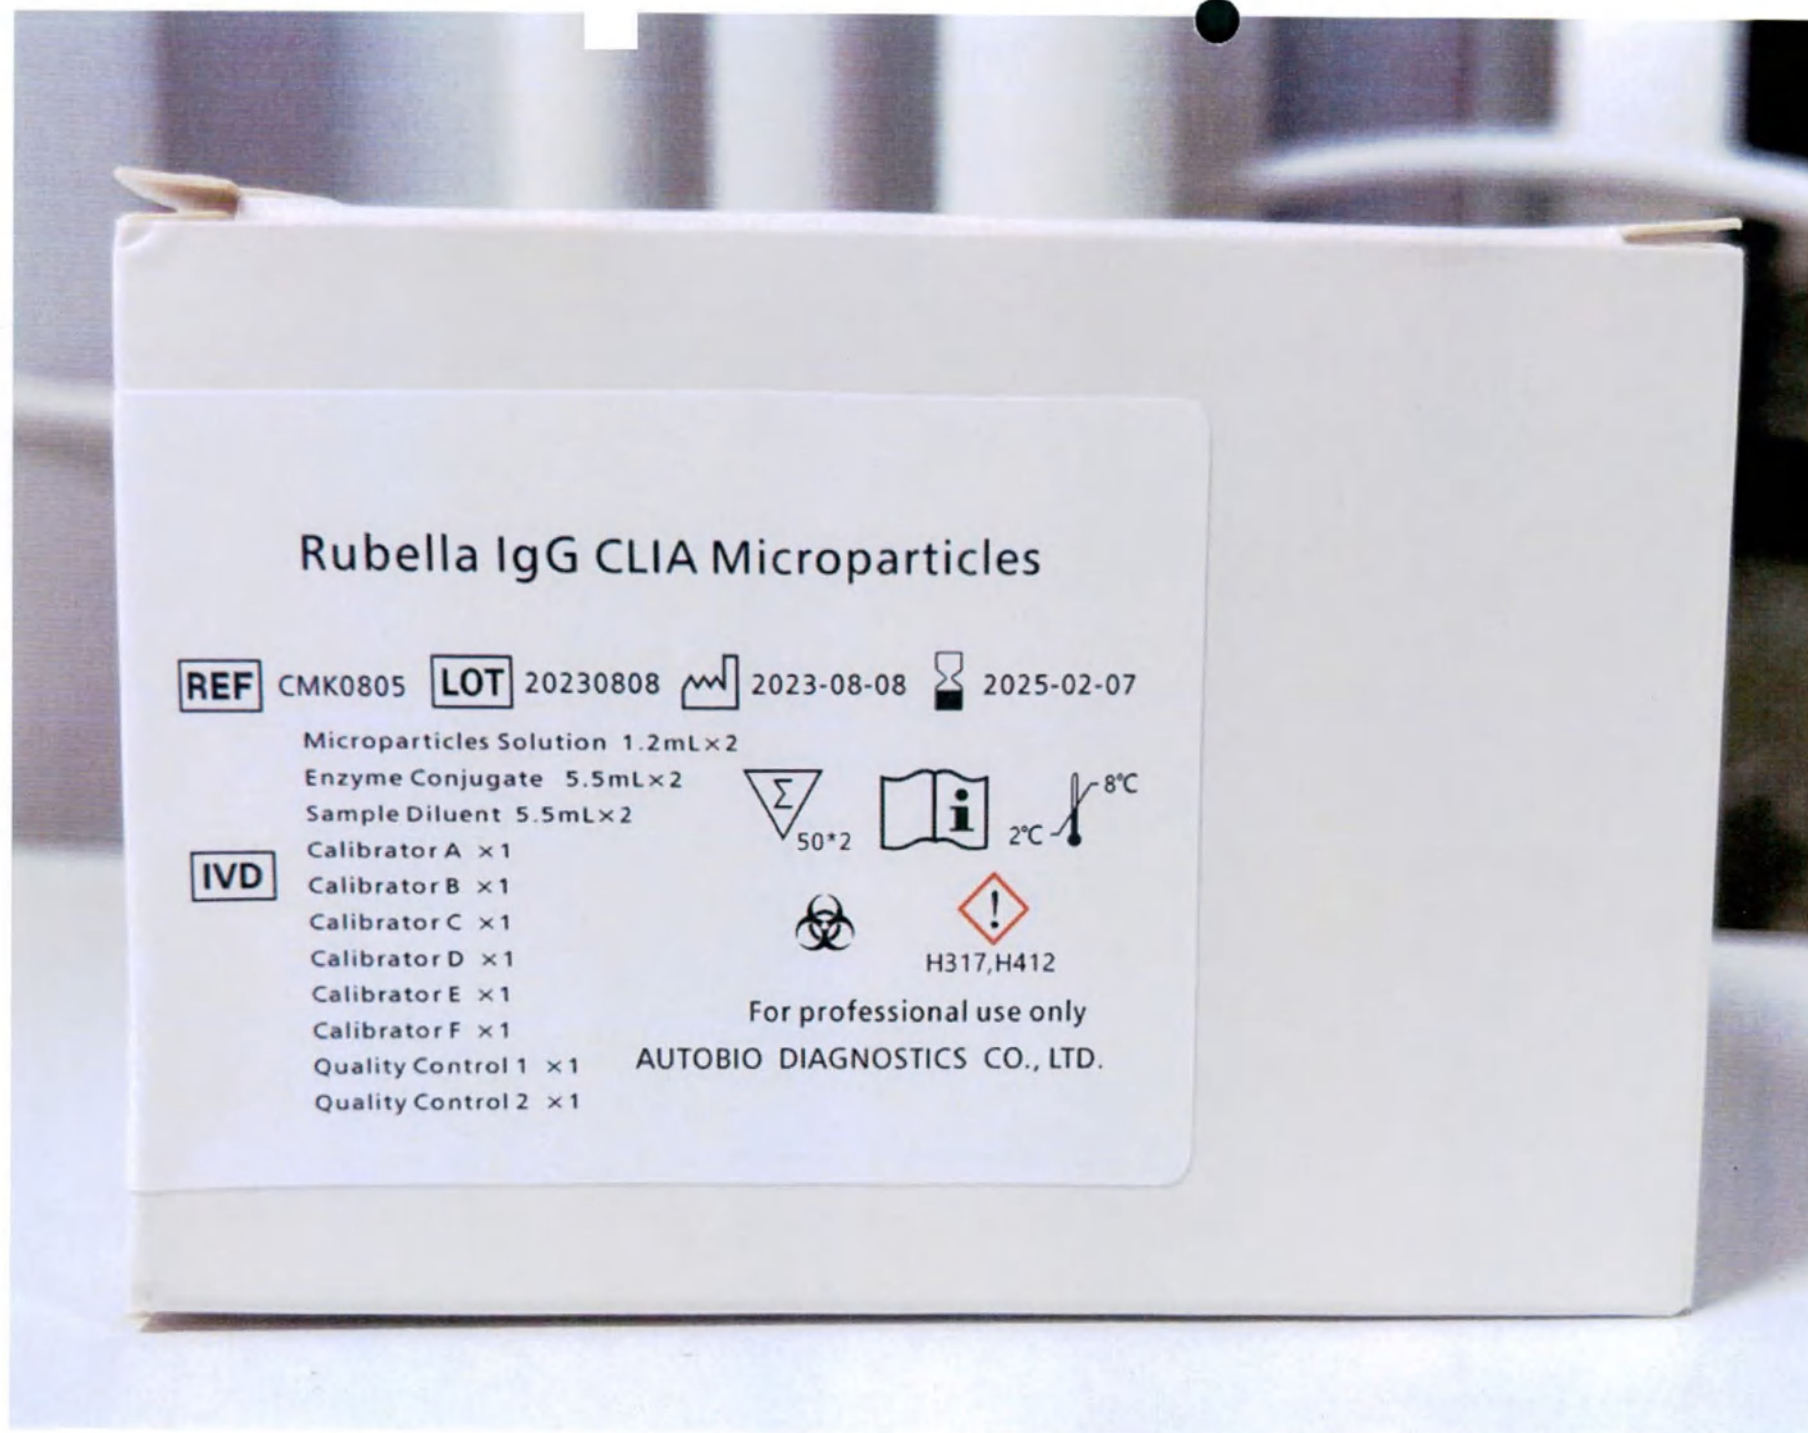

1. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 50*2 тестов.



2. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 50*2 тестов.

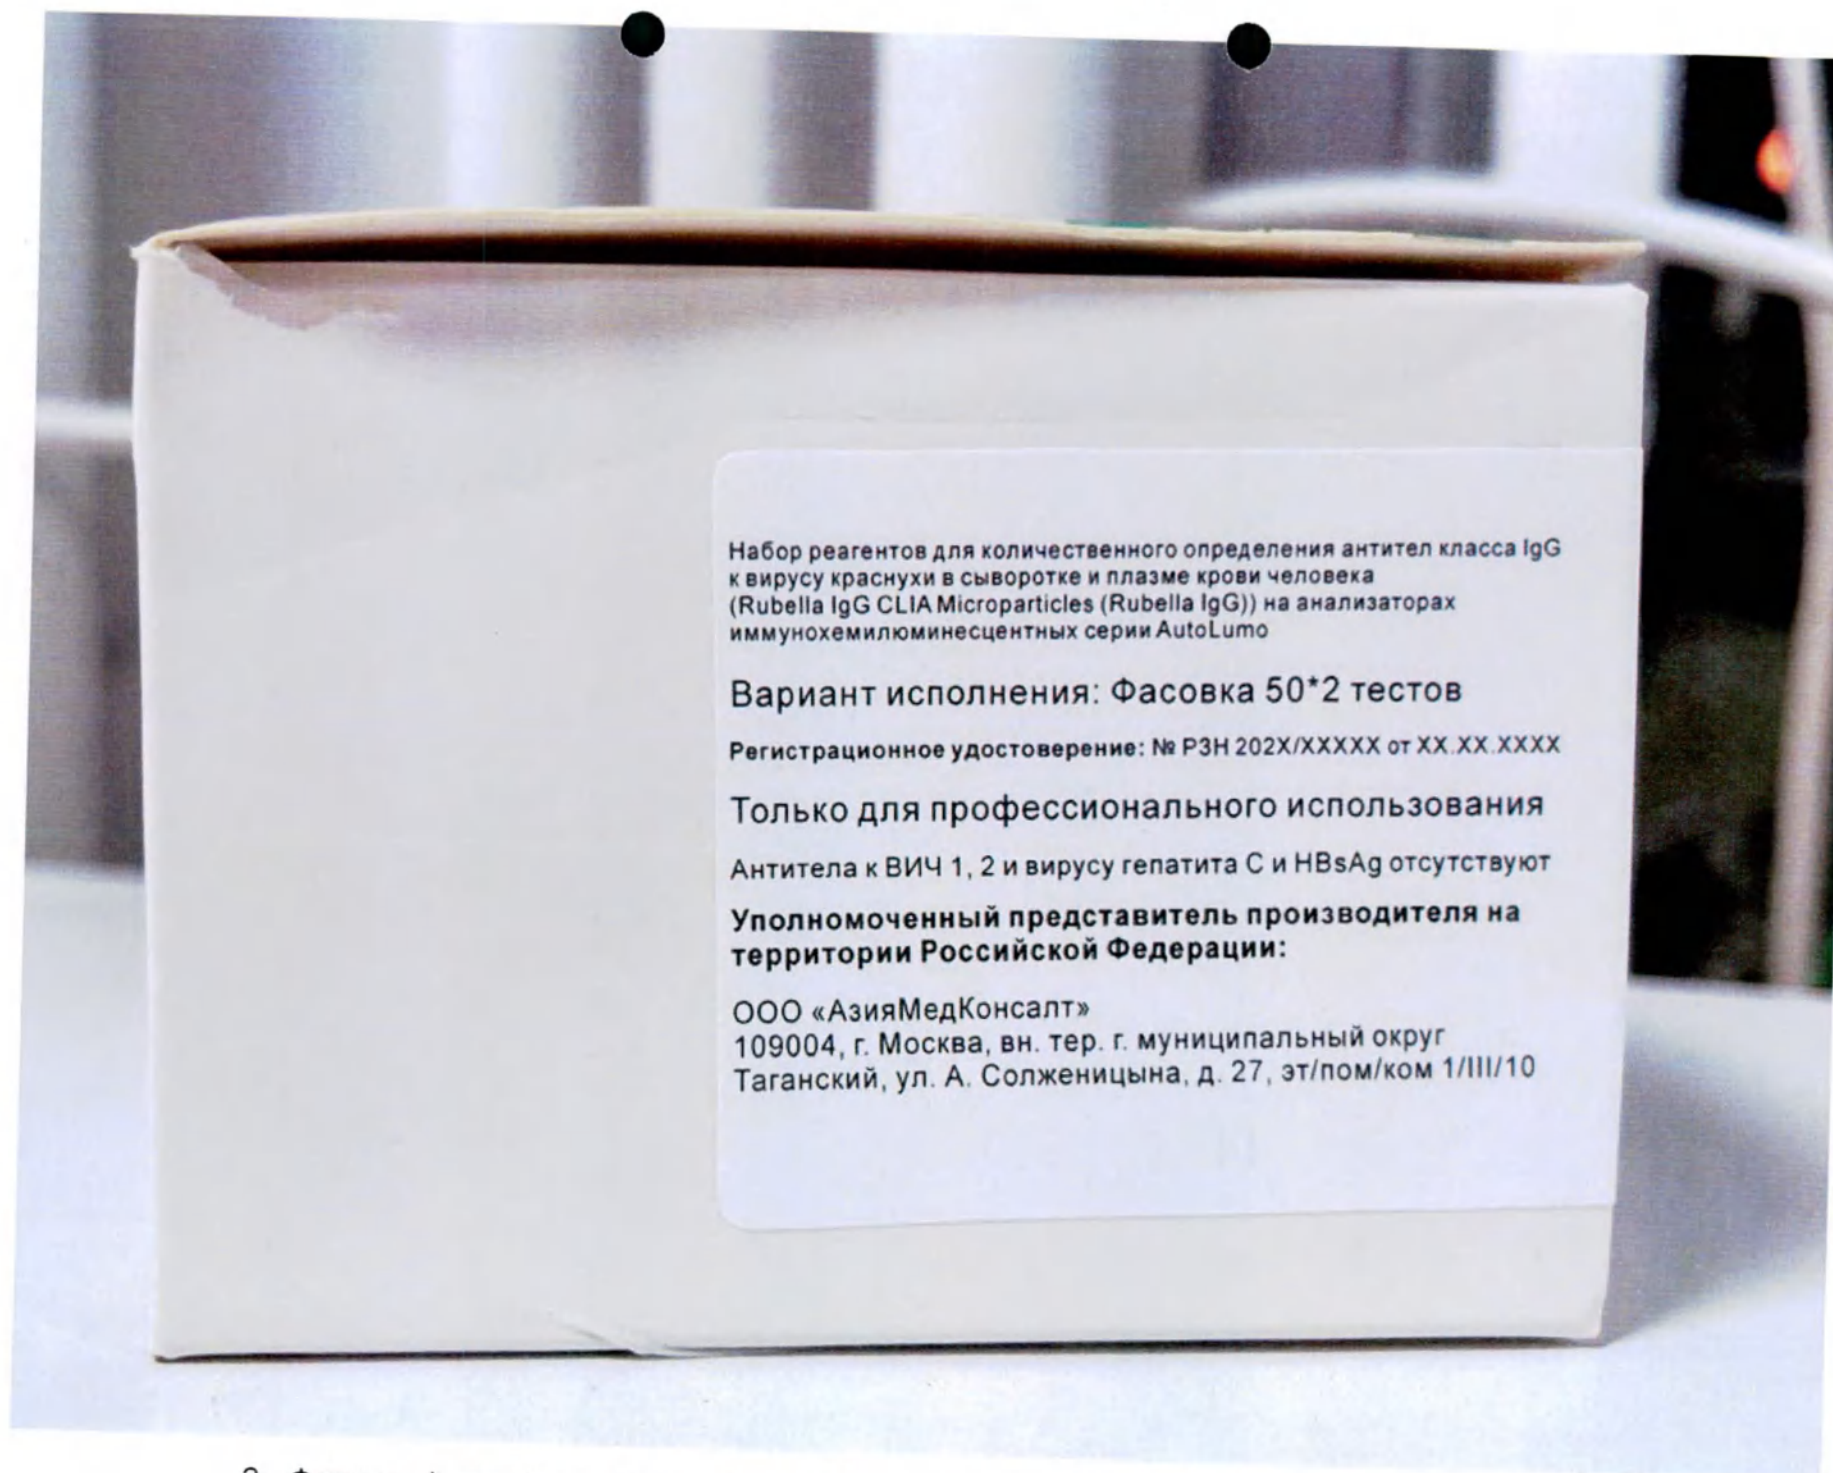

Набор реагентов для количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека (Rubella IgG CLIA Microparticles (Rubella IgG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXXX от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

3. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 50*2 тестов.



4. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 50*2 тестов.




AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.
No.87 Jingbei Yi Road, National Eco &
Tech Development Area, Zhengzhou,
China 450016
Tel: +86-371-67985313
Fax: +86-371-67985804
Web: www.autobio.com.cn


5. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 50*2 тестов.




6. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 50*2 тестов.

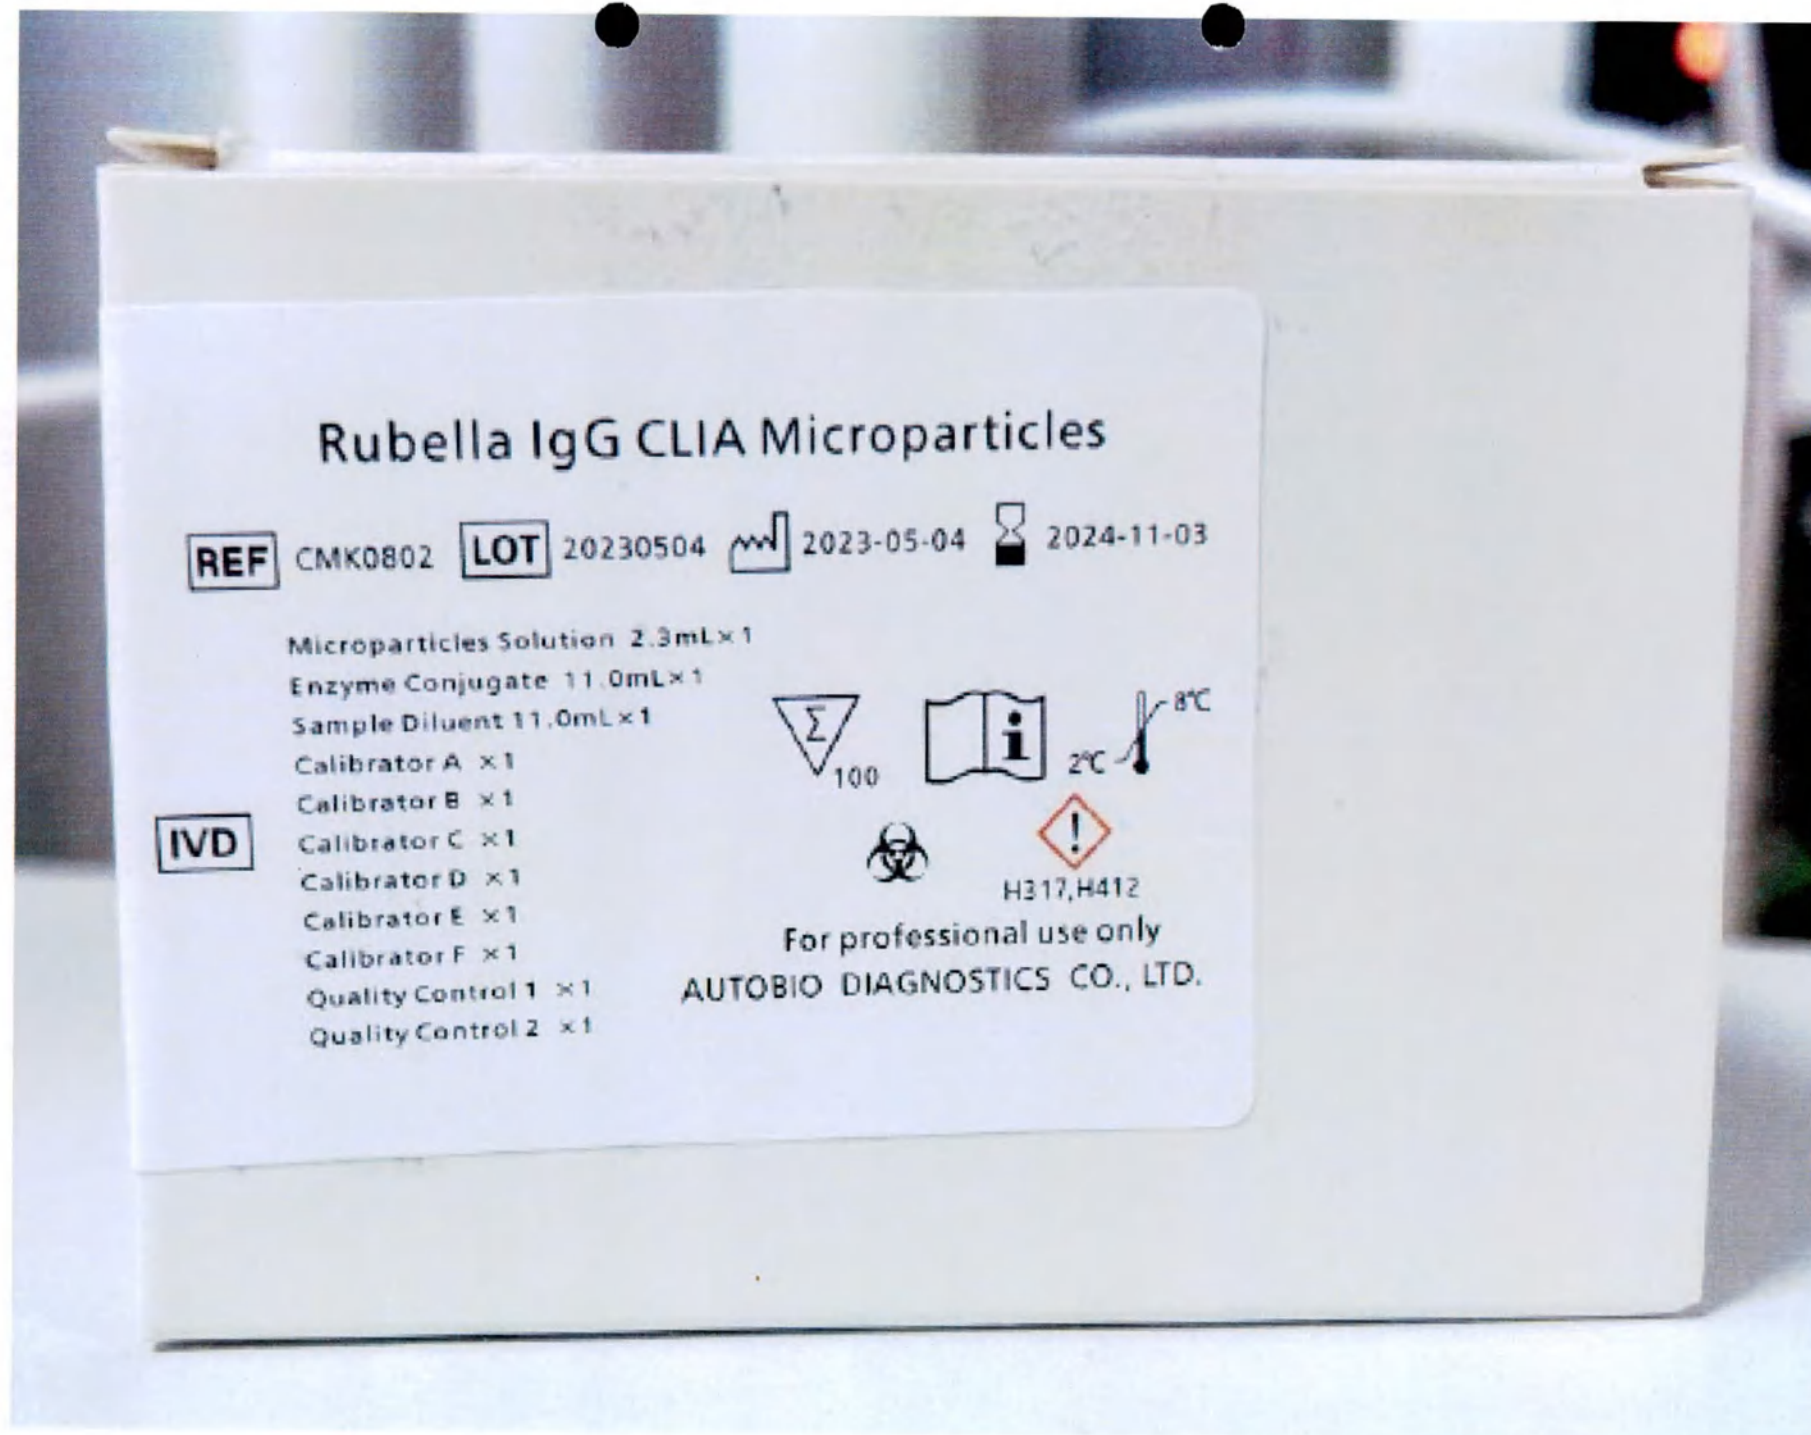

7. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 100 тестов.

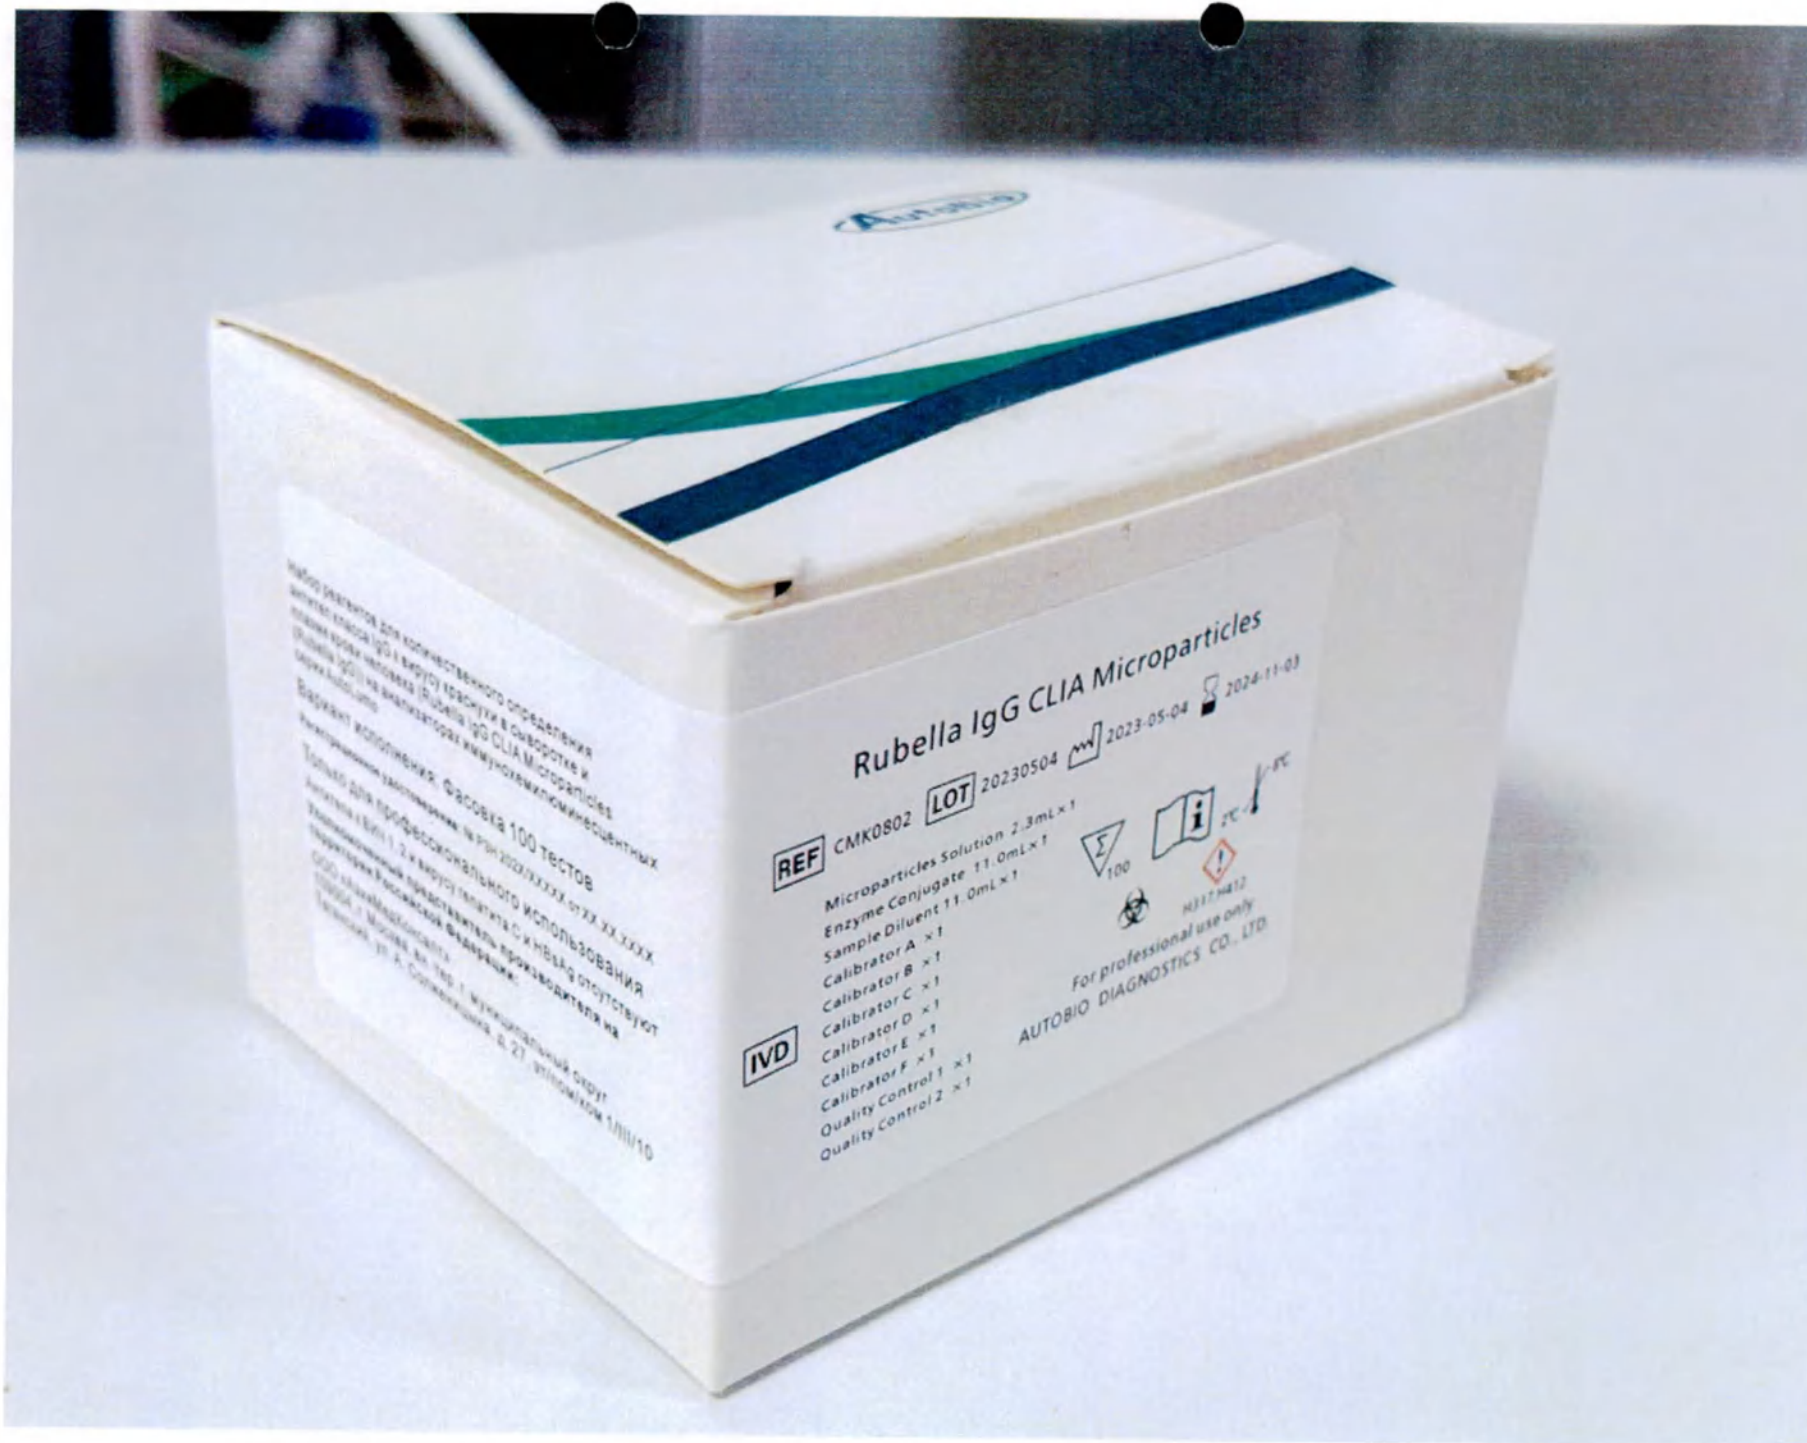

8. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 100 тестов.

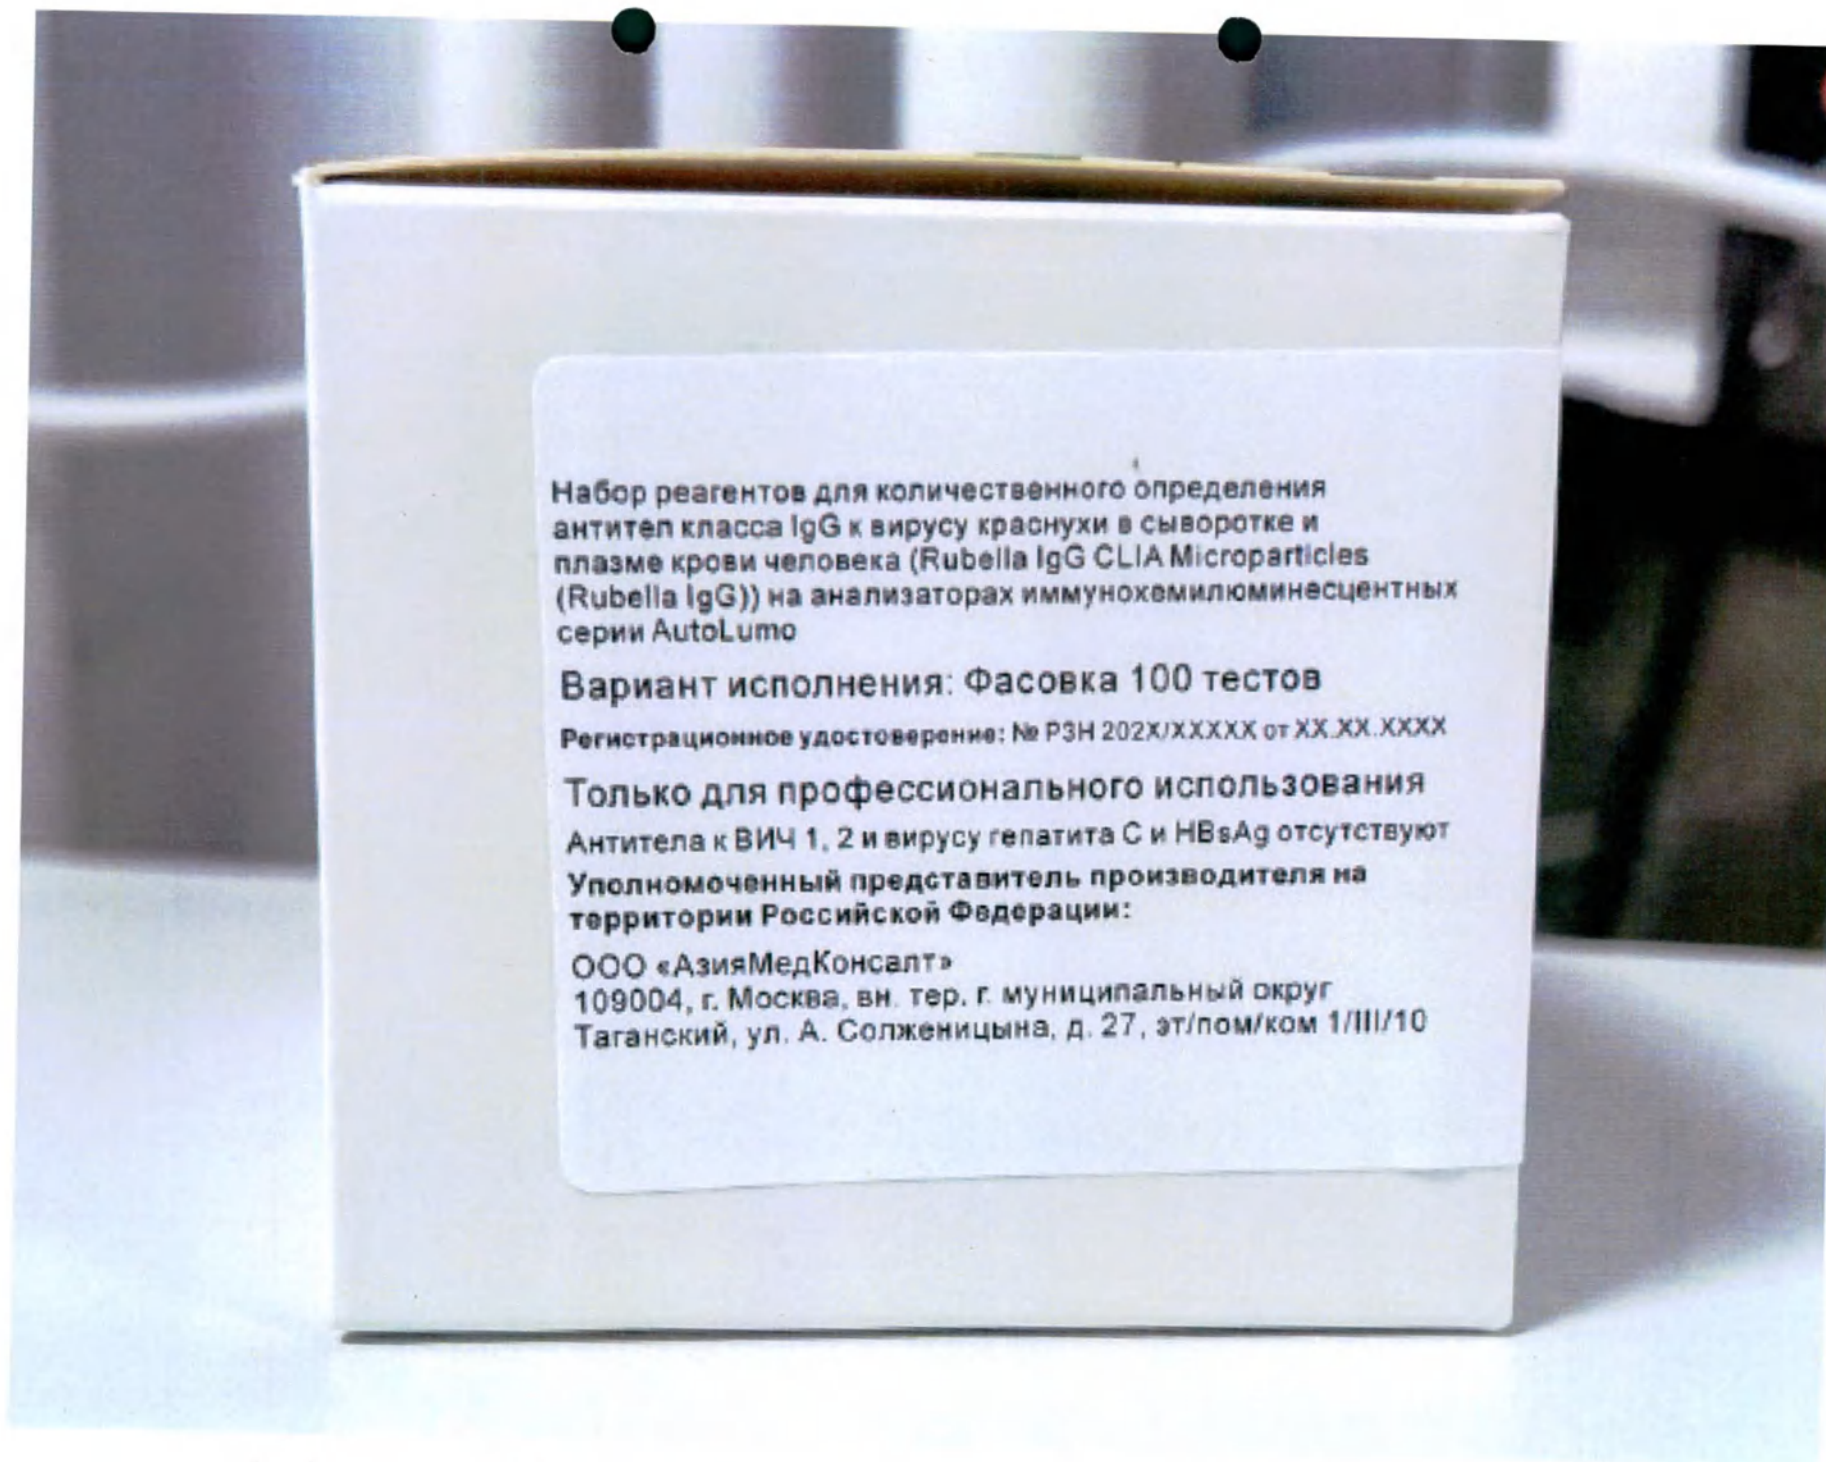

Набор реагентов для количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека (Rubella IgG CLIA Microparticles (Rubella IgG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»


109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

9. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 100 тестов.



10. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 100 тестов.

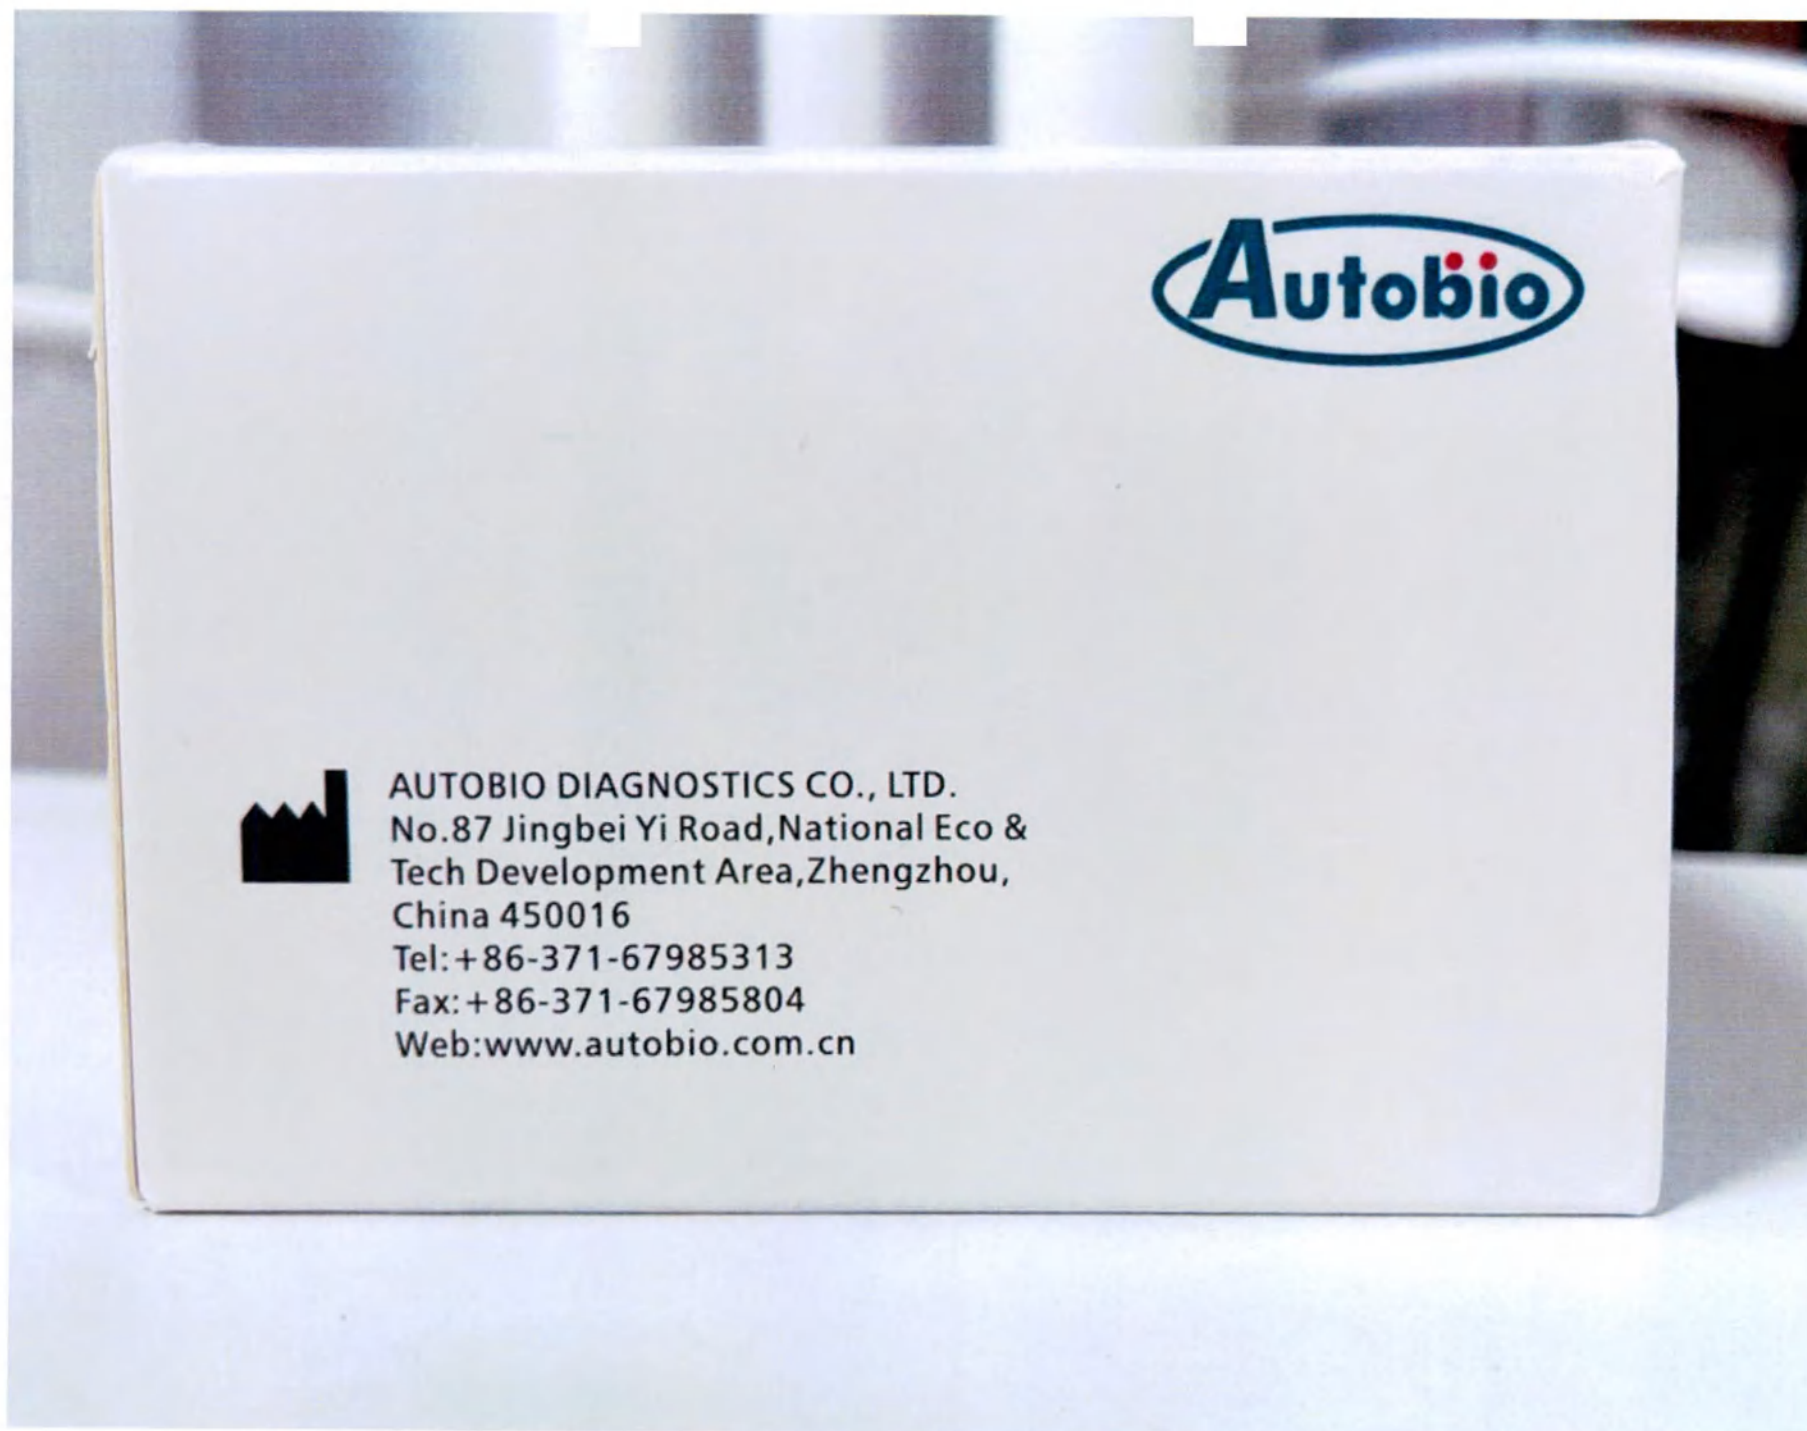

11. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 100 тестов.



12. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки, фасовка 100 тестов.



13. Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки, фасовка 50*2 тестов.




14. Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки, фасовка 100 тестов.



15. Фотография картриджа, вариант №1.




16. Фотография картриджа, вариант №2.

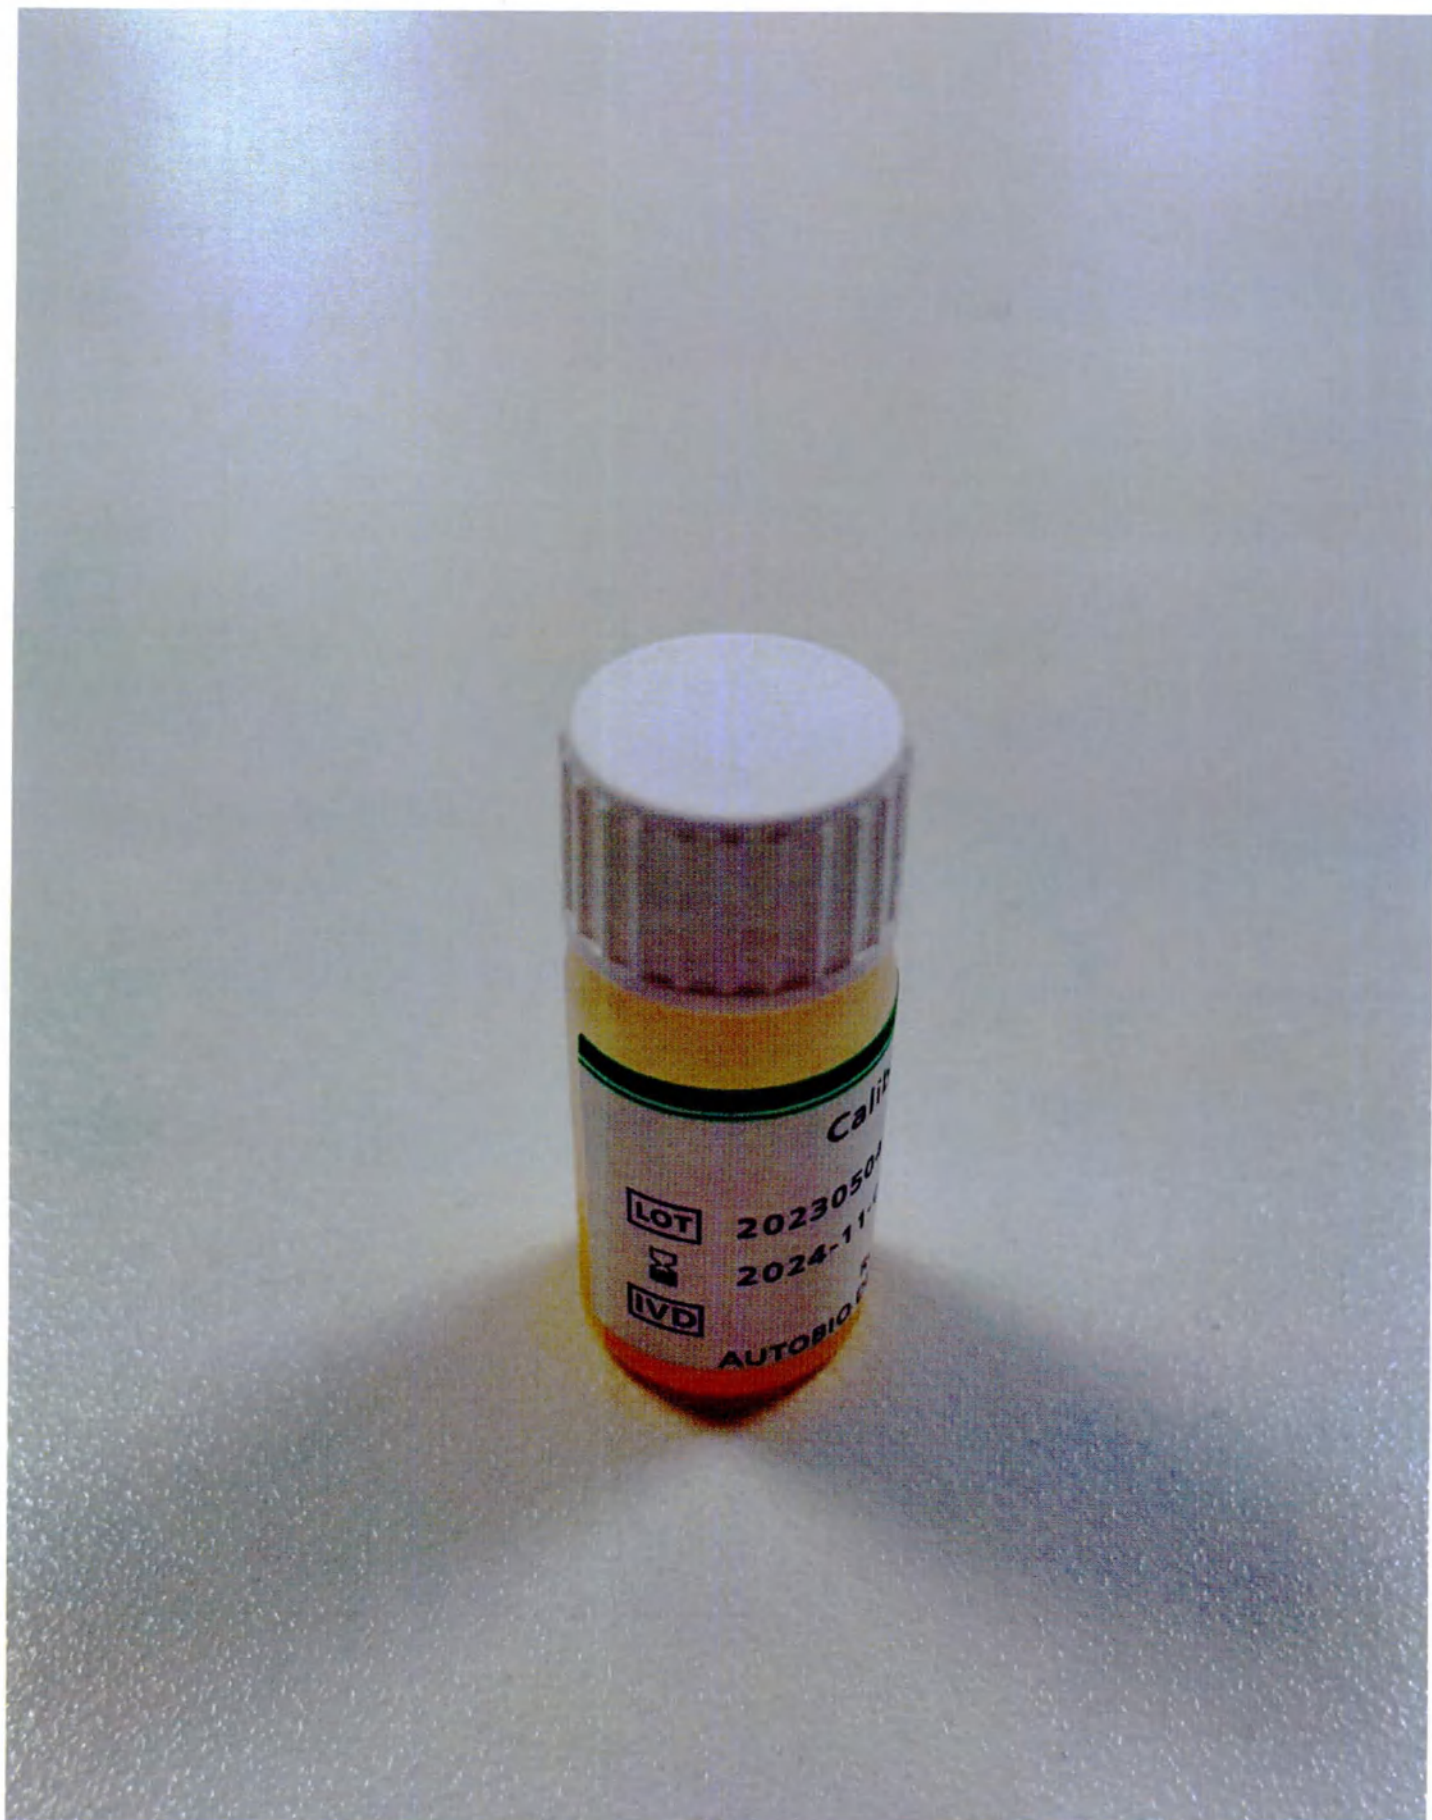


17. Фотография калибратора А (Calibrator A).




18. Фотография калибратора А (Calibrator A).

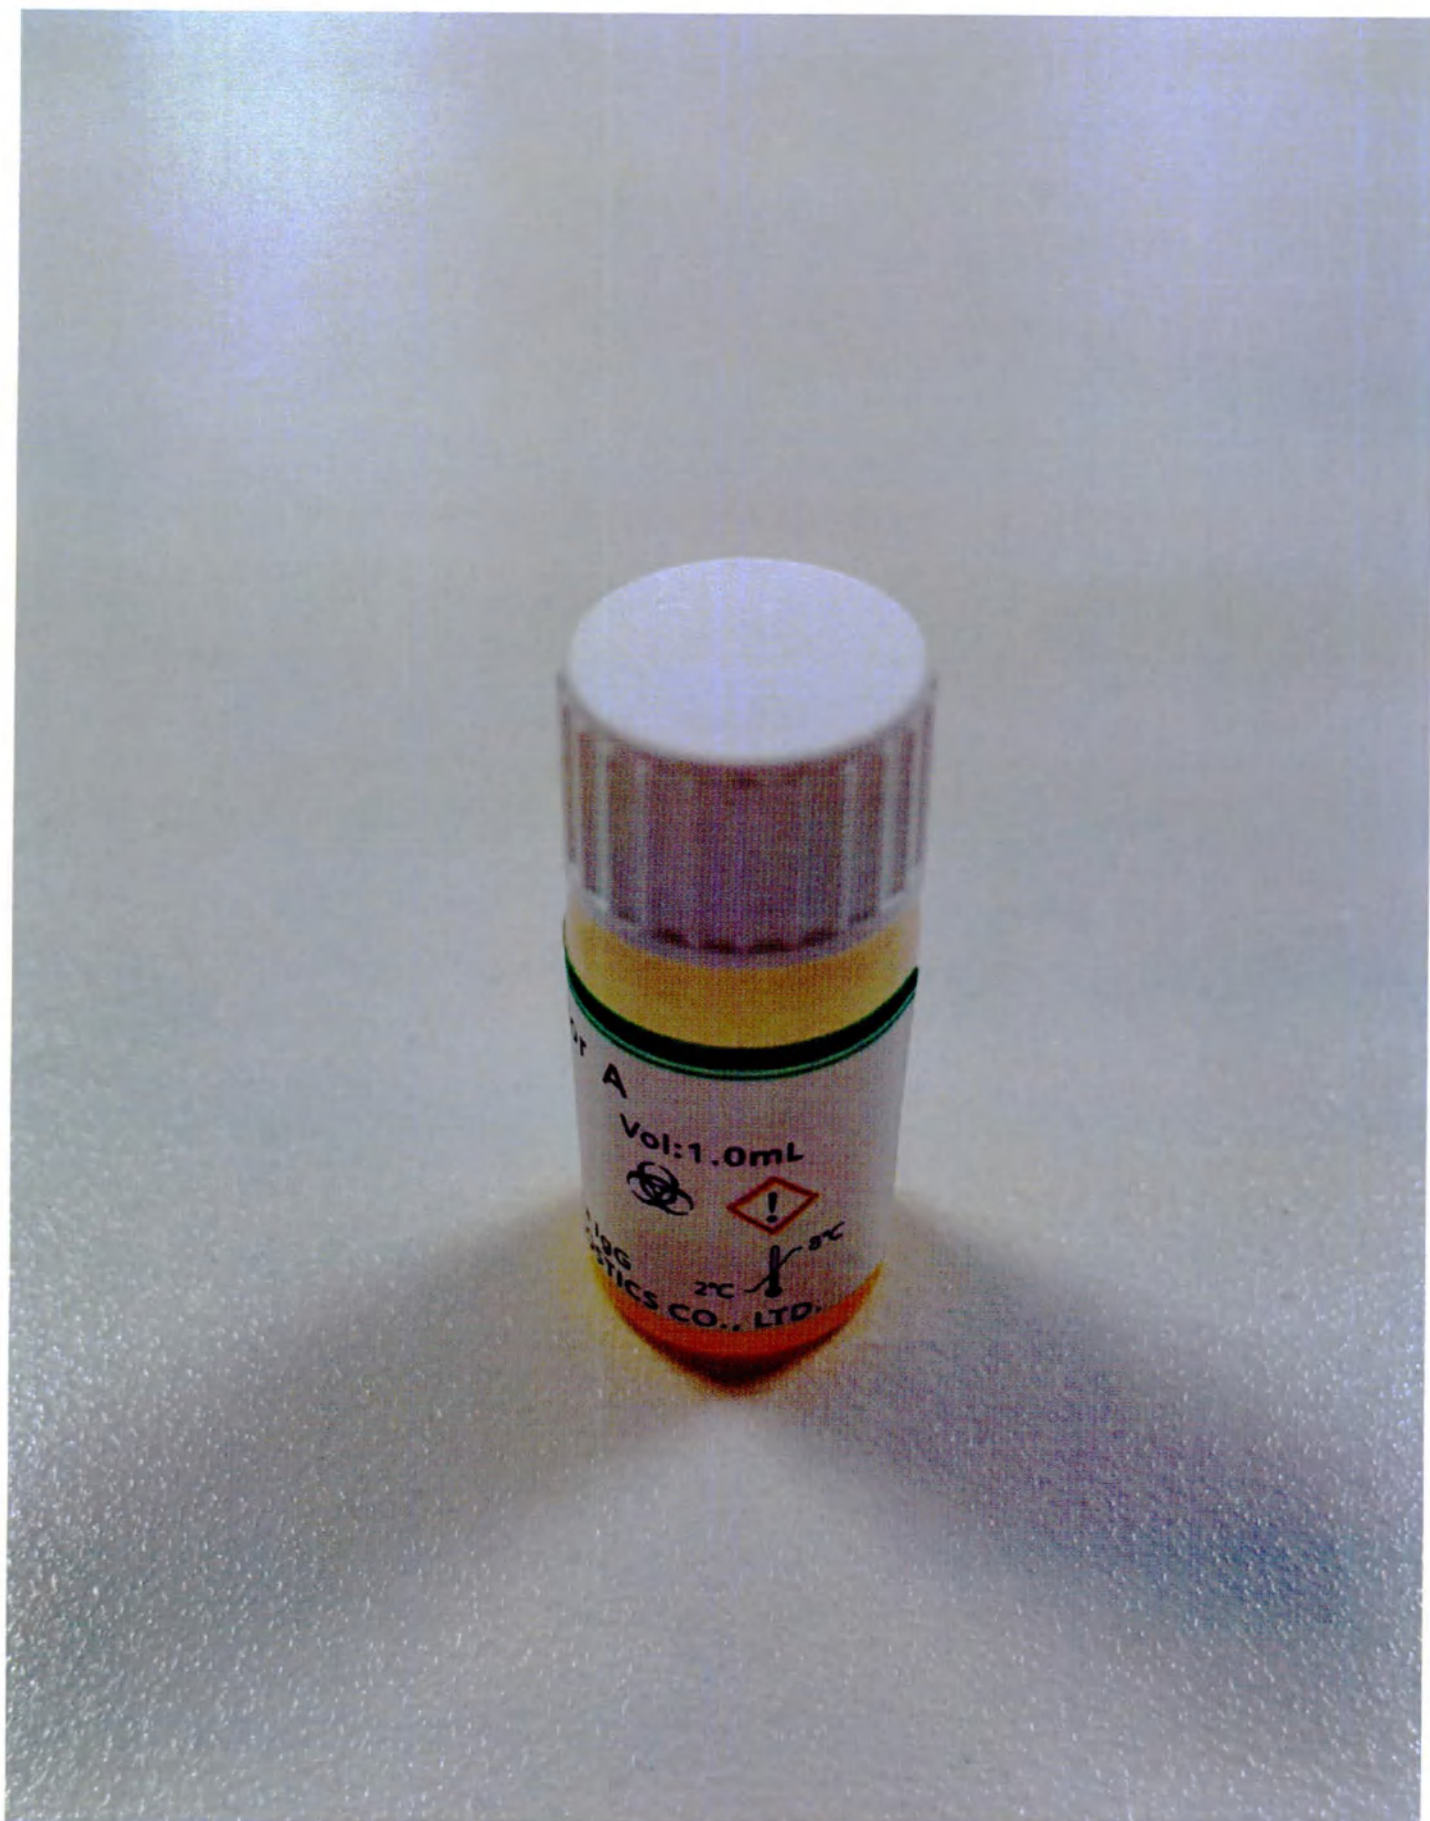


19. Фотография калибратора А (Calibrator A).

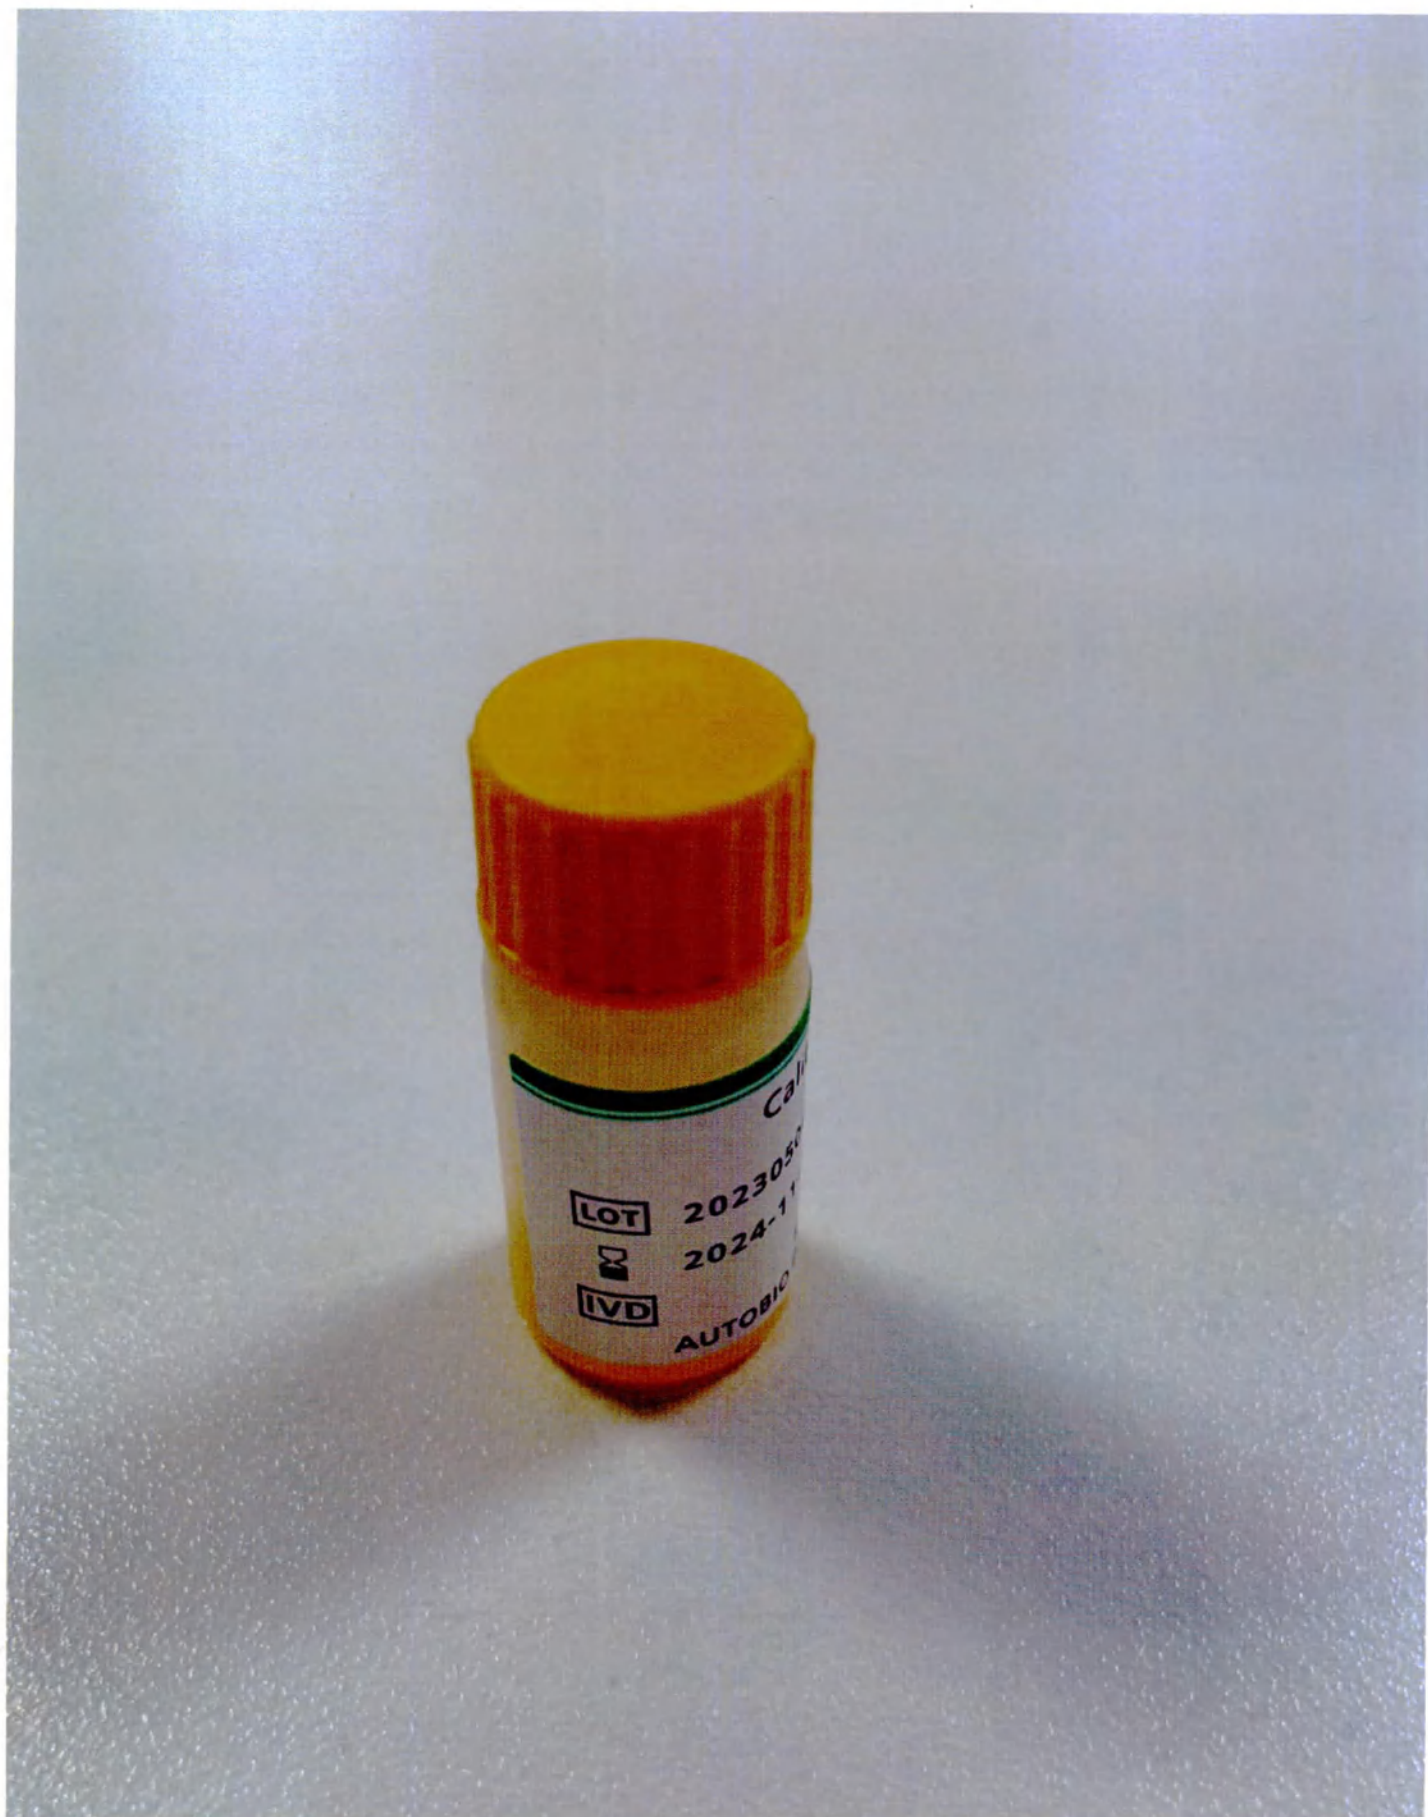


20. Фотография калибратора В (Calibrator B).

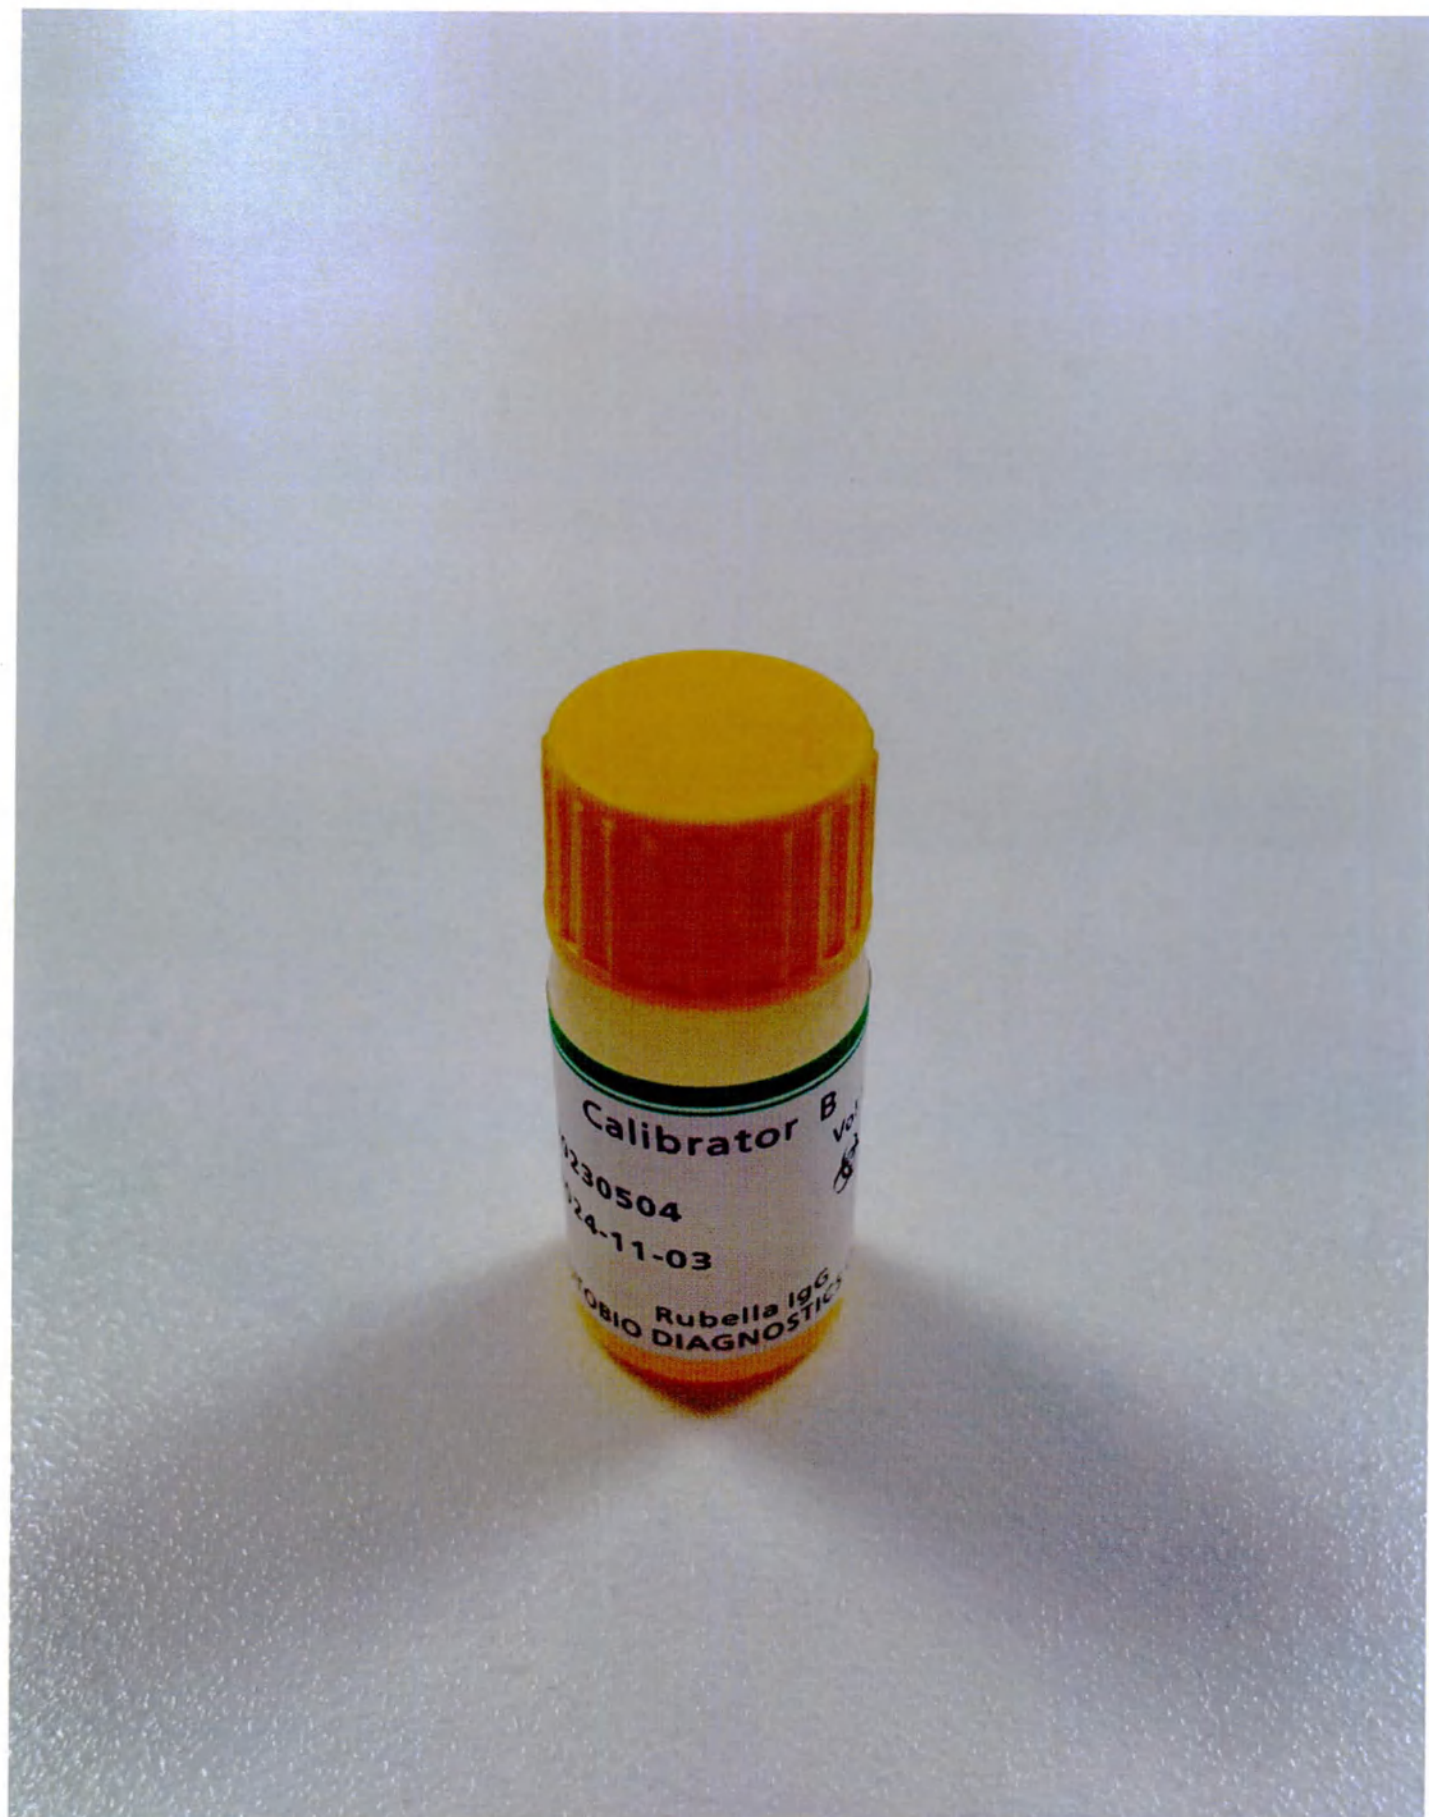


21. Фотография калибратора В (Calibrator B).

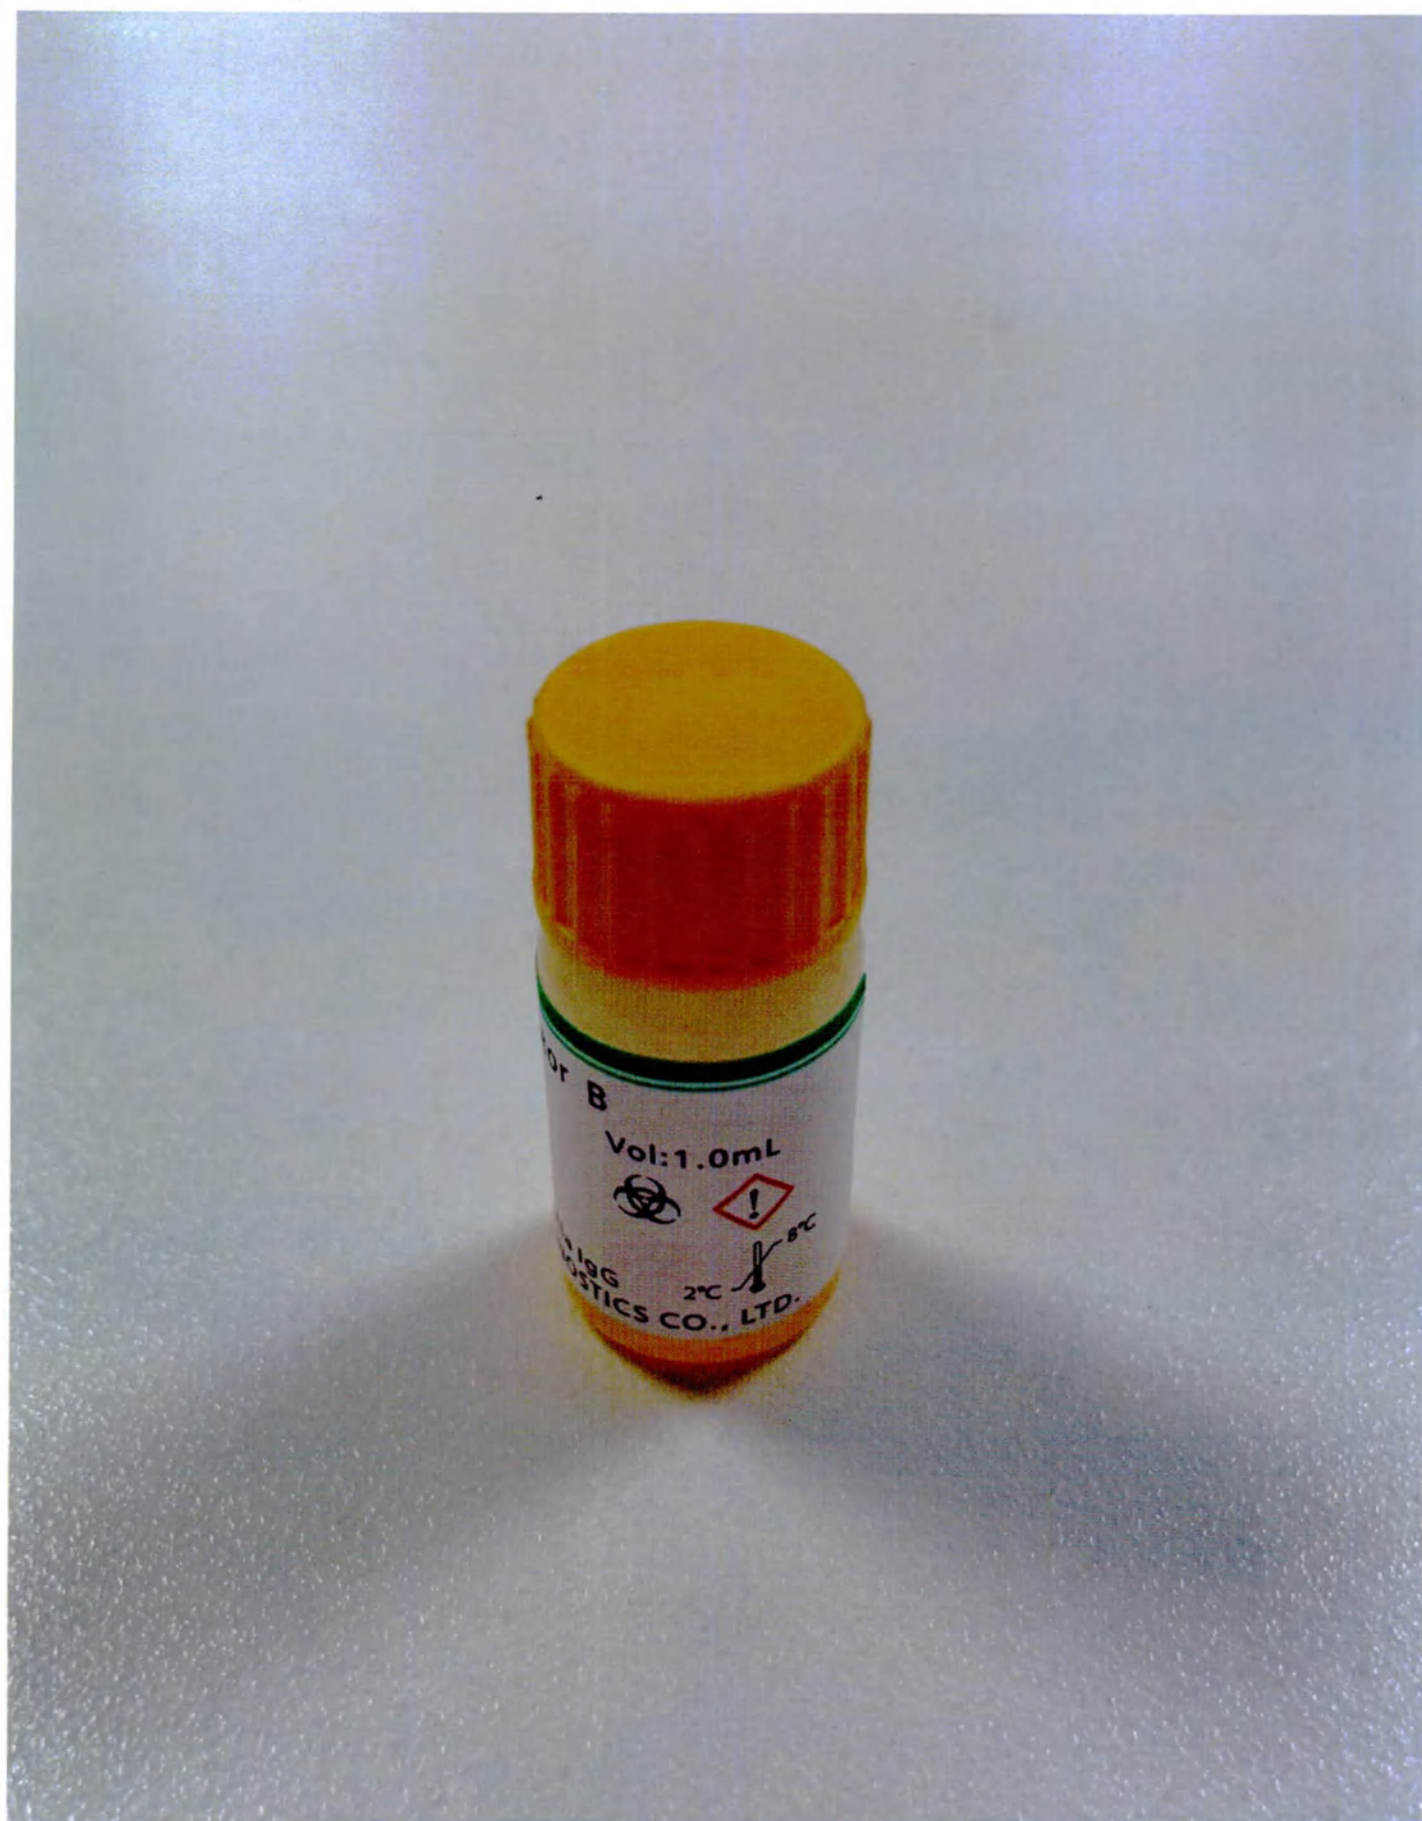


22. Фотография калибратора В (Calibrator B).

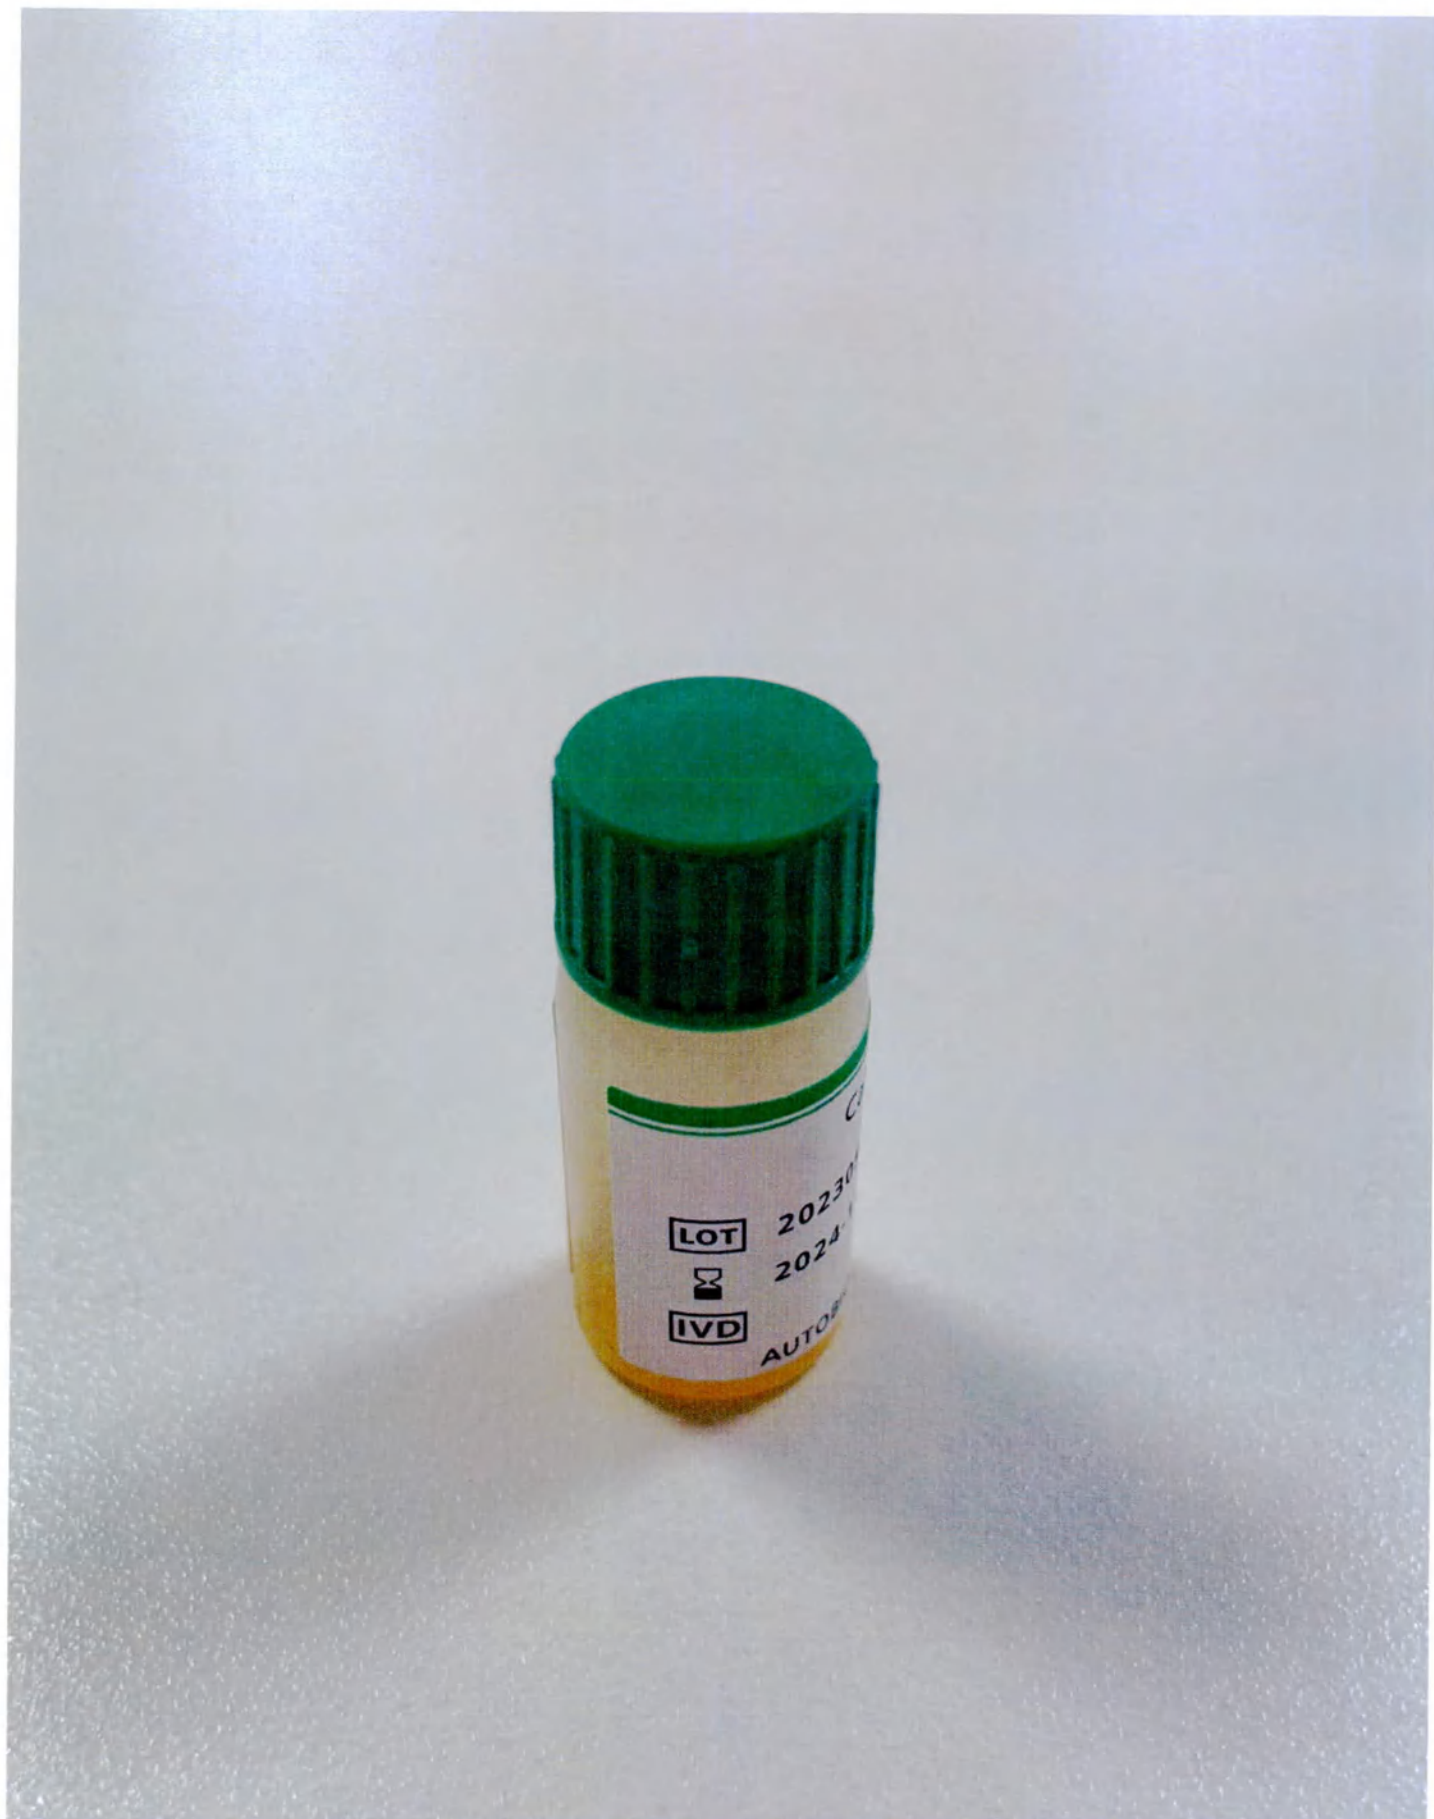


23. Фотография калибратора С (Calibrator C).

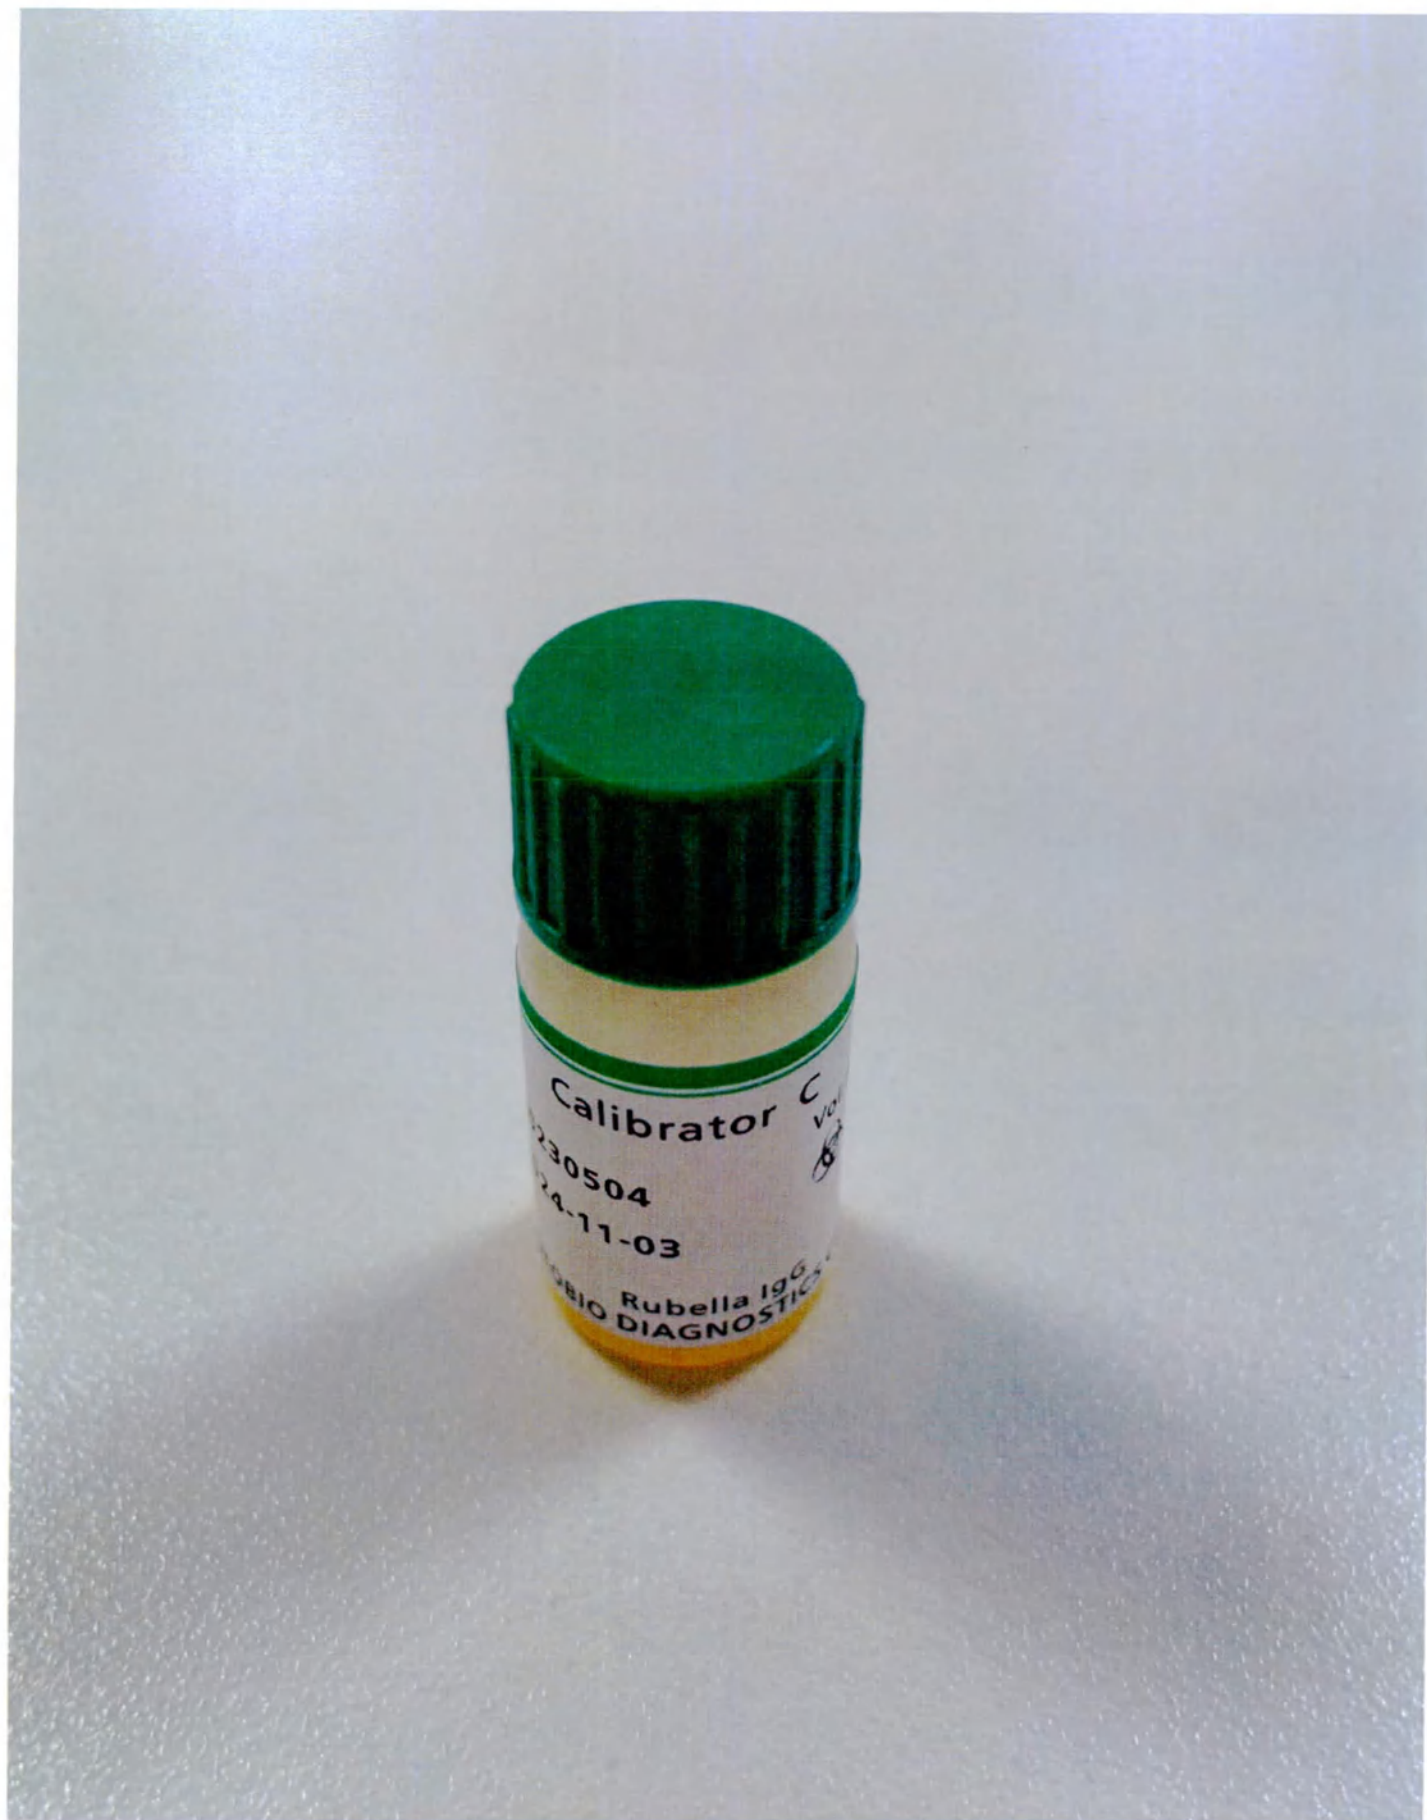

24. Фотография калибратора С (Calibrator C).

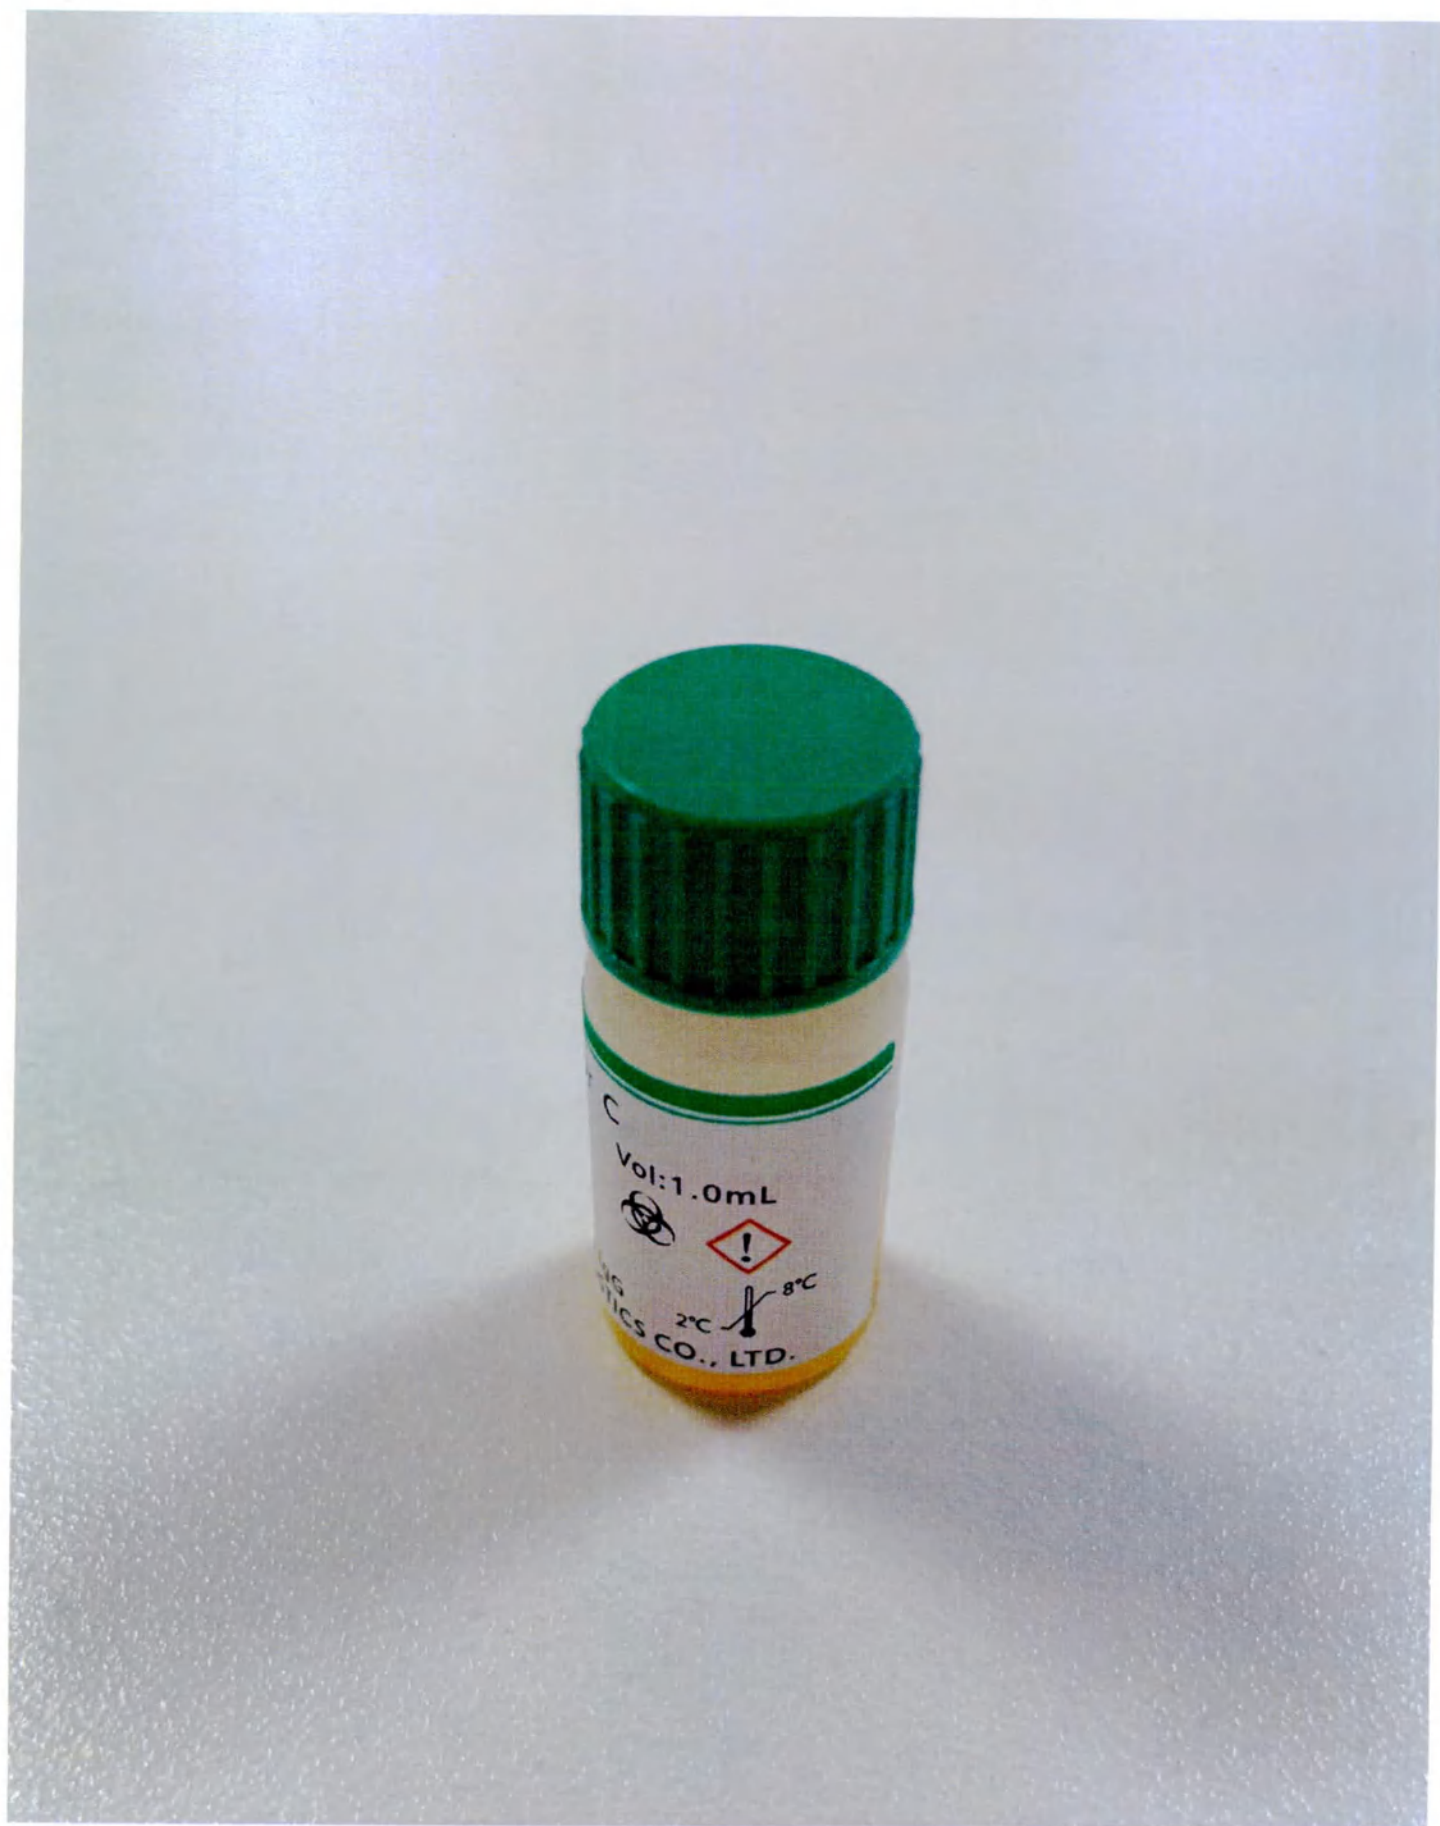

25. Фотография калибратора С (Calibrator C).

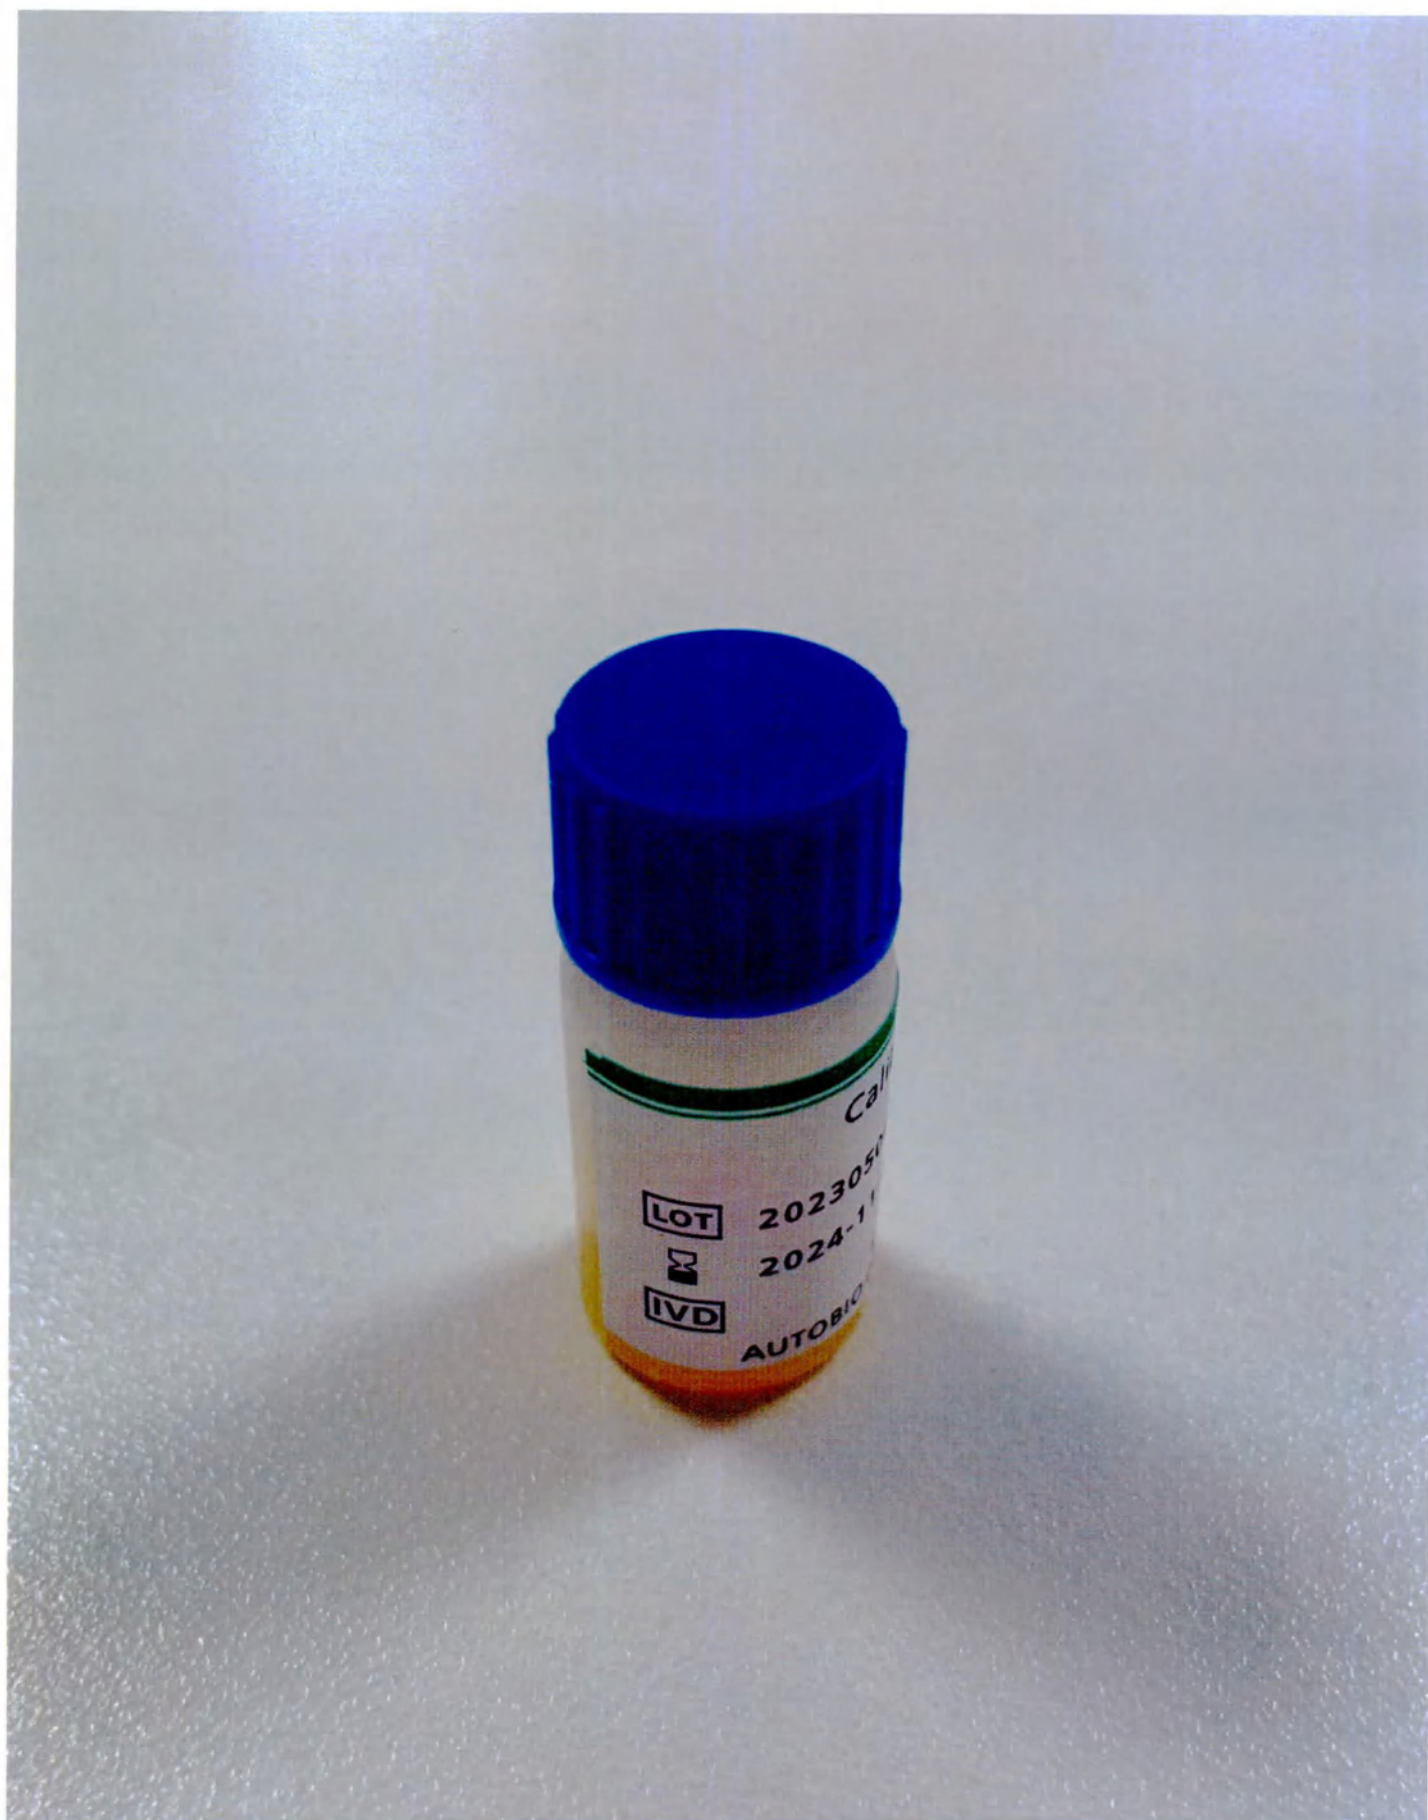


26. Фотография калибратора D (Calibrator D).



27. Фотография калибратора D (Calibrator D).



28. Фотография калибратора D (Calibrator D).

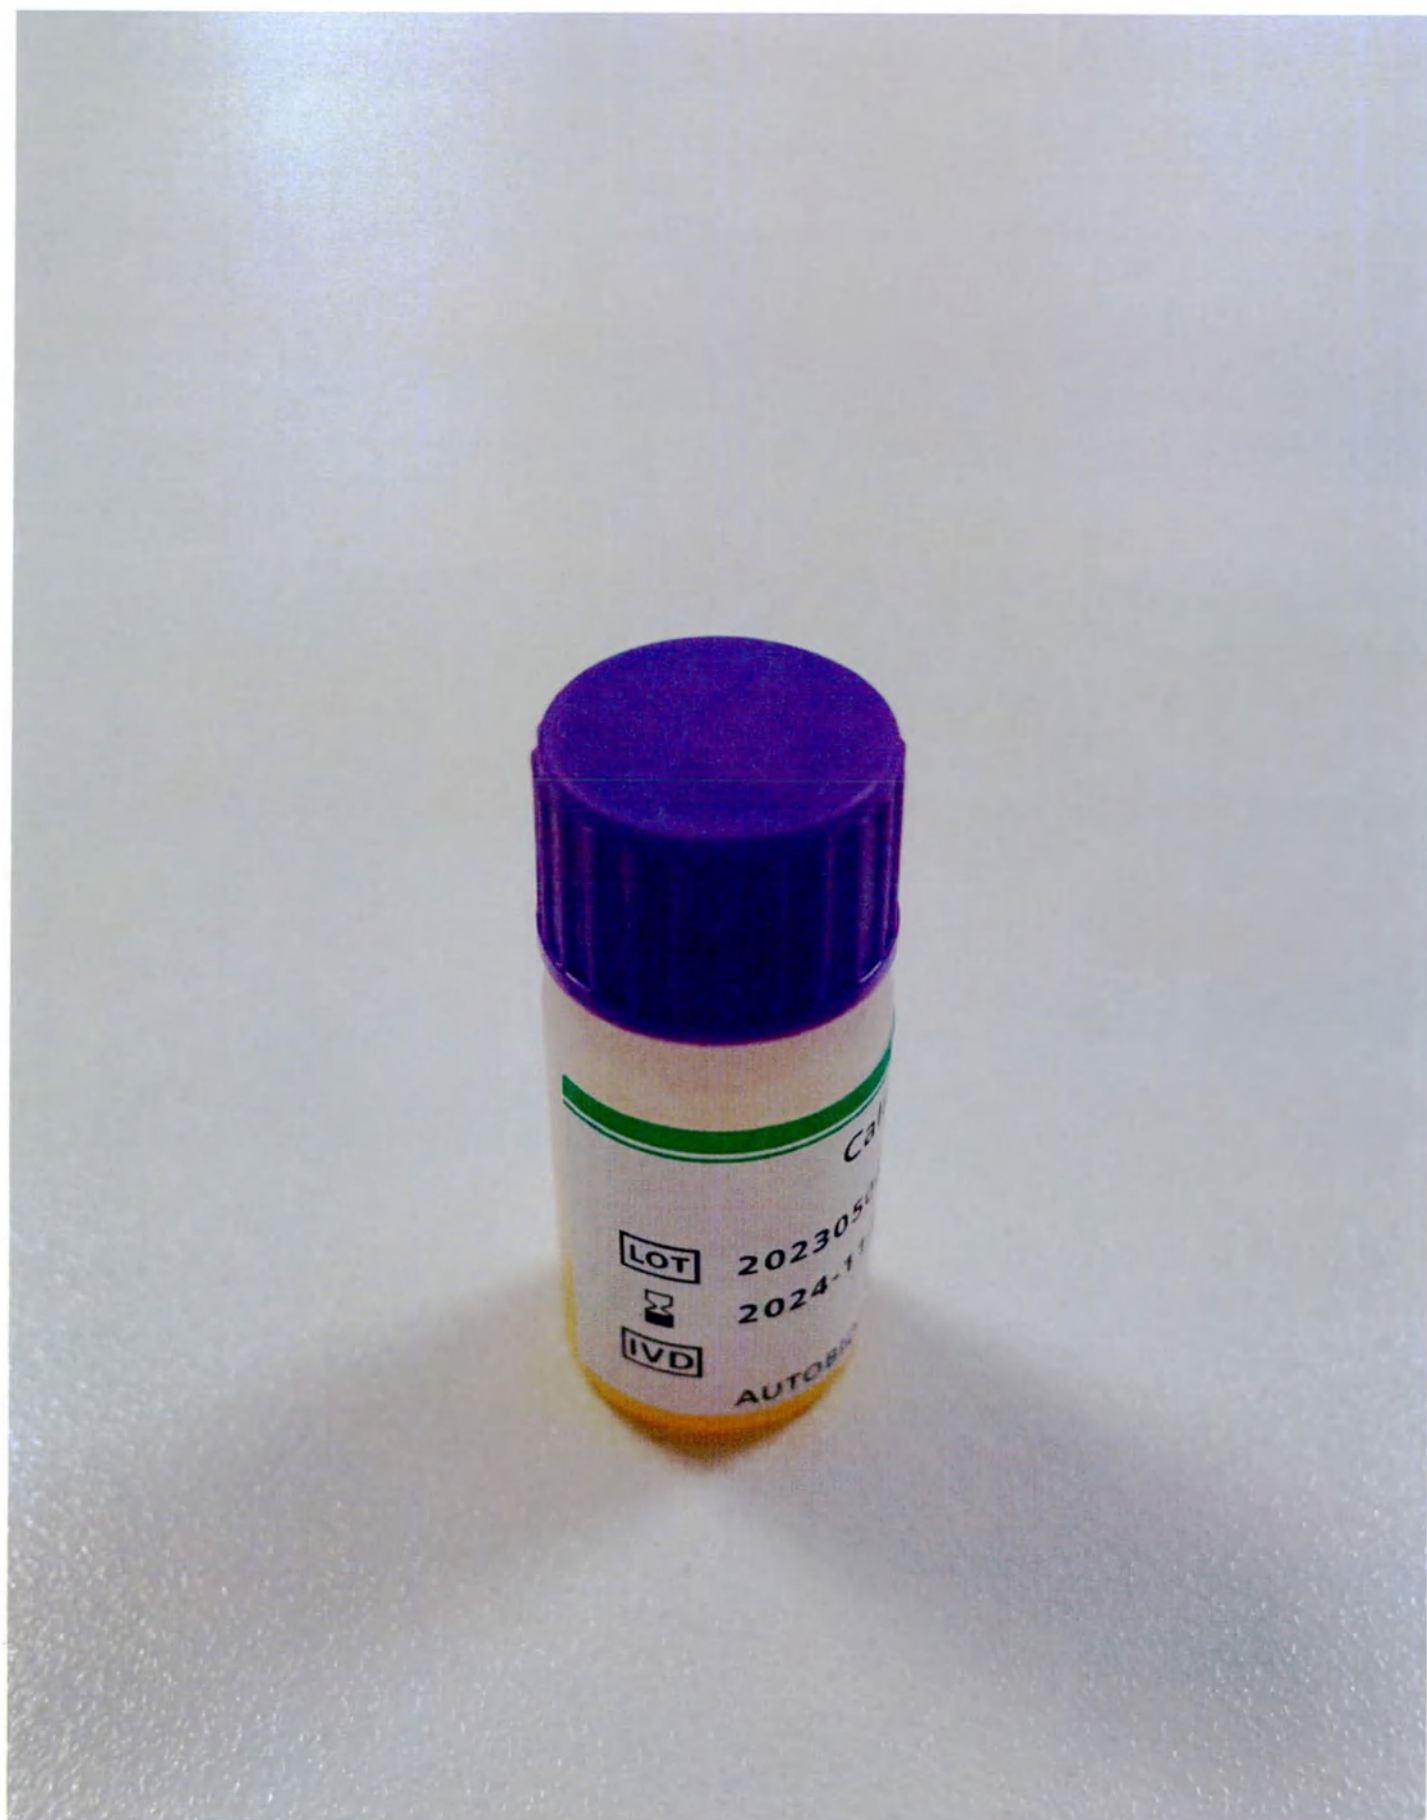


29. Фотография калибратора Е (Calibrator E).




30. Фотография калибратора Е (Calibrator E).



31. Фотография калибратора E (Calibrator E).

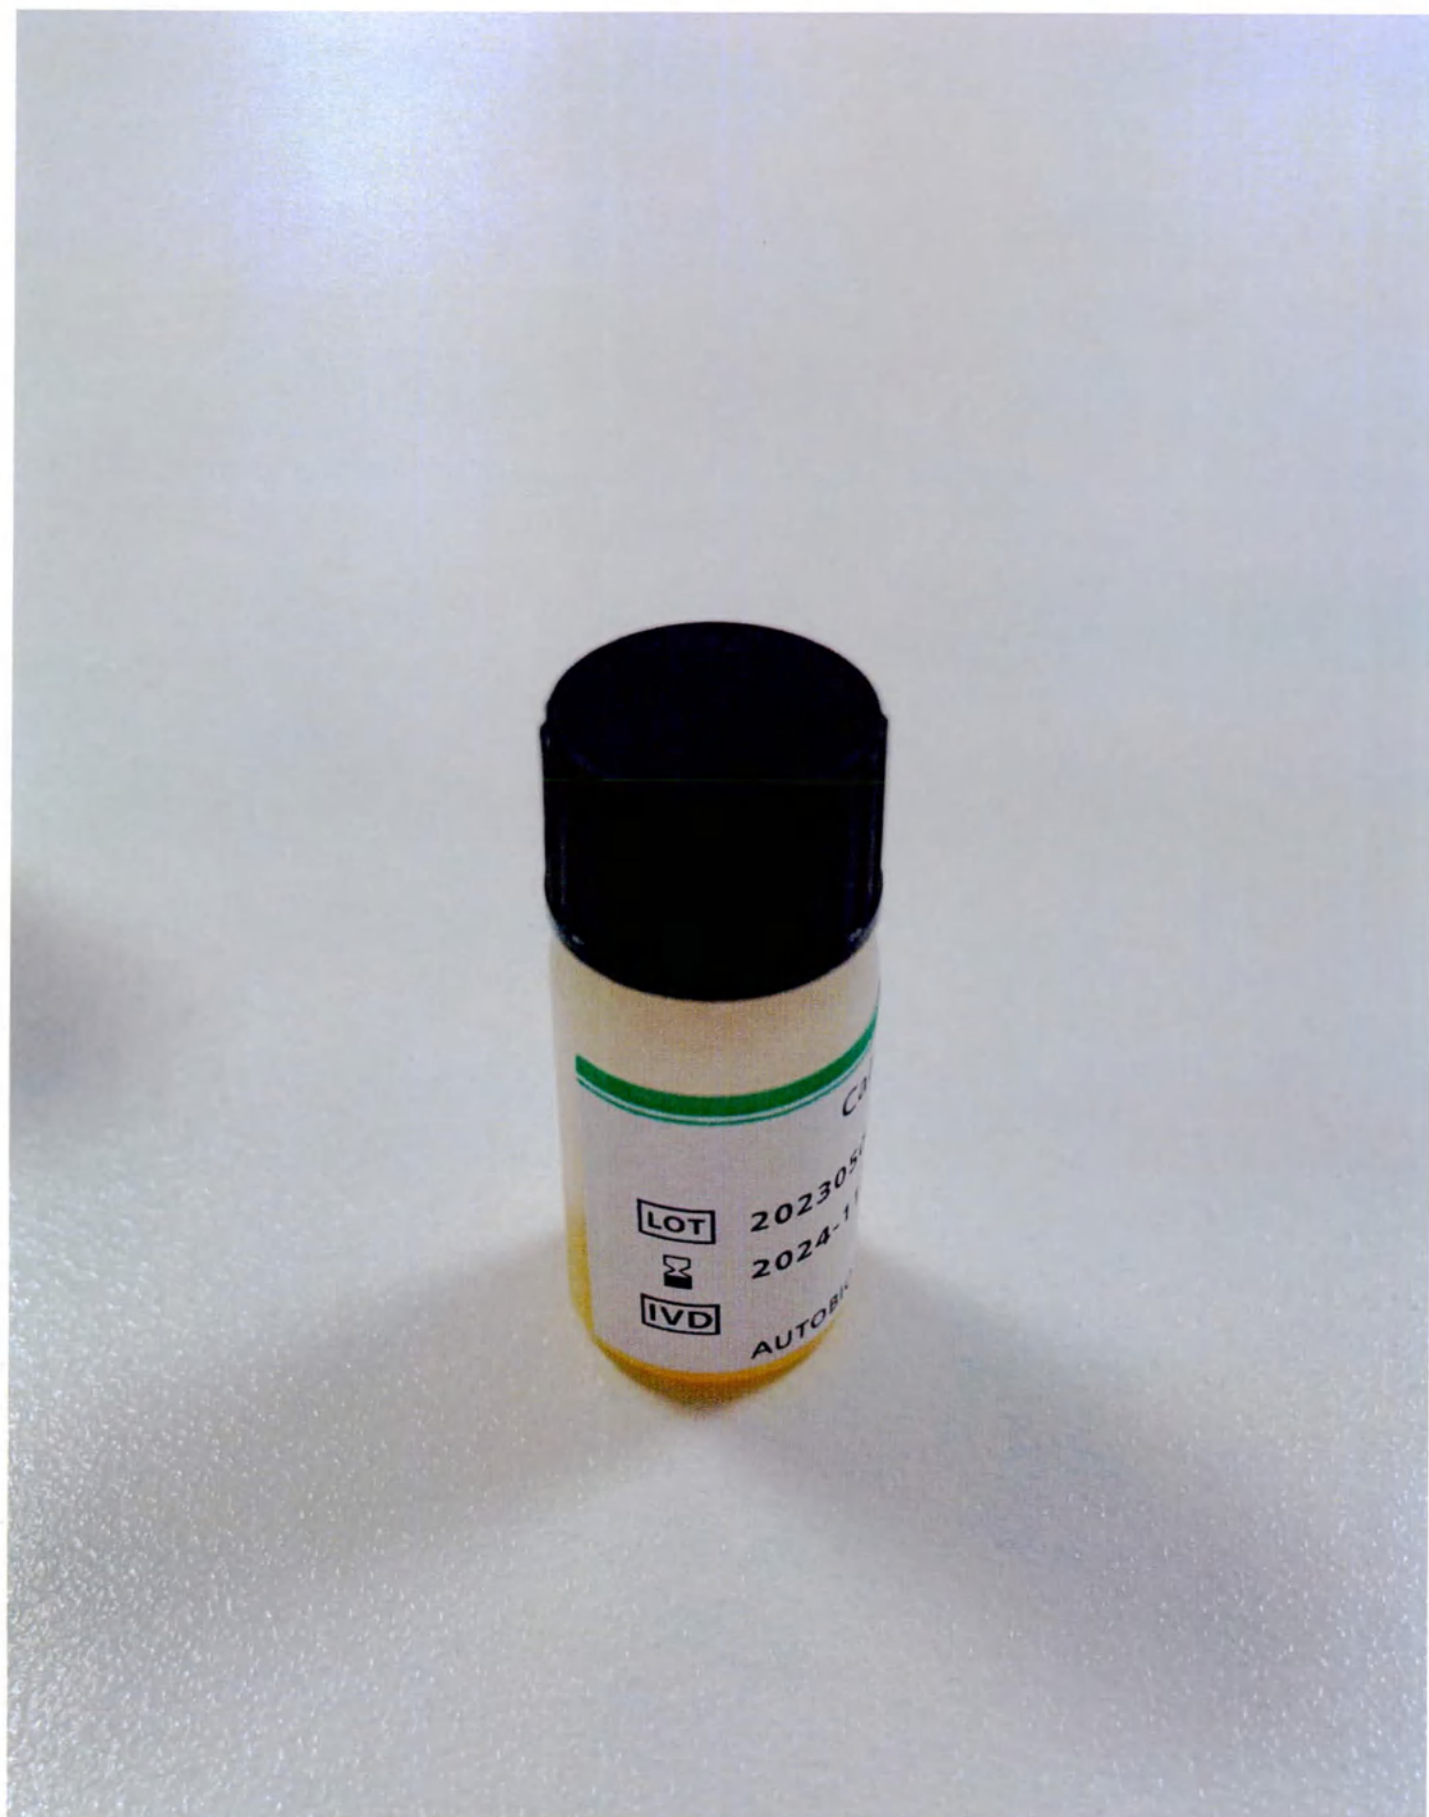


32. Фотография калибратора F (Calibrator F).

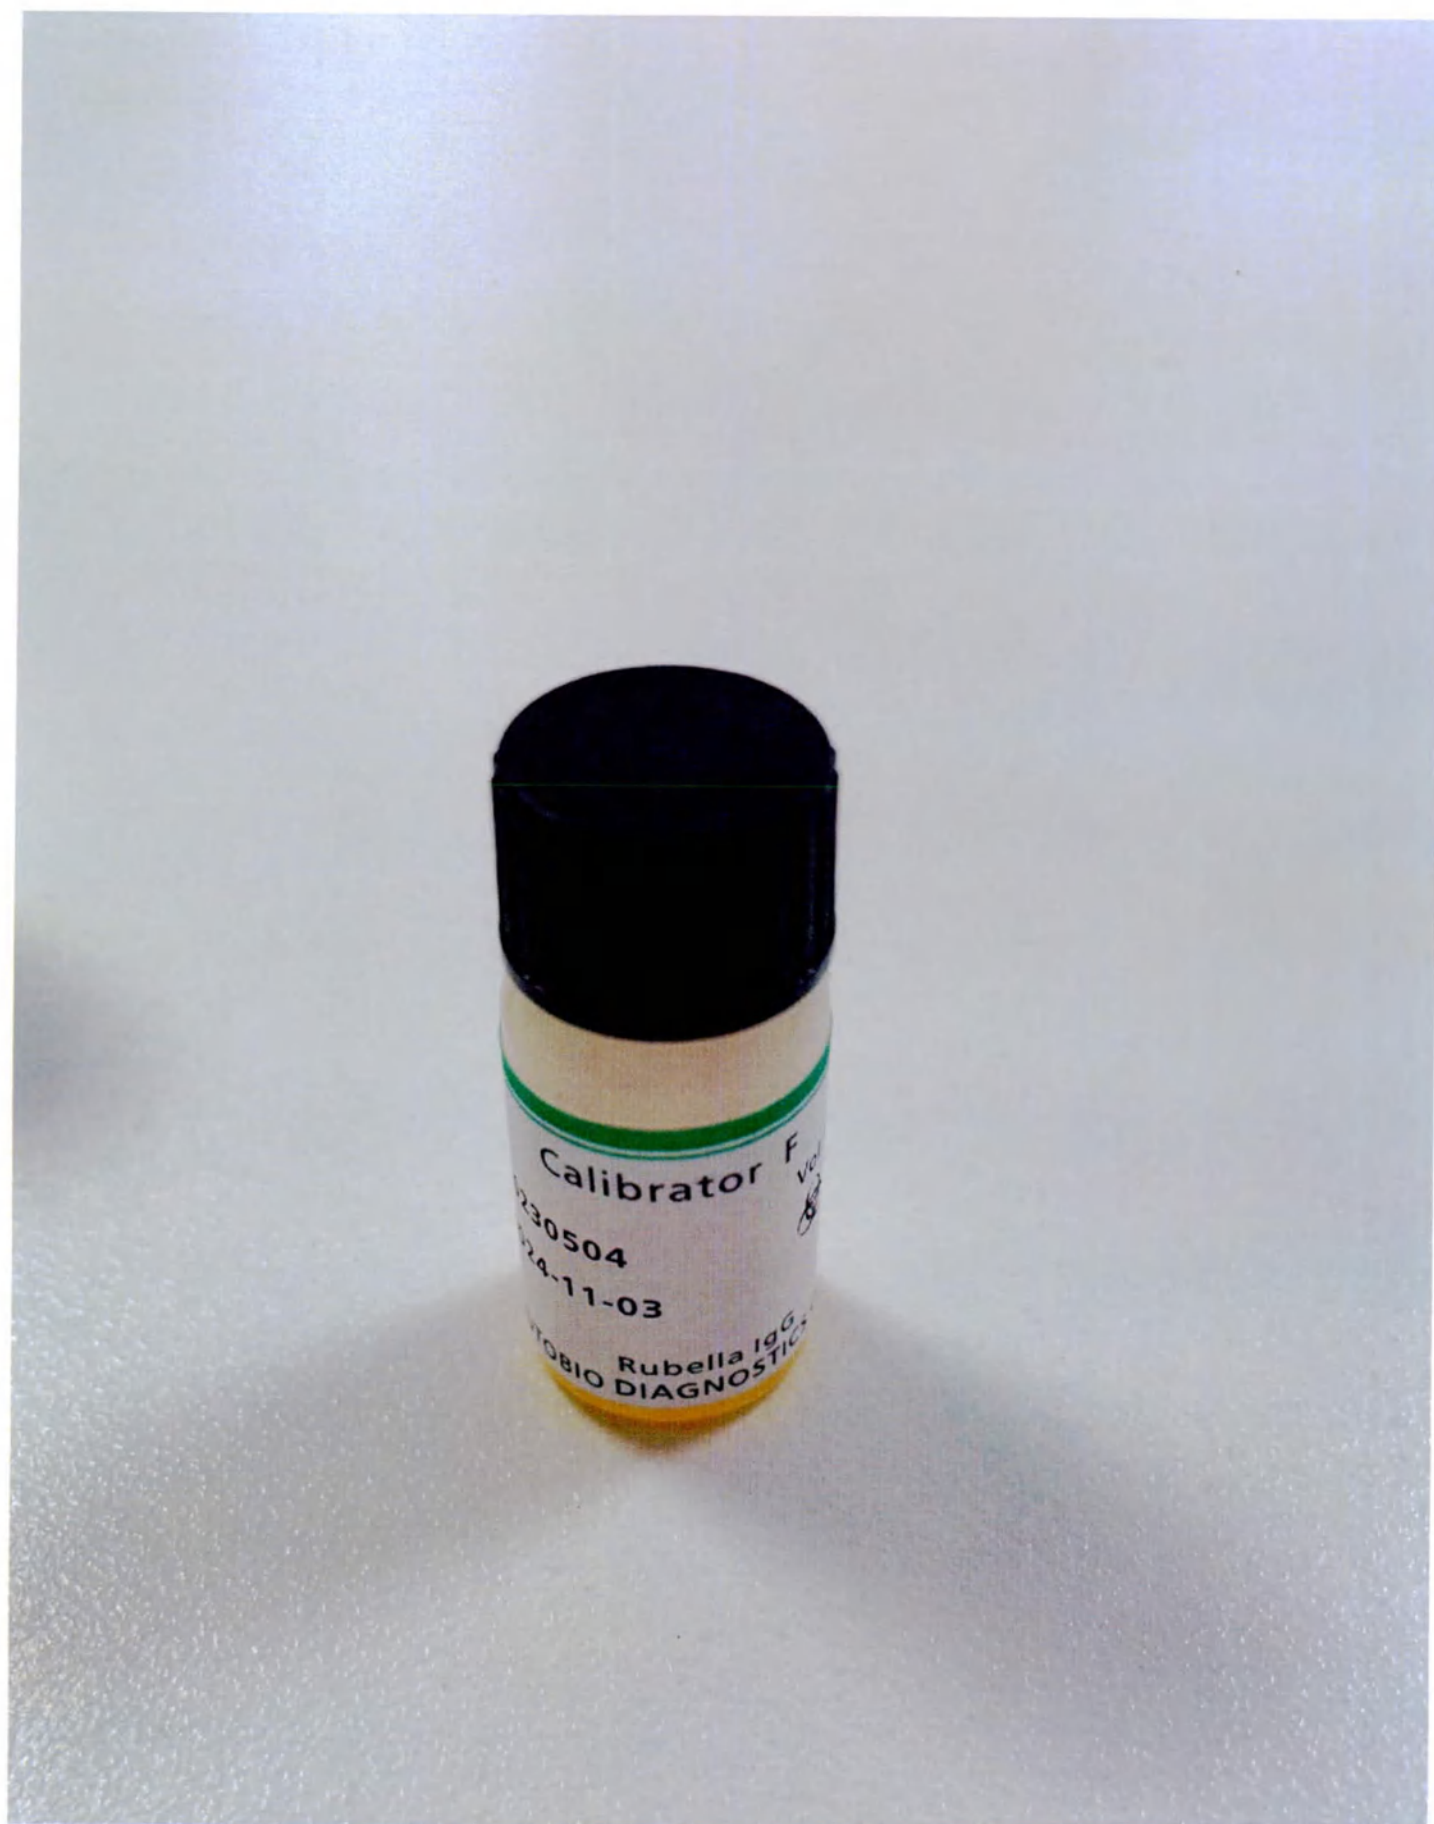


33. Фотография калибратора F(Calibrator F).



34. Фотография калибратора F (Calibrator F).

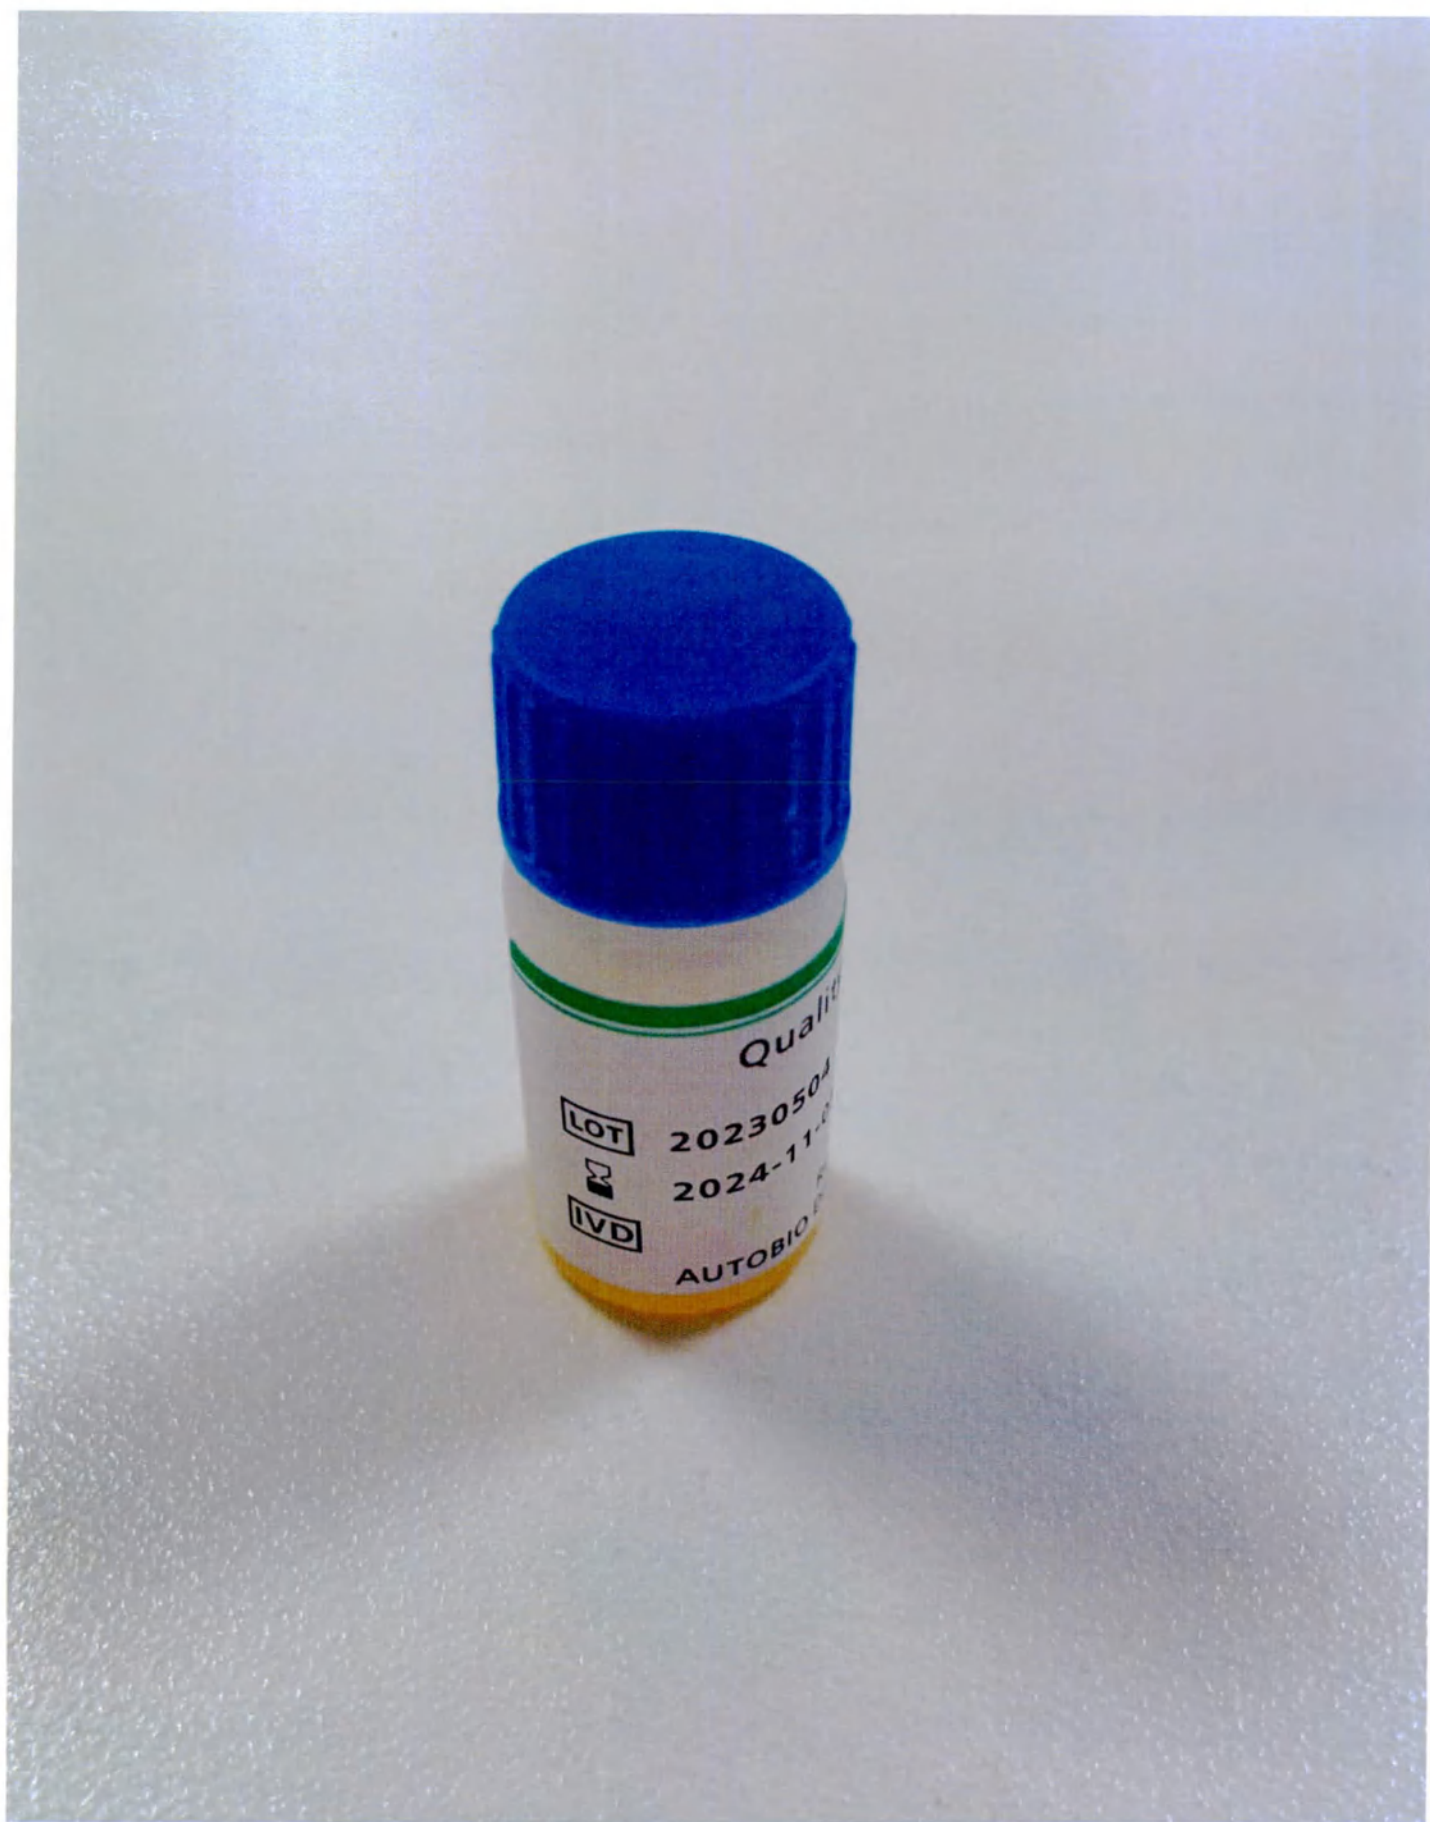


35. Фотография контроля высокого уровня (Quality control 2).

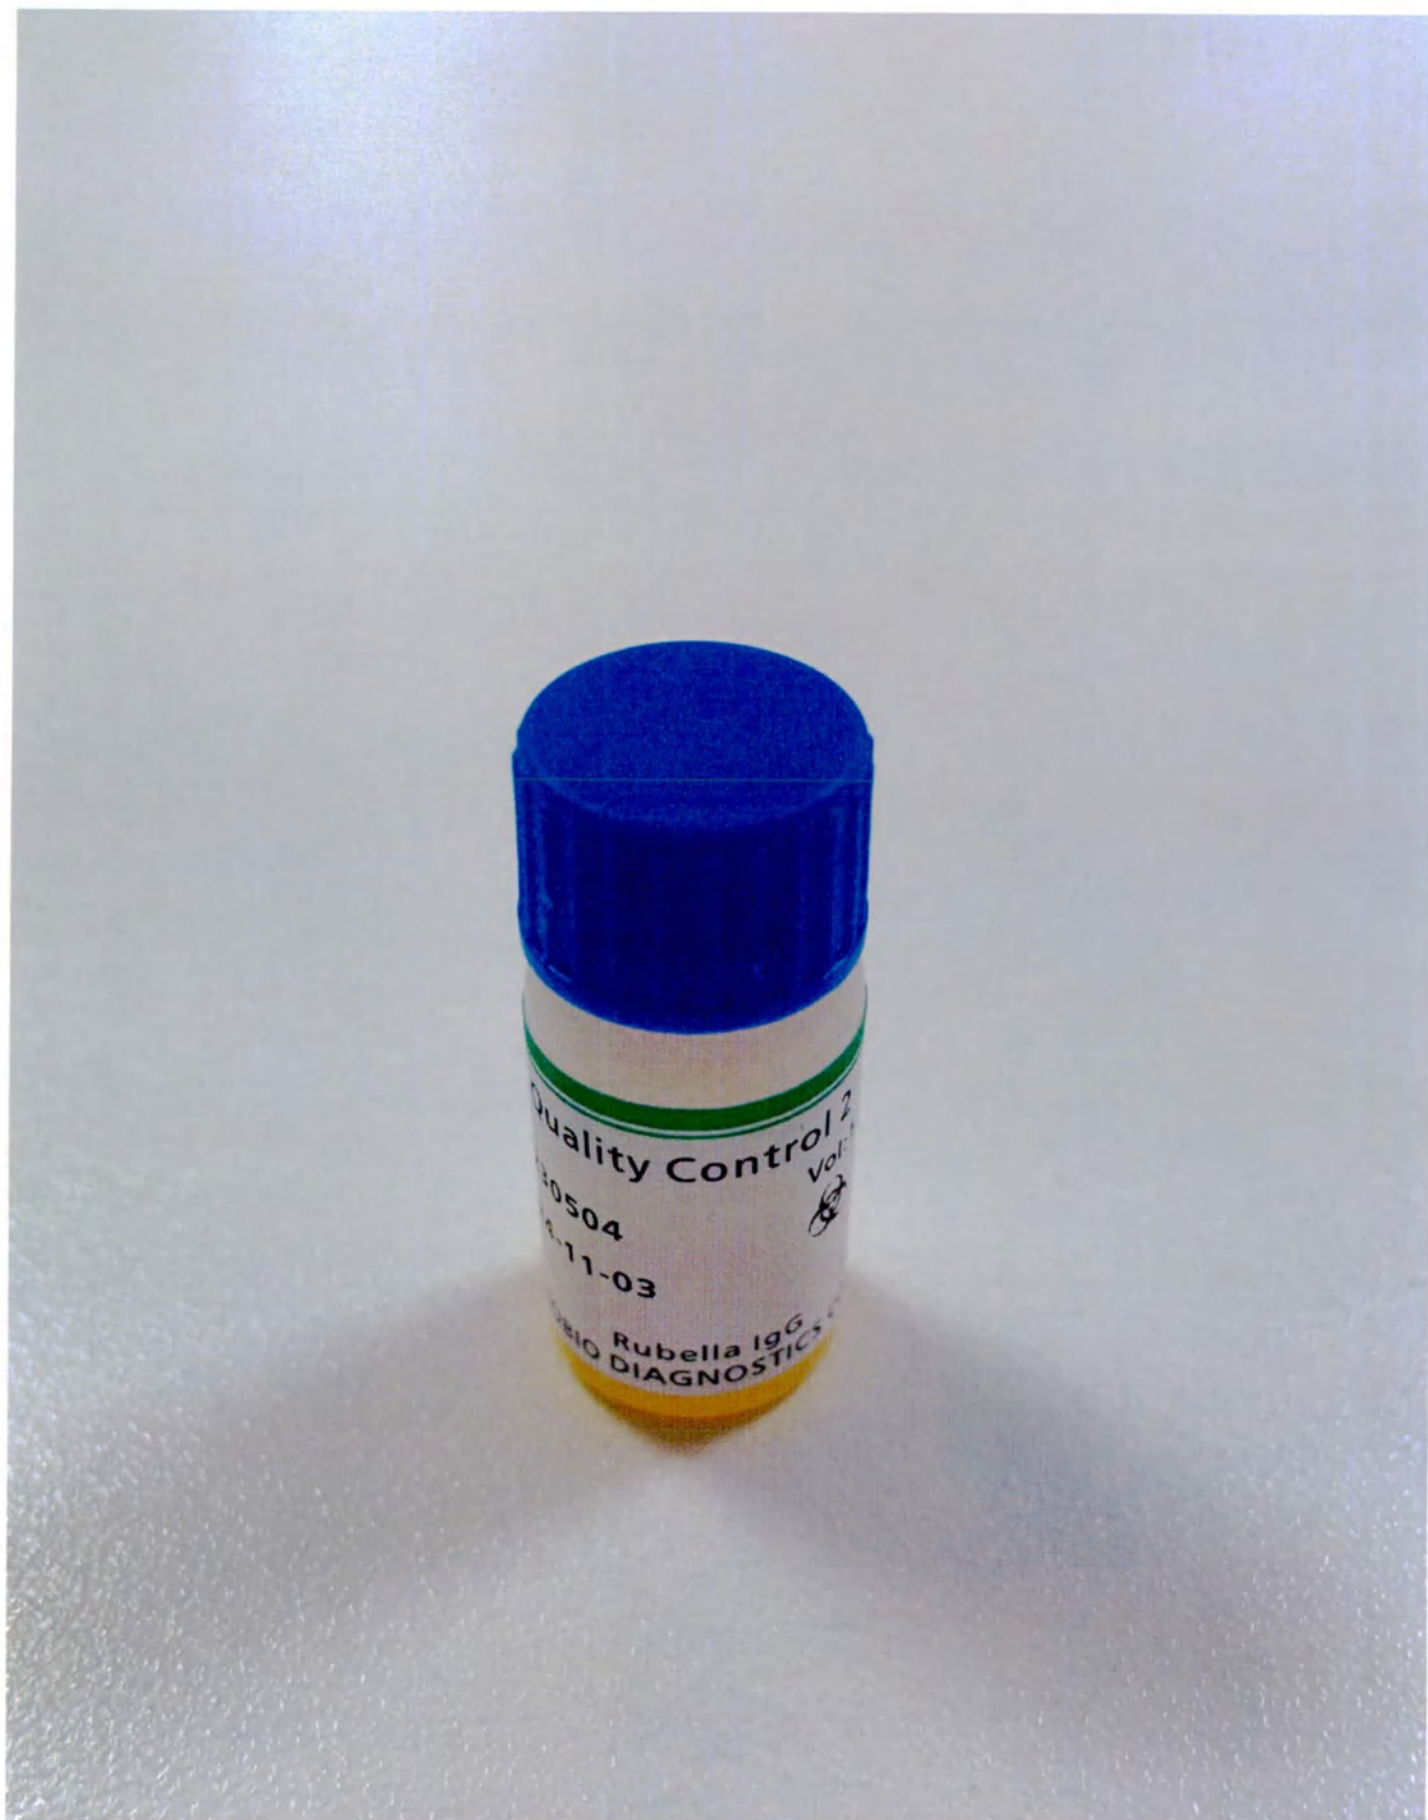


36. Фотография контроля высокого уровня (Quality control 2).




37. Фотография контроля высокого уровня (Quality control 2).

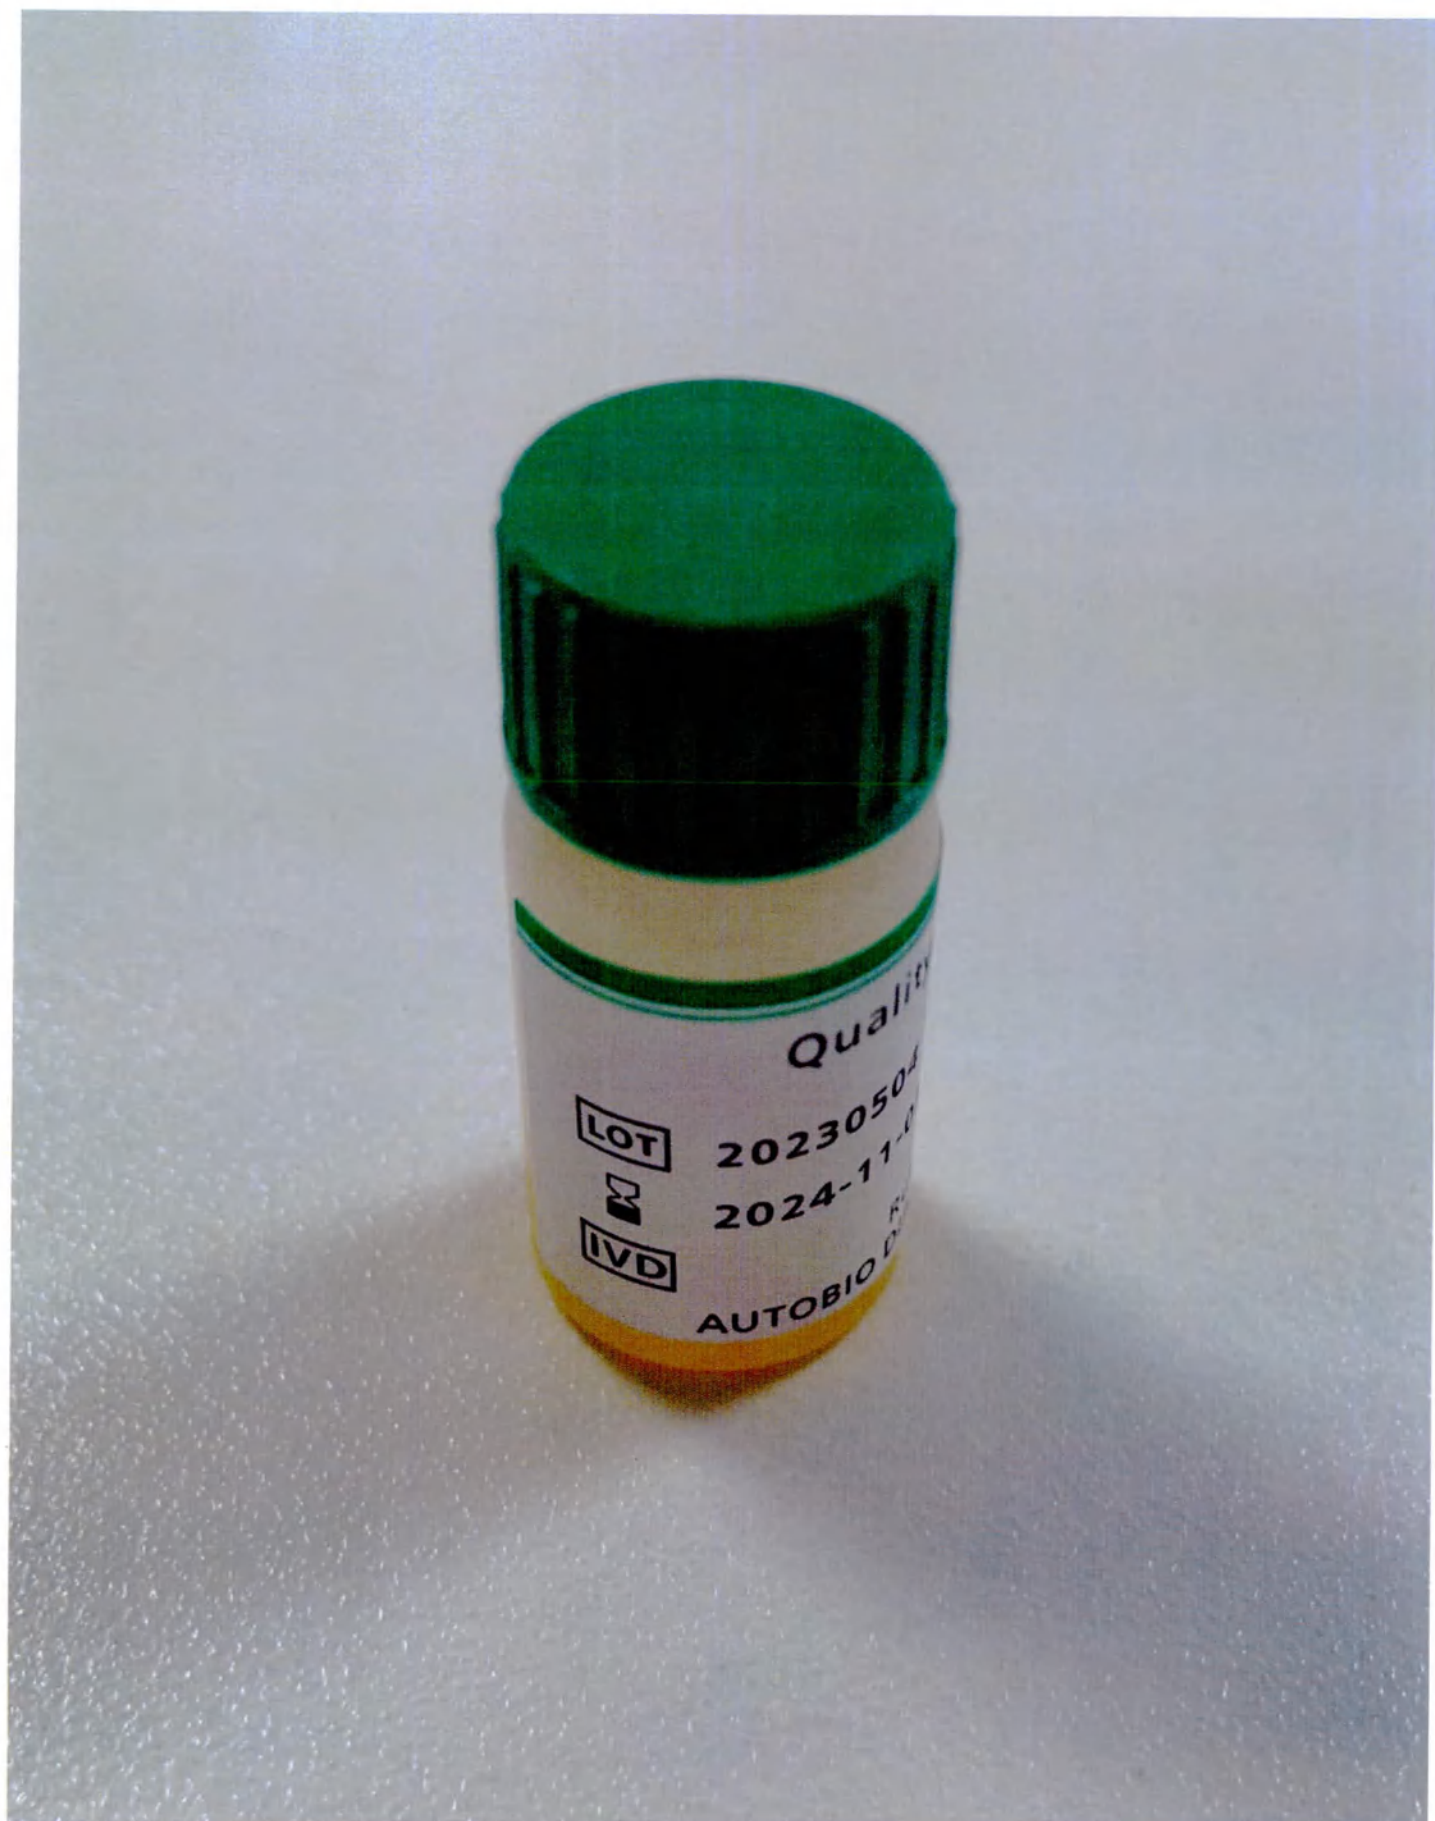

38. Фотография контроля низкого уровня (Quality control 1).

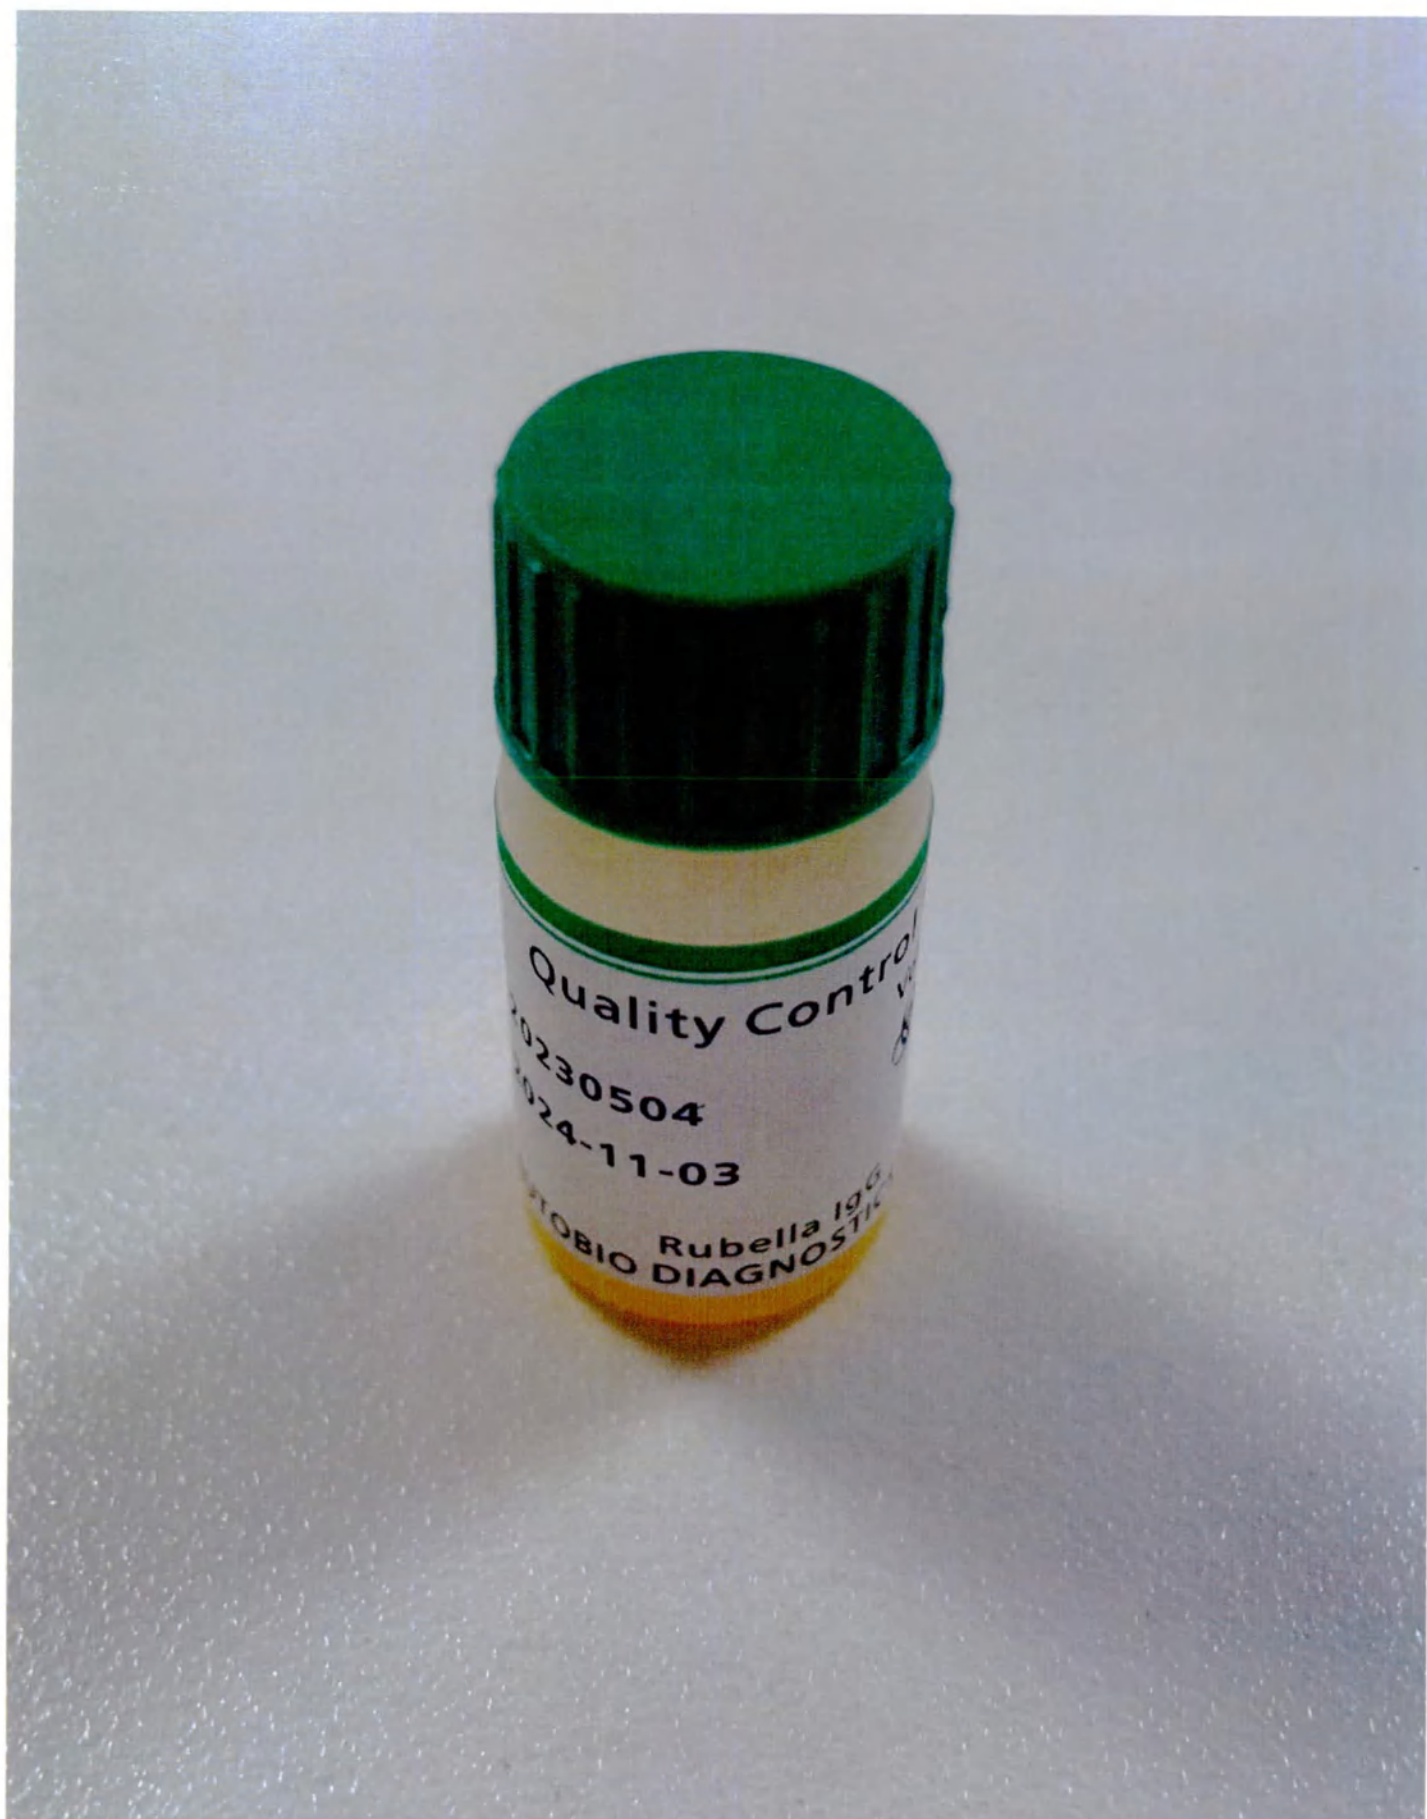

39. Фотография контроля низкого уровня (Quality control 1).

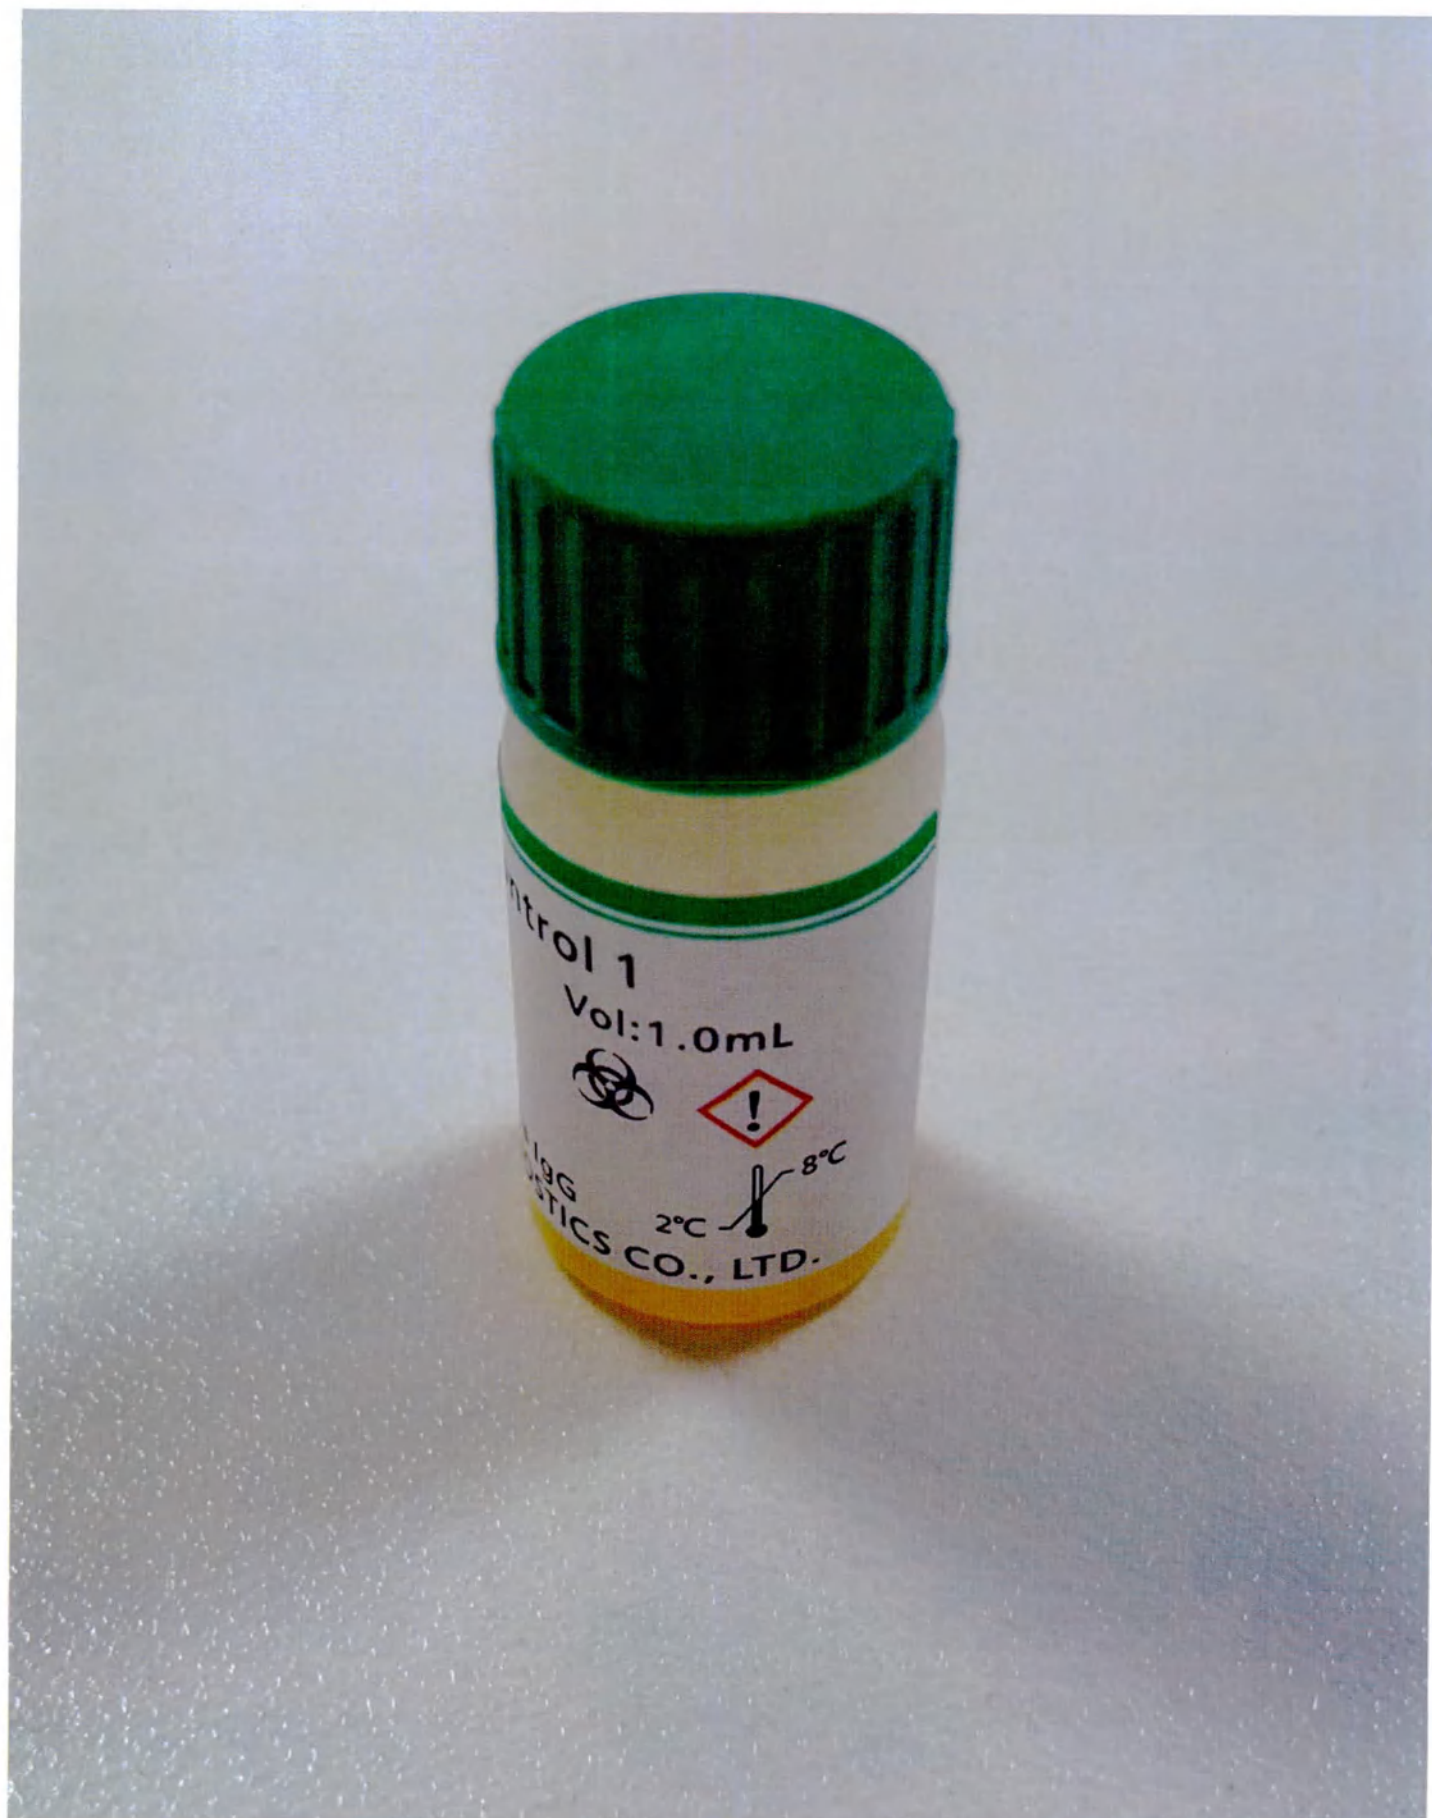

40. Фотография контроля низкого уровня (Quality control 1).



41. Фотография транспортной упаковки медицинского изделия.

Набор реагентов для количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека (Rubella IgG CLIA Microparticles (Rubella IgG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Rubella IgG CLIA Microparticles

REF CMK0805

LOT



IVD

Microparticles Solution 1.2mL x 2

Enzyme Conjugate 5.5mL x 2

Sample Diluent 5.5mL x 2

Calibrator A x 1

Calibrator B x 1

Calibrator C x 1

Calibrator D x 1

Calibrator E x 1

Calibrator F x 1

Quality Control 1 x 1

Quality Control 2 x 1



H317, H412

For professional use only

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

42. Макет русскоязычной маркировки для фасовки 50*2 тестов.

Набор реагентов для количественного определения антител класса IgG к вирусу краснухи в сыворотке и плазме крови человека (Rubella IgG CLIA Microparticles (Rubella IgG)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»

109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ

Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

Rubella IgG CLIA Microparticles

REF CMK0802

LOT



IVD

Microparticles Solution 2.3mL x 1

Enzyme Conjugate 11.0mL x 1

Sample Diluent 11.0mL x 1

Calibrator A x 1

Calibrator B x 1

Calibrator C x 1

Calibrator D x 1

Calibrator E x 1

Calibrator F x 1

Quality Control 1 x 1

Quality Control 2 x 1



H317, H412

For professional use only

AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

43. Макет русскоязычной маркировки для фасовки 100 тестов.



Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 48
(сорок три) листах

