

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО «ЭльМедика»**



**Андросова Е.А.
м.п.**


**Фотографические изображения
медицинского изделия**

**Видеоларингоскоп, серии: VL300, VL310 в
вариантах исполнения**


Zhejiang UE Medical Corp. (Чжэцзян UE Медикал Корп.), Китай



Монитор VL300 (вид спереди)

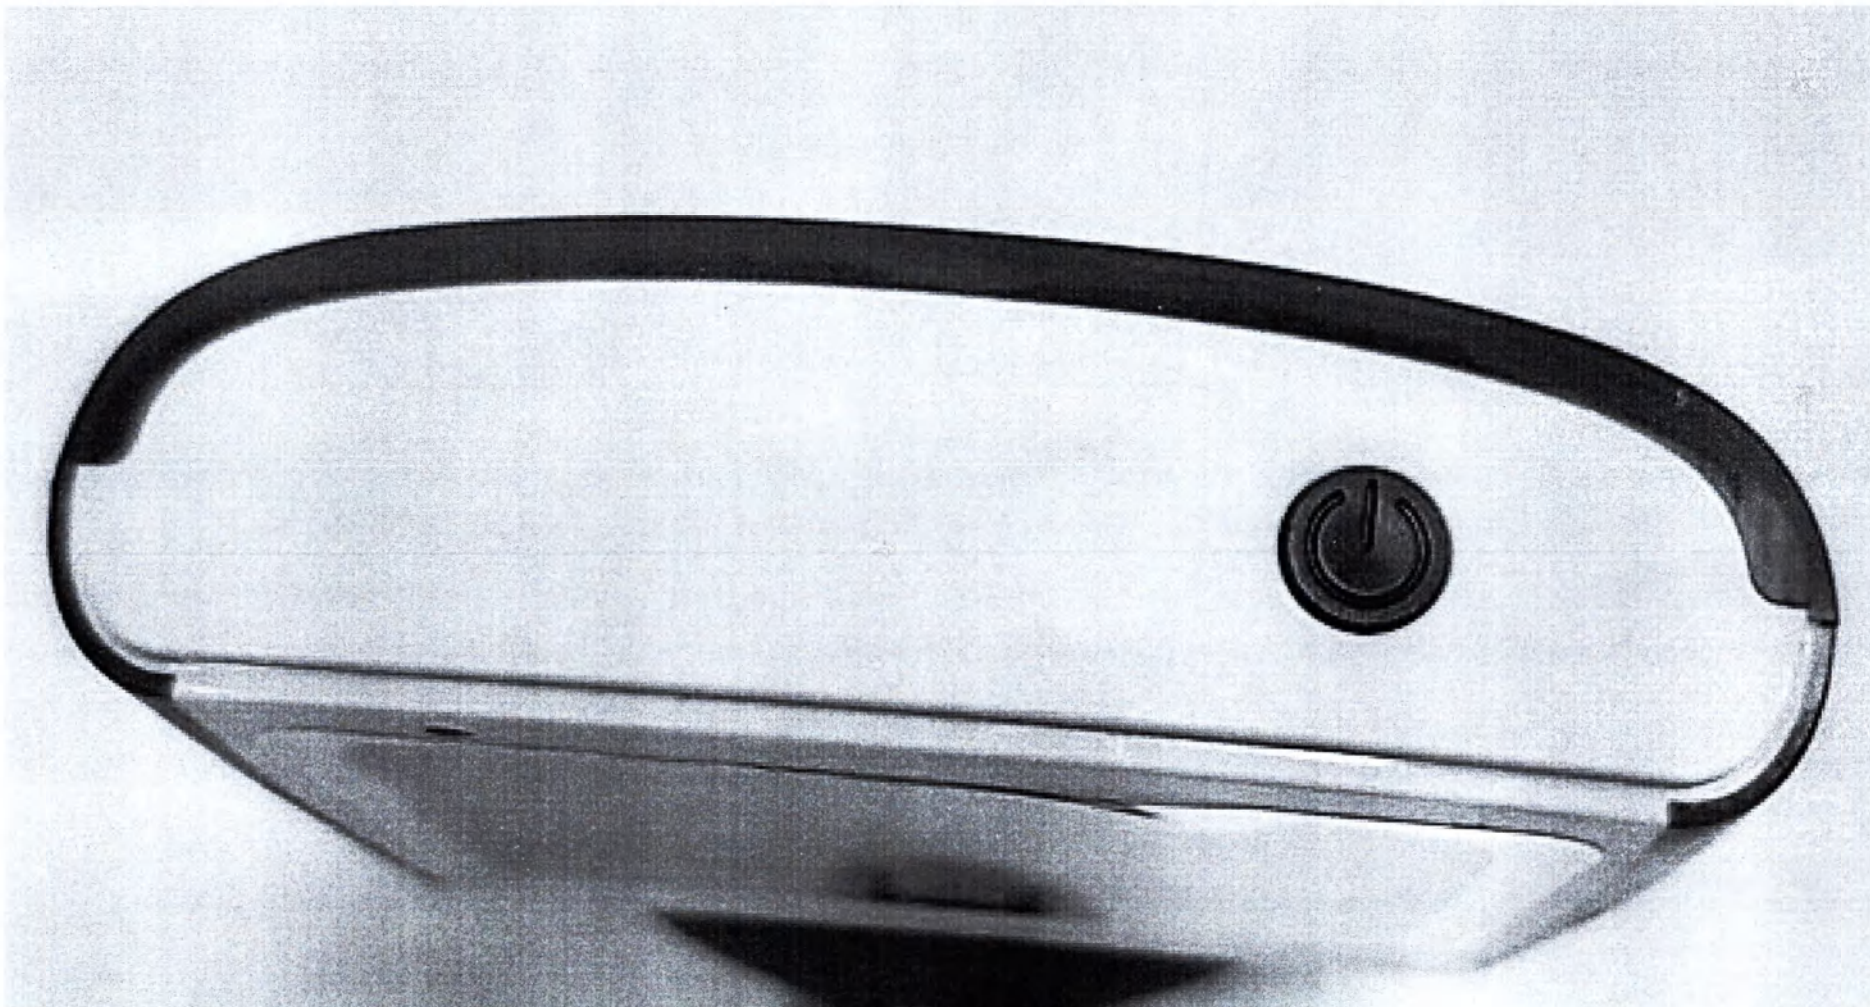

Монитор VL300 (вид сверху)

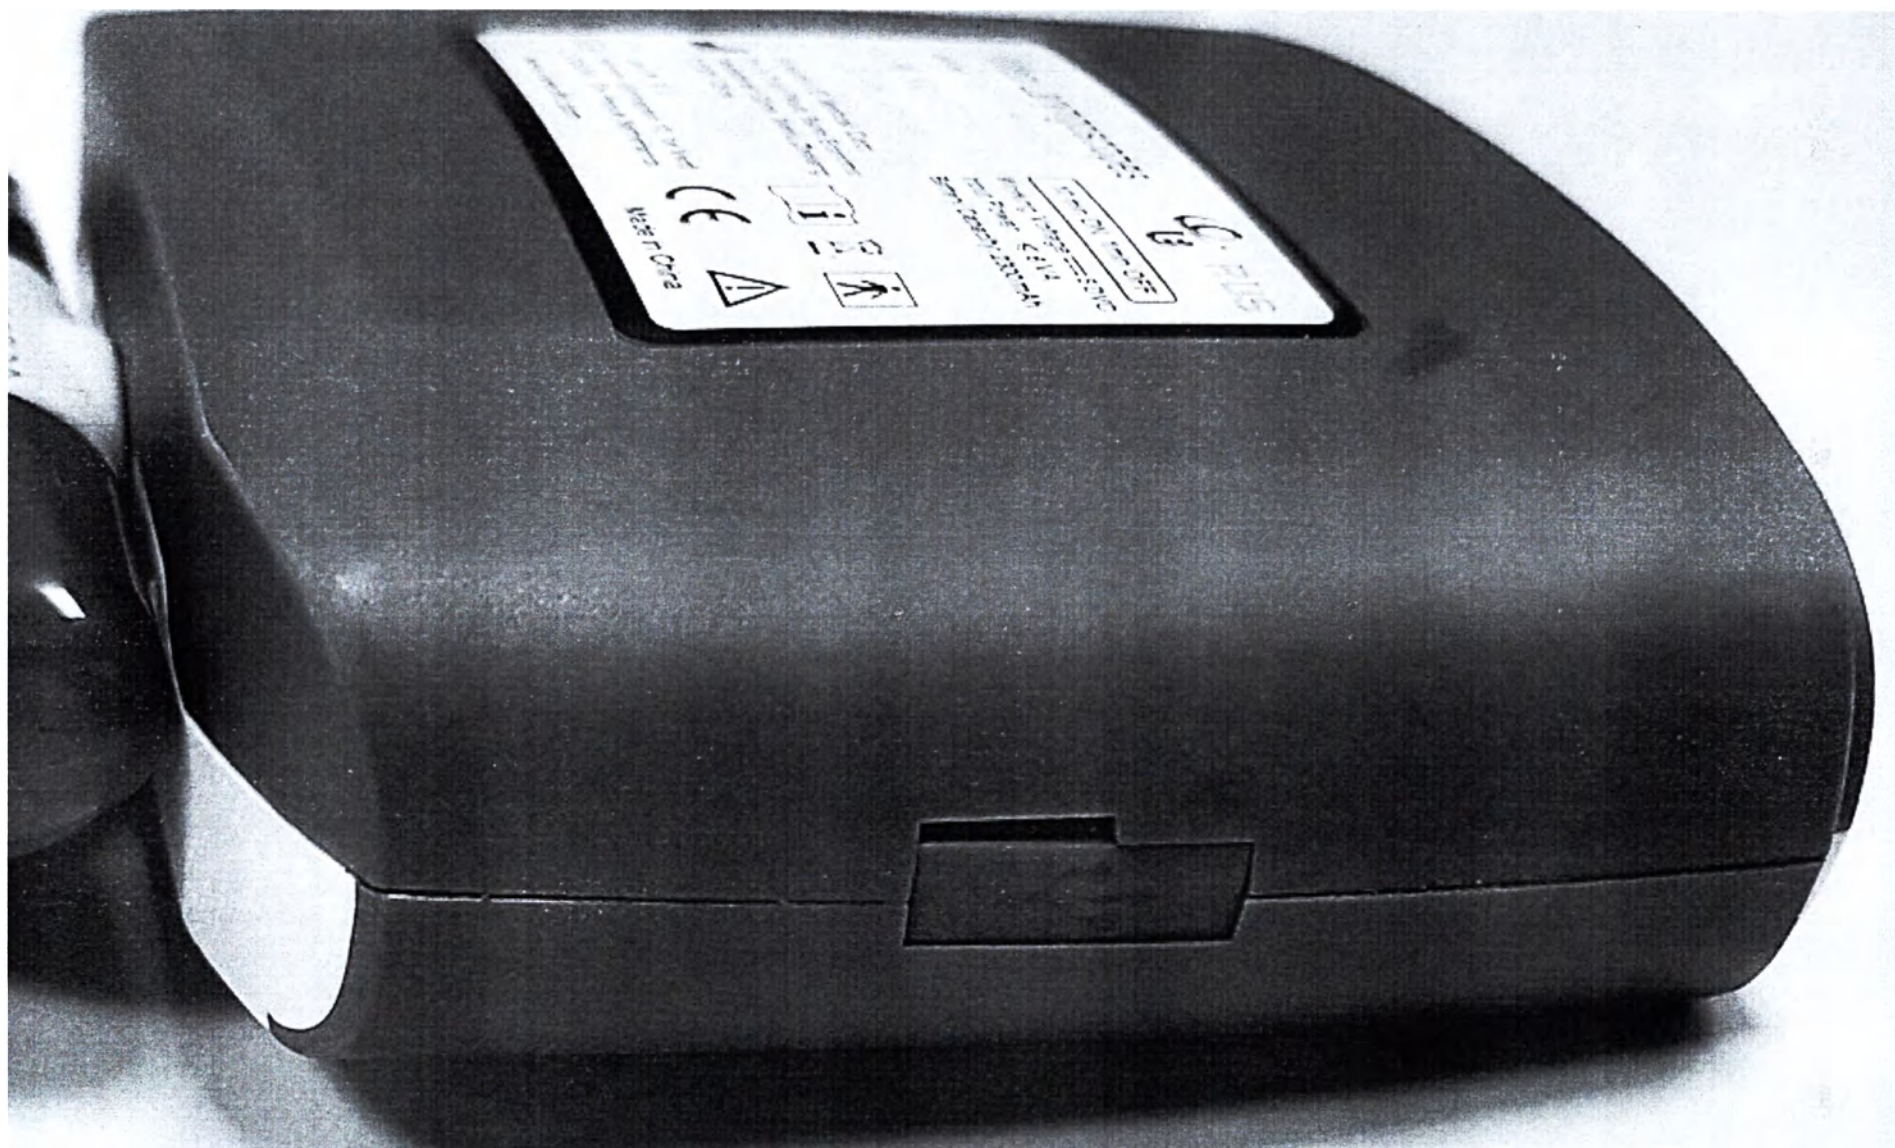

Монитор VL300 (вид сбоку)



Video Laryngoscopes



Model: VL300 Monitor

10 min ON, 1min OFF

[SN]: UEA0C72F

Working Voltage: $\approx$ 5DVC

[Date]: 2023-09-23

Input Power: $\leq$ 6 VA

Battery Capacity: 2300 mAh



Zhejiang UE Medical Corp.

No. 8, Youyi Road, Baila Economic
Development Zone, Xianju, Zhejiang
317300, China



Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd
2595AA, The Hague, Netherlands



www.ueworld.com


Made in China

UEA0C72F


Монитор VL300 (маркировка)



Монитор VL310 (вид спереди)

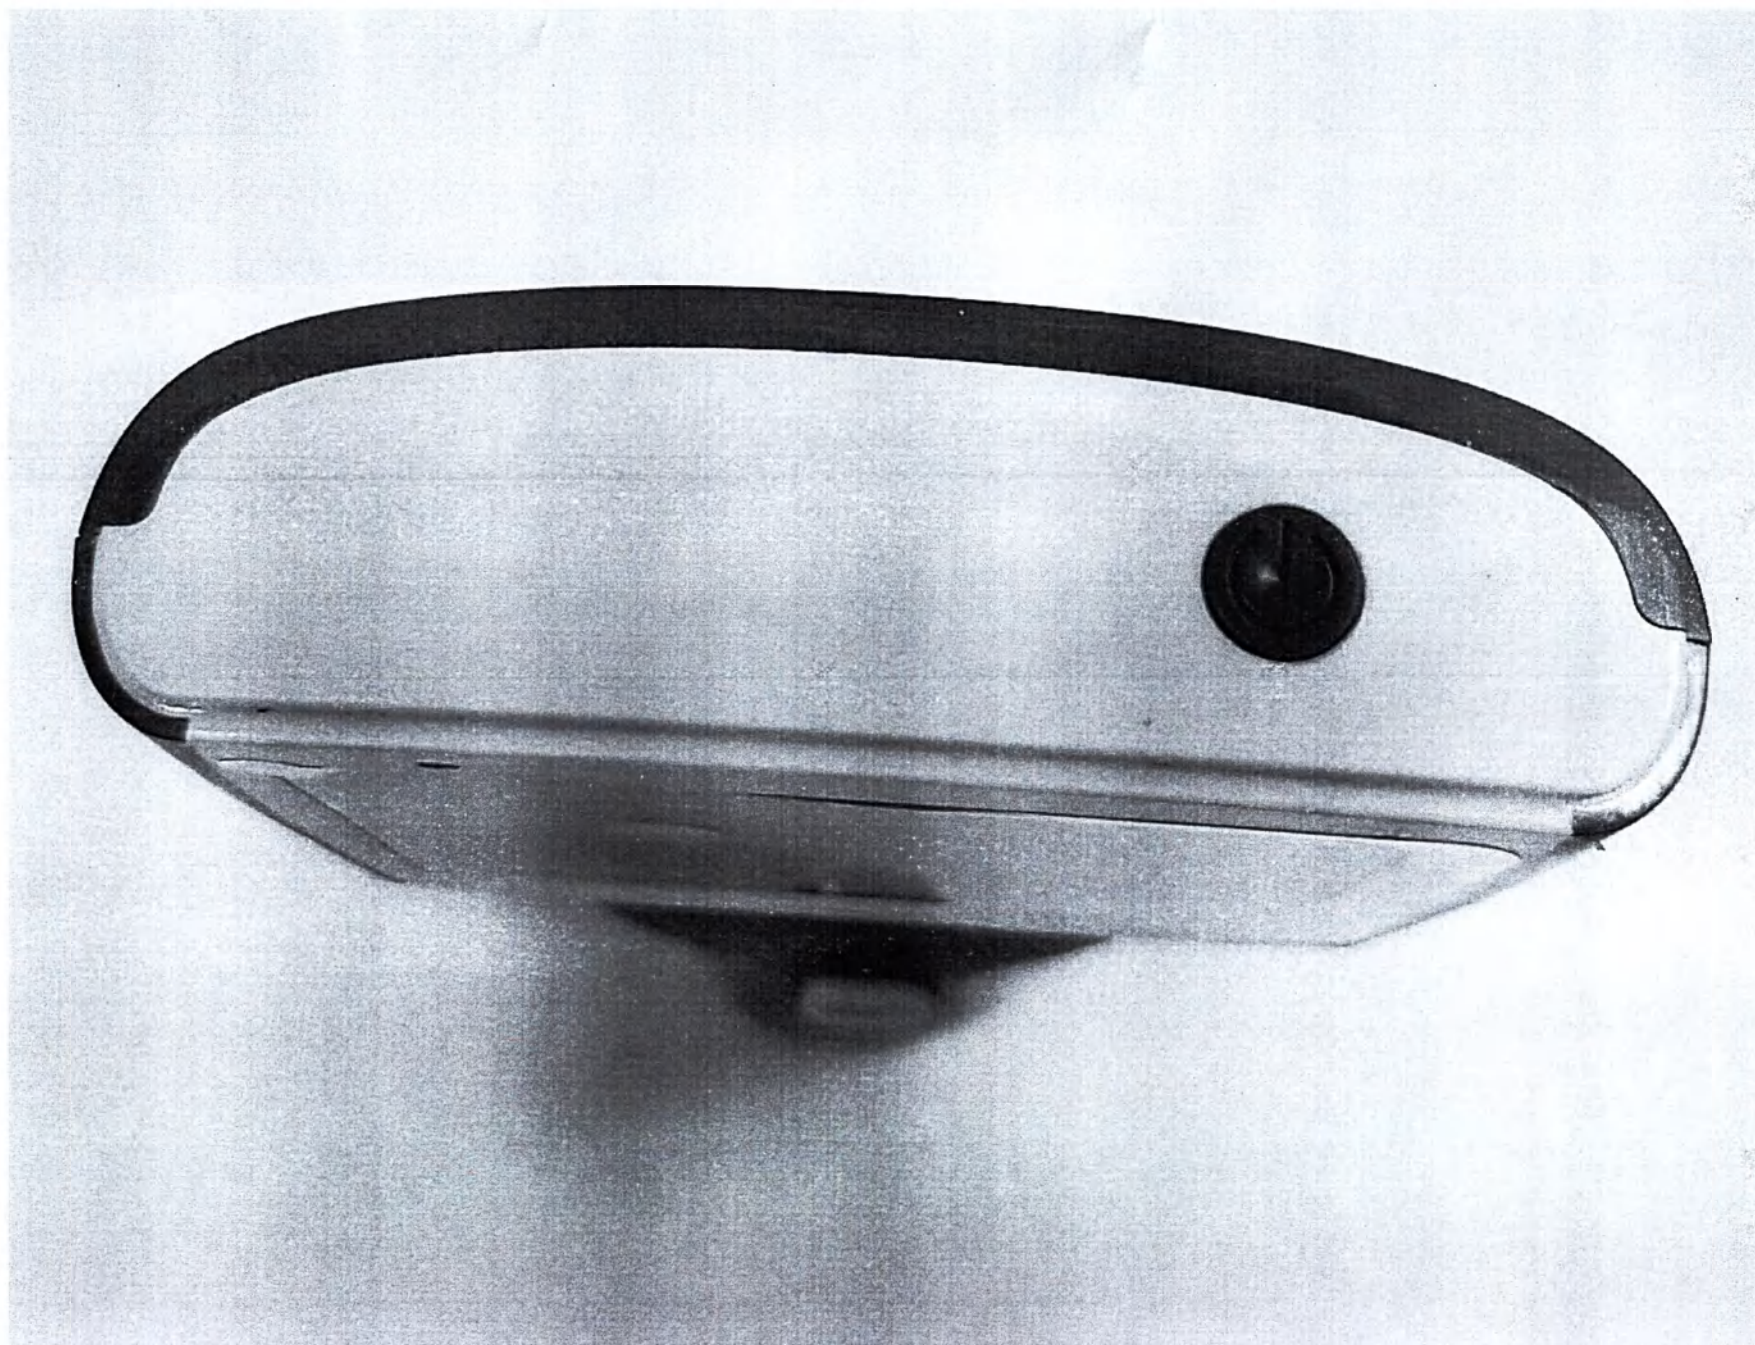


Монитор VL310 (вид сверху)

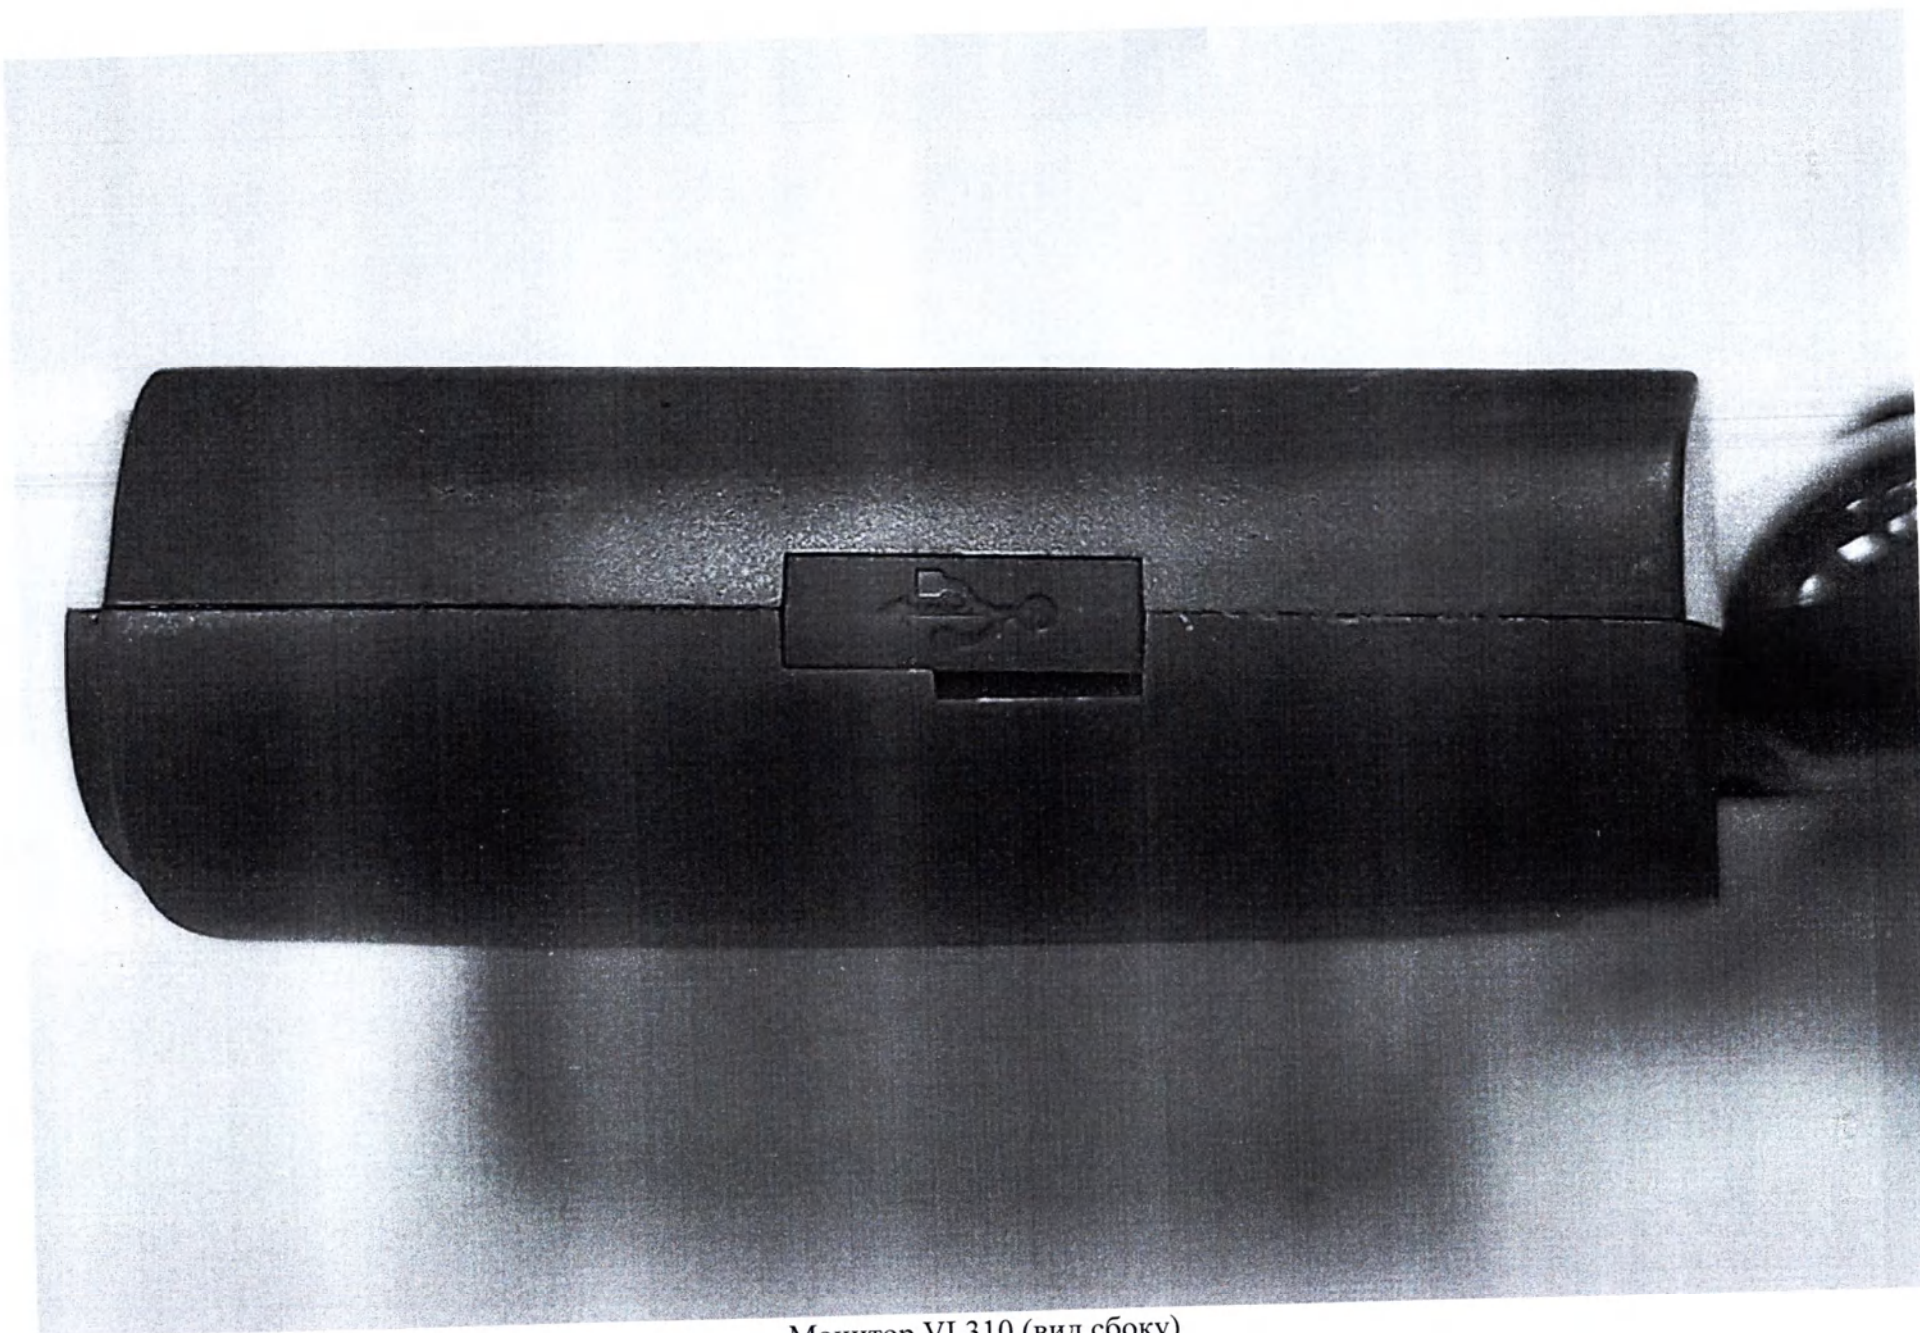

Монитор VL310 (вид сбоку)

Video Laryngoscopes



Model: VL310 Monitor

10 min ON, 1min OFF

SN: UEA0C730

Working Voltage: 5DVC

2023-09-15

Input Power: ≤ 6 VA

Battery Capacity: 2300 mAh



Zhejiang UE Medical Corp.

No. 8, Youyi Road, Baita Economic
Development Zone, Xianju, Zhejiang
317300, China



Lotus NL B.V.

Koningin Julianaplein 10, 1e Verd
2595AA, The Hague, Netherlands




www.ueworld.com

Made in China

UEA0C730

Монитор VL310 (маркировка)

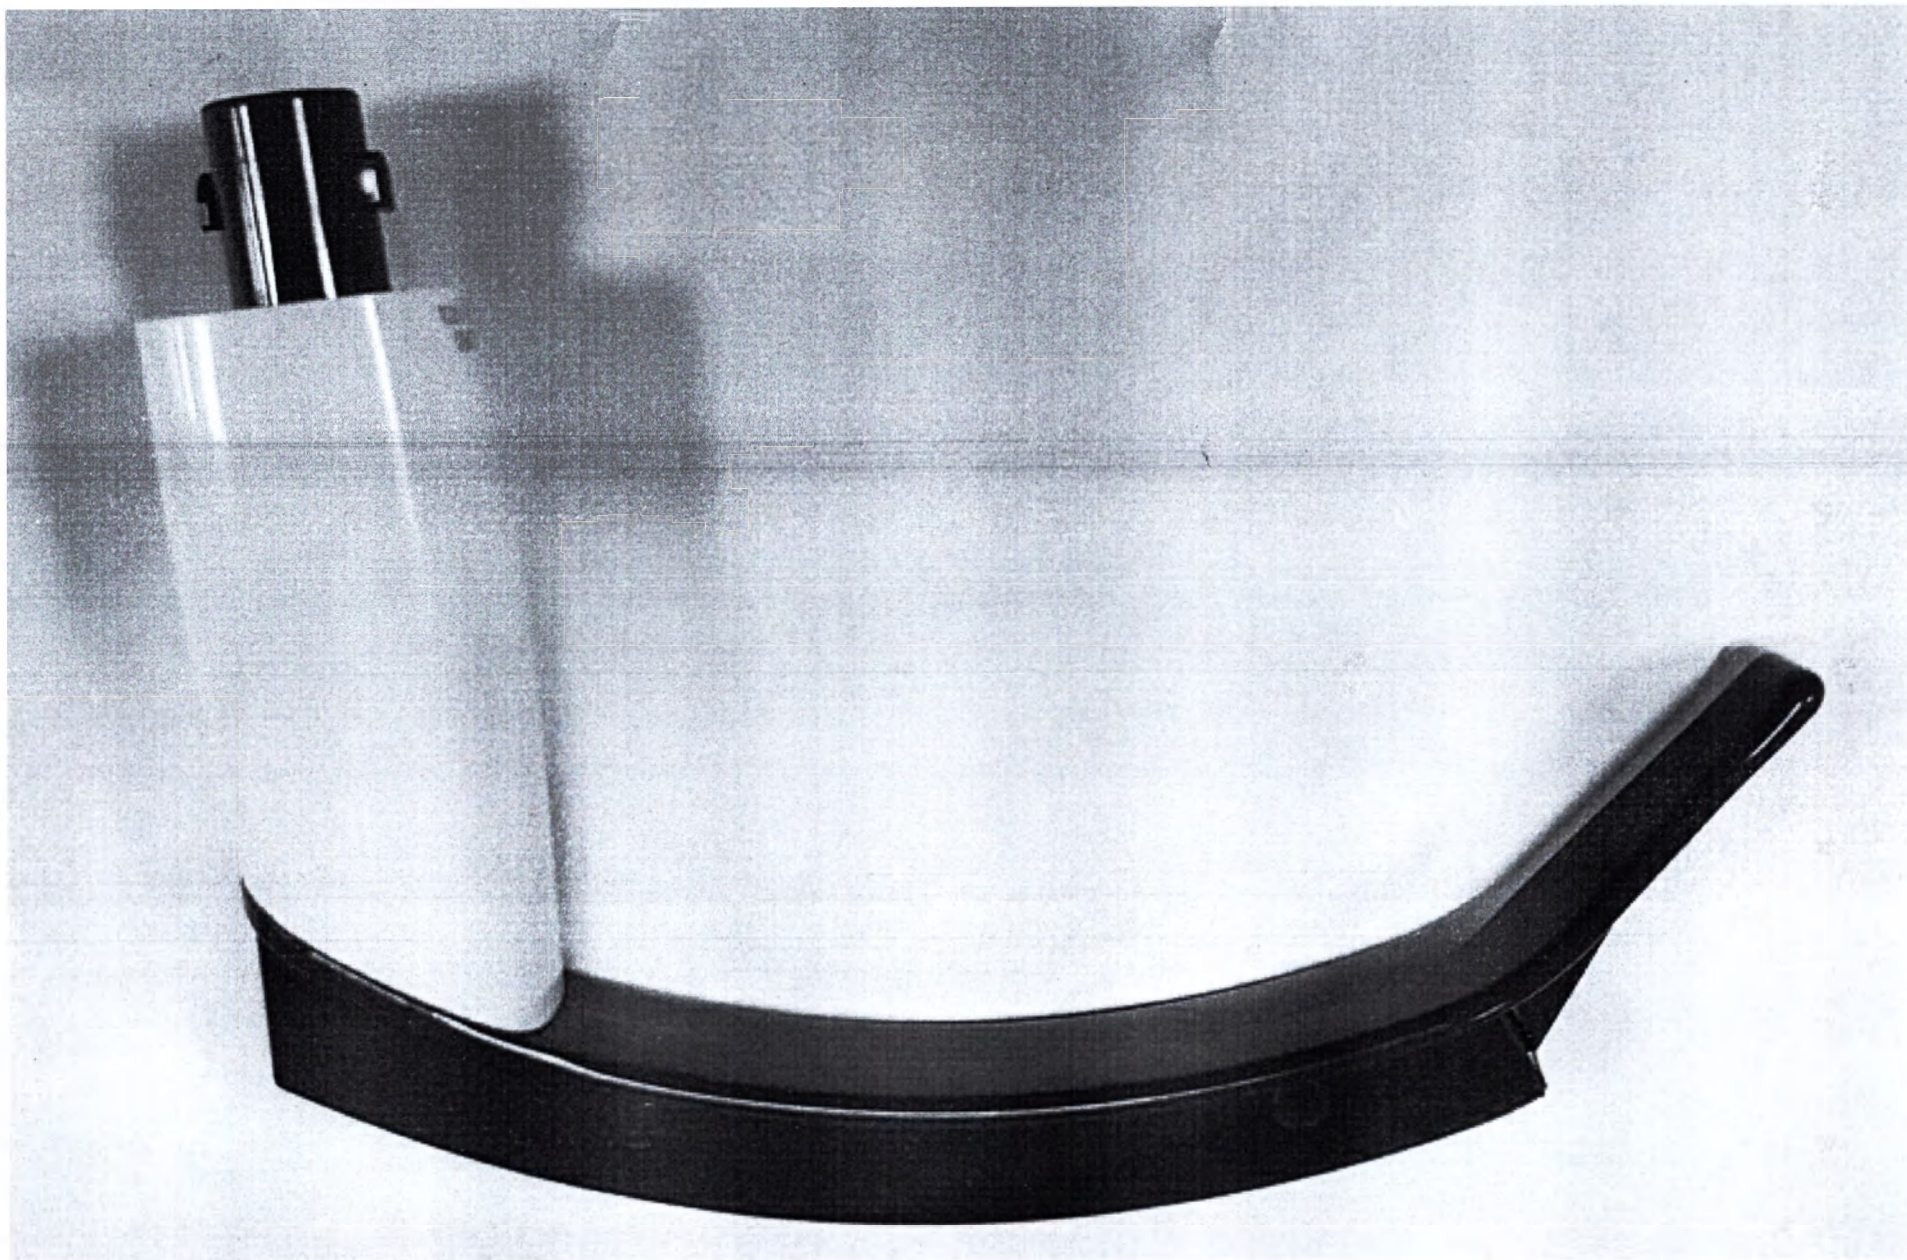


Общий вид Ручка-клинок изогнутый, многоразовый, размер L, размер 4



Ручка-клинок изогнутый, многоцветный, размер 4 (маркировка)



Ручка-клинок изогнутый, многоцветный, размер L (маркировка)

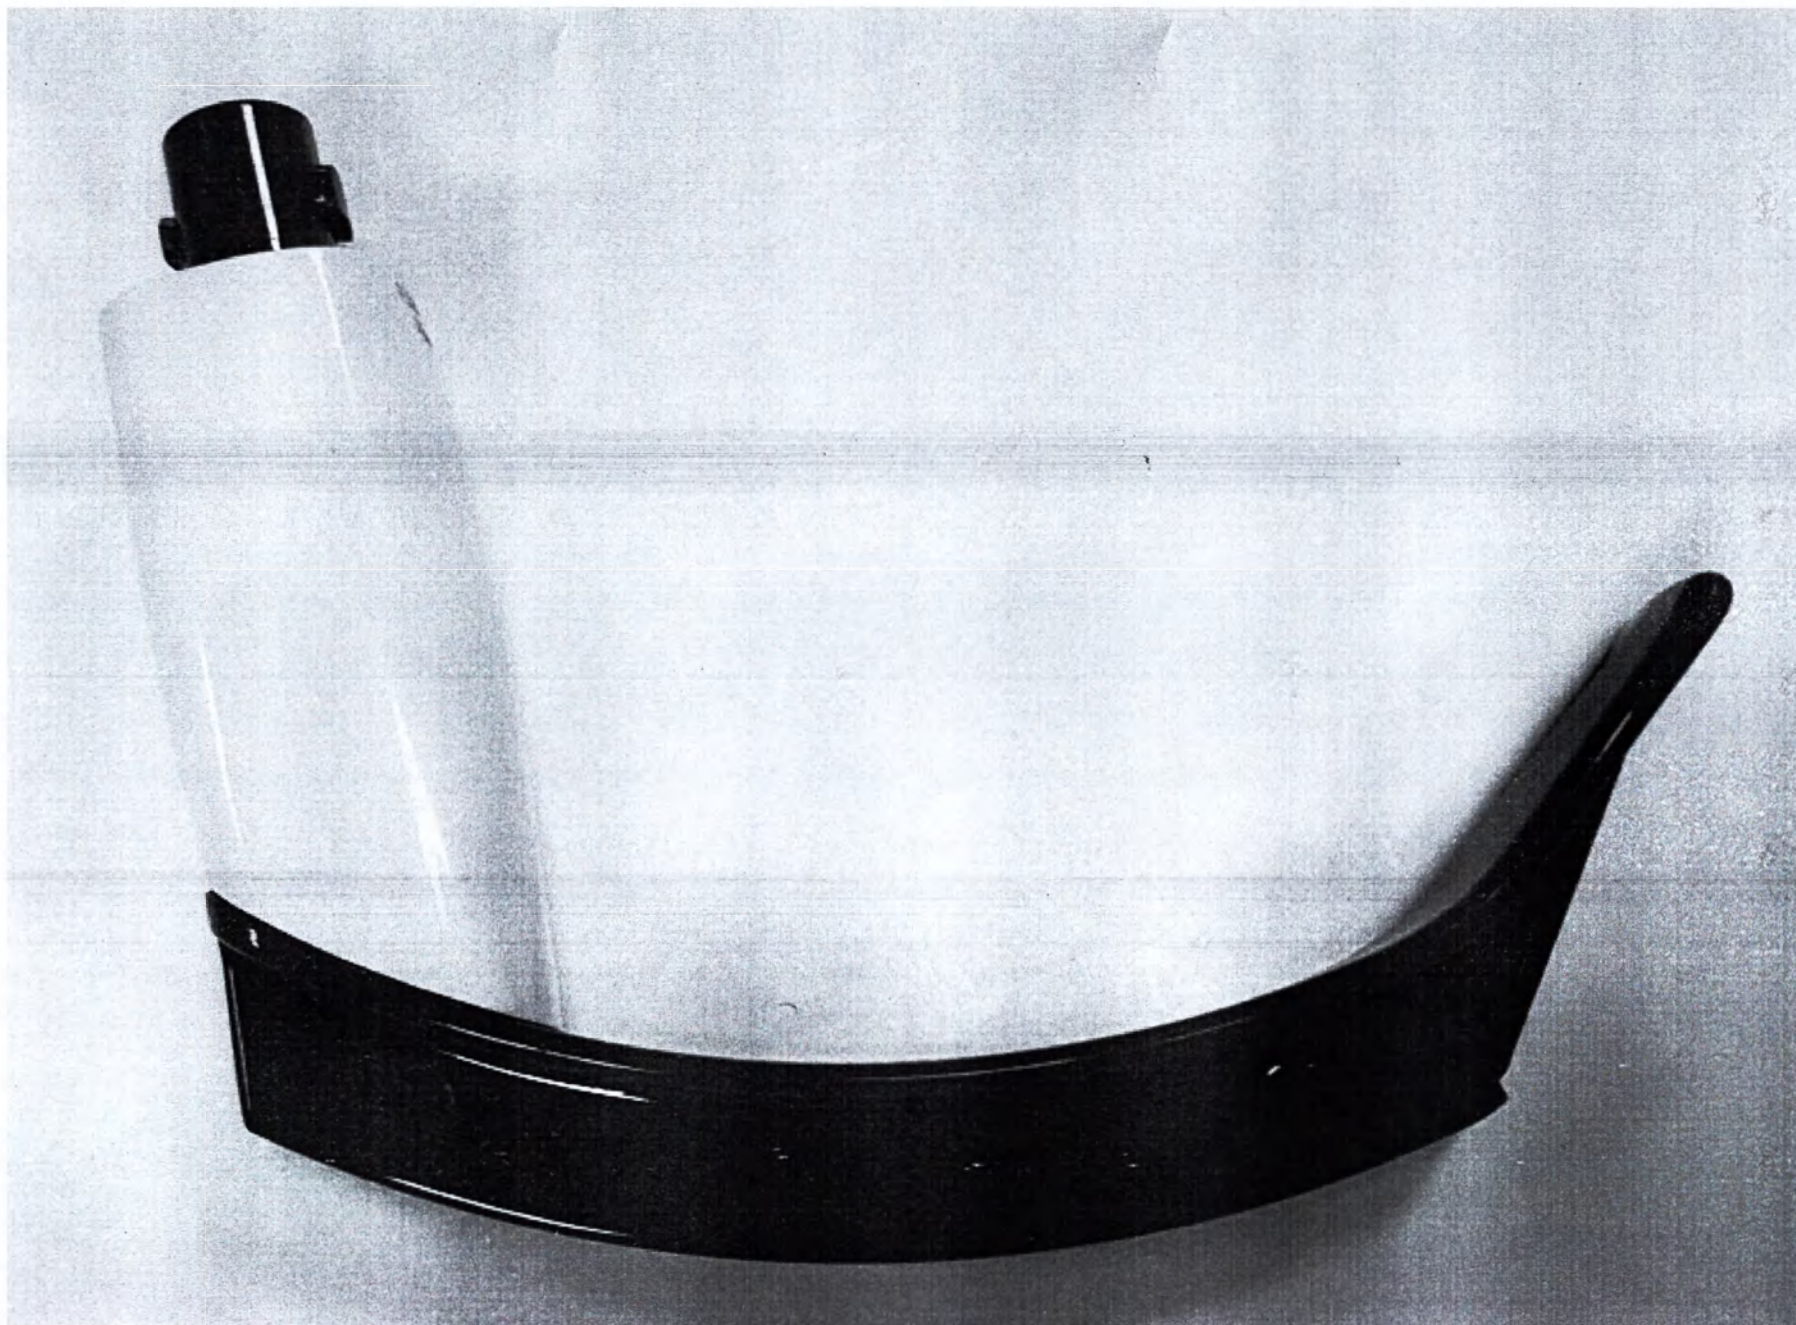


Общий вид Ручка-клинок изогнутый, многогранный, размер М, размер 3



Ручка-клинок изогнутый, многоразовый, размер М (маркировка)



Ручка-клинок изогнутый, многоразовый, размер 3 (маркировка)

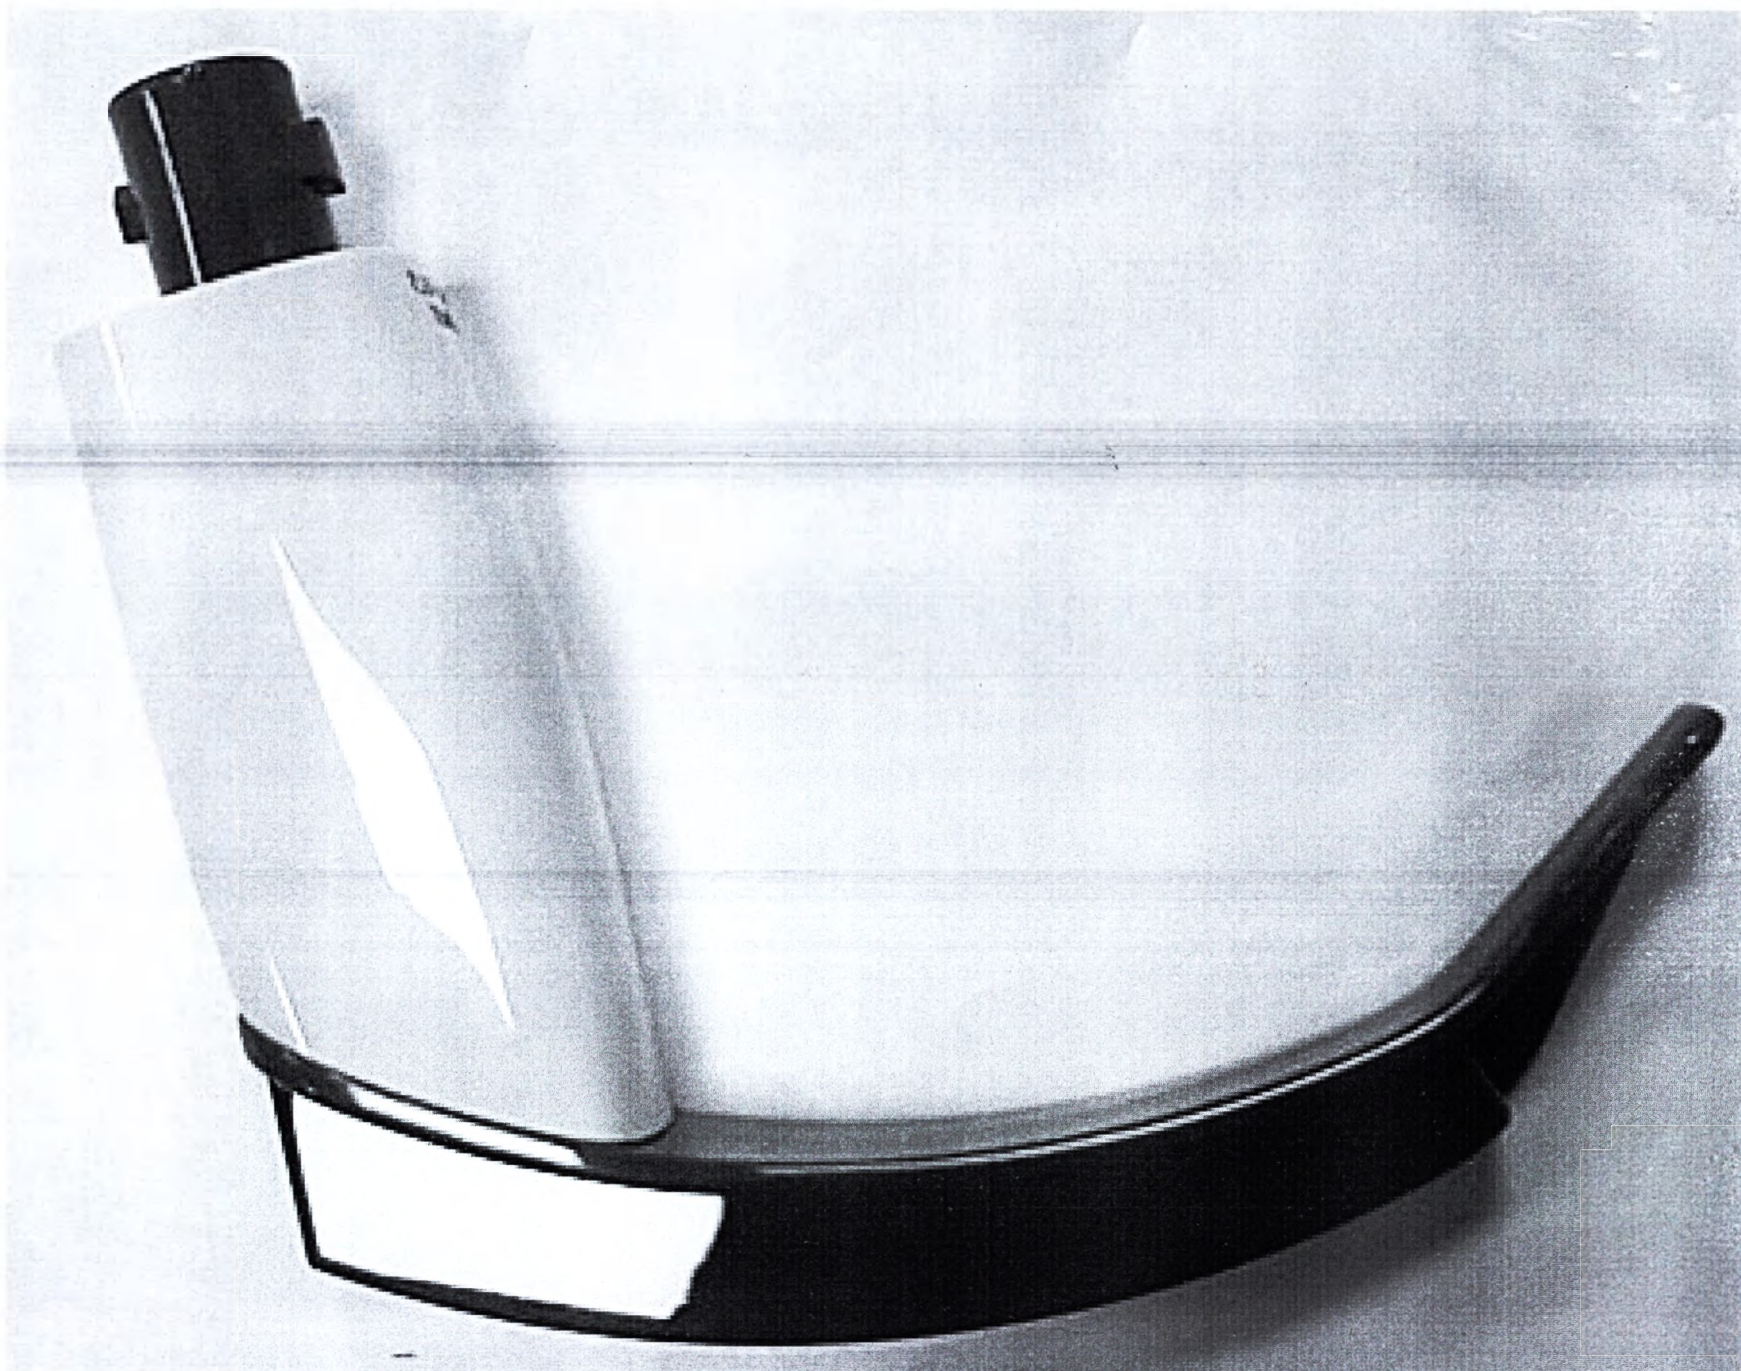


Общий вид Ручка-клинок изогнутый, многоразовый, размер SM, размер 2



Ручка-клинок изогнутый, многолезвийный, размер SM (маркировка)



Ручка-клинок изогнутый, многоцветный, размер 2 (маркировка)

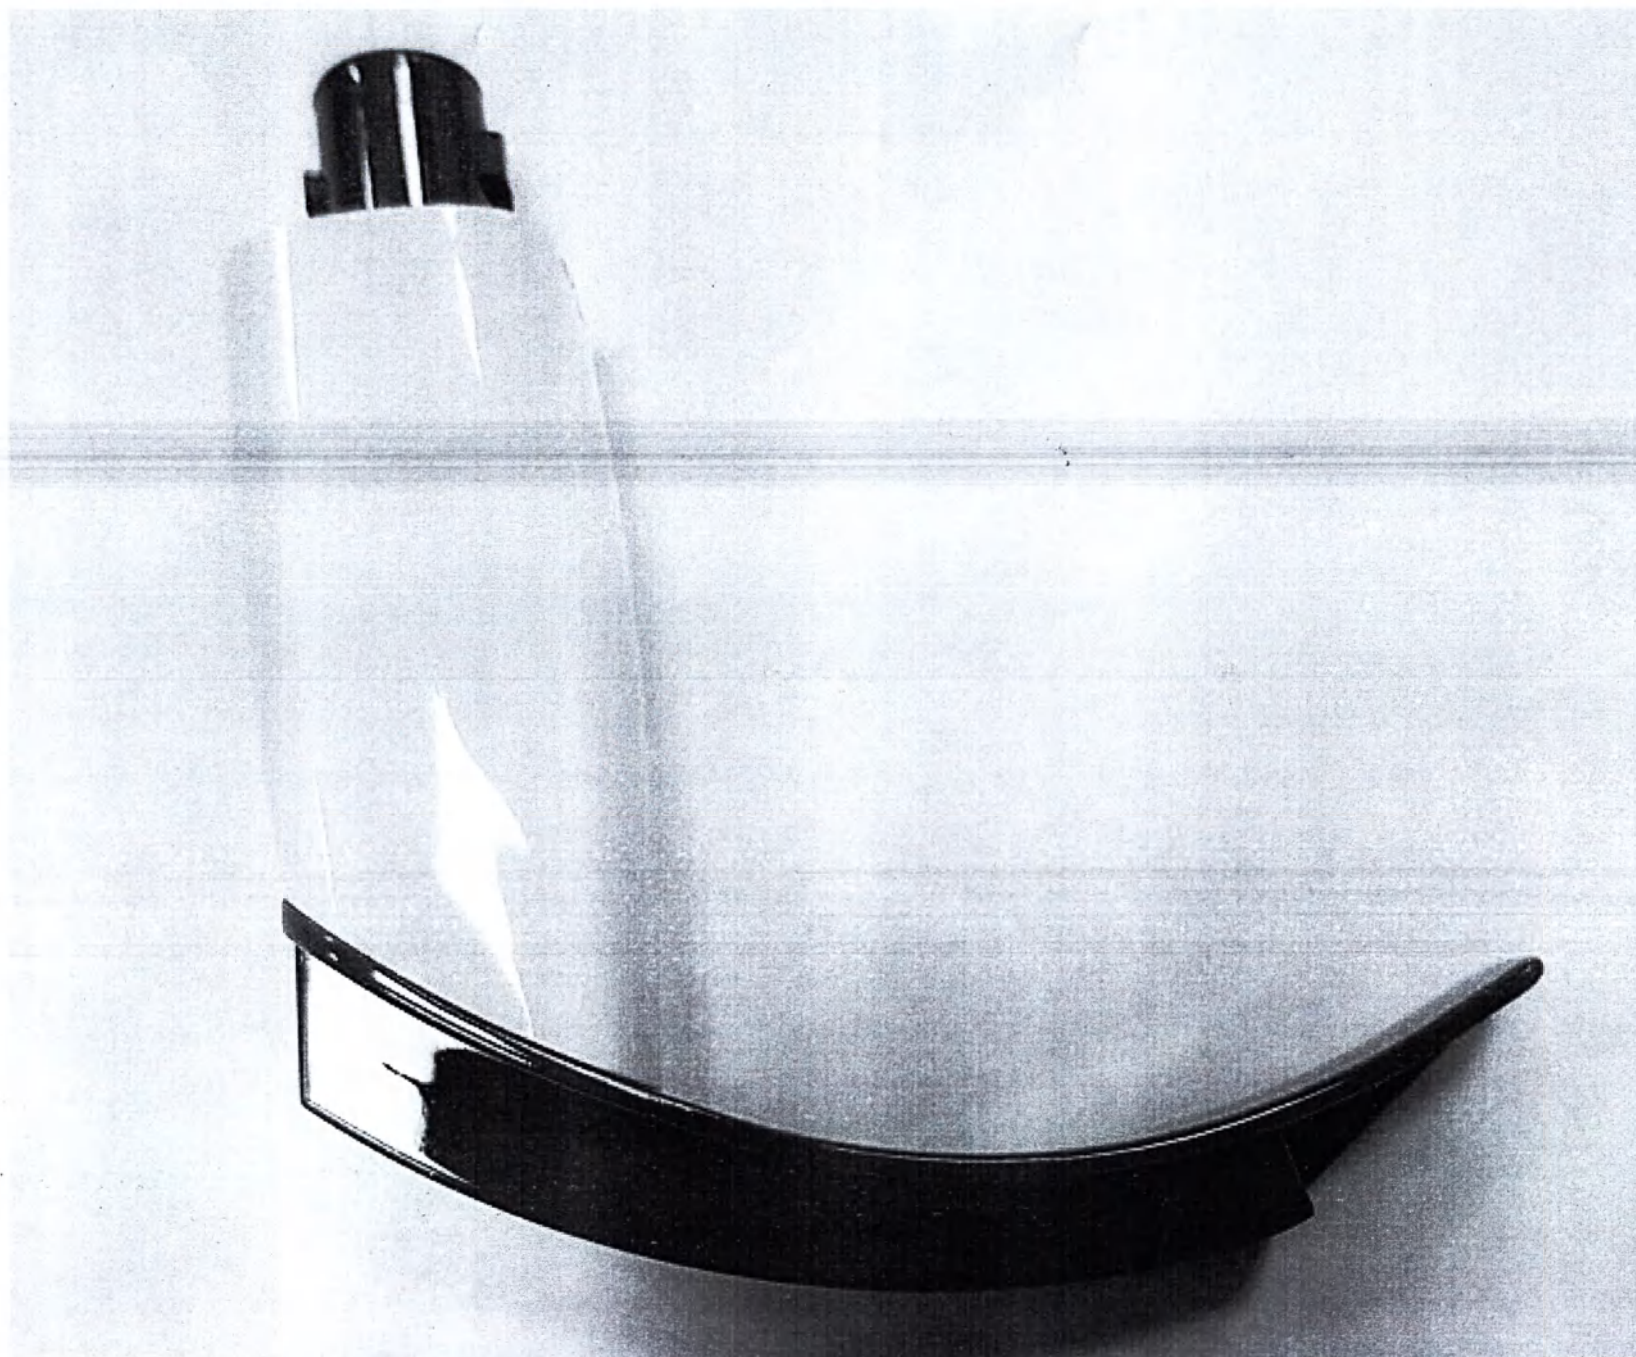


Общий вид Ручка-клинок изогнутый, многогранный, размер S, размер 1



Ручка-клинок изогнутый, многоцветный, размер 1 (маркировка)



Ручка-клинок изогнутый, многоцветный, размер S (маркировка)

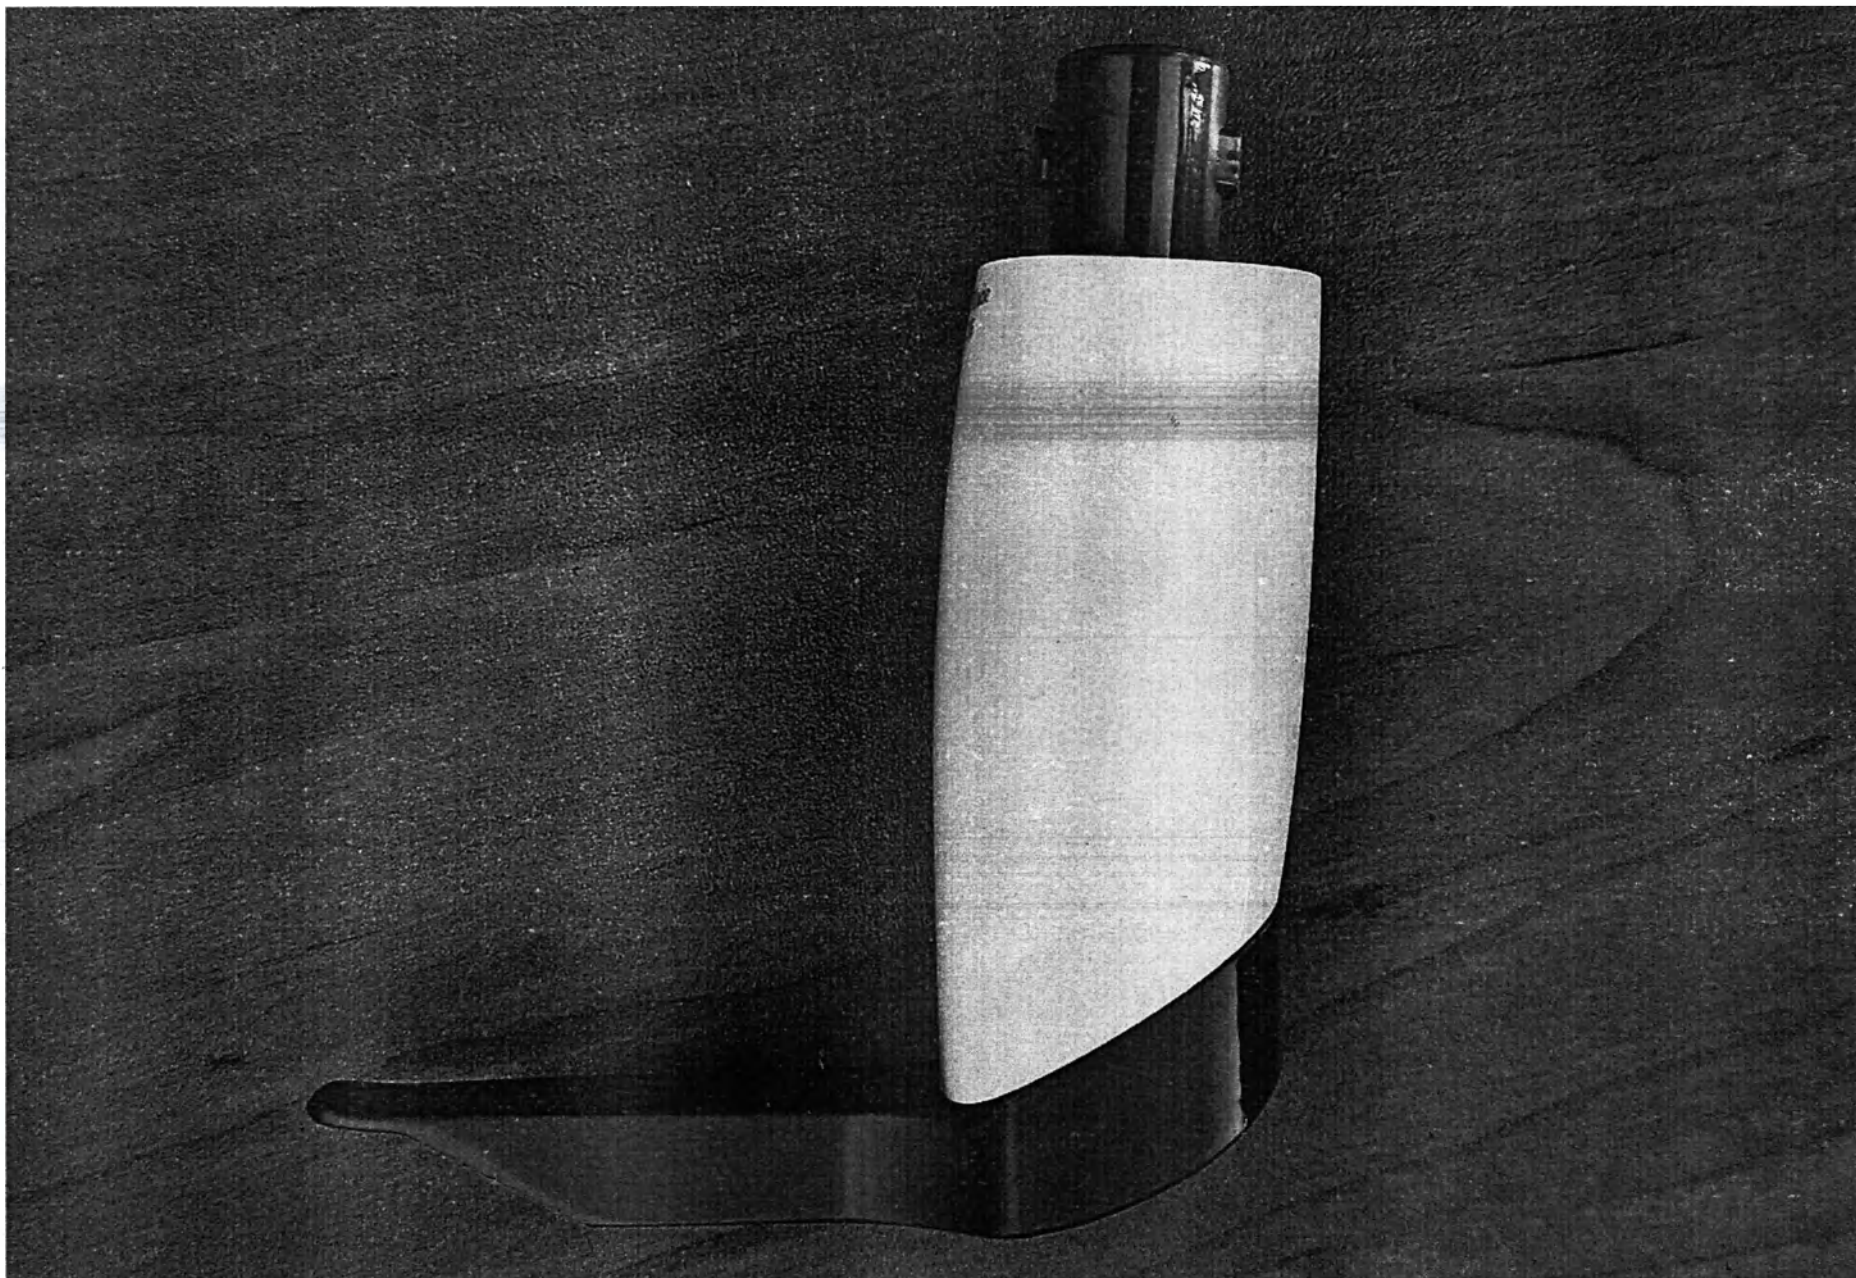


Общий вид Ручка-клинок изогнутый, многоразовый, размер SS-1, размер 0



Ручка-клинок изогнутый, многоразовый, размер SS-1 (маркировка)



Ручка-клинок изогнутый, многоцветный, размер 0 (маркировка)

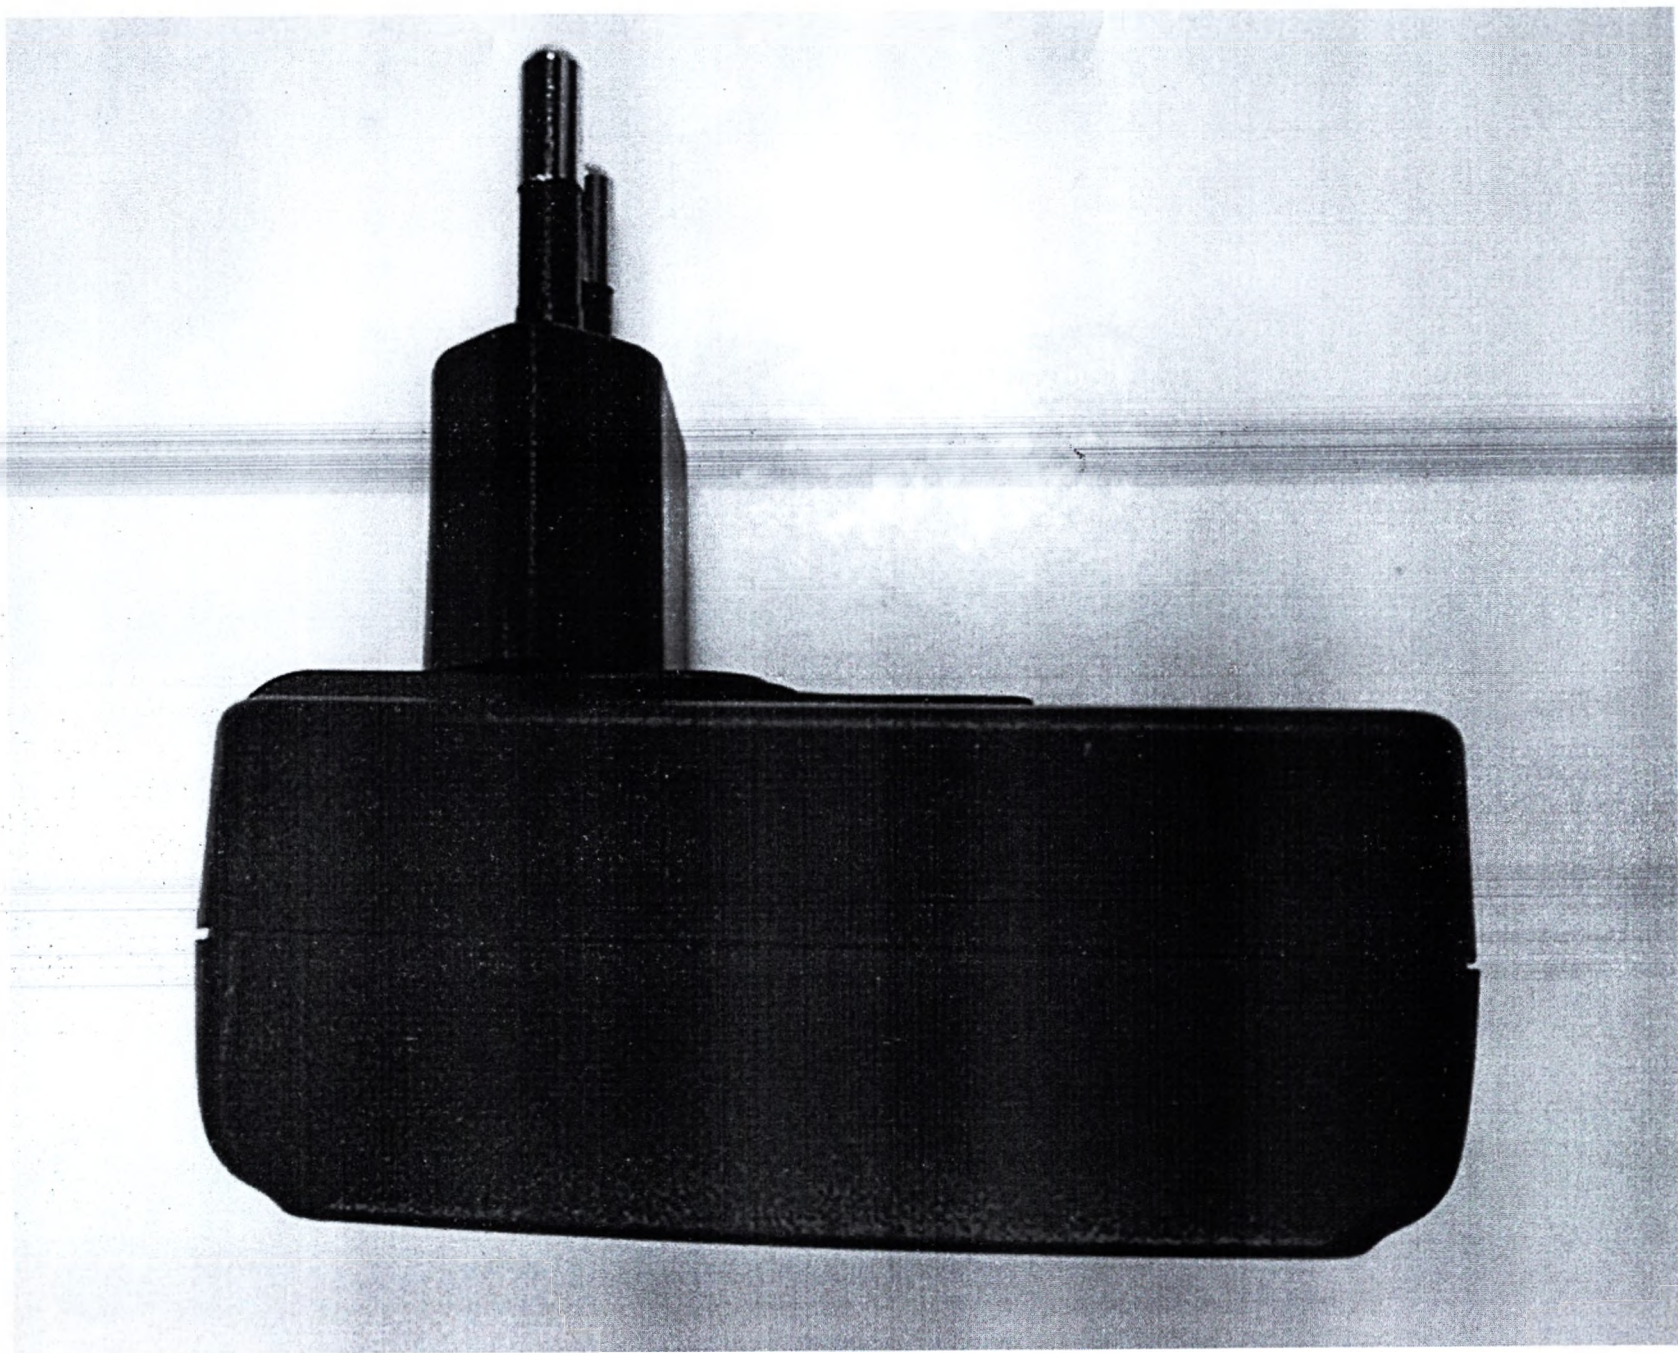

Сетевое зарядное устройство, 5В



GlobTek, Inc. адаптер питания

إمدادات الطاقة

ITE/ICT/Medical Power Supply (开关电源适配器)
Fuente de alimentación de ITE.



N136

SAA-211052-EA

仅适用于海拔2000米以下地区使用

REF P/N/料号/Parte/номер/ الجزء رقم: WR9QA1200USBNMEDRVB
MODEL/型号/Modelo/модель/ نموذج: GTM41078-0605-USB
INPUT/输入/Entrada/вход/ دخول: 100-240V~, 50-60Hz, 0.3A
OUTPUT/输出/Salida/выход/ مخرج: 5.0V --- 1.2A, 6.0W



Conforms to ANSI/AAMI Std. ES60601-1
Cert. to CAN/CSA Std. C22.2 NO. 60601-1
Conforms to ANSI/UL Std. 60950-1
Cert. to CAN/CSA Std. C22.2 NO. 60950-1



GlobTek, Inc.

RoHS

LPS



PRECAUCION: PARA USO EN EQUIPOS
ELECTRONICOS SOLAMENTE

MADE IN CHINA

المحرز في الصين

中国制造/Китай Производство

EFFICIENCY LEVEL



1123



PIN 1: +5V
PIN 2: NC
PIN 3: NC
PIN 4: -


EAC




H005 19




Сетевое зарядное устройство, 5В (маркировка)

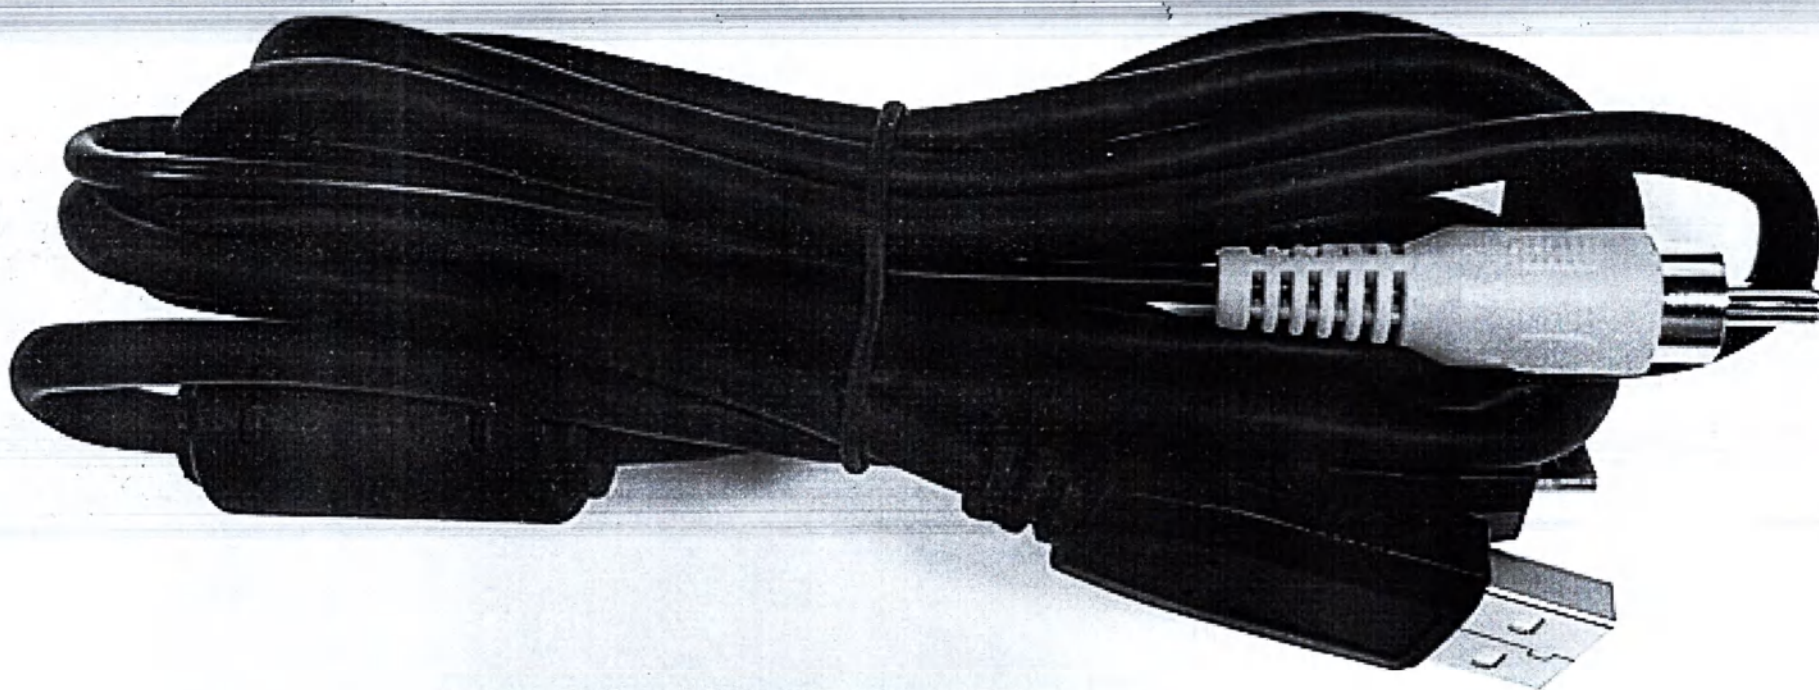


Кабель для зарядки и передачи данных mini USB - USB/RCA

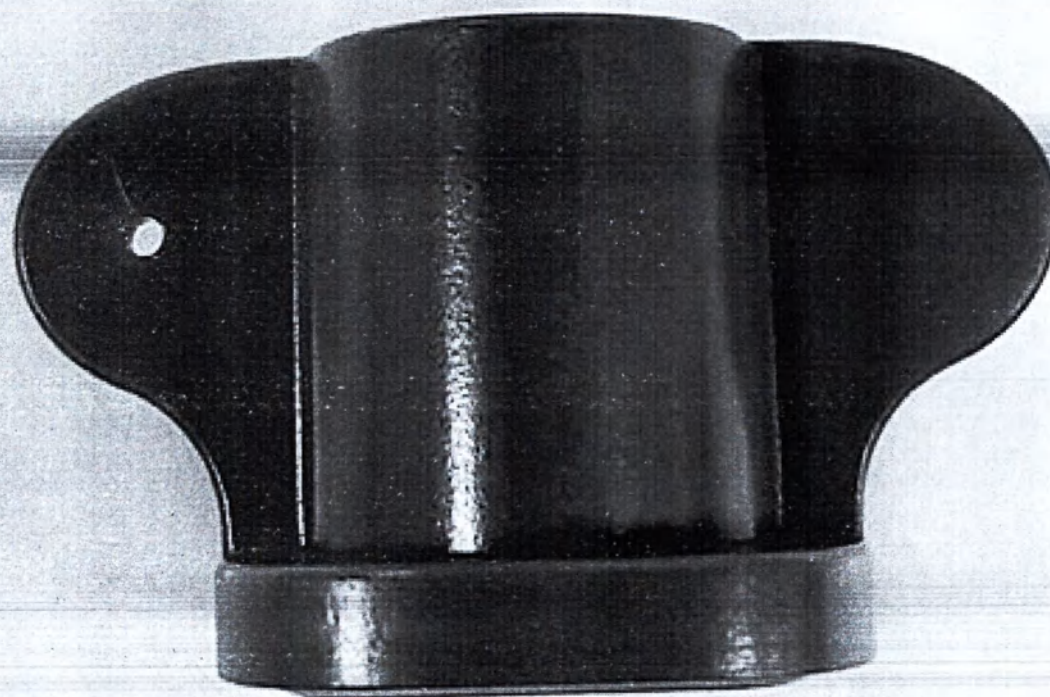


Колпачок для дезинфекции

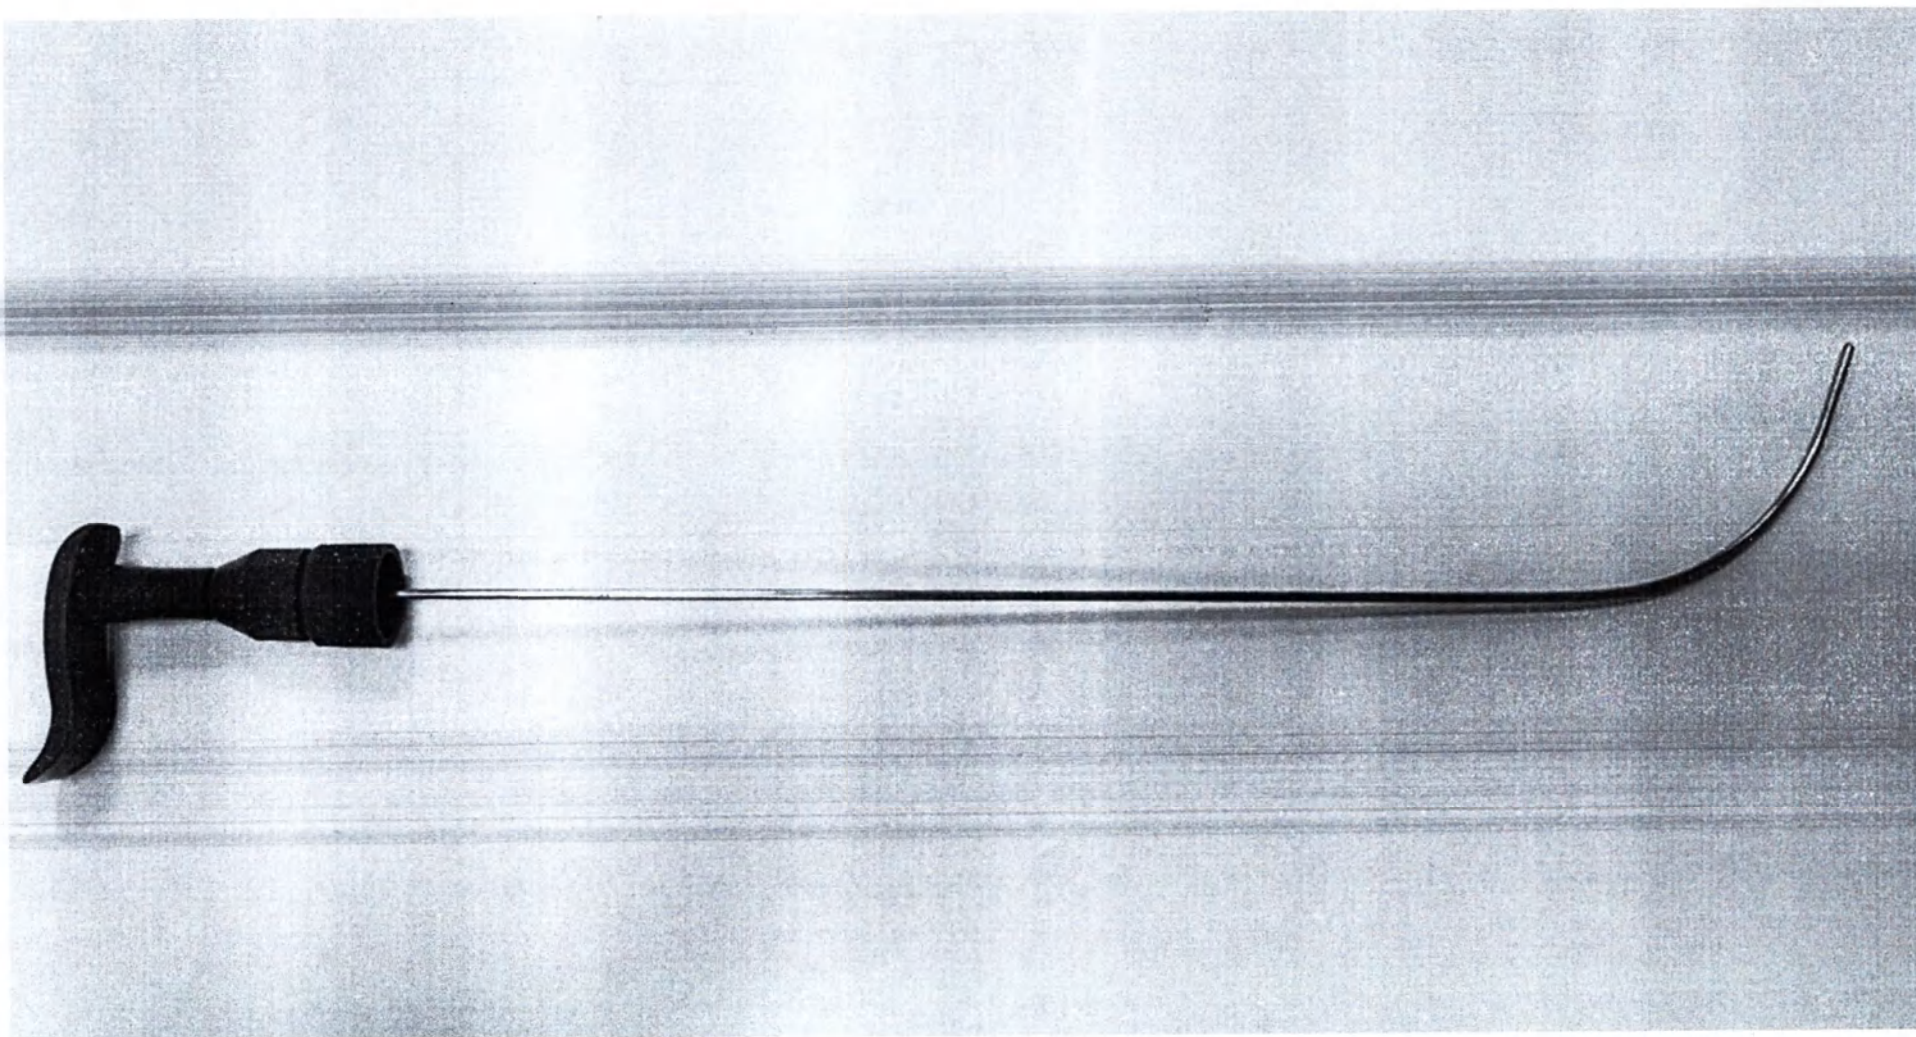

Стиллет педиатрический

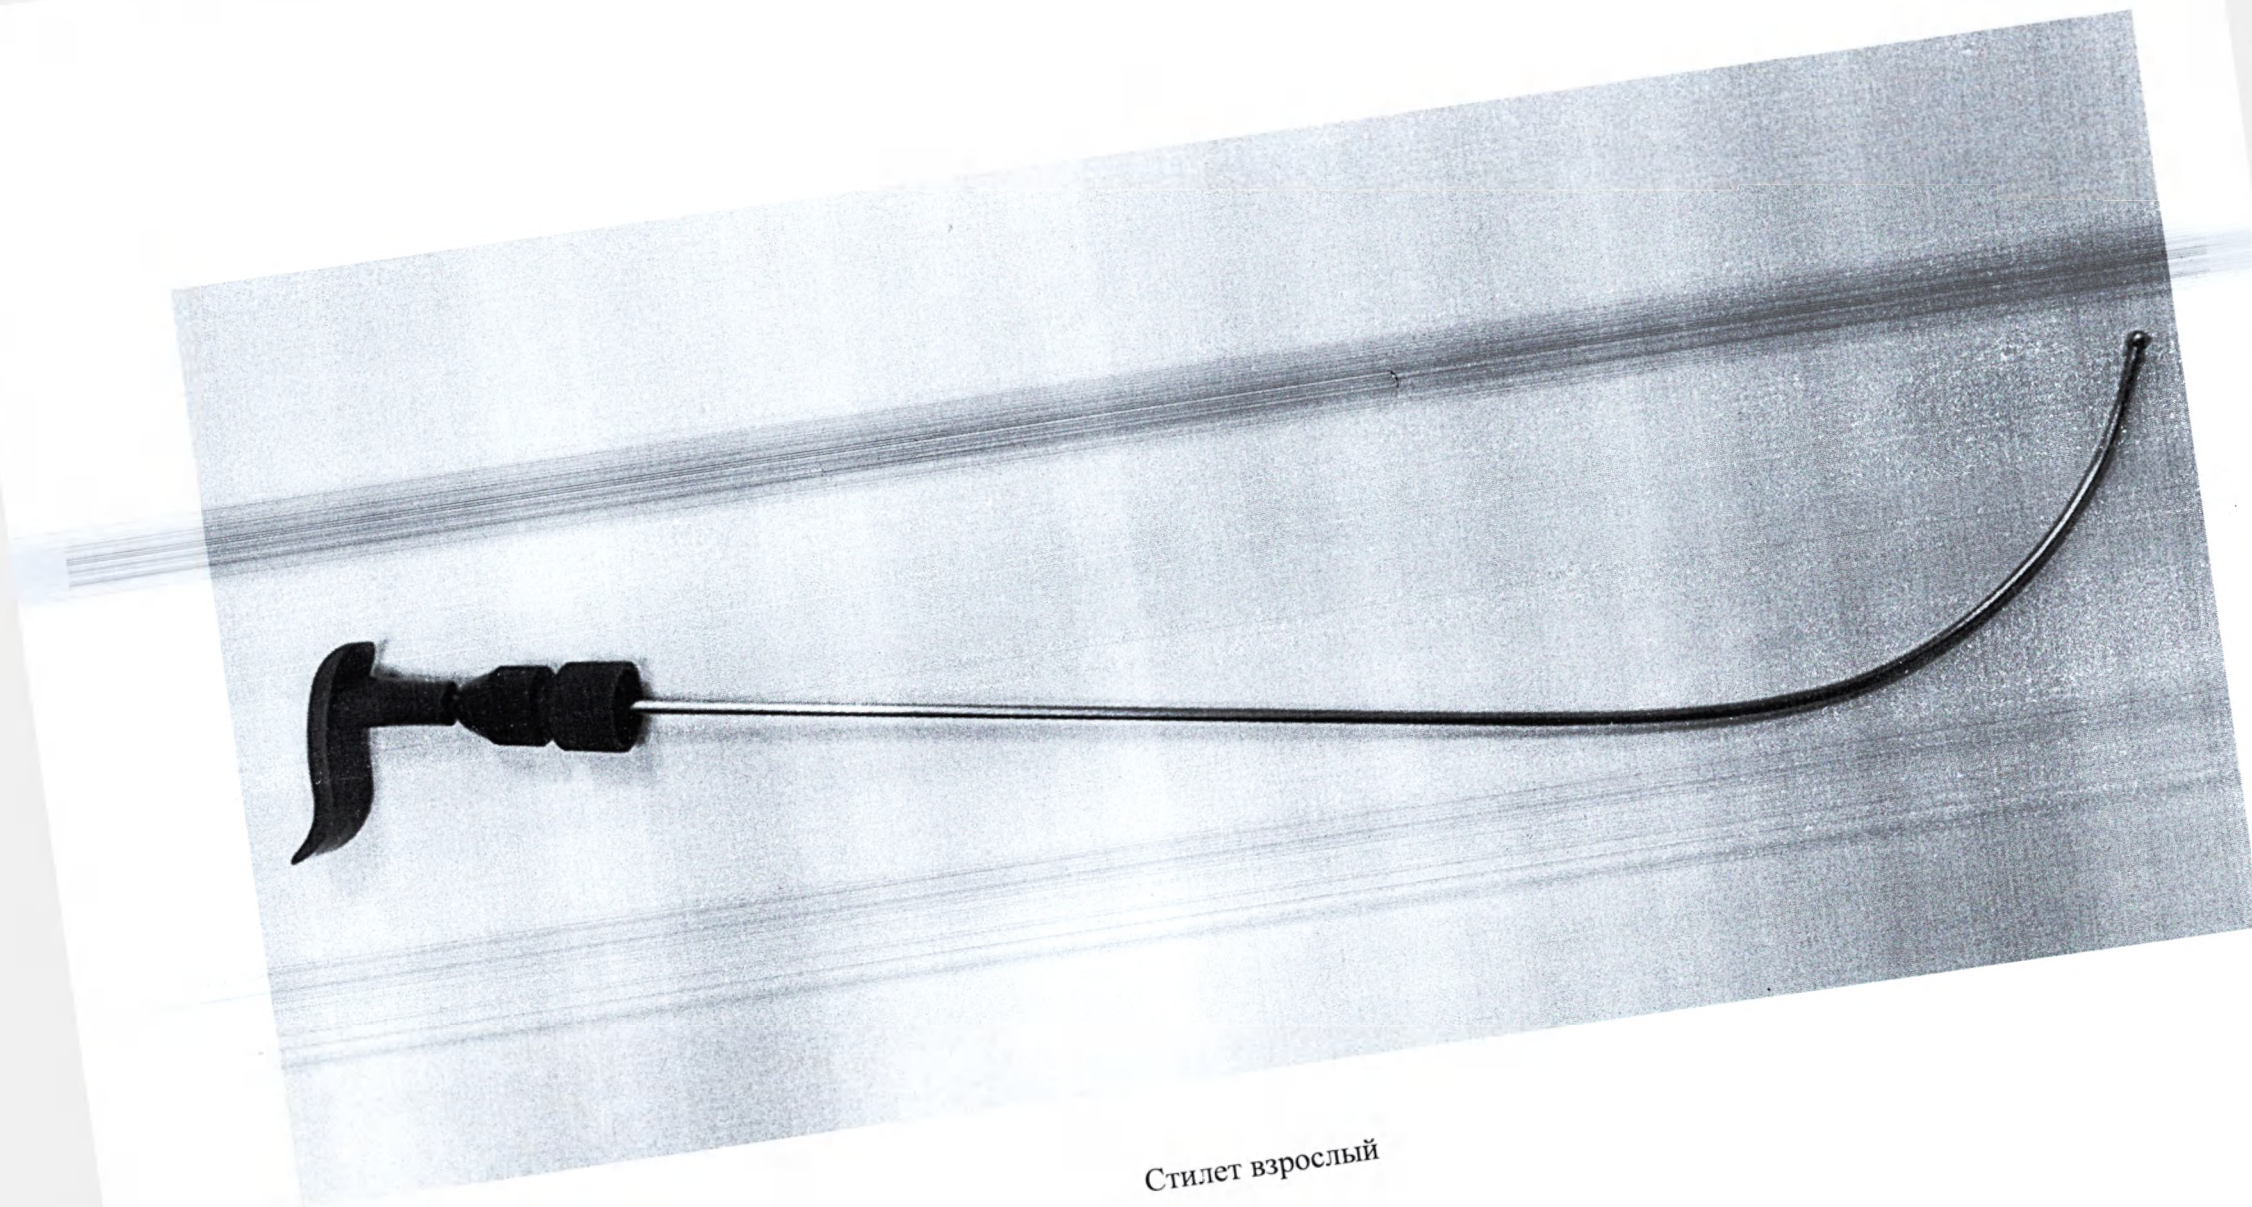

Стилет взрослый

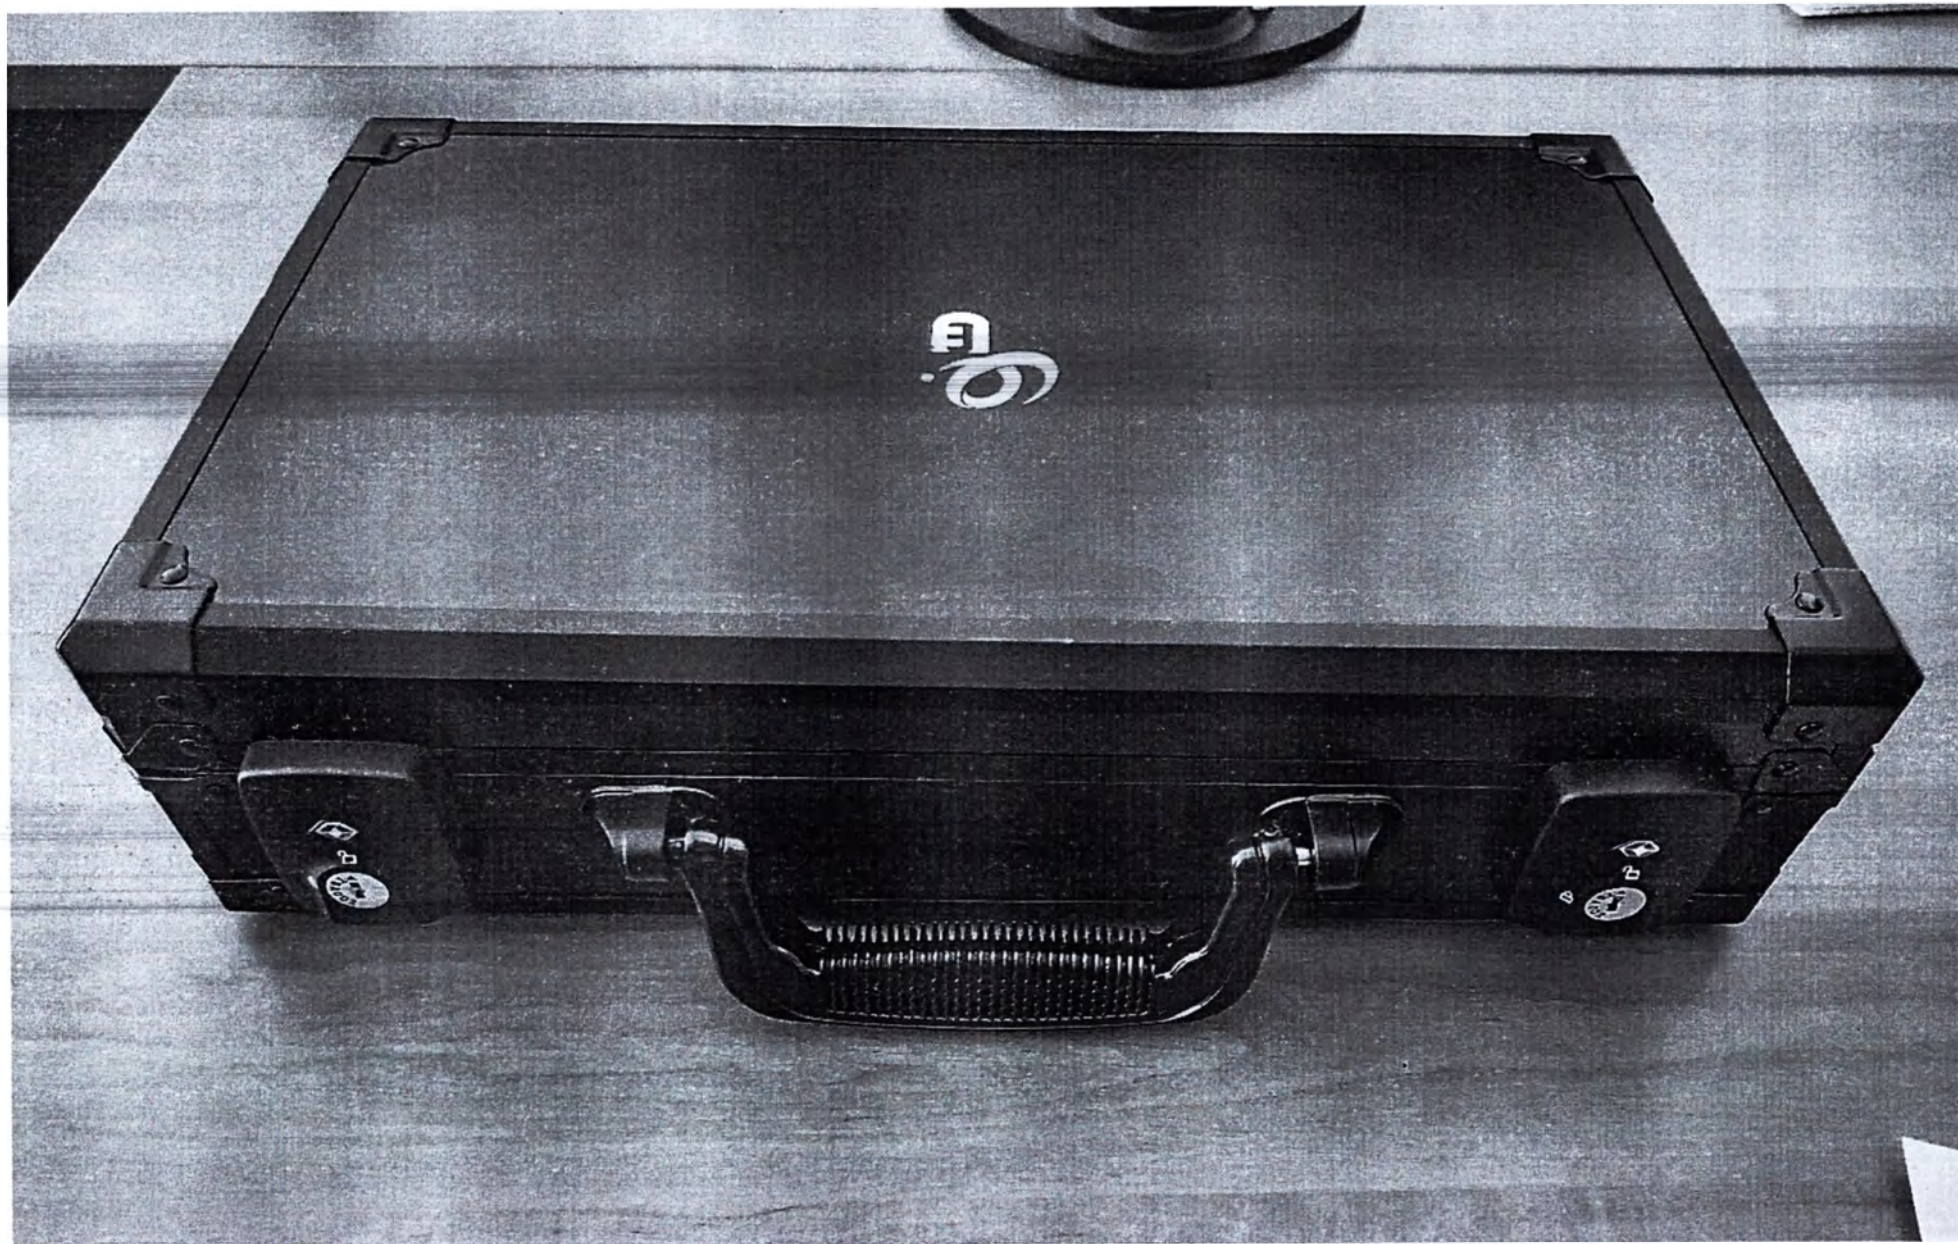

Кейс для хранения и транспортировки



Транспортная упаковка



RS00000000776562

Видеоларингоскопы, серии: VL300, VL310



РУ РЗН № _____ ОТ _____

Zhejiang UE Medical Corp.
No. 8, Youyi Road, Baita Economic Development Zone,
Xianju 317300 Zhejiang P.R. China

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ЭльМедика»
17342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, этаж 3 комн. 271

Транспортная упаковка (маркировка)

Видеоларингоскоп, серия:
VL300

Модель: VL300L



10 мин ВКЛ, 1 мин ВЫКЛ

 **XXXXXX**

Частота: 50-60 Гц

~~Рабочее напряжение: 5 В~~

 **YYYY-MM-DD**

Входная мощность: макс. 6 ВА

Емкость батареек: 2300 мАч


Zhejiang UE Medical Corp.
No. 8, Youyi Road, Baita
Economic Development Zone,
Xianju 317300 Zhejiang P.R.
China

РУ № _____ от _____



Уполномоченный представитель в
РФ: ООО «ЭльМедика»
117342, г. Москва, ул. Бутлерова,
д.17, этаж 3 ком. 271



Сделано в Китае



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd
2595AA, The Hague, Netherlands
www.ueworld.com

Видеоларингоскоп, серия:
VL310

Модель: VL310-4



10 мин ВКЛ, 1 мин ВЫКЛ

SN: XXXXXX

YYYY-MM-DD

Частота: 50-60 Гц

Рабочее напряжение: $\approx$ 5 В

Входная мощность: макс. 6 ВА

Емкость батареек: 2300 мАч



Zhejiang UE Medical Corp.
No. 8, Youyi Road, Baita
Economic Development Zone,
Xianju 317300 Zhejiang P.R.
China

РУ № _____ от _____



Уполномоченный представитель в
РФ: ООО «ЭльМедика»
117342, г. Москва, ул. Бутлерова,
д.17, этаж 3 ком. 271



Сделано в Китае



Lotus NL B.V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd
2595AA, The Hague, Netherlands
www.ueworld.com

Транспортирование

Видеоларингоскоп, серии: VL300, VL310



РУ РЗН № _____ от _____

 **Zhejiang UE Medical Corp.**
No. 8, Youyi Road, Baita Economic Development Zone,
Xianju 317300 Zhejiang P.R. China

Уполномоченный представитель в РФ: ООО «ЭльМедика»
117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д.17, этаж 3 ком. 271



Всего прошито и скреплено
печатью 37 листа(ов)

 Андросова Е.А.