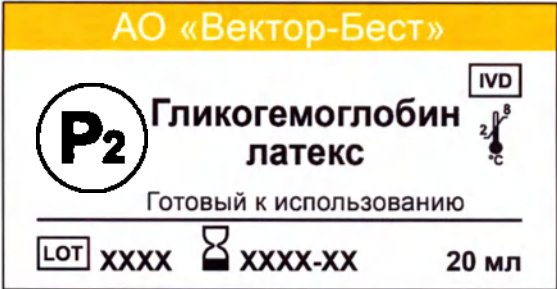



«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
АО «Вектор-Бест»
М.Д. Хусаинов
«24» 03 2024 г.

Образцы маркировки на Набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина
A1c в крови иммунотурбидиметрическим методом
(Гликогемоглобин латекс)

1. Образцы этикеток на компоненты набора «Гликогемоглобин латекс»

Наименование компонента	Этикетка
Вариант комплектации 1	
Реагент 1 (P1)	АО «Вектор-Бест» P₁ Гликогемоглобин латекс IVD  Готовый к использованию  LOT XXXX  XXXX-XX 25 мл
Реагент 2 (P2)	АО «Вектор-Бест» P₂ Гликогемоглобин латекс IVD  Готовый к использованию LOT XXXX  XXXX-XX 10 мл

Вариант комплектации 2	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	
Вариант комплектации 3 (Тaurus)	
Реагент 1 (P1)	

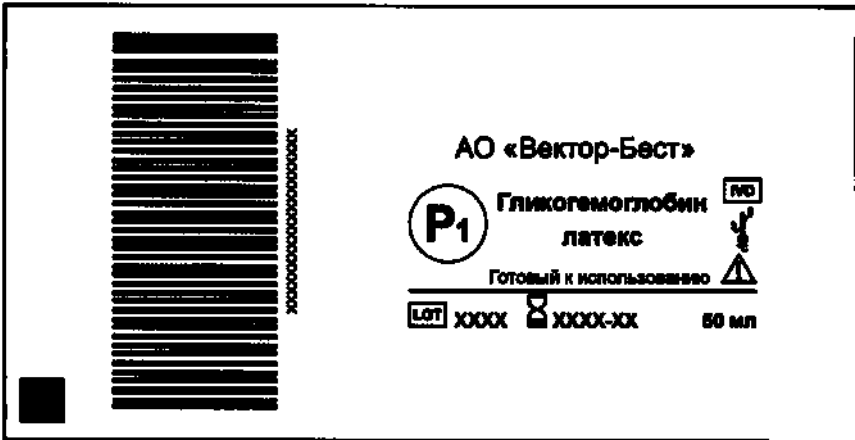
Реагент 2 (P2)	 Label for Reagent 2 (P2) showing a barcode, AO «Вектор-Бест», Glycated Hemoglobin Latex, and lot information. The label includes a barcode, the text «Вектор-Бест», Glycated Hemoglobin Latex, and lot information (LOT XXXX, XXXX-XX, 18 ml).
Вариант комплектации 4 (BA400)	
Реагент 1 (P1)	 Label for Reagent 1 (P1) showing a barcode, AO «Вектор-Бест», Glycated Hemoglobin Latex, and lot information. The label includes a barcode, the text «Вектор-Бест», Glycated Hemoglobin Latex, and lot information (LOT XXXX, XXXX-XX, 50 ml).


Реагент 2 (P2)



Вариант комплектации 5 (Аспект)


Реагент 1 (P1)

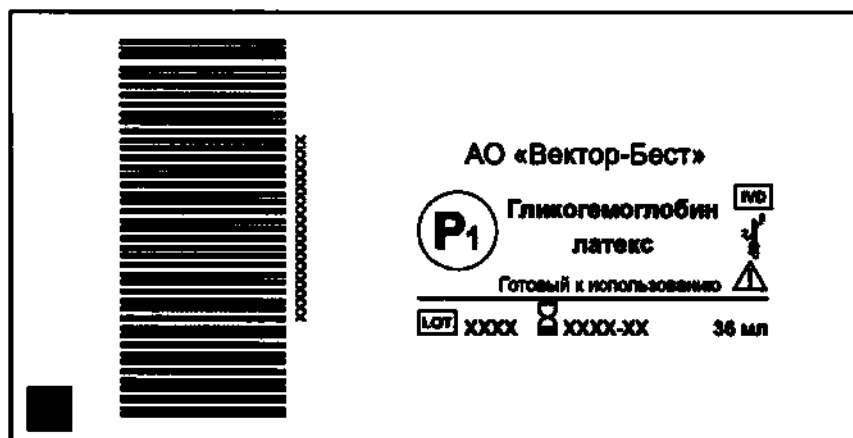

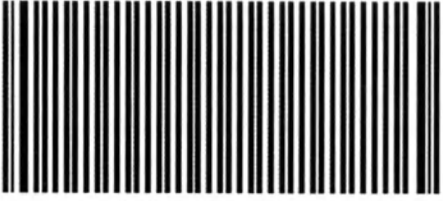Реагент 2 (P2)	  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX АО «Вектор-Бест» P₂ Гликогемоглобин латекс IVD Готовый к использованию LOT XXXX XXXX-XX 9 мл
----------------	---

2. Образцы этикеток на коробку набора «Гликогемоглобин латекс»

2.1. Верхняя этикетка.

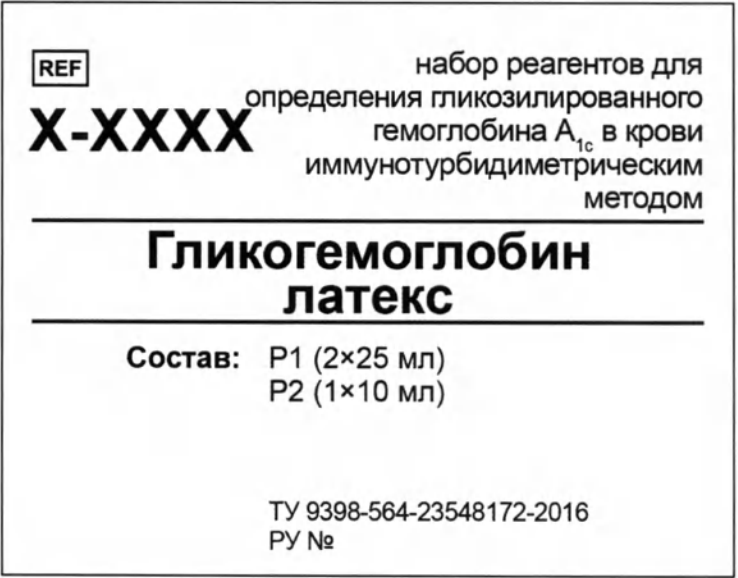Вариант комплектации 1	 REF X-XXXX набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина A_{1c} в крови иммунотурбидиметрическим методом Гликогемоглобин латекс Состав: P1 (2×25 мл) P2 (1×10 мл) ТУ 9398-564-23548172-2016 РУ №
------------------------	---

Вариант комплектации 2

REF

X-XXXX

набор реагентов для
определения гликозилированного
гемоглобина A_{1c} в крови
иммунотурбидиметрическим
методом

Гликогемоглобин латекс

Состав: P1 (2×50 мл)
P2 (1×20 мл)

ТУ 9398-564-23548172-2016
ПУ №

Вариант комплектации 3
(Таурус)

REF

X-XXXX

набор реагентов для
определения гликозилированного
гемоглобина A_{1c} в крови
иммунотурбидиметрическим
методом

Гликогемоглобин латекс

Состав: P1 (2×42 мл)
P2 (2×18 мл)

Таурус

ТУ 9398-564-23548172-2016
ПУ №

Вариант комплектации 4
(BA400)

REF

X-XXXX

набор реагентов для
определения гликозилированного
гемоглобина A_{1c} в крови
иммунотурбидиметрическим
методом

Гликогемоглобин латекс

Состав: P1 (1×50 мл)
P2 (1×10 мл)

BA400

ТУ 9398-564-23548172-2016
ПУ №

Вариант комплектации 4 (Аспект)	REF X-XXXX набор реагентов для определения гликозилированного гемоглобина A_{1c} в крови иммунотурбидиметрическим методом Гликогемоглобин латекс Состав: P1 (2×36 мл) P2 (2×9 мл) Аспект ТУ 9398-564-23548172-2016 РУ №
--	---

2.2. Боковая этикетка.

Варианты комплектации 1, 2	REF X-XXXX LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Гликогемоглобин латекс 2 8 °C ! IVD i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения
Вариант комплектации 3 (Таурус)	REF X-XXXX Σ 385 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Гликогемоглобин латекс 4 ! IVD i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения

Вариант комплектации 4 (BA400)	REF X-XXXX Σ 225 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Гликогемоглобин латекс 2 3 °C ! IVD i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения
Вариант комплектации 5 (Аспект)	REF X-XXXX Σ 364 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX Гликогемоглобин латекс 2 3 °C ! IVD i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения

Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


AO Vector-Best
Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ
630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-ендірістік аймақ,
36 корпус, 211 белме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



В.К. Ткачев

«24» 03 2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.

Директор по технологии и качеству

АО «Вектор-Бест»

Масяго А.В.

“27” 08 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»





Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА A1c
В КРОВИ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
(Гликогемоглобин латекс)
(вариант комплектации 1)

Фотографическое изображение общего вида медицинского изделия
«Гликогемоглобин латекс»
(вариант комплектации 1, серия 1)

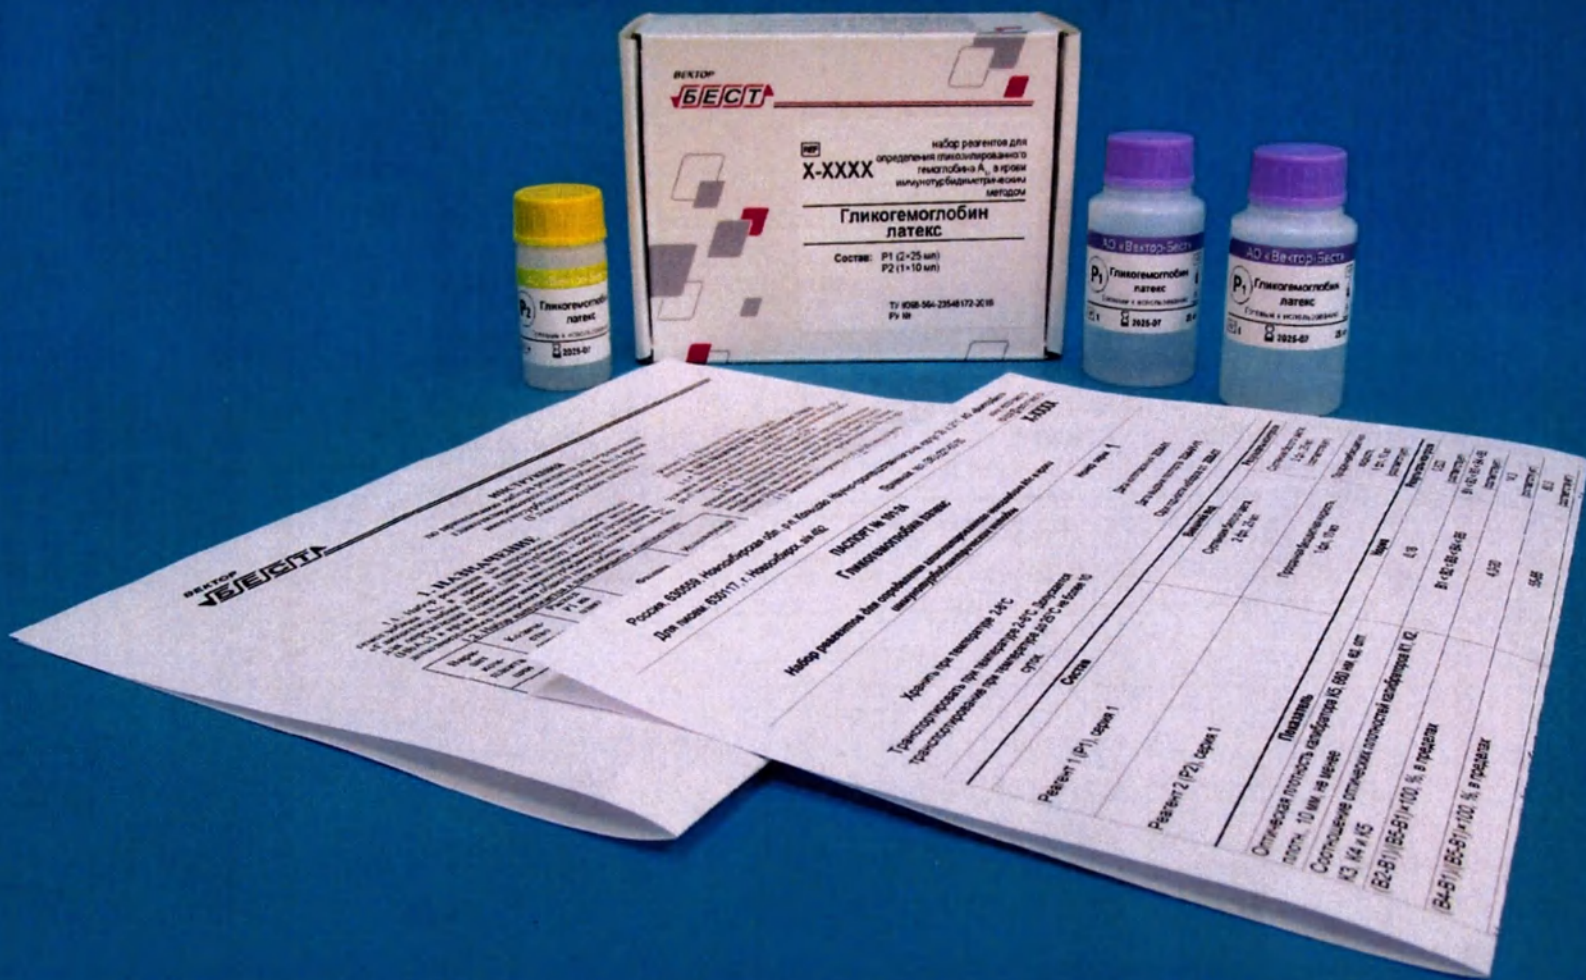

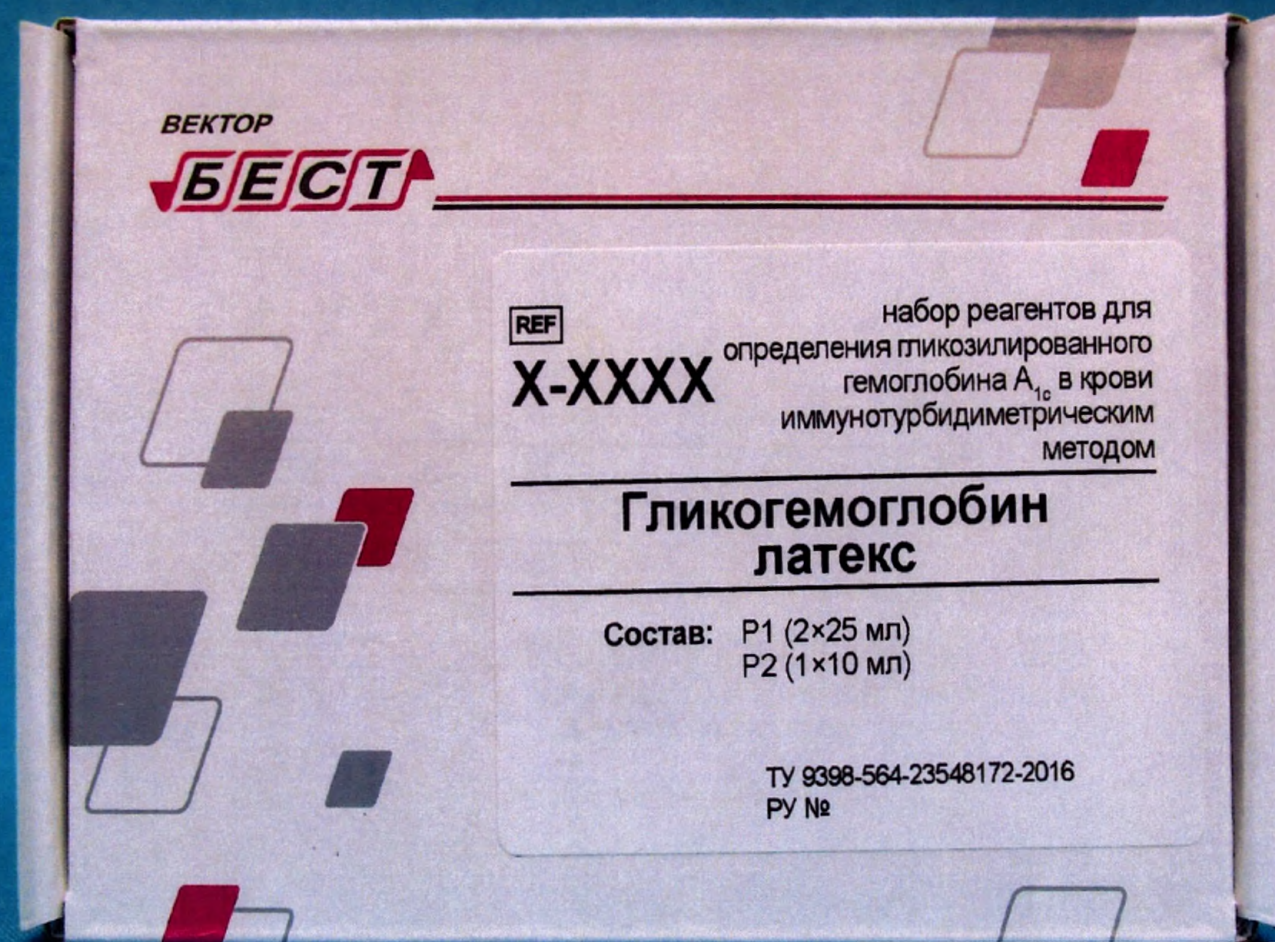





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

АО Vector-Best

Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия
«Гликогемоглобин латекс»
№ 1 (вариант комплектации 1, серия 1)



Фотографическое изображение компонентов медицинского изделия

«Гликогемоглобин латекс»

№ 2 (вариант комплектации 1, серия 1)





Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.

Директор по технологии и качеству

АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В.

"27"

2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»





Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА A1c
В КРОВИ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
(Гликогемоглобин латекс)
(вариант комплектации 2)

(вариант комплектации 2, серия 1)

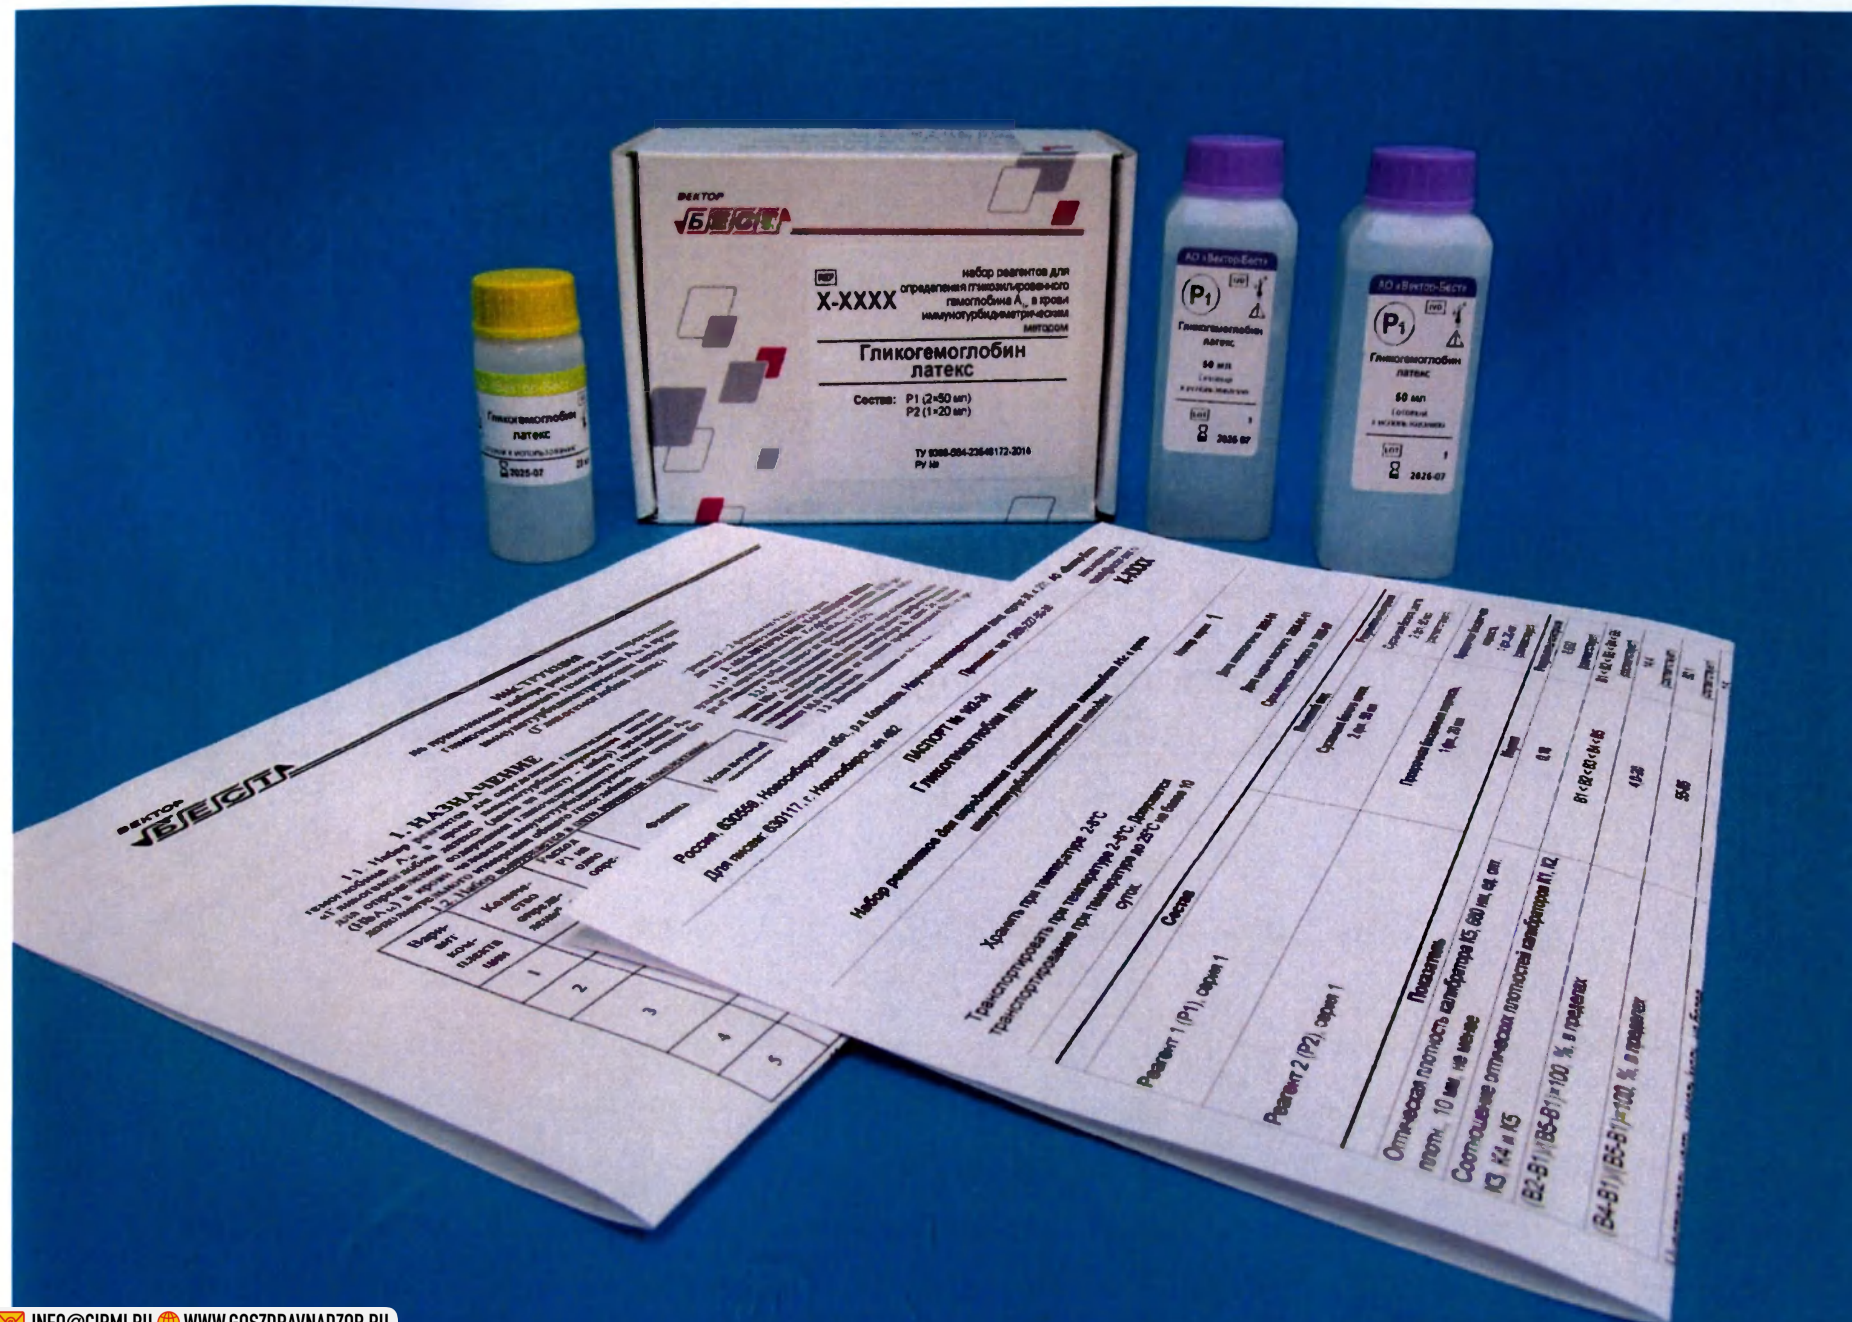


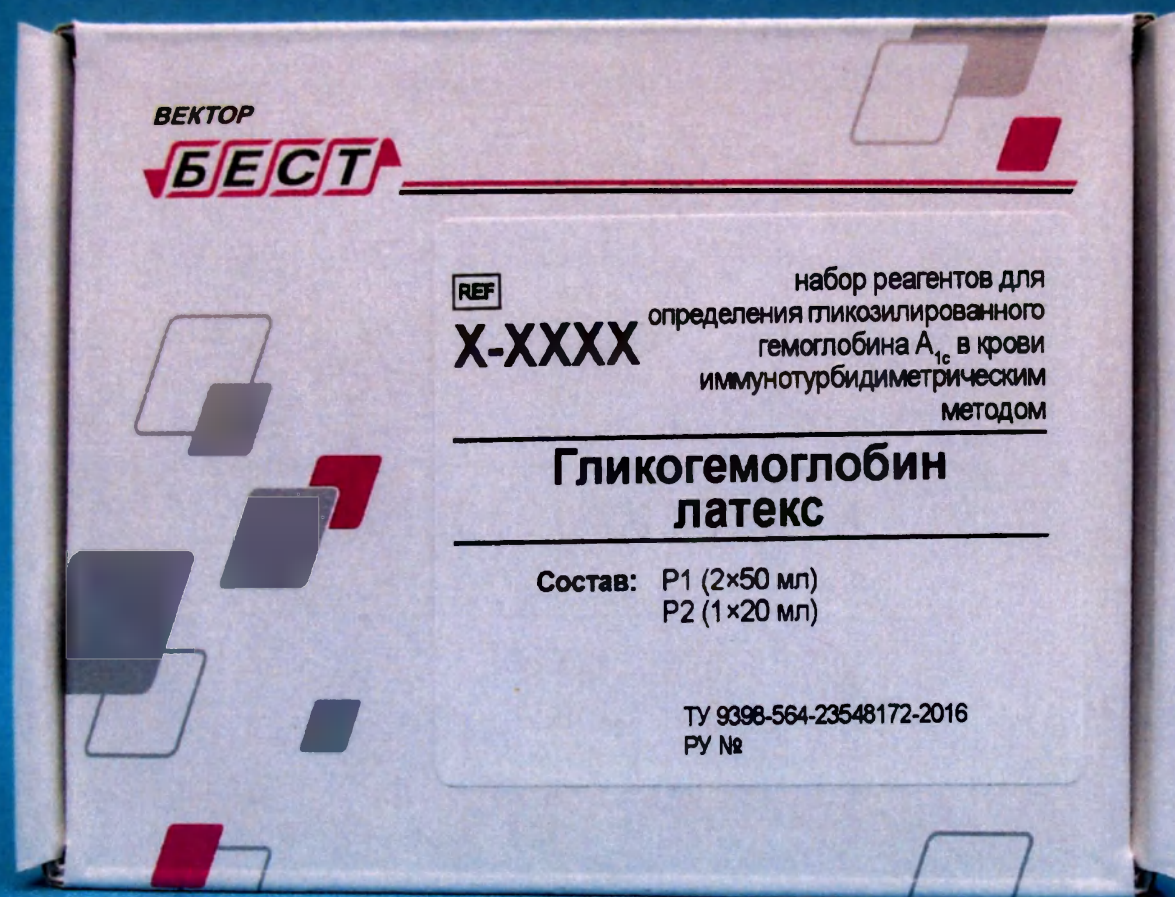

REF

X-XXXX

LOT



1

2024-01

2025-07

Гликогемоглобин латекс



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



Для профессионального применения



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best


Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


«Вектор-Бест» АҚ


630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru



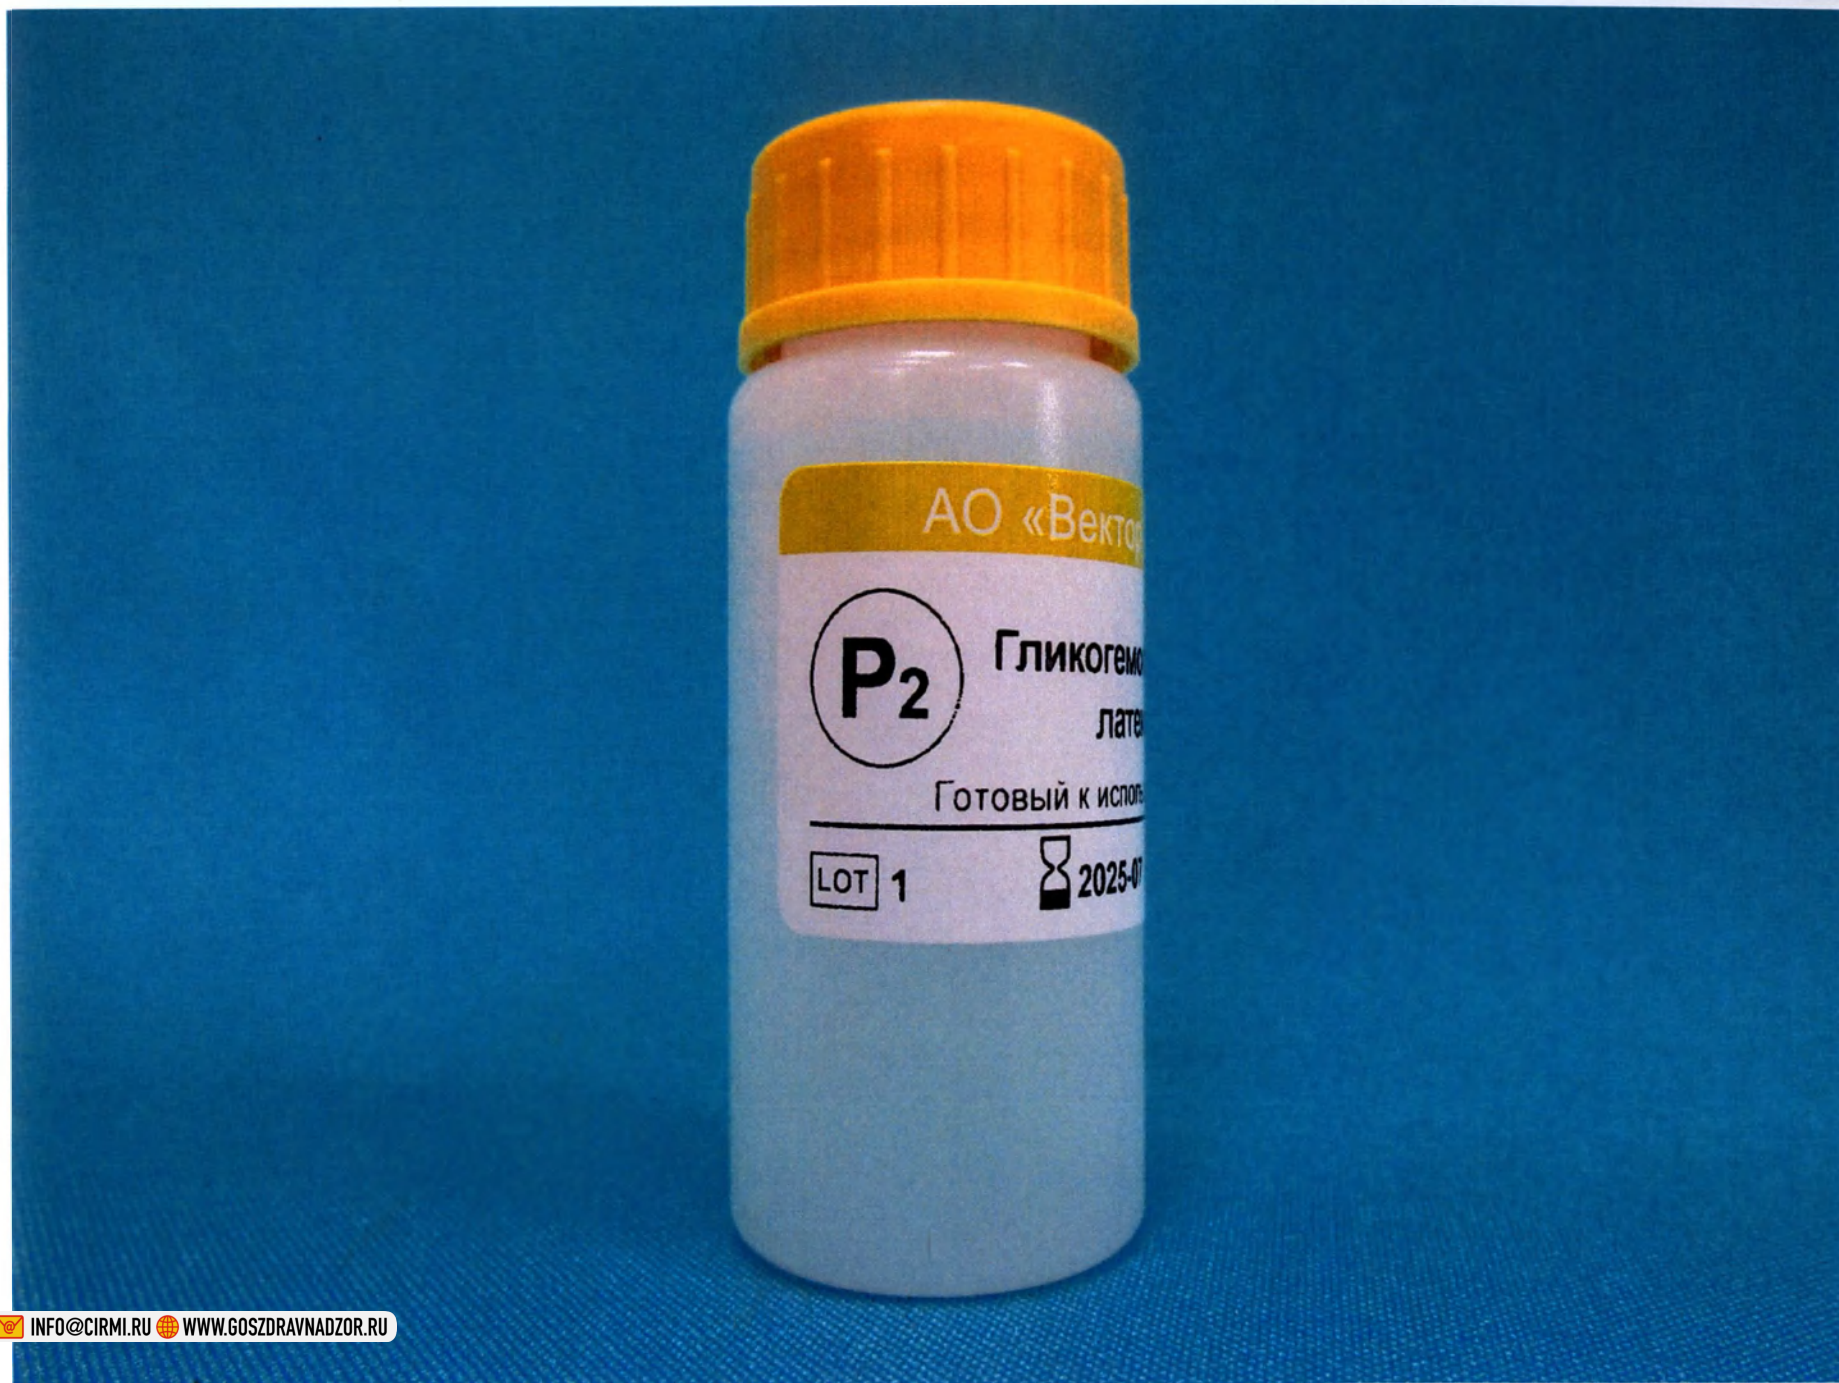

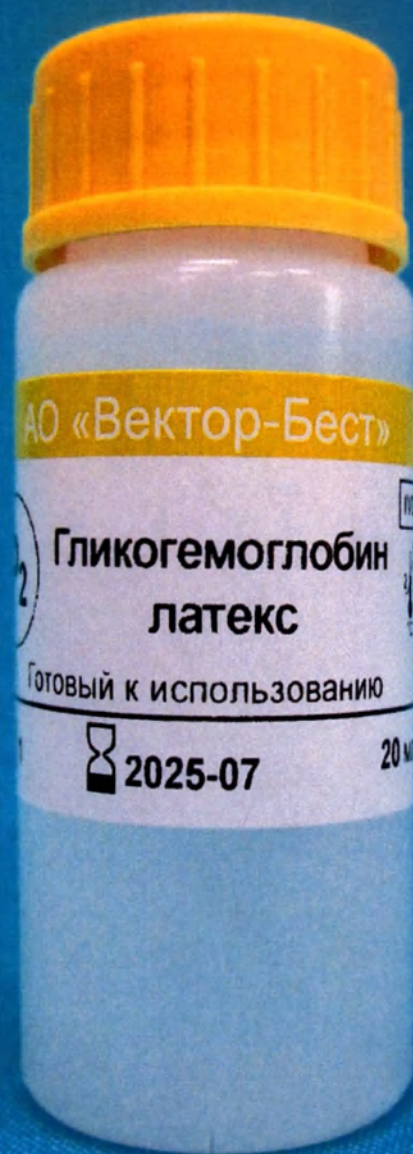

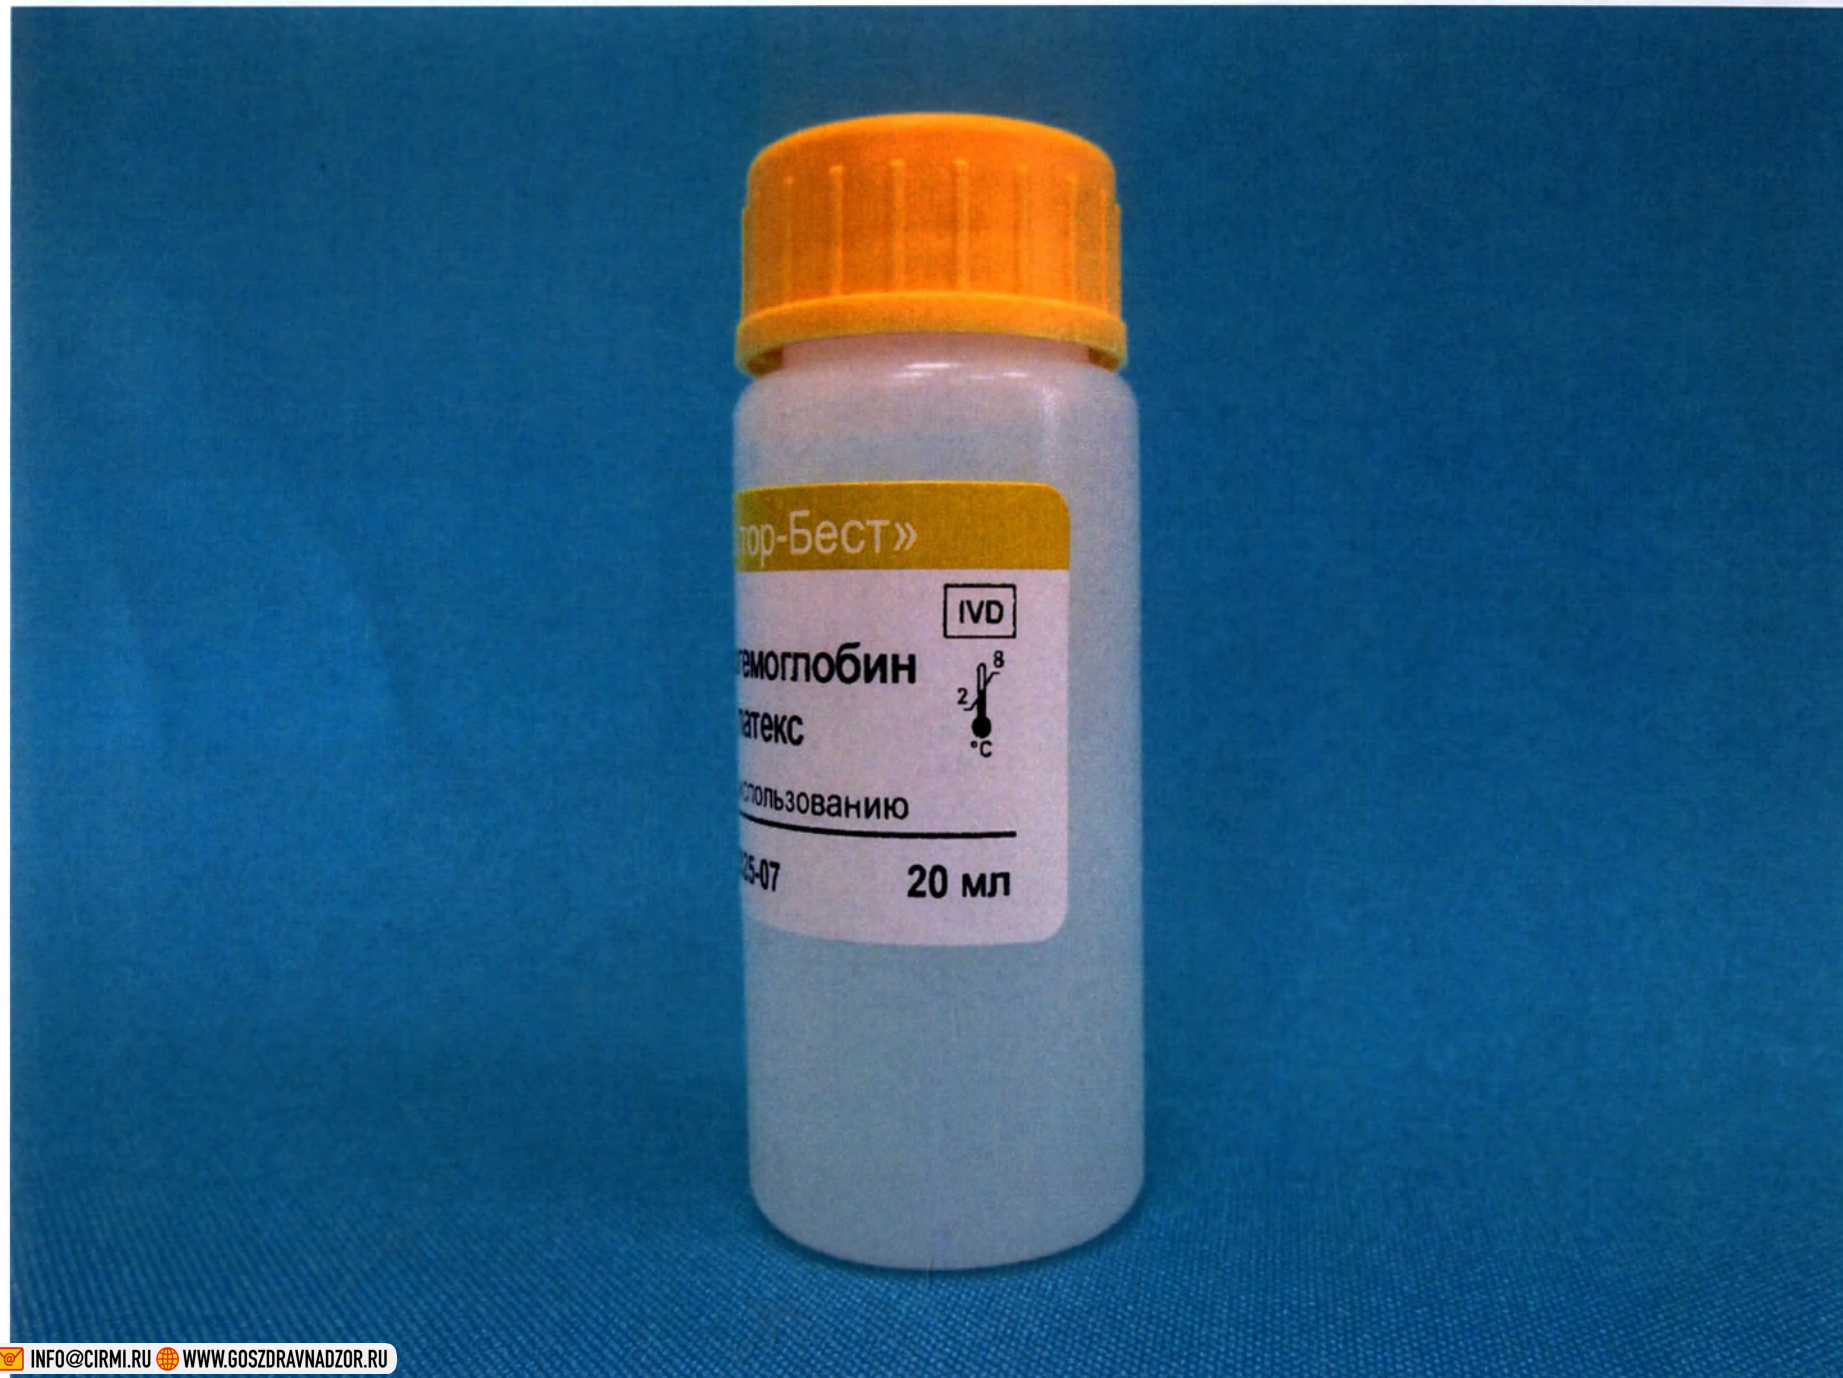


Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.

Директор по технологии и качеству

АО «Вектор-Бест»

Масяго А.В.

20 24 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА A1c
В КРОВИ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
(Гликогемоглобин латекс)
(вариант комплектации 3)



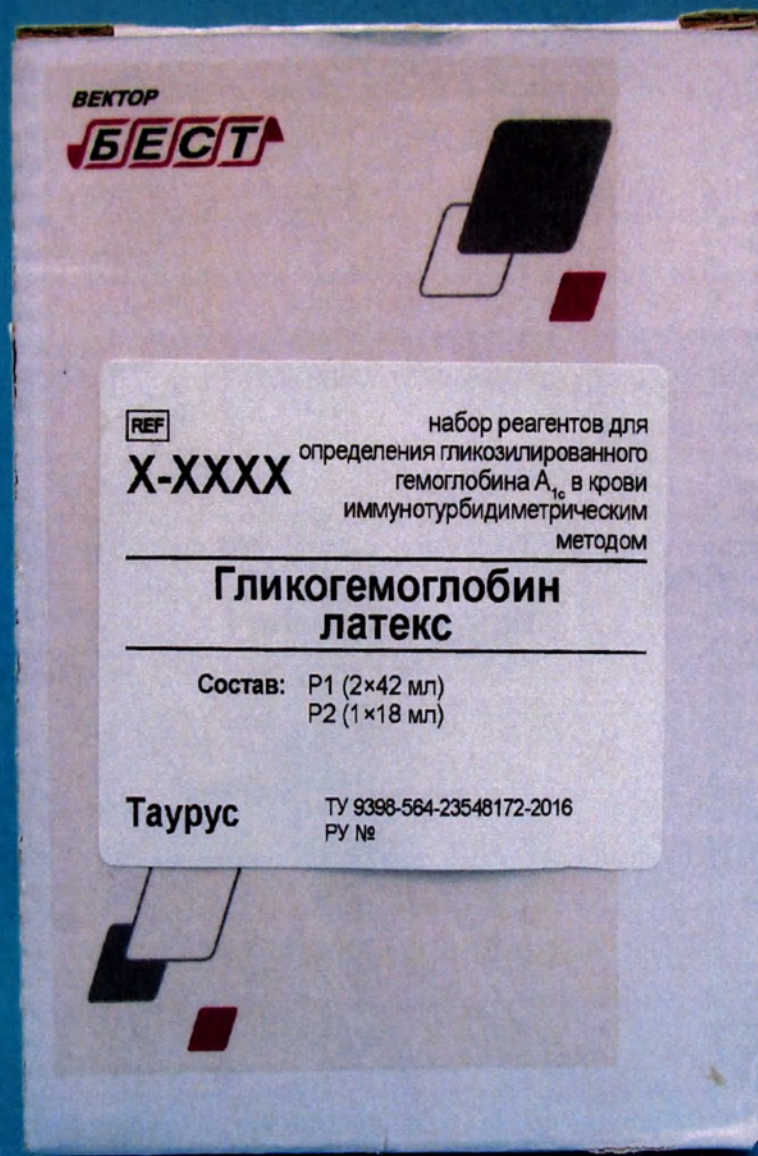





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

63559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

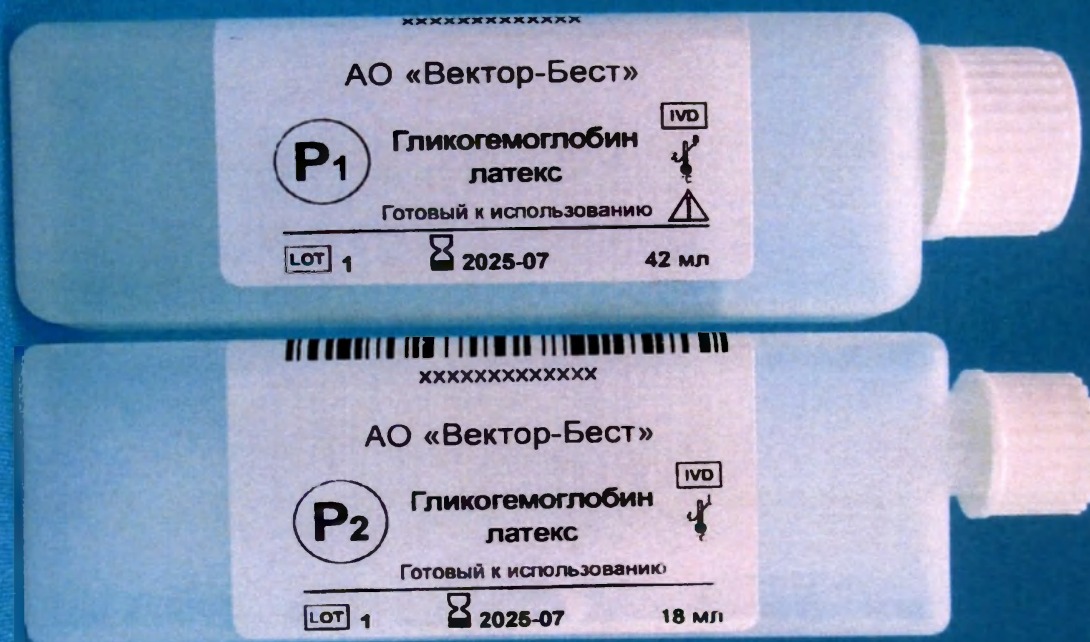






Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.

Директор по технологии и качеству

АО «Вектор-Бест»

Масяго А.В.

27 " 03 20 24 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА A1c
В КРОВИ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
(Гликогемоглобин латекс)
(вариант комплектации 4)

«Гликогемоглобин латекс»
(вариант комплектации 4, серия 1)

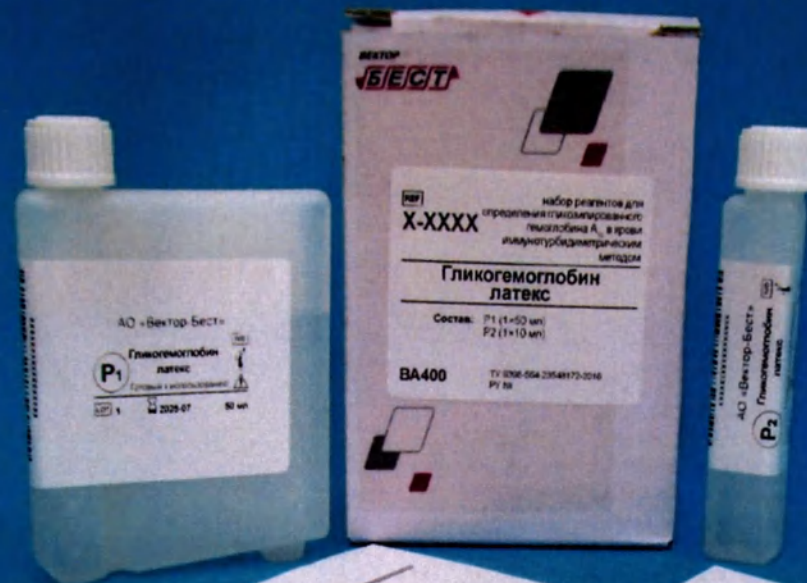

ВЕКТОР


1. НАЗНАЧЕНИЕ
Используется для определения гликогемоглобина (HbA1c) в крови методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием латексных частиц, покрытых антигеном гликогемоглобина.

2. КОМПОНЕНТЫ
Комплектация 4, серия 1:
- Реагент 1 (P1), серия 1 (1x50 мл)
- Реагент 2 (P2), серия 1 (1x10 мл)
- Набор реактивов для определения гликогемоглобина латекс (X-XXXX)

3. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ
Хранить при температуре 2-8°C. Транспортировать при температуре до 25°C. Вскрыть при температуре 2-8°C.

4. ПОКАЗАТЕЛИ
Показатель: Оптическая плотность калибратора K5 680 нм в 10 мм, не менее 0,15.
Соотношение оптической плотности калибратора K1 и K2: (B2-B1)/(B5-B1) x 100, % в пределах 4,0-5,5.
Соотношение оптической плотности калибратора K1 и K3: (B4-B1)/(B5-B1) x 100, % в пределах 4,0-5,5.

Параметр	Значение
Оптическая плотность калибратора K5 680 нм в 10 мм	0,15
Соотношение оптической плотности калибратора K1 и K2	4,0-5,5
Соотношение оптической плотности калибратора K1 и K3	4,0-5,5

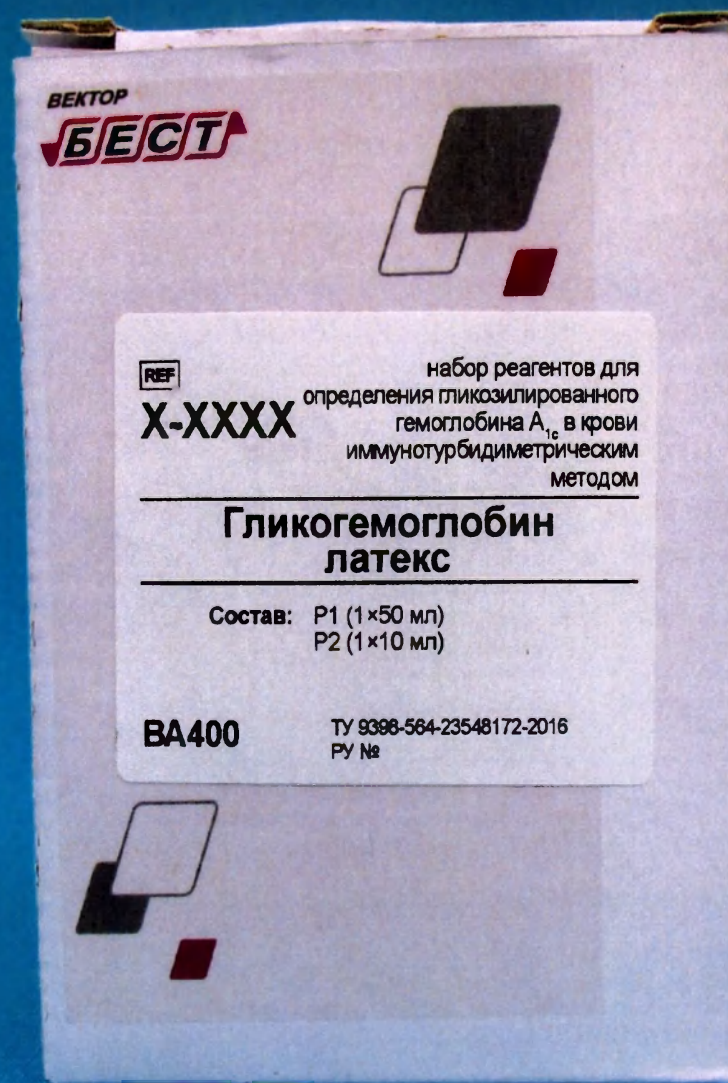





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

63559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**





№ 3 (вариант комплектации 4, серия 1)



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.
Директор по технологии и качеству

АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В.

20 24 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГЛИКОЗИЛИРОВАННОГО ГЕМОГЛОБИНА A1c
В КРОВИ ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
(Гликогемоглобин латекс)
(вариант комплектации 5)

«Гликогемоглобин латекс»
(вариант комплектации 5, серия 1)



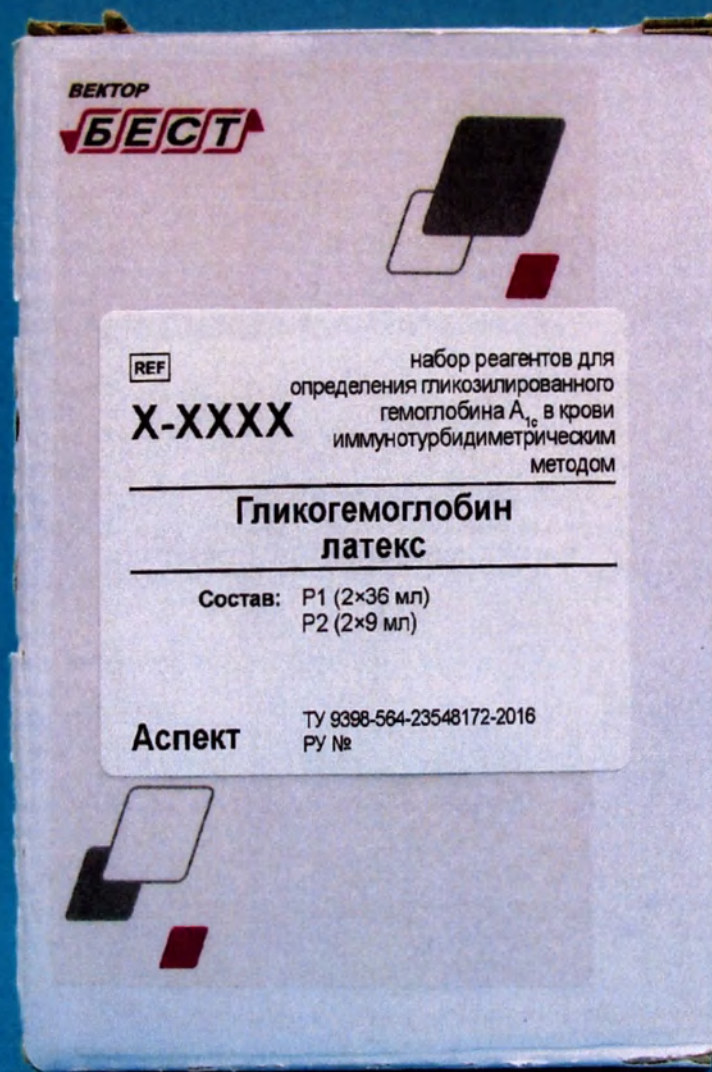





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

63559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**










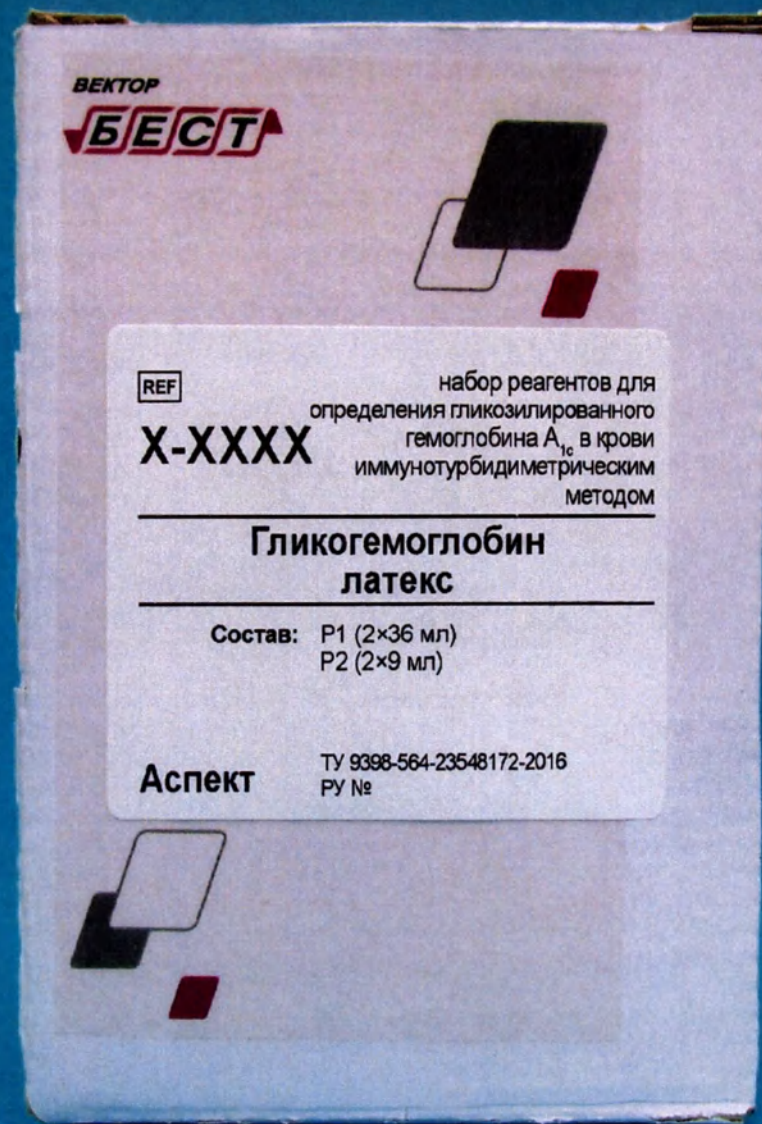

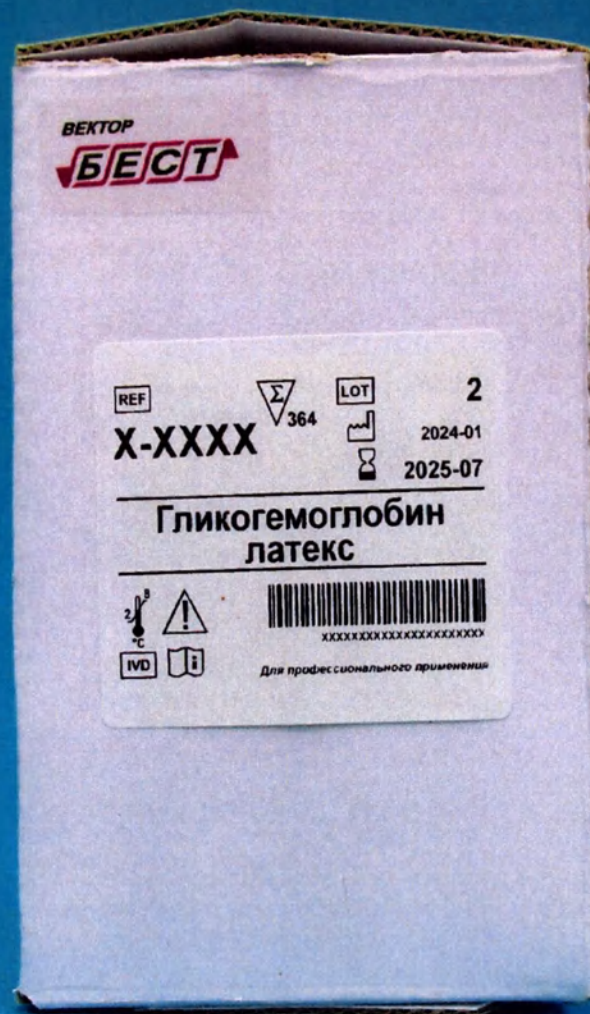



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

63559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru







Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15 листов.

Директор по технологии и качеству

АО «Вектор-Бест»

Масяго

Масяго А.В.

«27»

2023

20 24 г.

