

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»

М.Д. Хусаинов



«27» 05 2024 г.





Образцы маркировки на Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом (Иммуноглобулин А)


1. Образцы этикеток на компоненты набора «Иммуноглобулин А»

Наименование компонента	Этикетка
Вариант комплектации 1	
Реагент 1 (P1)	АО «Вектор-Бест» P₁ IVD Иммуноглобулин 45 мл Готовый к использованию LOT XXXX XXXX-XX

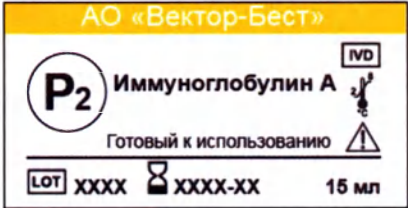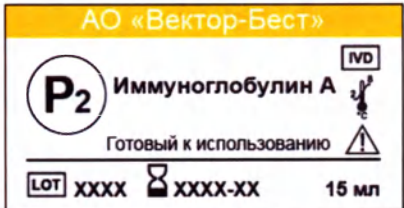Вариант комплектации 2	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	
Вариант комплектации 3	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	

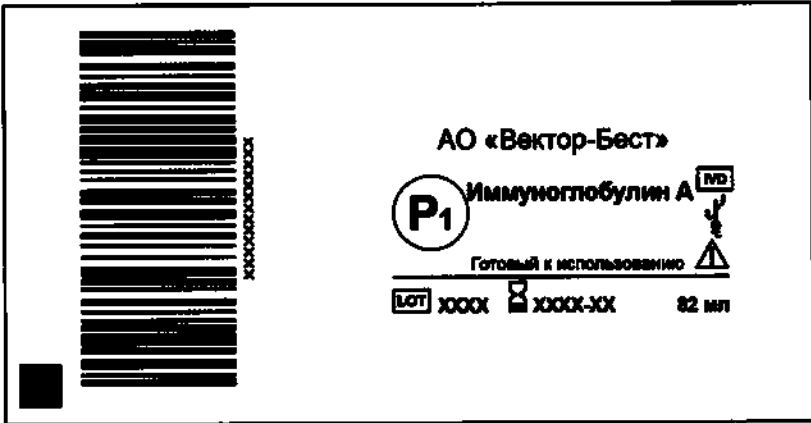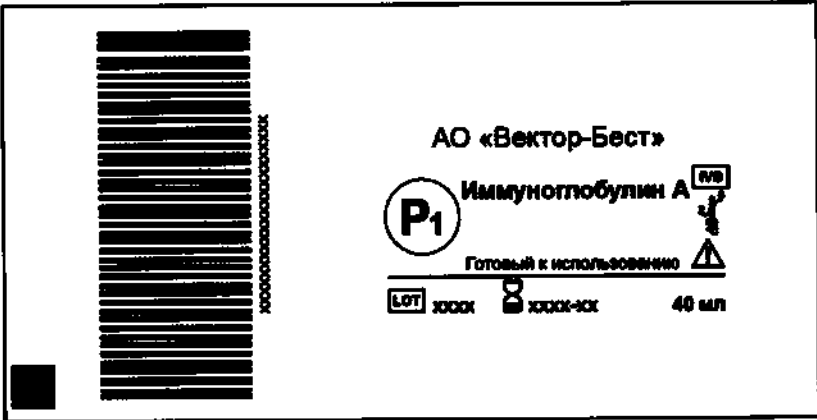Вариант комплектации 4 (Таурус)	
Реагент 1 (P1)	
Реагент 2 (P2)	
Вариант комплектации 5 (BA400)	
Реагент 1 (P1)	

Реагент 2 (P2)

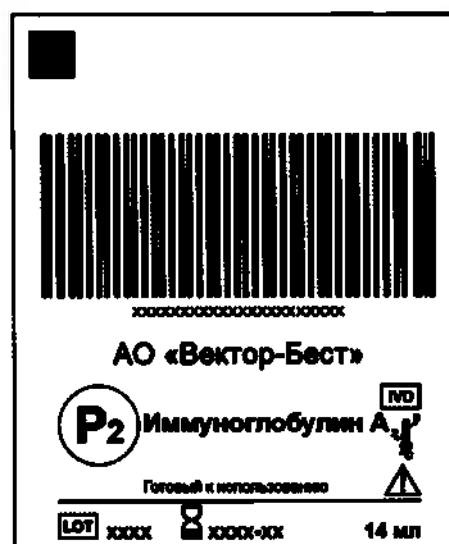

Вариант комплектации 6 (Аспект)


Реагент 1 (P1)



Реагент 2 (P2)	
----------------	--

2. Образцы этикеток на коробку набора «Имуноглобулин А»

2.1. Верхняя этикетка.

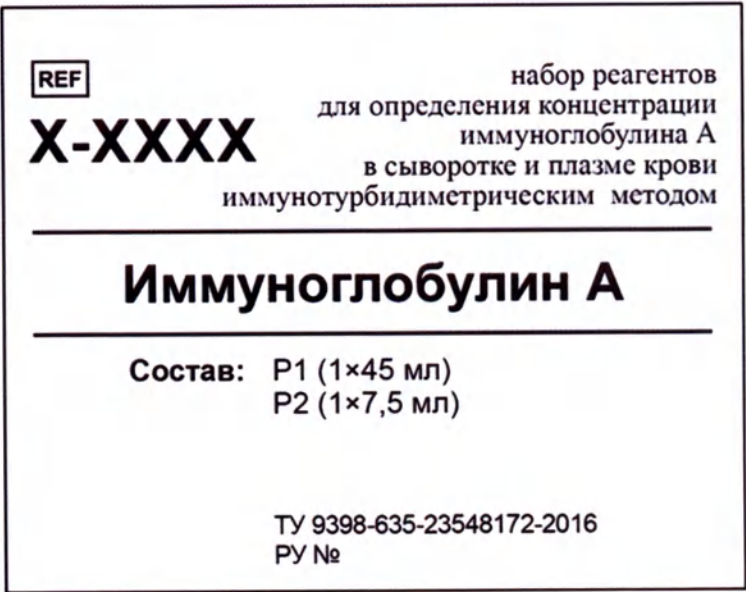Вариант комплектации 1	
------------------------	--

Вариант комплектации 2	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом Иммуноглобулин А Состав: P1 (2×45 мл) P2 (1×15 мл) ТУ 9398-635-23548172-2016 ПУ №
Вариант комплектации 3	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом Иммуноглобулин А Состав: P1 (2×90 мл) P2 (2×15 мл) ТУ 9398-635-23548172-2016 ПУ №
Вариант комплектации 4 (Таурус)	REF X-XXXX набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом Иммуноглобулин А Состав: P1 (1×82 мл) P2 (1×16 мл) Таурус ТУ 9398-635-23548172-2016 ПУ №

Вариант комплектации 5
(BA400)

REF

X-XXXX

набор реагентов
для определения концентрации
иммуноглобулина А
в сыворотке и плазме крови
иммунотурбидиметрическим методом

Иммуноглобулин А

Состав: P1 (2×40 мл)
P2 (1×14 мл)

BA400

ТУ 9398-635-23548172-2016
РУ №

Вариант комплектации 6
(Аспект)

REF

X-XXXX

набор реагентов
для определения концентрации
иммуноглобулина А
в сыворотке и плазме крови
иммунотурбидиметрическим методом

Иммуноглобулин А

Состав: P1 (2×44 мл)
P2 (2×9 мл)

Аспект

ТУ 9398-635-23548172-2016
РУ №

2.2. Боковая этикетка.

Варианты комплектации 1, 2, 3	
Вариант комплектации 4 (Таурус)	
Вариант комплектации 5 (BA400)	

Вариант комплектации 6 (Аспект)	REF X-XXXX Σ 276 LOT XXXX XXXX-XX XXXX-XX
	Иммуноглобулин А 2 3 с ! IVD i XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Для профессионального применения

Примечание. Непосредственно на коробку типографским способом наносятся следующие надписи:



АО «Вектор-Бест»
Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


AO Vector-Best
Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ
630559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-ендірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

«СОГЛАСОВАНО»

Директор по производству
АО «Вектор-Бест»



«24» 03

В.К. Ткачев
2024 г.

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 9 листов.

Директор по технологии и качеству

АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В.

2024г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ИММУНОГЛОБУЛИНА А В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ
ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
(Иммуноглобулин А)
(вариант комплектации 1)



«Иммуноглобулин А»
(вариант комплектации 1, серия 1)

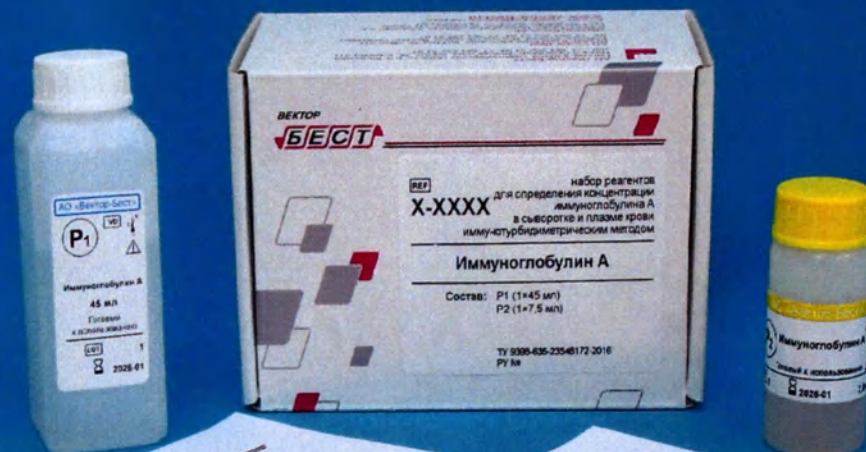

Вектор БЕСТ

Иммуноглобулин А

45 мл

П1

2028-01

БЕСТ

набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунобидиметрическим методом

Иммуноглобулин А

Состав: P1 (1×45 мл)
P2 (1×7.5 мл)

ТУ 9306-636-23546172-2016
P1 №

Иммуноглобулин А

2028-01

Вектор БЕСТ

Иммуноглобулин А

45 мл

П1

2028-01

БЕСТ

набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунобидиметрическим методом

Иммуноглобулин А

Состав: P1 (1×45 мл)
P2 (1×7.5 мл)

ТУ 9306-636-23546172-2016
P1 №

Иммуноглобулин А

2028-01

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
1	Иммуноглобулин А (P1)	мл	45	
2	Иммуноглобулин А (P2)	мл	7.5	

Вектор БЕСТ

Иммуноглобулин А

45 мл

П1

2028-01

БЕСТ

набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунобидиметрическим методом


Иммуноглобулин А

Состав: P1 (1×45 мл)
P2 (1×7.5 мл)

ТУ 9306-636-23546172-2016
P1 №

Иммуноглобулин А

2028-01

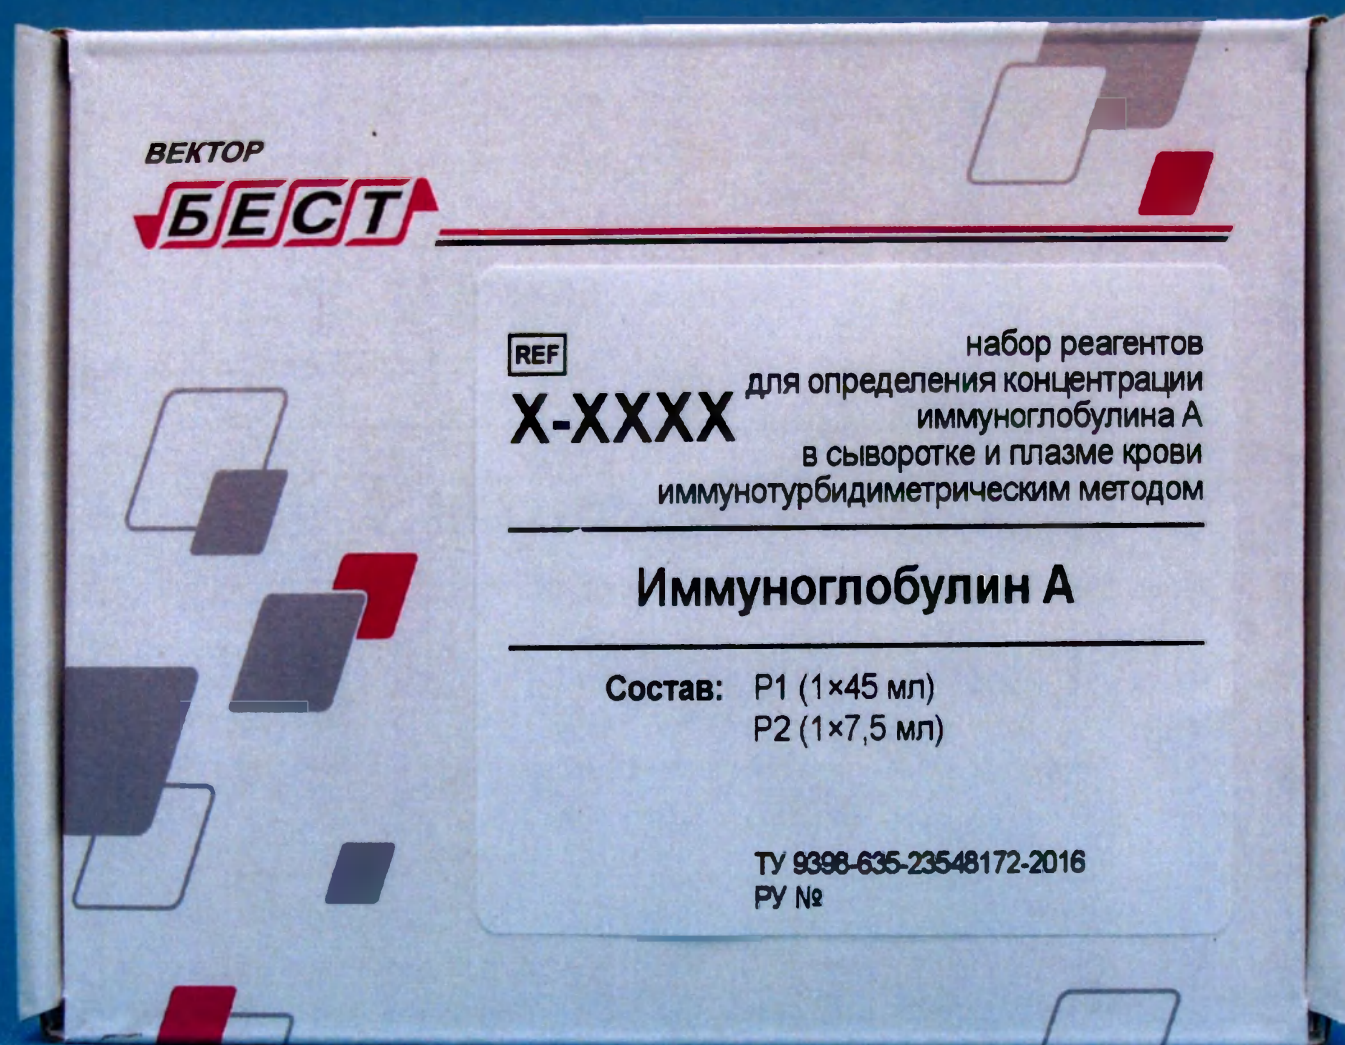

REF

X-XXXX

LOT

1




2024-01



2026-01

Иммуноглобулин А




IVD




XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


Для профессионального применения

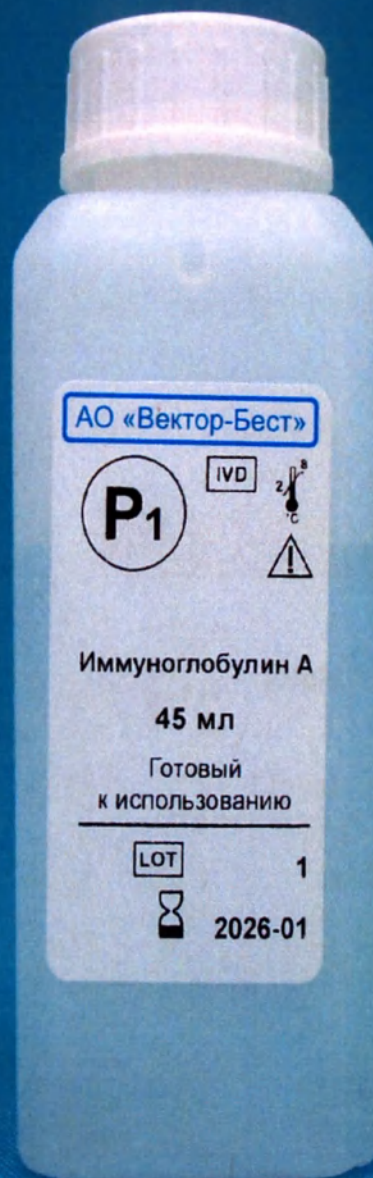



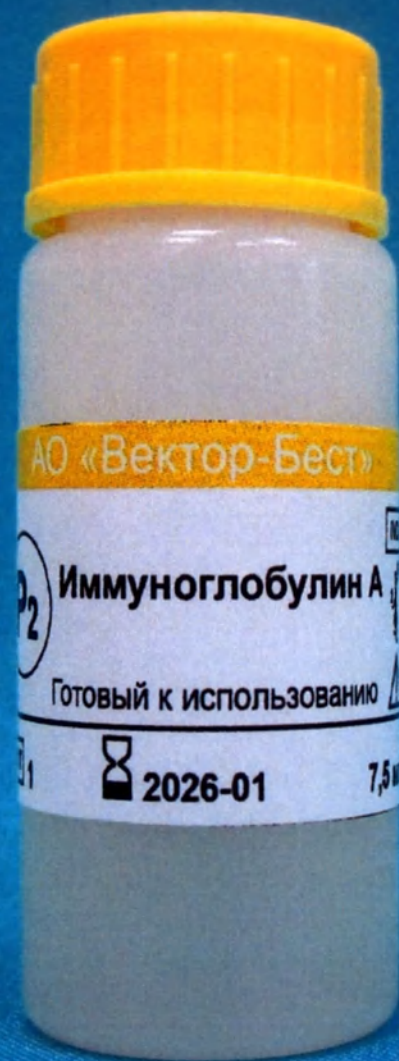

№ 4 (вариант комплектации 1, серия 1)

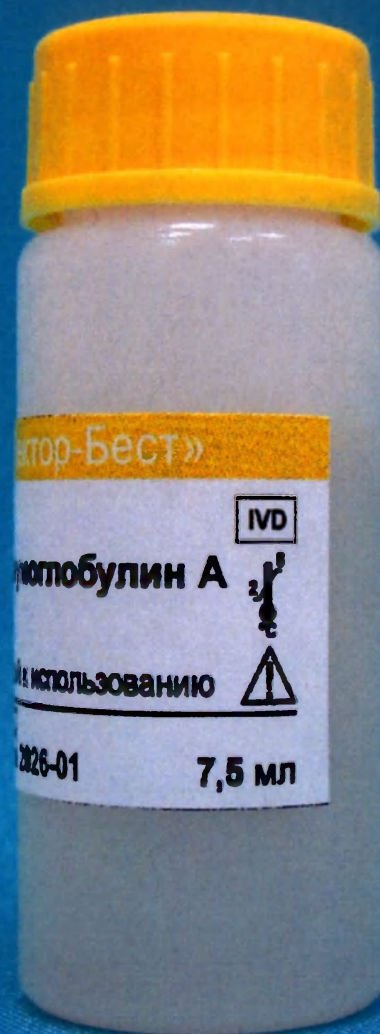

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.

Директор по технологии и качеству

АО «Вектор-Бест»

Масяго А.В.

23 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.


2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ИММУНОГЛОБУЛИНА А В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ
ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
(Иммуноглобулин А)
(вариант комплектации 2)

«Иммуноглобулин А»

(вариант комплектации 2, серия 1)

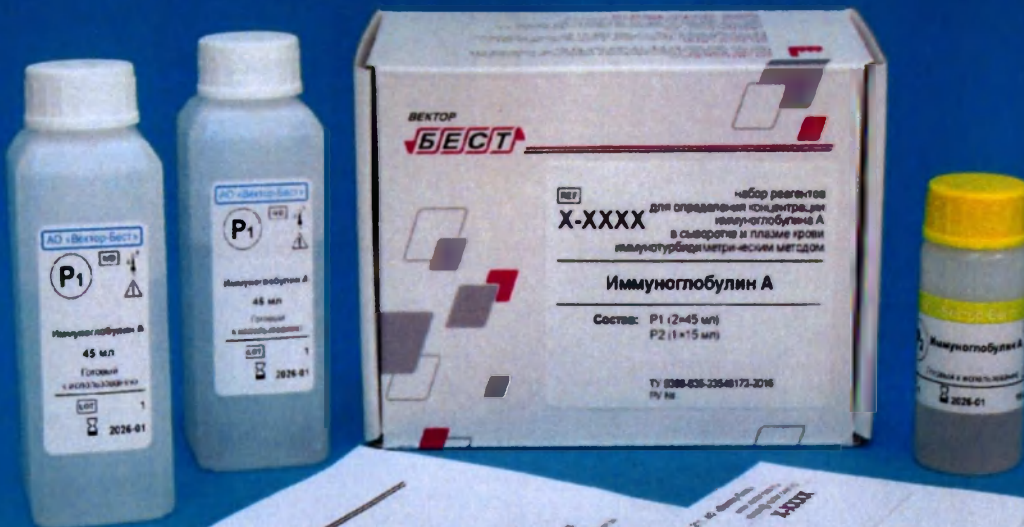[illegible]

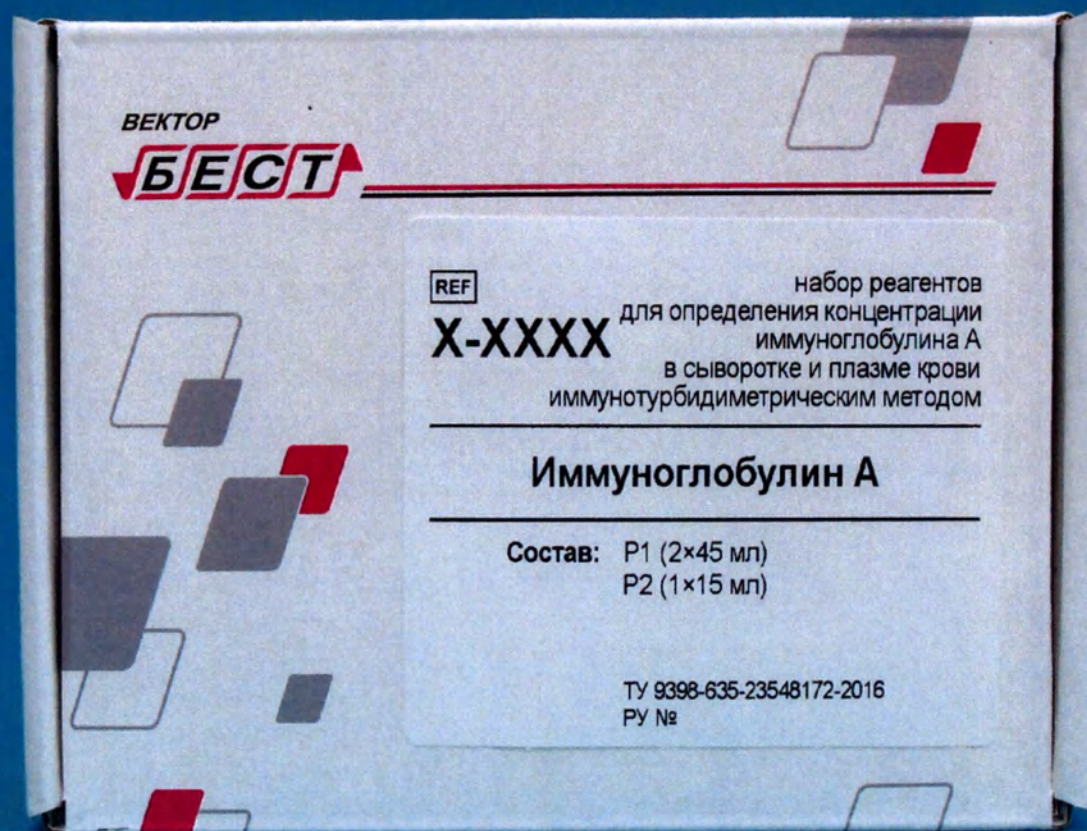





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


АО Vector-Best


Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru

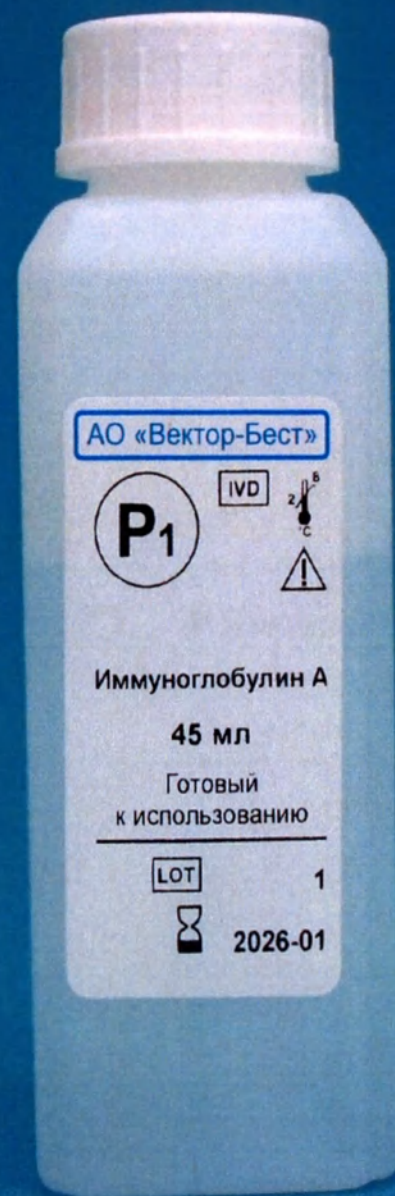

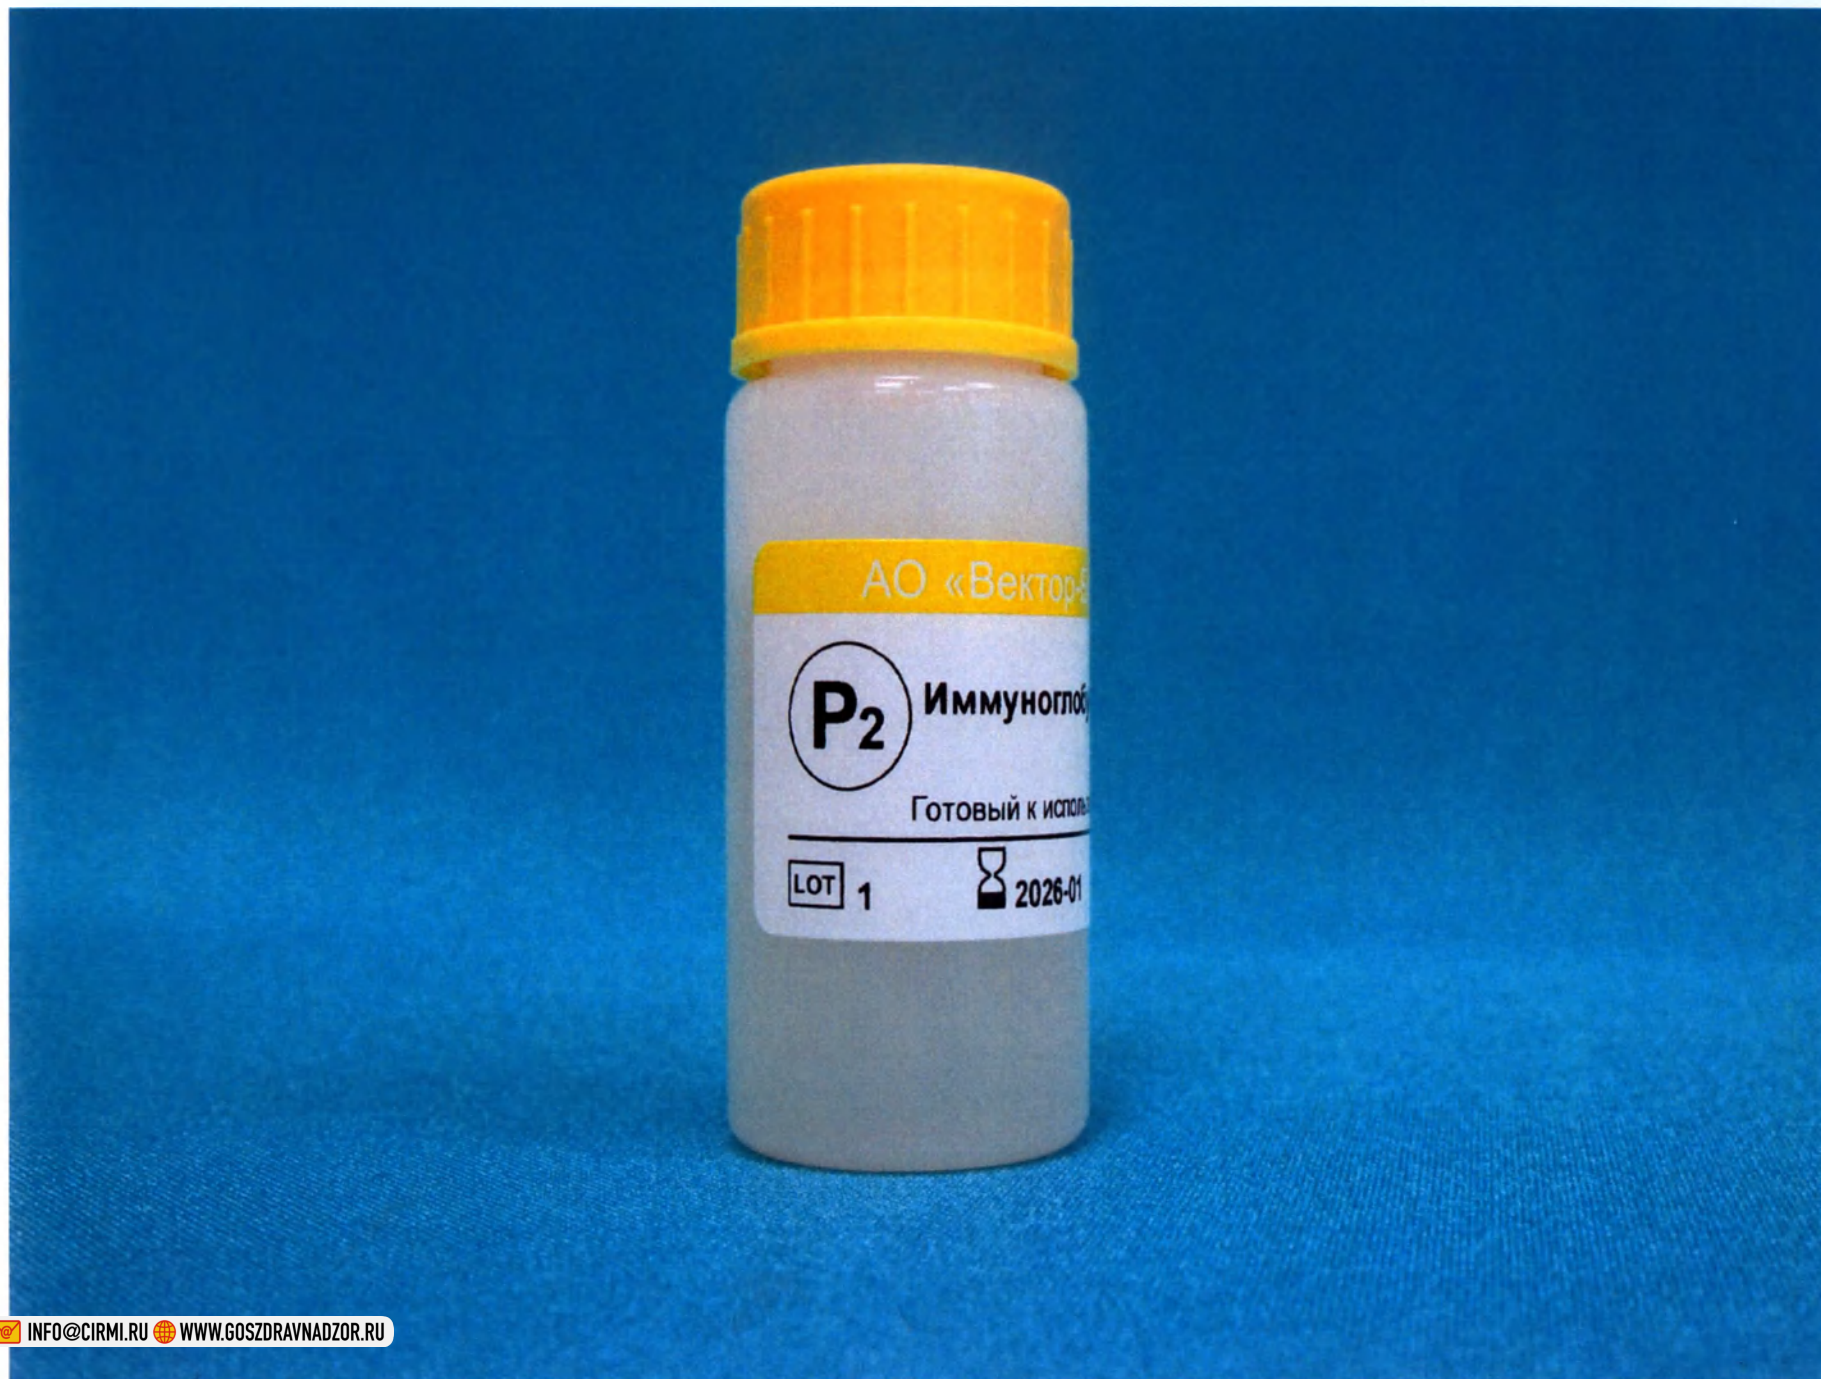

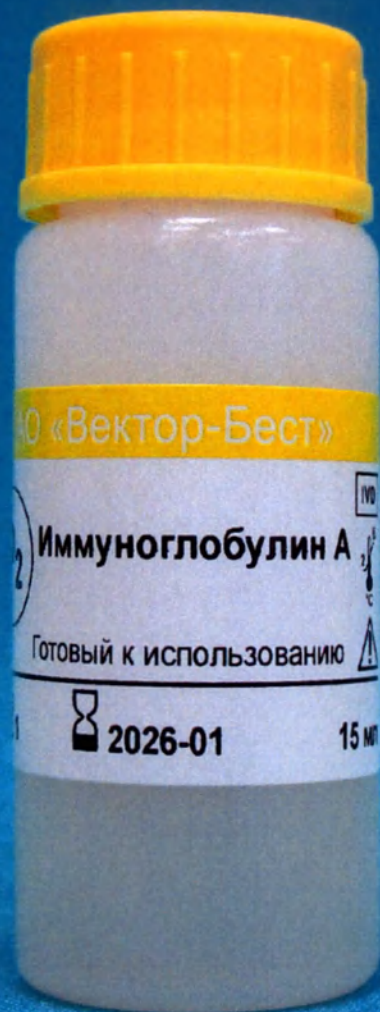



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью: 9 листов.

Директор по технологиям и качеству
АО "Вектор-Бест"

Масяго Масяго А.В.
23 20 24 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2024 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ИММУНОГЛОБУЛИНА А В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ
ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
(Иммуноглобулин А)
(вариант комплектации 3)

«Иммуноглобулин А»

(вариант комплектации 3, серия 1)





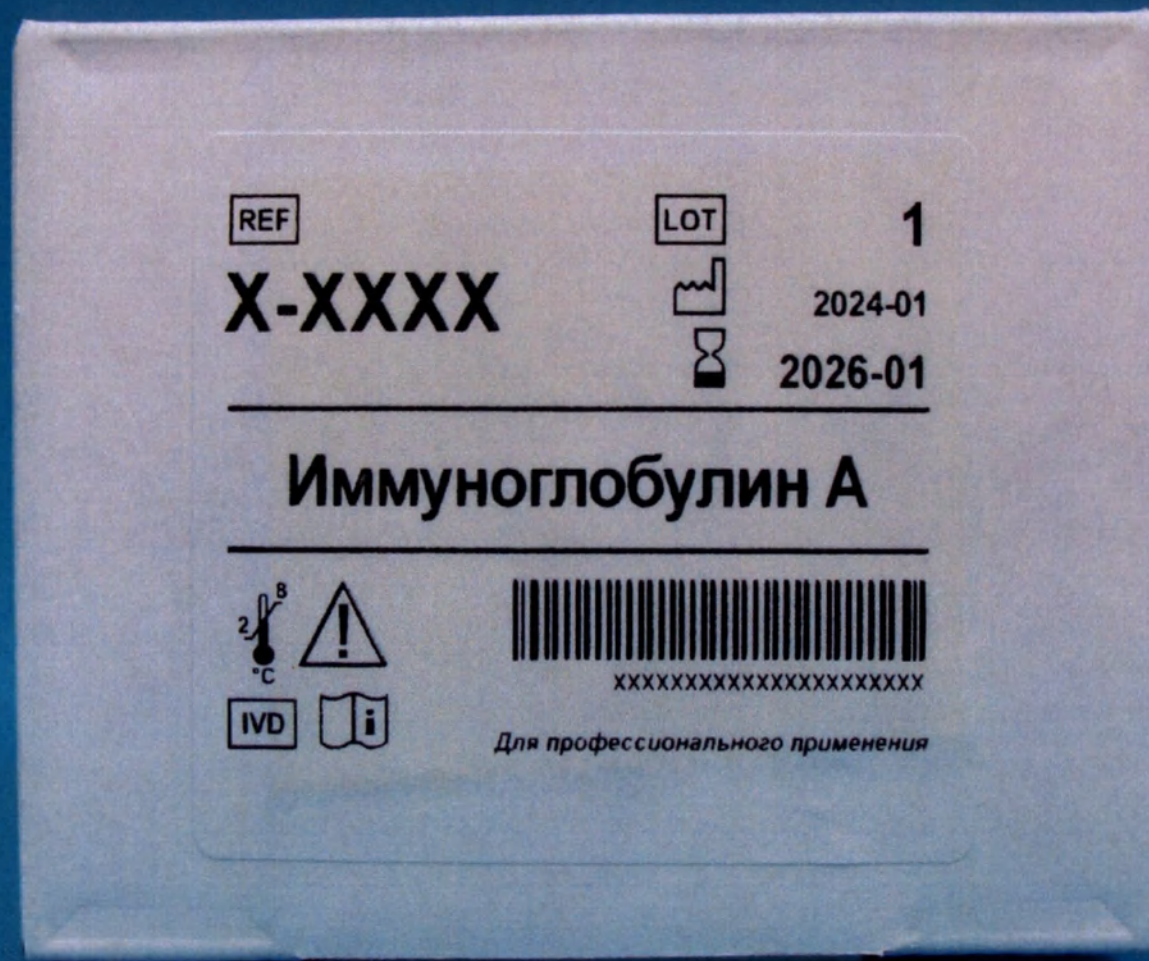



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,
Научно-производственная зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


AO Vector-Best


Research and Production area, building 36, office 211,
Koltsovo, 630559, Novosibirsk region, Russian Federation
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

630559, Ресей, Новосибирск облысы, Кольцово ж.к.
Ғылыми-өндірістік аймақ, 36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**

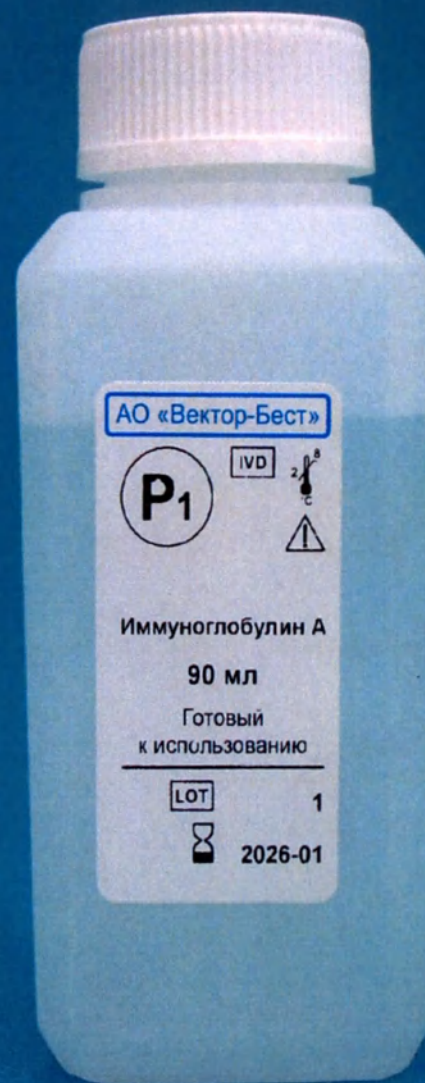

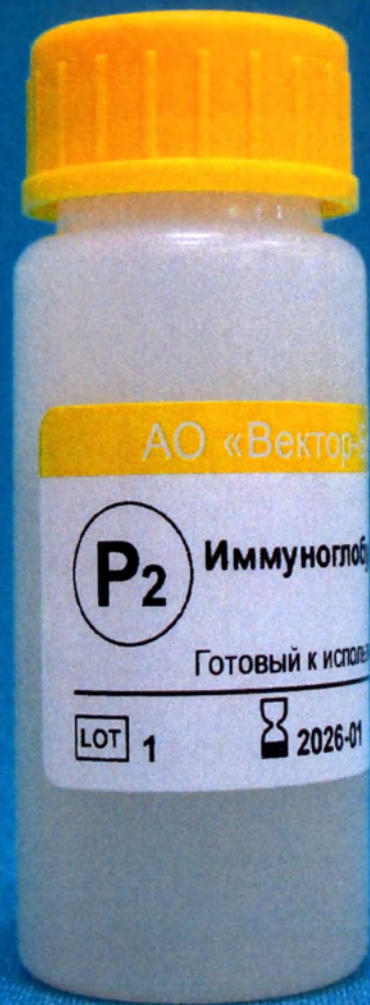





“ 27 ” 20 24 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»




Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ИММУНОГЛОБУЛИНА А В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ
ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
(Иммуноглобулин А)
(вариант комплектации 4)


«Иммуноглобулин А»
(вариант комплектации 4, серия 1)



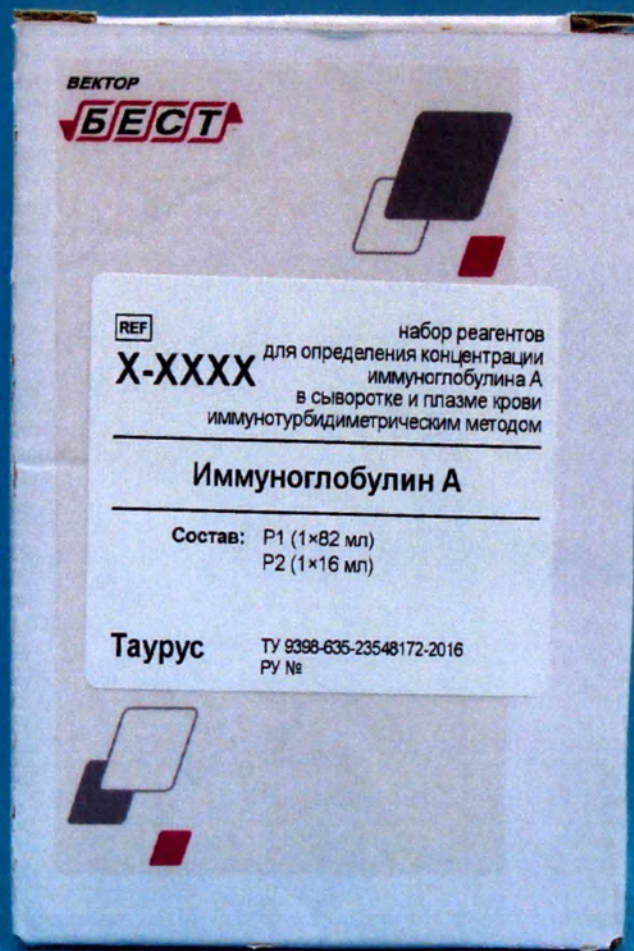

«Иммуноглобулин А»

№ 2 (вариант комплектации 4, серия 1)

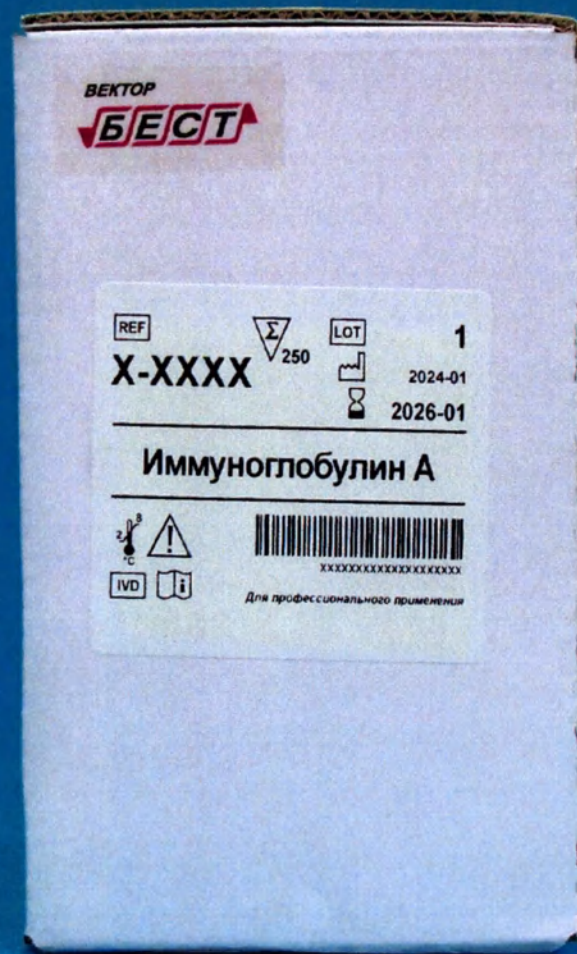



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

63559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru






«Иммуноглобулин А»

№ 3 (вариант комплектации 4, серия 1)



Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.

Директор по технологиям и качеству
АО "Вектор-Бест"

 Масяго А.В.
20 24 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.

2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ИММУНОГЛОБУЛИНА А В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ
ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
(Иммуноглобулин А)
(вариант комплектации 5)

«Иммуноглобулин А»
(вариант комплектации 5, серия 1)



Вектор-БЕСТ

ИММУНОГЛОБУЛИН А

ПАСПОРТ № 04/14

Иммуноглобулин А

Набор реагентов для определения концентрации иммуноглобулина А в сыворотке и плазме крови иммунотурбидиметрическим методом

Состав: P1 (2x40 мл)
P2 (1x14 мл)

ВА400

ТУ 8098-835-25548172-2016

РУ ИИ

Наименование	Единица измерения	Количество	Примечание
Иммуноглобулин А (P1)	мл	80	
Иммуноглобулин А (P2)	мл	14	

Срок годности: 12 месяцев


Условия хранения: при температуре от +2 до +8 °С


Производитель: АО «Вектор-Бест», г. Новосибирск



«Иммуноглобулин А»

№ 1 (вариант комплектации 5, серия 1)

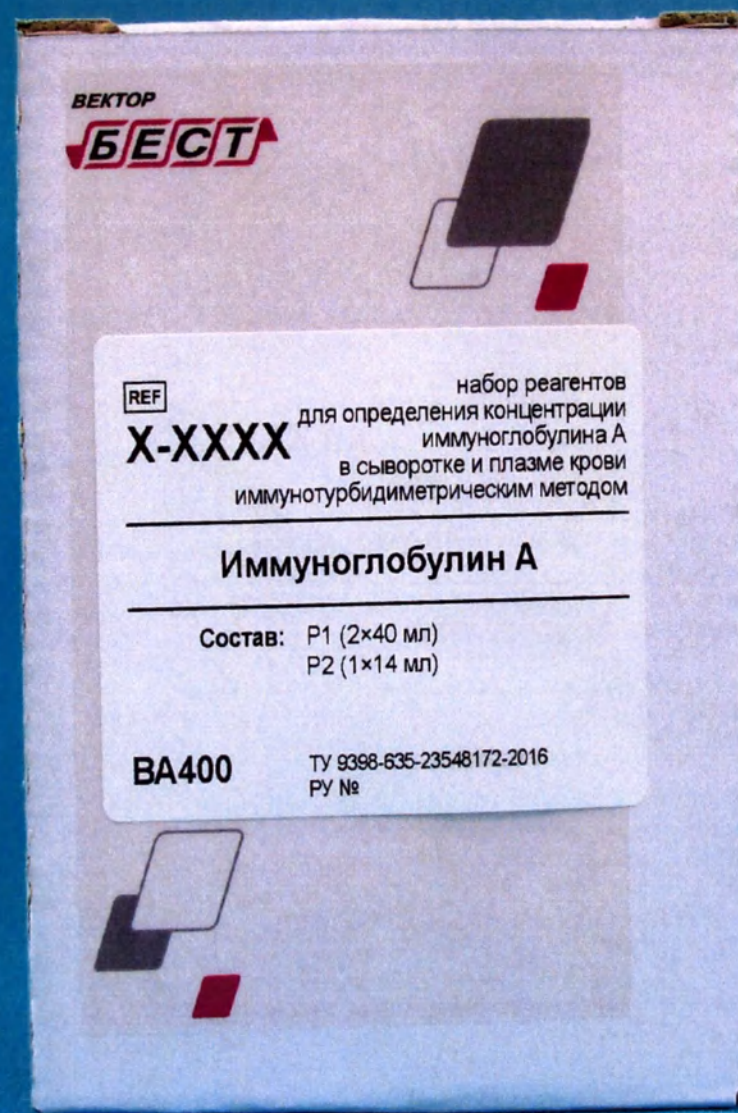

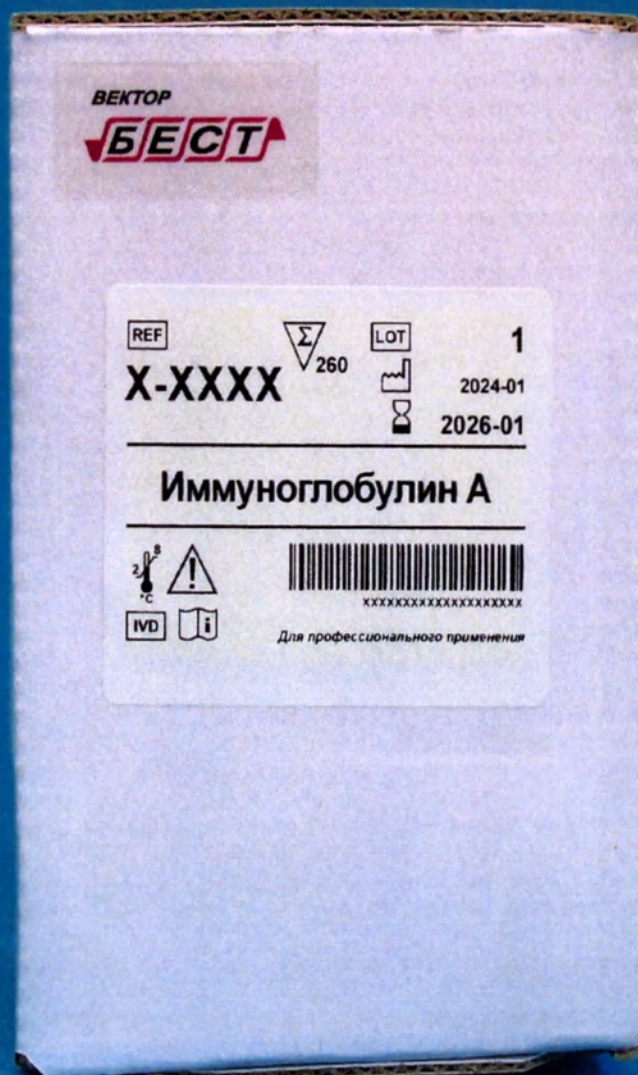



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67


AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

«Вектор-Бест» АҚ

63559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**

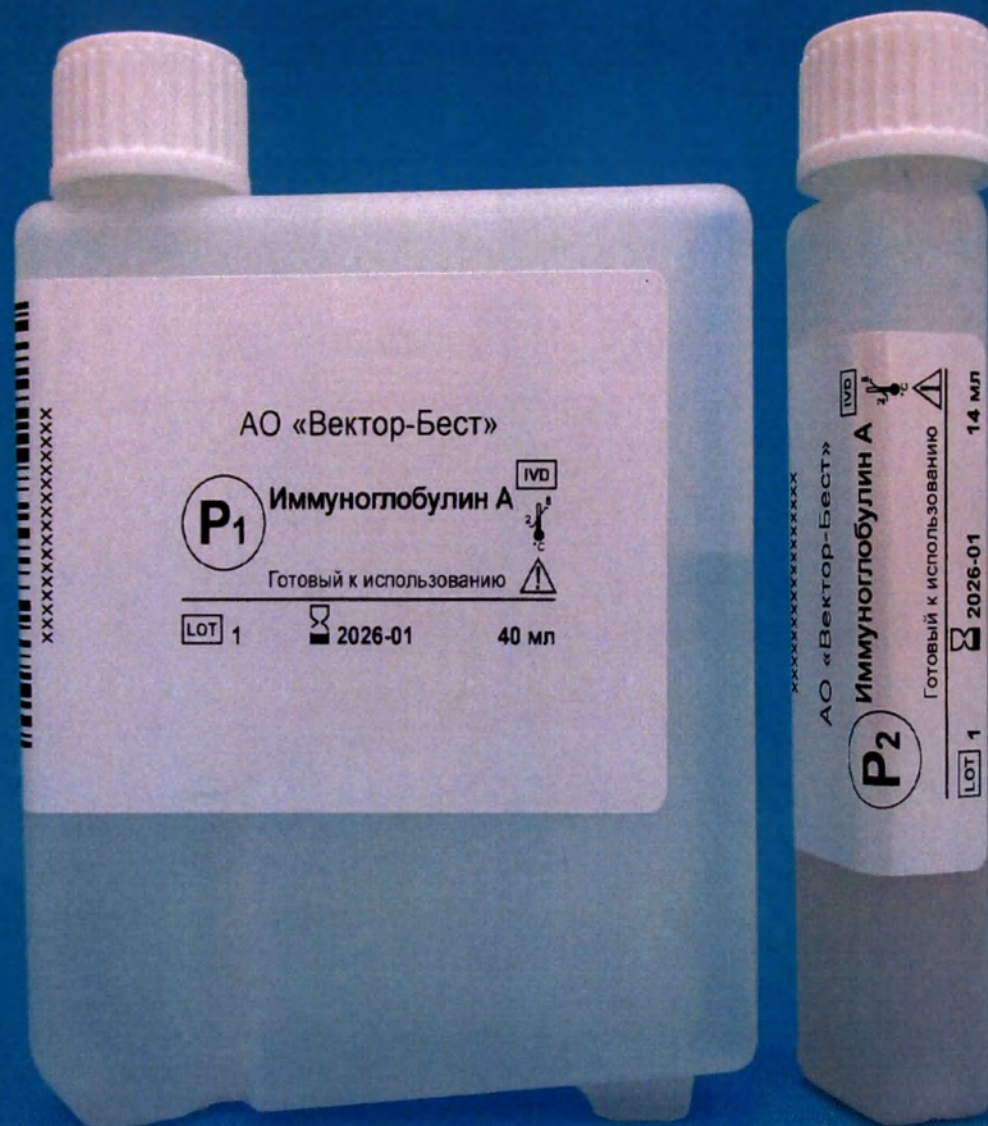






Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 8 листов.

Директор по технологии и качеству
АО "Вектор-Бест"

 Масяго А.В.

23 20 24 г.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Вектор-Бест»



Хусаинов М.Д.


27 2024 г.


ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
НАБОР РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ
ИММУНОГЛОБУЛИНА А В СЫВОРОТКЕ И ПЛАЗМЕ КРОВИ
ИММУНОТУРБИДИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
(Иммуноглобулин А)
(вариант комплектации 6)



«Иммуноглобулин А»
(вариант комплектации 6, серия 1)



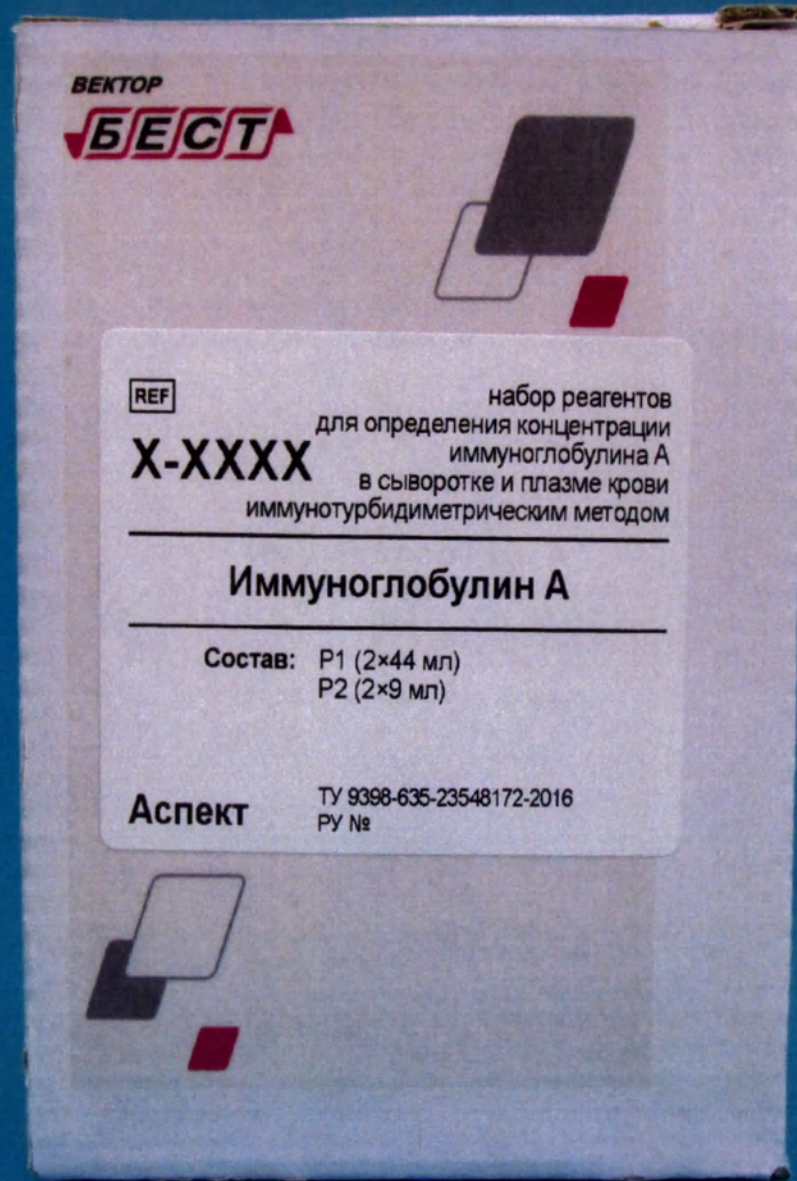

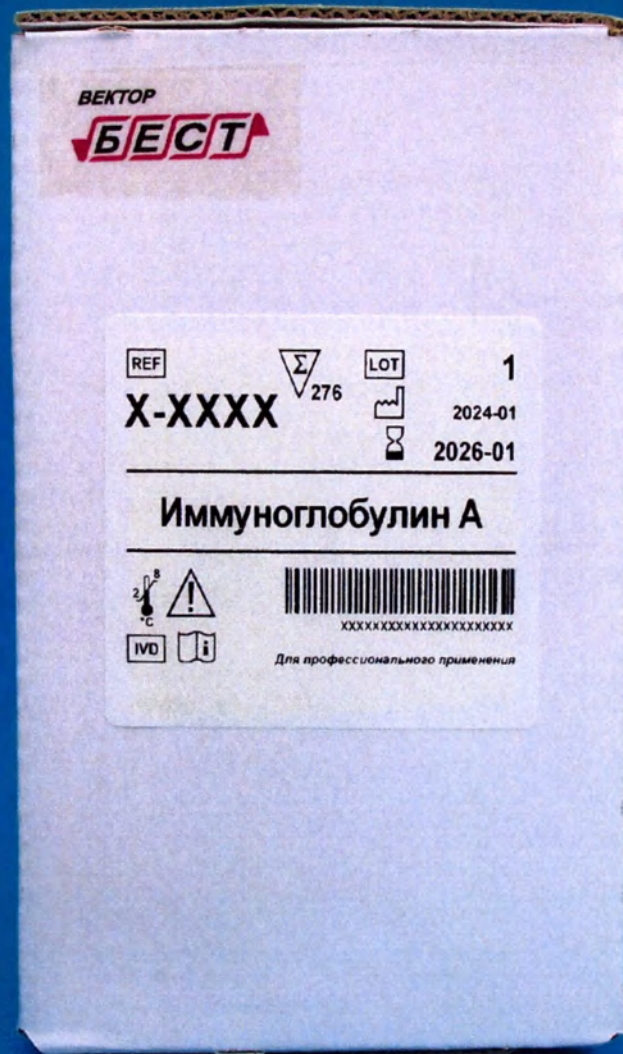



АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

AO Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


«Вектор-Бест» АҚ

63559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


**E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru**





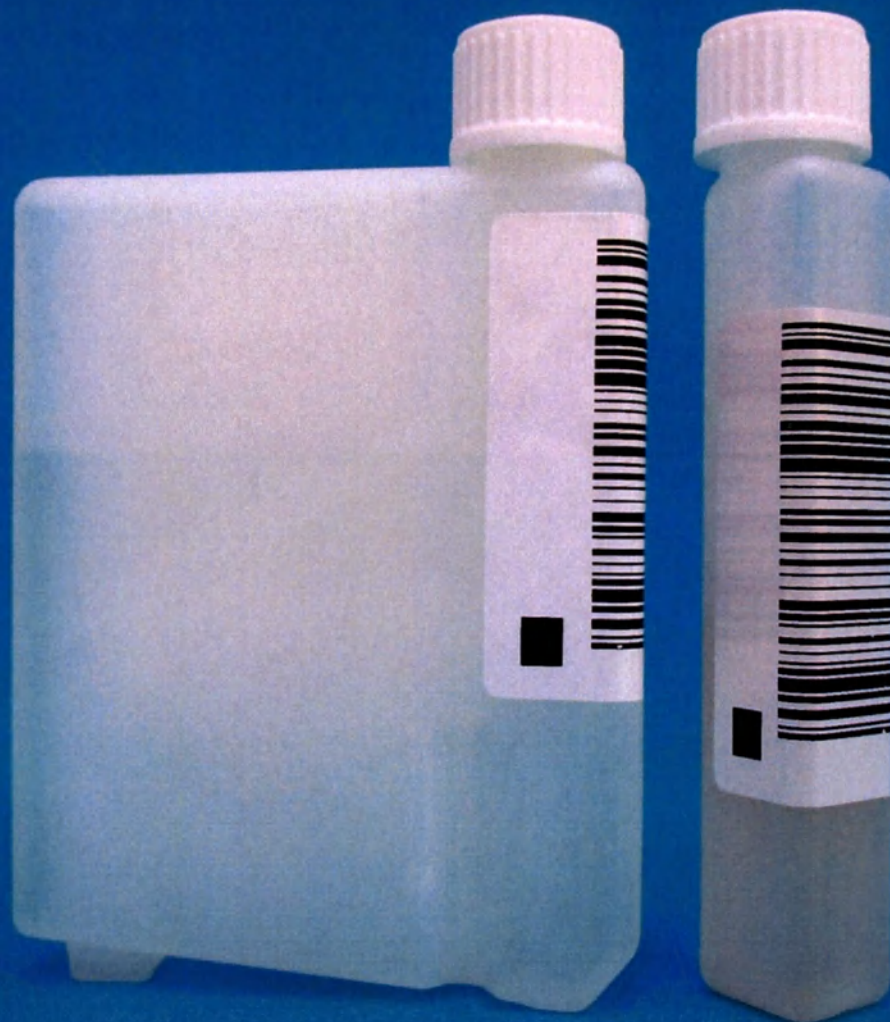



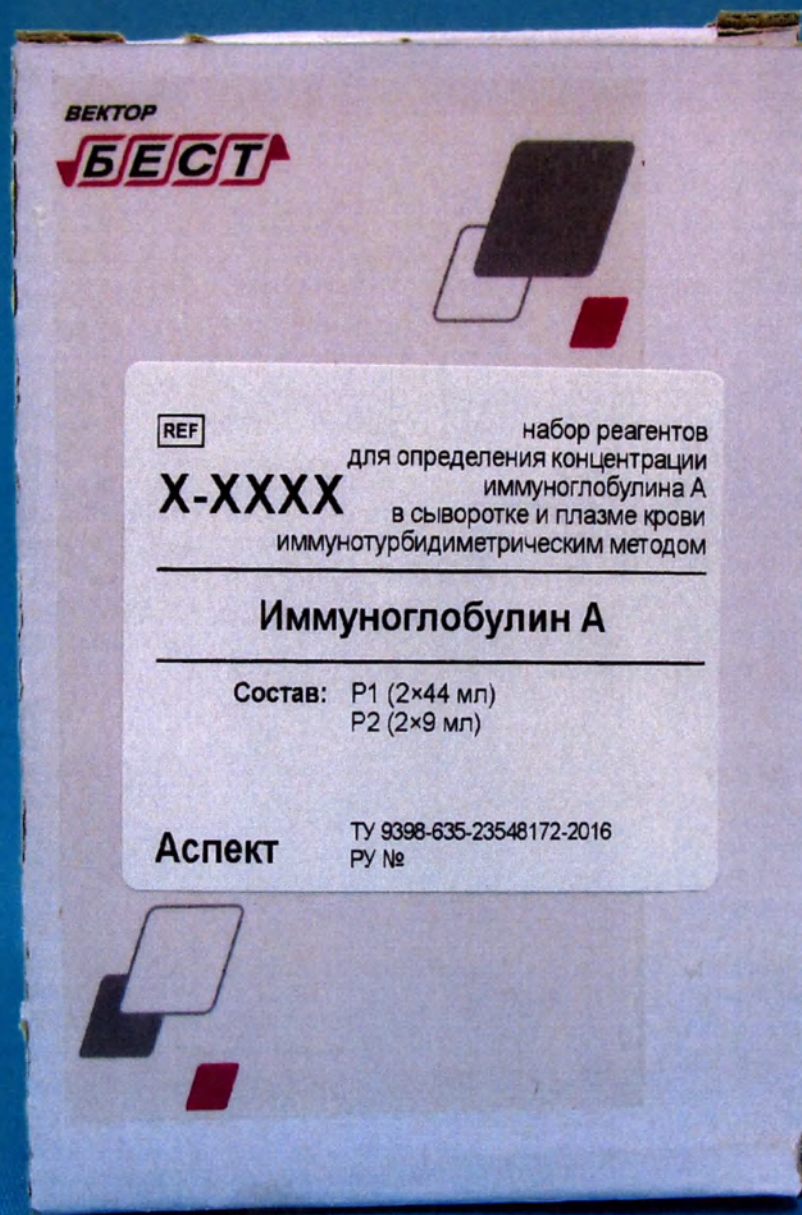





АО «Вектор-Бест»

Россия, 630559, Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Научно-производственная
зона, корпус 36, комната 211,
тел.: +7 383 252 5164, +7 383 252 51 67

АО Vector-Best

Research and Production area, building 36,
office 211, Koltsovo, 630559, Novosibirsk region,
Russian Federation,
tel.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67


«Вектор-Бест» АҚ

63559, Ресей, Новосибирск облысы,
Кольцово ж.к. Ғылыми-өндірістік аймақ,
36 корпус, 211 бөлме,
тел.: +7 383 252 51 64, +7 383 252 51 67

E-mail: vbmarket@vector-best.ru
www.vector-best.ru





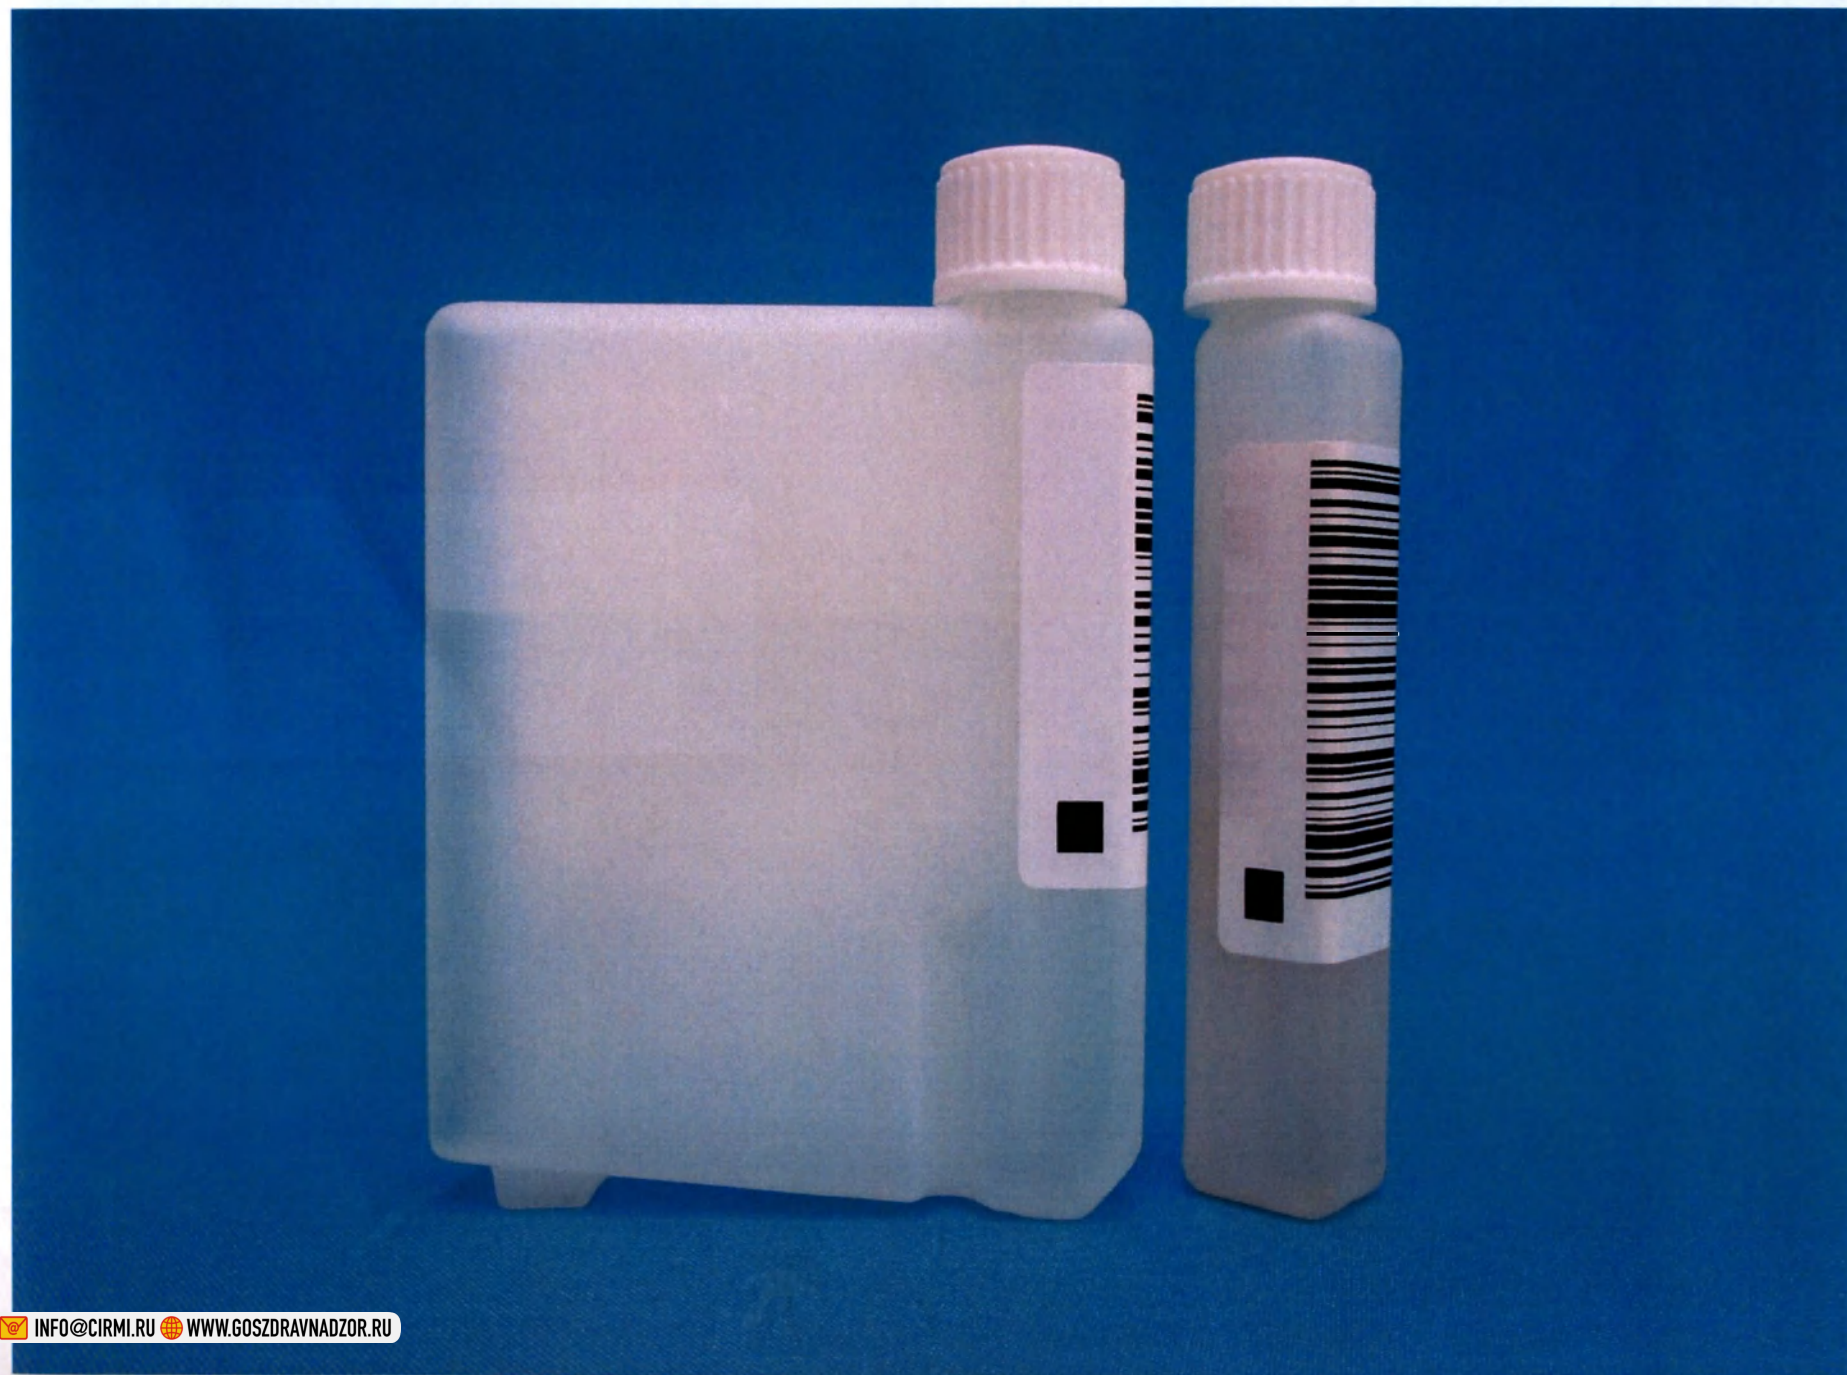

Всего прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 15 листов.

Директор по технологии и качеству

АО "Вектор-Бест"

Масяго А.В.

20 24 г.

