


УТВЕРЖДАЮ  
Старший специалист по регистрации  
ООО «Бекмен Культер»

Григорьева О.А.  
« 17 » \_\_\_\_\_ 2024 г.

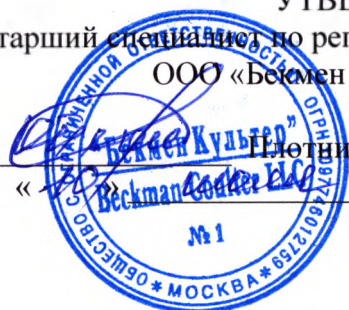

**Фотографические изображения медицинского изделия**  
«Система лабораторной автоматизации "Power Express"»,  
производства «Бекмен Культер, Инк.» (Beckman Coulter, Inc.), США

**Общество с ограниченной ответственностью «Бекмен Культер»**

109004 г. Москва, ул. Станиславского, д. 21, стр. 3

Тел.: +7 (495) 228 67 00; +7 (495) 228 67 01

E-mail: [beckman.ru@beckman.com](mailto:beckman.ru@beckman.com)

[www.beckmancoulter.com](http://www.beckmancoulter.com)





Рисунок 1. Динамический модуль загрузки образцов PE Dynamic Inlet.





Рисунок 2. Модуль определения ошибок на линии Error Lane.





Рисунок 3. Модуль выгрузки образцов Outlet.





Рисунок 4. Модуль удаления крышек с пробирок, первичный Primary Decarper.





Рисунок 5. Модуль удаления крышек с пробирок, вторичный Secondary Decapper.





Рисунок 6. Модуль установки универсальных крышек на пробирки Universal Recapper.





Рисунок 7. Молдук для подключения прибора Architect.





Рисунок 8. Блок питания модуля для подключения прибора Architect.





Рисунок 9. Линия двухполосная усиленная I 900 (2-2).



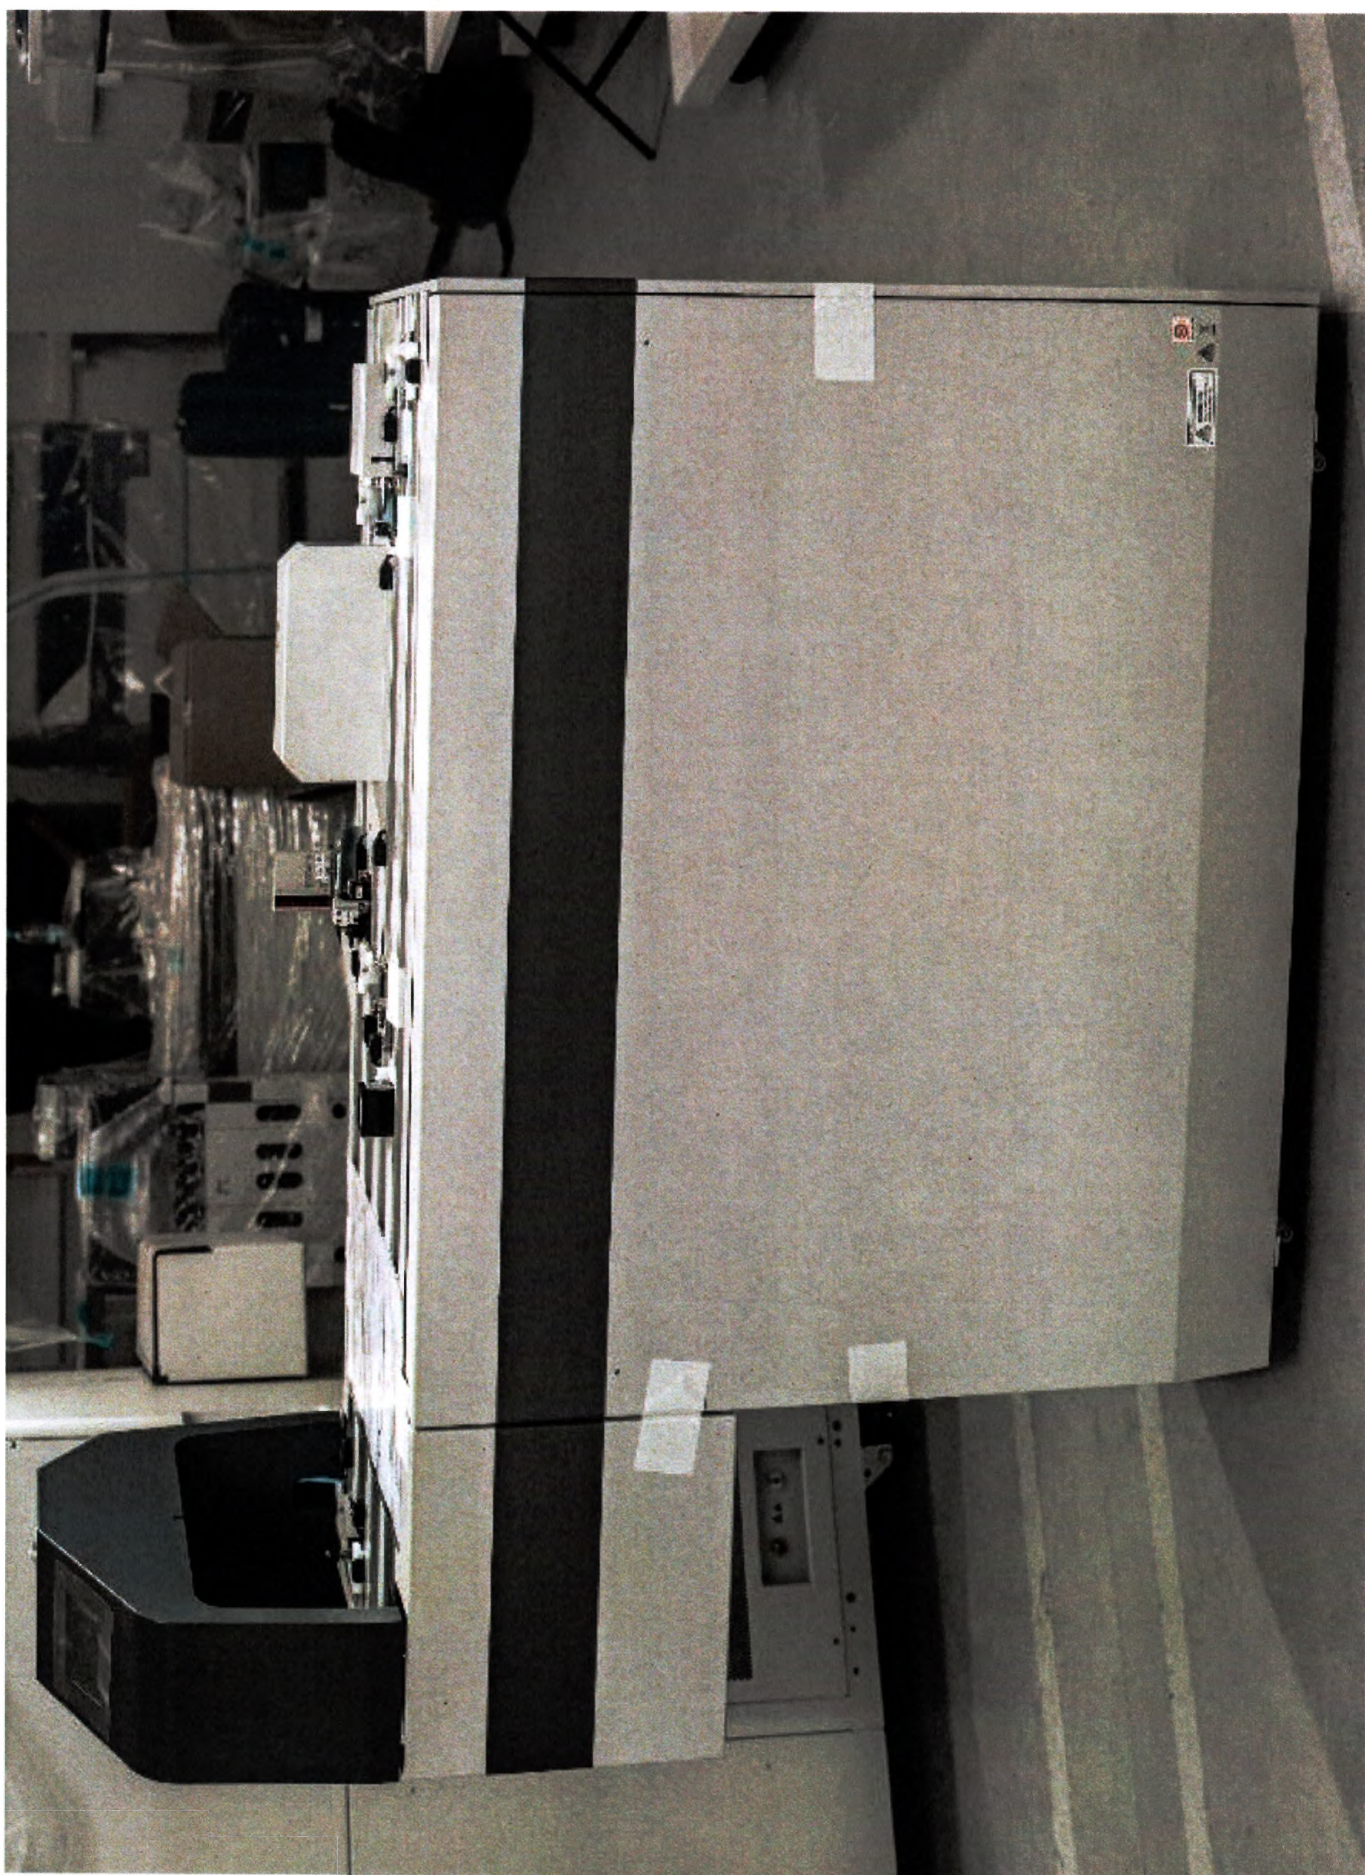


Рисунок 10. Модуль для подключения прибора DxH.





Рисунок 11. Интерфейс для подключения прибора ДХН.





Рисунок 12. Штативы для приборов DxH.









Рисунок 14. Модуль для подключения прибора AU 5800 и Крышка, линия подключения AU5800.



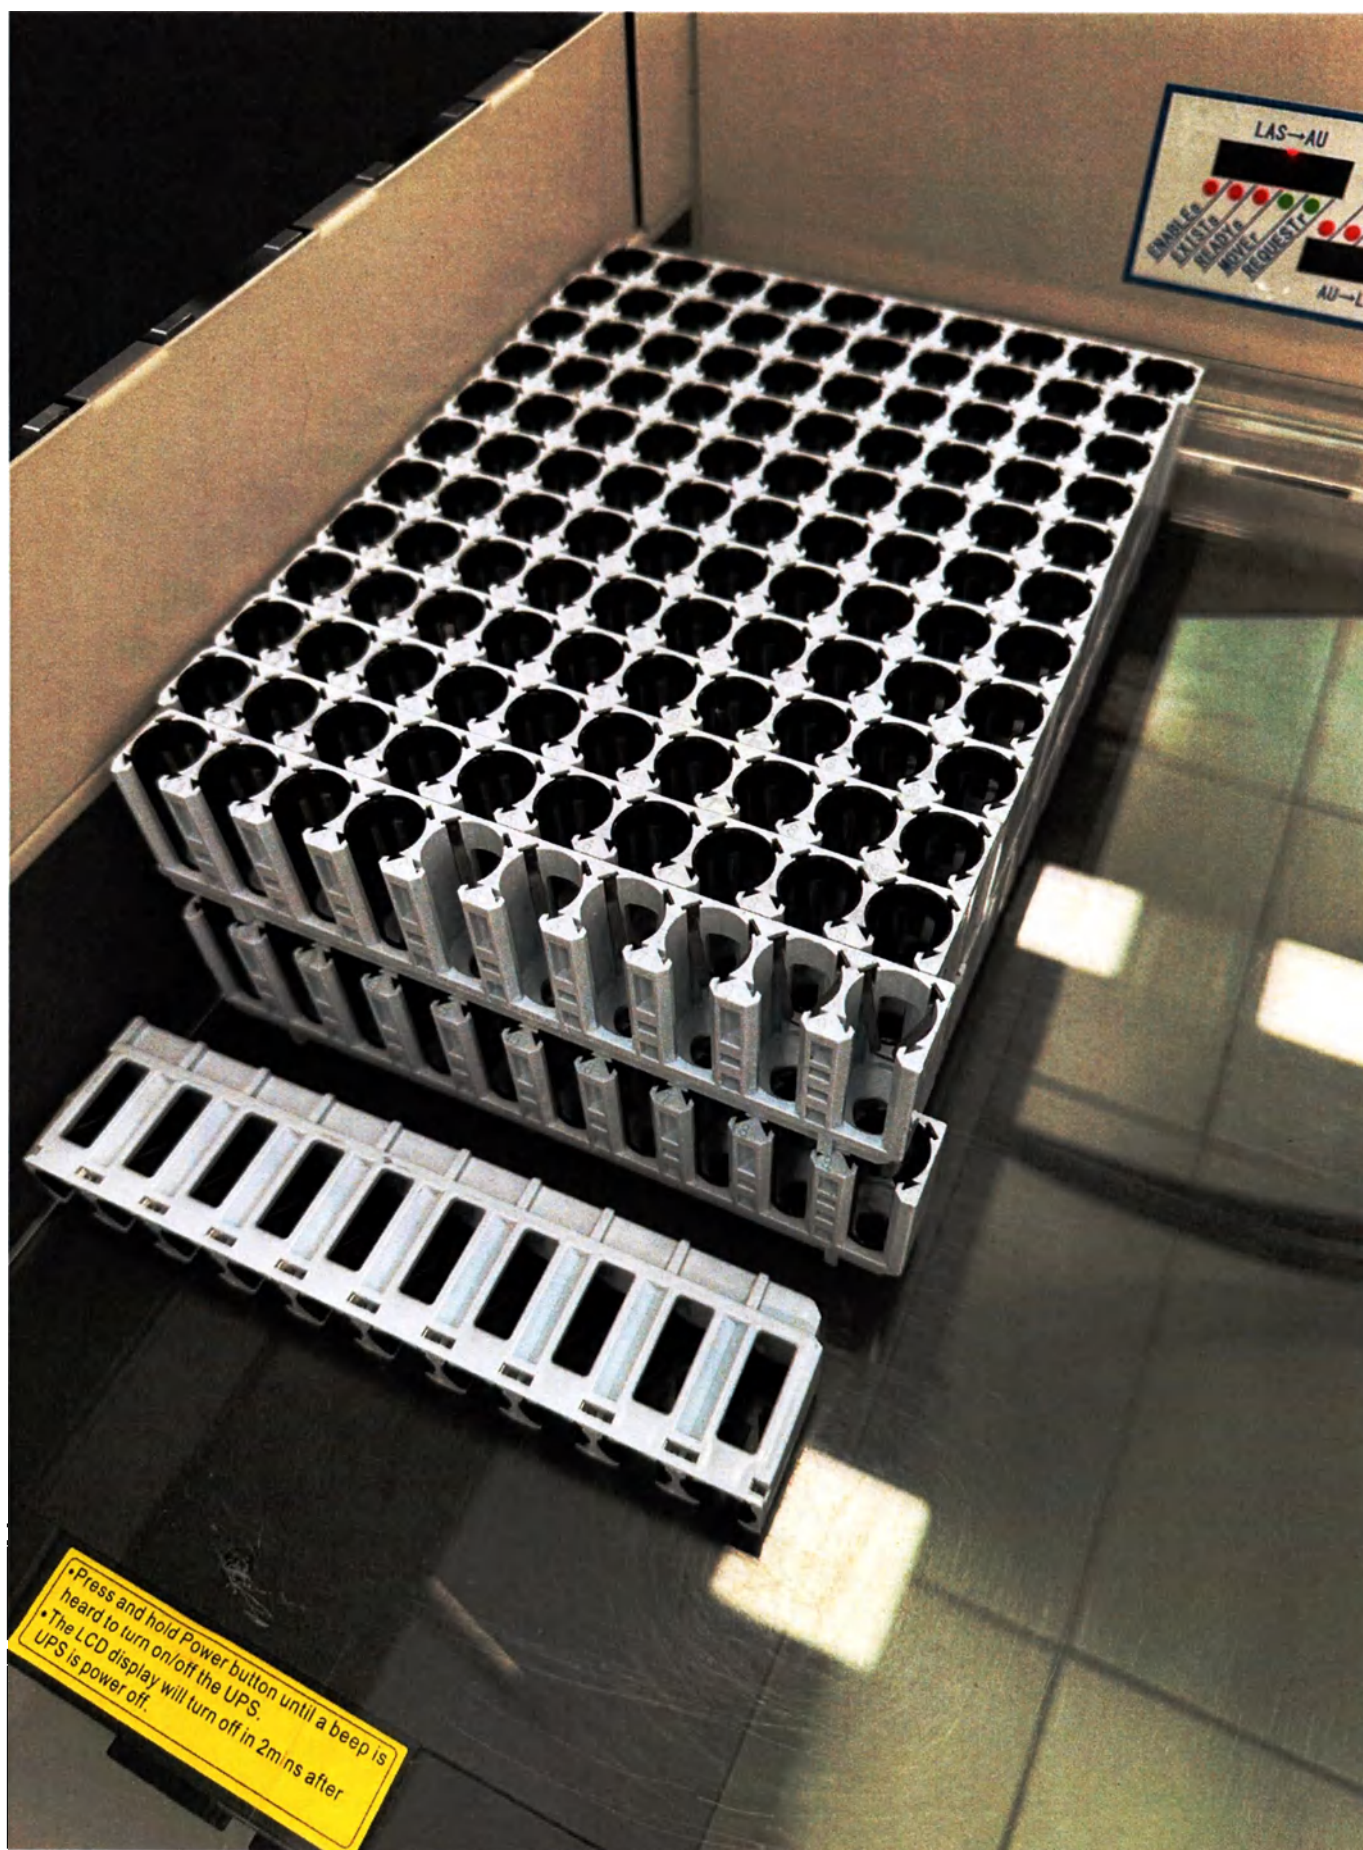


Рисунок 15. Штативы для приборов AU 5800.



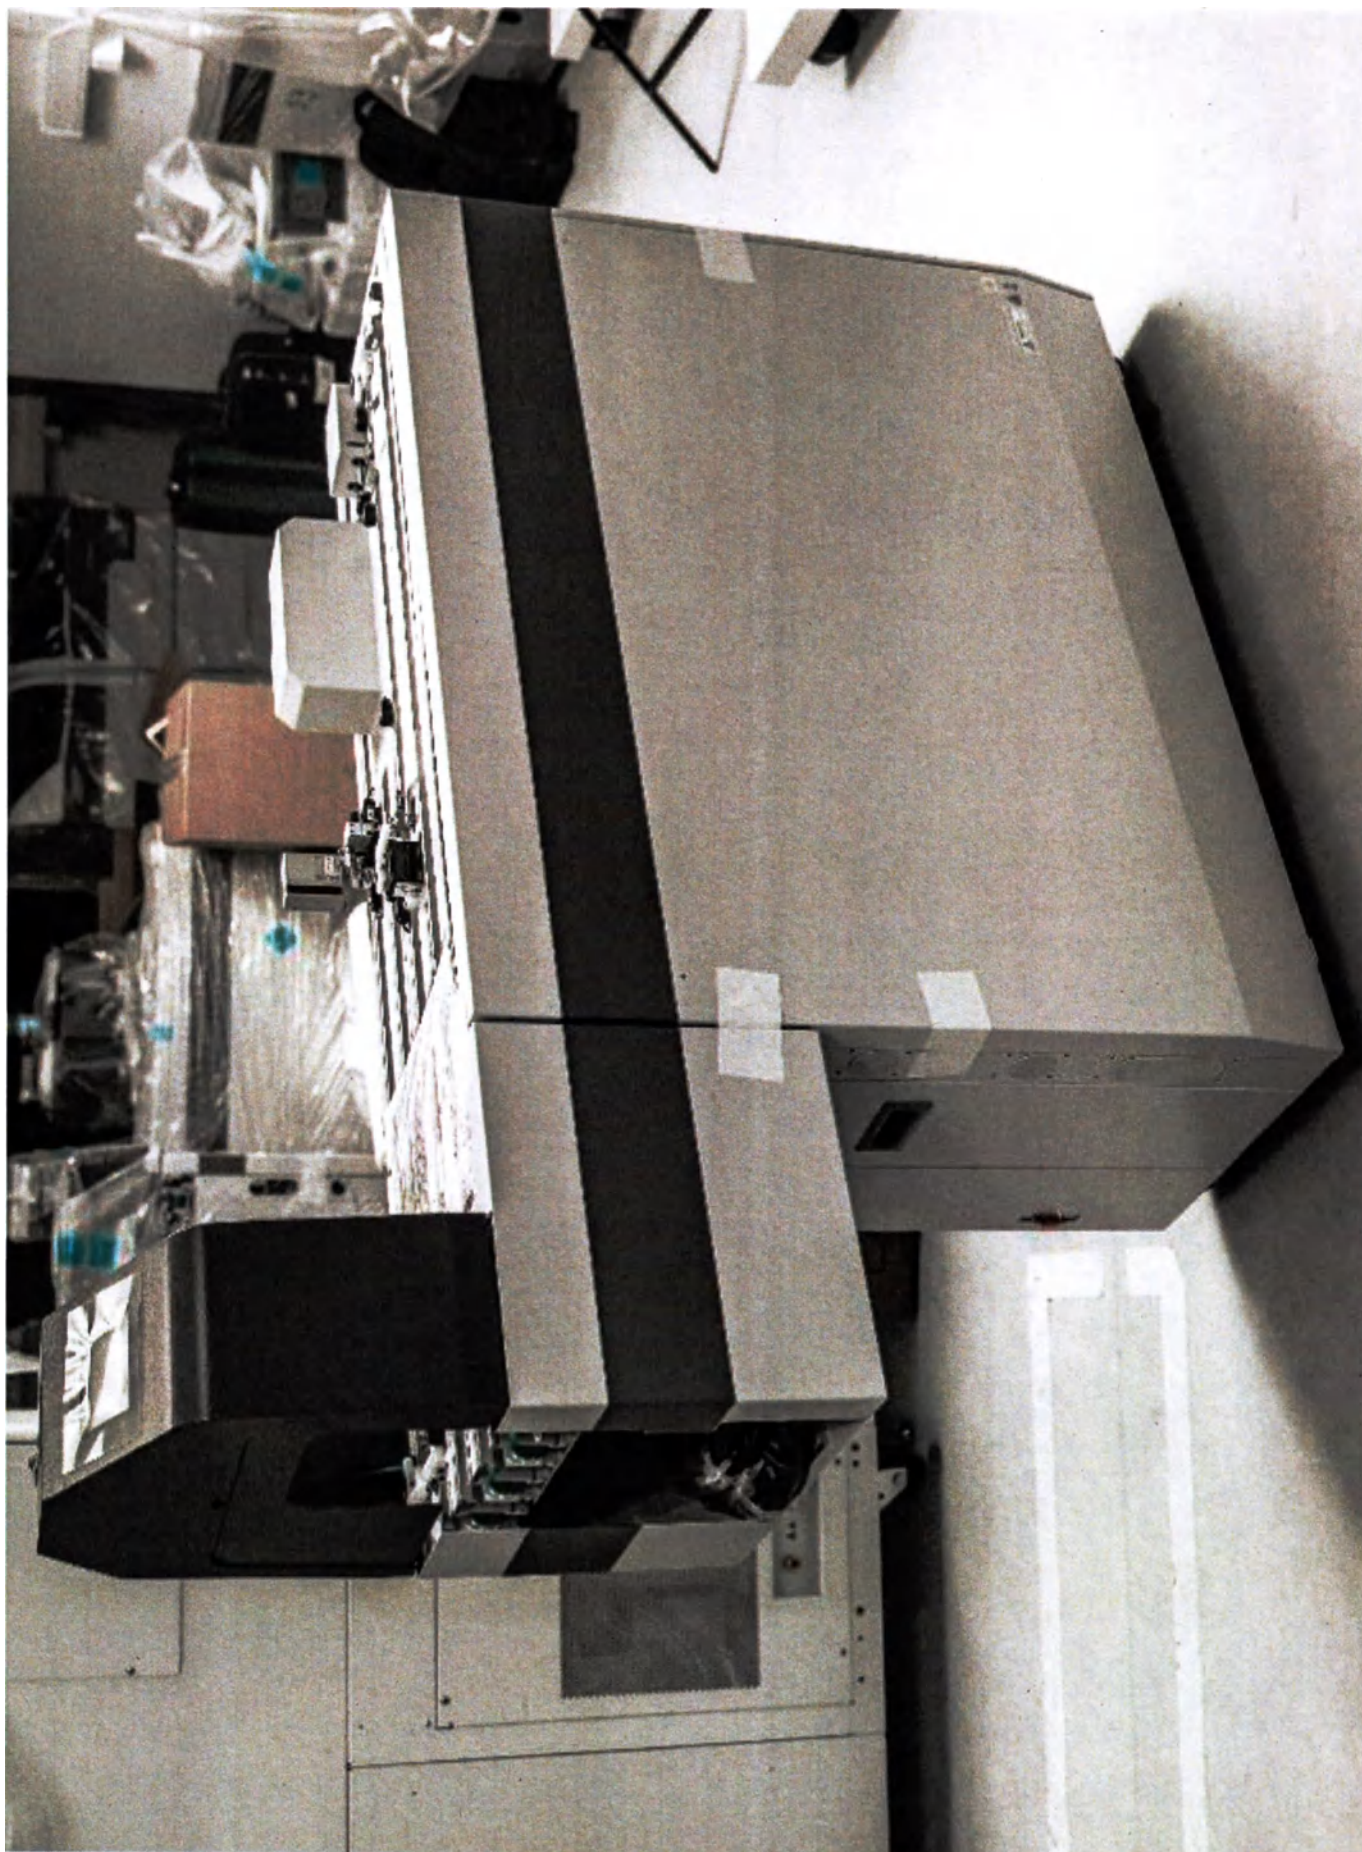


Рисунок 16. Линия для подключения приборов Dxl - Dxl Connection.





Рисунок 17. Линия для подключения приборов AU/DxC - AU/DxC Connection.





**Рисунок 18. Линия для подключения приборов DiaSorin Liaison XL - Liaison XL Connection.**



Stago  
Analyzer

Stago  
Connection Unit



Рисунок 19. Линия для подключения приборов Stago - Stago Connection.





Рисунок 20. Линия для подключения приборов CS Sysmex- CS Connection.





Рисунок 21. Линии I 300 (4-4).





Рисунок 22. Крышки для линии I 300 (4-4).





Рисунок 23. Линии I 600 (4-4).





Рисунок 24. Крышки для линии I 600 (4-4).





Рисунок 25. Линии I 900 (4-4).





Рисунок 26. Крышки для линии I 900 (4-4).



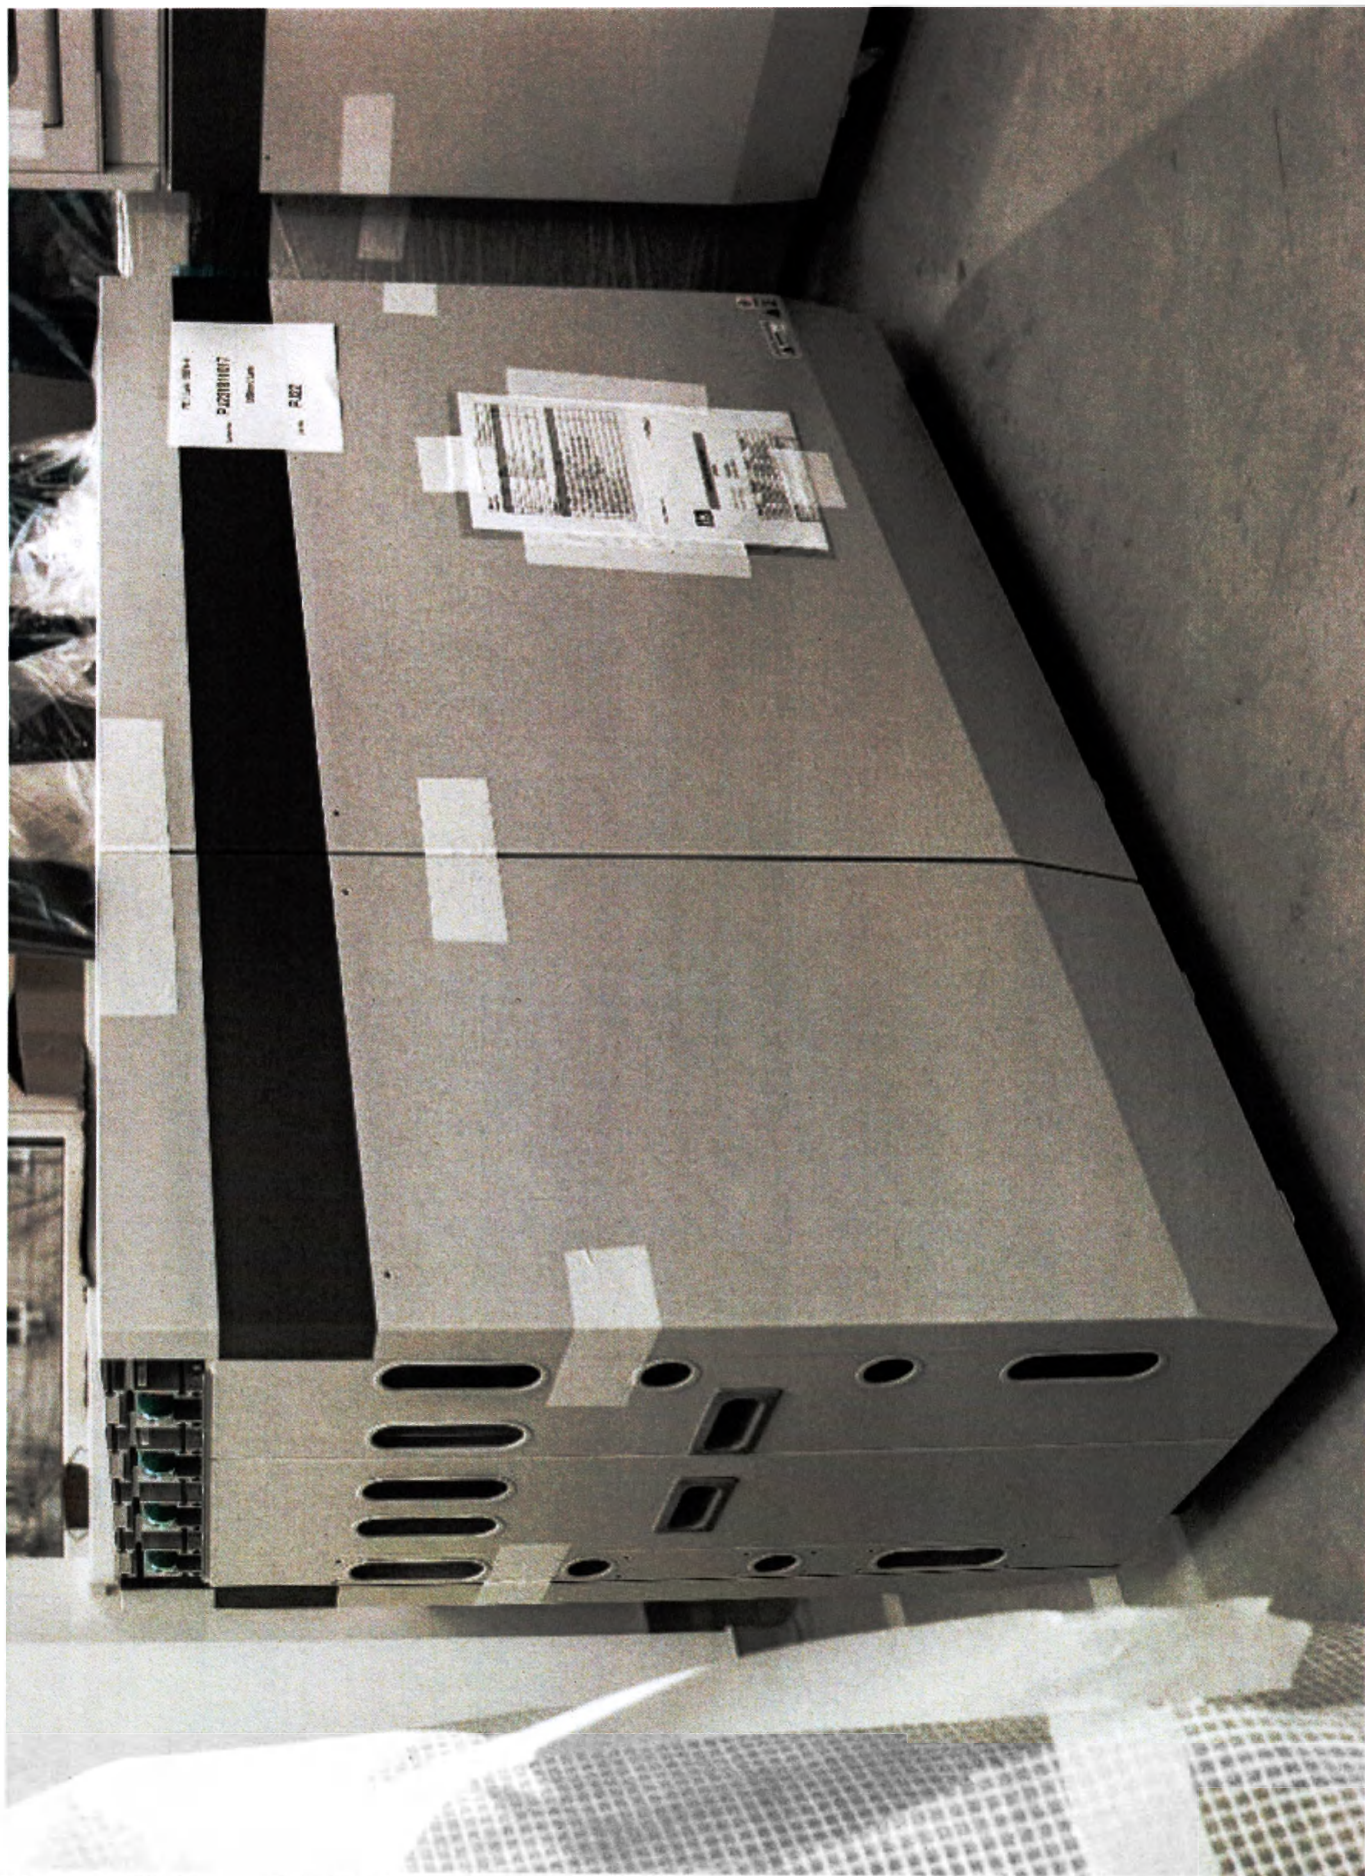


Рисунок 27. Линии I 1200 (4-4).



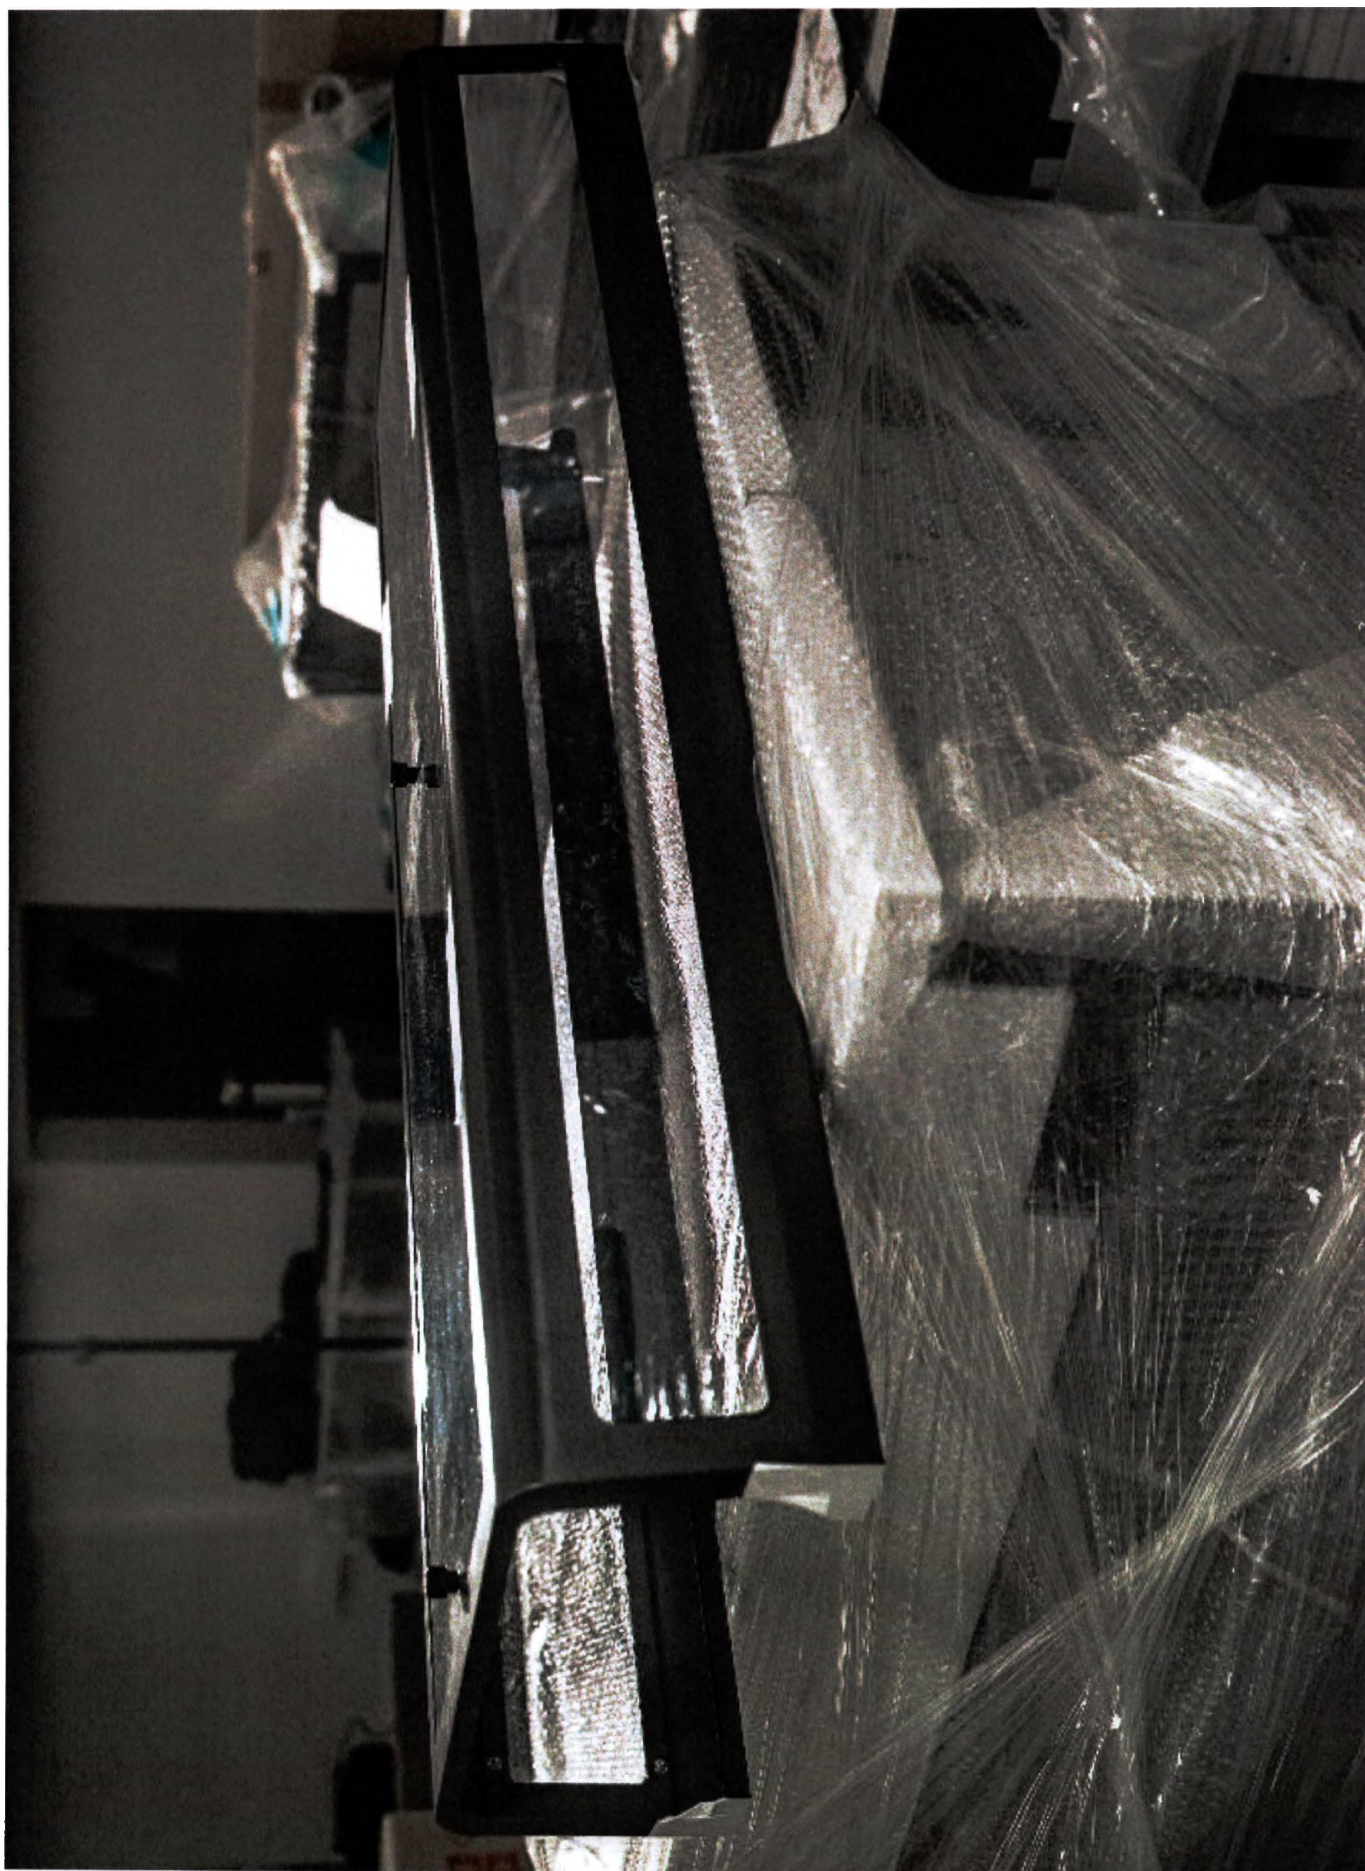


Рисунок 28. Крышки для линии I 1200 (4-4).



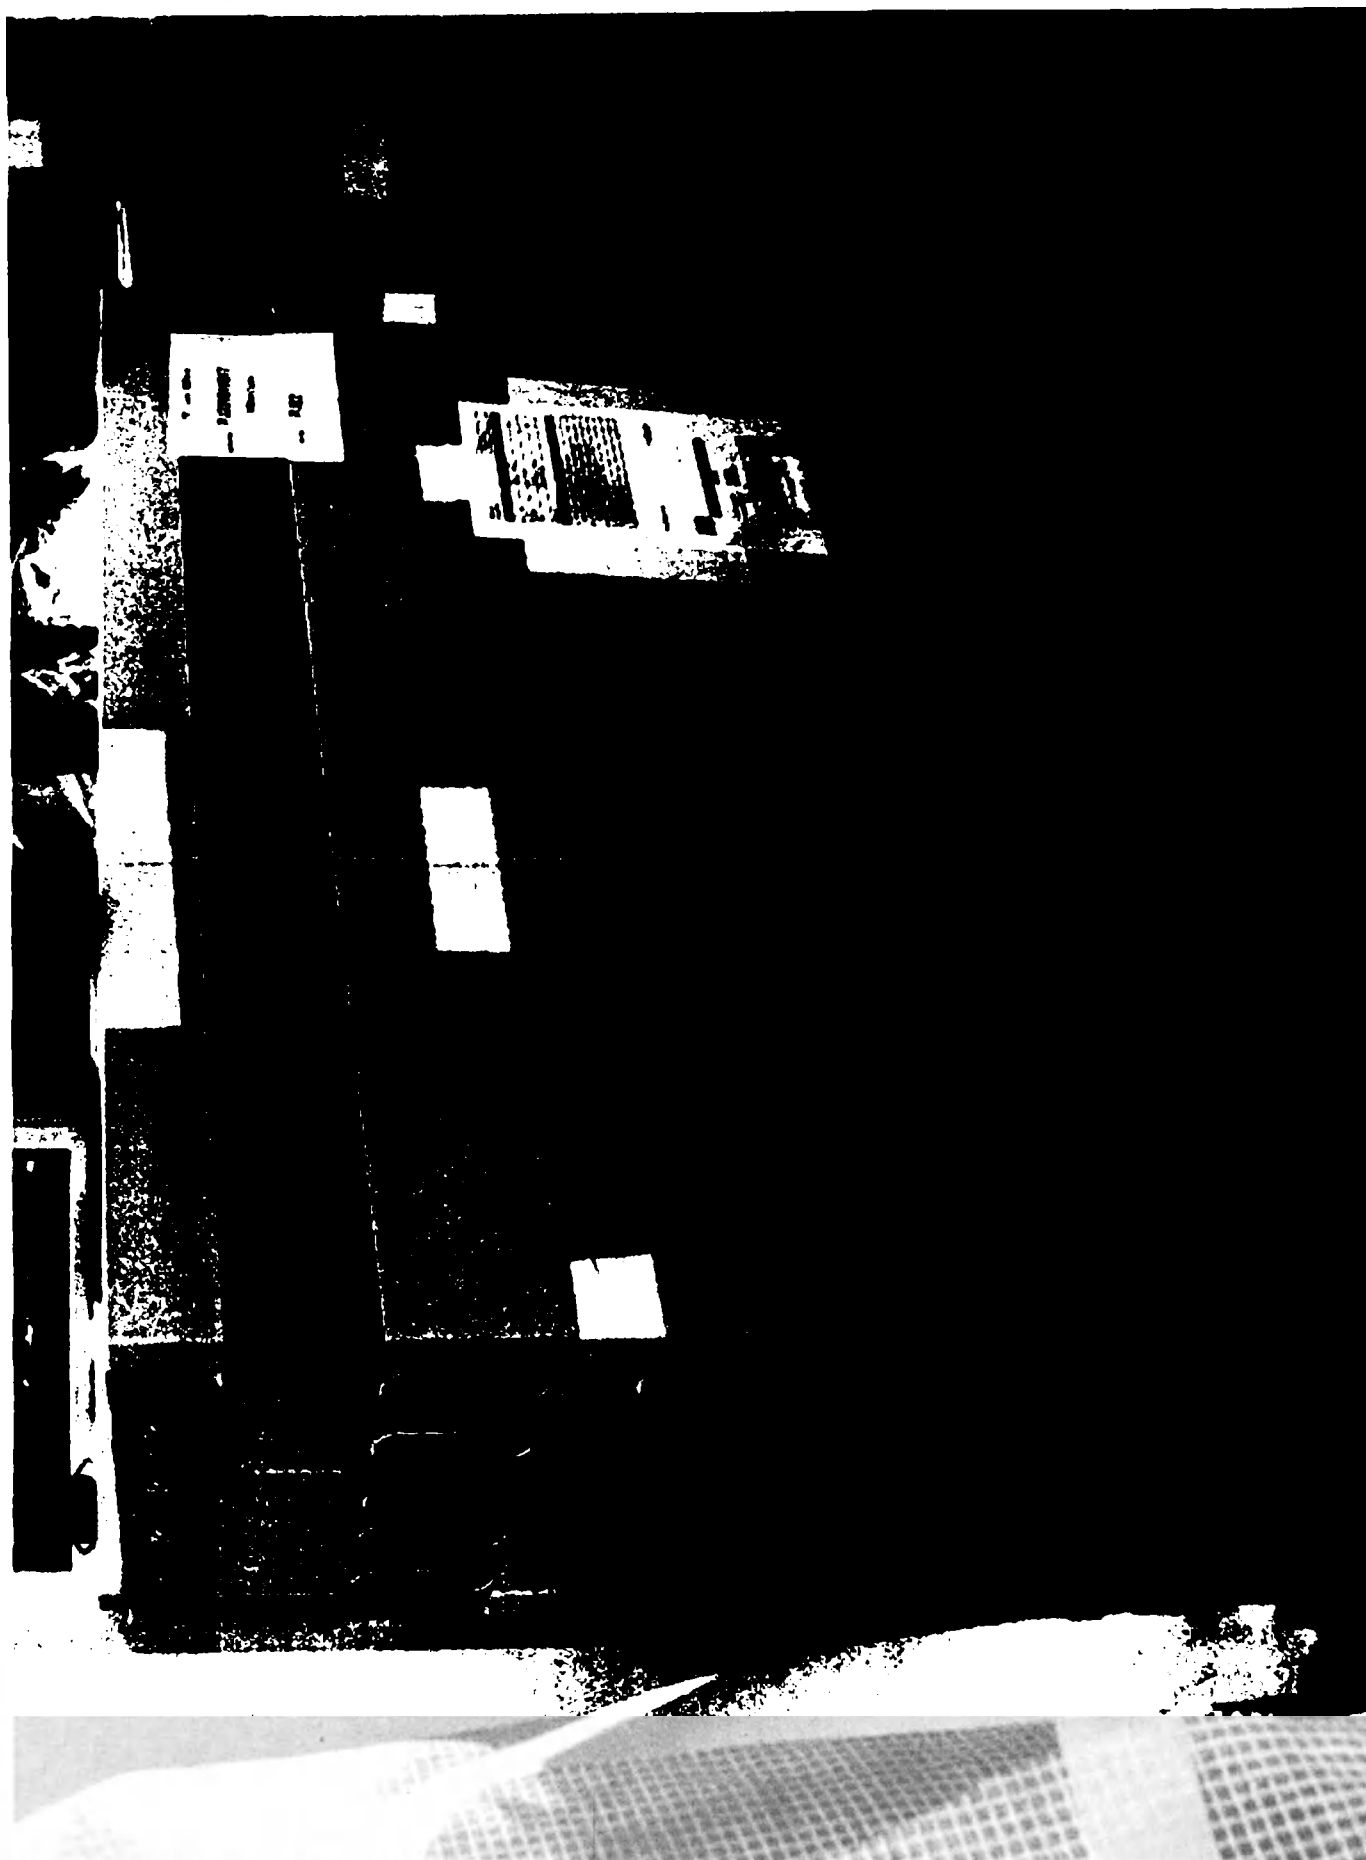


Рисунок 29. Линии I 1200 (4-4), без пьедестала.





Рисунок 30. Крышки для линии I 1200 (4-4), без пьедестала.



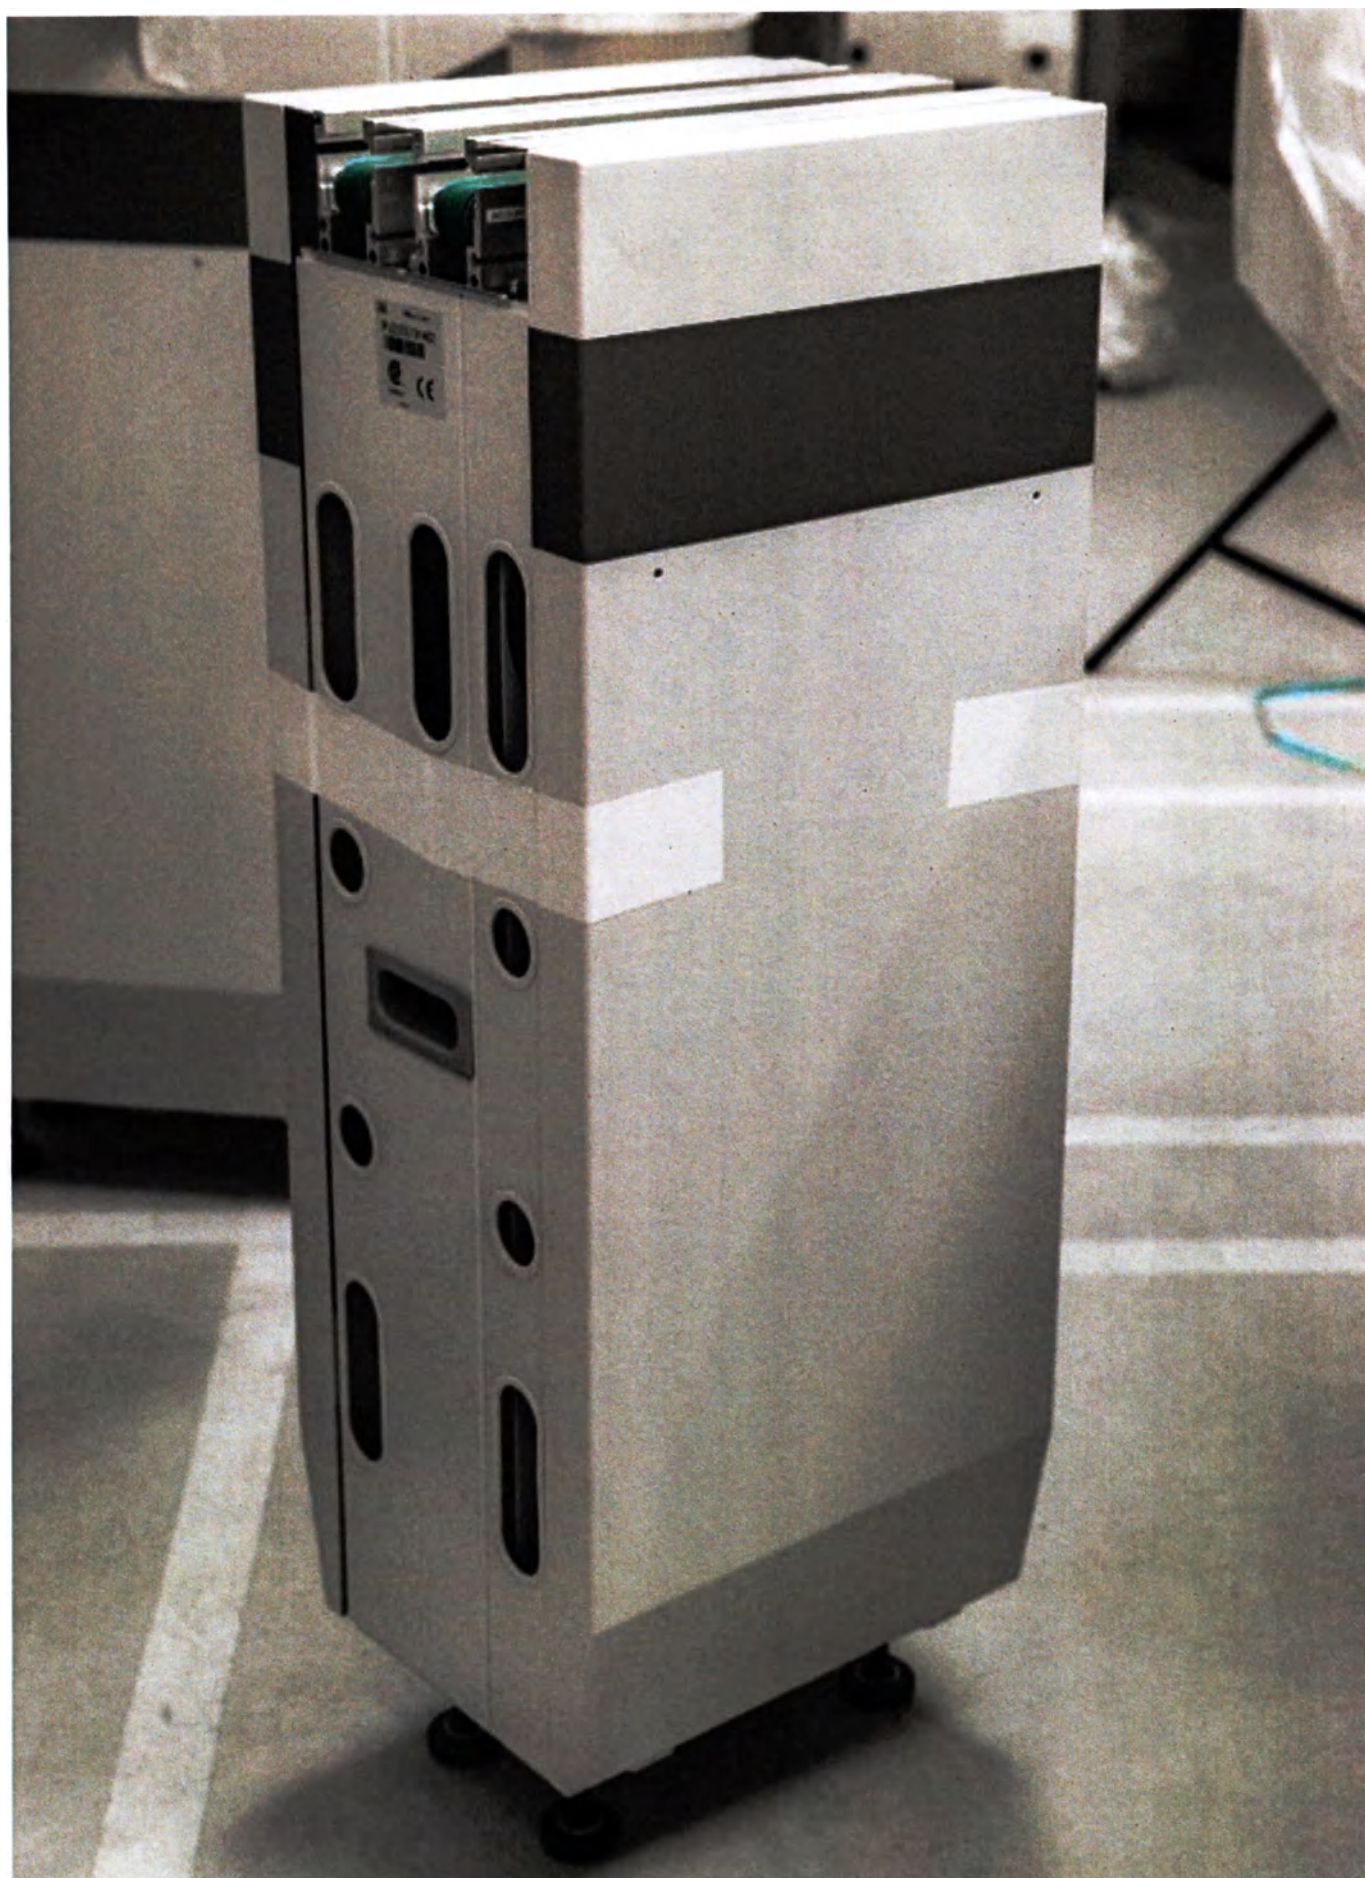


Рисунок 31. Линии I 300 (2-2).





Рисунок 32. Крышки для линии I 300 (2-2).



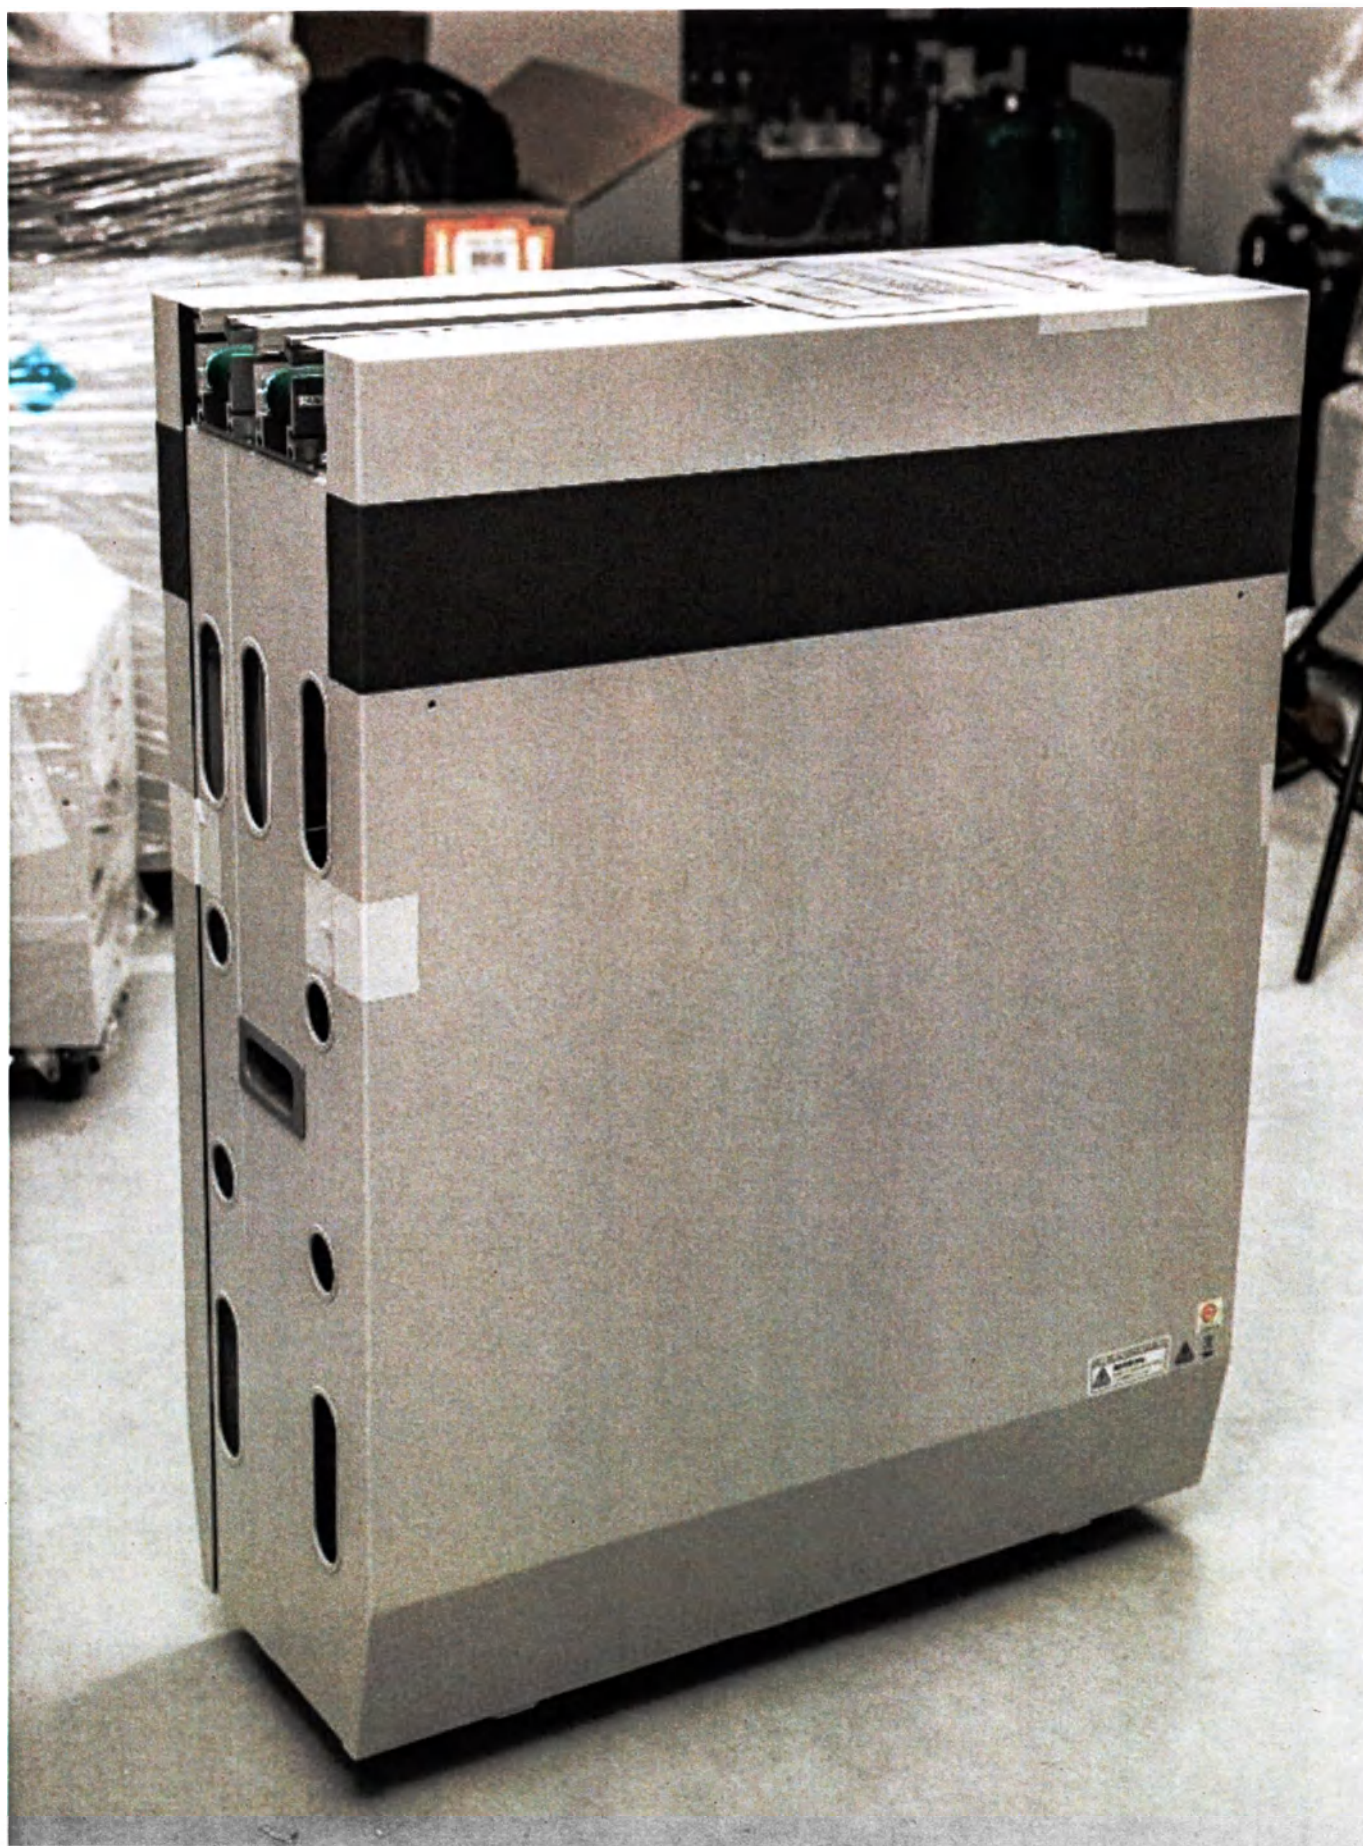


Рисунок 33. Линии I 600 (2-2).





Рисунок 34. Крышки для линии I 600 (2-2).



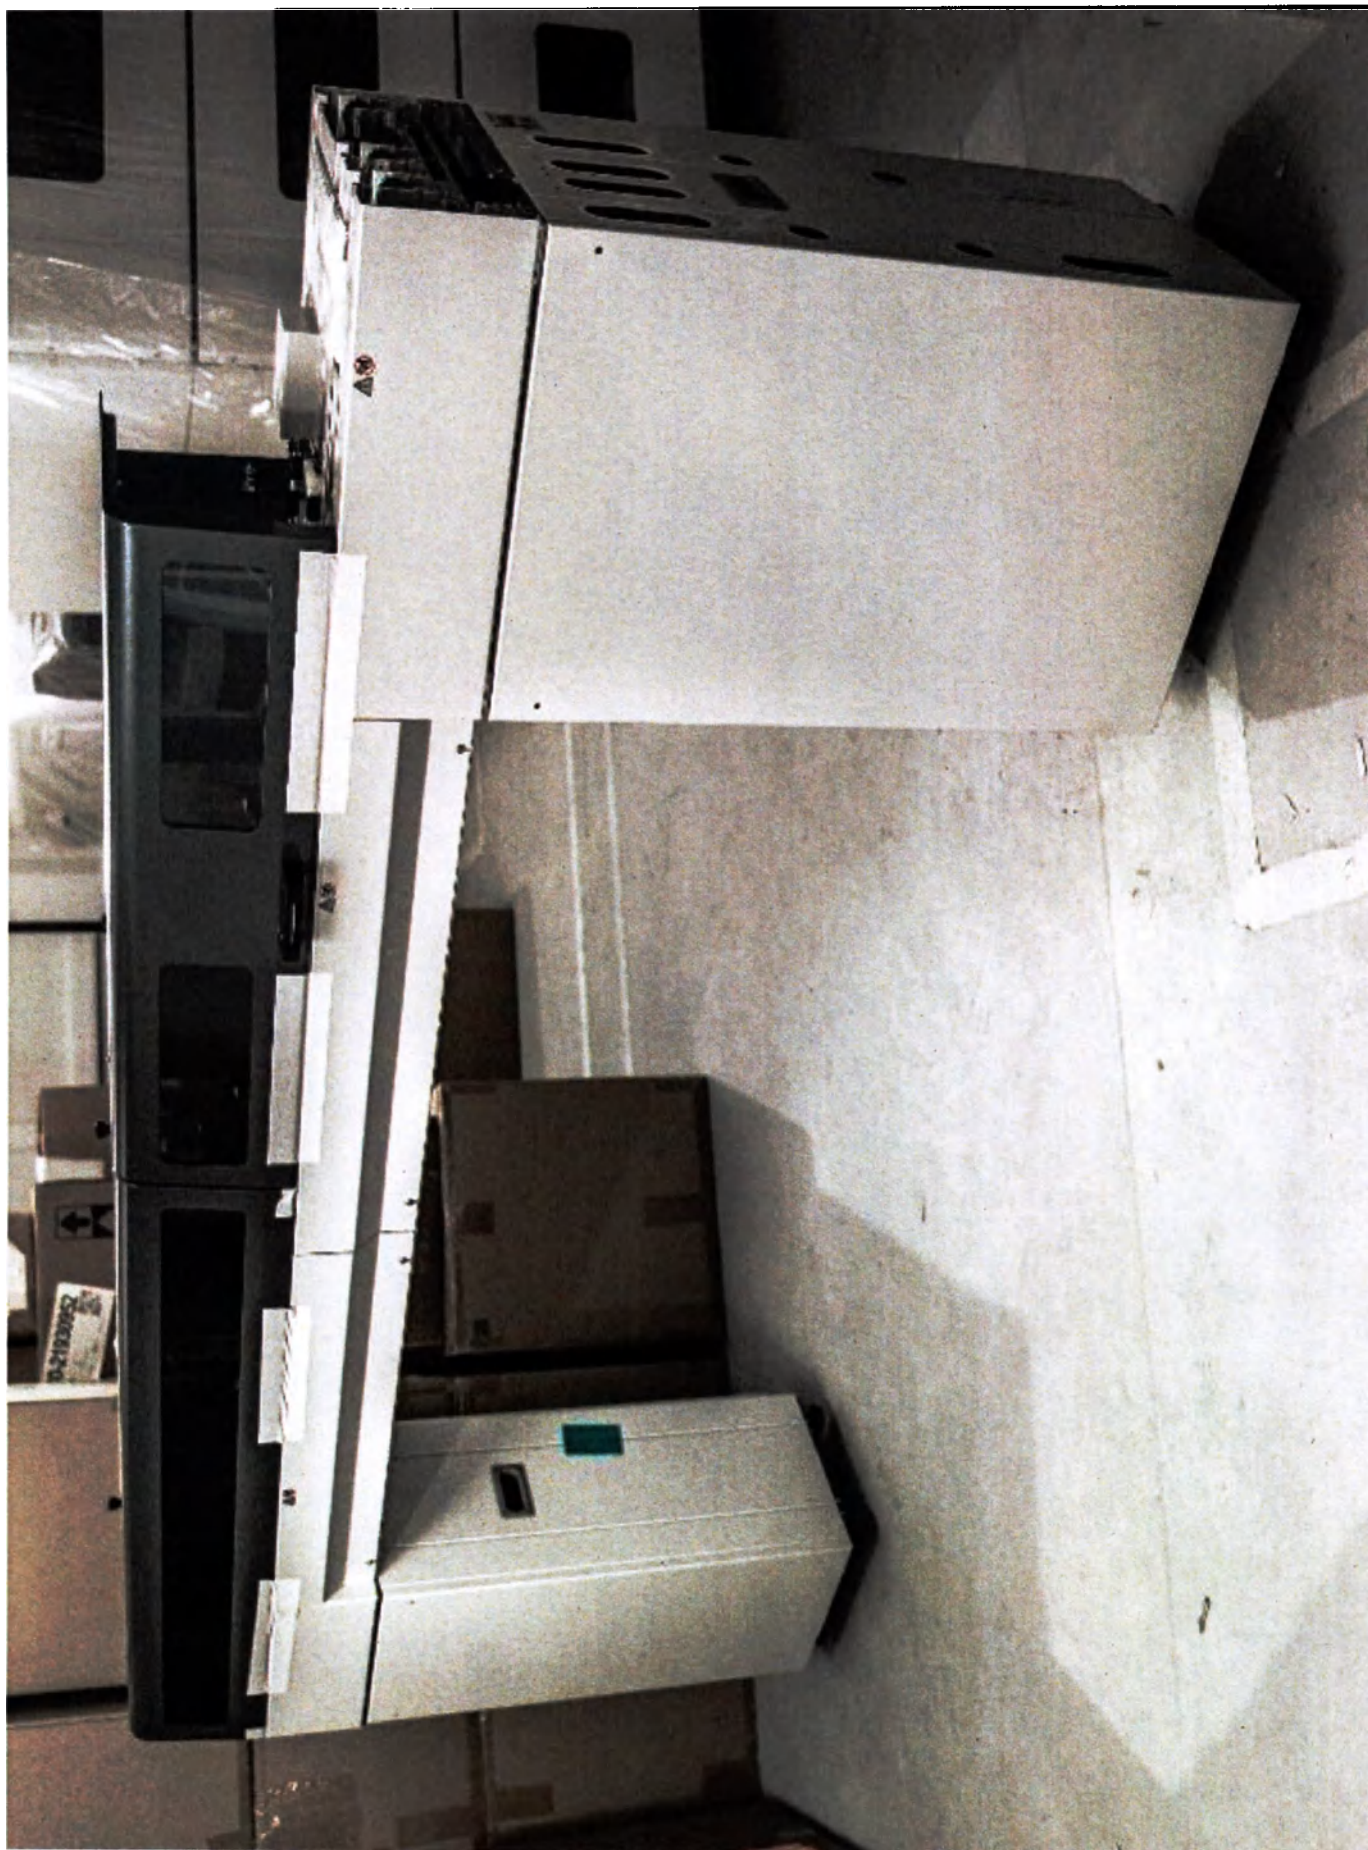


Рисунок 35. Линии I 900 (2-2).





Рисунок 36. Крышки для линии I 900 (2-2).





Рисунок 37. Линия I 1200 (2-2).





Рисунок 38. Крышки для линии I 1200 (2-2).





Рисунок 39. Линии U для динамического модуля загрузки (при необходимости).



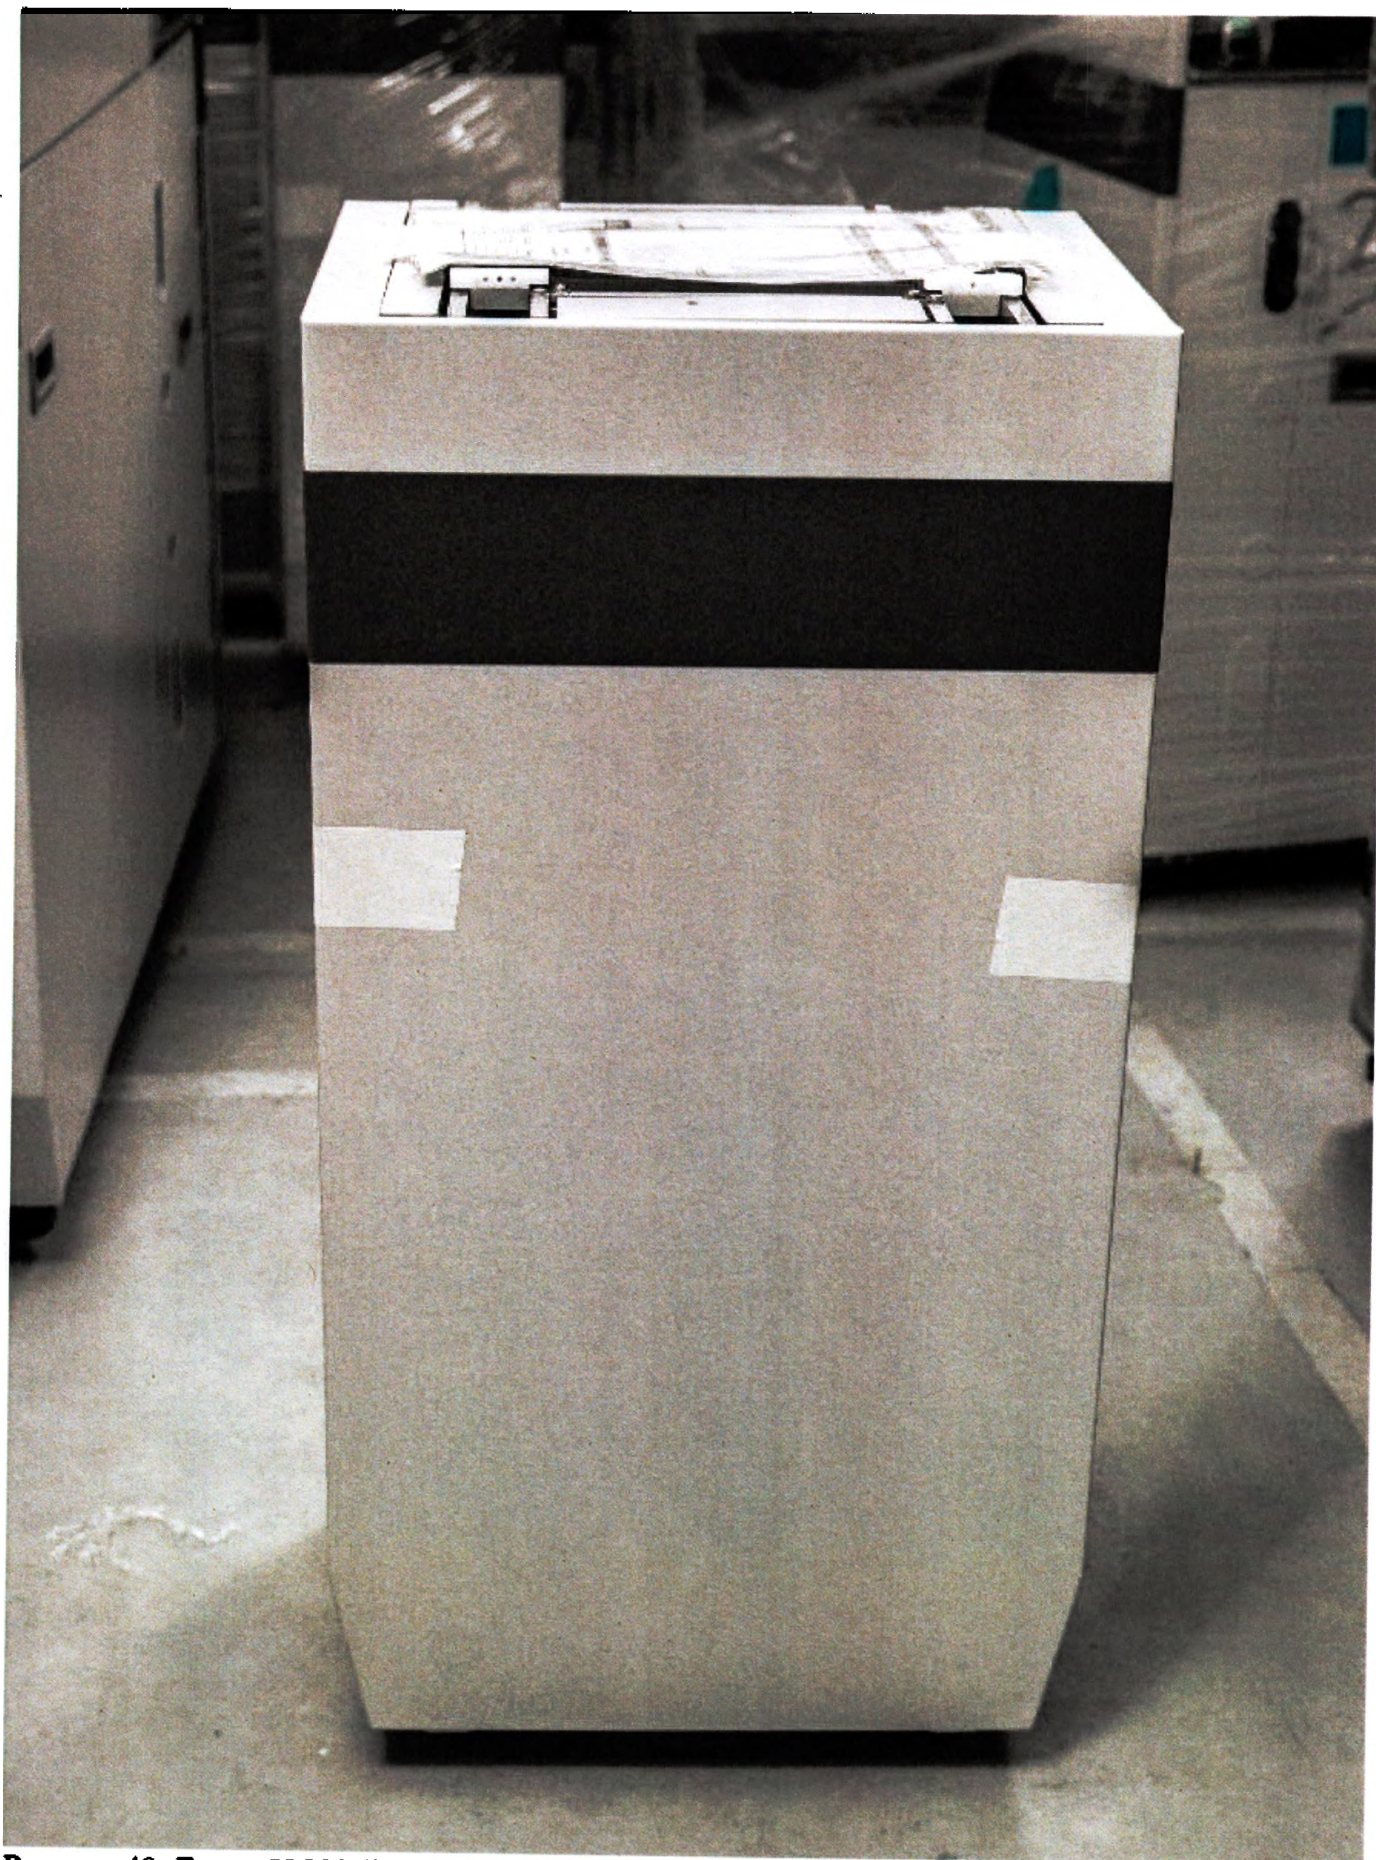


Рисунок 40. Линии U 300 (2-4).





Рисунок 41. Крышки для линии U 300 (2-4).



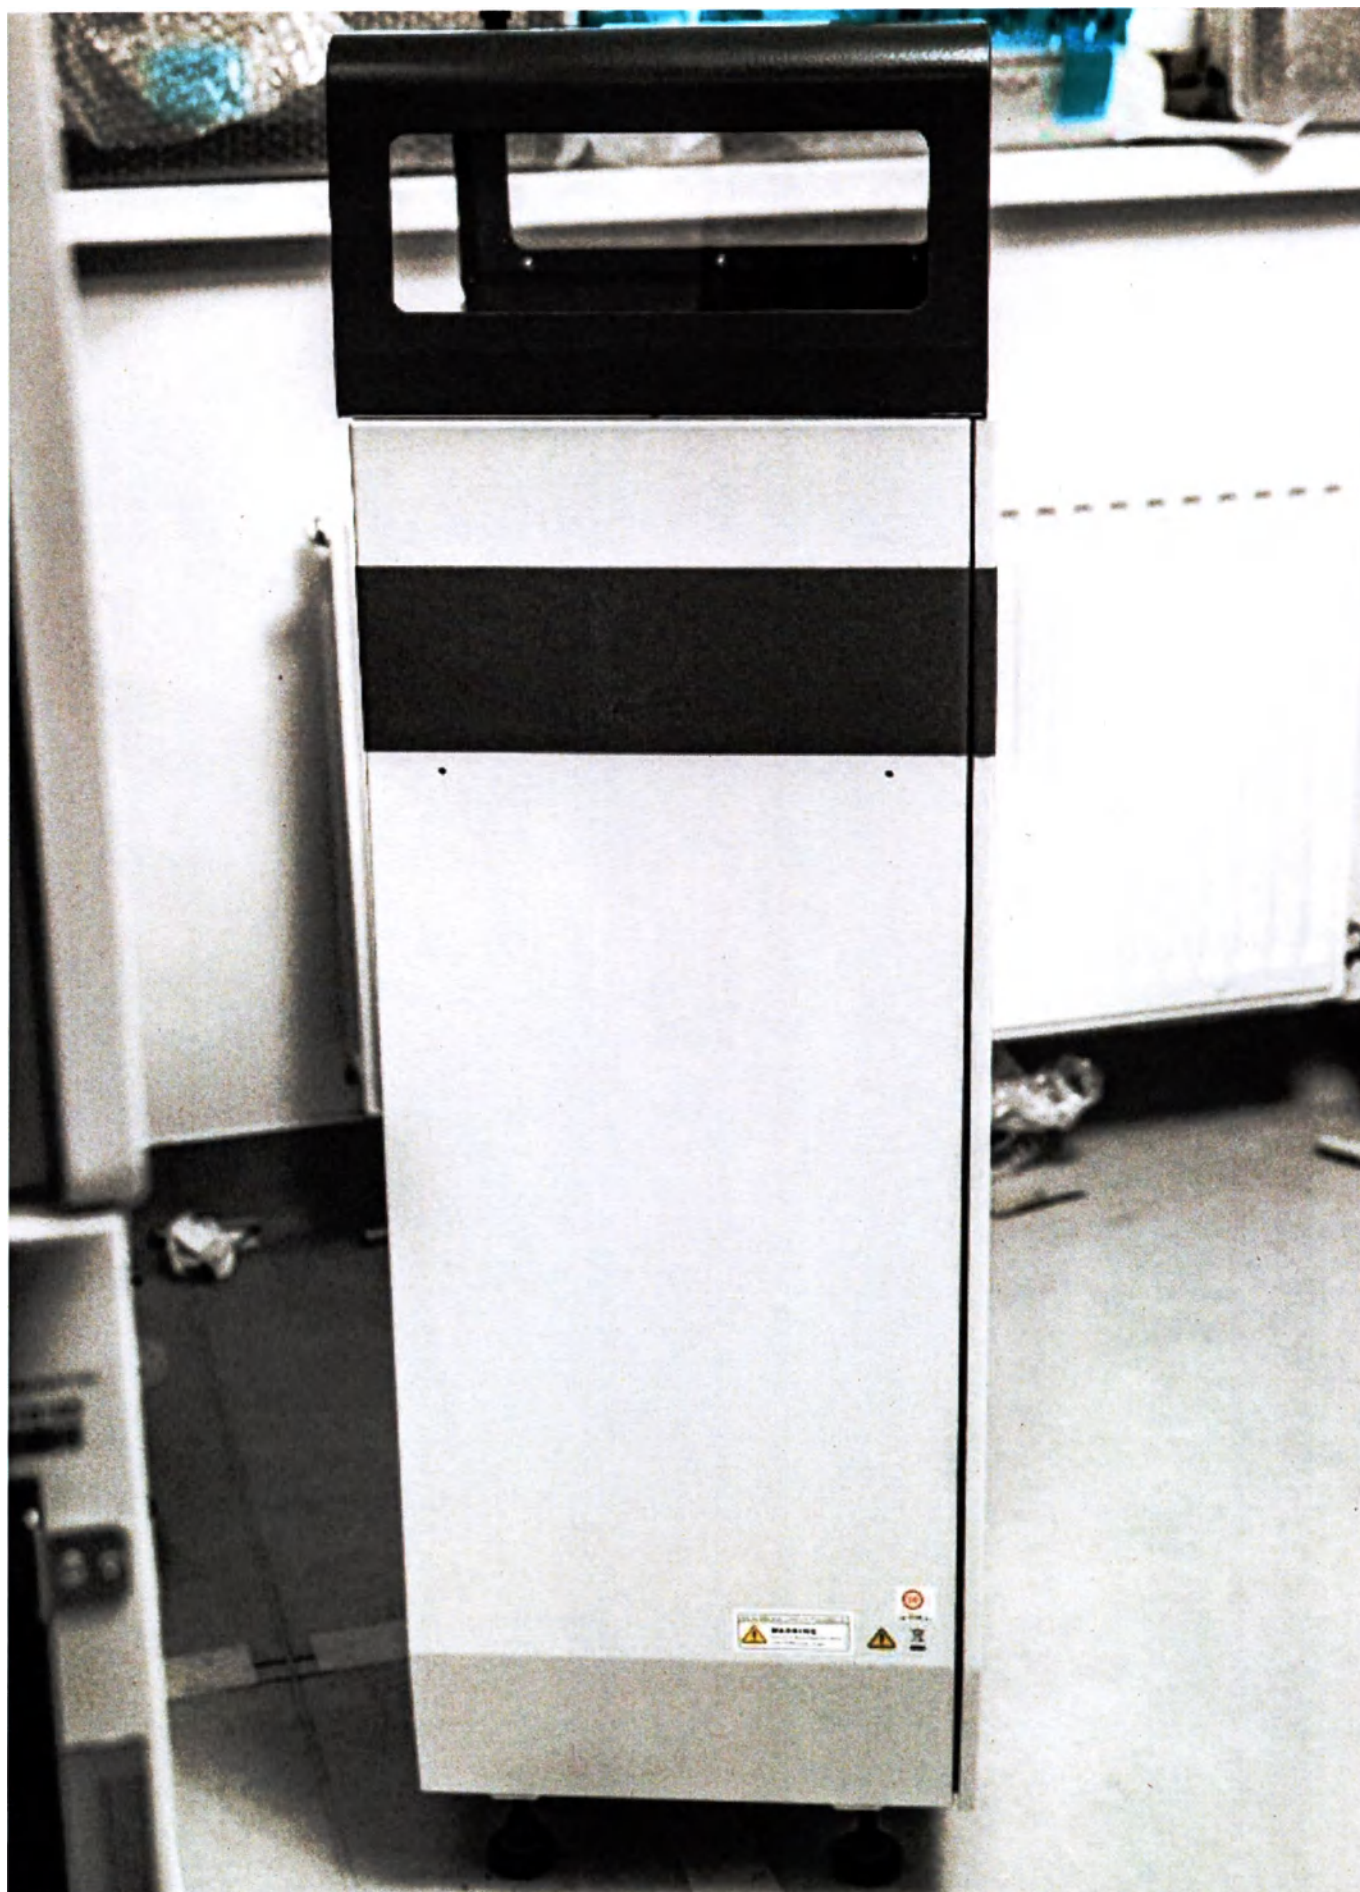


Рисунок 42. Линии поворотные U 300 (3-4).





Рисунок 43. Крышки для линии U 300 (3-4).





**Рисунок 44. Линии U 400 (2-2).**





Рисунок 45. Крышки для линии U 400 (2-2).



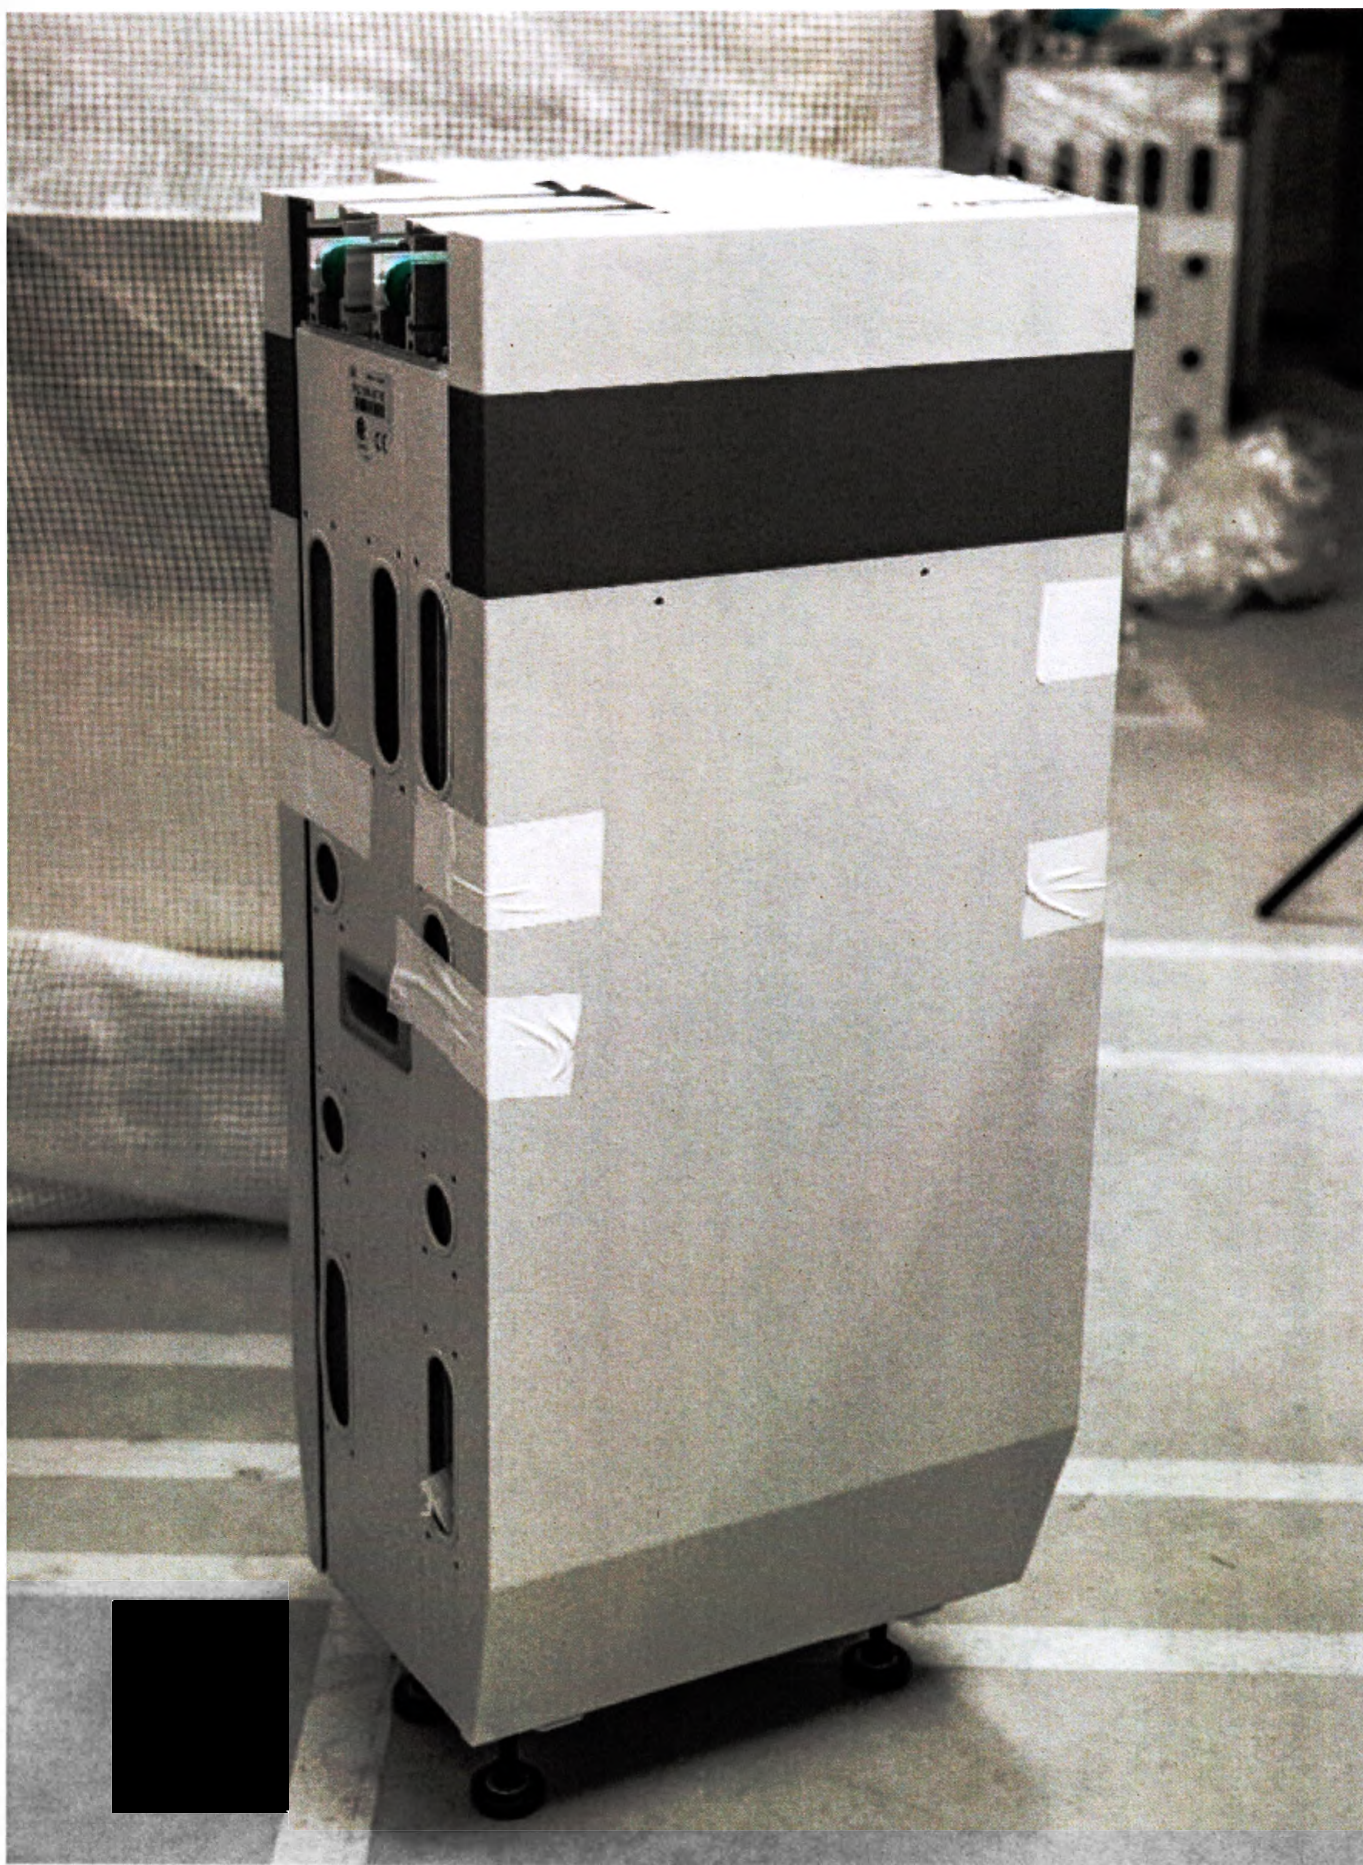


Рисунок 46. Линии L 300 (2-2), Линии L 600 (4-4), Линии L (2-4).





Рисунок 47. Крышки для линии L 300 (2-2), Крышки для линии L 600 (4-4), Крышки для линии L (2-4).



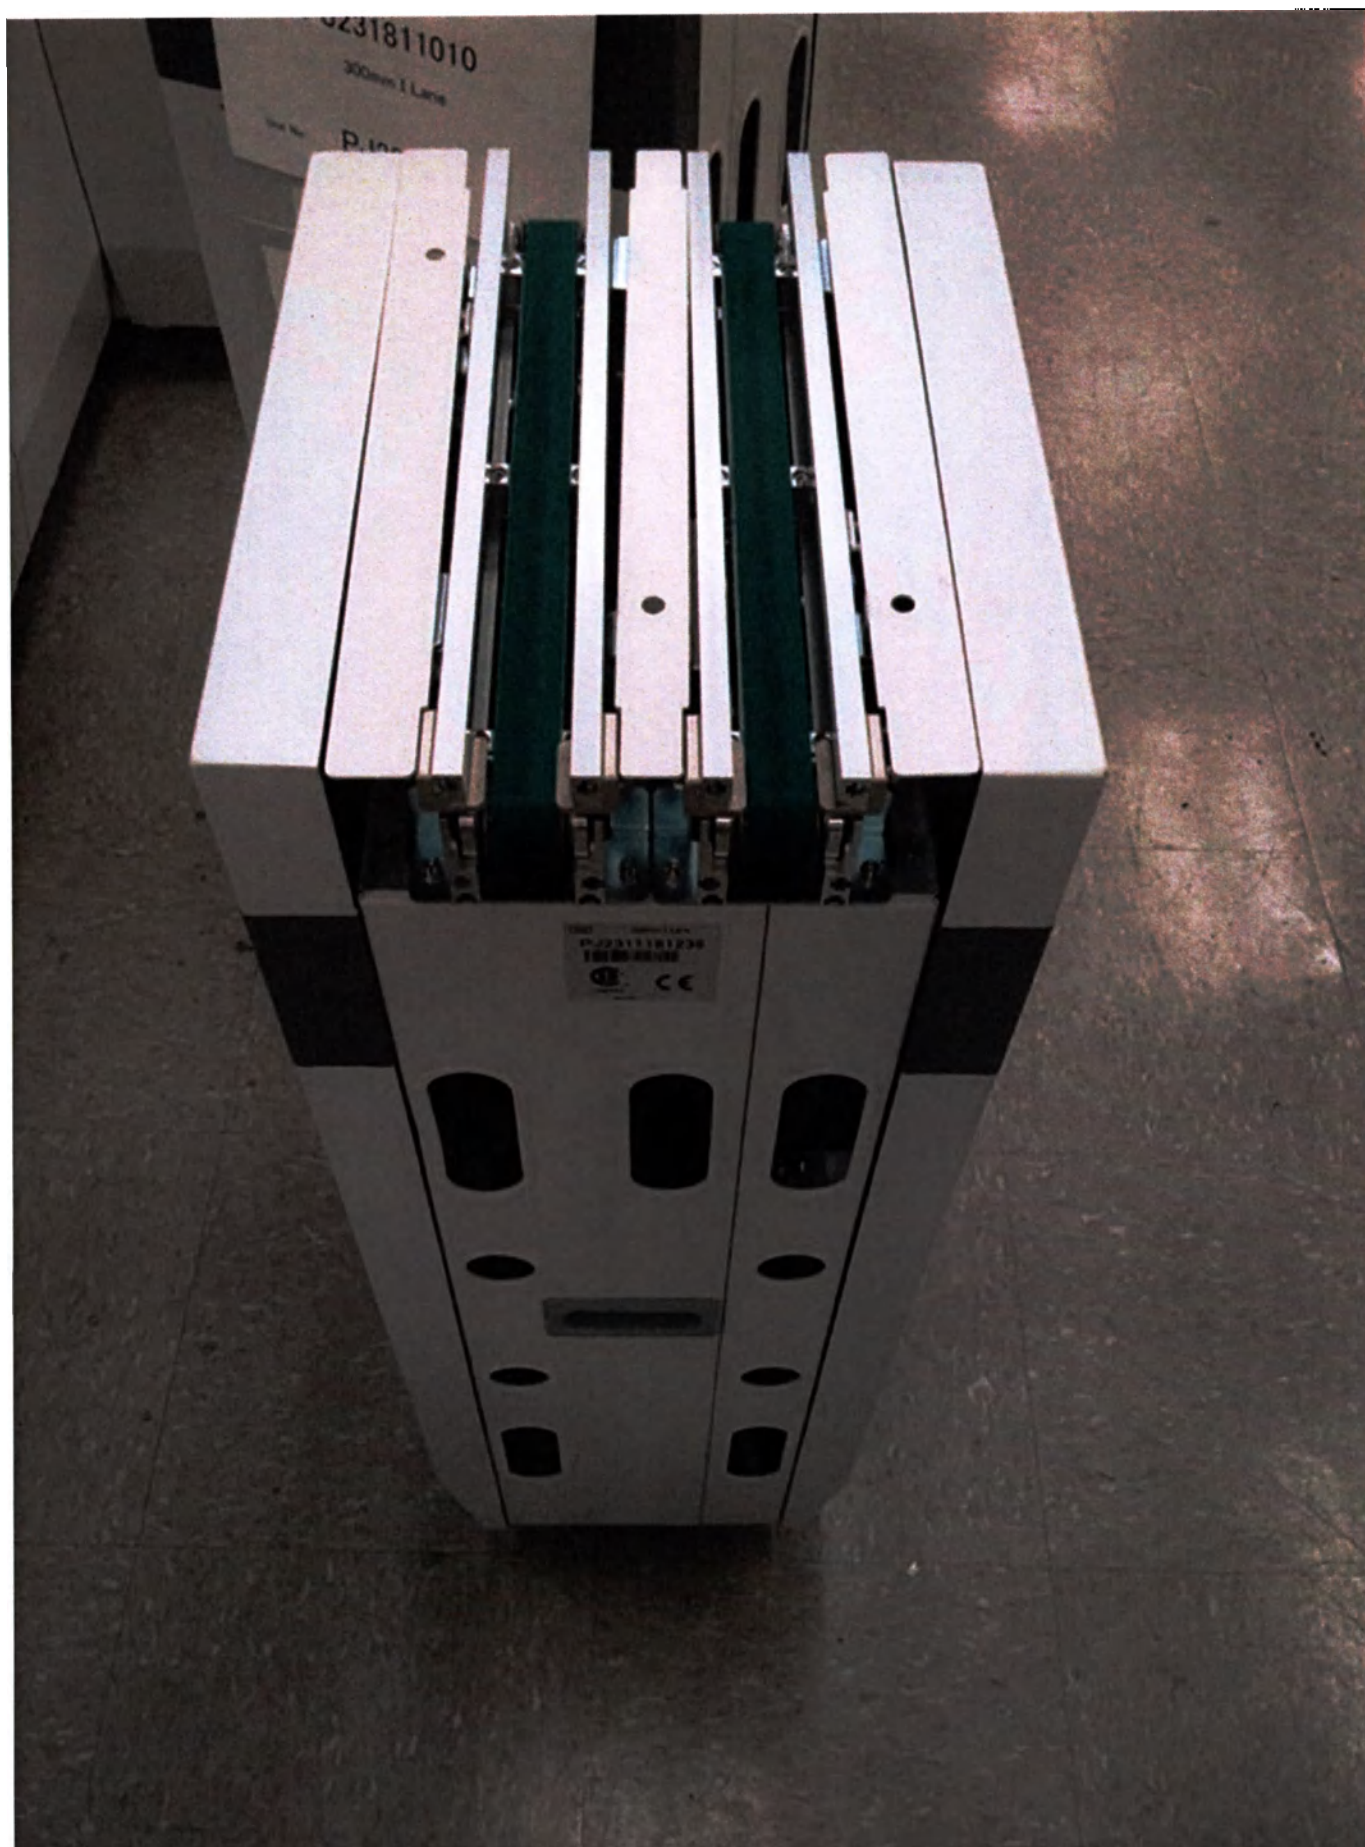


Рисунок 48. Линии переходные (2-4).





Рисунок 49. Крышки для линии переходной (2-4).





Рисунок 50. Крышка для линии Т 600 (4-4).





**Рисунок 51. Линии Т 1, Линии Т 2.**



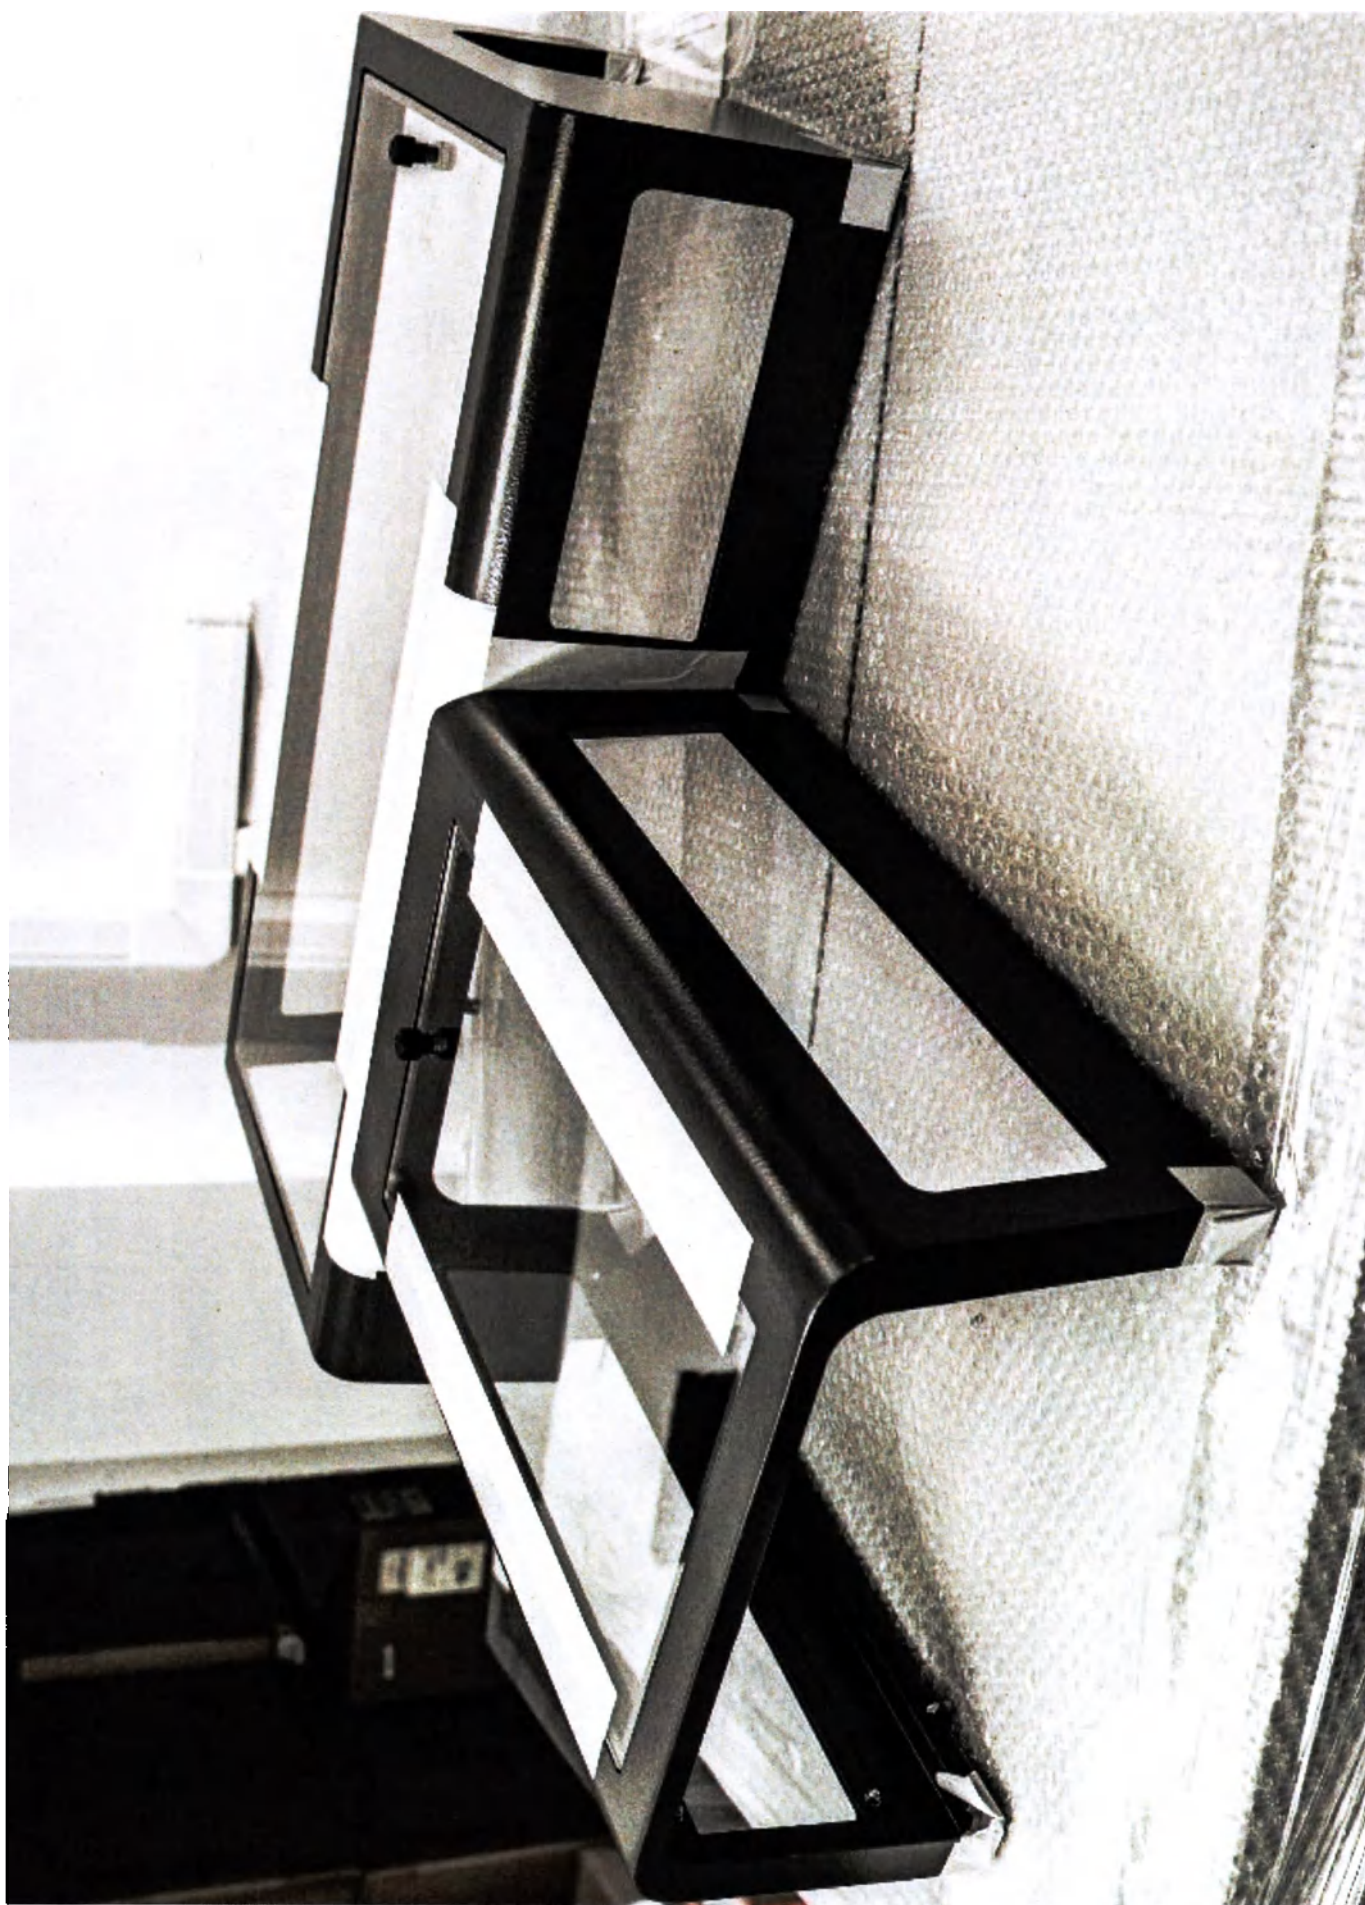


Рисунок 52. Крышки для линии Т 1, Крышки для линии Т 2.



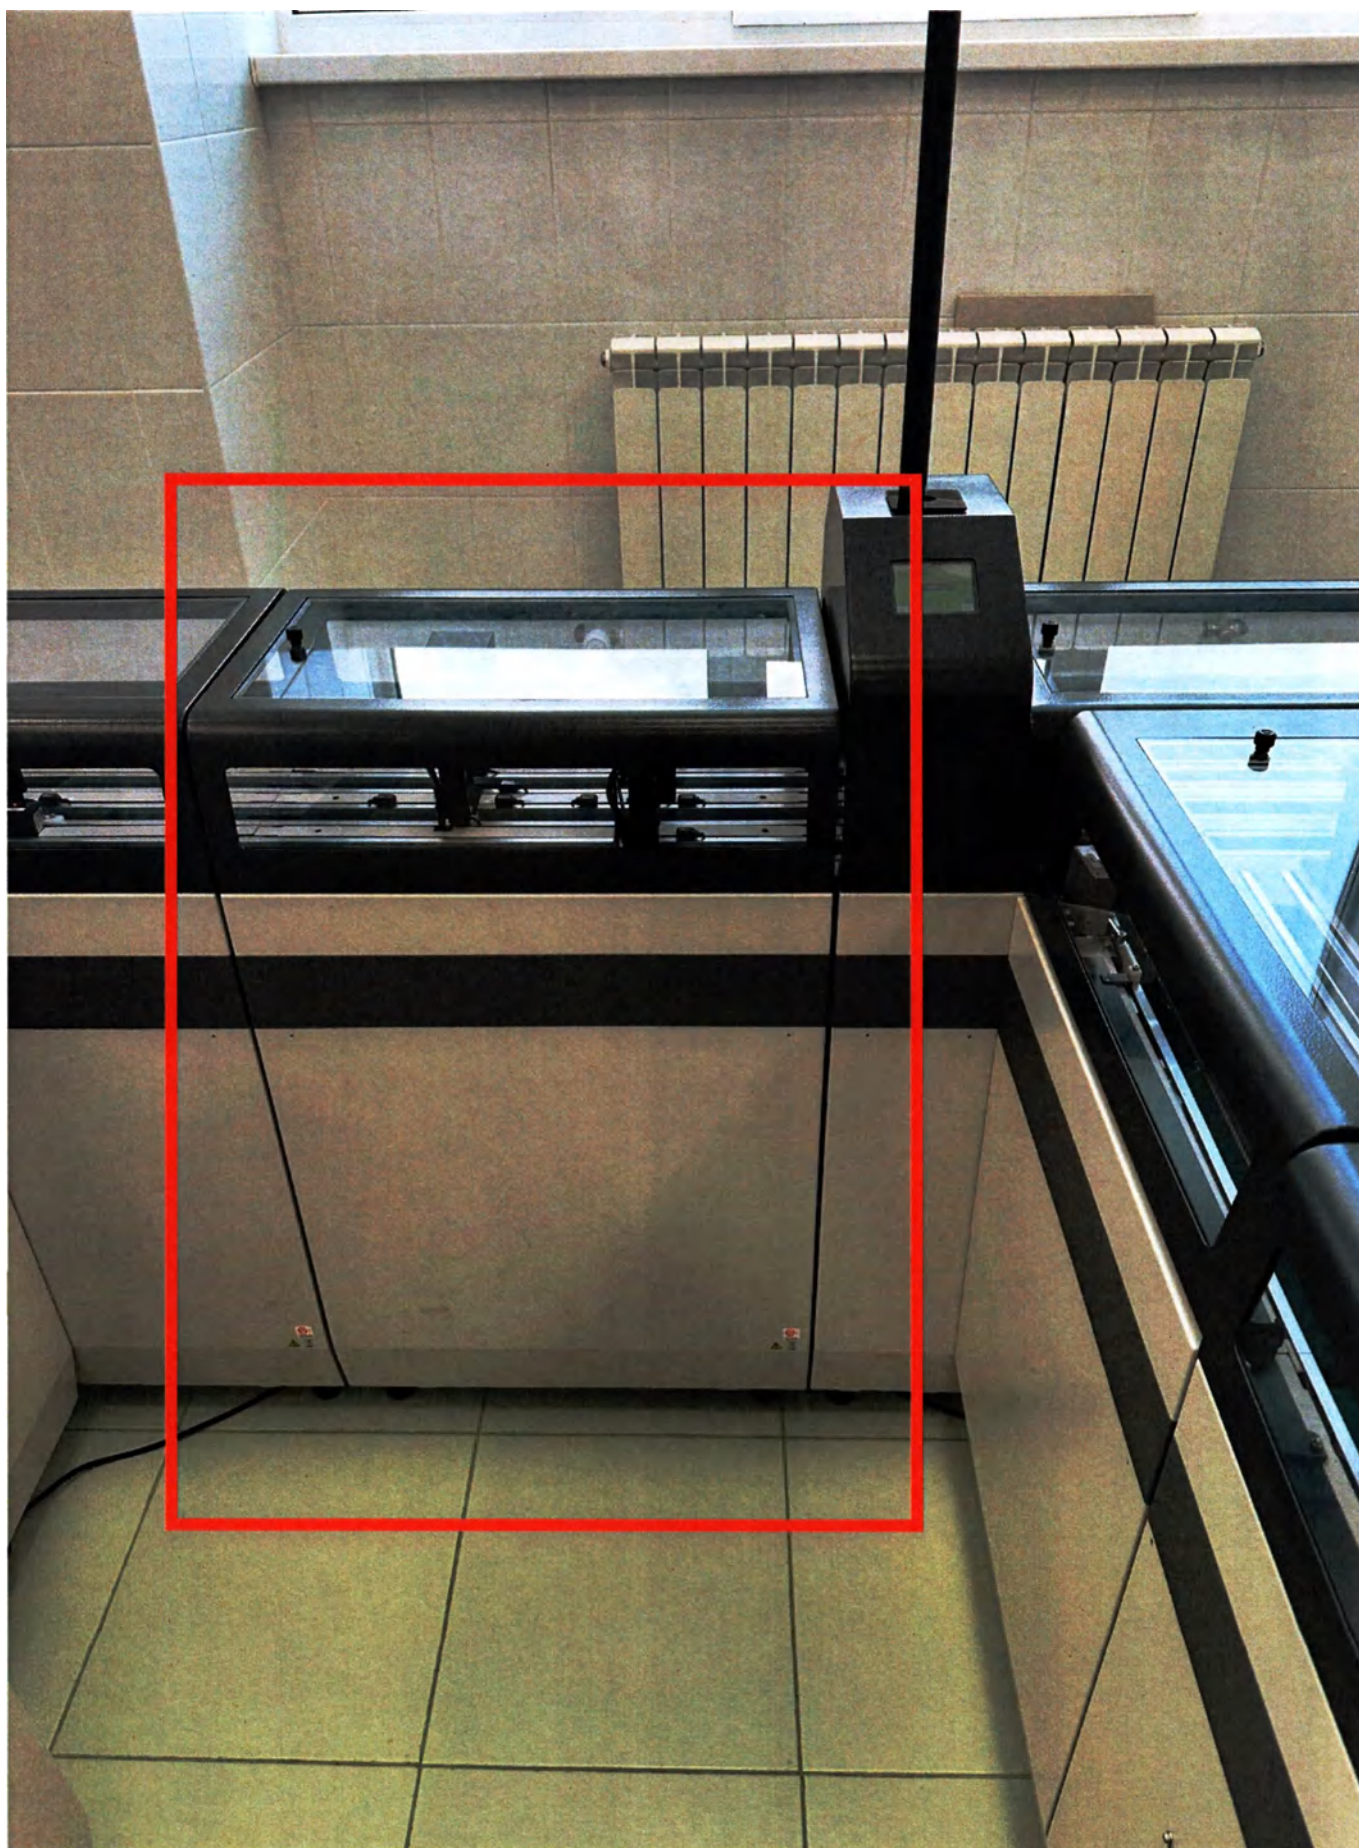


Рисунок 52. Линии переходные 1.



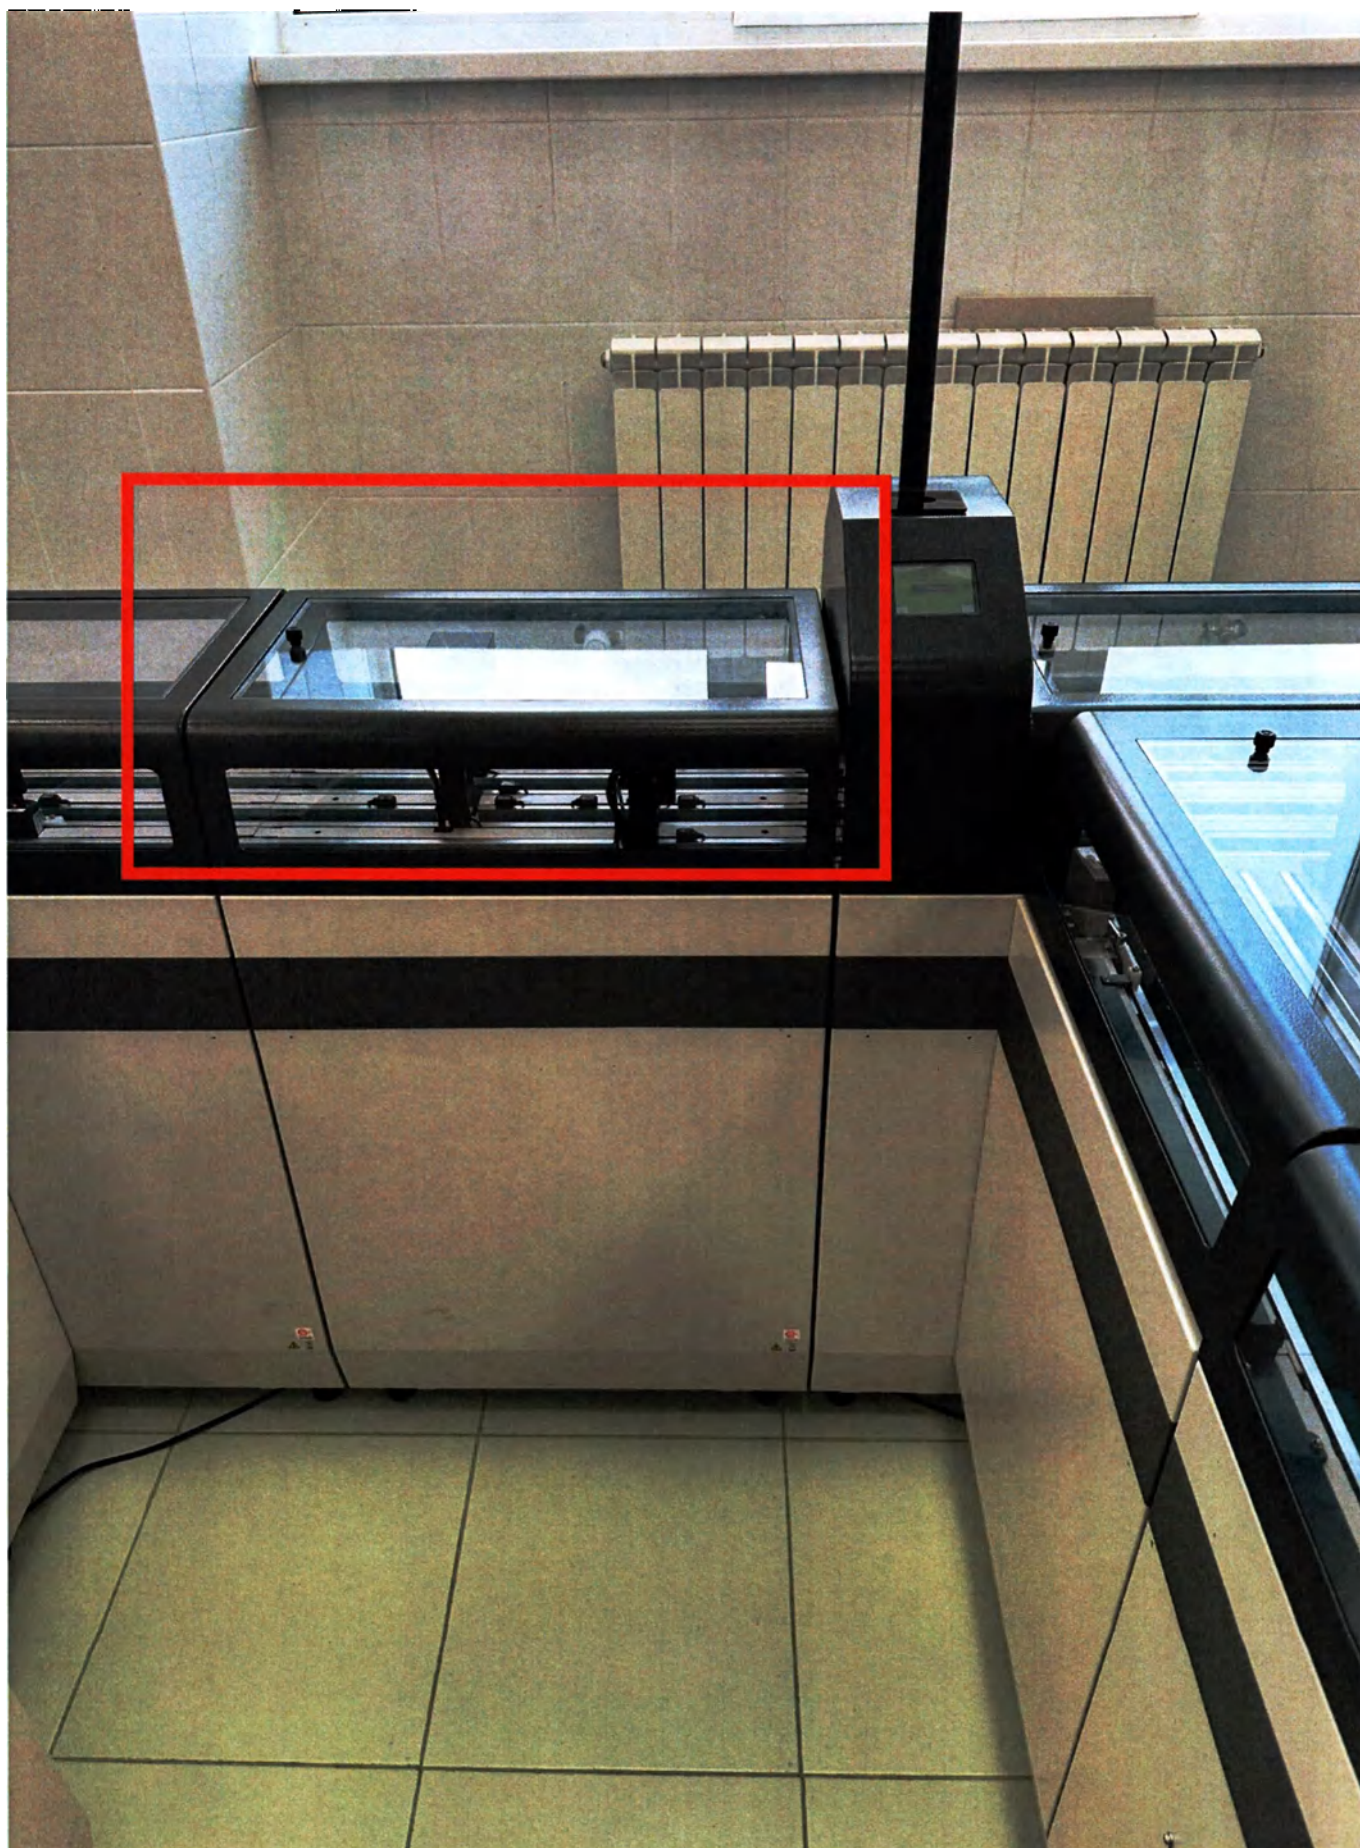


Рисунок 53. Крышки для линии переходной 1.



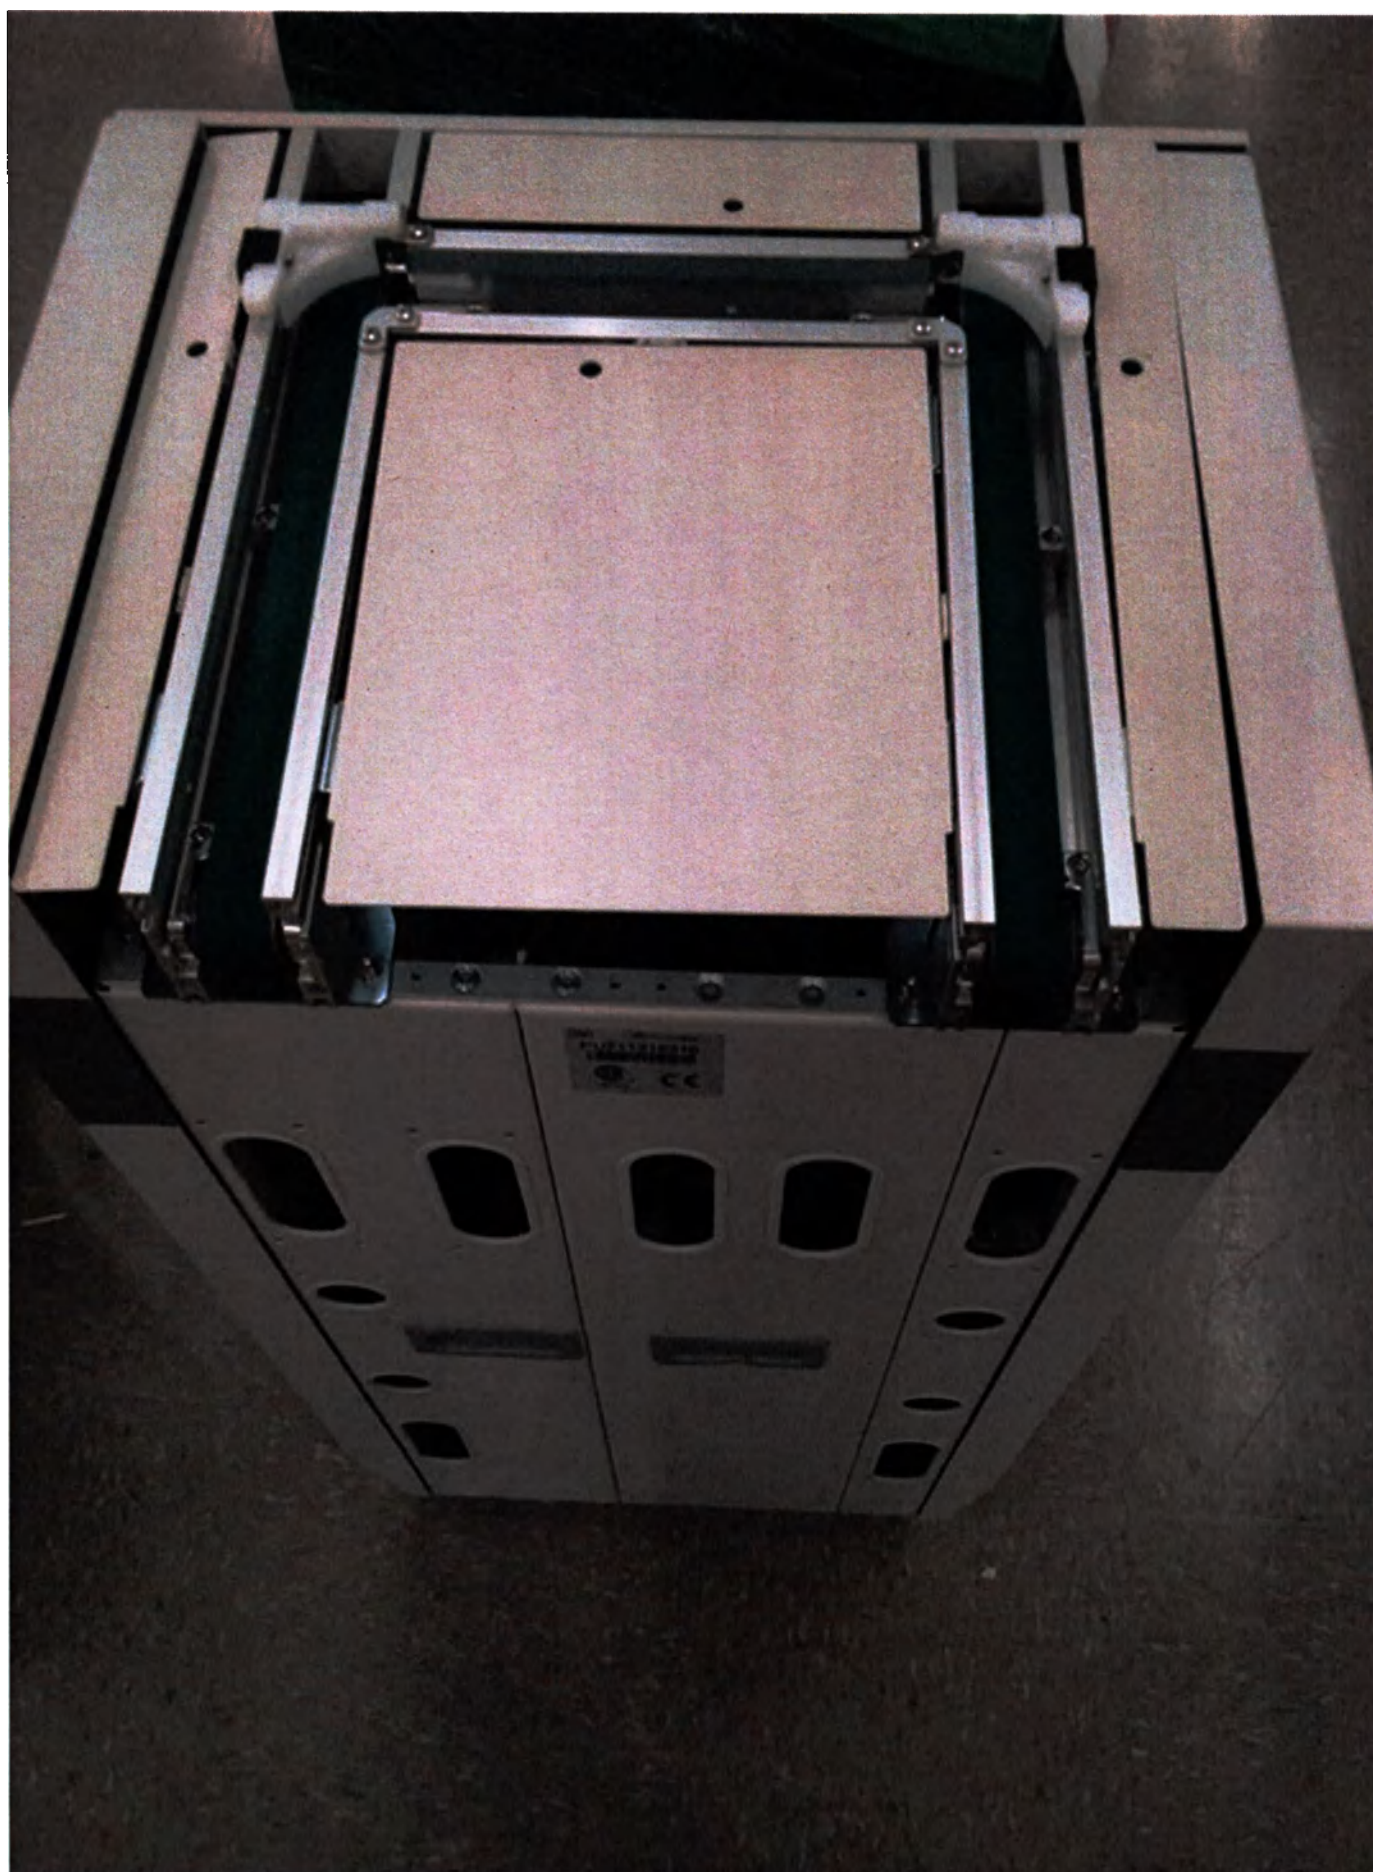






Рисунок 55. Крышки для линии переходной 2.





**Рисунок 56. Линии D 1, Линии D 2.**





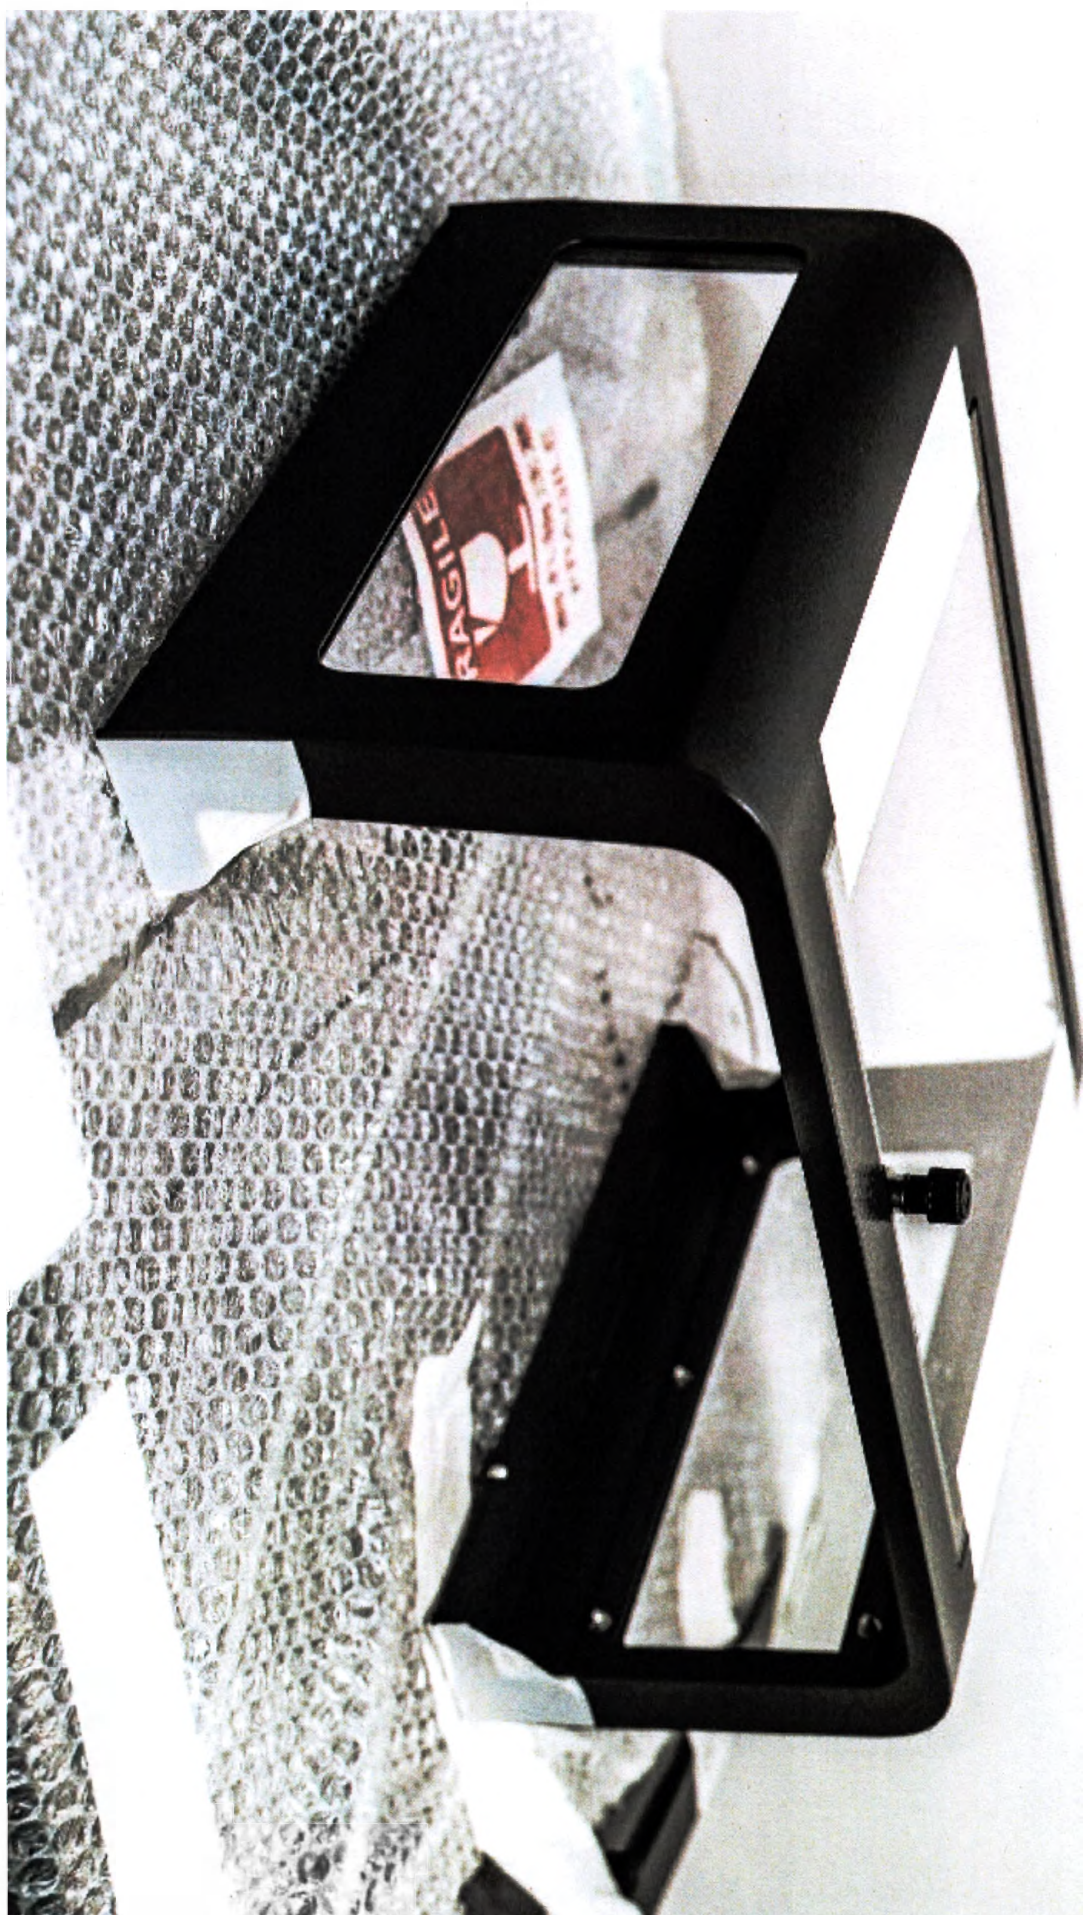


Рисунок 57. Крышки для линии D 1, Крышки для линии D 2.





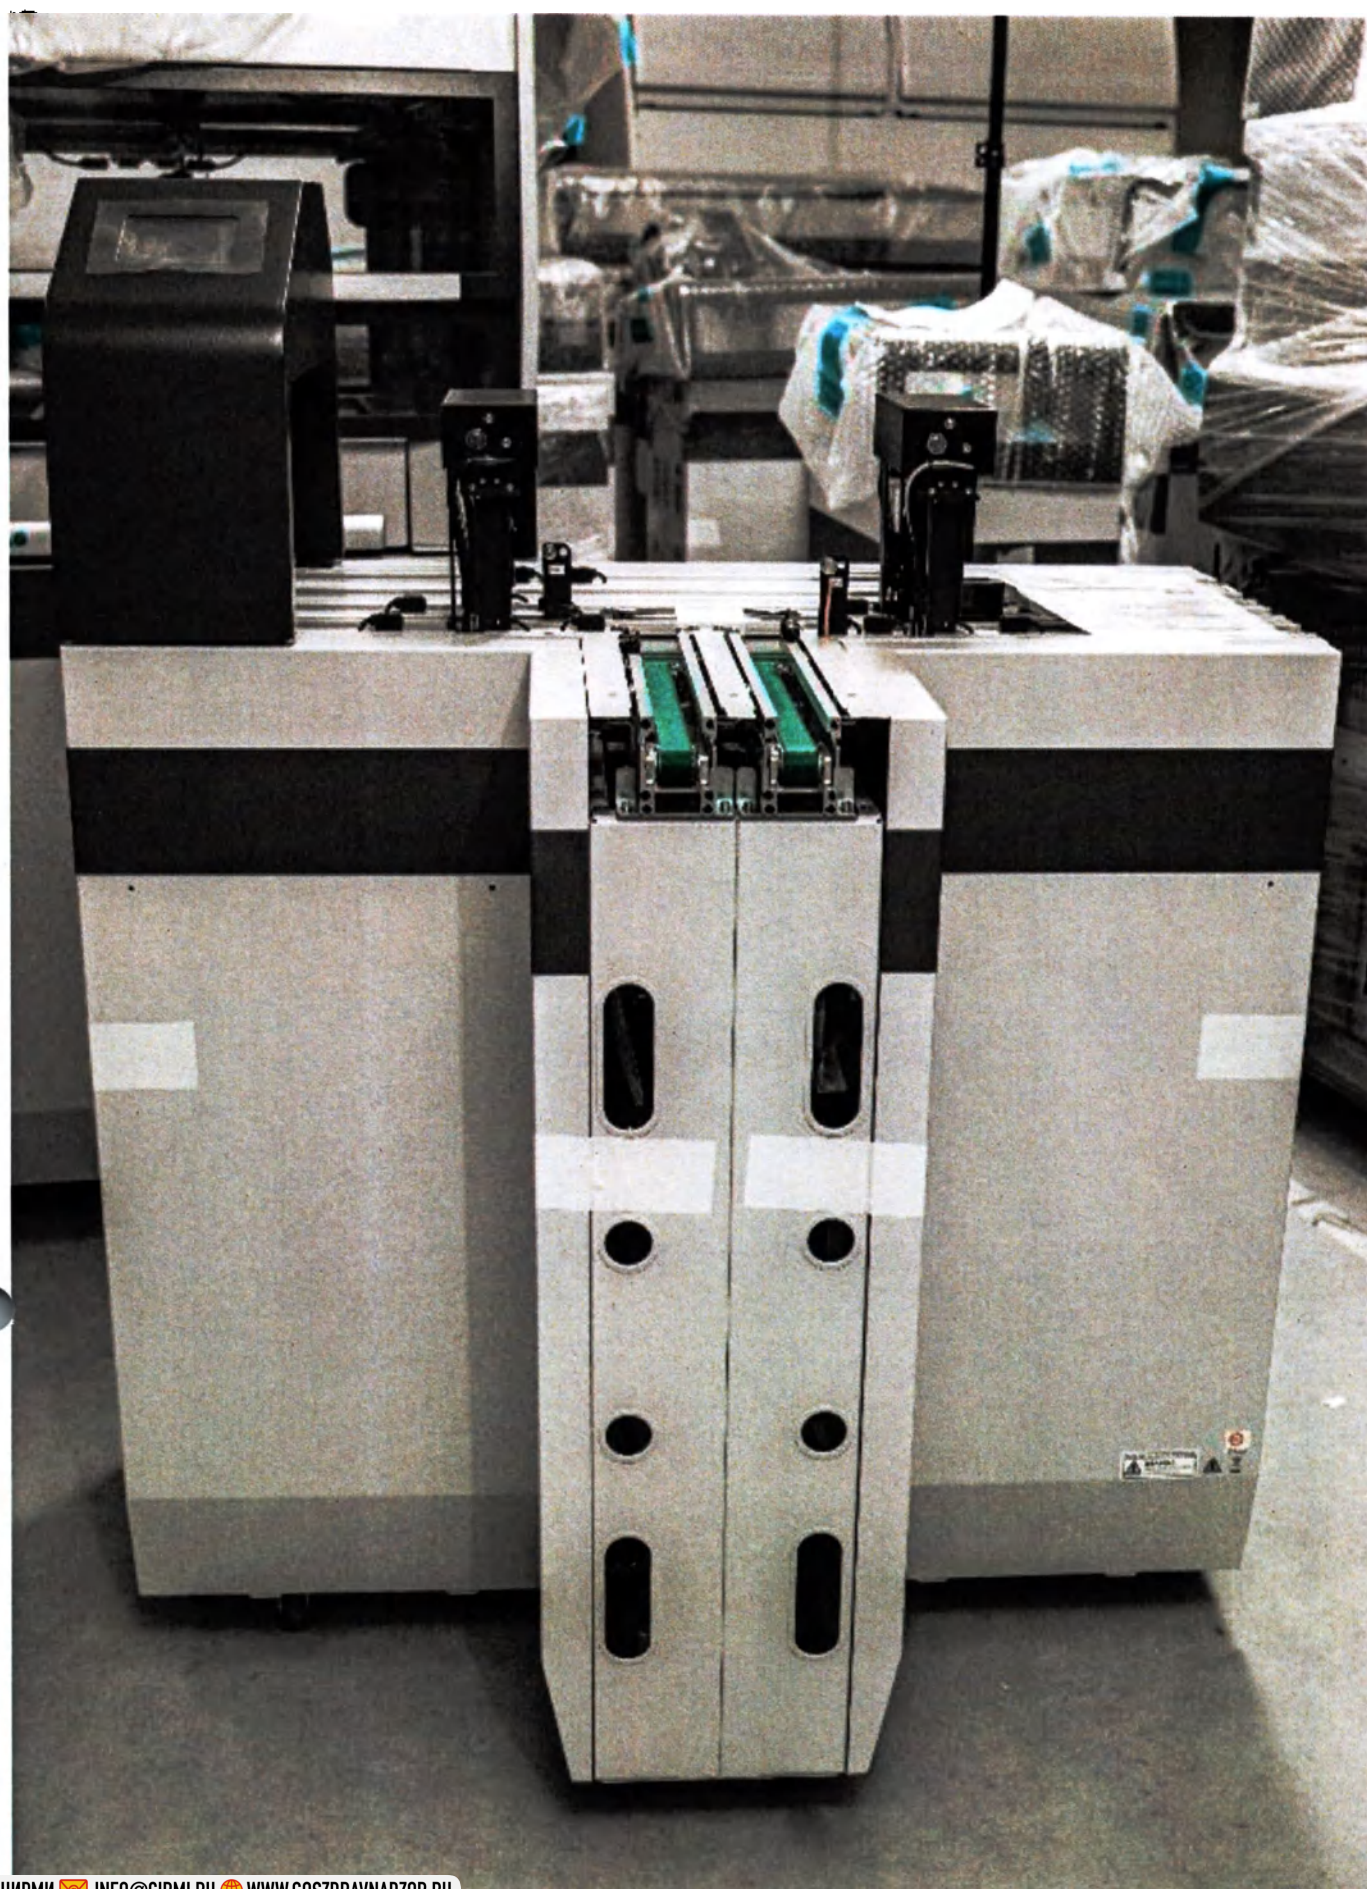

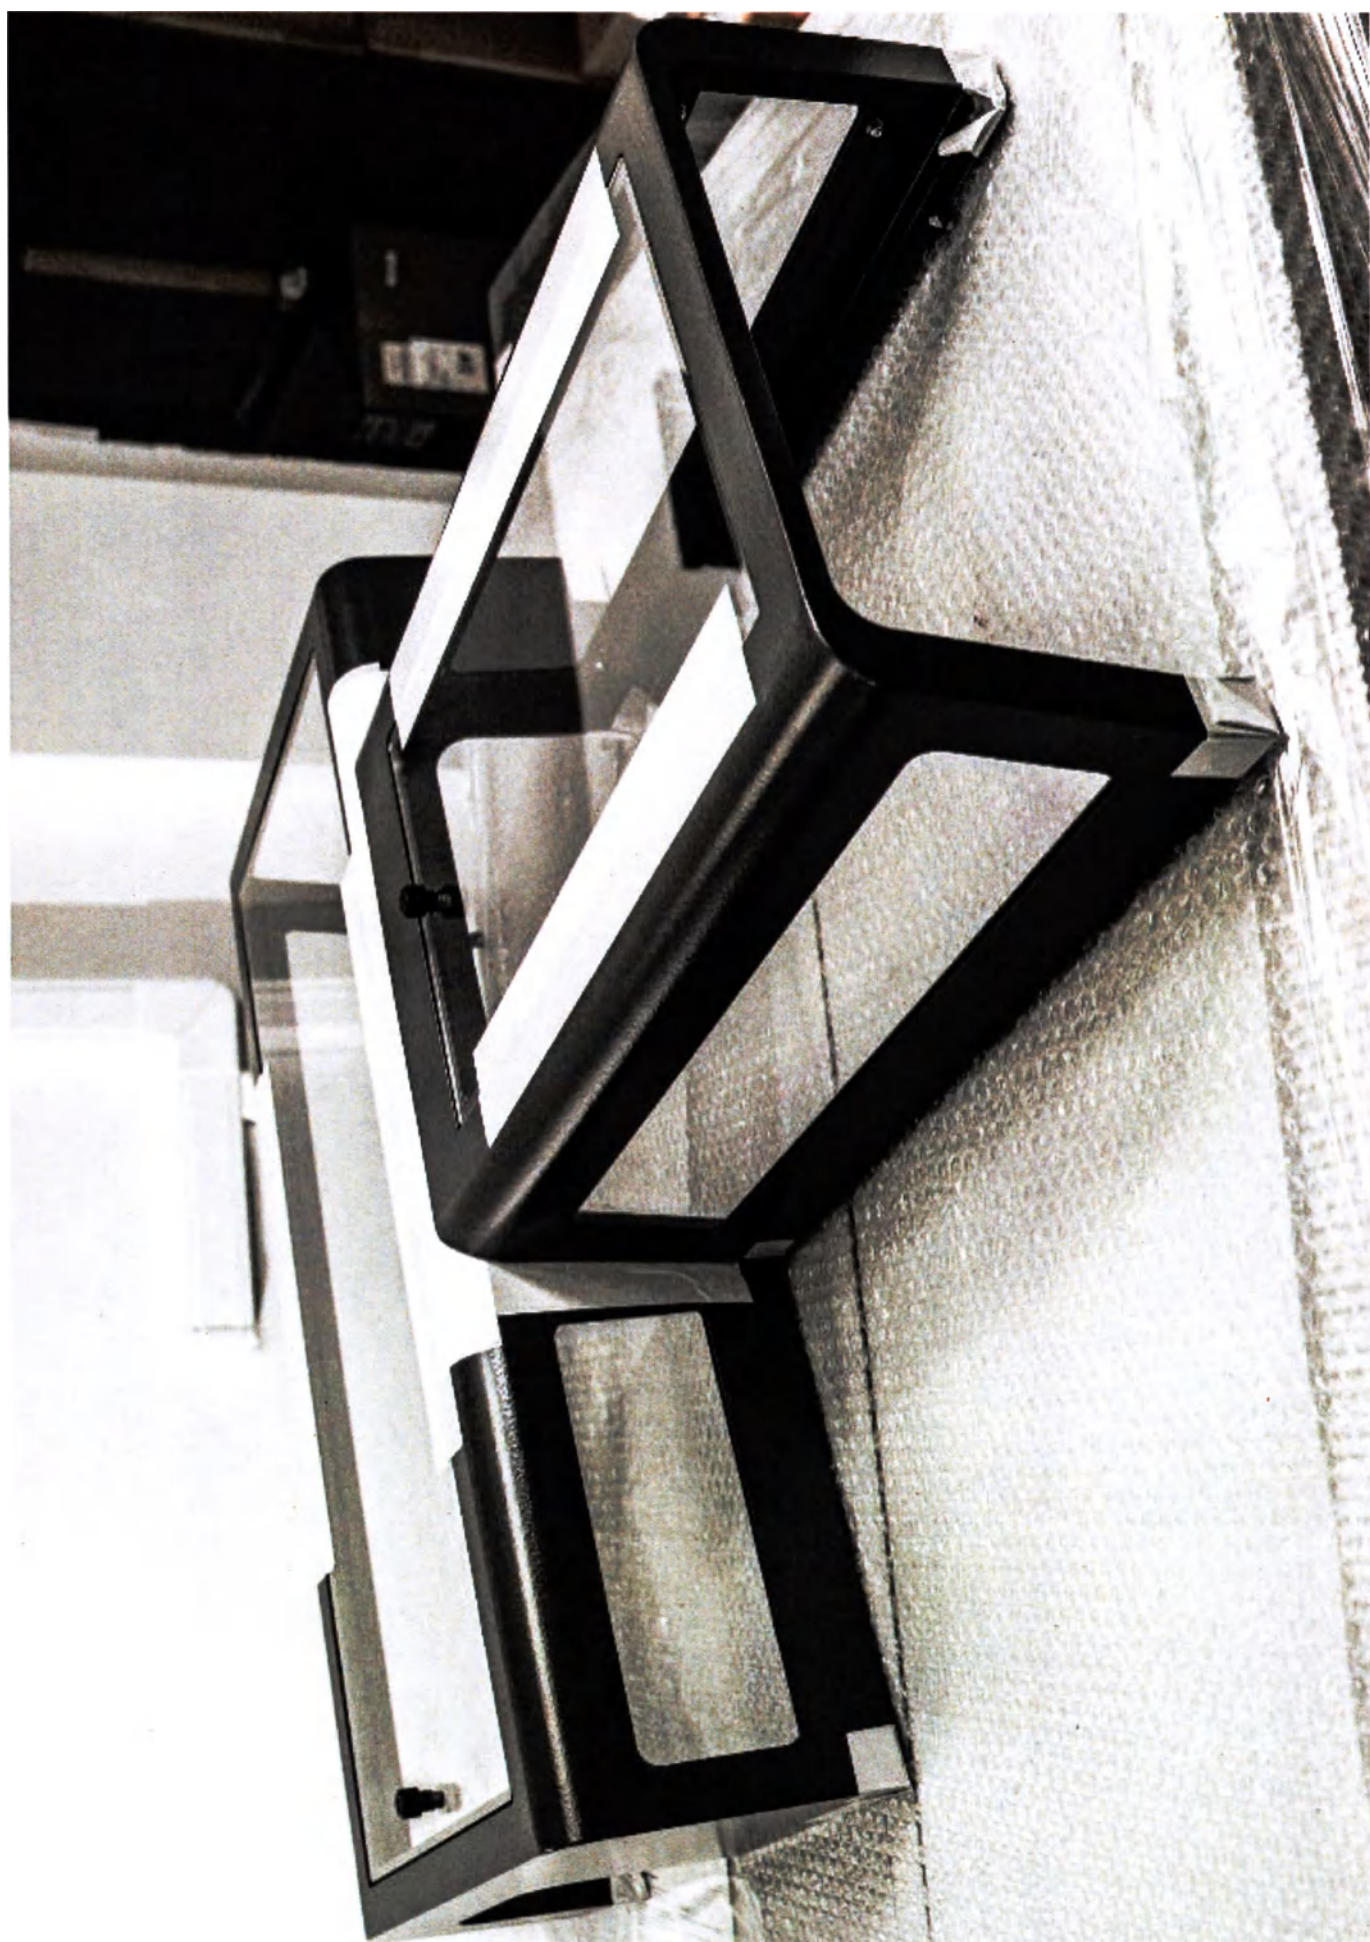

**Рисунок 59. Крышки для линии стандартной Т 900.**





Рисунок 60. Линии концевые Т 900.





Рисунок 61. Крышки для линии концевой Т 900.




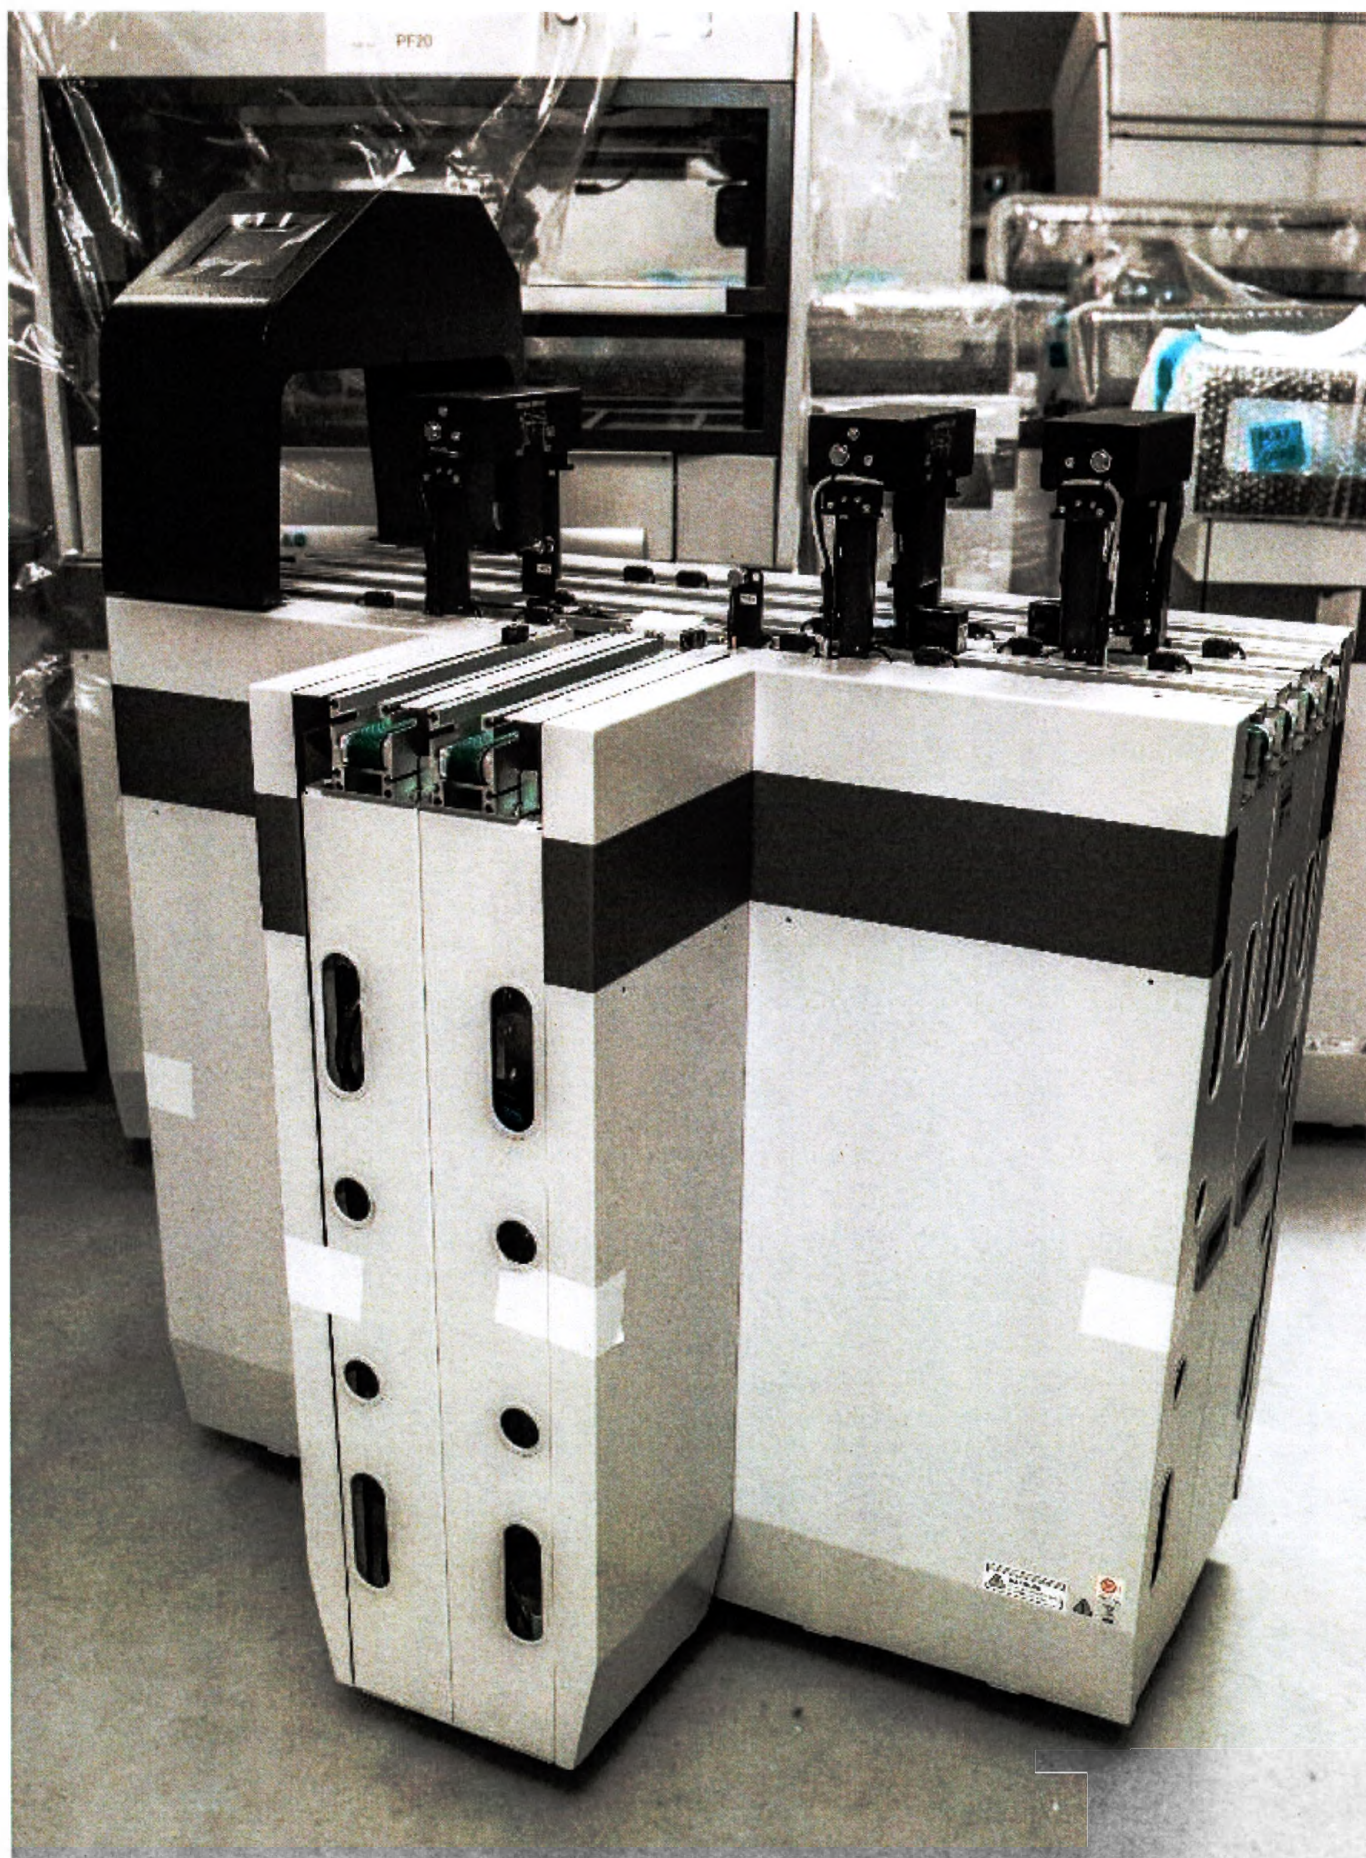



Рисунок 62. Линии однонаправленные Т 900.





**Рисунок 63. Крышки для линии однонаправленной Т 900.**

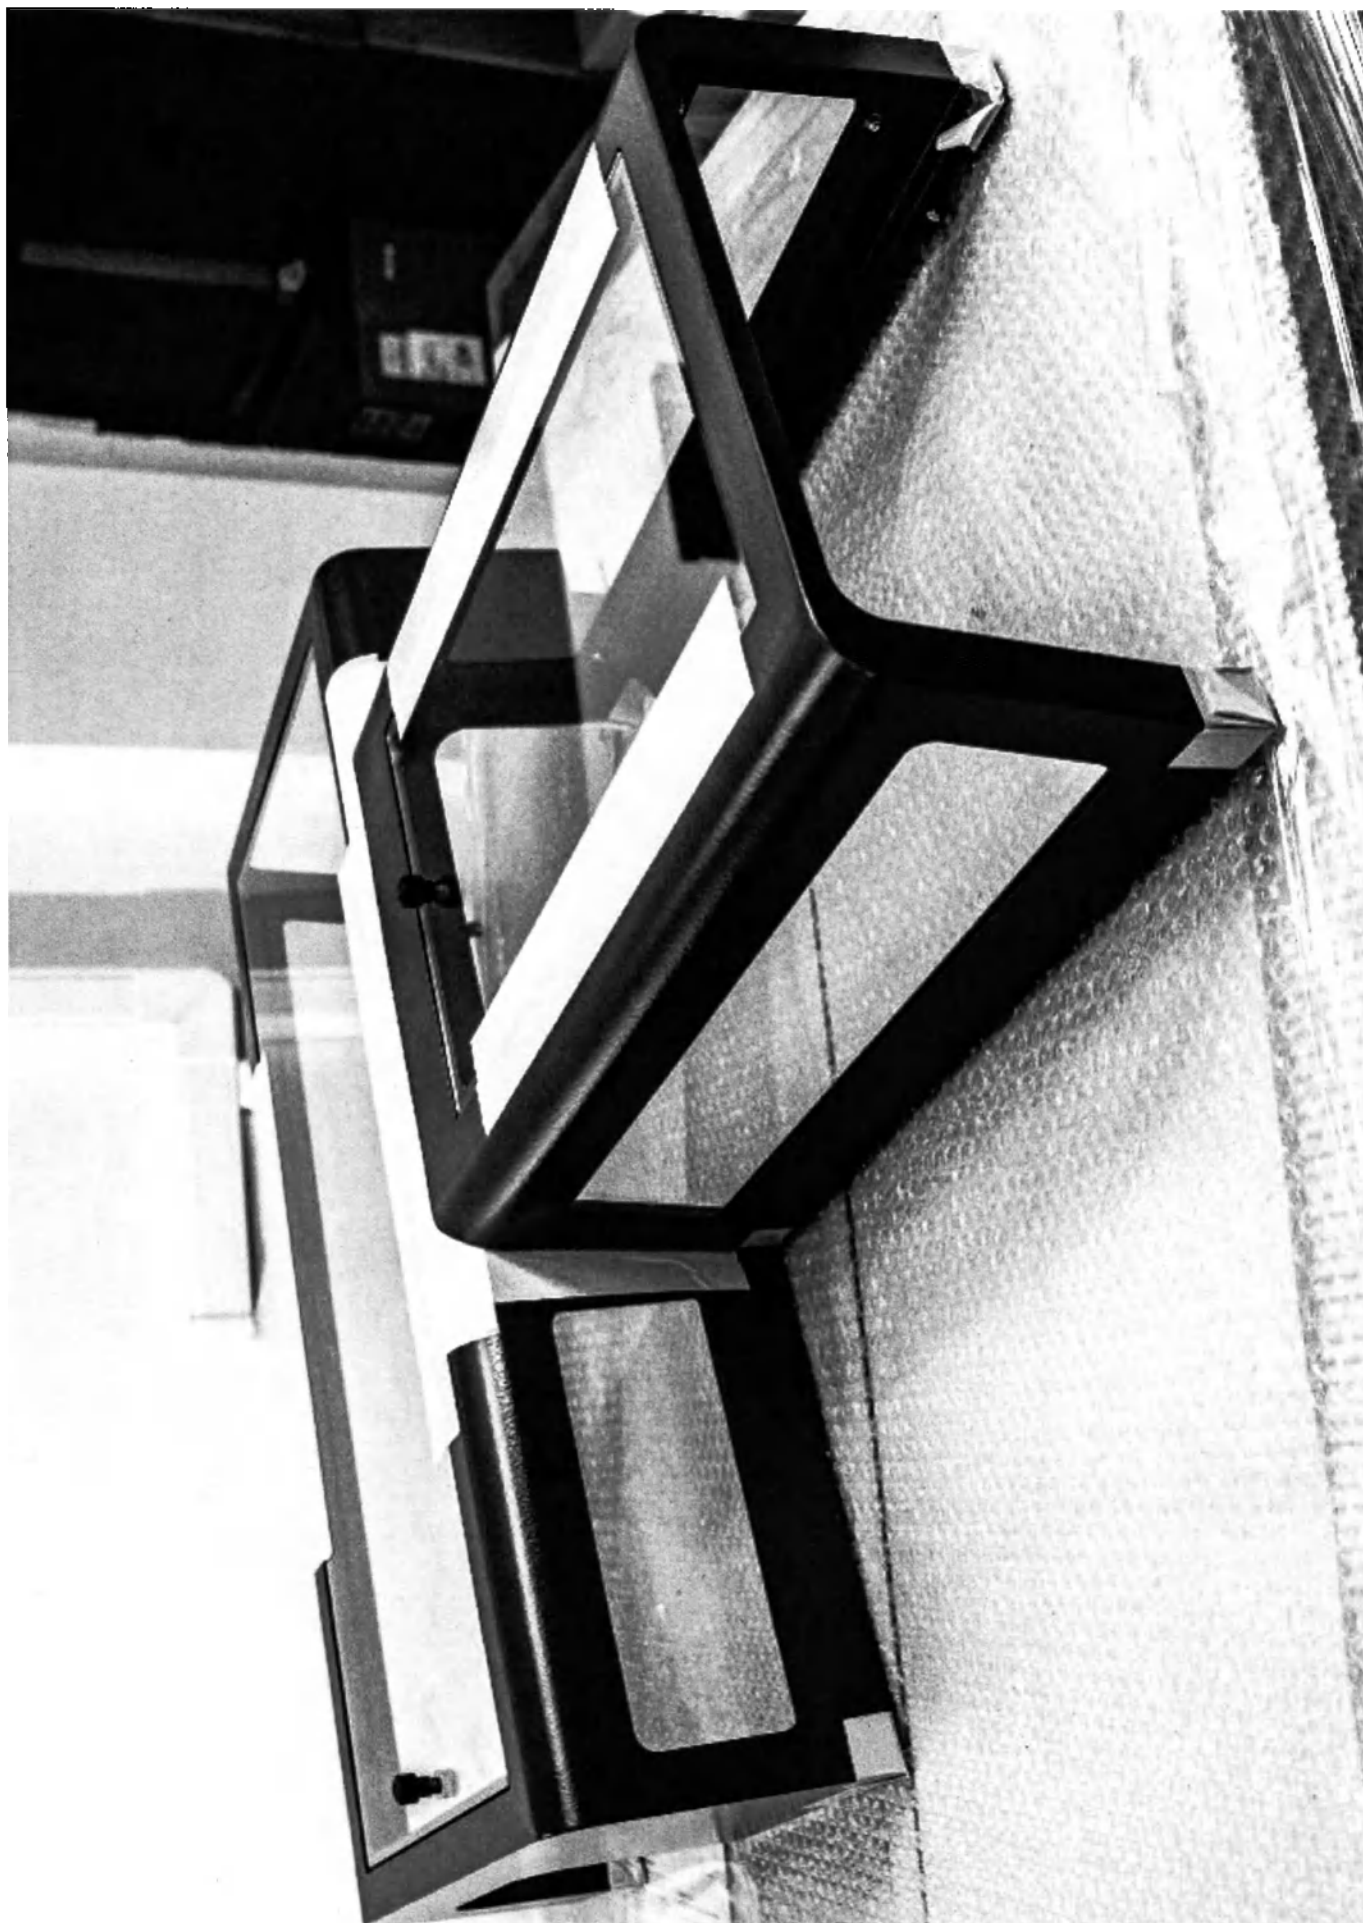

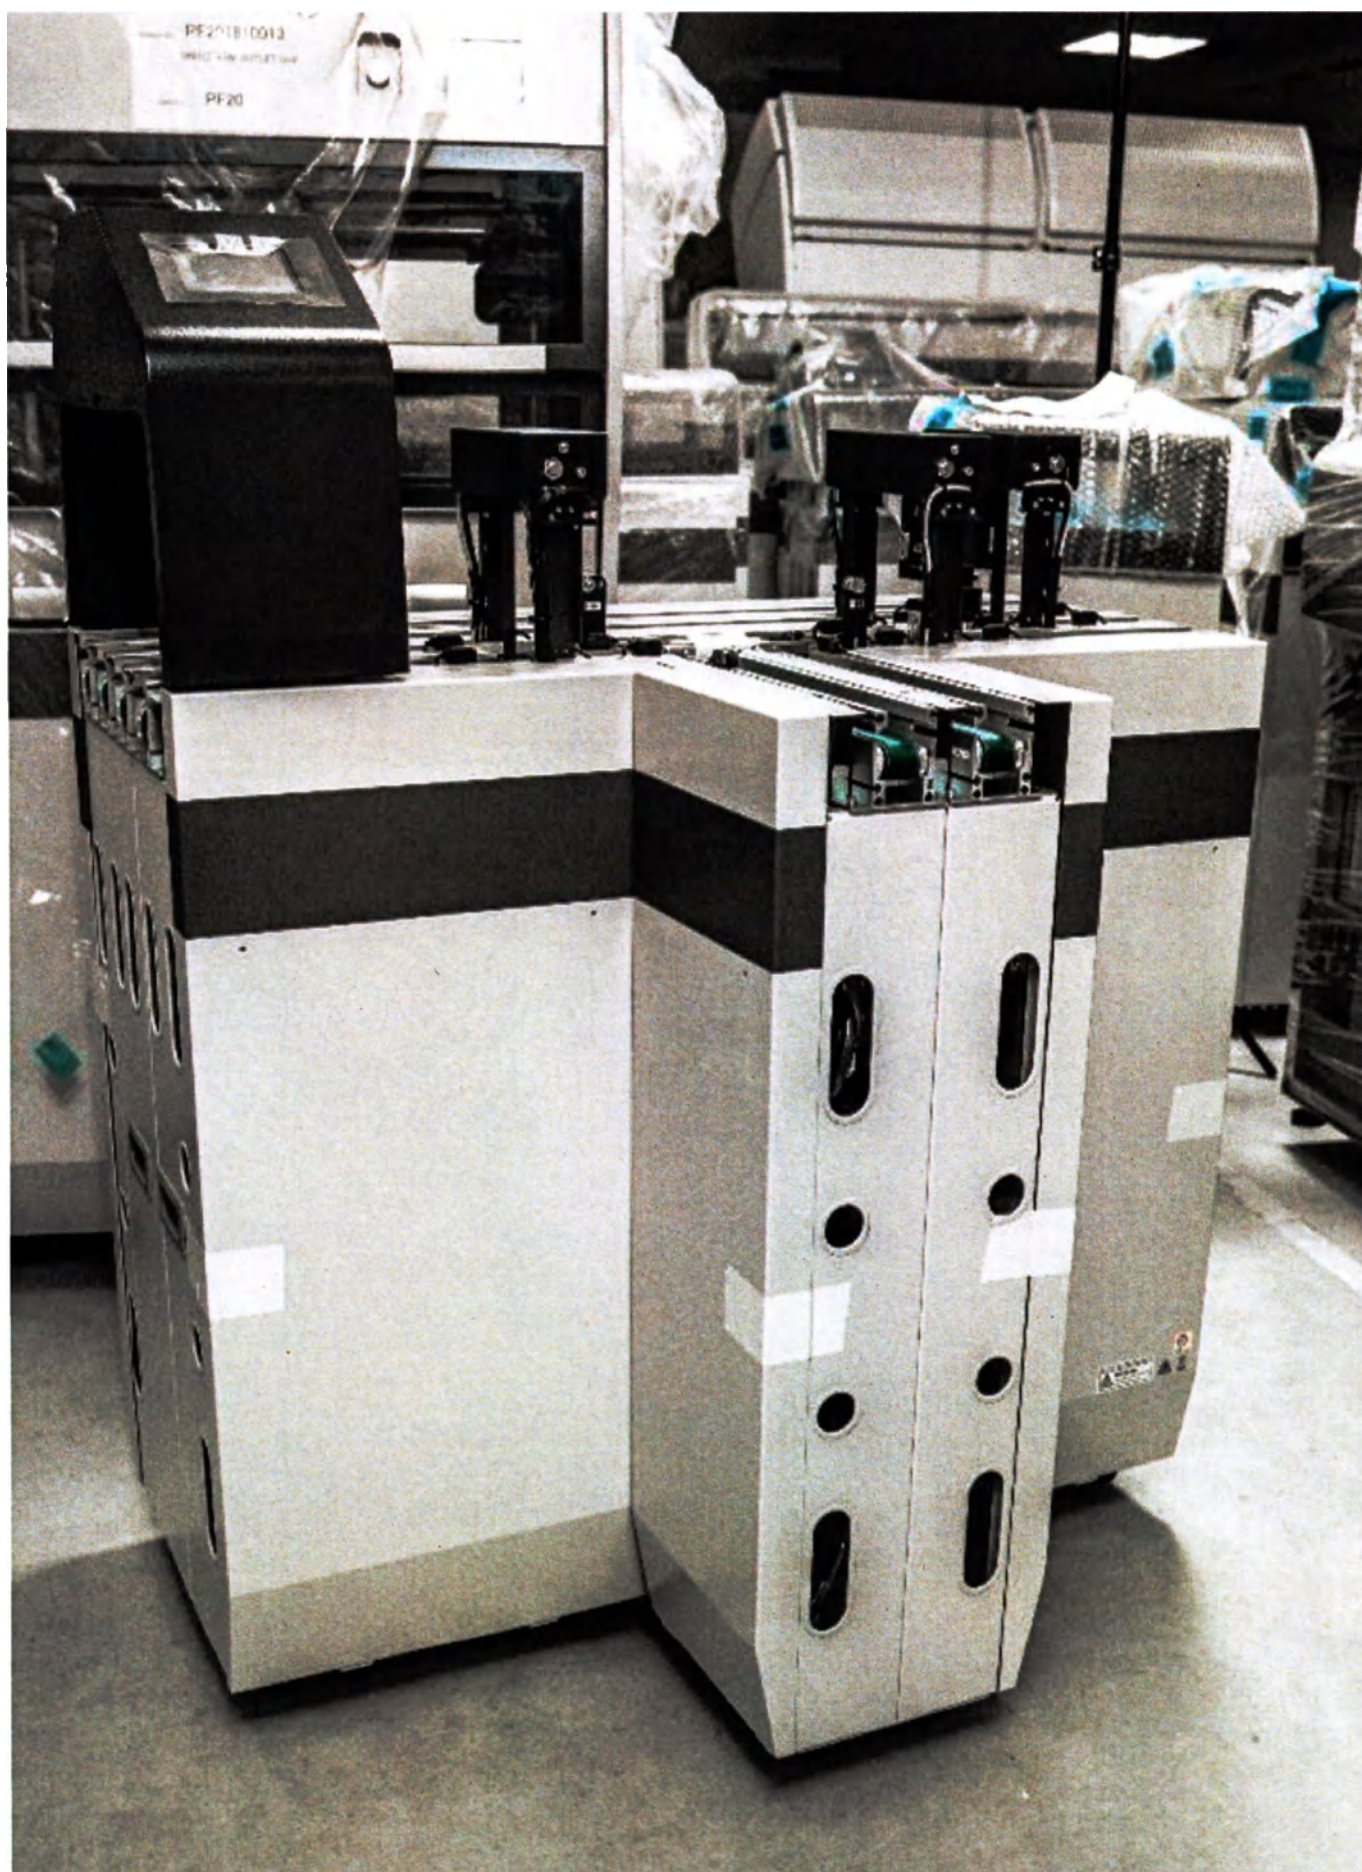

**Рисунок 64. Линии возвратные Т 900.**





**Рисунок 65. Крышки для линии возвратной Т 900.**



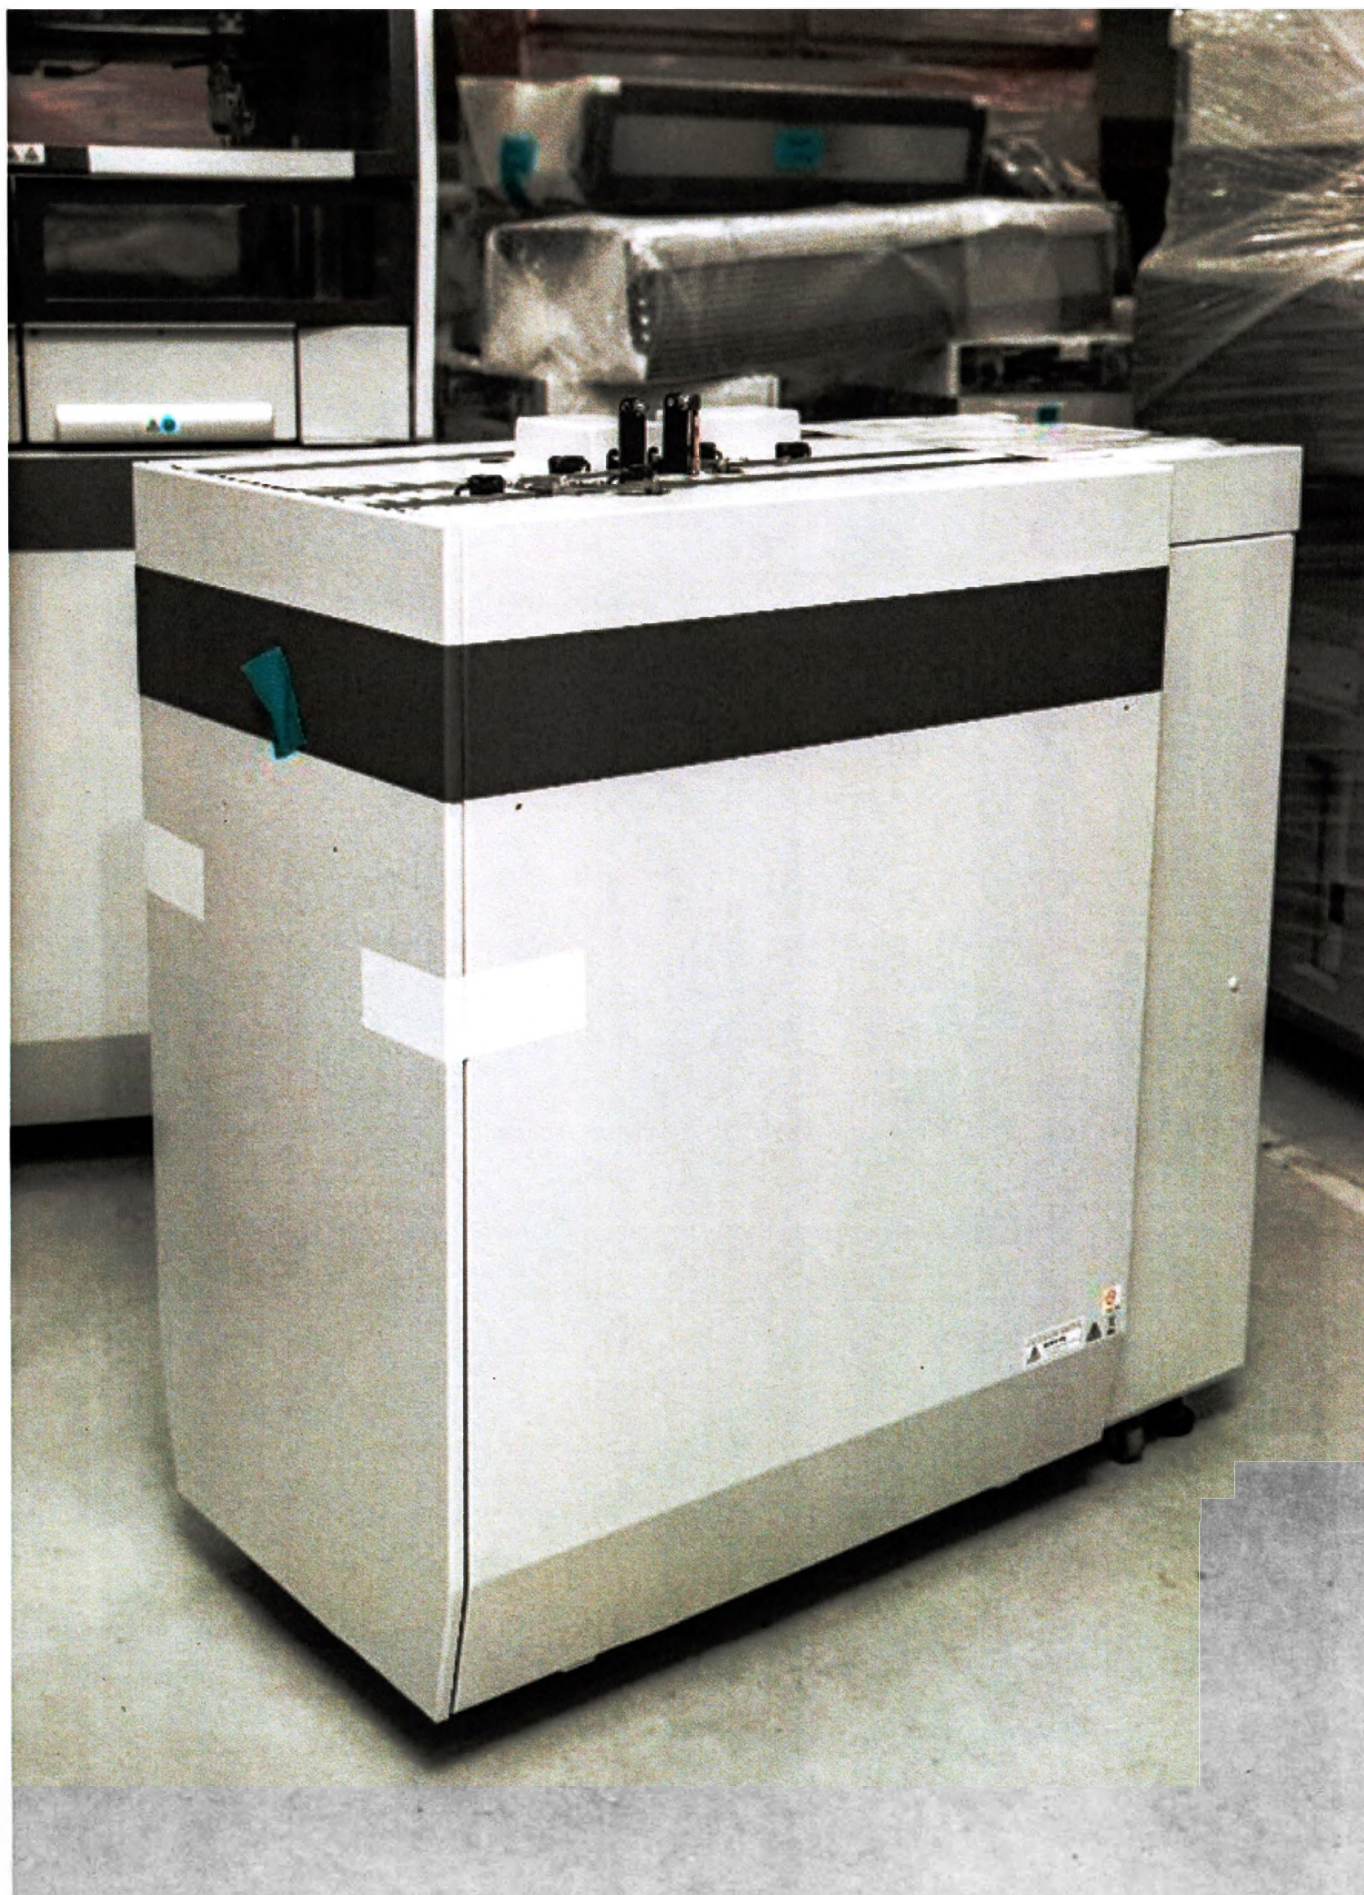


Рисунок 66. Линии H800.





**Рисунок 67. Крышки для линии Н 800.**



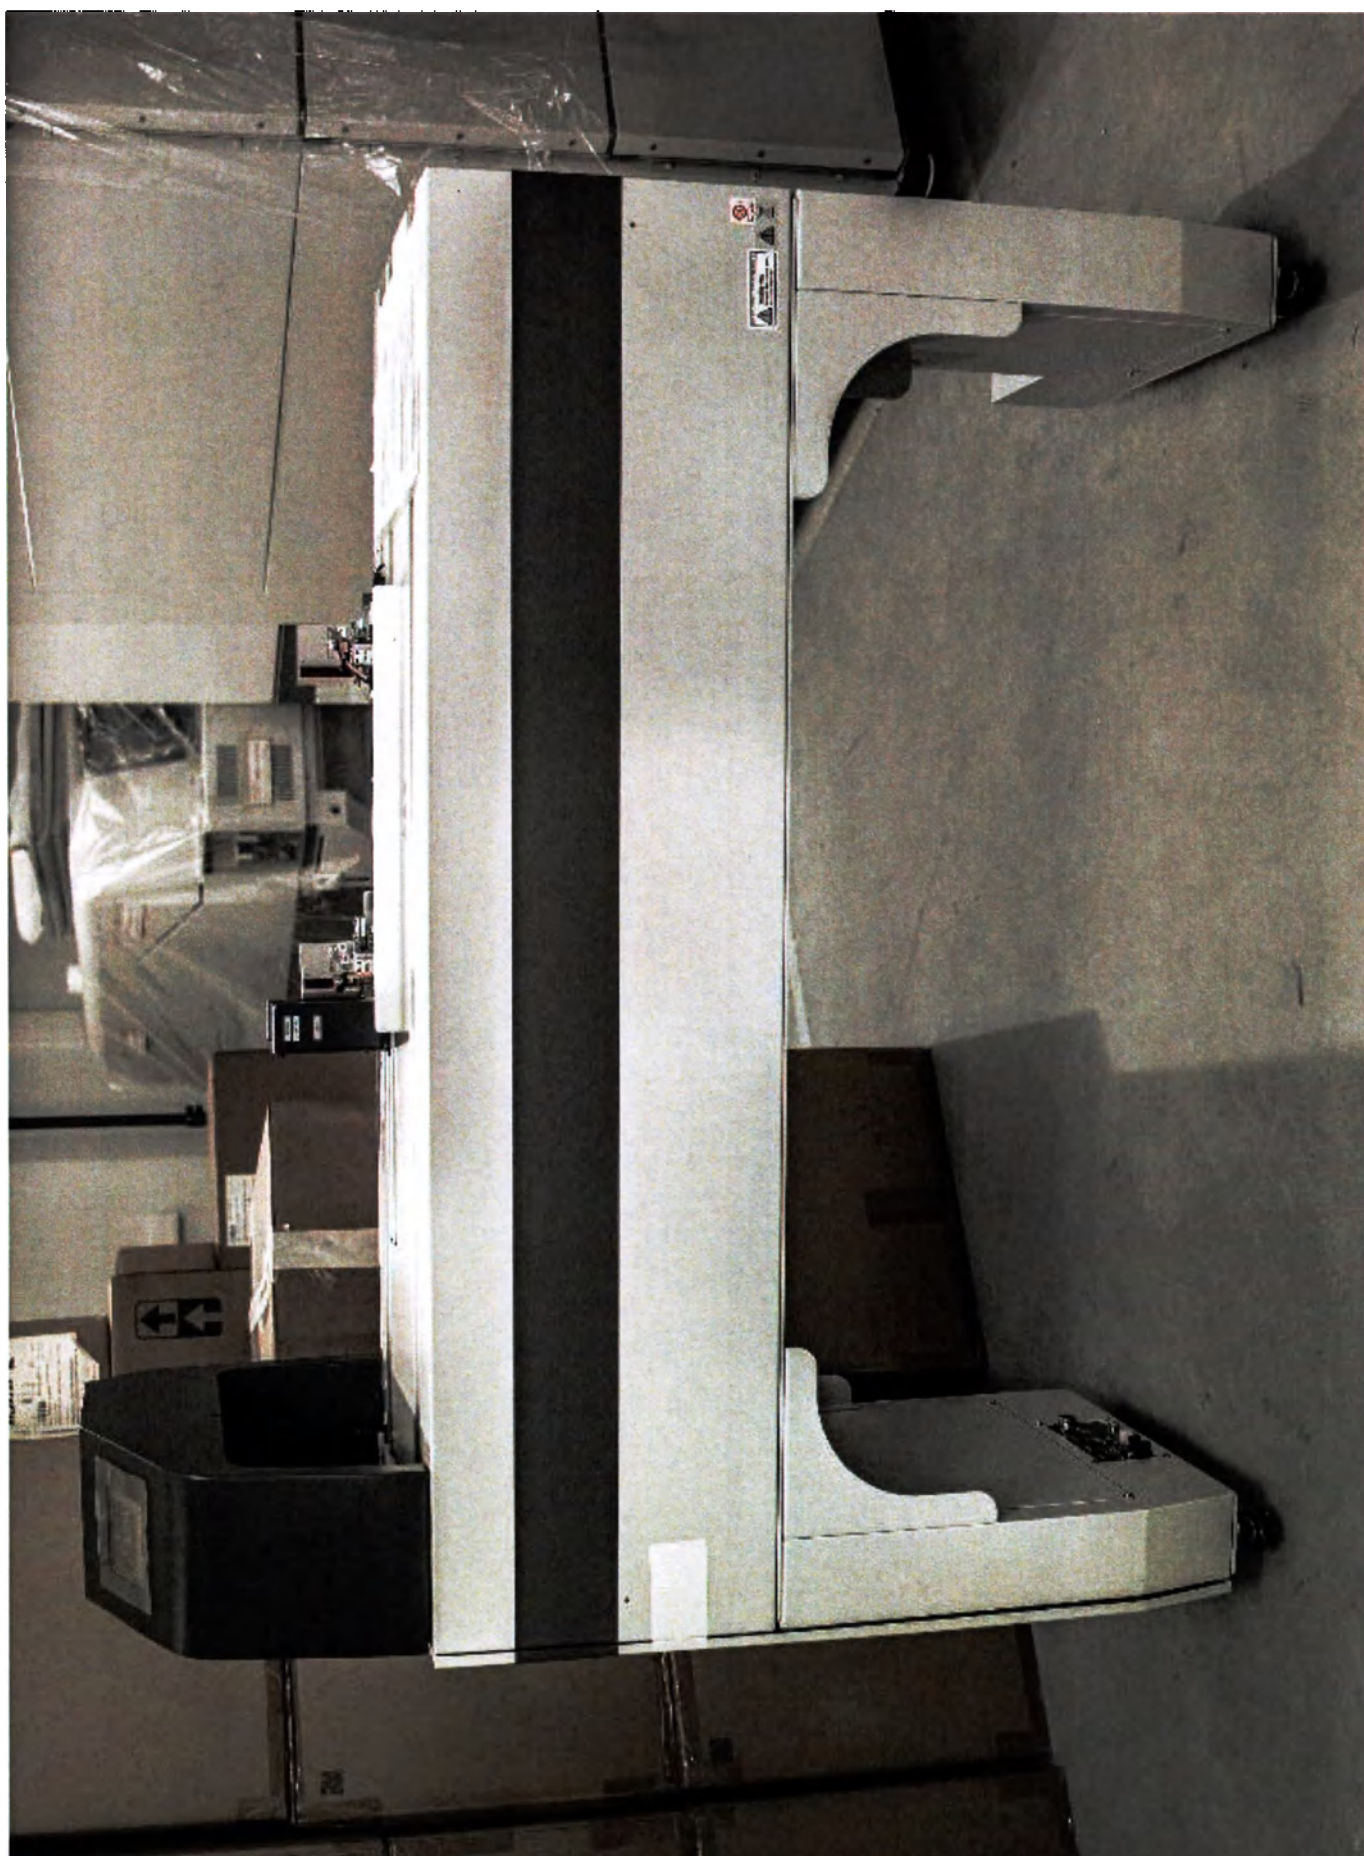


Рисунок 68. Линии Н1200.





Рисунок 69. Крышки для линии Н 1200.



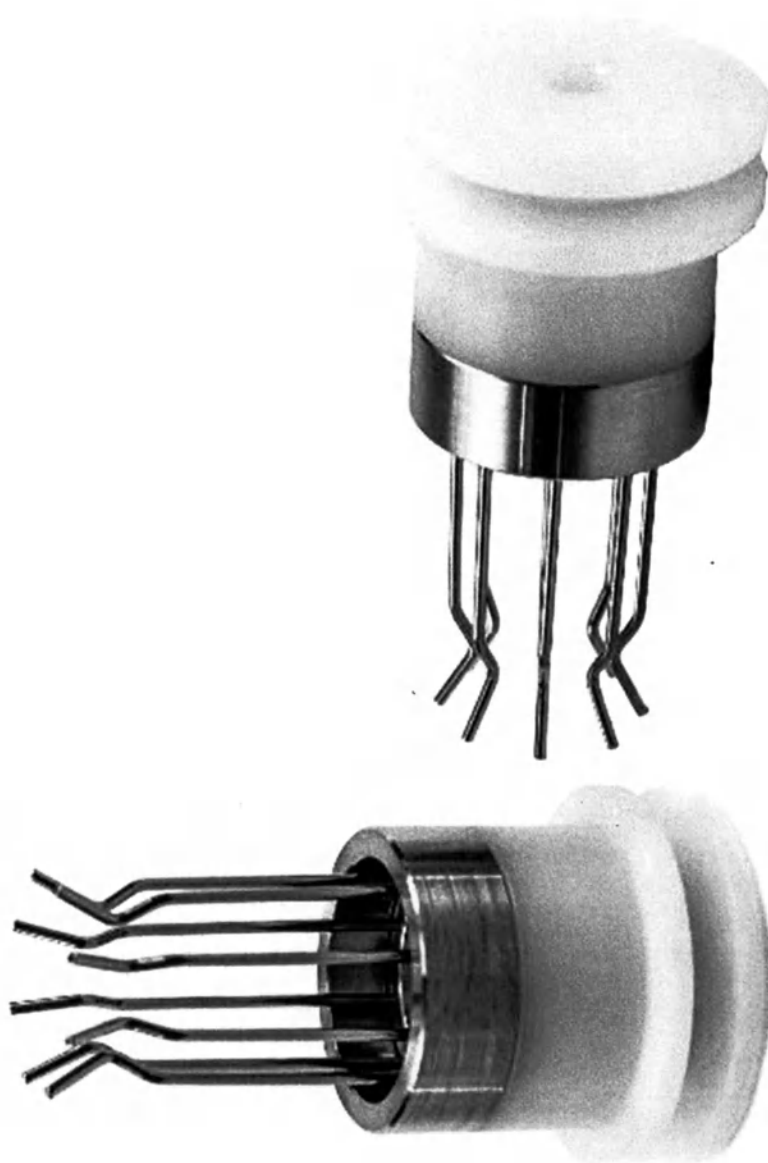


Рисунок 70. Держатели для пробирок.



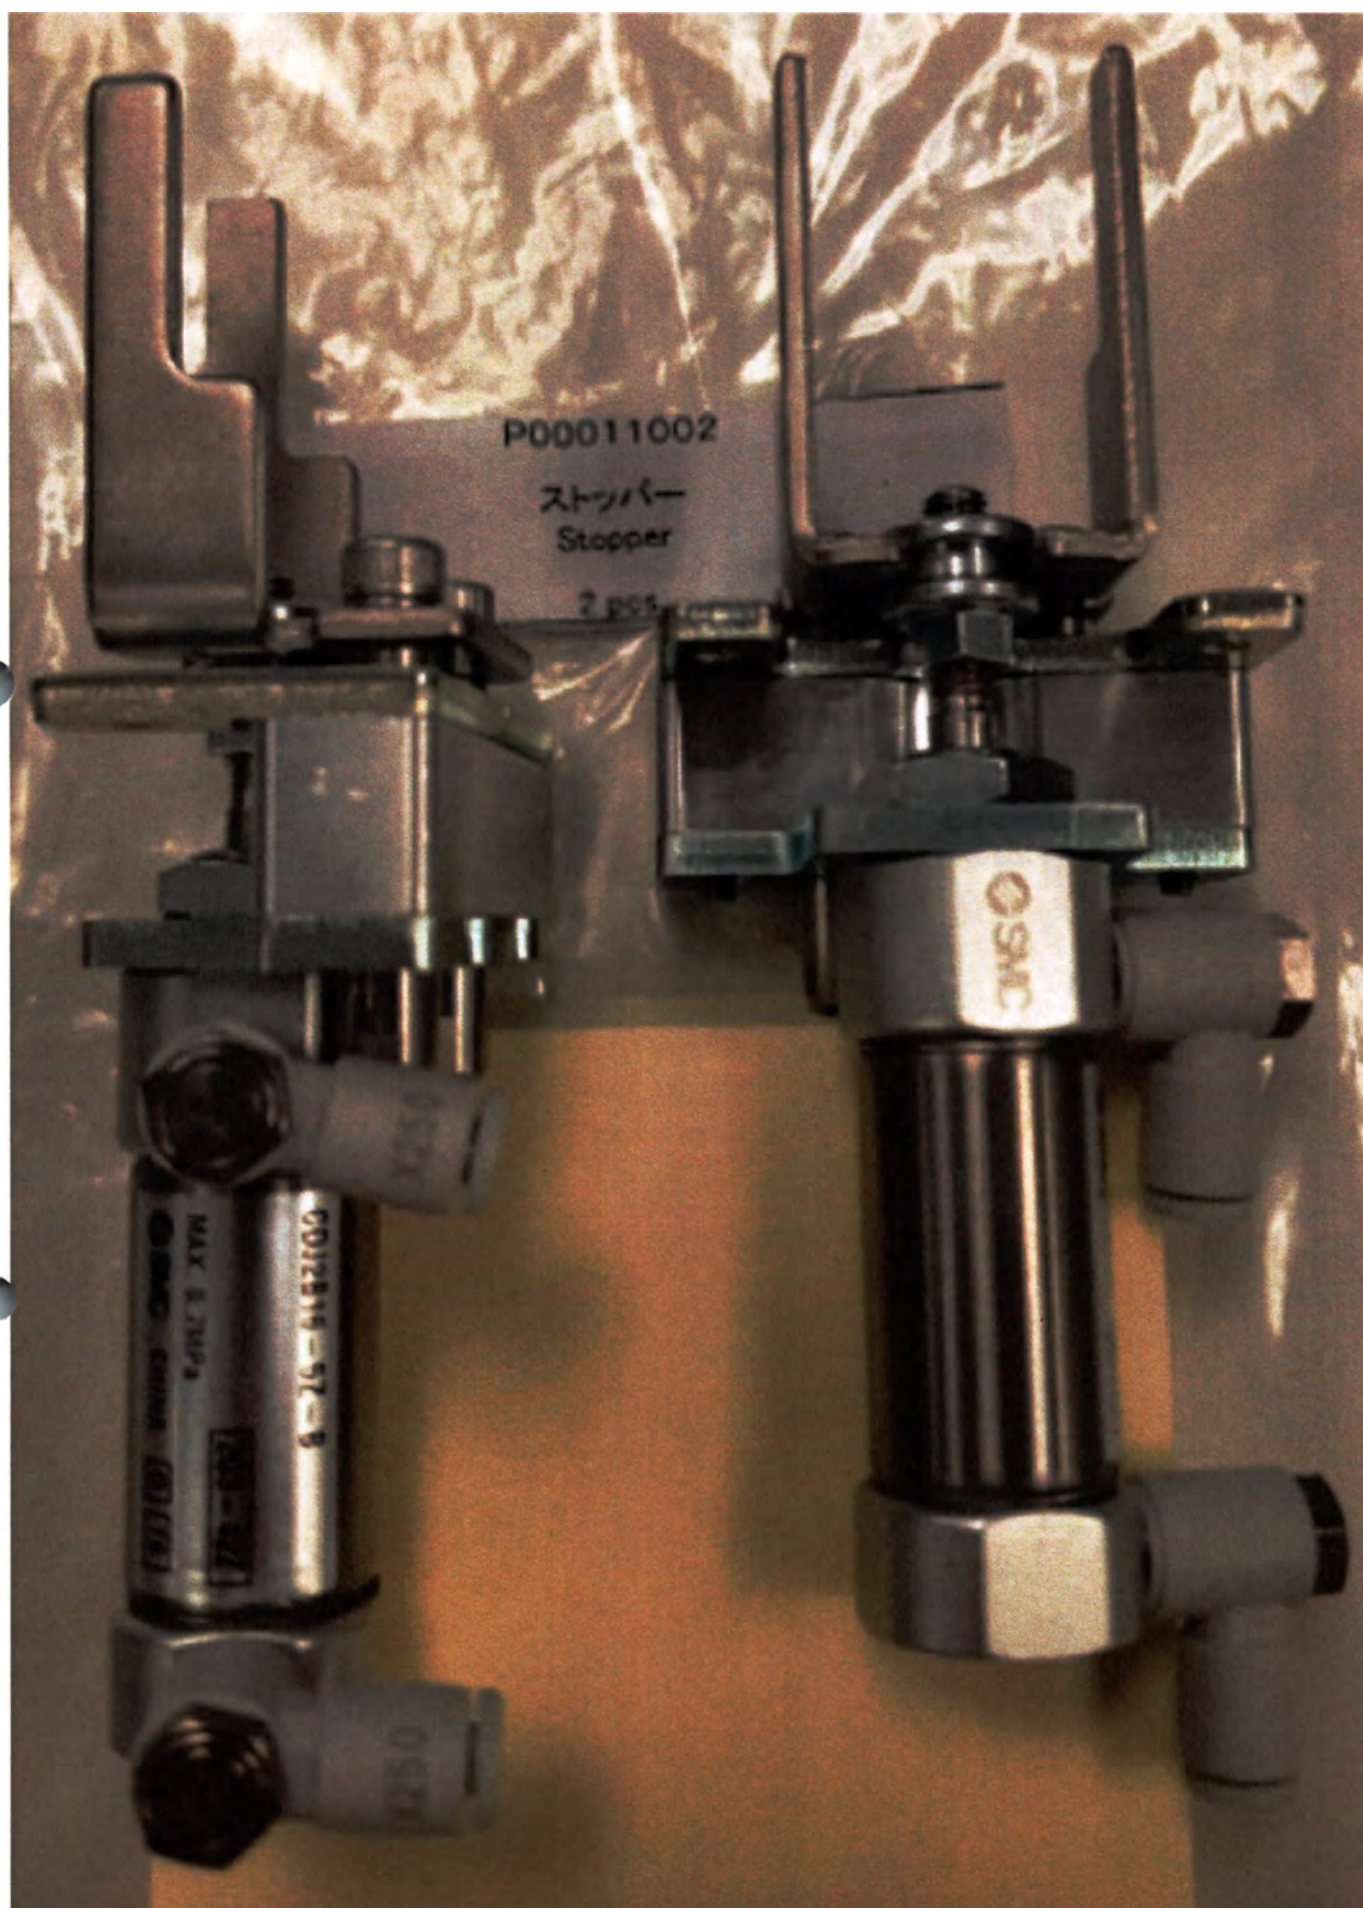


Рисунок 71. Ограничитель очереди для пробирок.





**Рисунок 72. Крышки универсальные для модуля установки крышек.**





Рисунок 73. Штатив для пробирок с высоким приоритетом (срочных проб).



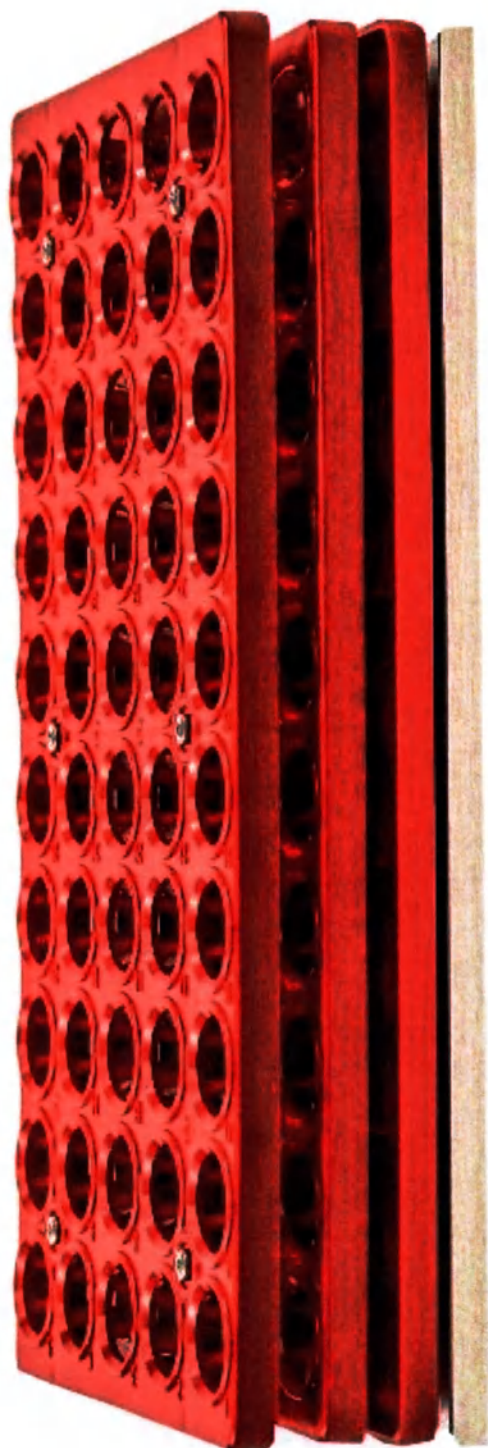


Рисунок 74. Штатив для пробирок с высоким приоритетом (срочных проб), легковесный.





Рисунок 75. Штатив для пробирок с обычным приоритетом.



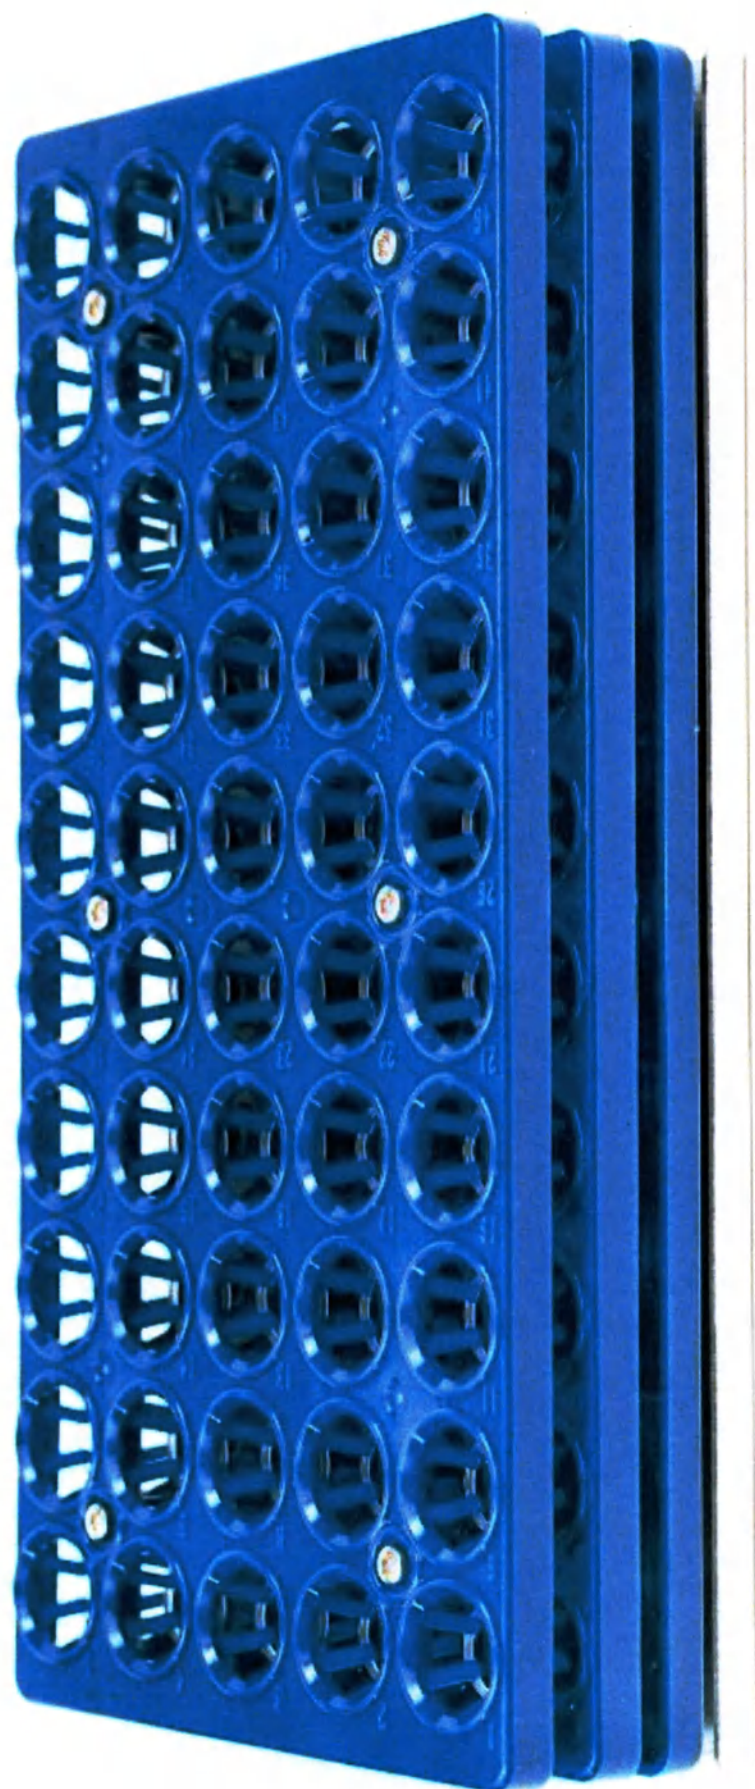


Рисунок 76. Штатив для пробирок с обычным приоритетом, легковесный.



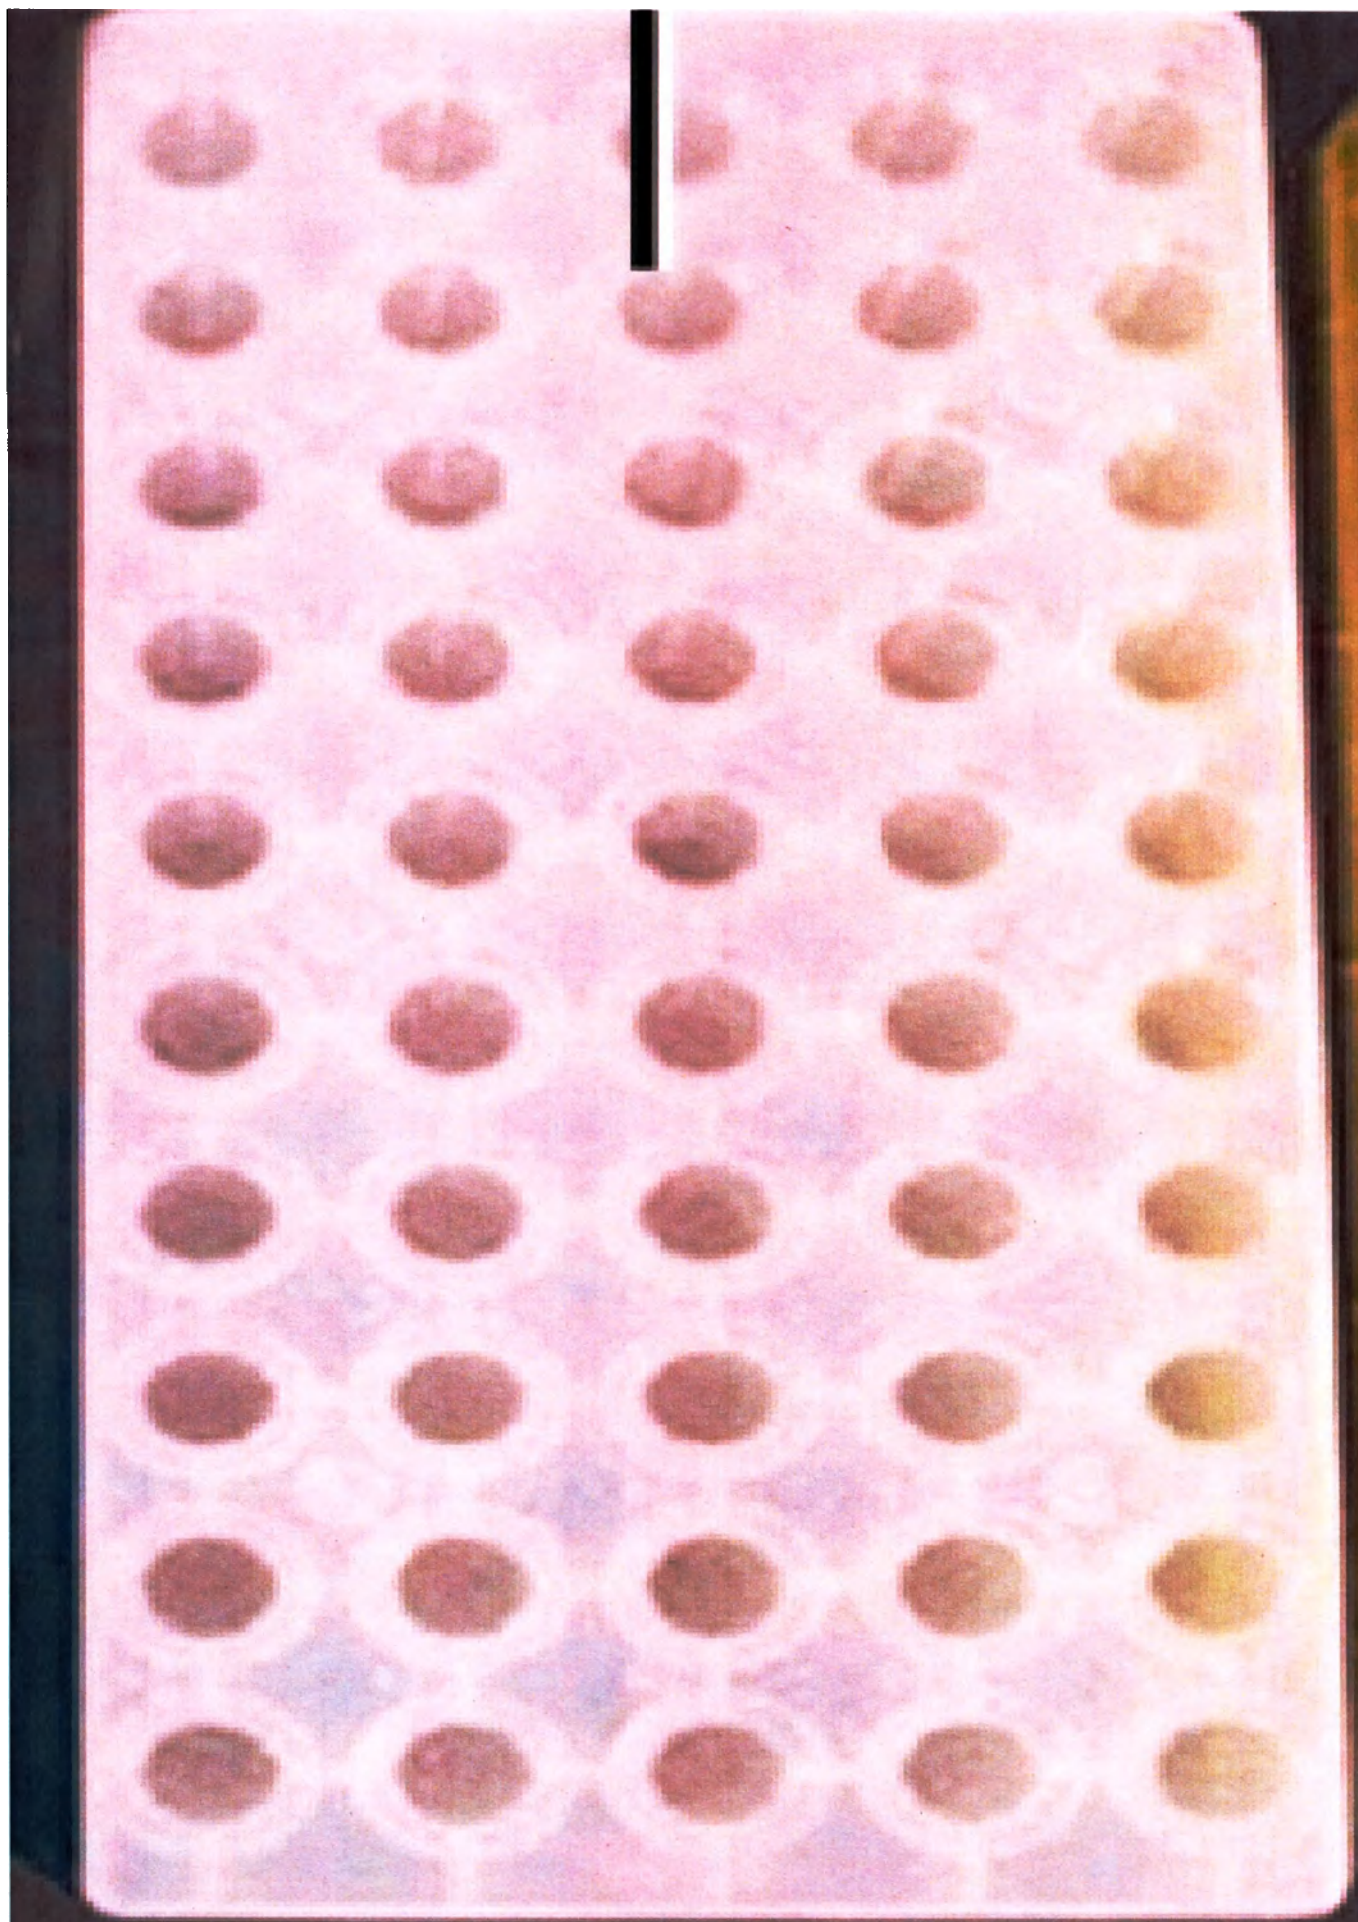


Рисунок 77. Штатив для центрифугированных пробирок.



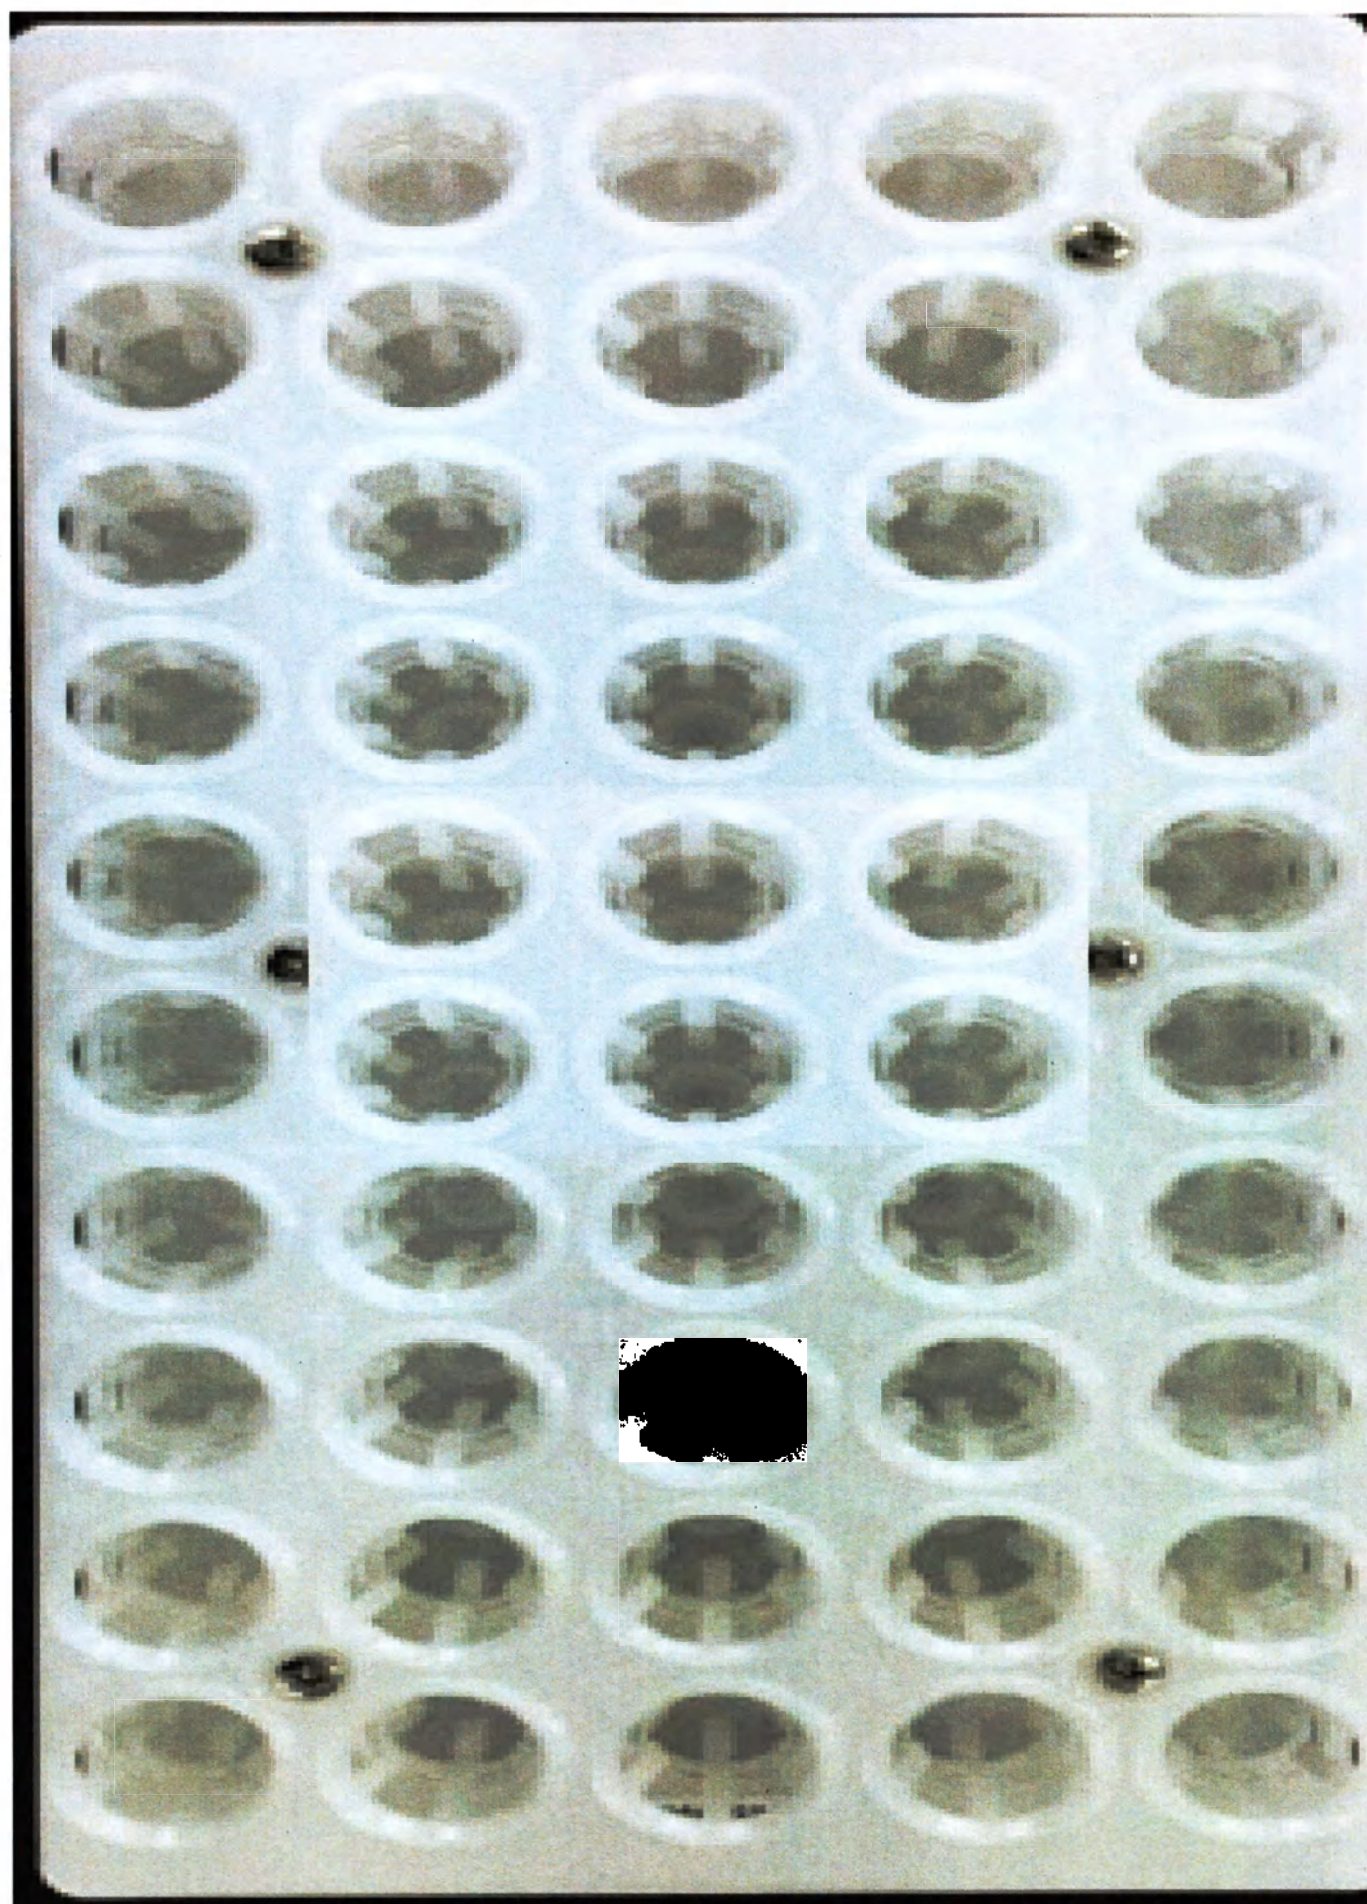


Рисунок 78. Штатив для центрифугированных пробирок, легковесный.




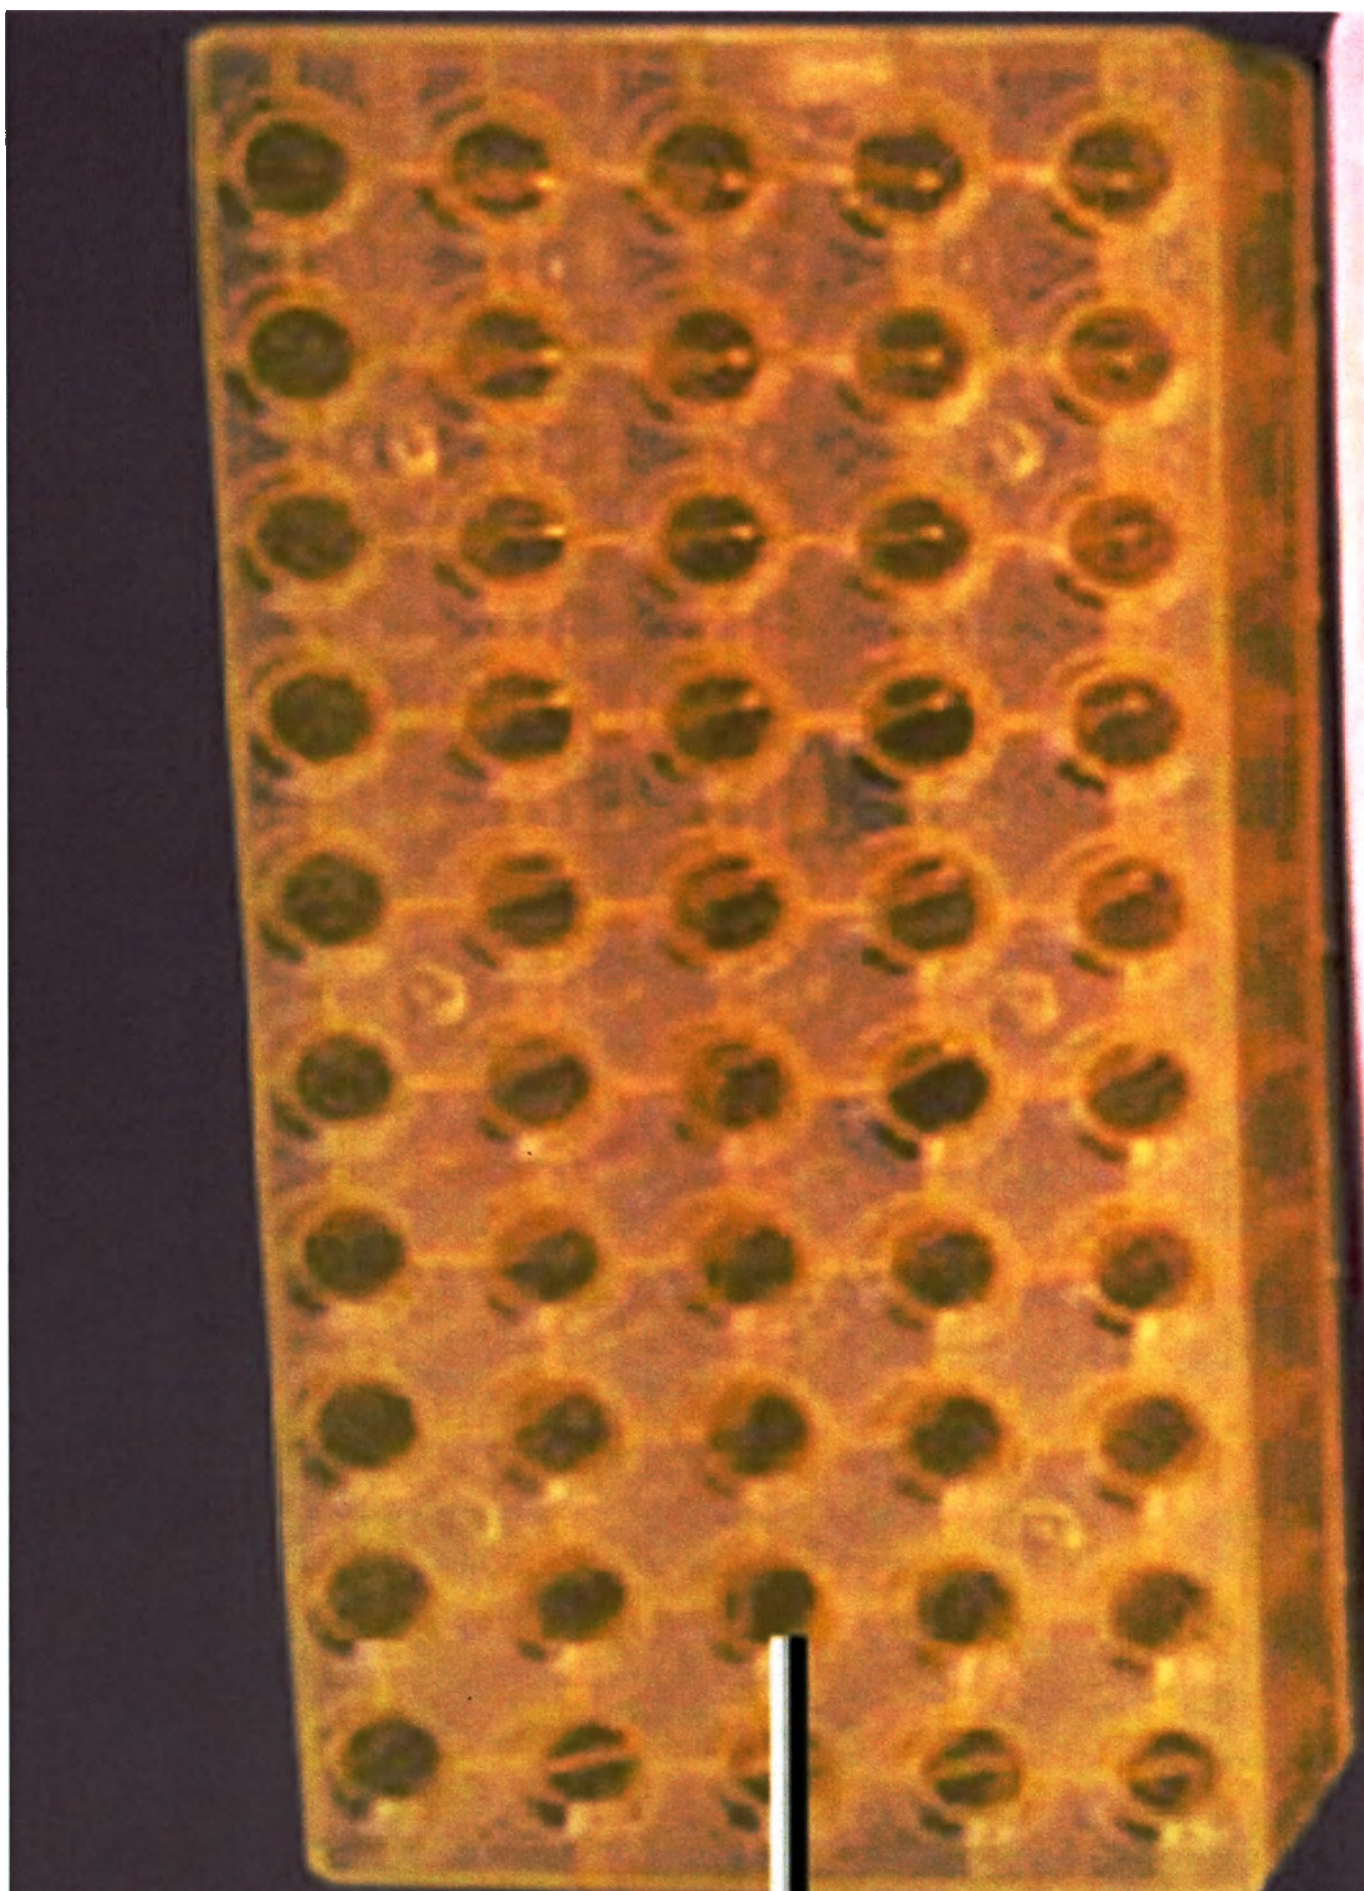


Рисунок 79. Штатив для повторной постановки пробирок.



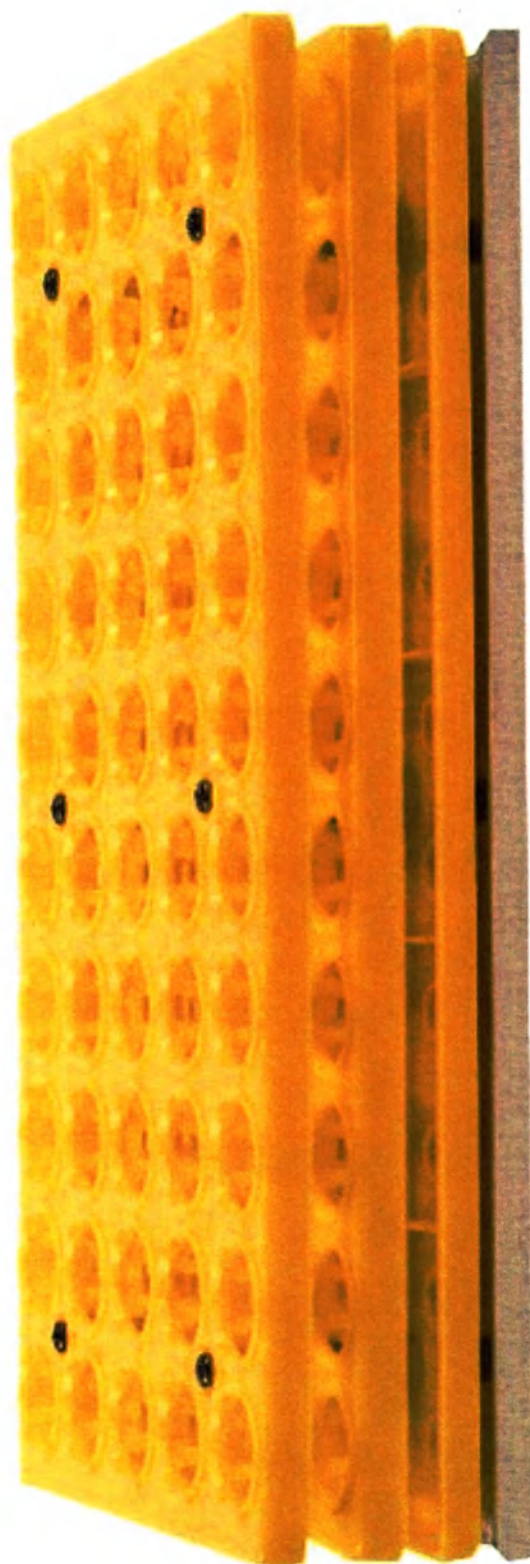

**Рисунок 80. Штатив для повторной постановки пробирок, легковесный.**



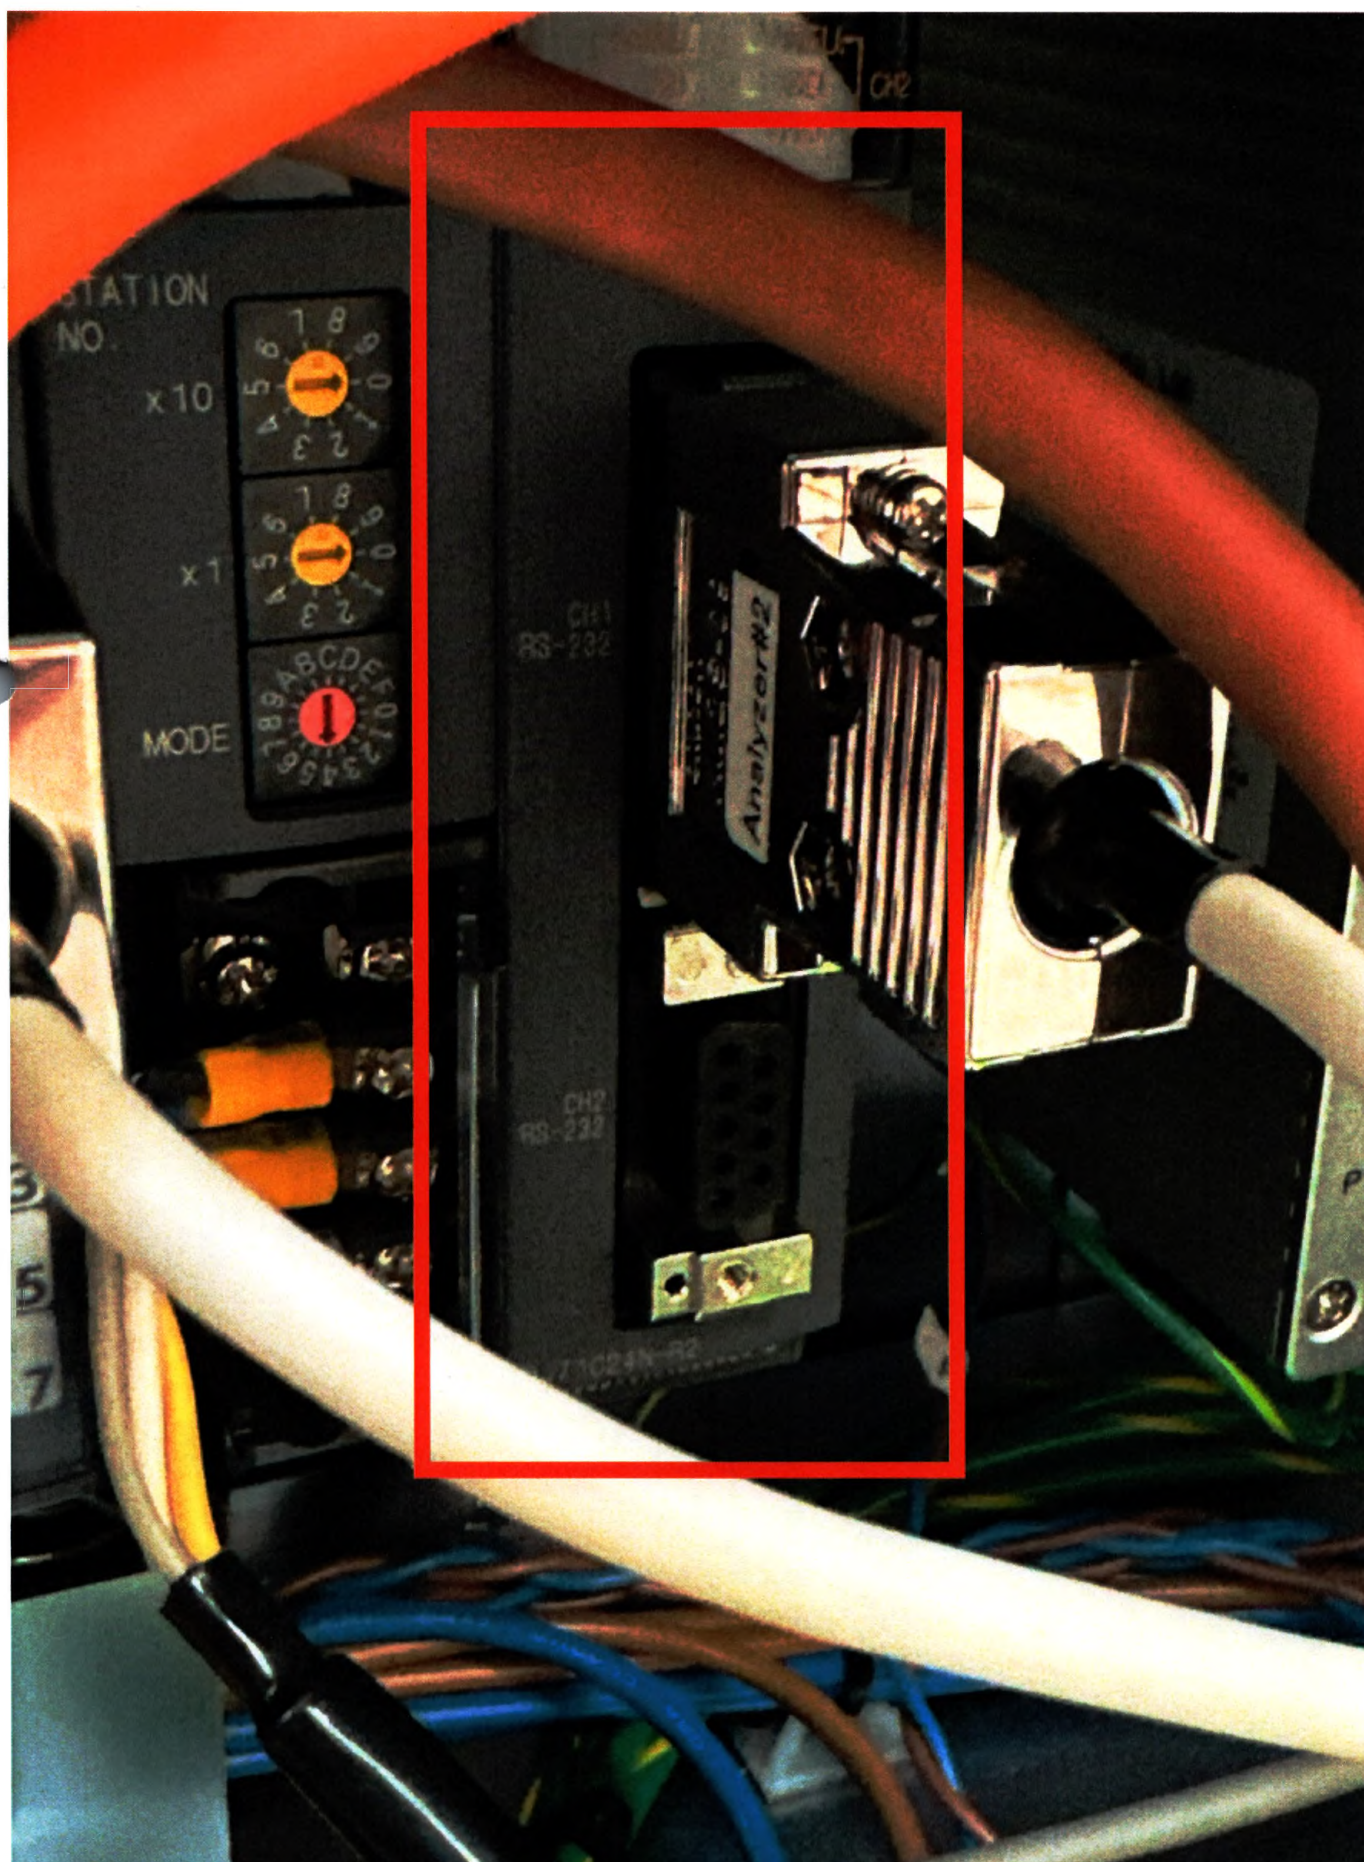


Рисунок 81. Контроллер для линии Т 900 (4-4).



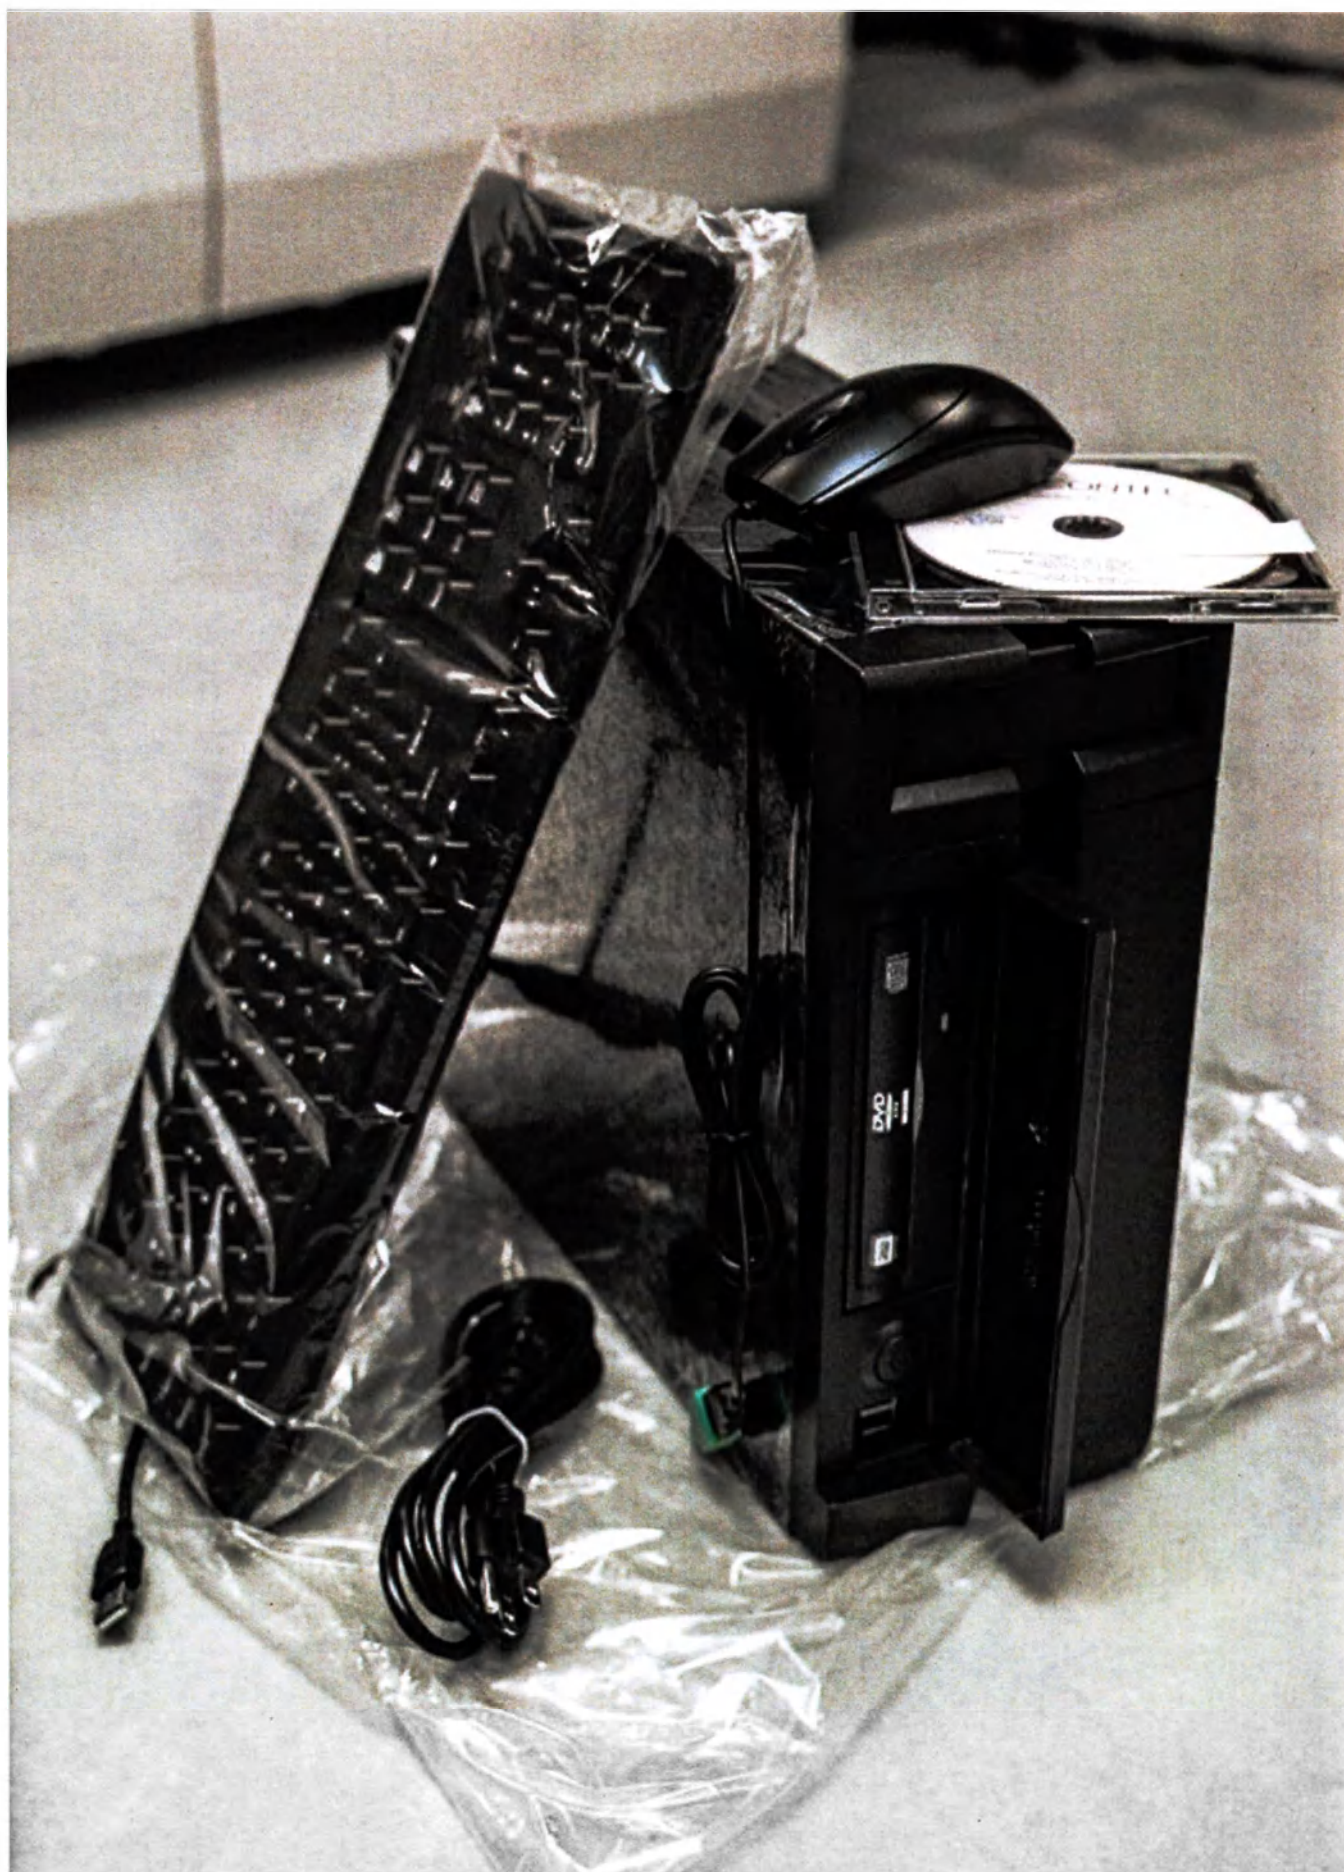


Рисунок 82. Управляющий компьютер с ПО Sennexus.





**Рисунок 83. Монитор.**





Рисунок 84. Модуль питания - не более 5 шт.



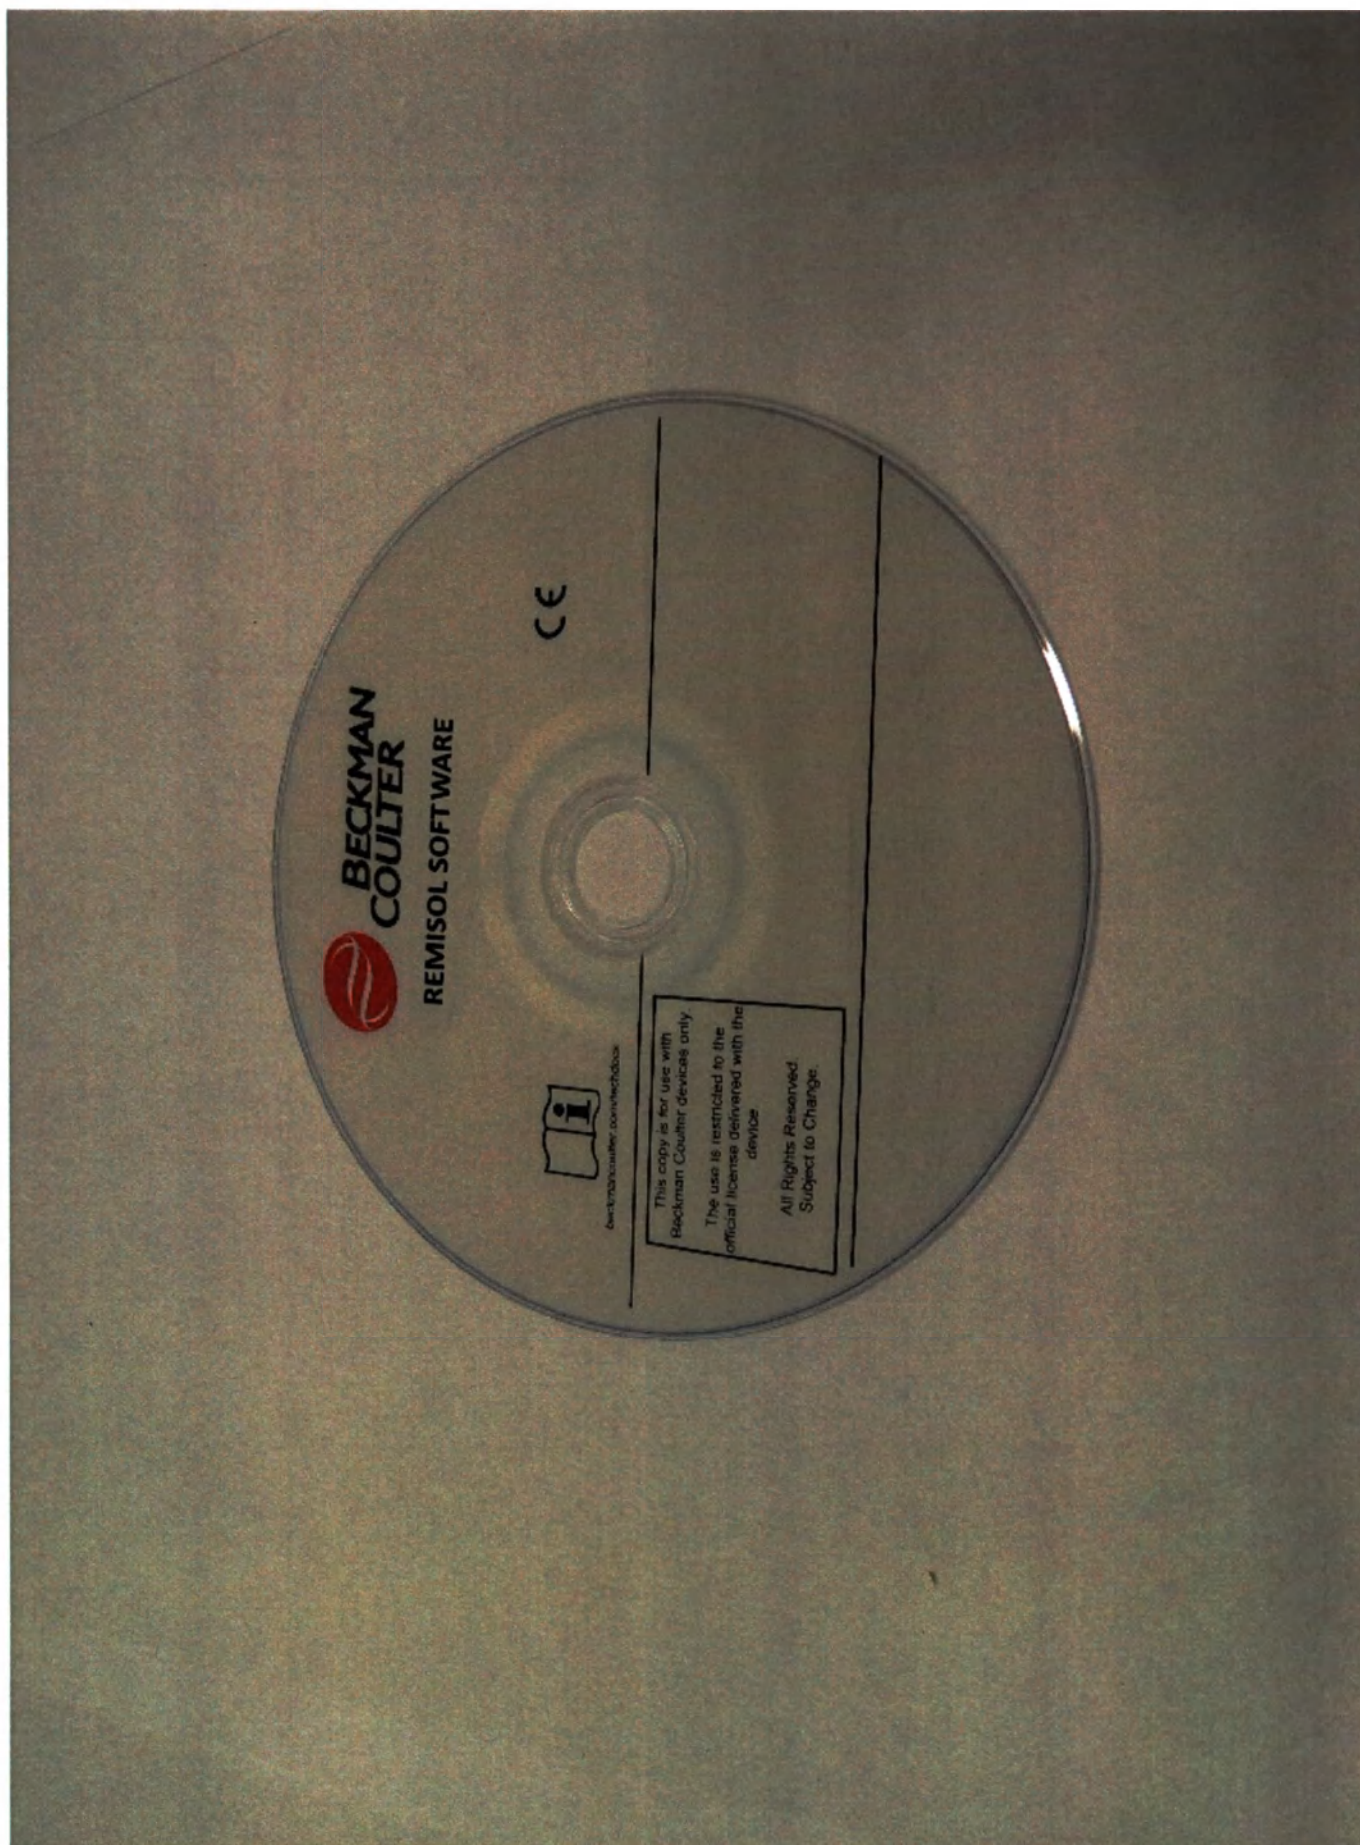


Рисунок 85. Программное обеспечение Remisol.



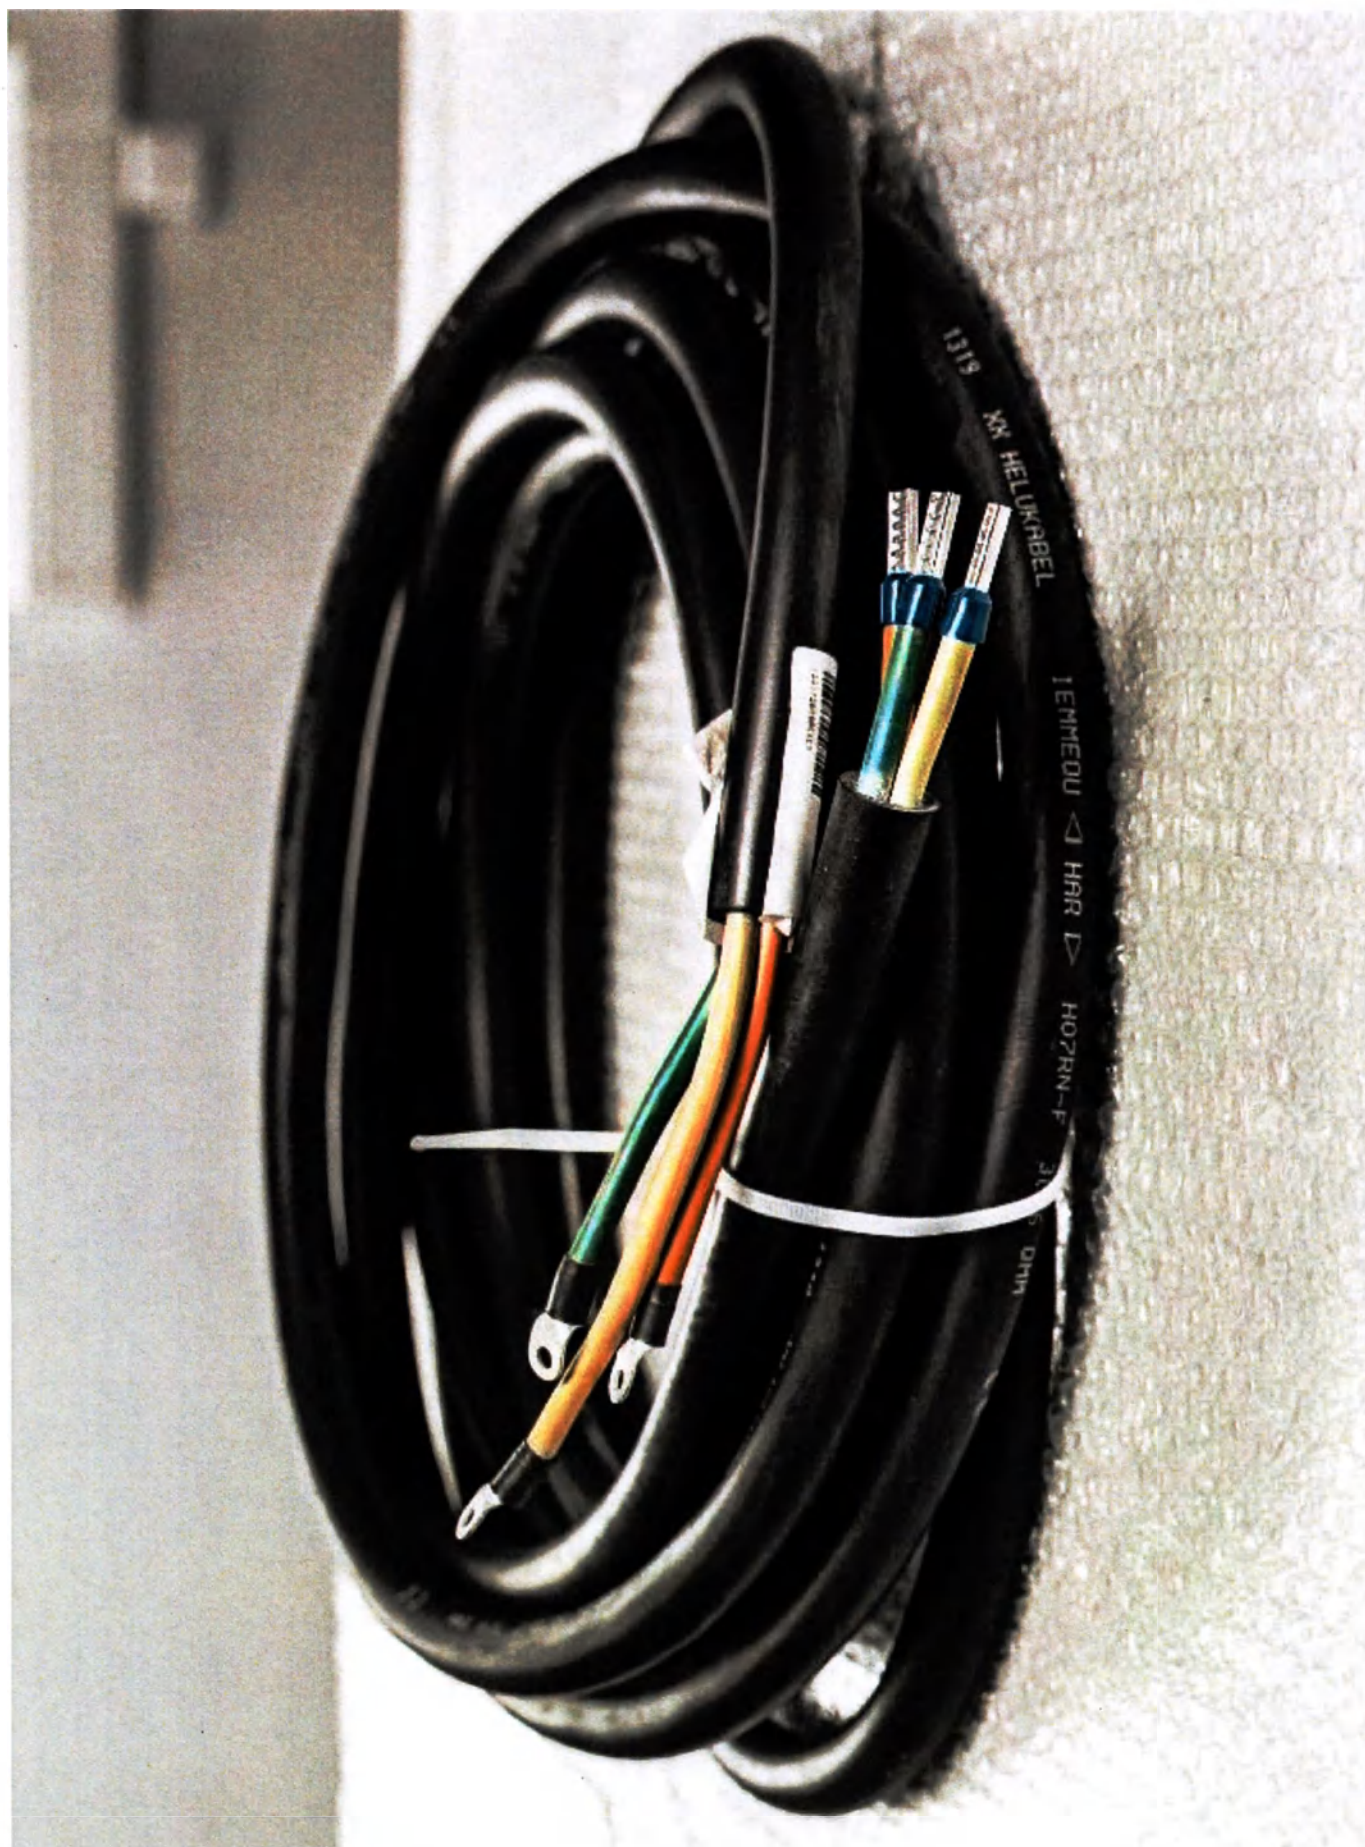


Рисунок 86. Кабель питания.






**Рисунок 87. Кабель для подключения - не более 30 шт.**






Рисунок 88. Кабель-переходник - не более 30 шт.



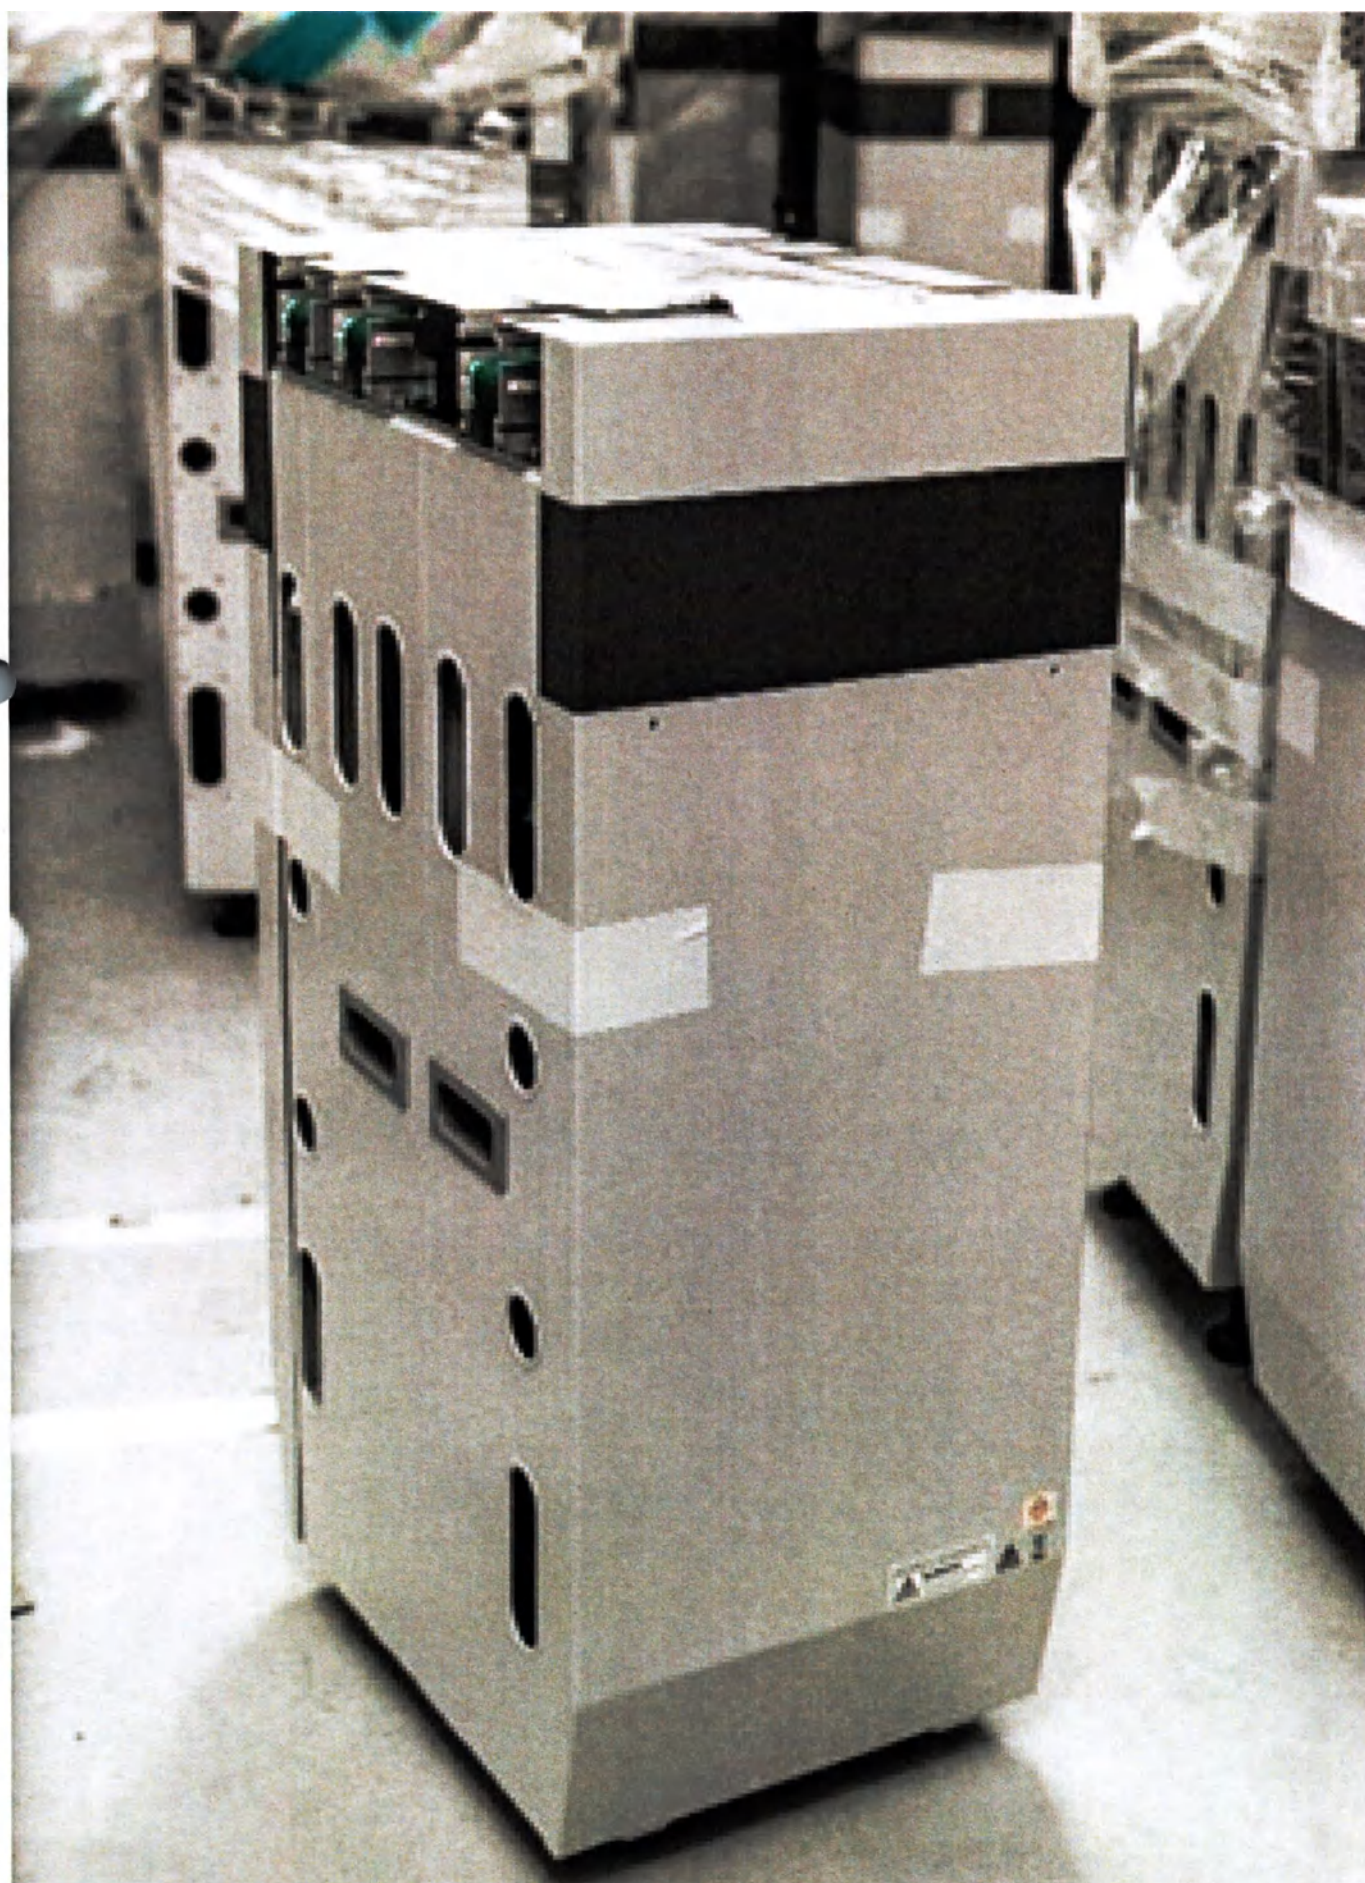

**Рисунок 89. Линии объединительные для модуля центрифугирования без контроля температуры.**



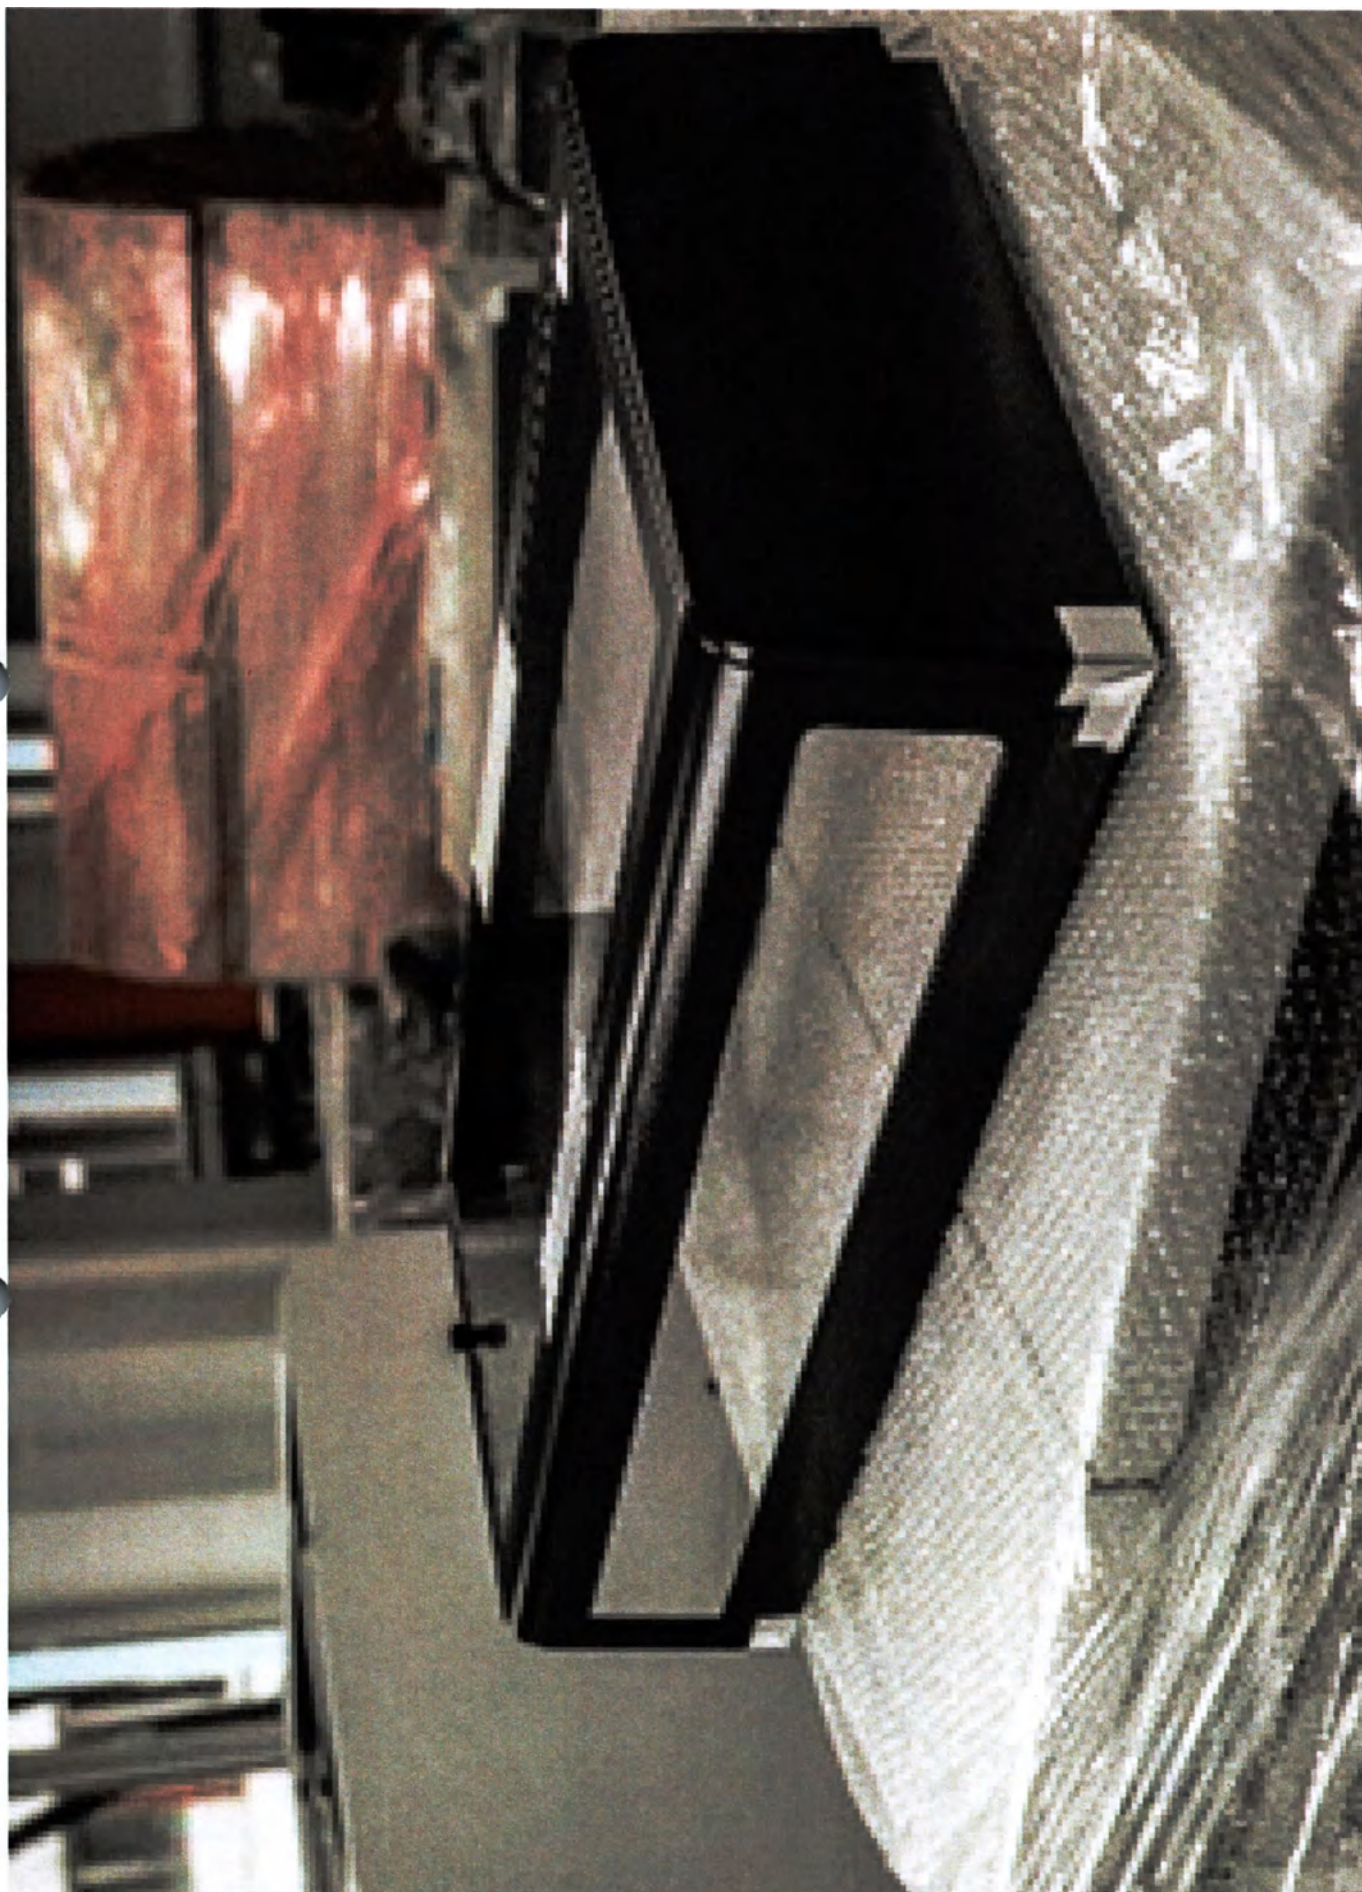

**Рисунок 90. Крышки для линии объединительной для модуля центрифугирования без контроля температуры.**



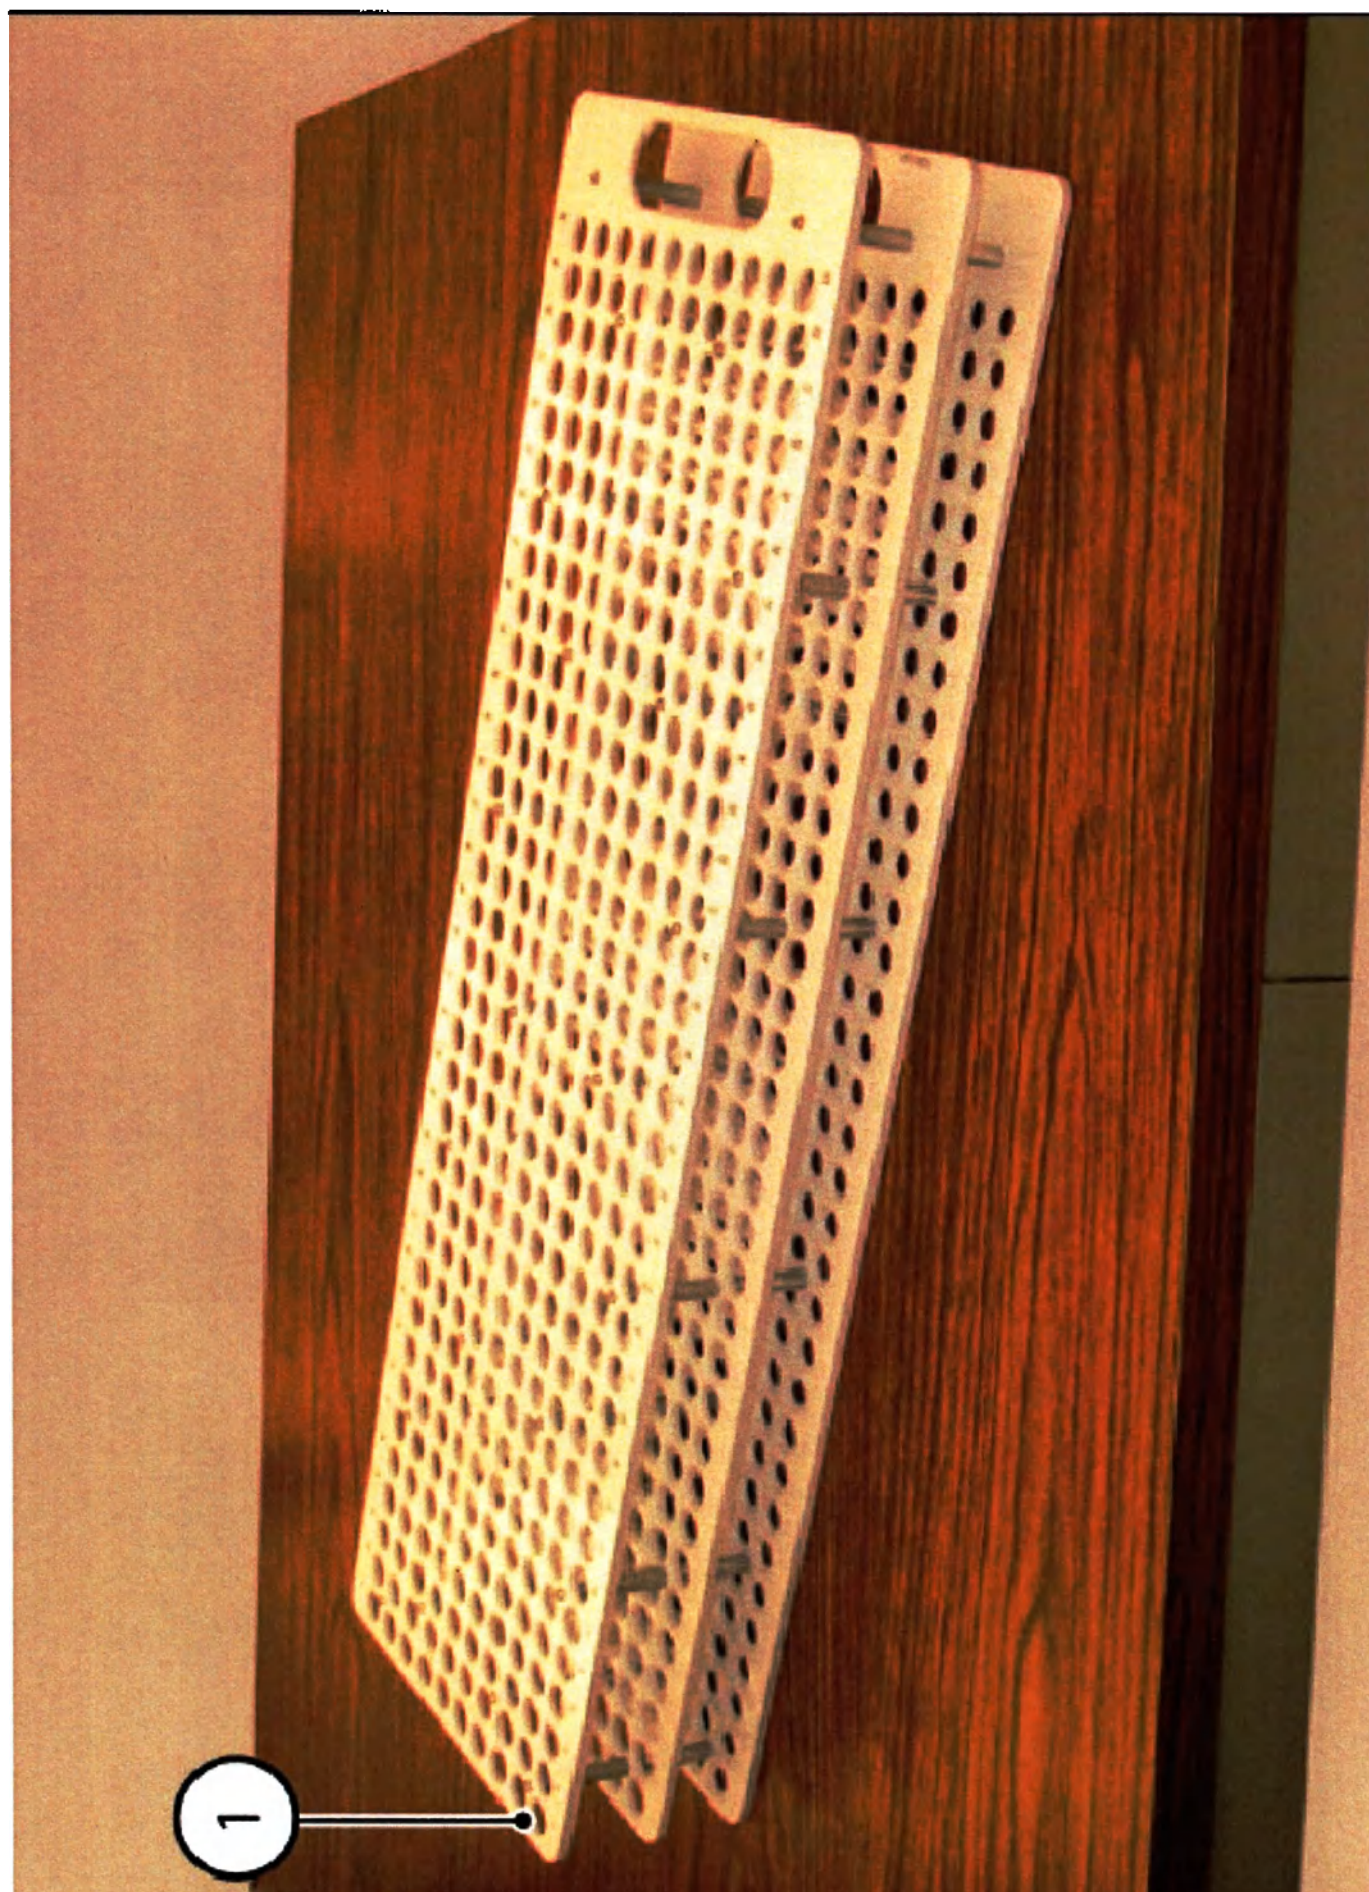


Рисунок 92. Штатив для пробирок 13x100.



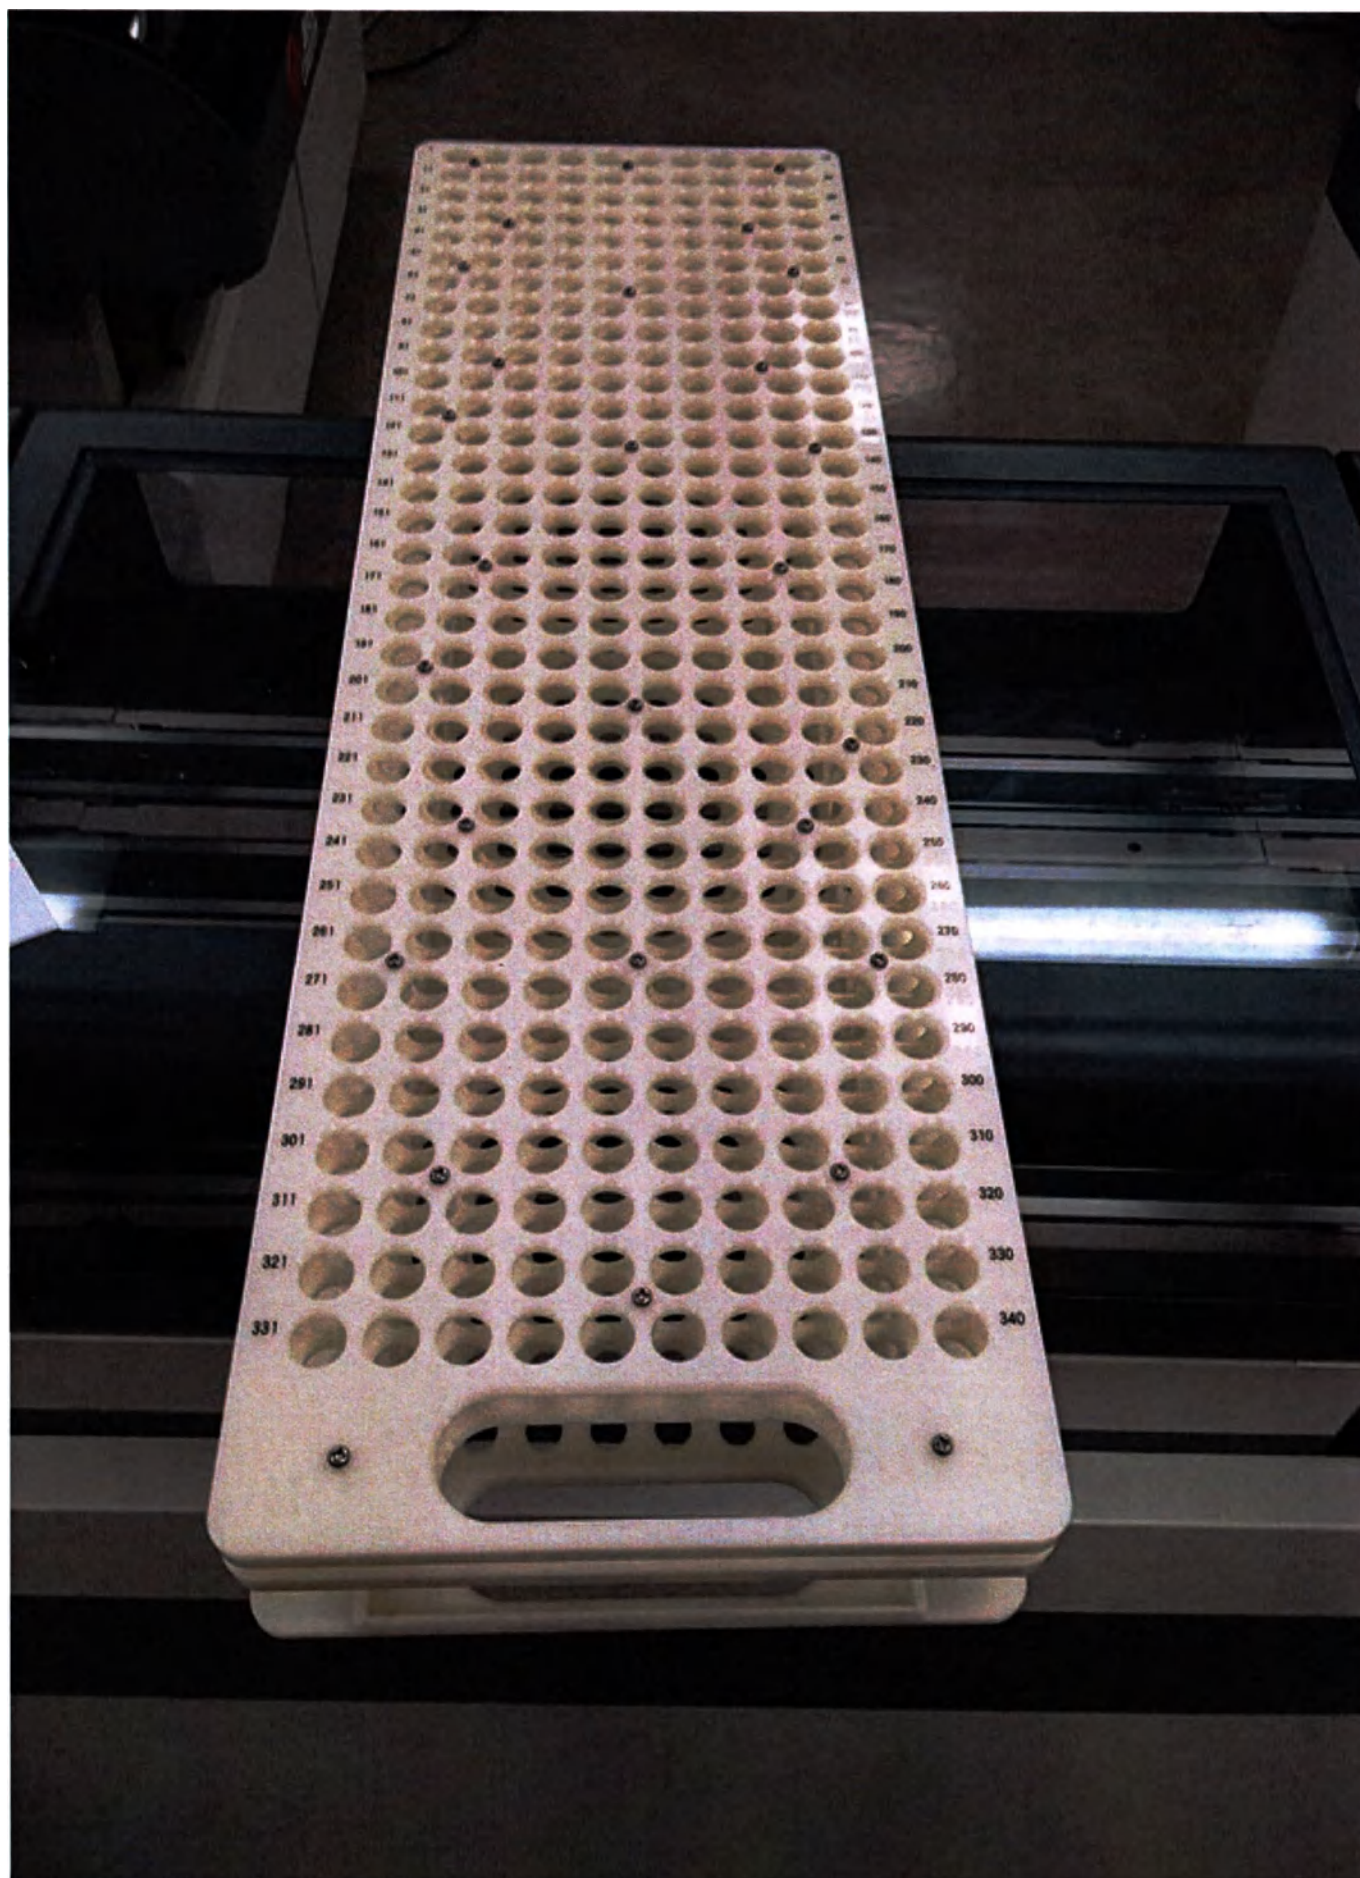


Рисунок 93. Штатив для пробирок 13x75.



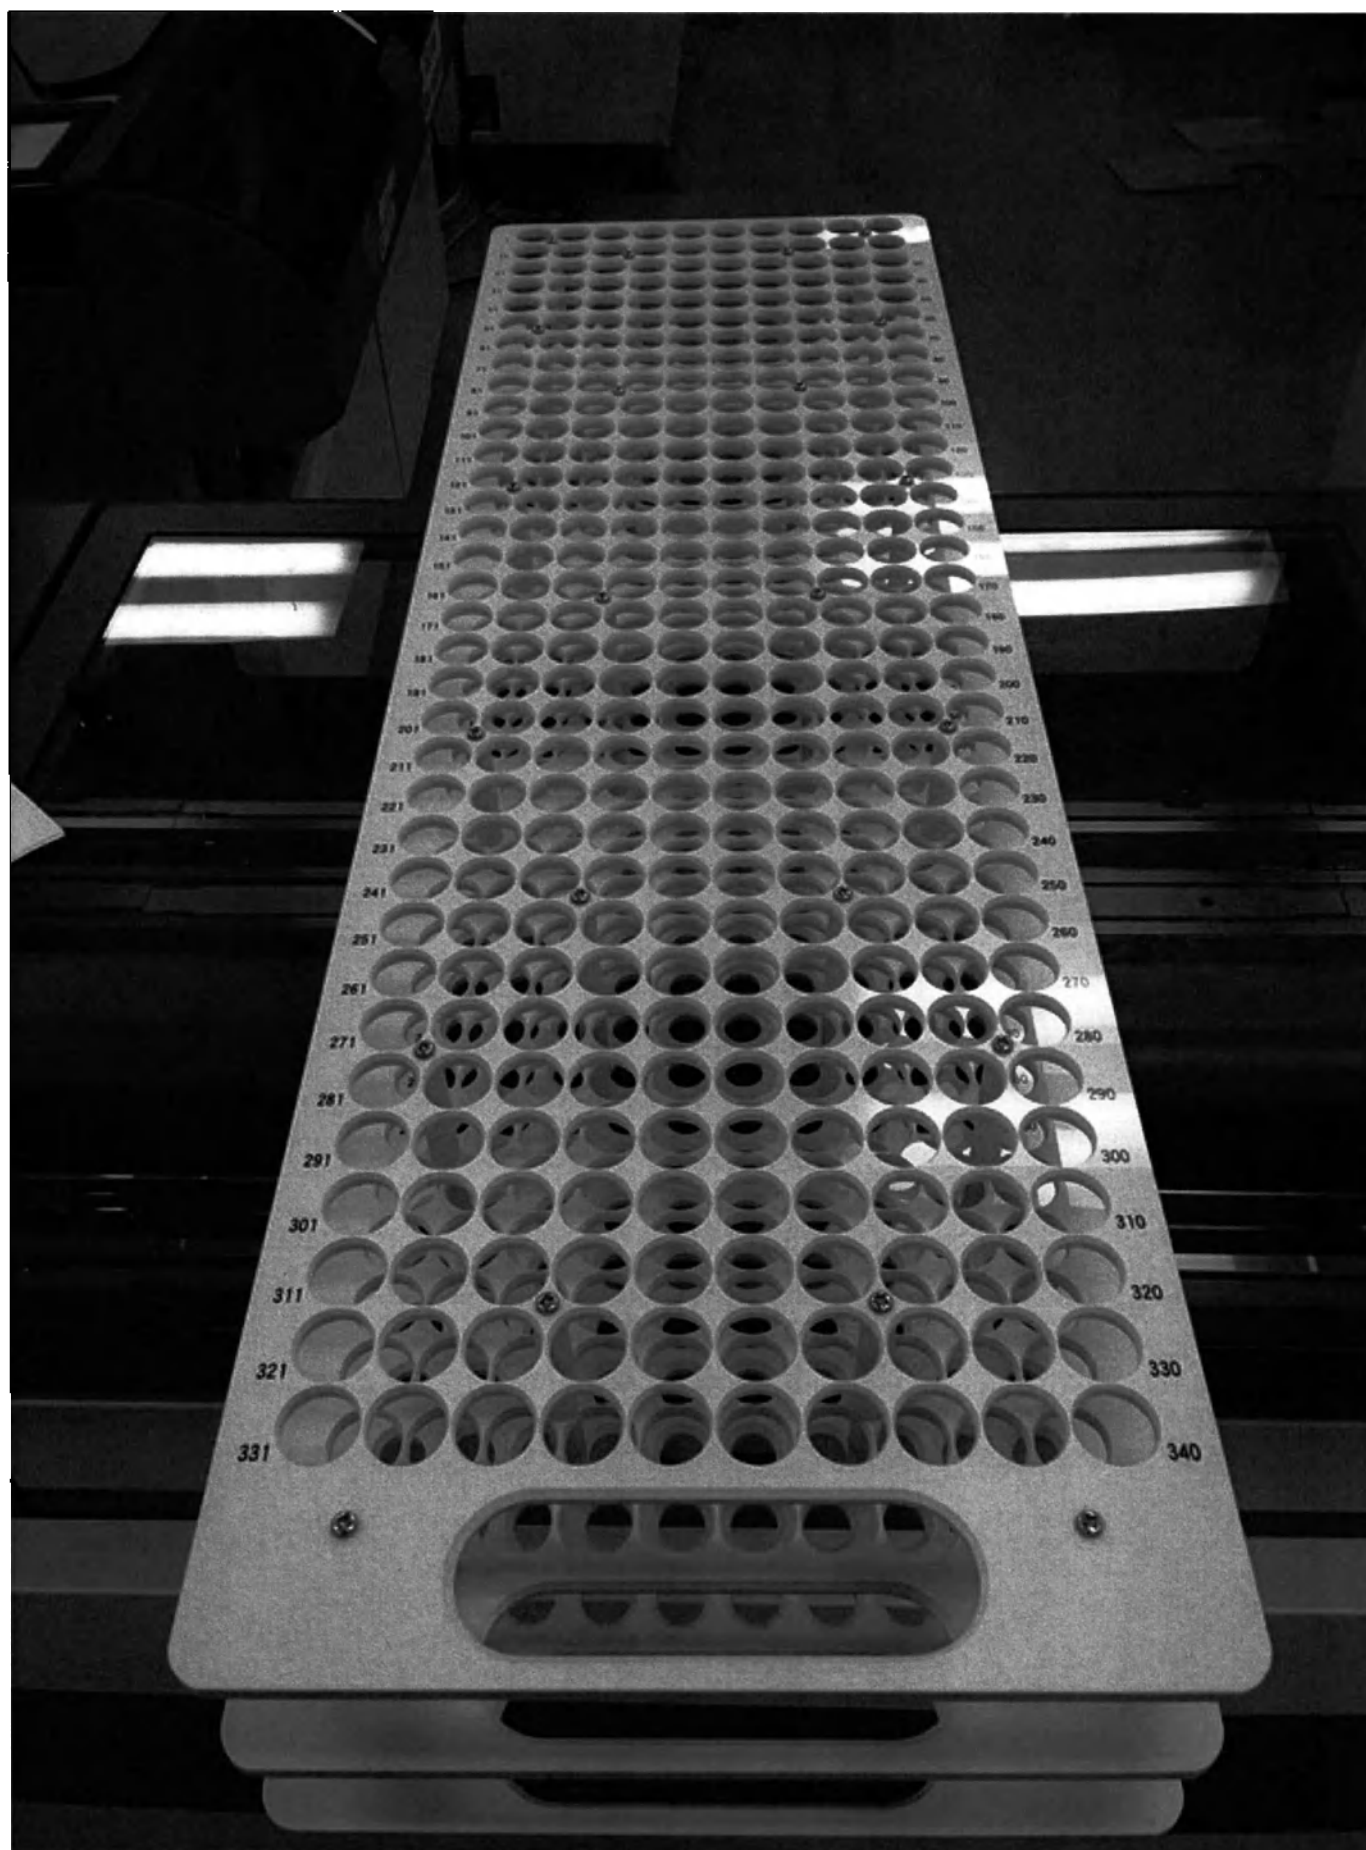


Рисунок 94. Штатив для пробирок 16х100.





**Рисунок 95. Крышки стандартные для модуля повторной установки крышек.**



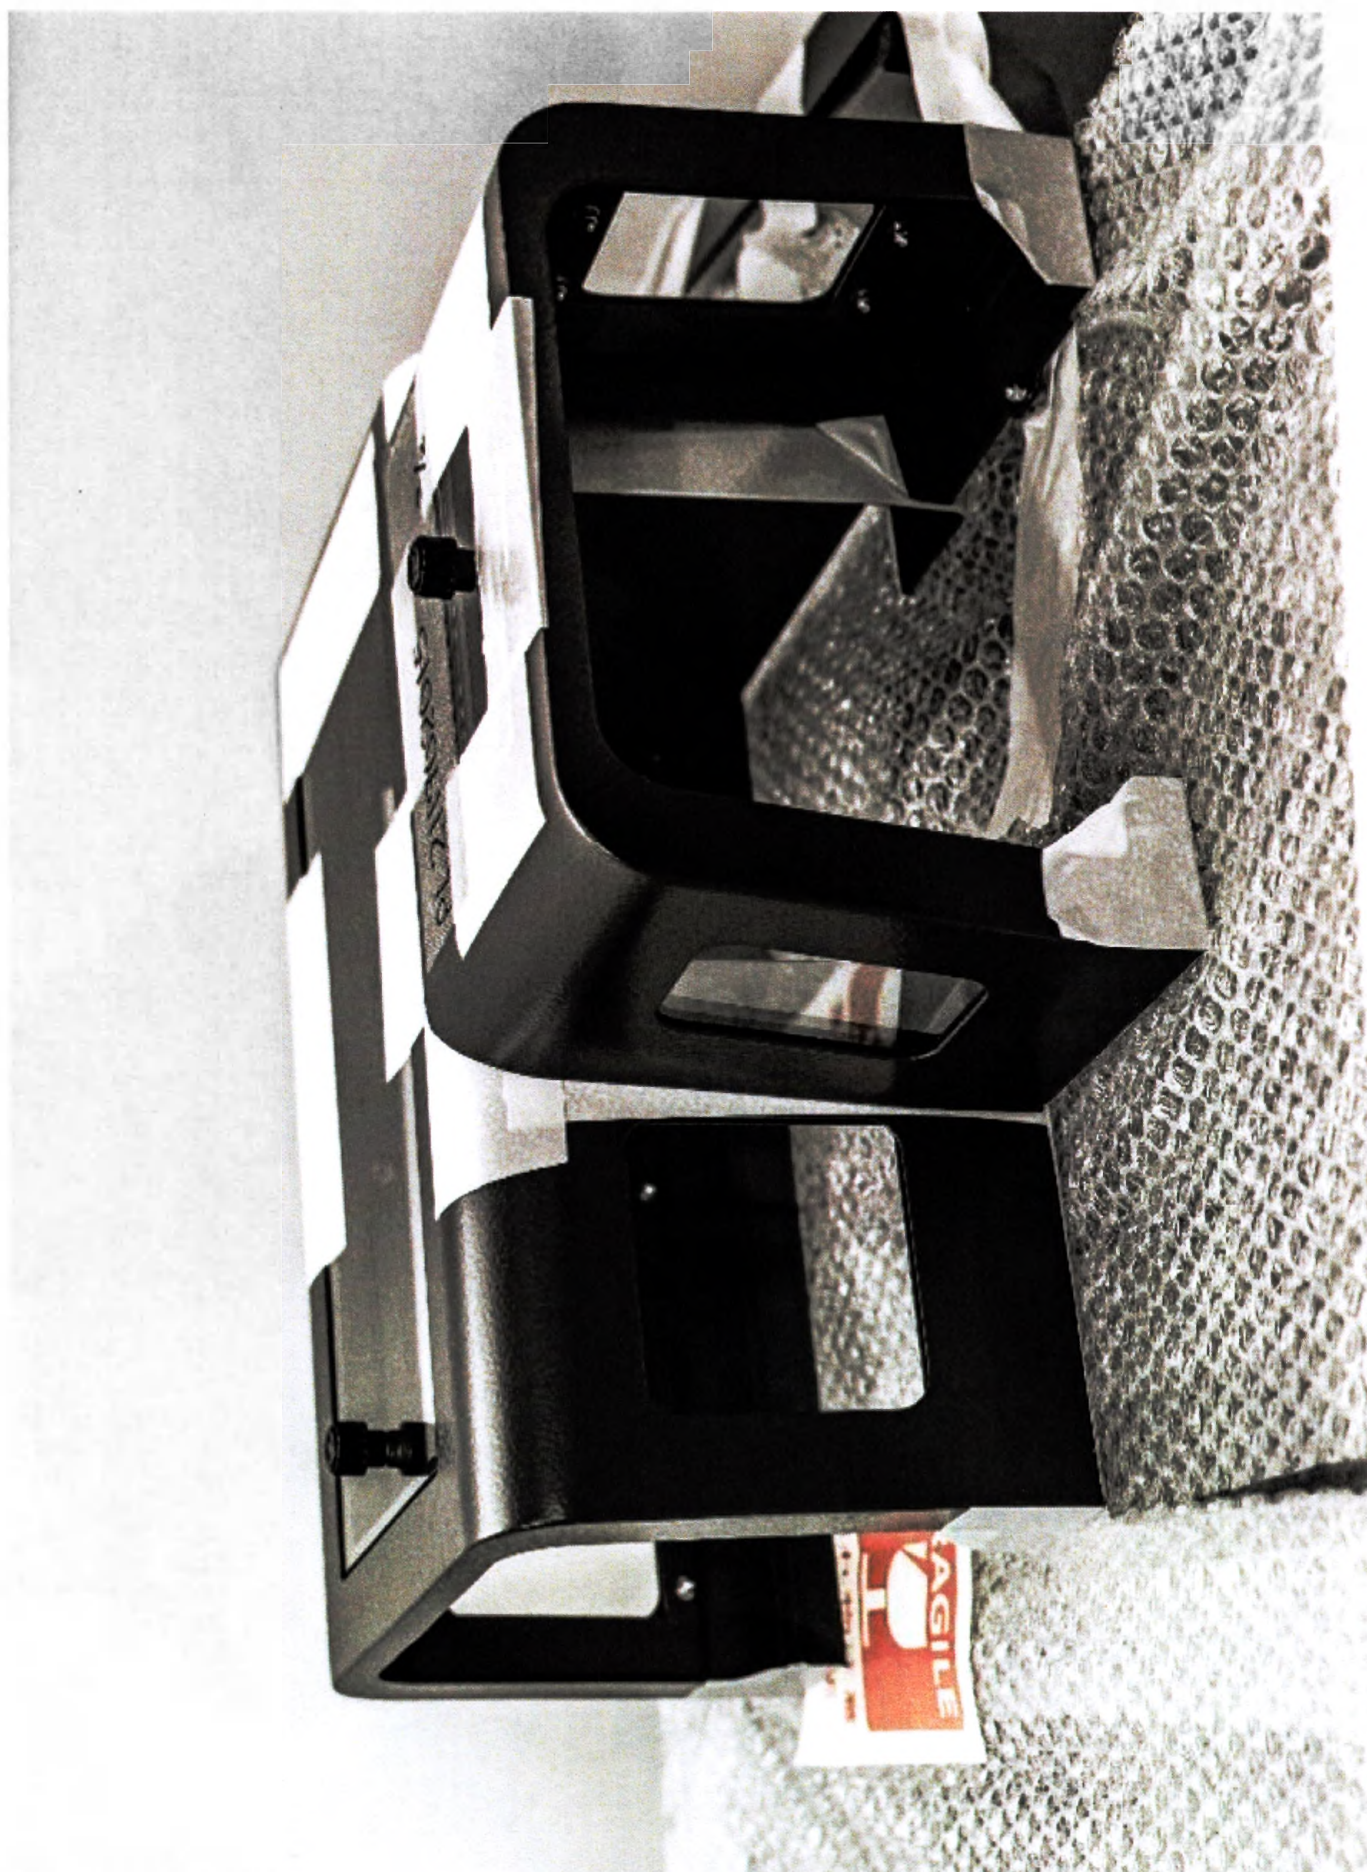



Рисунок 96. Крышка для линии L 1200 (4-4) без подставки.





**Рисунок 97. Роторы.**



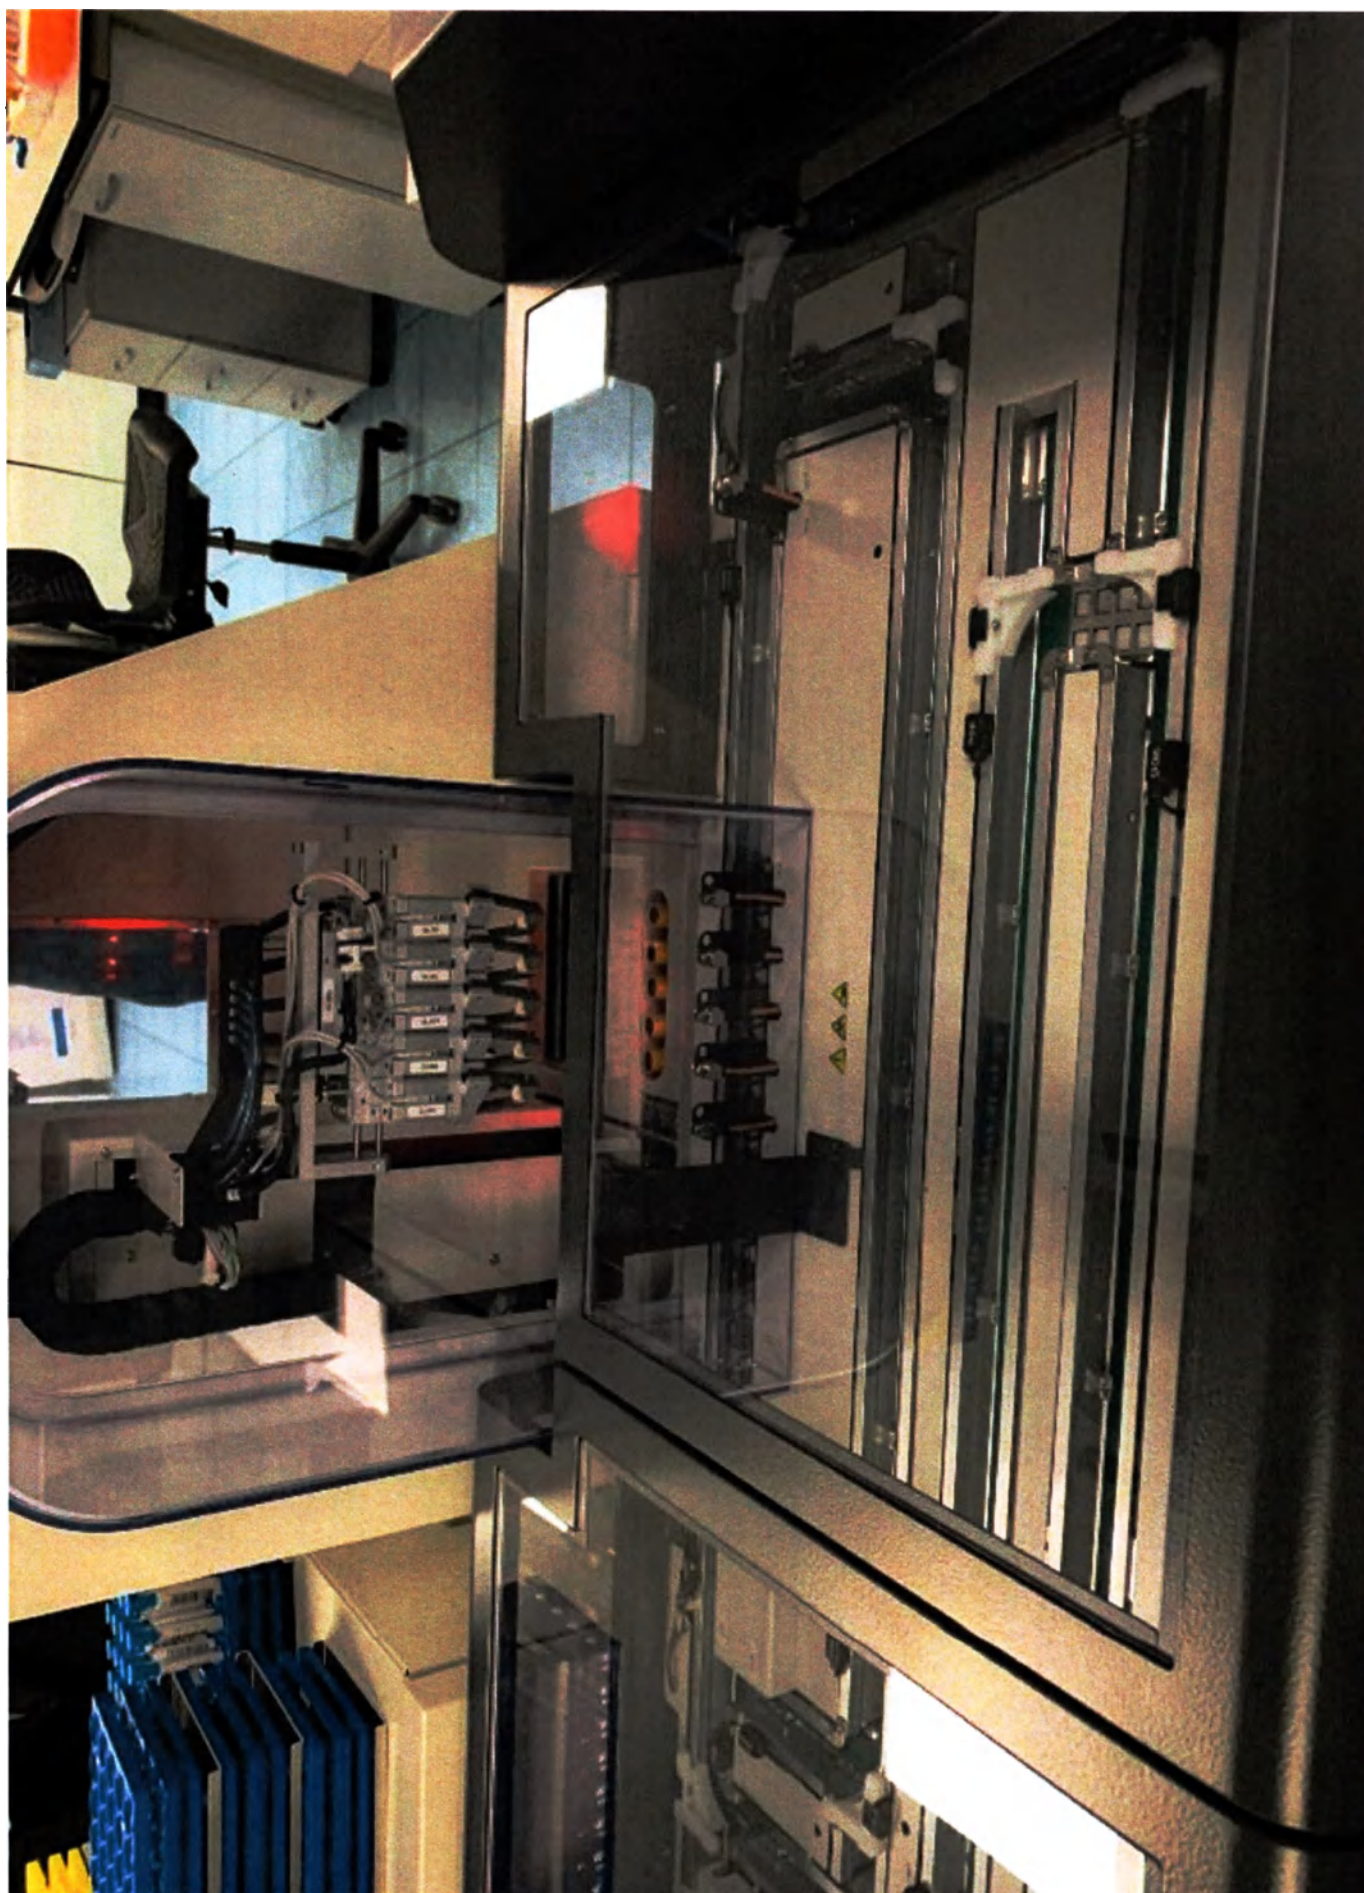

**Рисунок 98. Линии D 1 для центрифуги с контроллером температуры, Линии D 2 для центрифуги с контроллером температуры.**



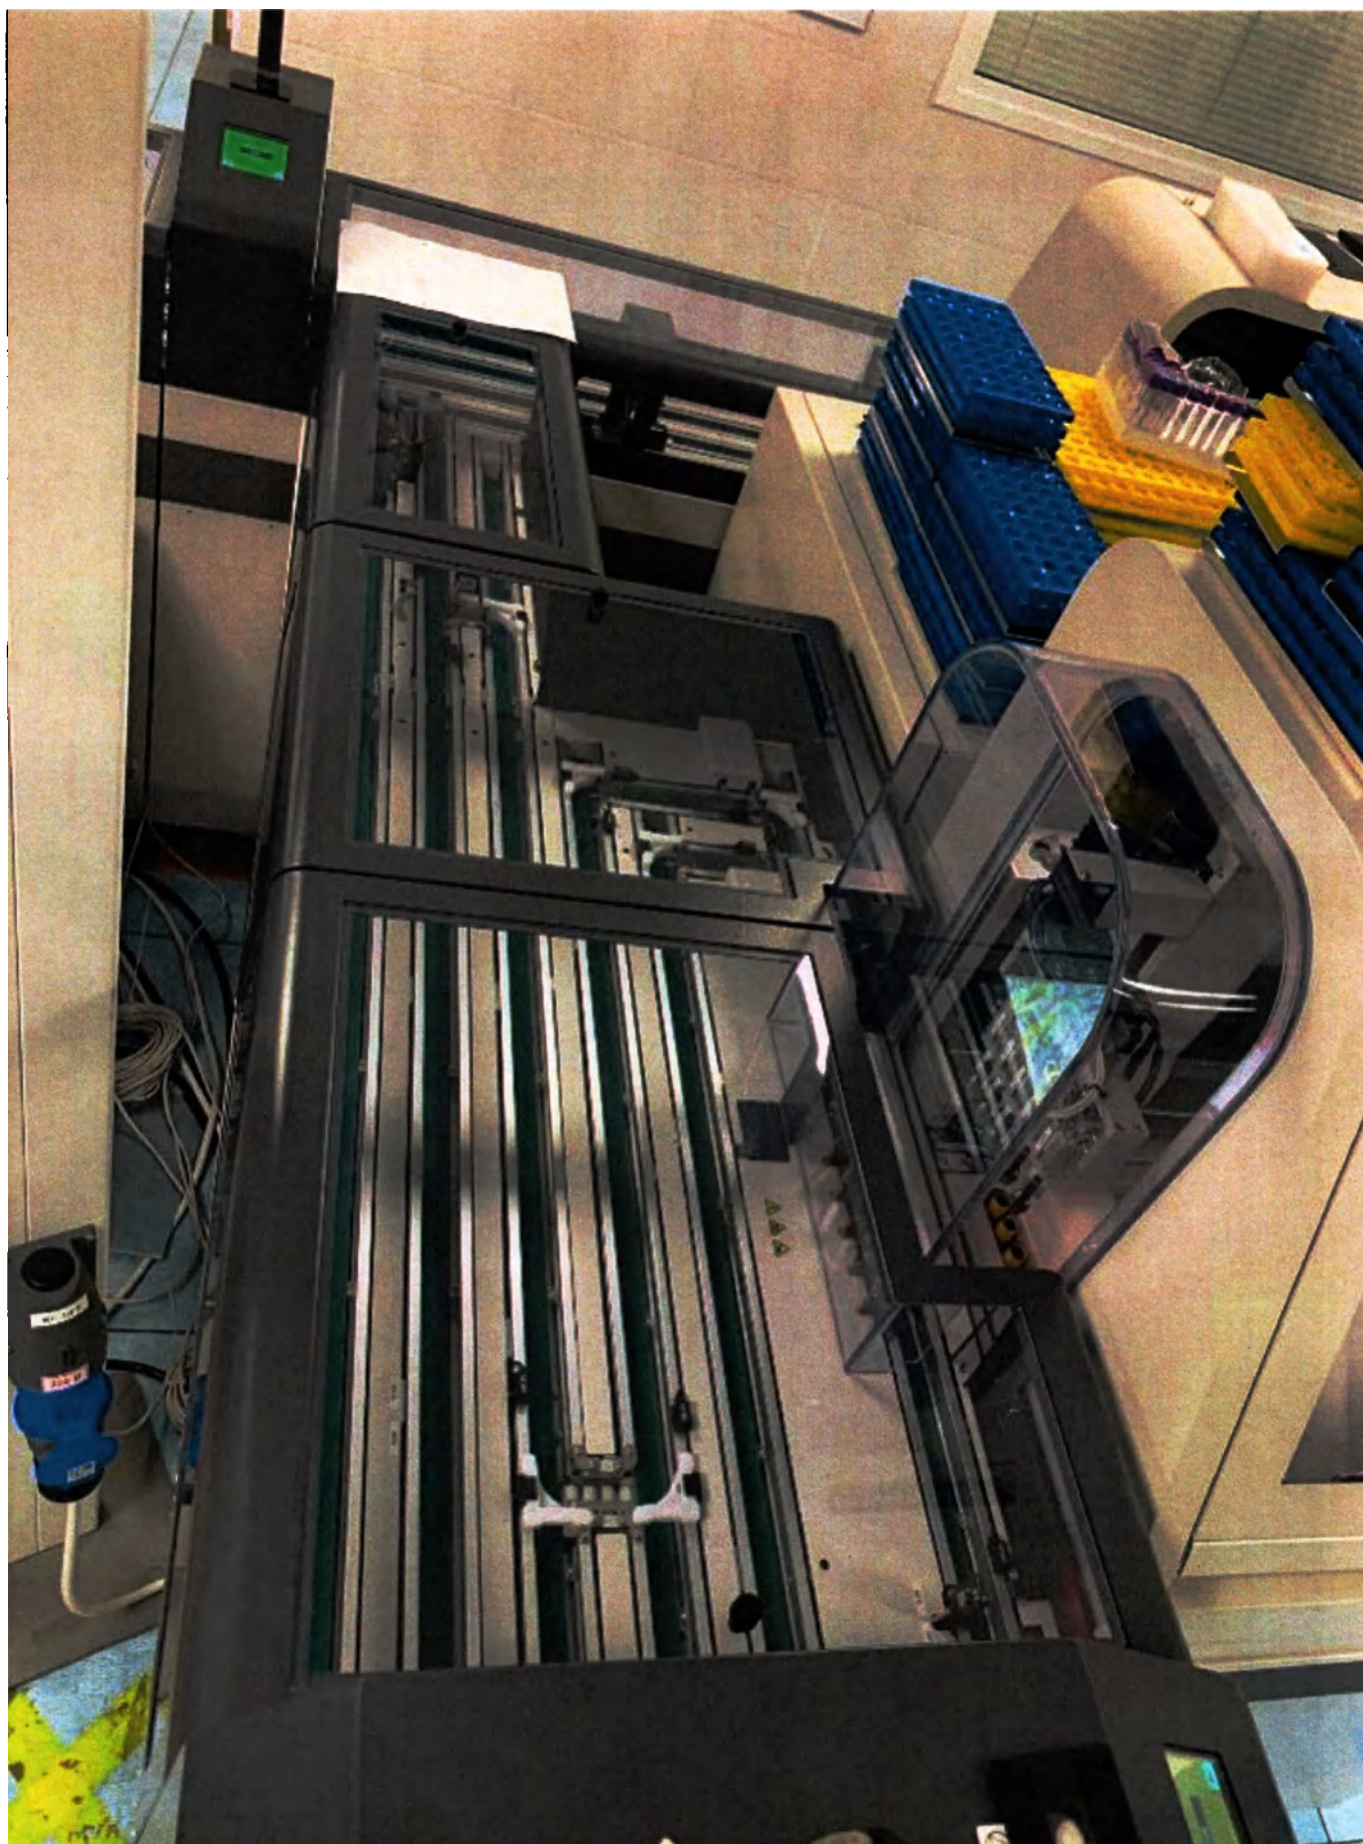


Рисунок 99. Крышки для линии D 1 для центрифуги с контроллером температуры, Крышки для линии D 2 для центрифуги с контроллером температуры.



### **Принадлежности:**



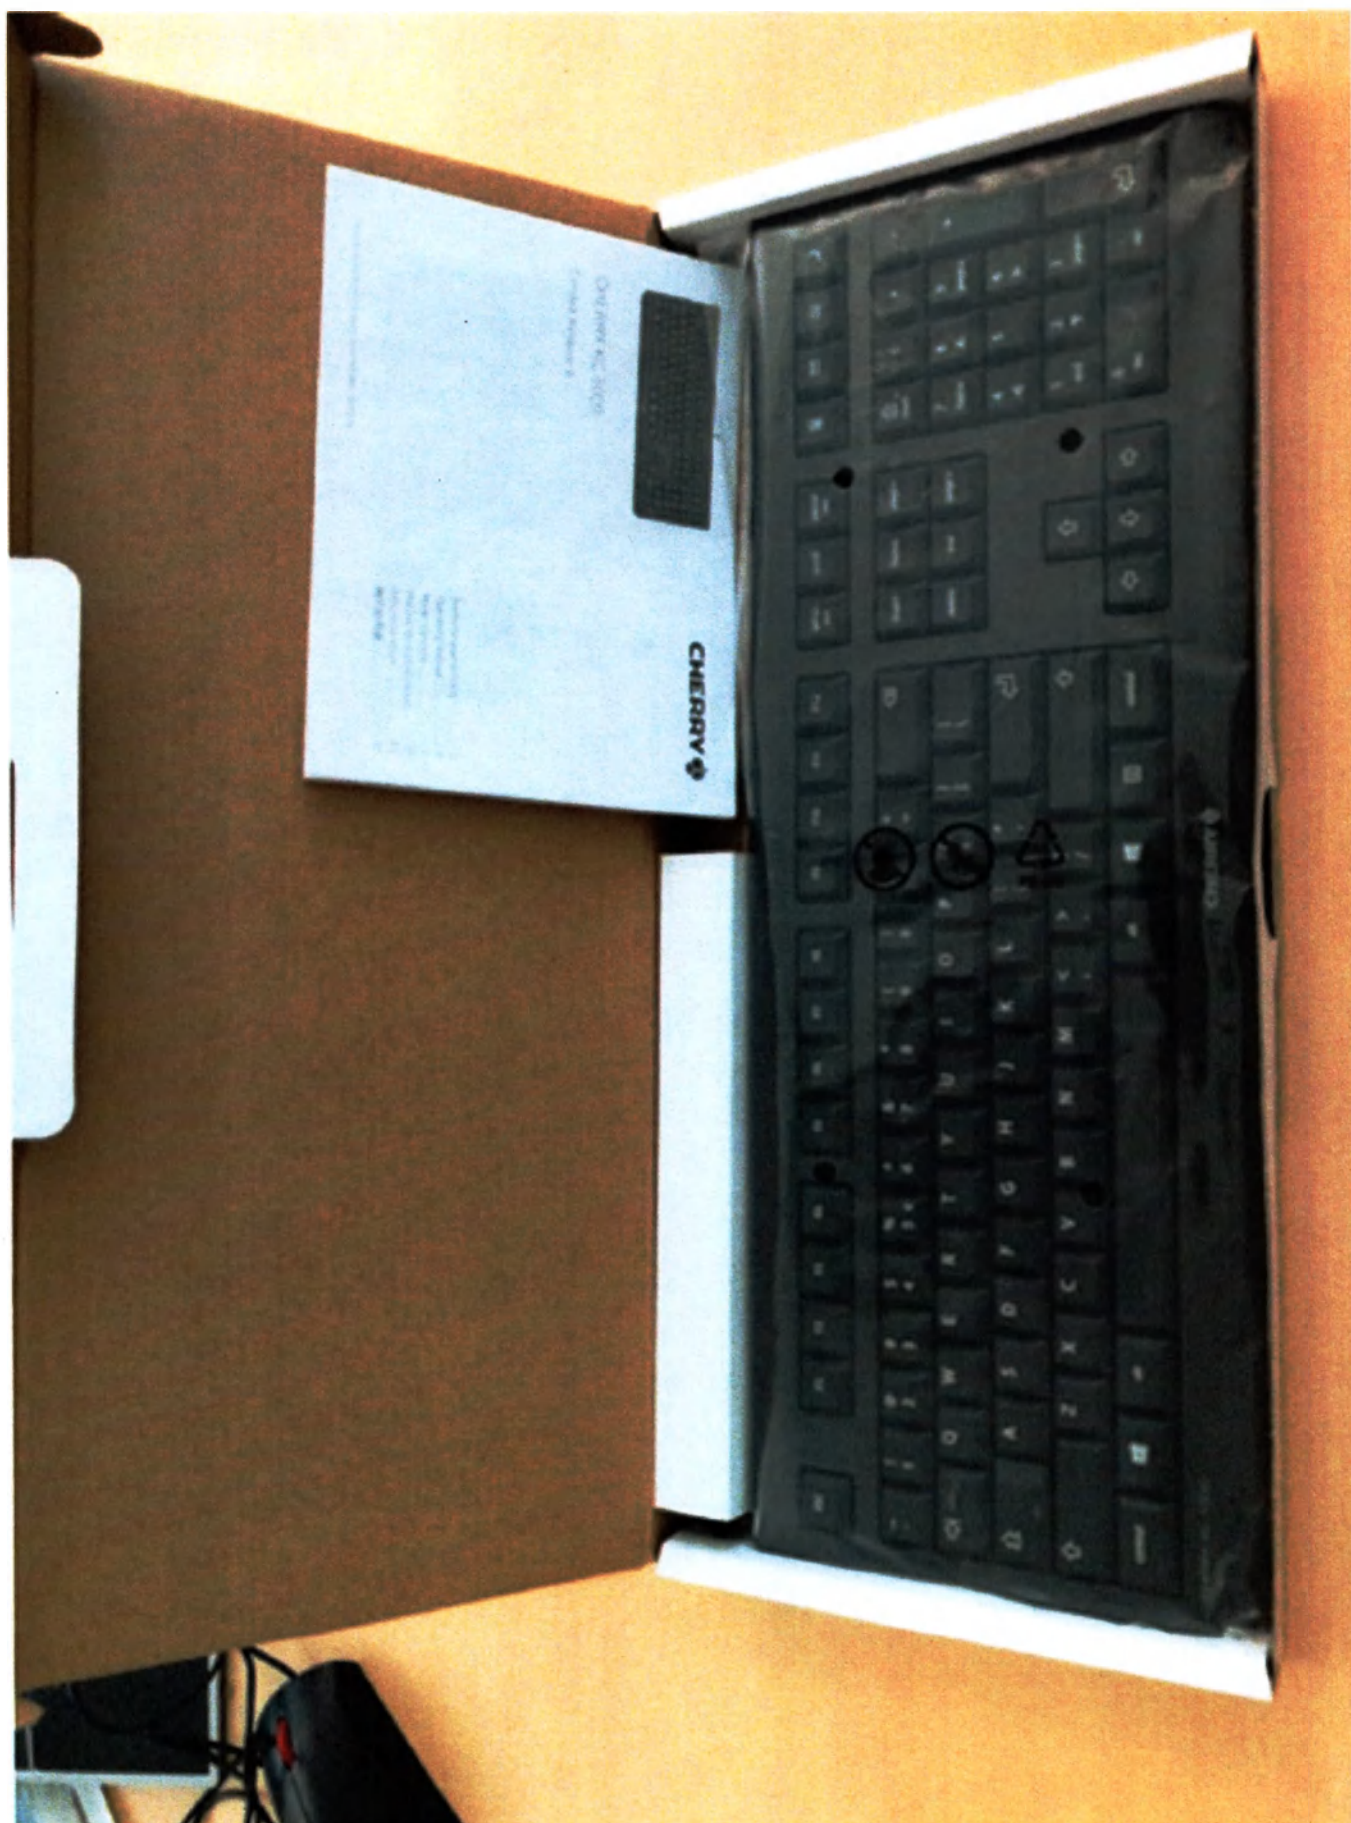


Рисунок 1. Клавиатура.



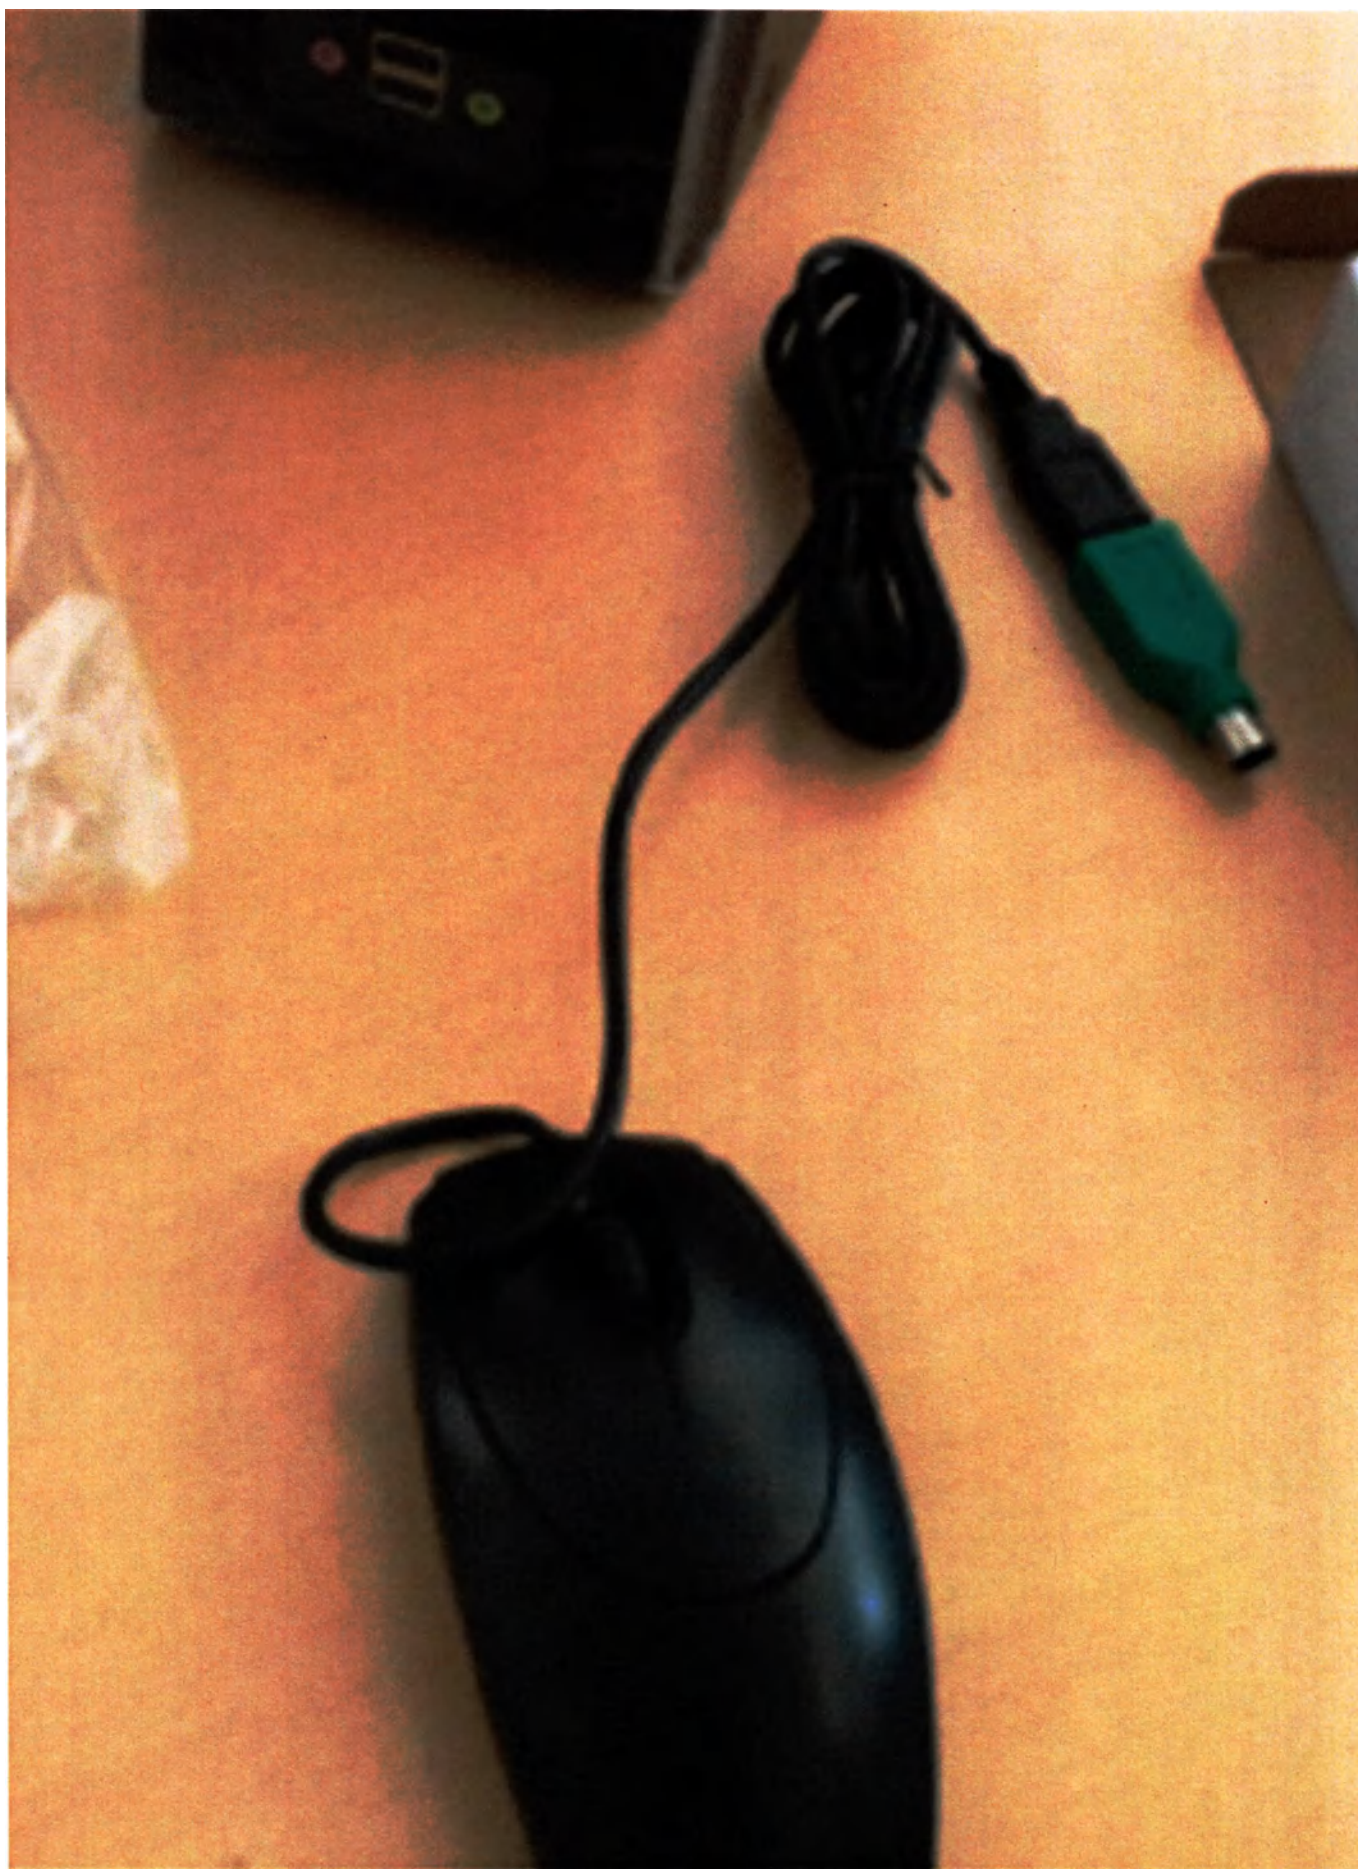


Рисунок 2. Манипулятор типа мышь.





Рисунок 3. Сетевая карта CC-Link.





Рисунок 4. Коммутатор сетевой тип 1.





Рисунок 5. Коммутатор сетевой тип 2.





Рисунок 6. Кабель нуль-модемный.





Рисунок 7. Кабель RJ 45.





Рисунок 8. Стойка для компьютера и монитора.






Рисунок 9. Крышка универсальная.





Рисунок 10. Крышка голубая.



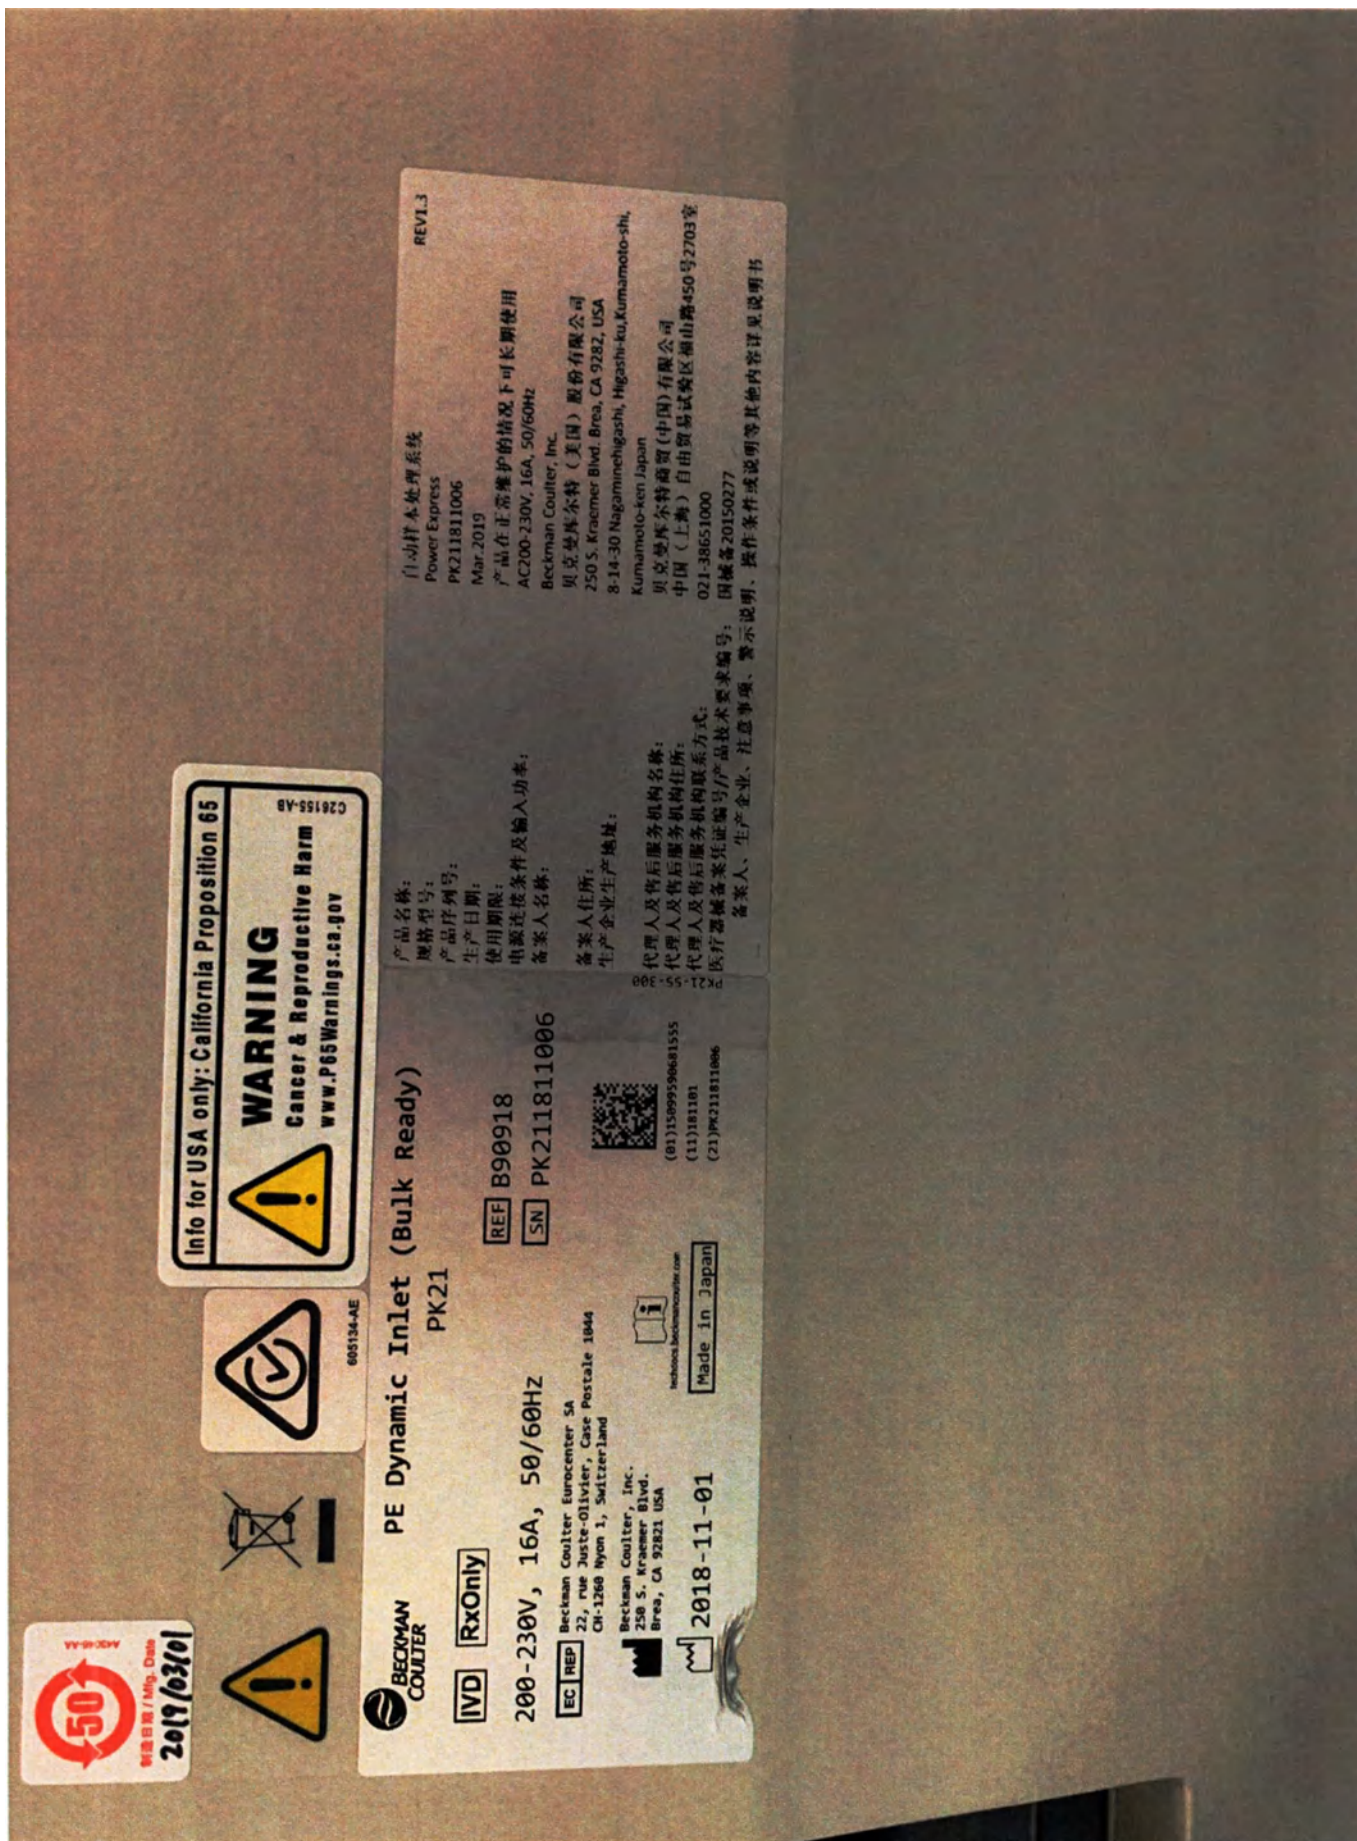

Маркировка медицинского изделия «Система лабораторной автоматизации "Power Express"».





Регистрационное удостоверение: Система лабораторной автоматизации "Power Express"  
РЗН 2022/16463 от 01.02.2022 г.

## Power Express

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| Кат. номер:                | <b>B90918</b>                  |
| Серийный номер:            | см. на оригинальной маркировке |
| Дата производства:         | см. на оригинальной маркировке |
| Произведено в:             | Япония                         |
| Дополнительная информация: | см. на оригинальной маркировке |



**Производитель:**  
Бекмен Культер, Инк. 250 S. Kraemer Blvd., Brea, CA 92821, США  
**Уполномоченный представитель производителя:**  
ООО "Бекмен Культер", Москва, Россия, 109004, Станиславского 21, стр.3

B90918\_RUS\_v1



ПРОШТО, ПРОНУМЕРОВАНО  
И СРЕДЛЕНО ПЕЧАТЪЮ  
418 ЛИСТОВ

