

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	1 из 41

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный Директор

(должность)

ООО «Евротайп Рус»

(организация)

Попов Дмитрий Валериевич

(Ф.И.О.)

(подпись)




Фотографические изображения
№РЕР-011-ФИ

Ретрактор губ стоматологический EuroGate
по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023


Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	2 из 41

Раздел 1. Ретрактор губ стоматологический EuroGate, размер Small, цвет белый

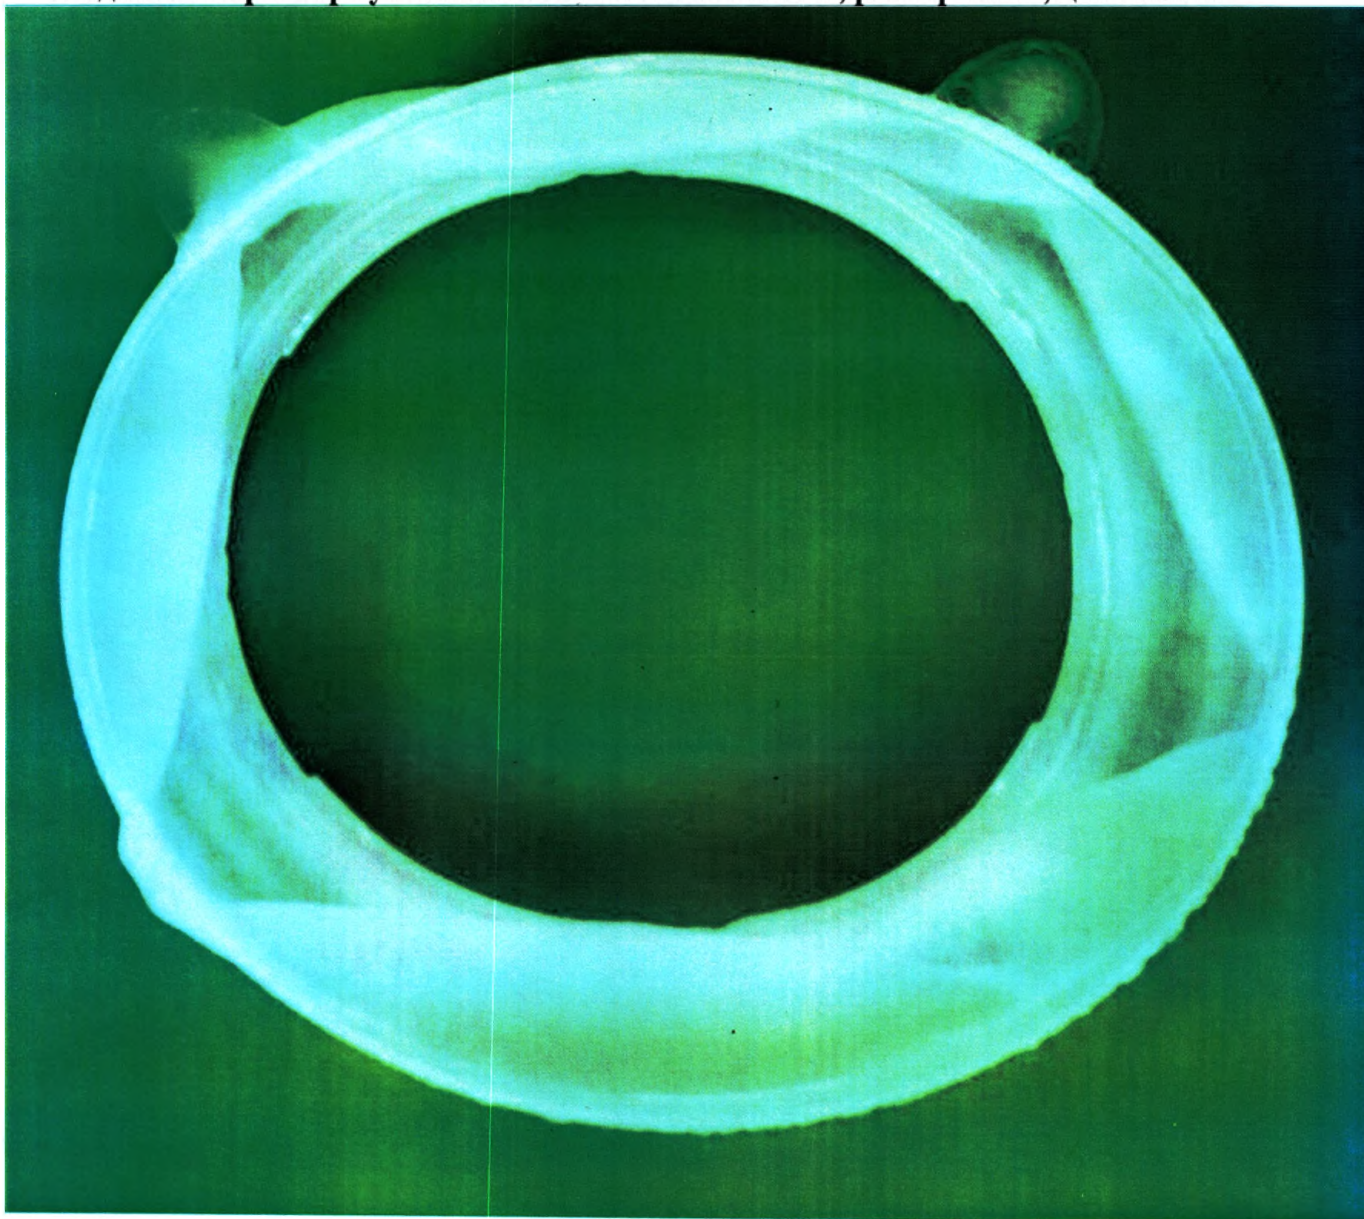


Фотографическое изображение 1 – Вид сверху

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	3 из 41

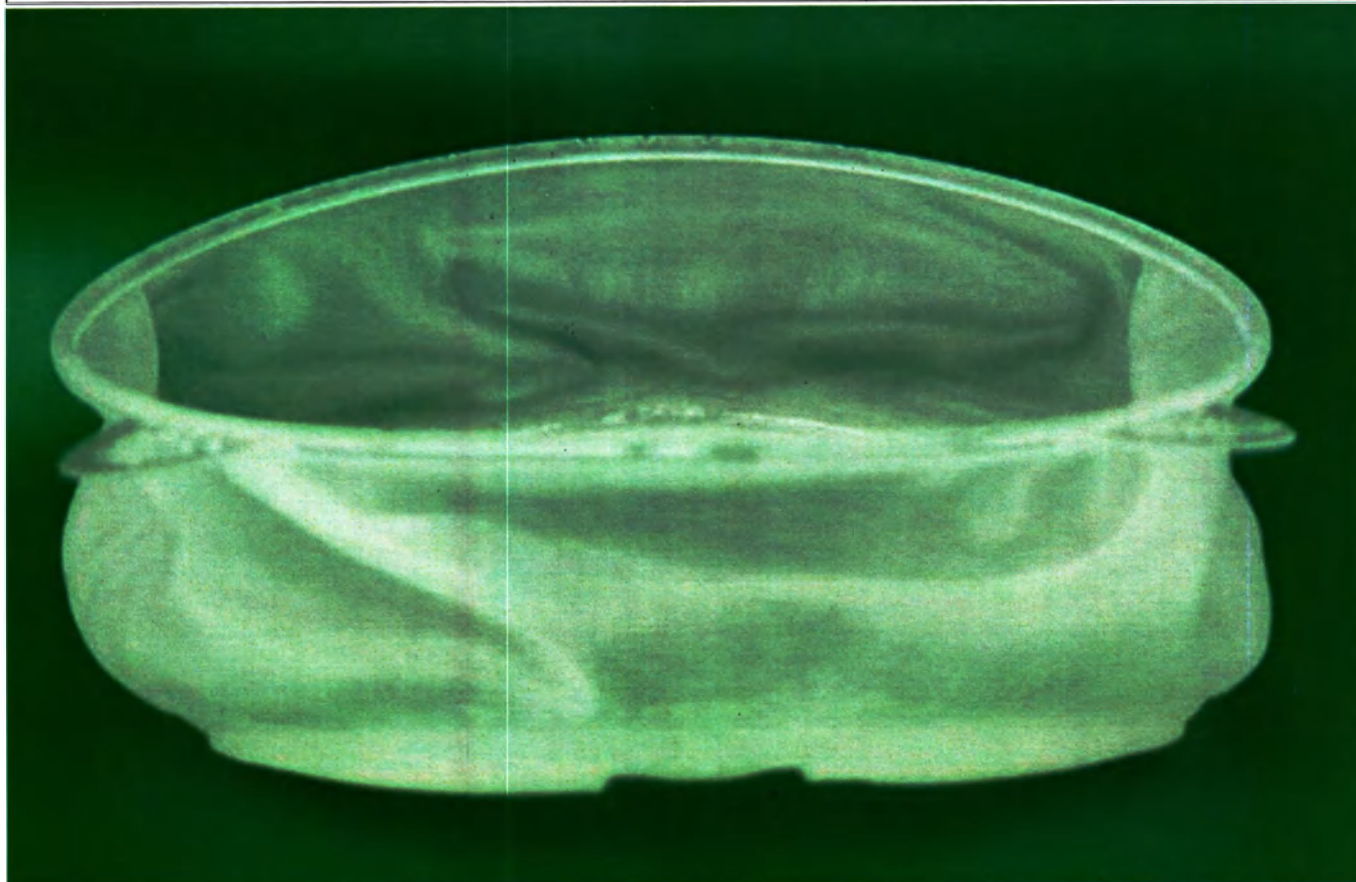

Фотографическое изображение 2 – Вид сбоку

Фотографические изображения		РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023		Дата пересмотра	23.07.2024
		Страница	4 из 41

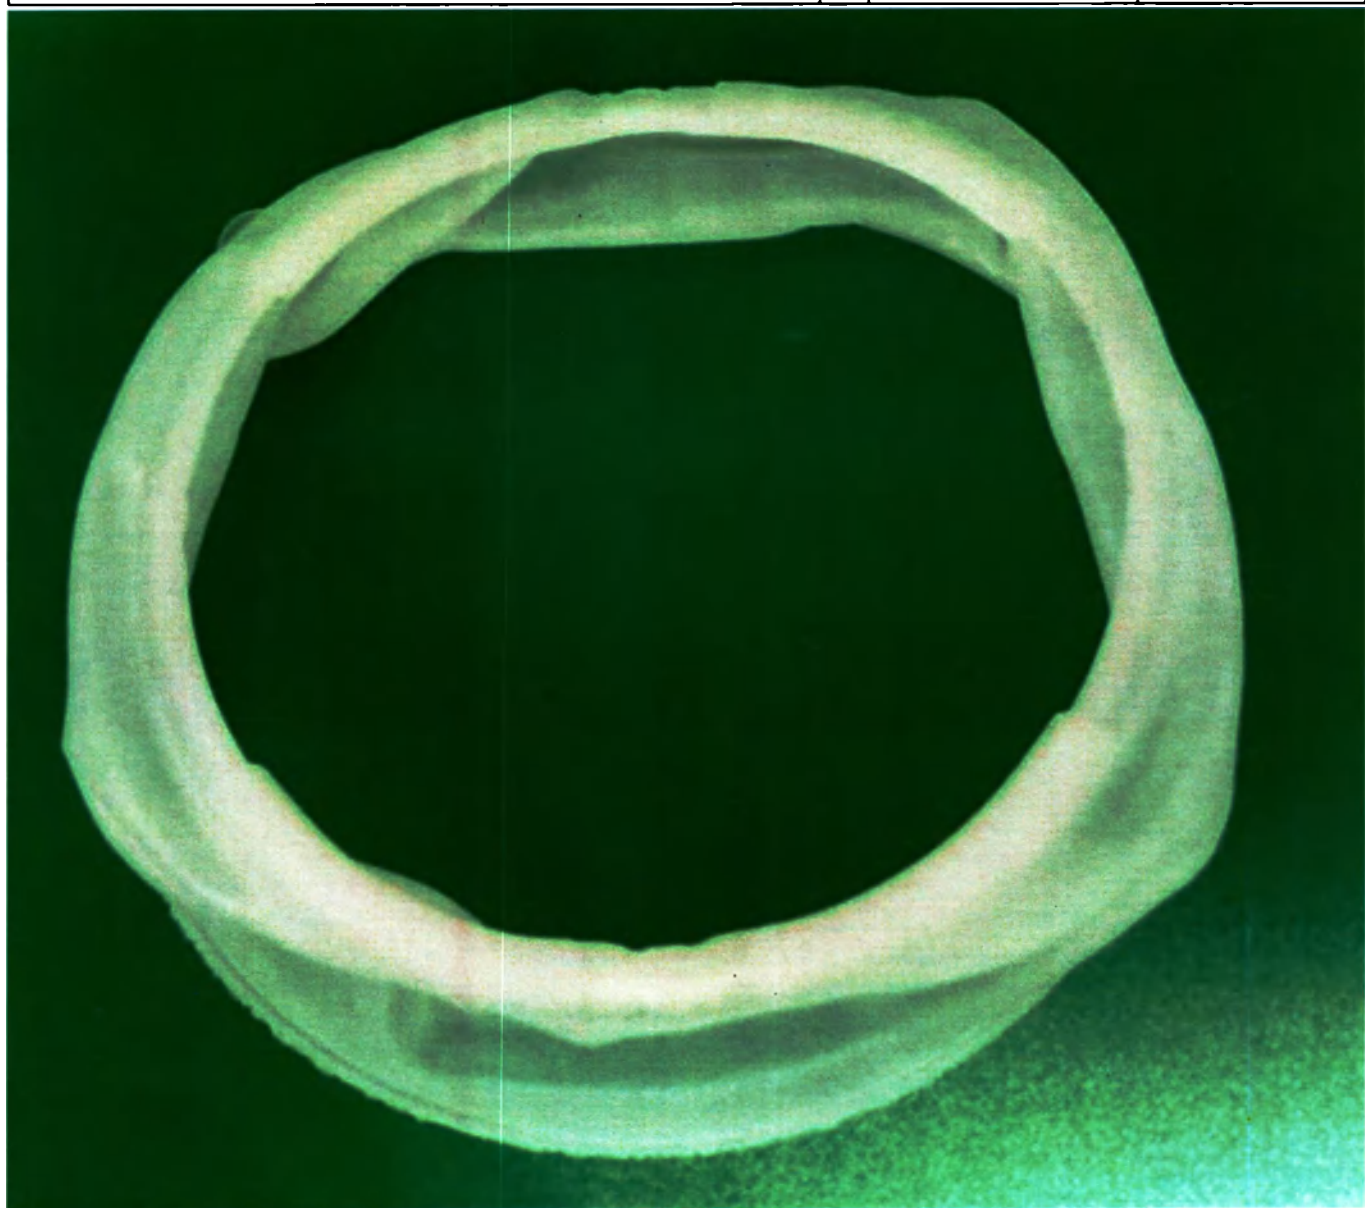

Фотографическое изображение 3 – Вид снизу

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	5 из 41



Фотографическое изображение 4 – Индивидуальная упаковка (лицевая сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	6 из 41



Фотографическое изображение 5 – Индивидуальная упаковка (тыльная сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	7 из 41



Фотографическое изображение 6 – Потребительская упаковка (лицевая сторона)



Фотографическое изображение 7 – Потребительская упаковка (тыльная сторона)




Фотографическое изображение 8 – Потребительская упаковка (верхняя сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	8 из 41



Фотографическое изображение 9 – Потребительская упаковка (левая сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	9 из 41

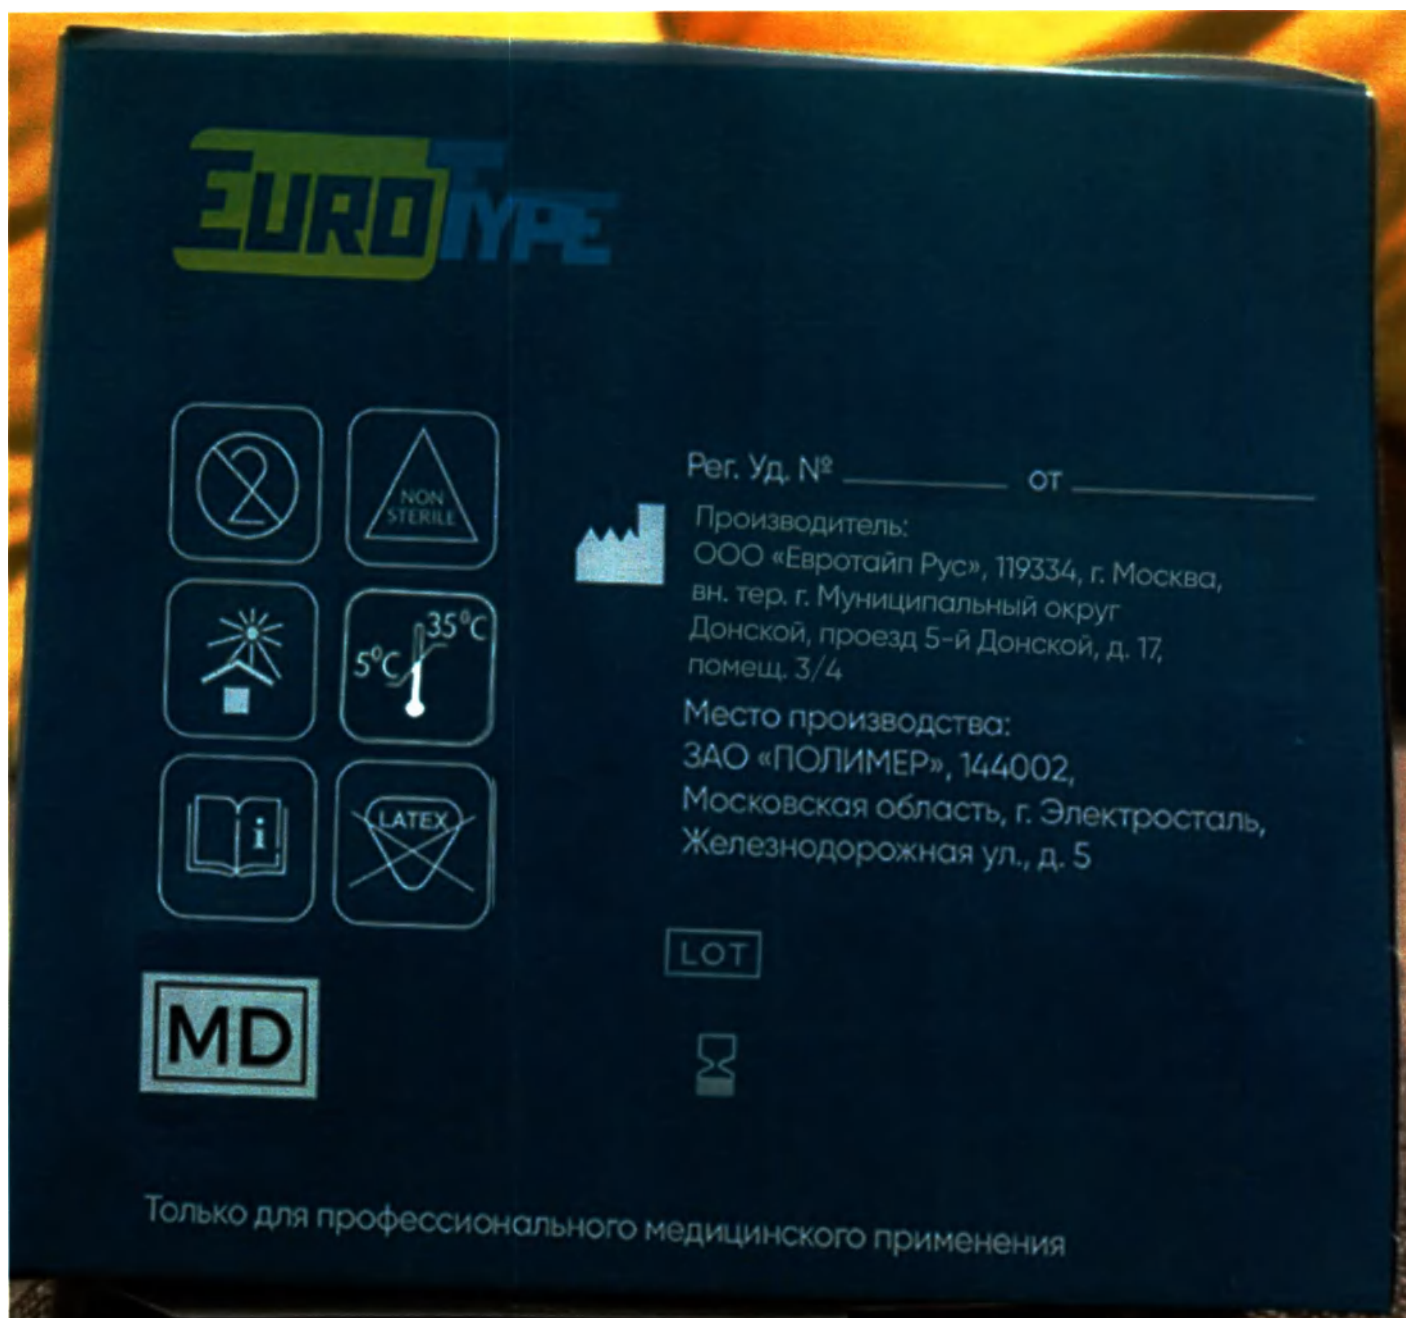

Фотографическое изображение 10 – Потребительская упаковка (правая сторона)


Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	10 из 41

Раздел 2. Ретрактор губ стоматологический EuroGate, размер Regular, цвет белый




Фотографическое изображение 11 – Вид сверху

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	11 из 41

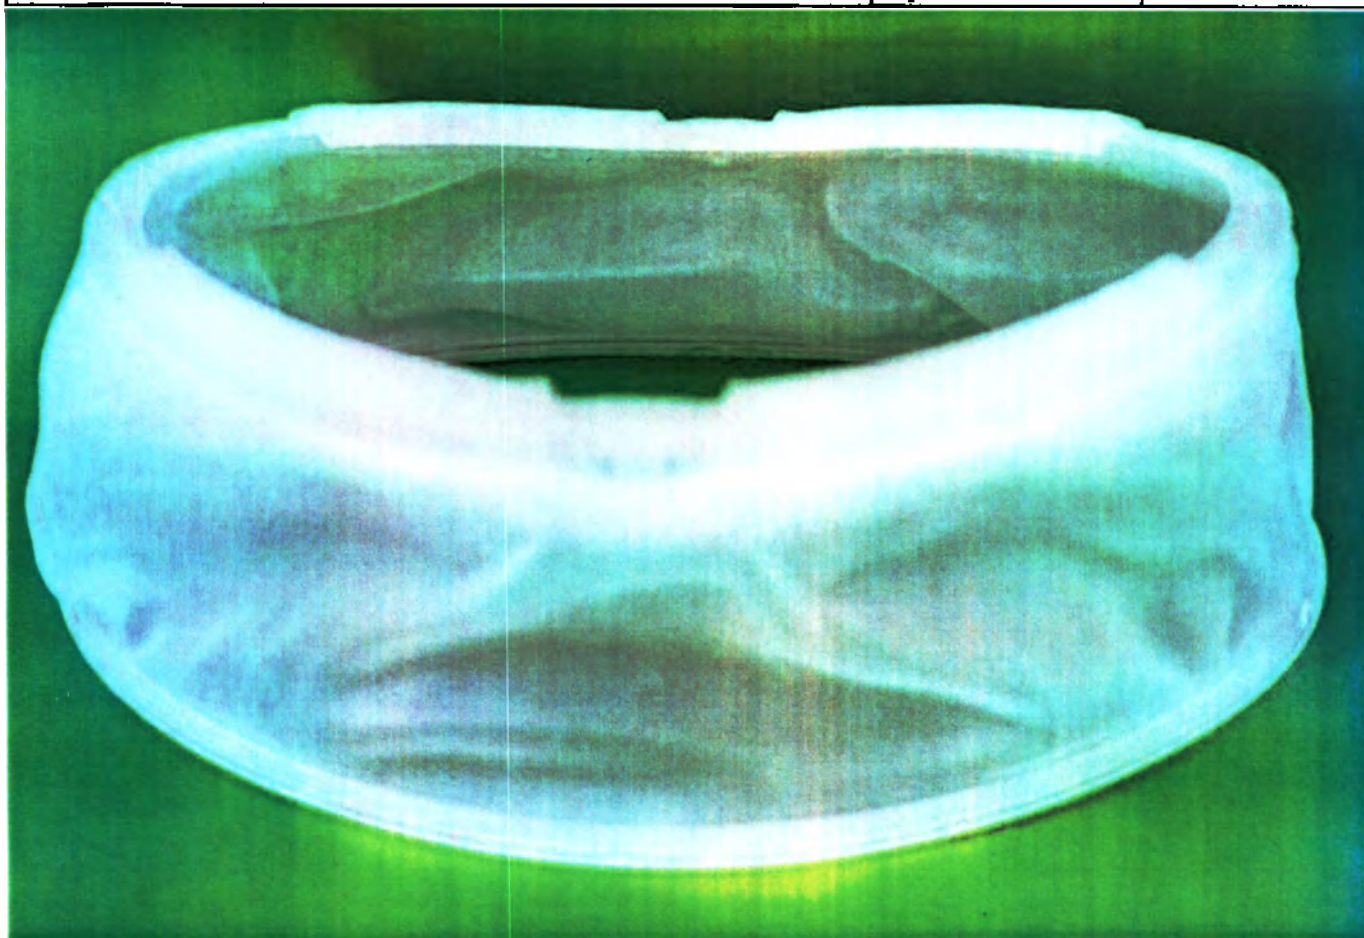

Фотографическое изображение 12 – Вид сбоку

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	12 из 41

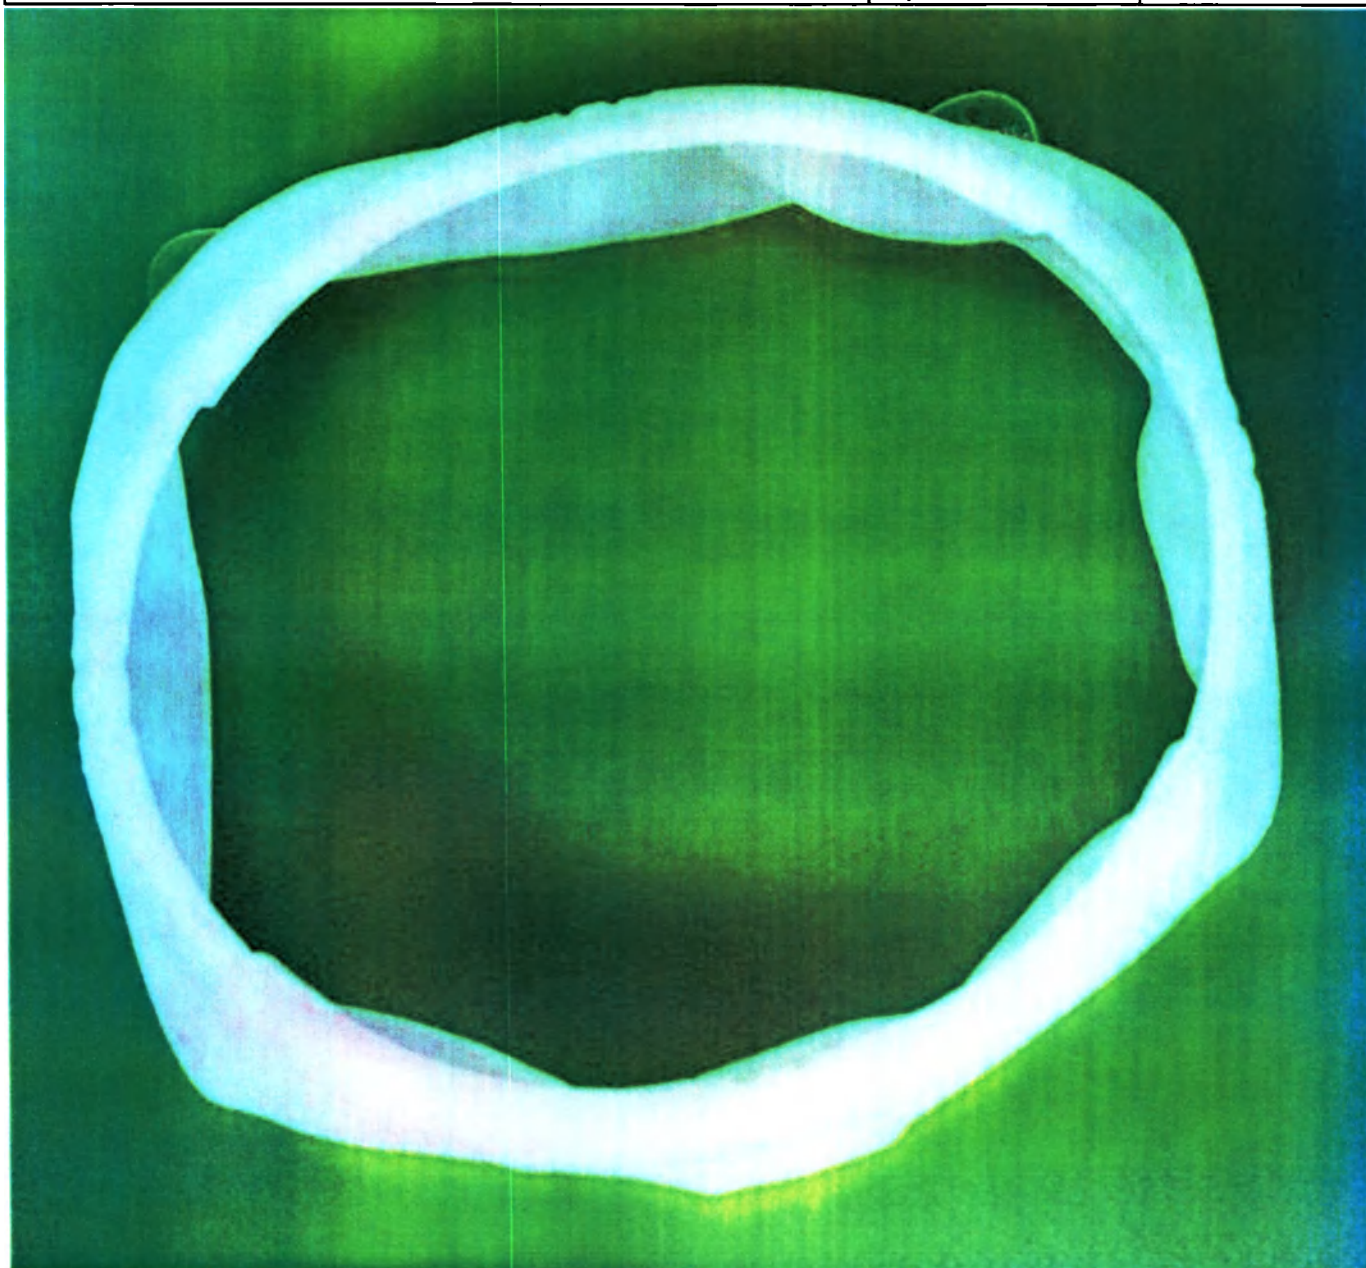

Фотографическое изображение 13 – Вид снизу

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	13 из 41




Фотографическое изображение 14 – Индивидуальная упаковка (лицевая сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	14 из 41



Фотографическое изображение 15 – Индивидуальная упаковка (тыльная сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	15 из 41

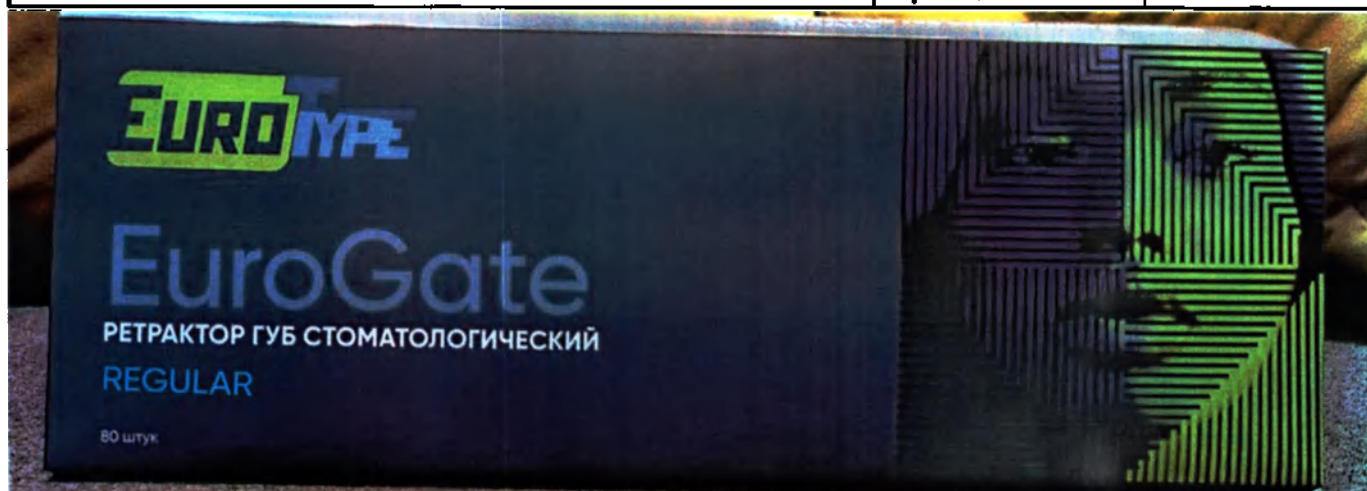

Фотографическое изображение 16 – Потребительская упаковка (лицевая сторона)



Фотографическое изображение 17 – Потребительская упаковка (тыльная сторона)




Фотографическое изображение 18 – Потребительская упаковка (верхняя сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	16 из 41



Фотографическое изображение 19 – Потребительская упаковка (левая сторона)


Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	17 из 41

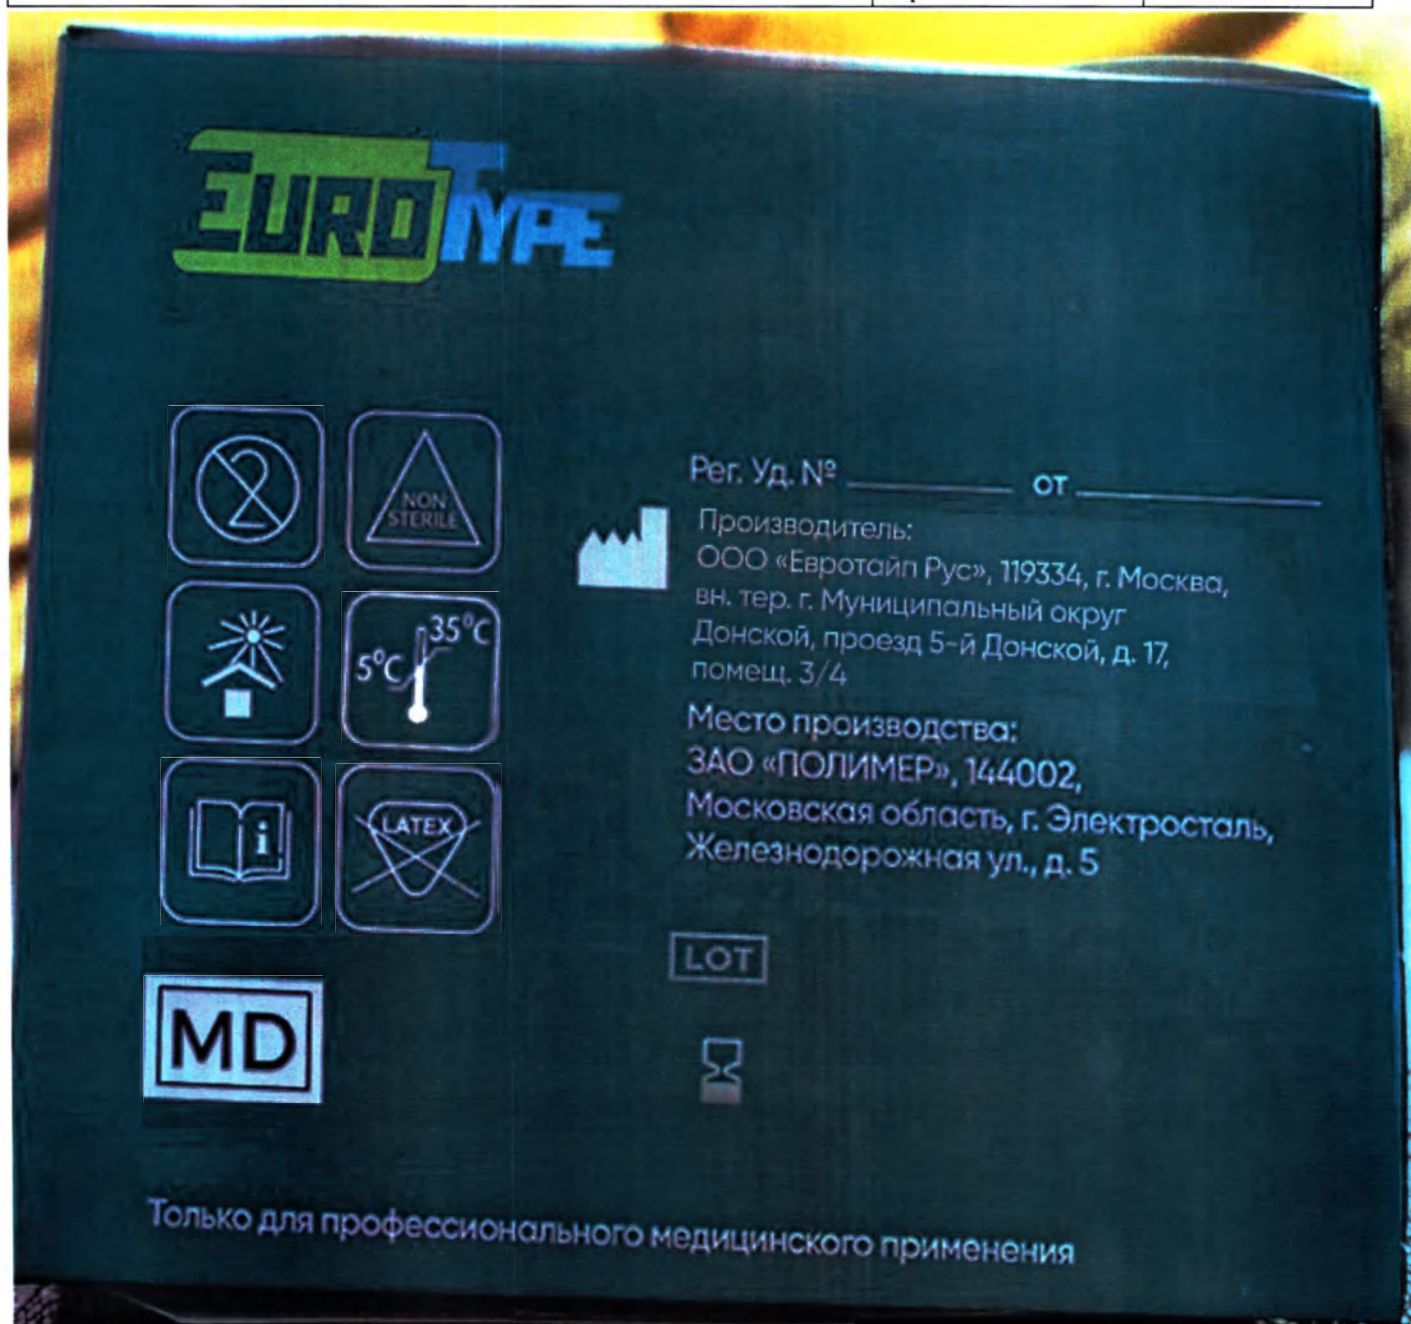

Фотографическое изображение 20 – Потребительская упаковка (правая сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	18 из 41

Раздел 3. Ретрактор губ стоматологический EuroGate, размер Junior, цвет белый

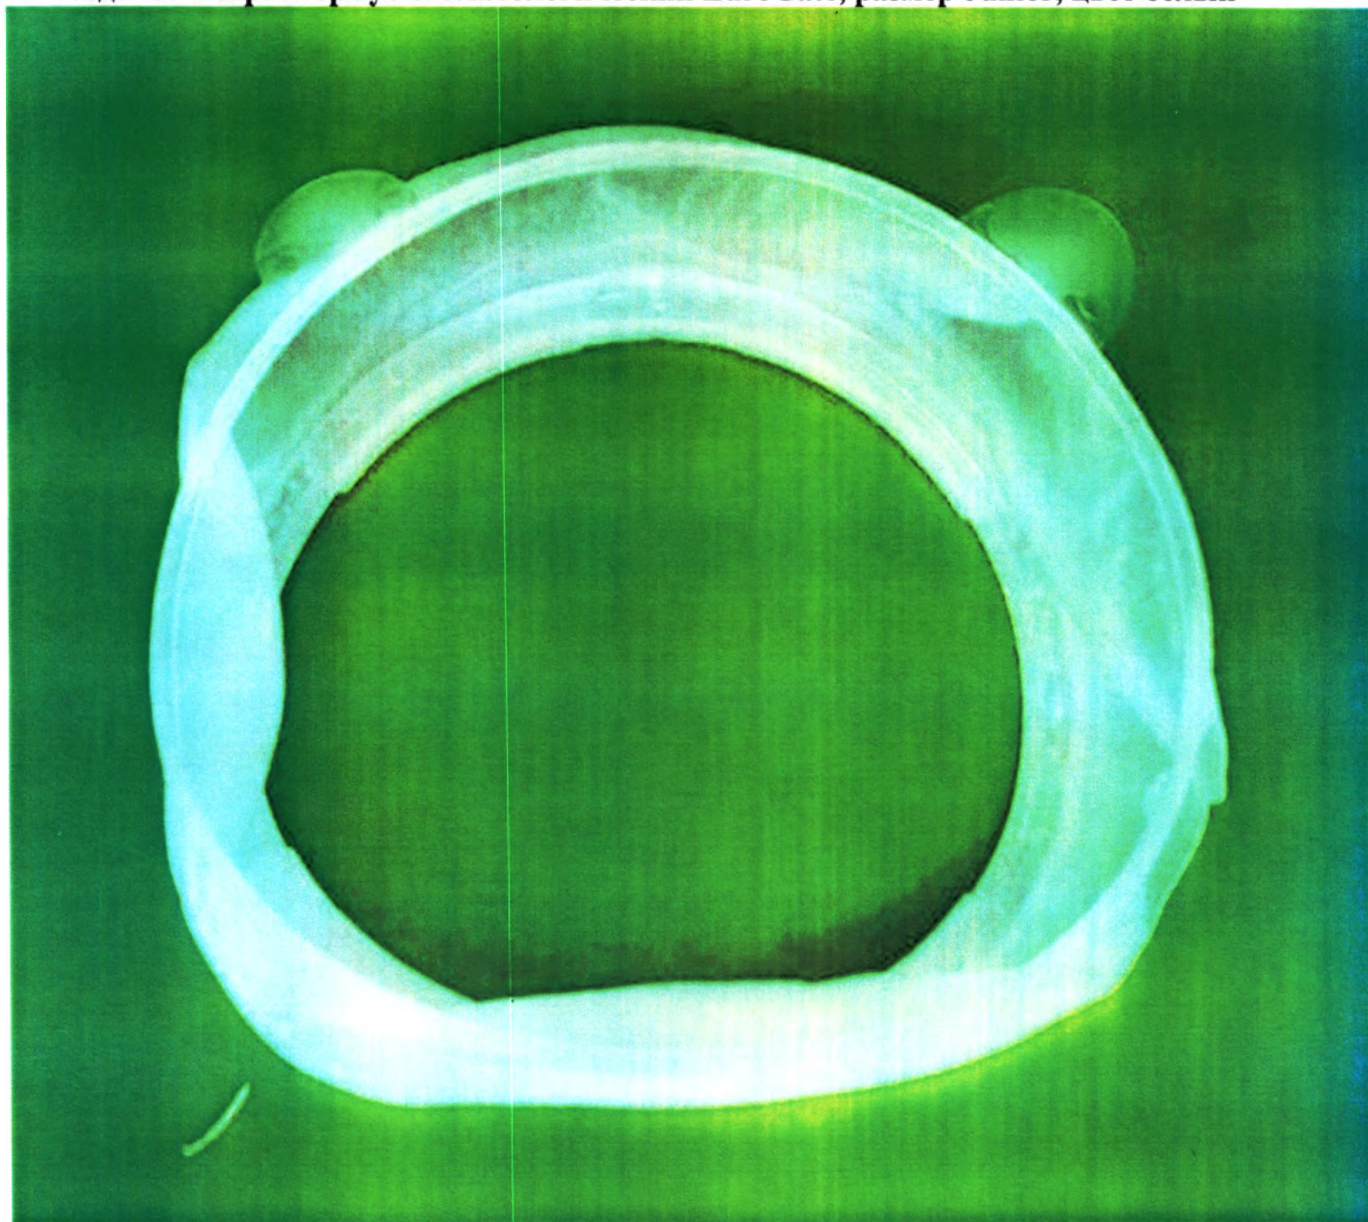


Фотографическое изображение 21 – Вид сверху

Фотографические изображения		РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023		Дата пересмотра	23.07.2024
		Страница	19 из 41



Фотографическое изображение 22 – Вид сбоку

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	20 из 41

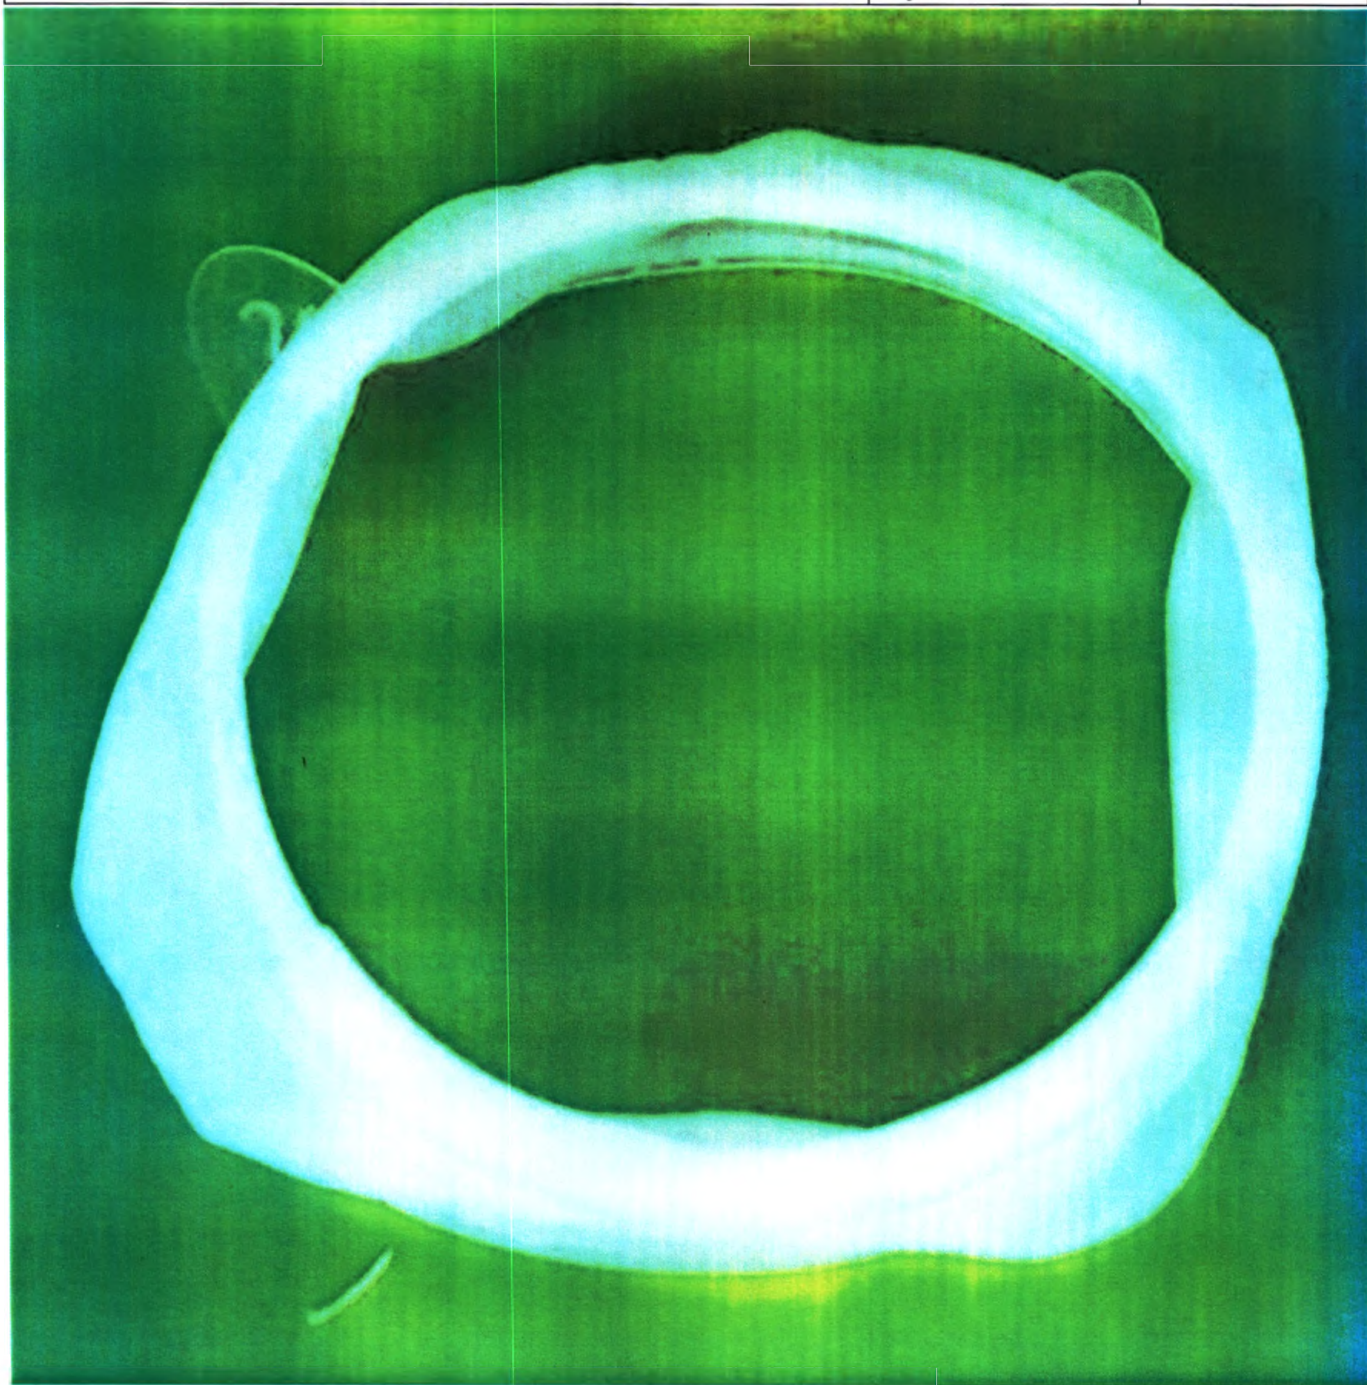

Фотографическое изображение 23 – Вид снизу

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	21 из 41



Фотографическое изображение 24 – Индивидуальная упаковка (лицевая сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	22 из 41



Фотографическое изображение 25 – Индивидуальная упаковка (тыльная сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	23 из 41



Фотографическое изображение 26 – Потребительская упаковка (лицевая сторона)



Фотографическое изображение 27 – Потребительская упаковка (тыльная сторона)




Фотографическое изображение 28 – Потребительская упаковка (верхняя сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	24 из 41



Фотографическое изображение 29 – Потребительская упаковка (левая сторона)


Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	25 из 41

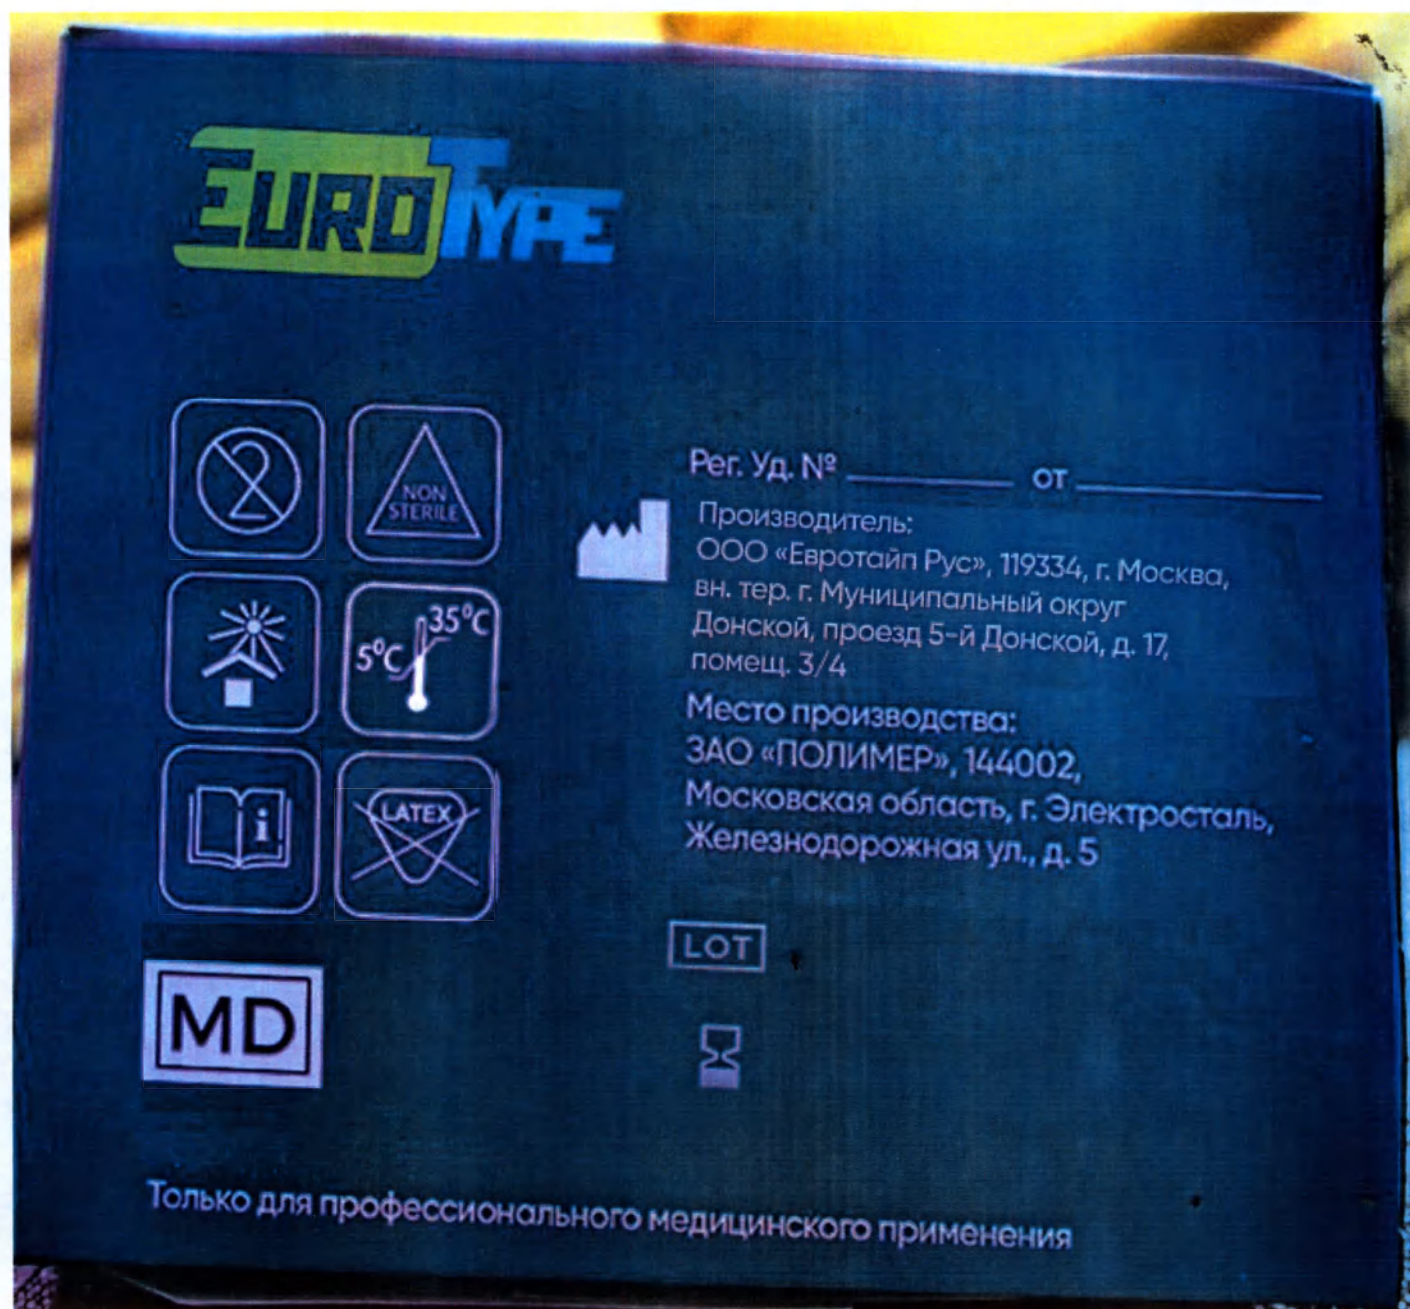


Фотографическое изображение 30 – Потребительская упаковка (правая сторона)

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	30 из 41

Фотографическое изображение 34 – Развертка общая, размер Small

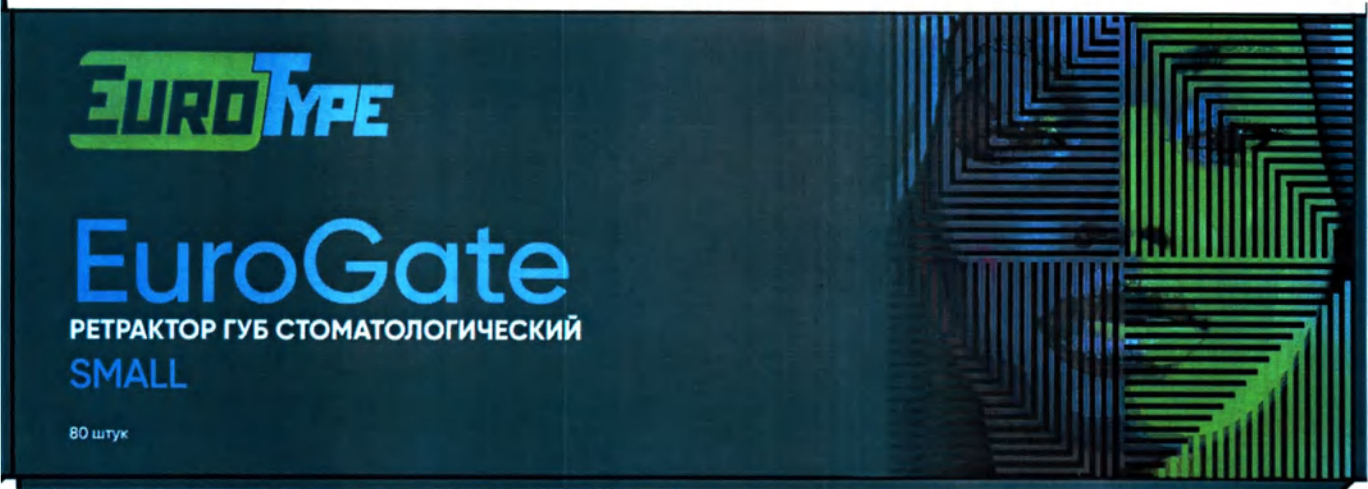

Фотографическое изображение 35 – Лицевая сторона, размер Small

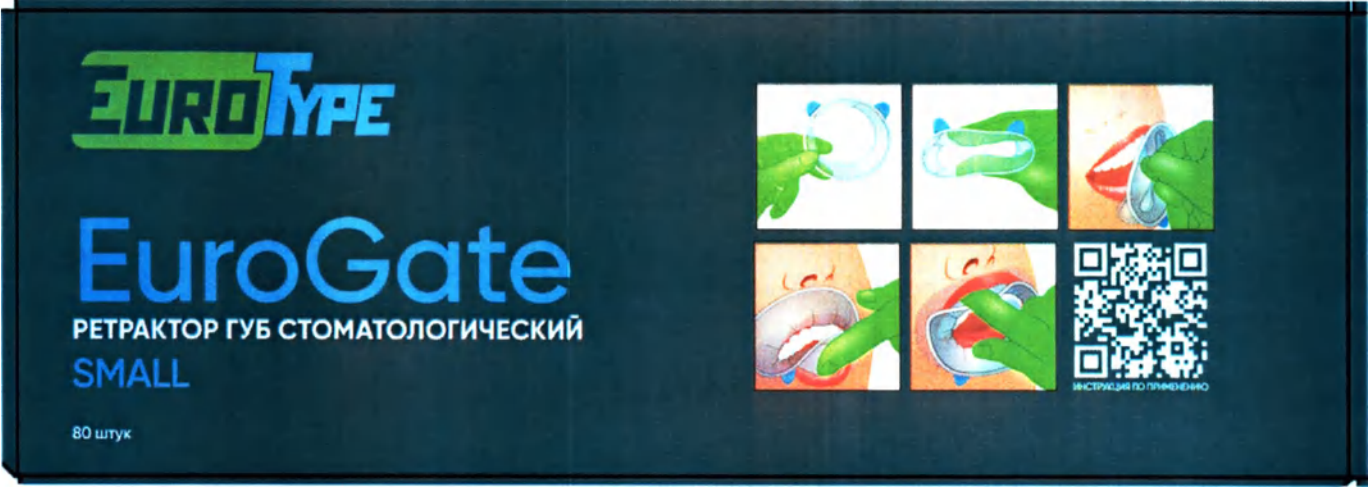

Фотографическое изображение 36 – Тыльная сторона, размер Small




Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	31 из 41

Фотографическое изображение 37 – Правая сторона, размер Small



Фотографическое изображение 38 – Левая сторона, размер Small

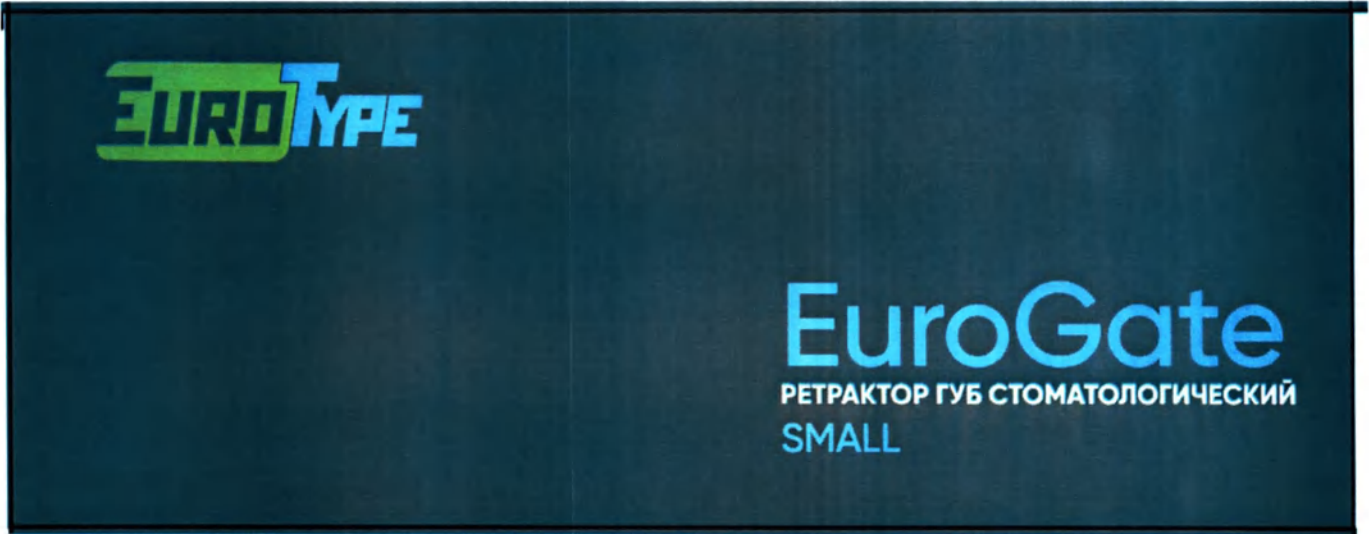


Фотографическое изображение 39 – Верхняя сторона, размер Small

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	32 из 41




Фотографическое изображение 40 – Развертка общая, размер Regular

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	33 из 41

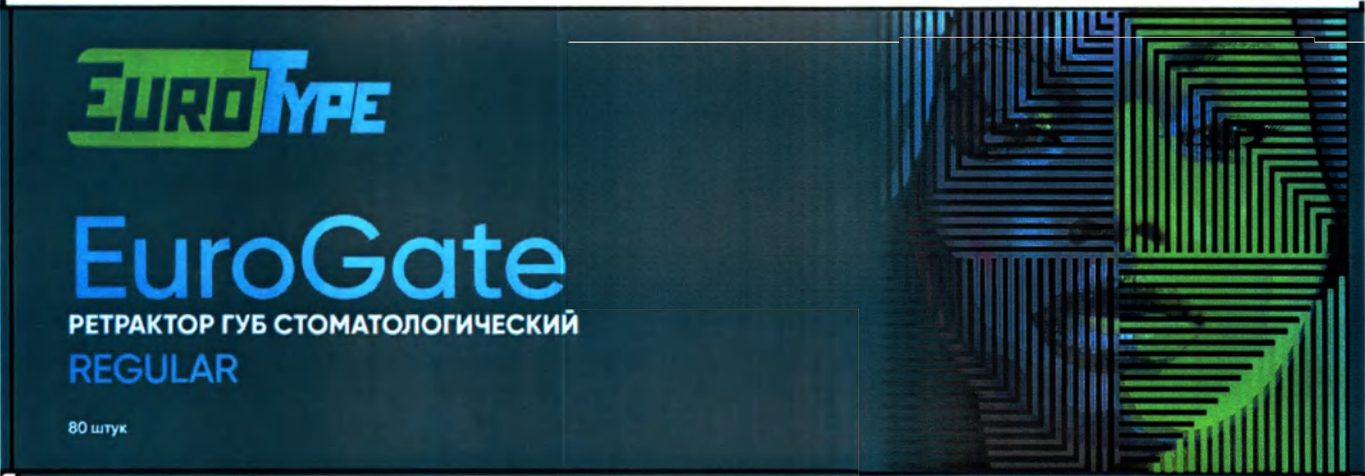

Фотографическое изображение 41 – Лицевая сторона, размер Regular

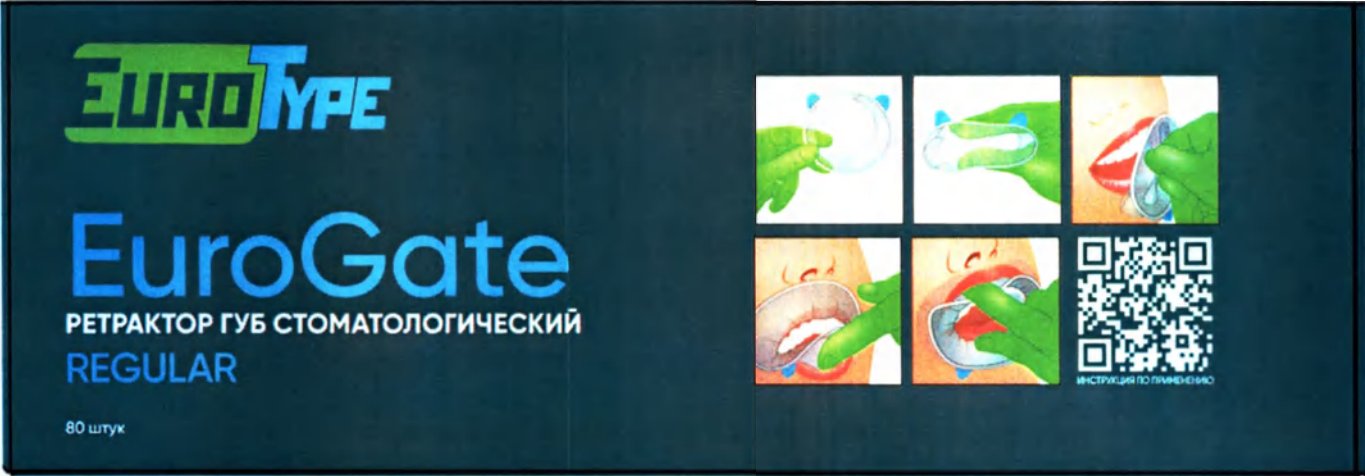


Фотографическое изображение 42 – Тыльная сторона, размер Regular




Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	34 из 41

Фотографическое изображение 43 – Правая сторона, размер Regular

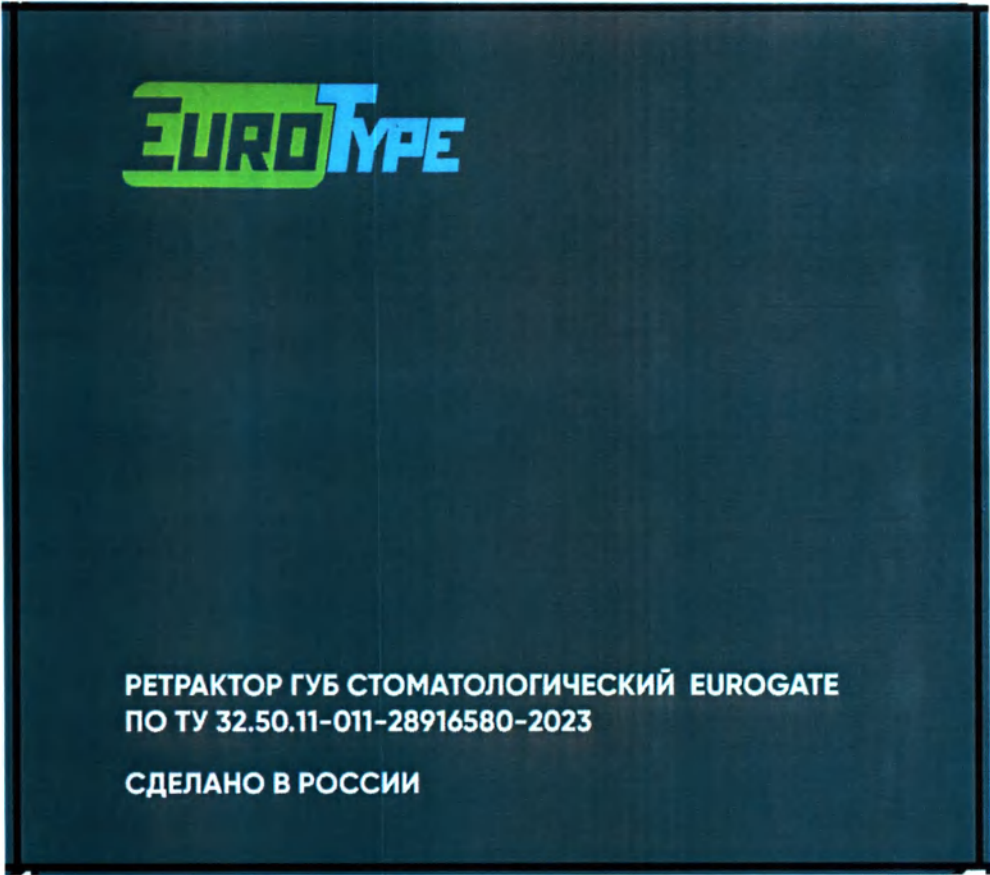

Фотографическое изображение 44 – Левая сторона, размер Regular

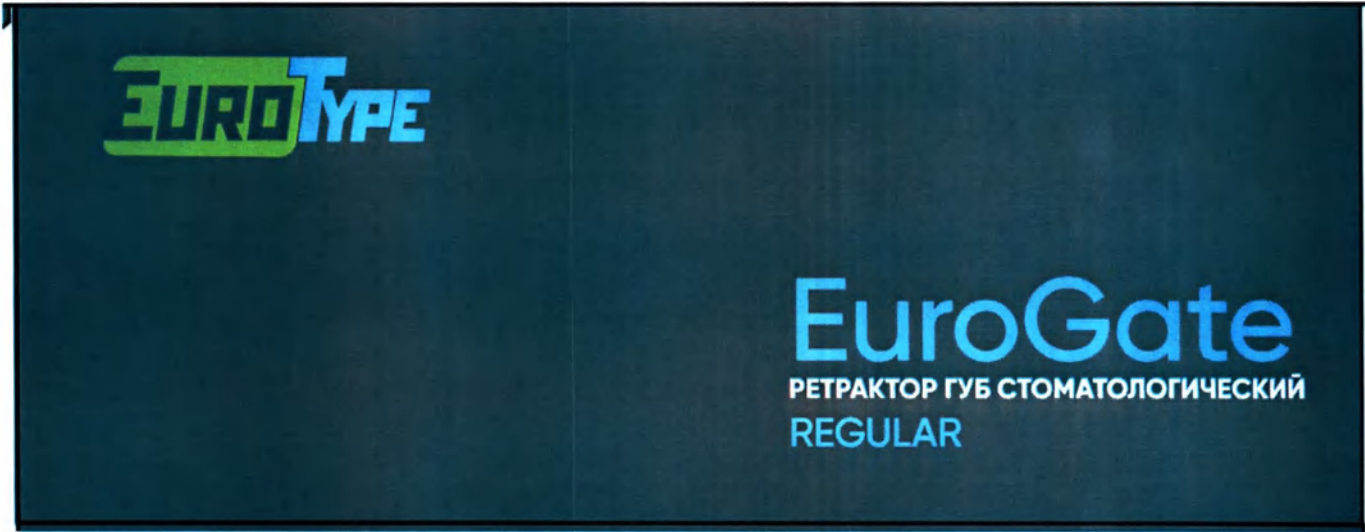


Фотографическое изображение 45 – Верхняя сторона, размер Regular

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	35 из 41




Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	36 из 41

Фотографическое изображение 46 – Развертка общая, размер Junior

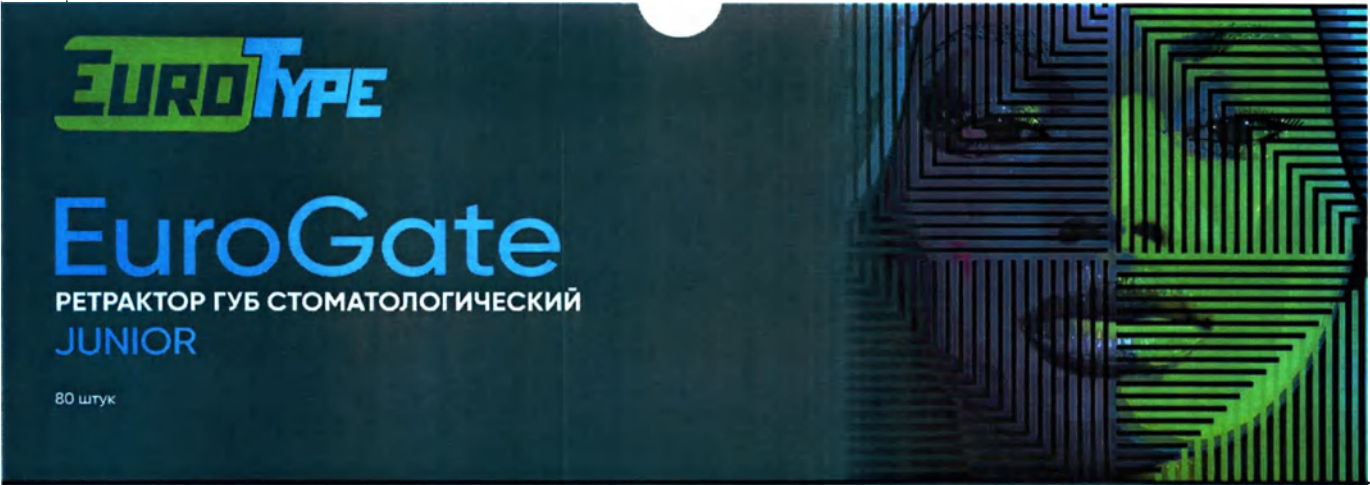


Фотографическое изображение 47 – Лицевая сторона, размер Junior

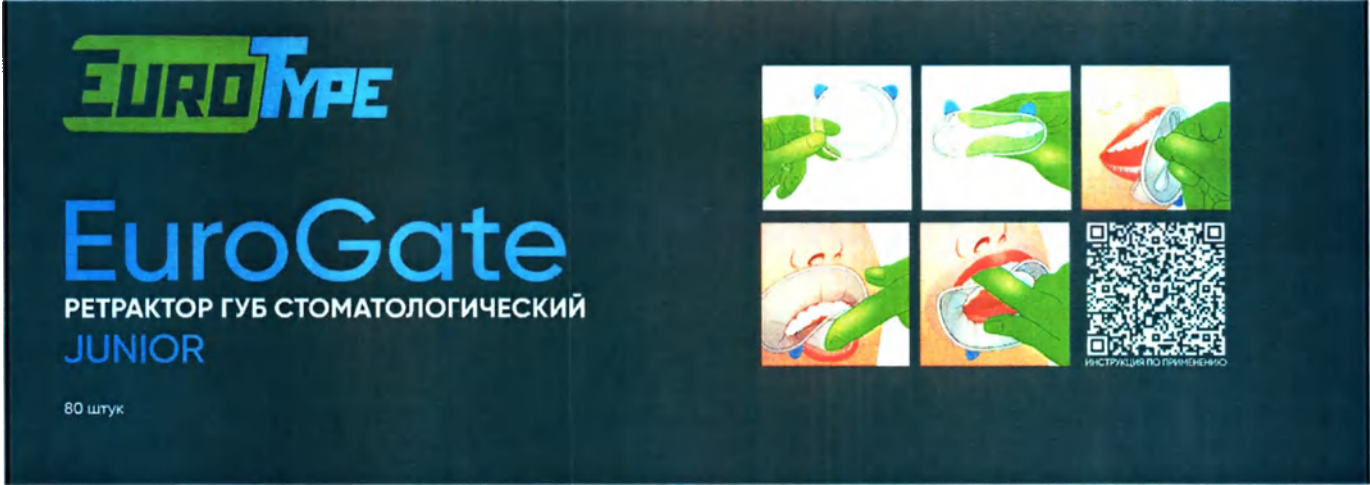

Фотографическое изображение 48 – Тыльная сторона, размер Junior

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	37 из 41

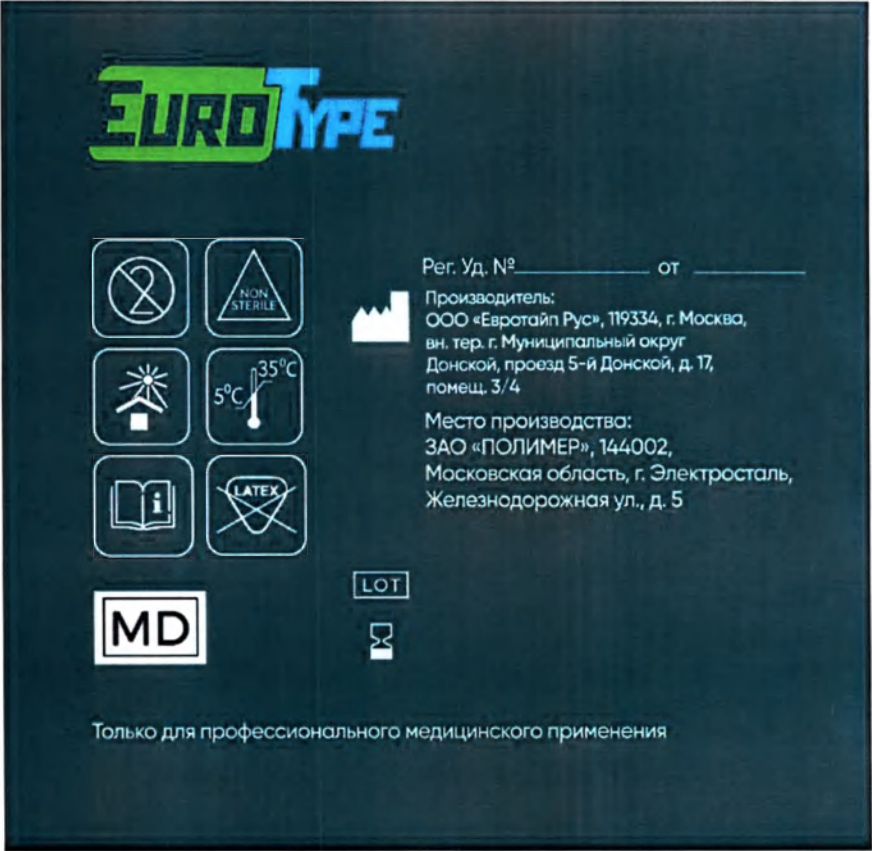

Фотографическое изображение 49 – Правая сторона, размер Junior



Фотографическое изображение 50 – Левая сторона, размер Junior


Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	38 из 41



Фотографическое изображение 51 – Верхняя сторона, размер Junior

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	39 из 41

Раздел 6. Транспортная маркировка и упаковка

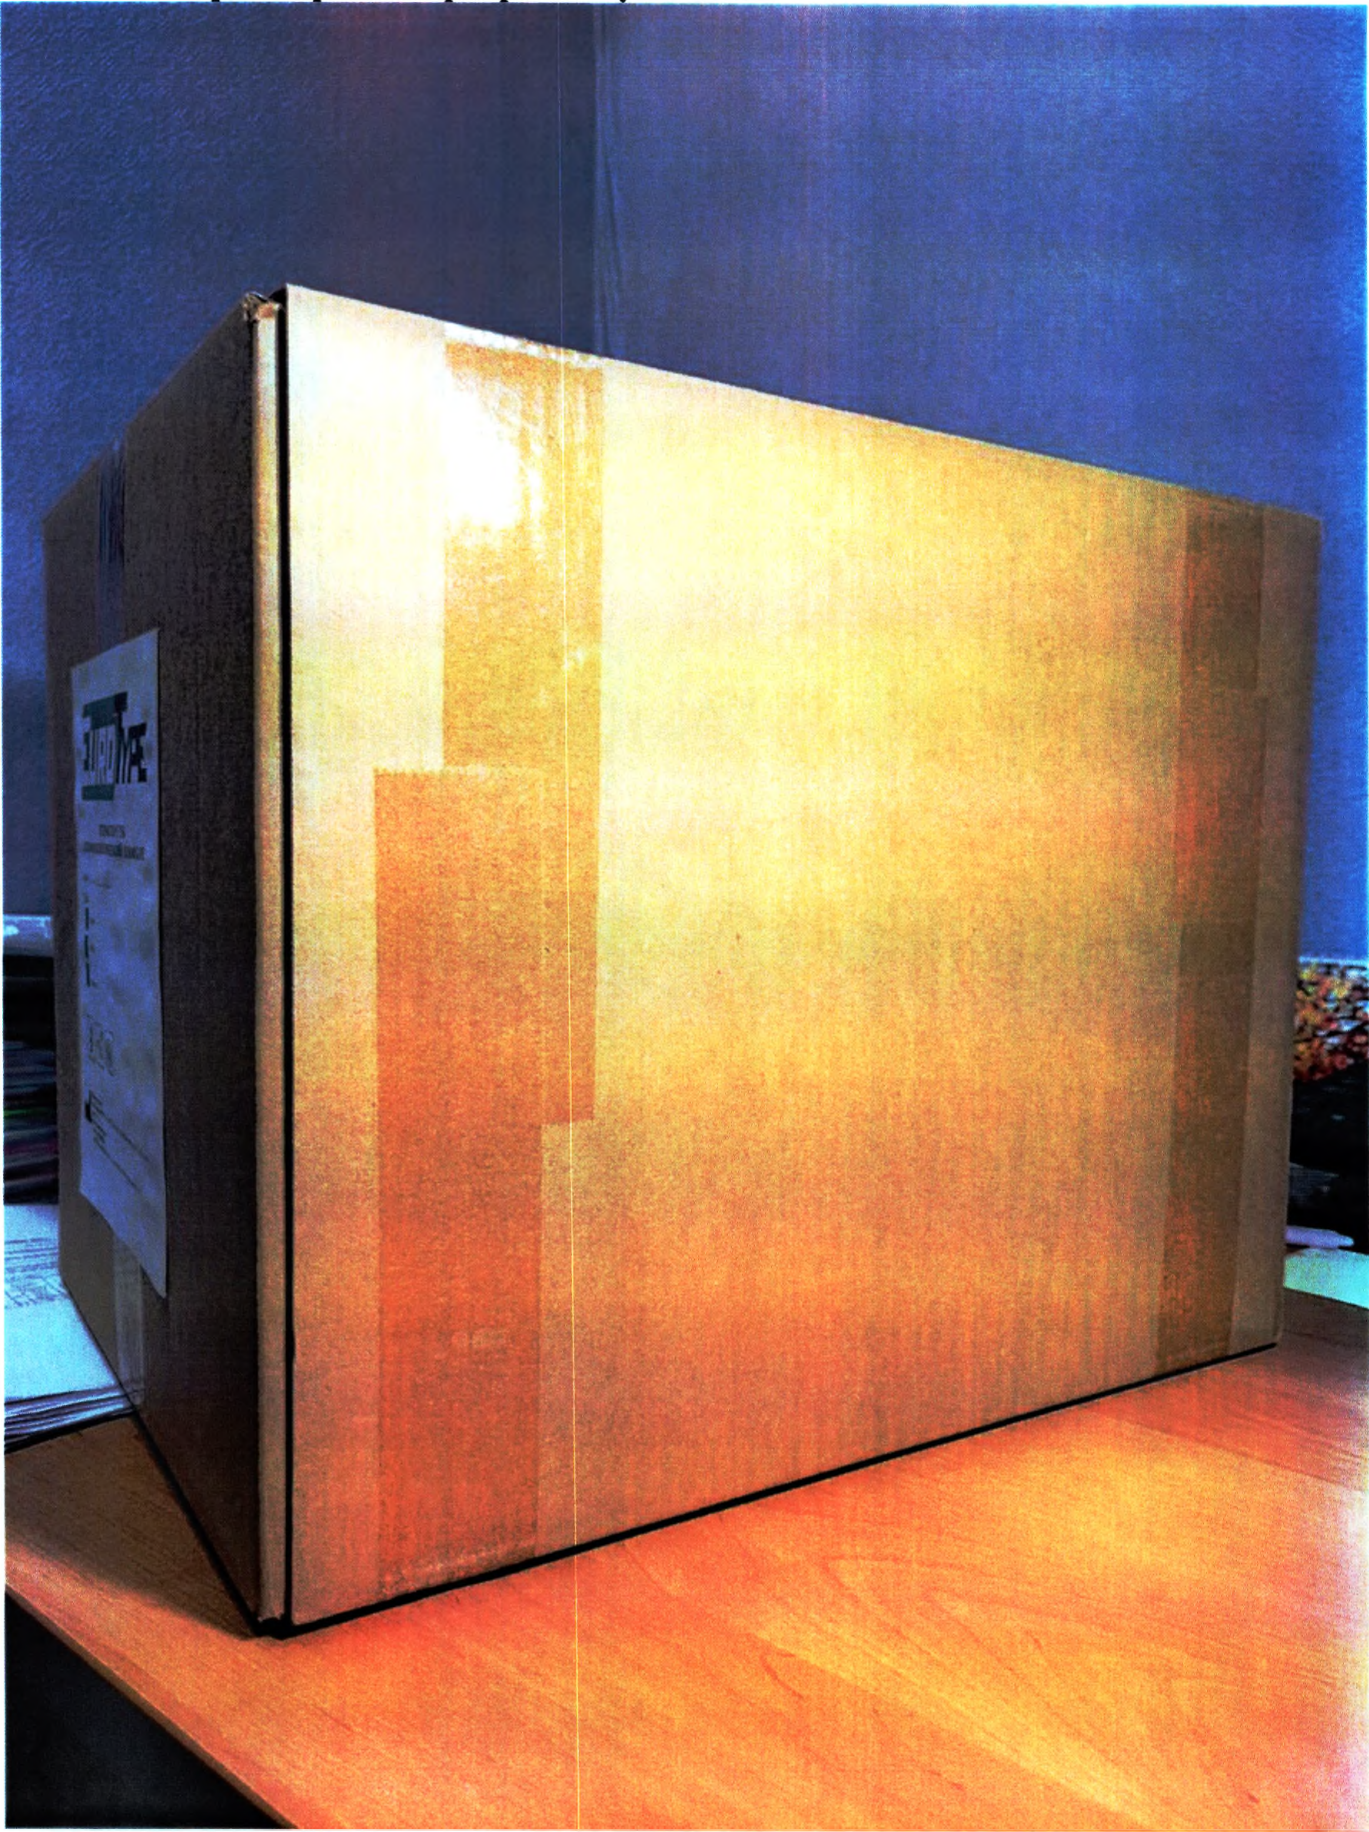

Фотографическое изображение 52 – Общий вид

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	40 из 41



Фотографическое изображение 53 – Маркировка

Фотографические изображения	РЕР-011-ФИ	
Ретрактор губ стоматологический EuroGate по ТУ 32.50.11-011-28916580-2023	Дата пересмотра	23.07.2024
	Страница	41 из 41

Раздел 7. Используемые символы

Символ	Обозначение
	Изготовитель
	Код партии
	Использовать до
	Запрет на повторное применение
	Нестерильно
	Не допускать воздействия солнечного света
	Температурный диапазон
	Обратитесь к инструкции по применению в электронном виде
	Не использовать при повреждении упаковки и обратиться к инструкции по применению
	Не содержит латекс
	Медицинское изделие

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

41 листов

Генеральный директор

Д.В. Попов

