

Фотографическое изображение медицинского изделия

Реагенты VITROS ТТГ3 в кассете (VITROS TSH3 Reagent Pack) для количественного иммунодиагностического определения тиреотропного гормона (ТТГ) методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS.

Реагенты VITROS ТТГ3 в кассете.



Реагенты VITROS TTГ3 в кассете. Упаковка с этикеткой на русском языке.

684 4466

Реагенты VITROS ТТГЗ в кассете (VITROS TSH3 Reagent Pack) для количественного иммунодиагностического определения тиреотропного гормона (ТТГ) методом усиленной хемилюминесценции на анализаторах серии VITROS.


Назначение: Для количественного иммунодиагностического определения тиреотропного гормона (ТТГ) методом усиленной хемилюминесценции в человеческой сыворотке (с активатором свертывания) и плазме (с ЭДТА и литий-гепарином) с использованием анализаторов серии VITROS (VITROS Eci/ECiQ, VITROS 3600, VITROS 5600, VITROS XT 7600).

Регистрационное удостоверение в РФ: _____

Уполномоченная организация на территории РФ:
ООО «Орто-Клиникал Диагностикс», Россия, 143026,
Московская область, г.о. Одинцовский, дер.
Сколково, ул. Новая, дом. 100, стр. 9

Версия _____

Реагенты VITROS ТТГ3 в кассете. Кассета с реагентами, вид сбоку.

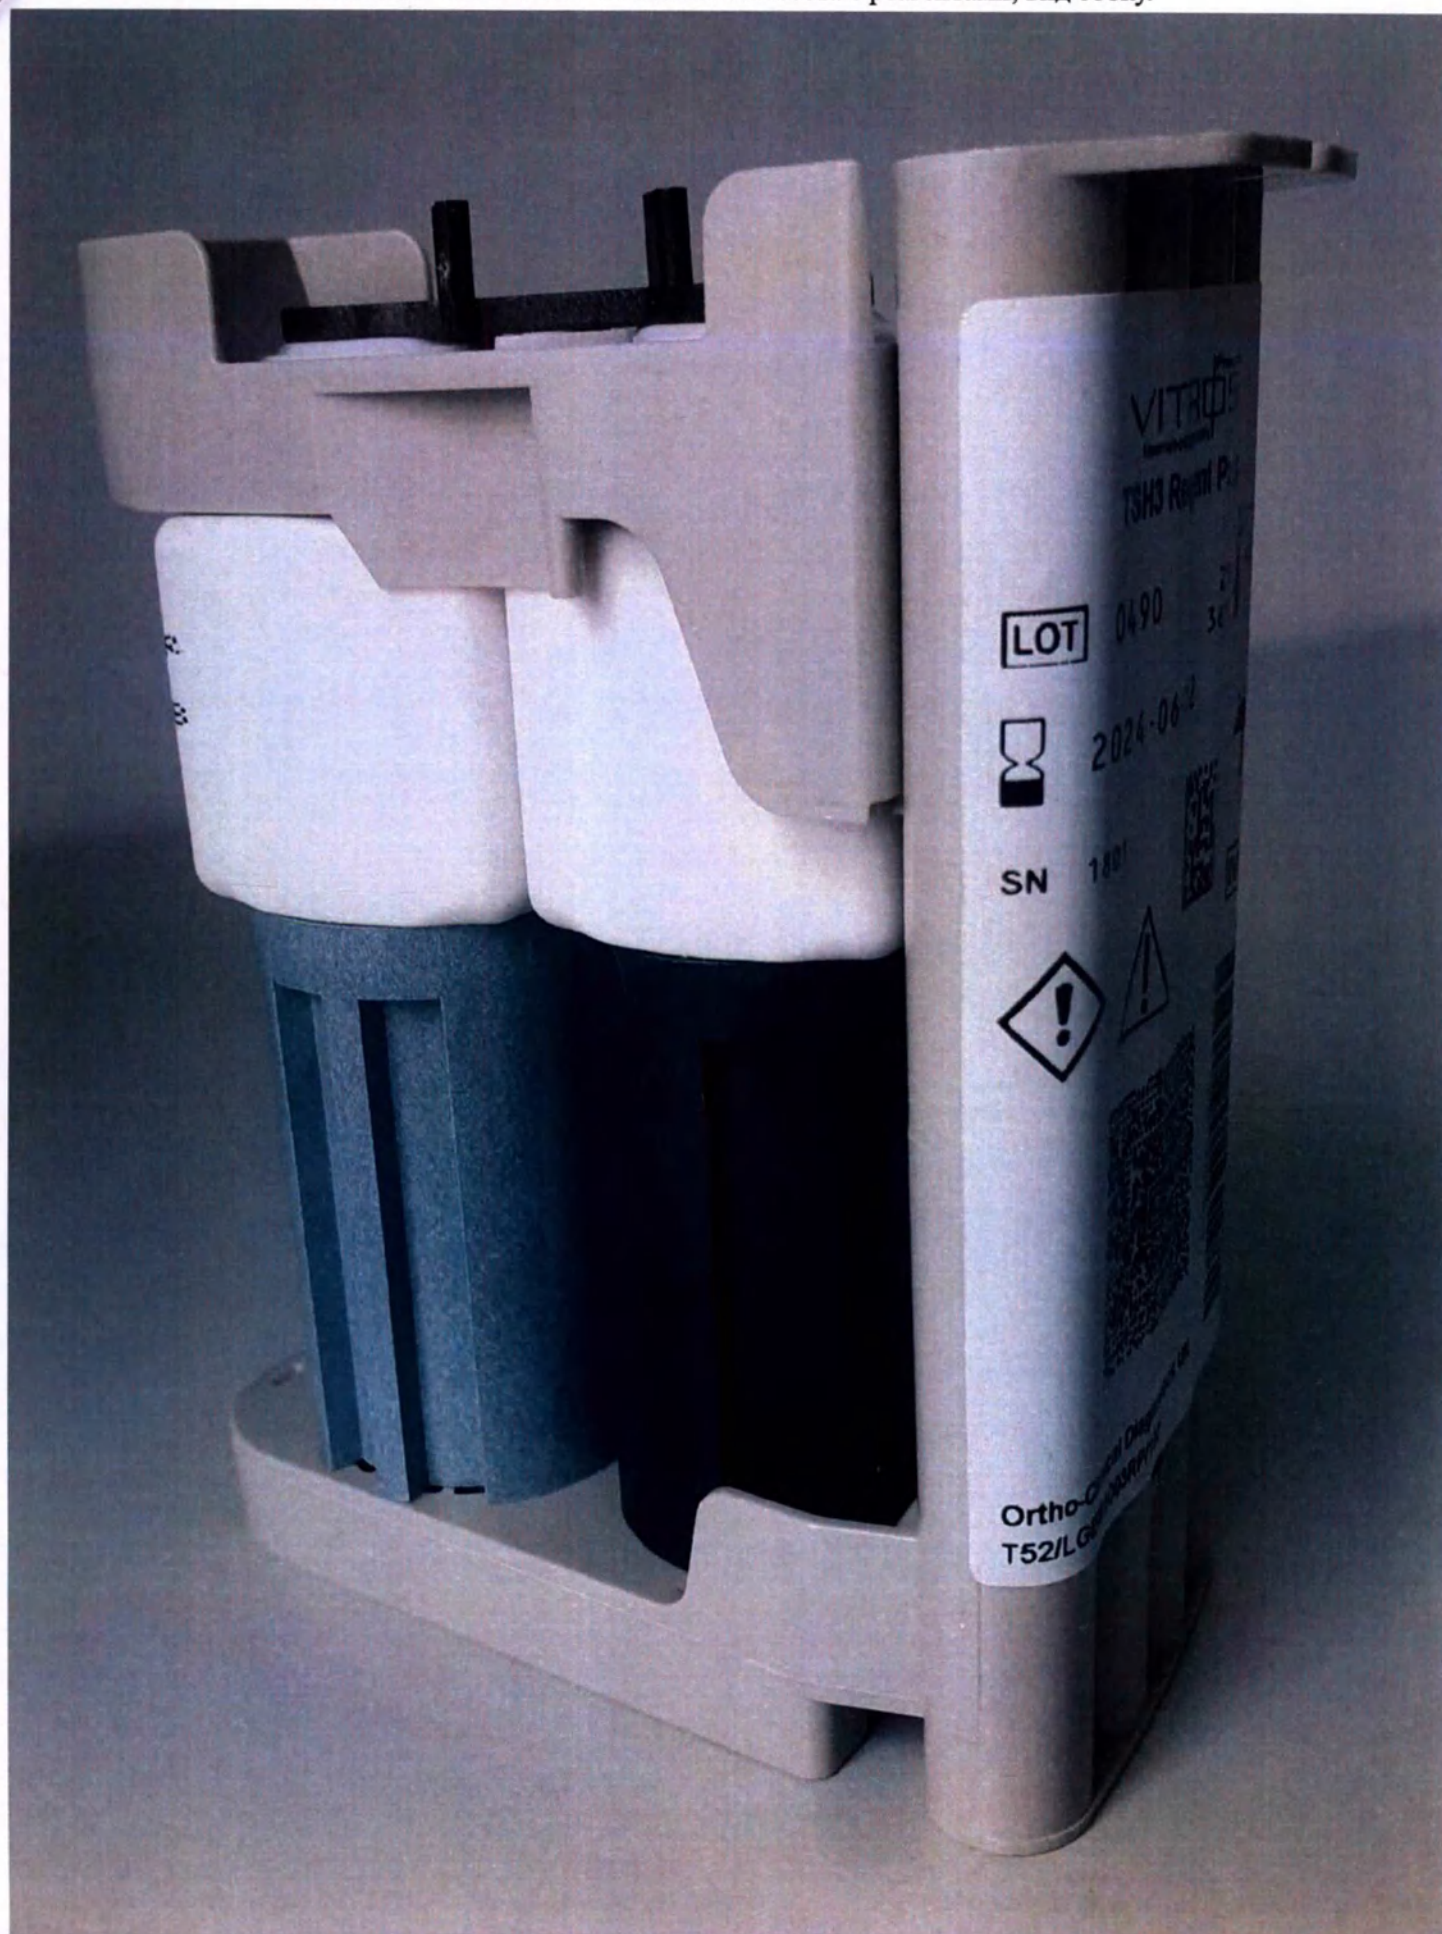

Реагенты VITROS ТТГЗ в кассете. Кассета с реагентами, вид спереди.

VITROS[®] Products
Immunodiagnostic

TSH3 Reagent Pack

LOT 0490

2°C
36°F



2024-06-12

1801



IVD



11004901801



Ortho-Clinical Diagnostics UK
LULGEM1003RP/100

ПРОШИТО. ПРОНУМЕРОВАНО

ВСЕГО 8 лист об

" " 20__ г.

Генеральный директор

ООО "Орто-Клиникал Диагностикс"

В.К. Сергеенко

