



Общество с ограниченной ответственностью
«АзияМедКонсалт»
Россия, 109004, Москва, ул. А. Солженицына, д. 27
Тел.: +7 495 988 47 44
ОГРН: 1137746433879
ИНН: 7709929540

ПОДТВЕРЖДАЮ


Директор по развитию
ООО «АМК»




Н. Н. Перцева
«10» октябрь 2024 г.

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ


Набор реагентов для количественного определения ракового антигена в сыворотке крови человека (CA15-3 CLIA Microparticles (CA15-3)) на анализаторах иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

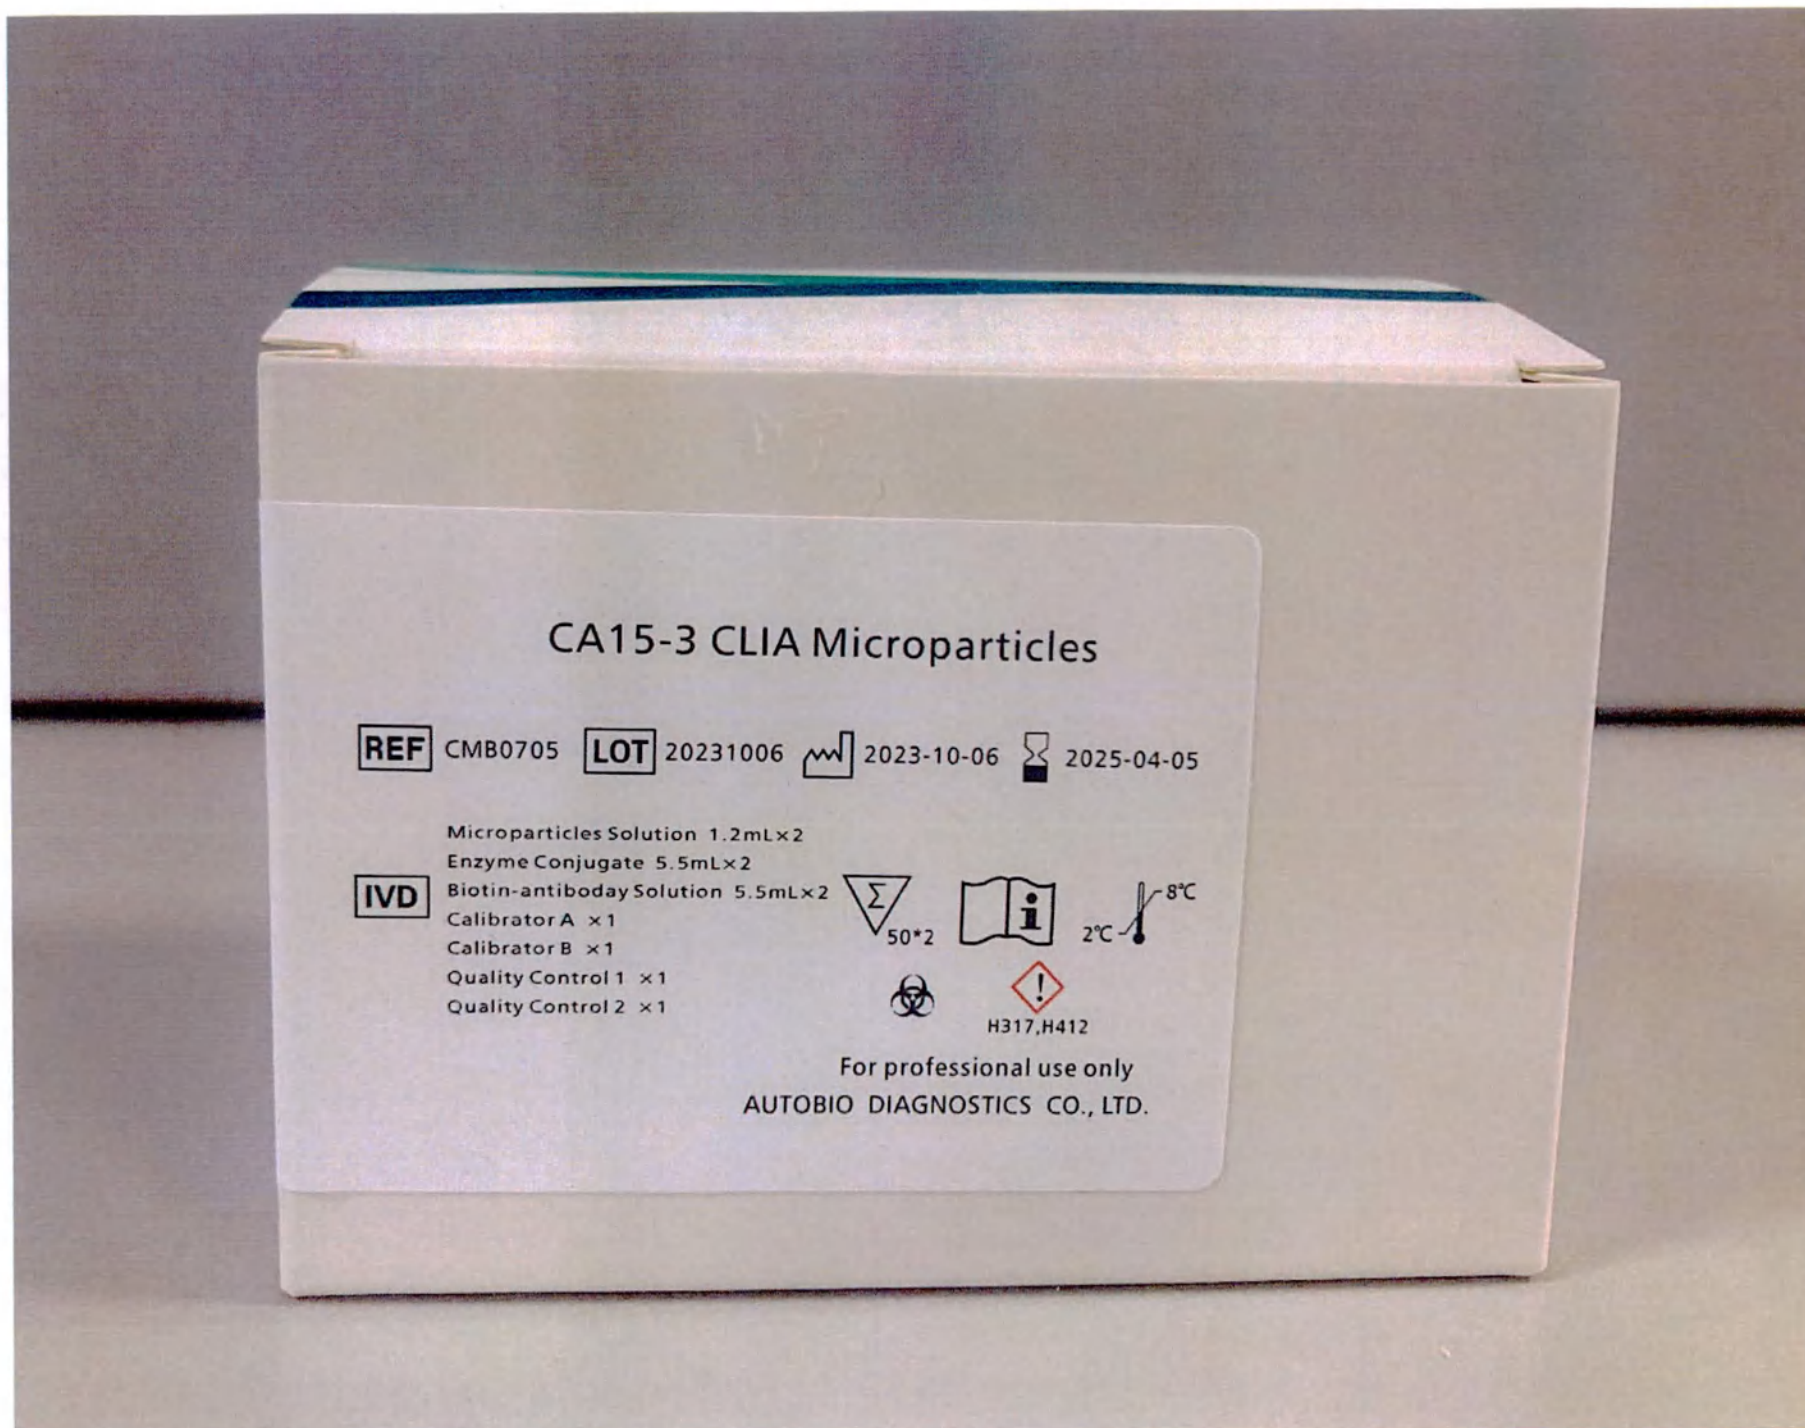

1. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов.

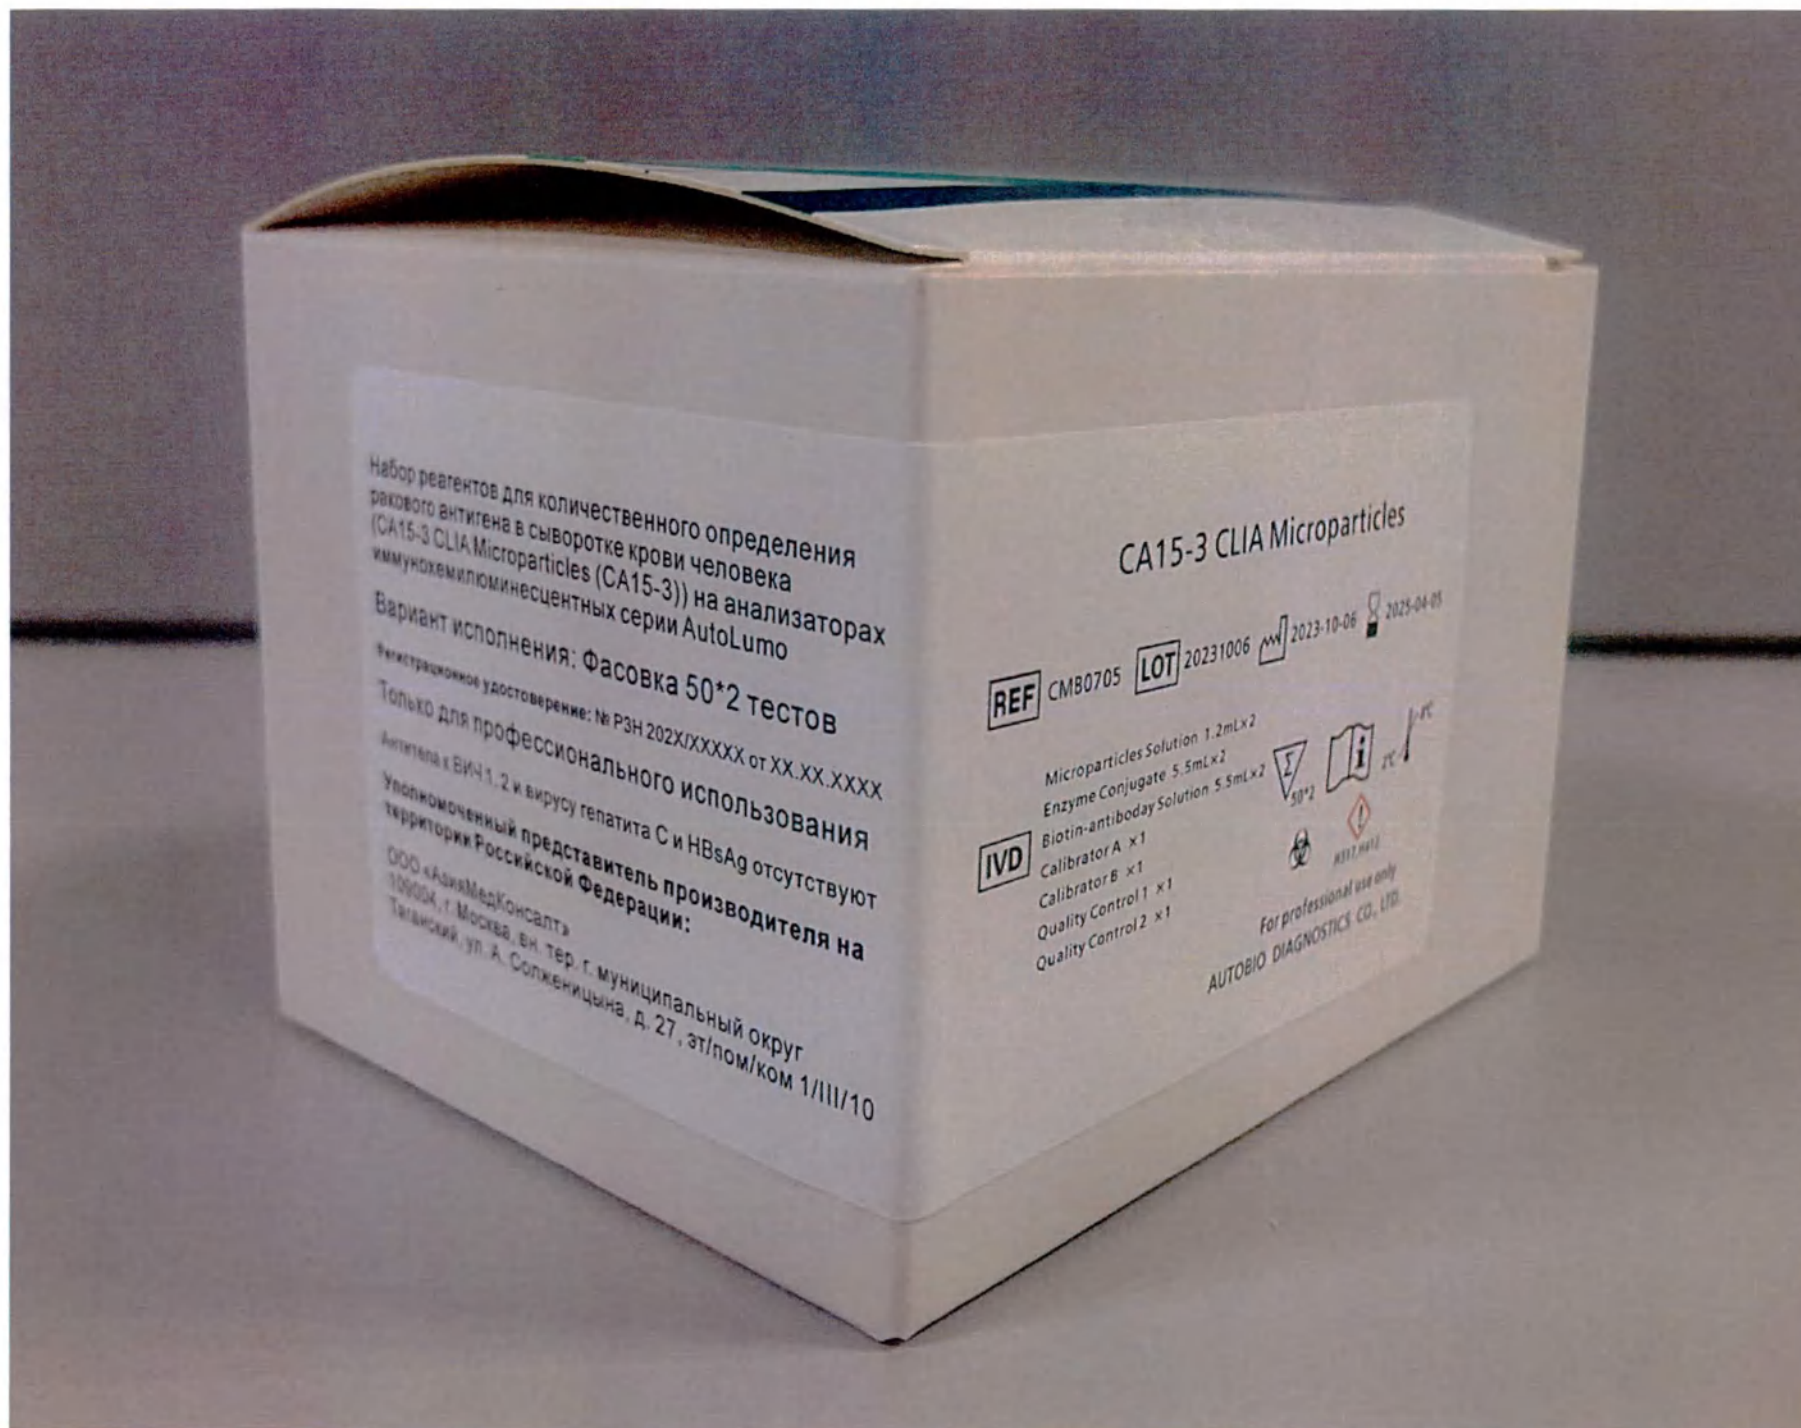

2. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов.

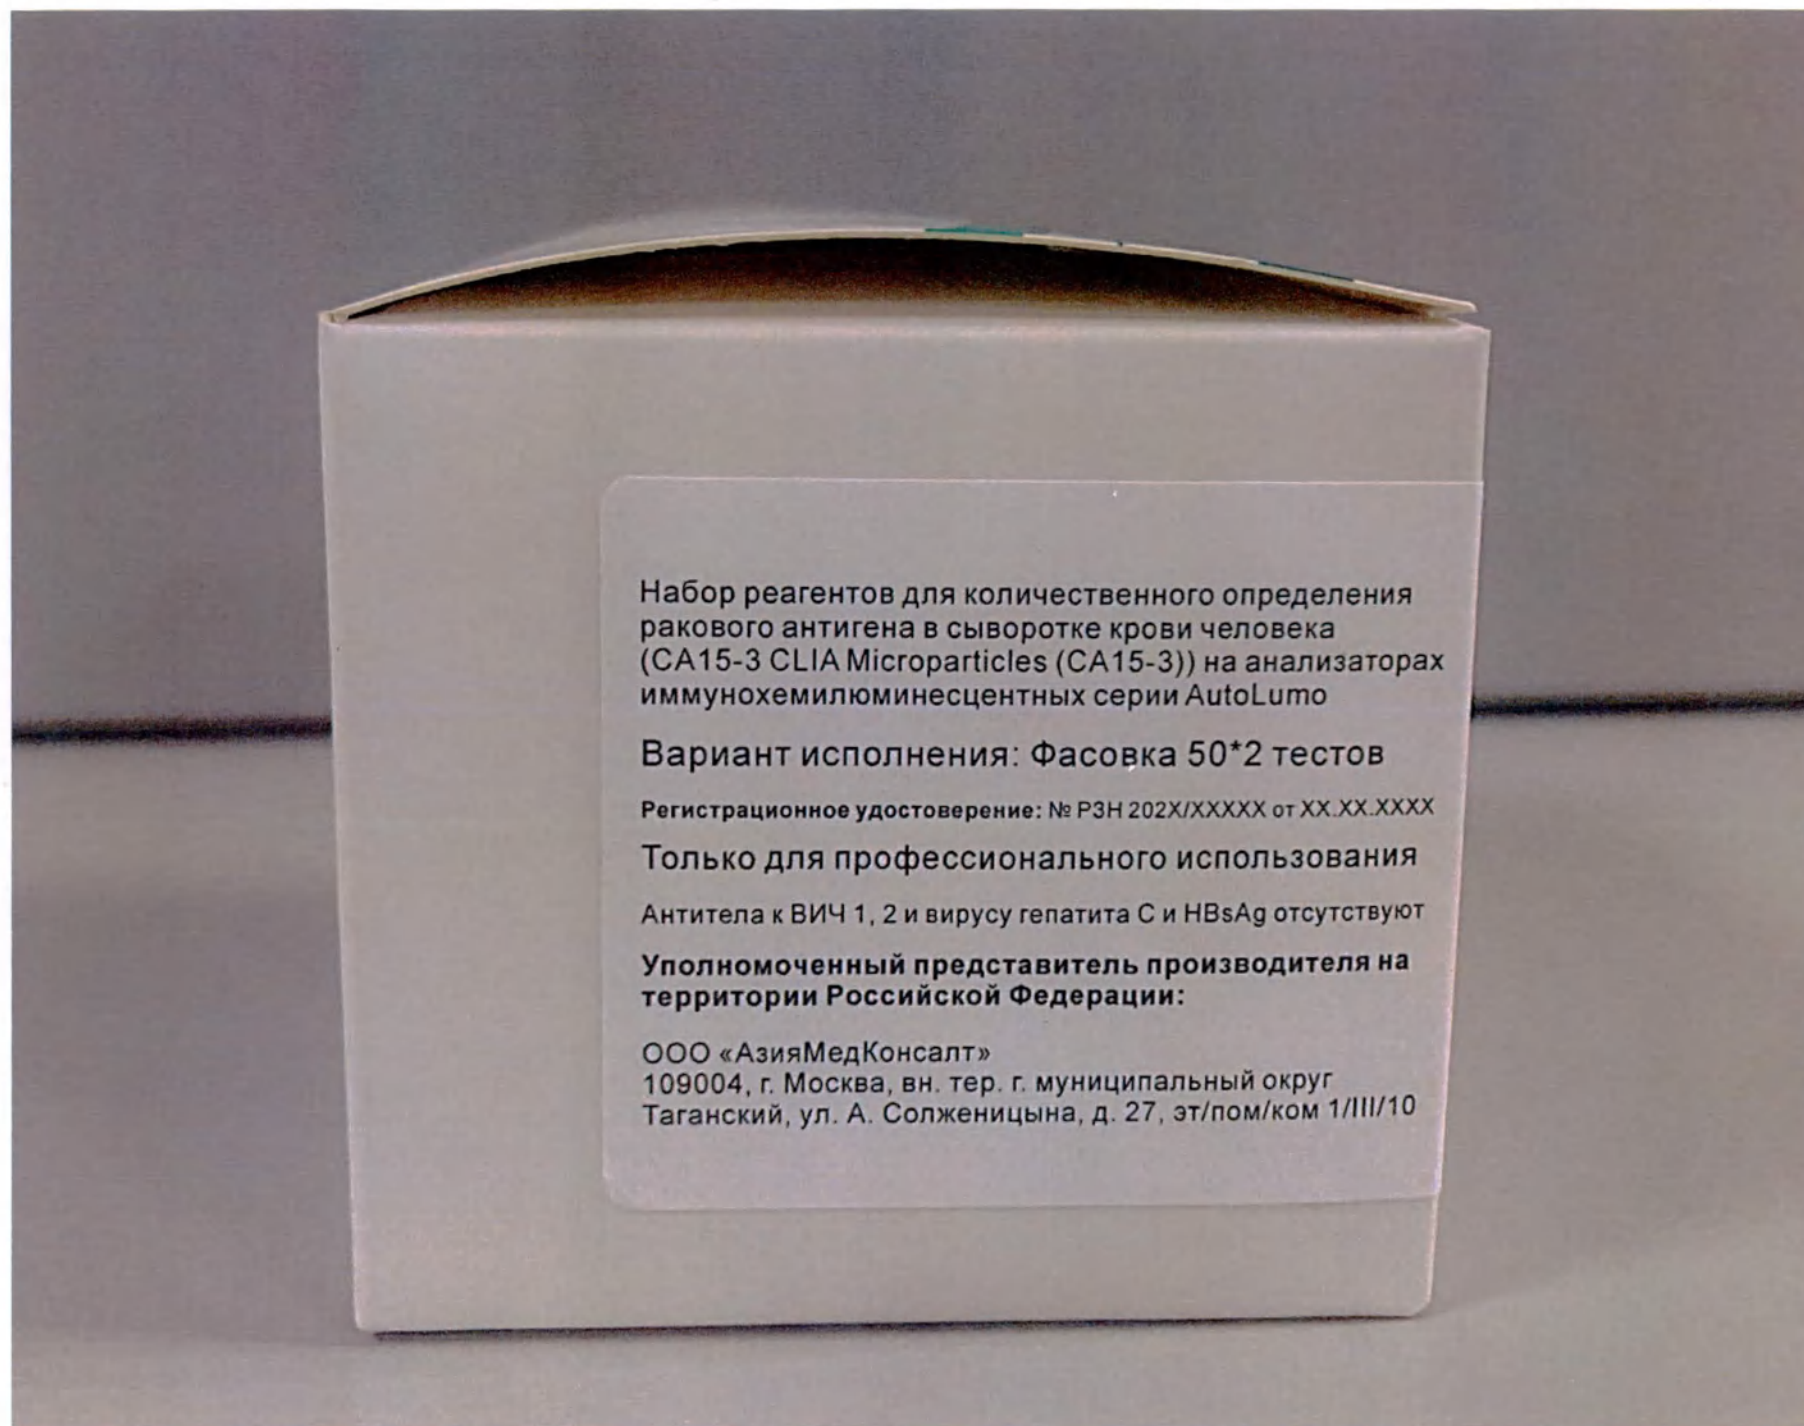

Набор реагентов для количественного определения
ракового антигена в сыворотке крови человека
(CA15-3 CLIA Microparticles (CA15-3)) на анализаторах
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXХ от ХХ.ХХ.ХХХХ

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

**Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации:**

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10


3. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов




4. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 50*2 тестов




5. Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки, фасовка 50*2 тестов

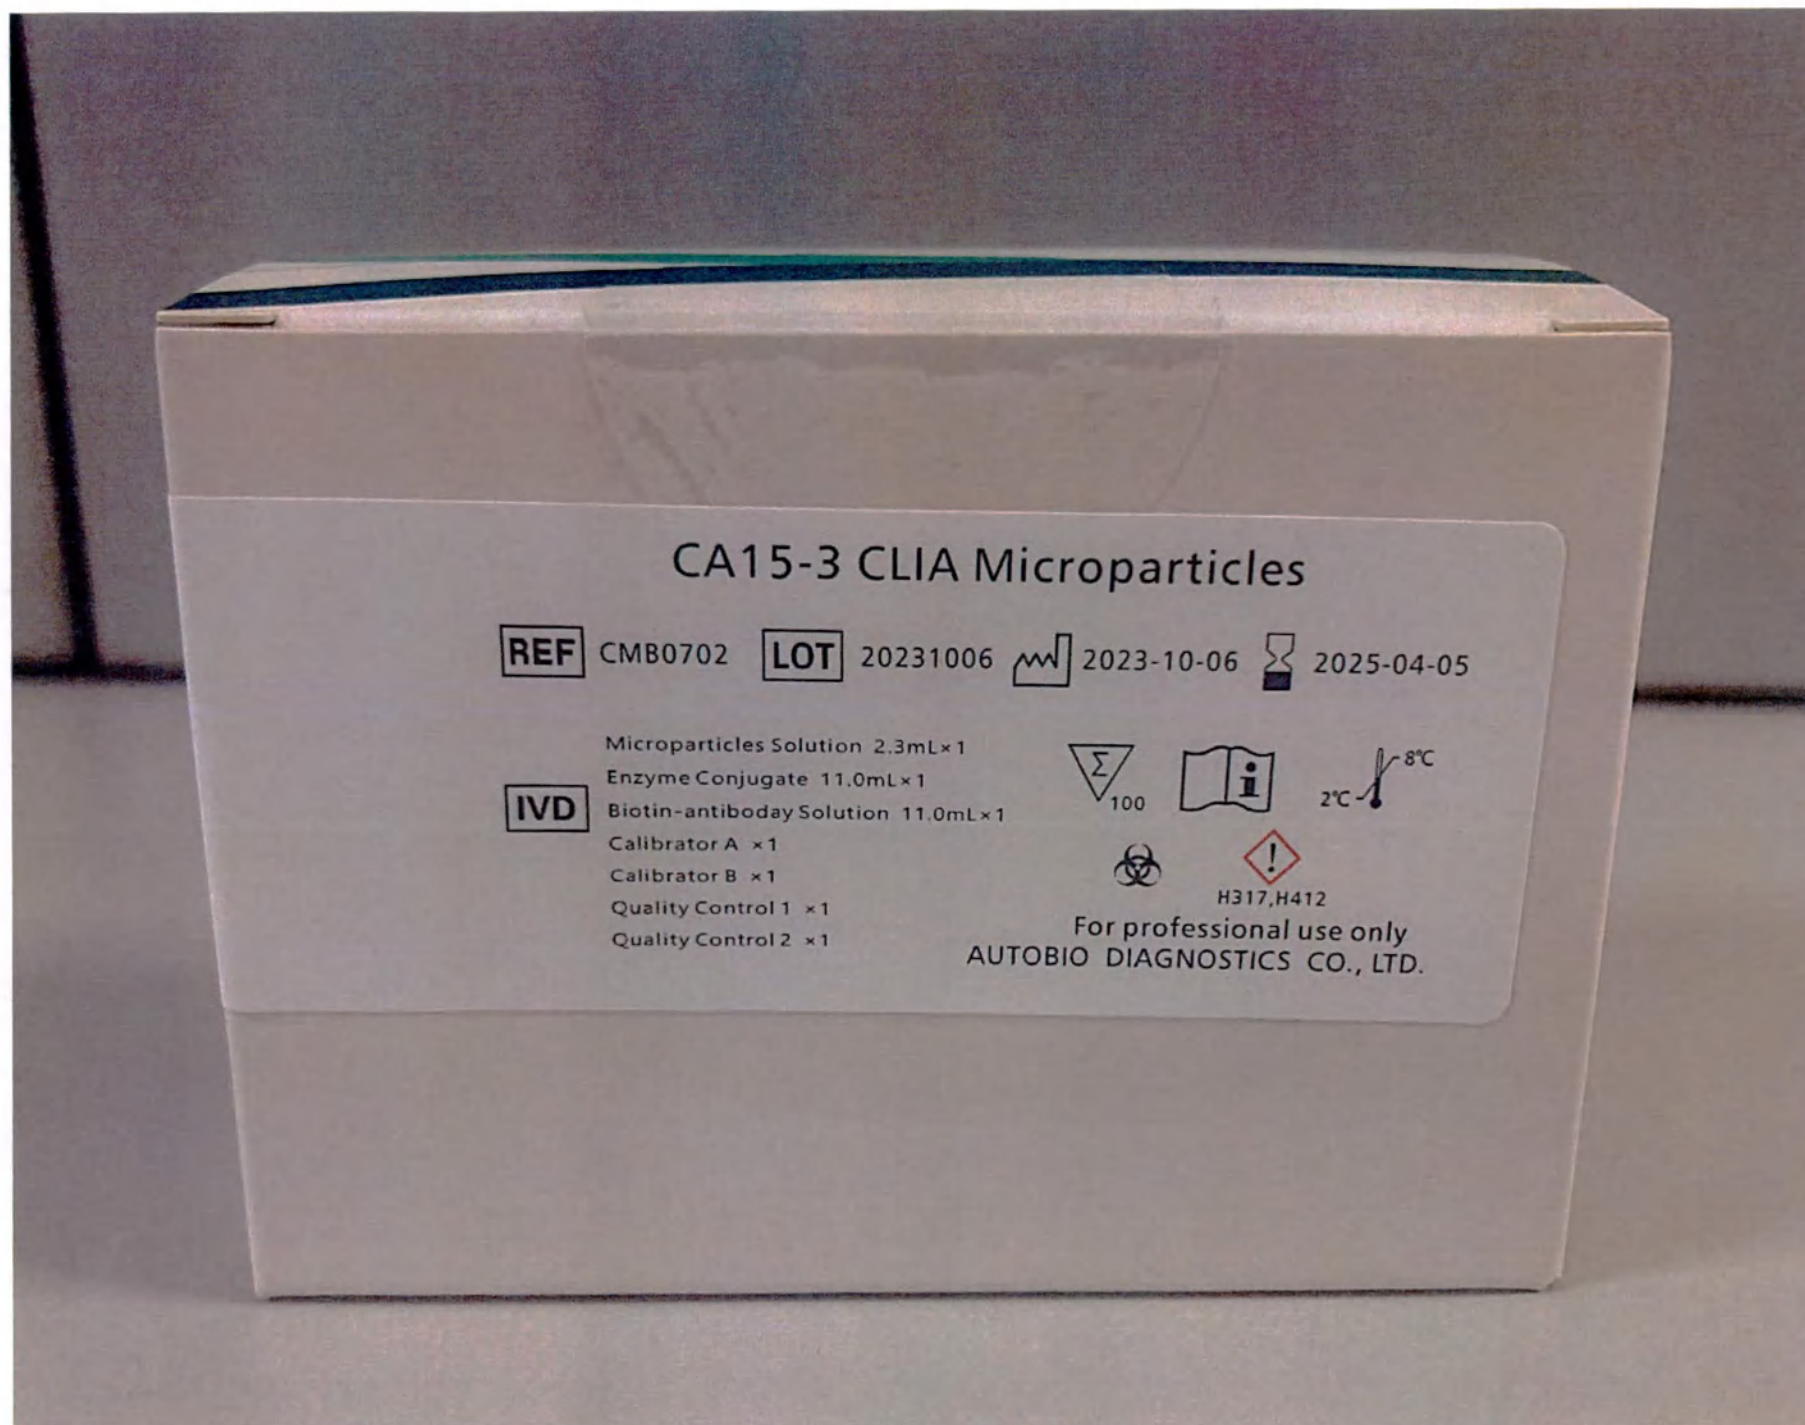

6. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100 тестов

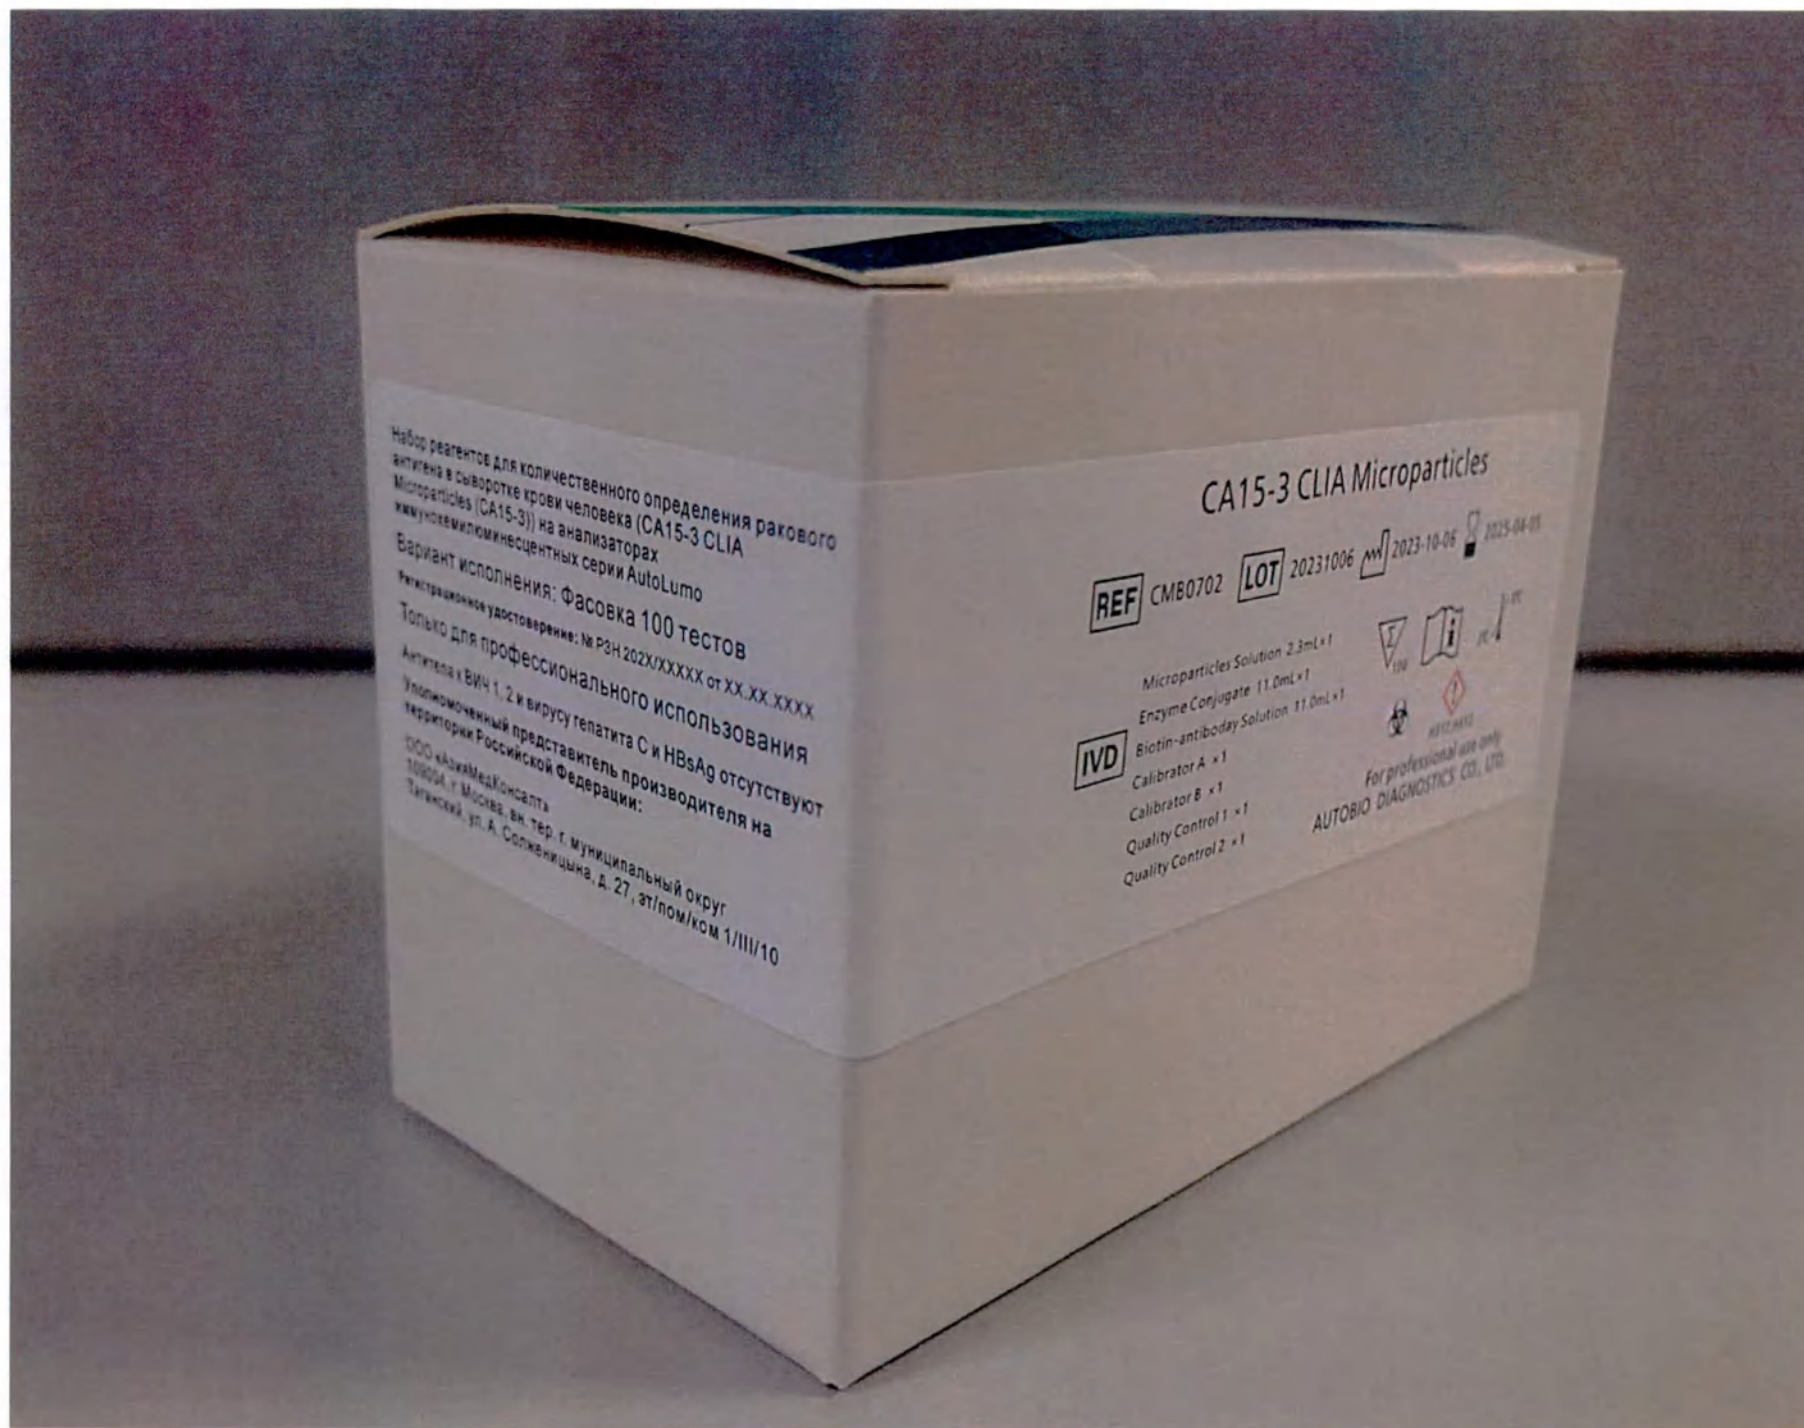


7. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100 тестов

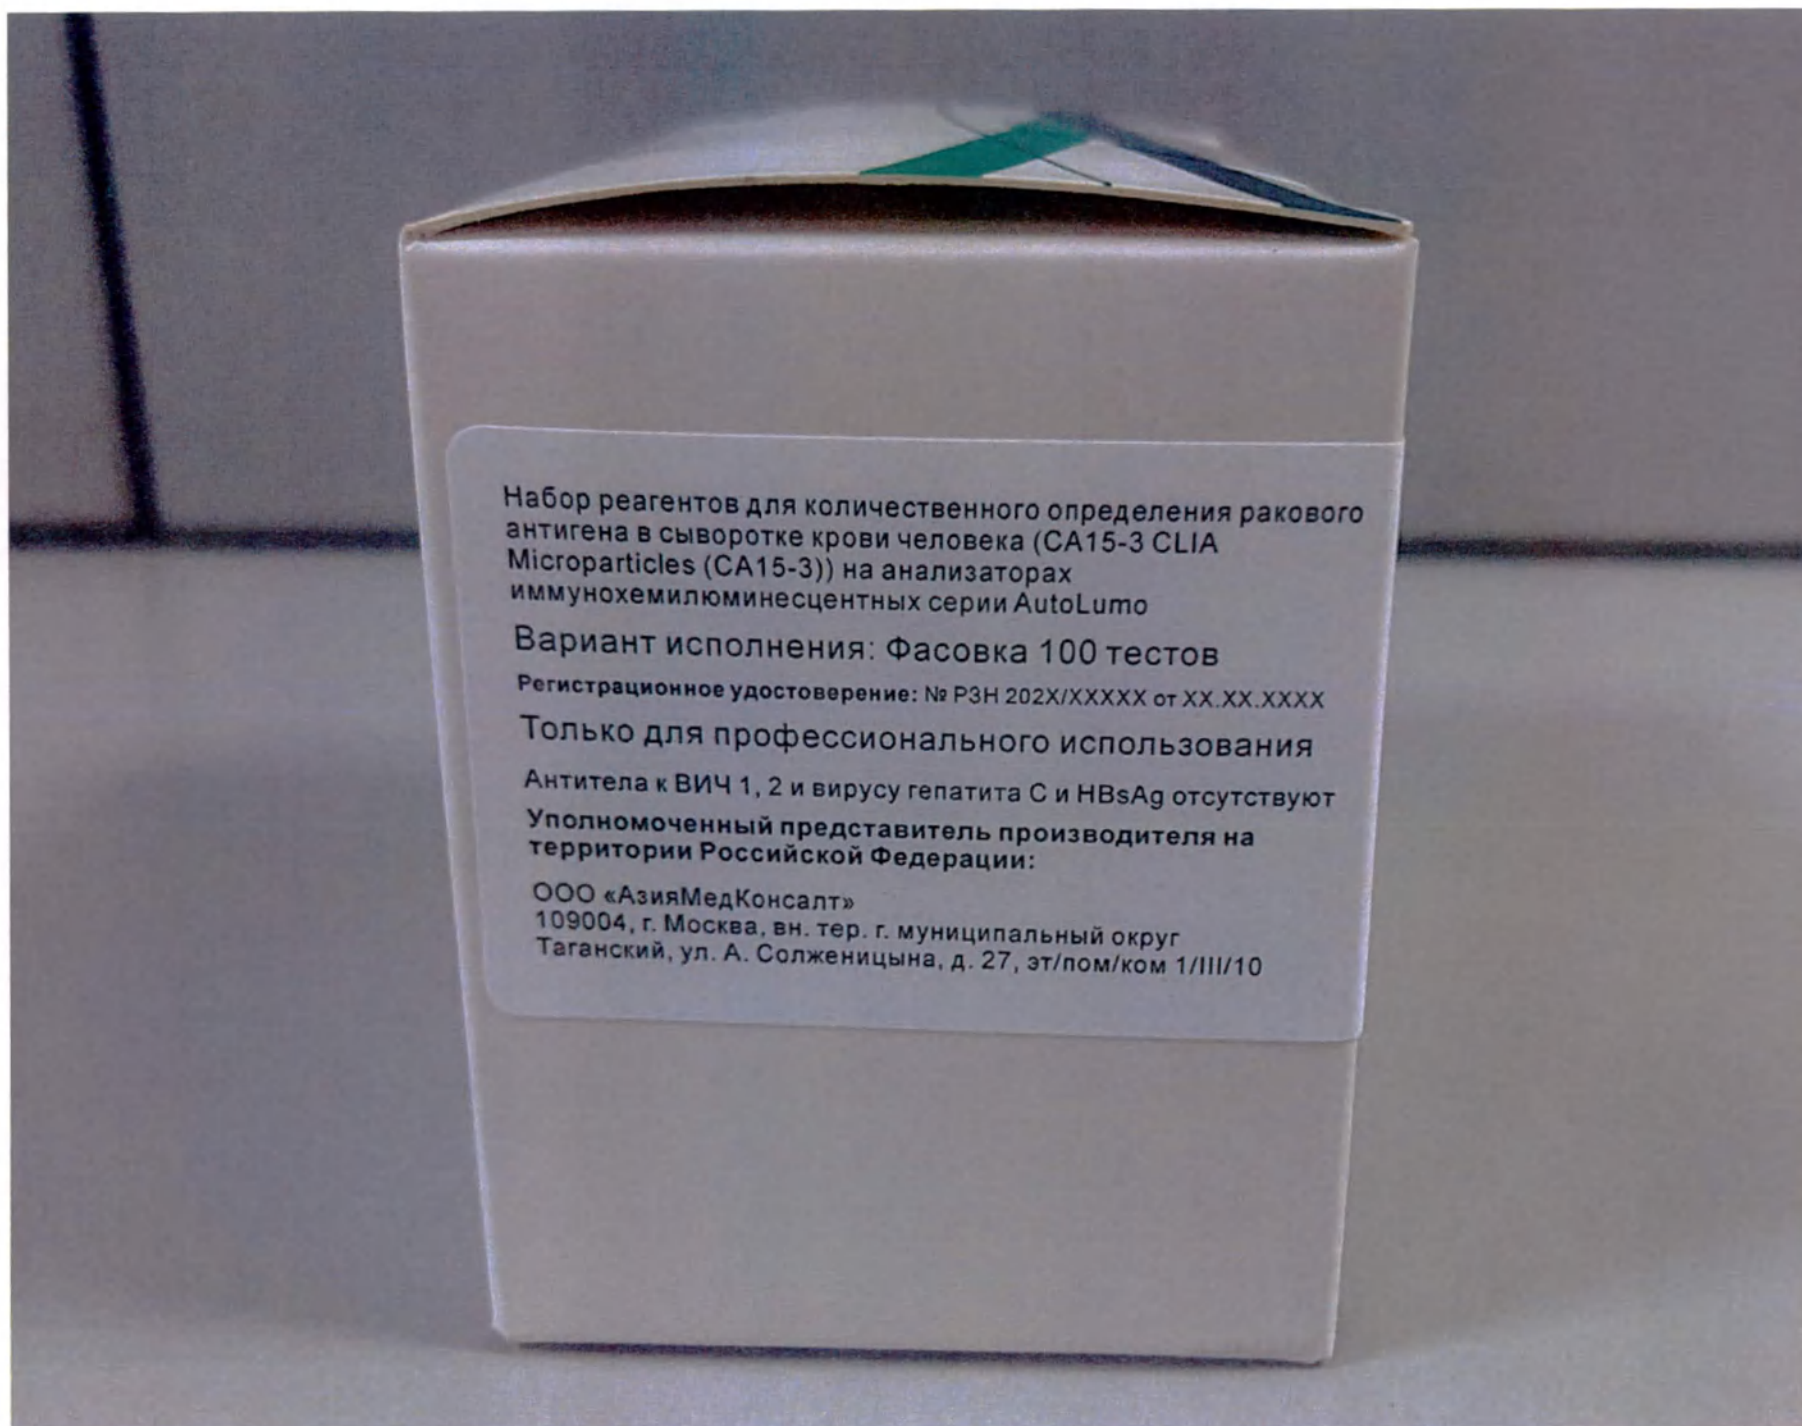


8. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100 тестов



9. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100 тестов

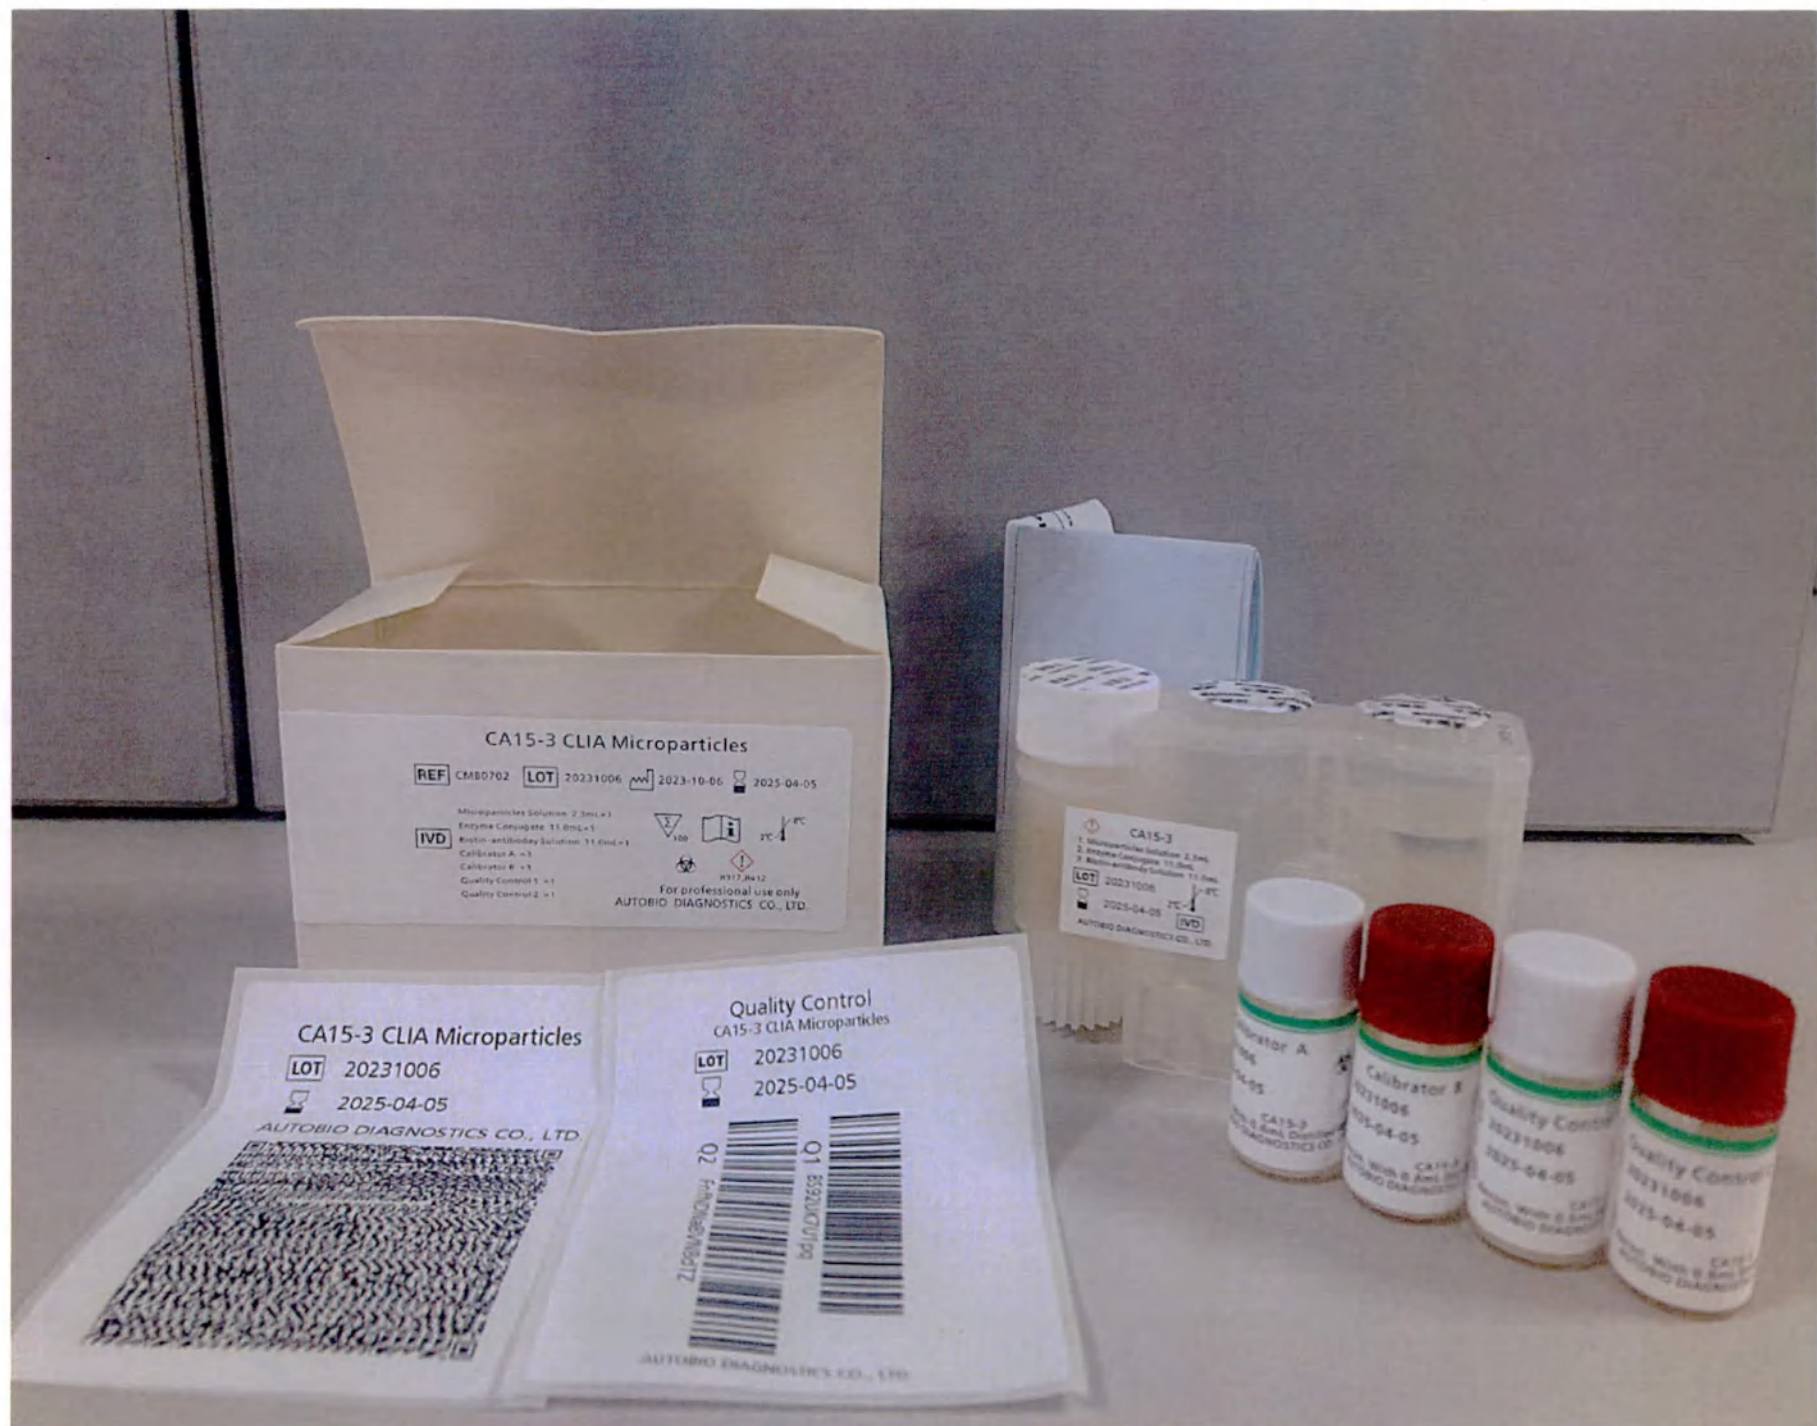


10. Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки, фасовка 100 тестов

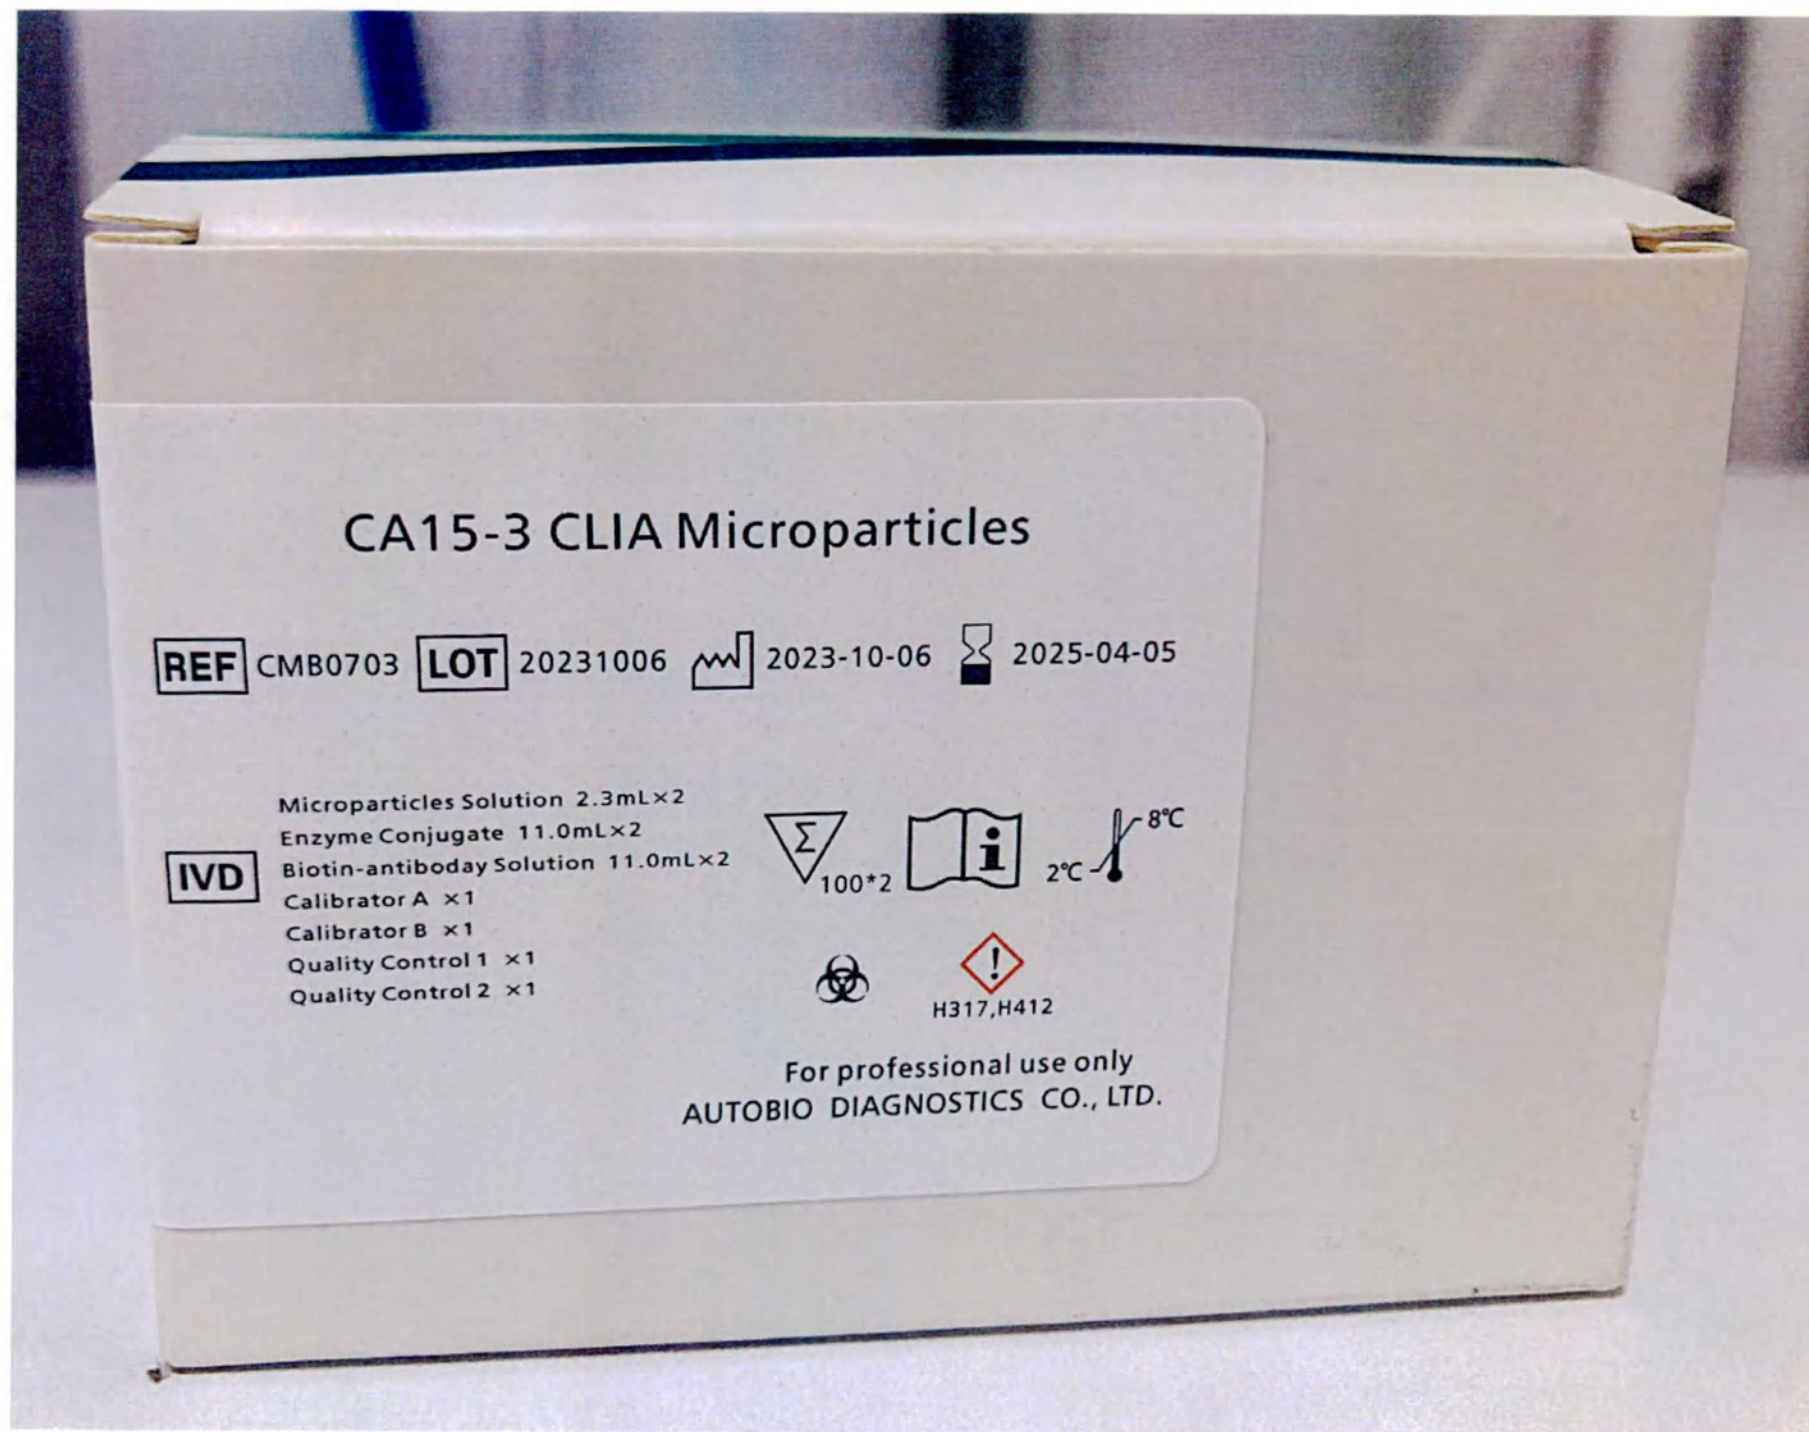

11. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100*2 тестов




12. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100*2 тестов

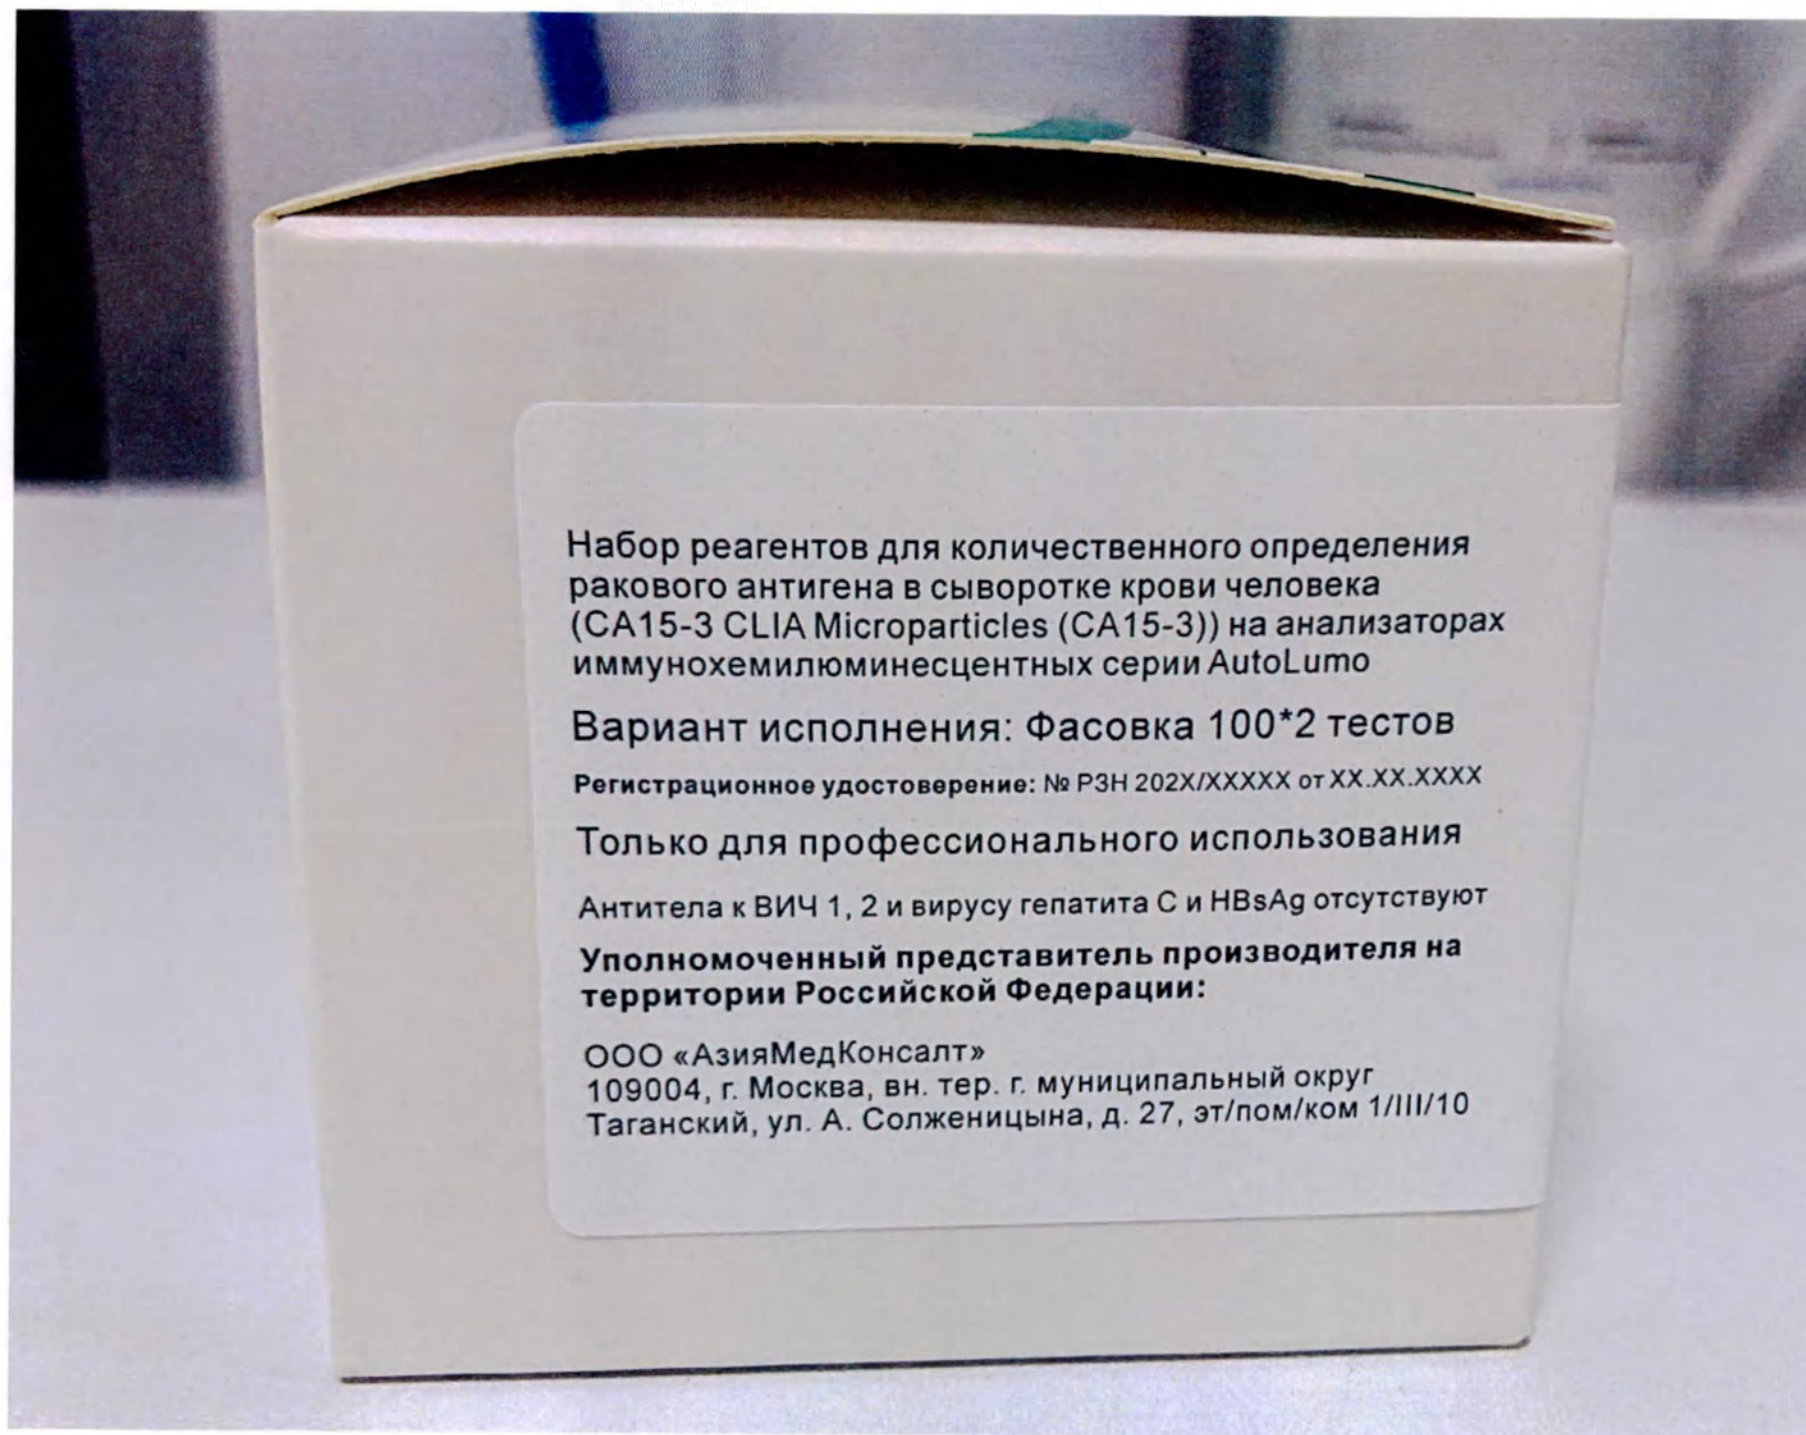

13. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100*2 тестов



14. Фотография набора реагентов до вскрытия внешней упаковки (коробка), фасовка 100*2 тестов

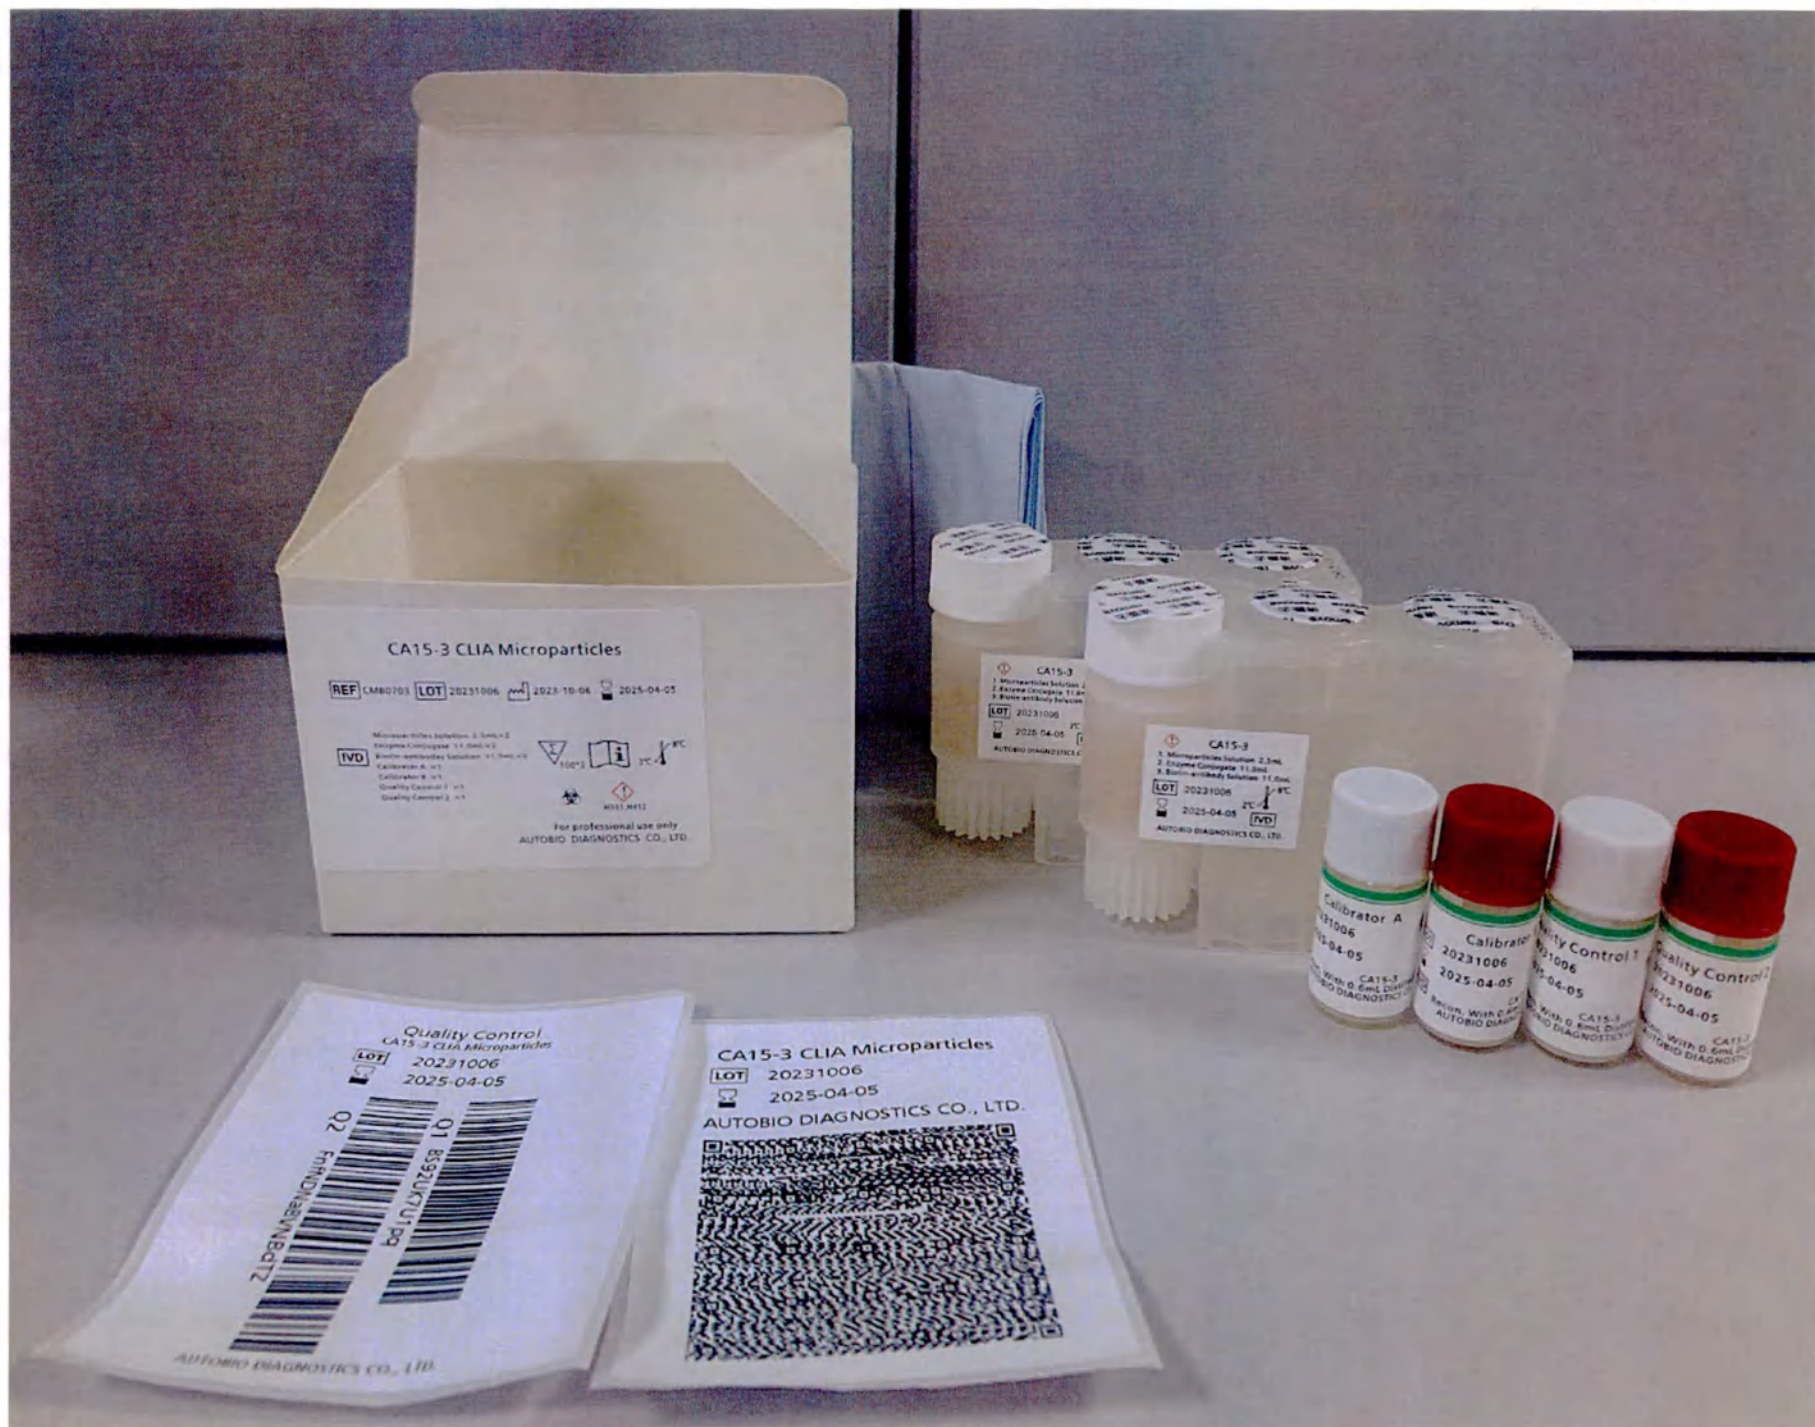

15. Фотография набора реагентов после вскрытия внешней упаковки, фасовка 100*2 тестов



16. Фотография картриджа (Вариант №1)



17. Фотография картриджа (вариант 2)



18. Фотография калибраторов (Calibrator A, Calibrator B)



19. Фотография калибраторов (Calibrator A, Calibrator B)



20. - Фотография калибраторов (Calibrator A, Calibrator B)




21. Фотография контролей (Quality Control 1, Quality Control 2)



22. Фотография контролей (Quality Control 1, Quality Control 2)



23. Фотография контролей (Quality Control 1, Quality Control 2)

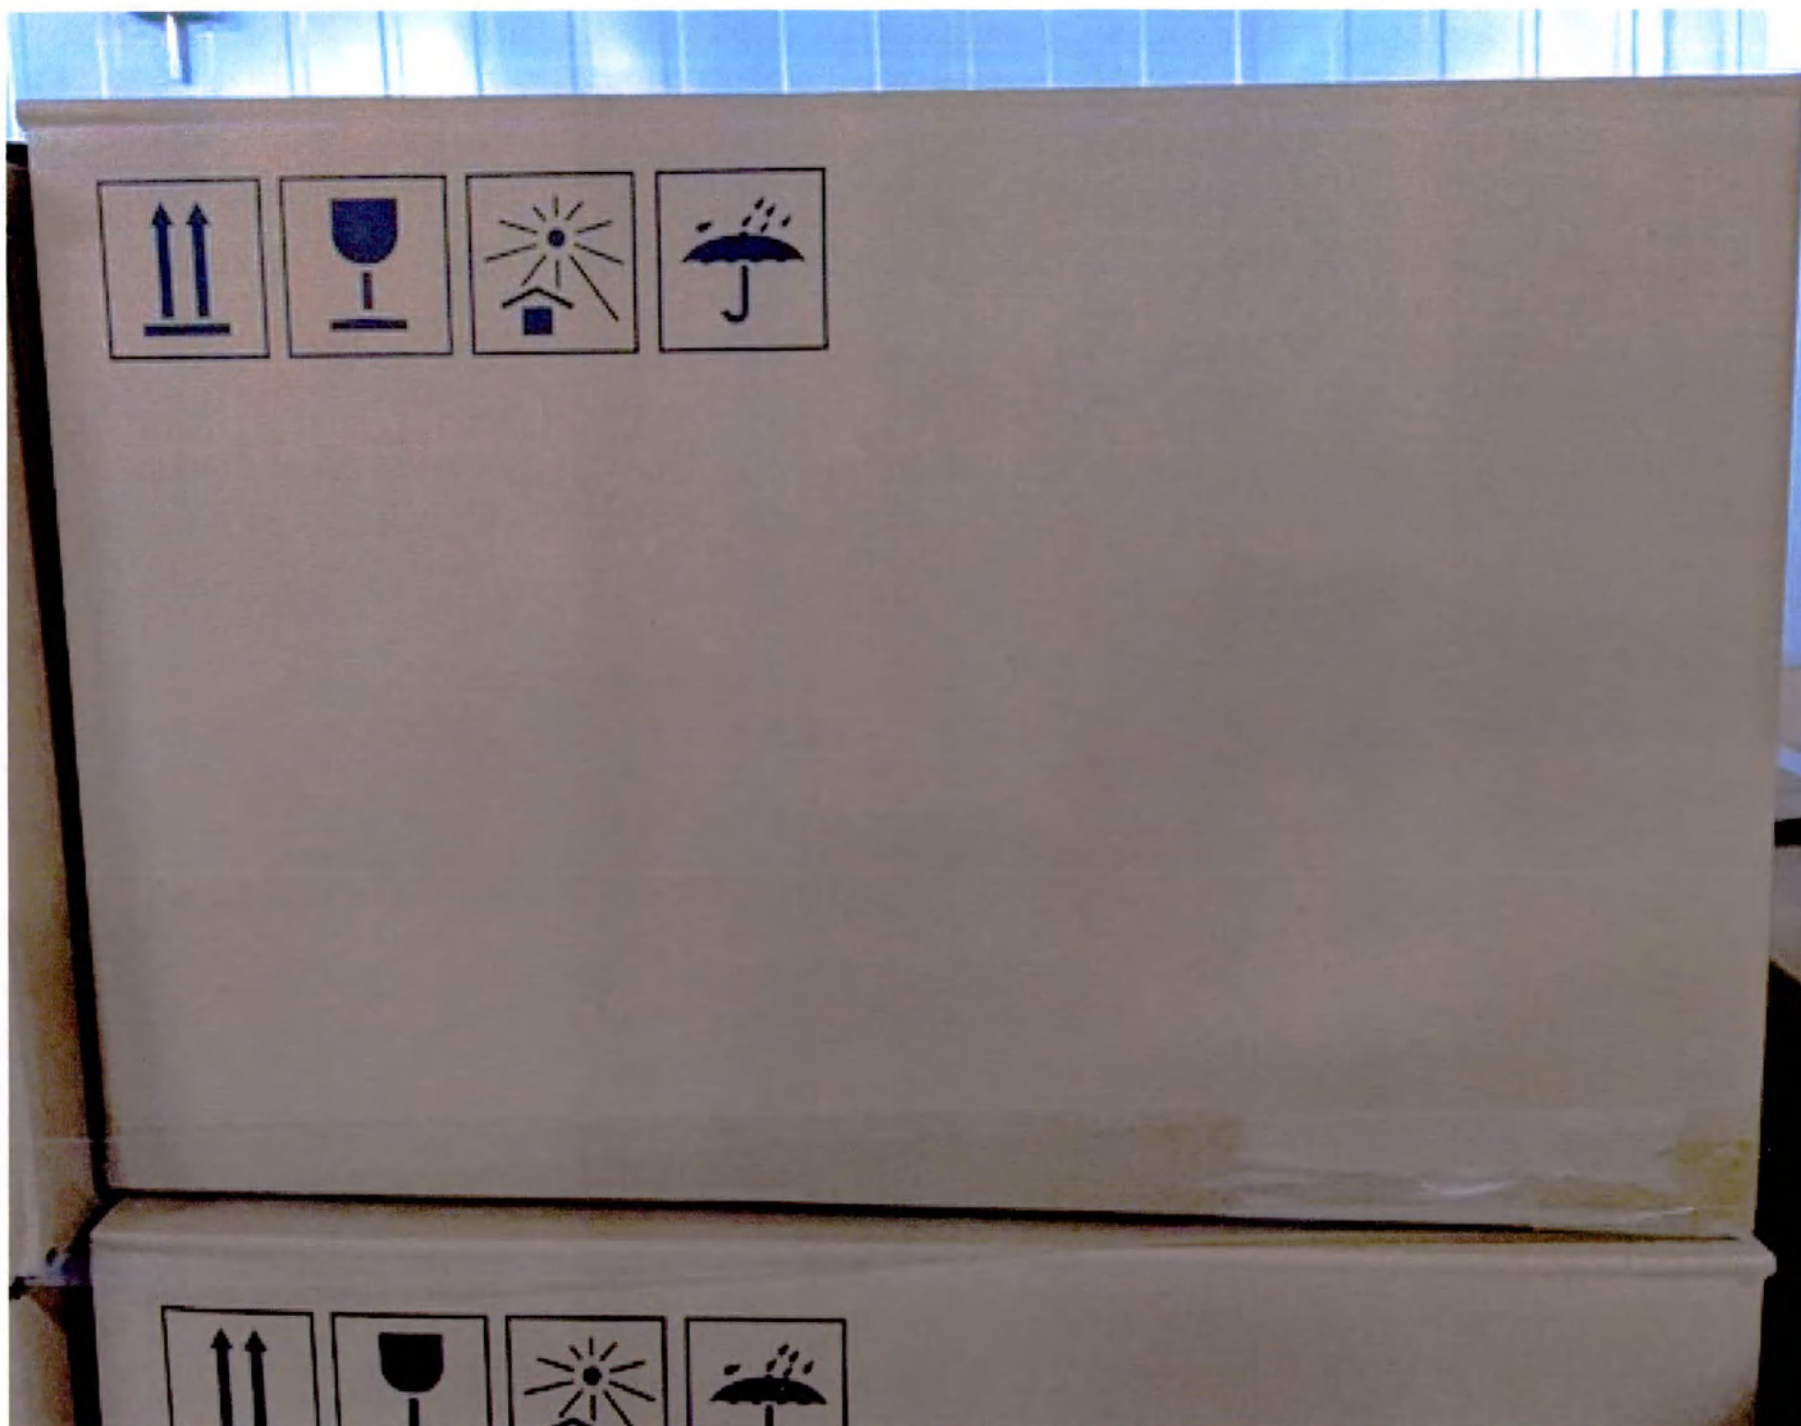

24. Фотография транспортной упаковки медицинского изделия.

Набор реагентов для количественного определения
ракового антигена в сыворотке крови человека
(CA15-3 CLIA Microparticles (CA15-3)) на анализаторах
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 50*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

CA15-3 CLIA Microparticles

REF CMB0705

LOT



Microparticles Solution 1.2mL×2
Enzyme Conjugate 5.5mL×2
Biotin-antibody Solution 5.5mL×2

IVD

Calibrator A ×1
Calibrator B ×1
Quality Control 1 ×1
Quality Control 2 ×1



H317, H412
For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

25.Макет русскоязычной маркировки для фасовки 50*2 тестов

Набор реагентов для количественного определения ракового
антигена в сыворотке крови человека (CA15-3 CLIA
Microparticles (CA15-3)) на анализаторах
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

CA15-3 CLIA Microparticles

REF CMB0702

LOT



Microparticles Solution 2.3mL×1
Enzyme Conjugate 11.0mL×1
Biotin-antibody Solution 11.0mL×1

IVD

Calibrator A ×1
Calibrator B ×1
Quality Control 1 ×1
Quality Control 2 ×1



H317, H412
For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

26. Макет русскоязычной маркировки для фасовки 100 тестов

Набор реагентов для количественного определения
ракового антигена в сыворотке крови человека
(CA15-3 CLIA Microparticles (CA15-3)) на анализаторах
иммунохемилюминесцентных серии AutoLumo

Вариант исполнения: Фасовка 100*2 тестов

Регистрационное удостоверение: № РЗН 202Х/XXXXX от XX.XX.XXXX

Только для профессионального использования

Антитела к ВИЧ 1, 2 и вирусу гепатита С и HBsAg отсутствуют

Уполномоченный представитель производителя на
территории Российской Федерации:

ООО «АзияМедКонсалт»
109004, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ
Таганский, ул. А. Солженицына, д. 27, эт/пом/ком 1/III/10

CA15-3 CLIA Microparticles

REF CMB0703

LOT



Microparticles Solution 2.3mL×2
Enzyme Conjugate 11.0mL×2
Biotin-antibody Solution 11.0mL×2

IVD

Calibrator A ×1
Calibrator B ×1
Quality Control 1 ×1
Quality Control 2 ×1



H317, H412
For professional use only
AUTOBIO DIAGNOSTICS CO., LTD.

27.Макет русскоязычной маркировки для фасовки 100*2 тестов

Пронумеровано, прошито и
скреплено печатью на 26
Свидетельств листах

