



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

На медицинское изделие
Машины моюще-дезинфицирующие WD с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
"СМЕГ С.п.А.", Италия,
SMEG S.p.A., Via Leonardo da Vinci 4, 42016 Guastalla (RE), Italy

Производитель
"СМЕГ С.п.А.", Италия,
SMEG S.p.A., Via Leonardo da Vinci 4, 42016 Guastalla (RE), Italy

Место производства медицинского изделия
BONFERRARO S.p.A., Via Oberdan 57 - 37060 Bonferraro di sorga (VR), Italy

Номер регистрационного досье № РД-63626/55377 от 18.07.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2a

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 19 листах

приказом Росздравнадзора от 28 августа 2024 года № 491/РЗН
допущено к обращению на территории Российской Федерации

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0076812

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 1

На медицинское изделие

Машины моюще-дезинфицирующие WD с принадлежностями,
варианты исполнения:

I. WD1160, WD1160D, WD1160-1, WD1160D1 в составе:

1. Машина моюще-дезинфицирующая - 1 шт.
2. Карта коммуникации WD-LANE - 1 шт. (при необходимости).
3. Крышка для моющих машин TOP60I - 1 шт. (при необходимости).
4. Датчик уровня моющего средства LS5010 - не более 5 шт. (при необходимости).
5. Насос перистальтический для дезинфицирующего средства P34060H - не более 5 шт. (при необходимости).
6. Устройство управления дозированием для дополнительных насосов перистальтических FLUX 4060 - не более 5 шт. (при необходимости).
7. Держатель, в исполнениях:
 - 7.1. BFS, для расширителей - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.2. SA3, для 3-х почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.3. SBAS5, для 5-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.4. SBAS6, для 6-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.5. SCVO, для оптического кабеля - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.6. D-LCN2, для канюль - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.7. D-SM1260E, для наконечников 12-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.8. D-SM4E, для наконечников 4-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.9. D-SM8E, для наконечников 8-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.10. D-SB2, для 2-х корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.11. D-SB3, для 3-х корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.12. D-SCT8I, для 8-ми крышек - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.13. D-SIMS, для 6-ти IMS корзин или 12 1/2 IMS корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.14. D-ST10, для 10-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.15. D-ST11, для 11-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.16. D-ST16, для 16-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.17. SPD, для щипцов - не более 10 шт. (при необходимости).
8. Корзина для детских бутылочек, в исполнениях:
 - 8.1. CB18 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 8.2. CB18/100 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 8.3. CB18/120 - не более 10 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0148713


ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 2

9. Корзина для сосок CPS20 - не более 10 шт. (при необходимости).
10. Корзина вертикальная D-SV - не более 10 шт. (при необходимости).
11. Корзина для инструментов высокая D-CM1 - не более 10 шт. (при необходимости).
12. Корзина для мелкого инструментария, в исполнениях:
 - 12.1. CSMICRO1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.2. CSMICRO2 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.3. CSMICRO3 - не более 10 шт. (при необходимости).
13. Корзина для наконечников KITD-SM4E - не более 10 шт. (при необходимости).
14. Корзина для инструментов малоинвазивной хирургии KITMIC10 - не более 10 шт. (при необходимости).
15. Корзина для хирургических инструментов, в исполнениях:
 - 15.1. CSK1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 15.2. CSK1/3 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 15.3. CSK1/6 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 15.4. CSK2 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 15.5. CSKDIN - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 15.6. CSKL - не более 10 шт. (при необходимости).
16. Тележка для корзин, в исполнениях:
 - 16.1. CS1-1, верхняя - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 16.2. CS2, нижняя - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 16.3. CS3, универсальная - не более 10 шт. (при необходимости).
17. Тележка загрузочная, в исполнениях:
 - 17.1. CM3, для хирургических масок - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.2. CSKSTOV, для посуды - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.3. CPC1B, для контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.4. CPCENDO, для эндоскопических контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.5. CSK4B, двухуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.6. CSK4BMIC, двухуровневая для инструментов малоинвазивной хирургии - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.7. CSK6B, трехуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.8. CSK8B, четырехуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
18. Тележка разгрузочная с подставкой DIS-WBS - не более 10 шт. (при необходимости).
19. Тележка для операционной обуви, в исполнениях:
 - 19.1. ZCS1 - не более 10 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

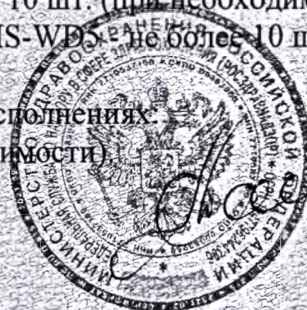

А.В. Самойлова

0148714

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 3

19.2. ZCS2 - не более 10 шт. (при необходимости).

19.3. ZCS3 - не более 10 шт. (при необходимости).

20. Руководство пользователя - 1 шт.

Принадлежности:

1. Бак дополнительный для деминерализованной воды, в исполнениях:

1.1. PD50, 50 л - 1 шт.

1.2. SDA50, 50 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.

1.3. SDA100, 100 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.

2. Бумага для принтера WD-PAPER - не более 30 рулонов.

3. Картридж для принтера, в исполнениях:

3.1. INKDP24 - не более 12 шт.

3.2. SGRINK, для термопринтера - не более 12 шт.

4. Комплект для подключения KITCON232 в составе: - 1 шт.

- USB - конвертер RS232;

- соединительный кабель male-female;

- соединительный кабель female-female;

- кабель USB;

- USB-флэш-накопитель.

5. Набор переходников для инструментов с канюлями KITLUER в составе: - не более 10 шт.:

- силиконовые трубки - 3 шт.

- переходники Луер-Лок - 3 шт.

- силиконовые переходники диаметром 1 мм - 3 шт.

- силиконовые переходники диаметром 6 мм - 3 шт.

- силиконовые переходники диаметром 10 мм - 3 шт.

- конусообразные силиконовые переходники - 3 шт.

6. Насос бустерный для деминерализованной воды, в исполнениях:

6.1. PAD - 1 шт.

6.2. PAD1 - 1 шт.

6.3. PAD2 - 1 шт.

6.4. PAD2X, из нержавеющей стали - 1 шт.

7. Подставка для моющих машин B6040L - 1 шт.

8. Принтер внешний WD-PRINTE - 1 шт.

9. Реле для насоса бустерного для деминерализованной воды PAD2R - 1 шт.

II. WD2145, WD2145D в составе:

1. Машина моюще-дезинфицирующая - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0148715

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 4

2. Крышка для моющих машин TOP45I - 1 шт. (при необходимости).
3. Датчик уровня моющего средства LS5010 - не более 5 шт. (при необходимости).
4. Держатель, в исполнениях:
 - 4.1. BFS, для расширителей - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.2. SA3, для 3-х почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.3. SBAS5, для 5-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.4. SBAS6, для 6-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.5. SCVO, для оптического кабеля - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.6. D-LCN2, для канюль - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.7. D-SM1260E, для наконечников 12-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.8. D-SM4E, для наконечников 4-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.9. D-SM8E, для наконечников 8-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.10. D-SB2, для 2-х корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.11. D-SB3, для 3-х корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.12. D-SCT8I, для 8-ми крышек - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.13. D-SIMS, для 6-ти IMS корзин или 12 1/2 IMS корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.14. D-ST10, для 10-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.15. D-ST11, для 11-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.16. D-ST16, для 16-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 4.17. SPD, для щипцов - не более 10 шт. (при необходимости).
5. Корзина для детских бутылочек, в исполнениях:
 - 5.1. CB18 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.2. CB18/100 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 5.3. CB18/120 - не более 10 шт. (при необходимости).
6. Корзина для сосок CPS20 - не более 10 шт. (при необходимости).
7. Корзина вертикальная D-SV - не более 10 шт. (при необходимости).
8. Корзина для инструментов высокая D-CM1 - не более 10 шт. (при необходимости).
9. Корзина для мелкого инструментария, в исполнениях:
 - 9.1. CSMICRO1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.2. CSMICRO2 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.3. CSMICRO3 - не более 10 шт. (при необходимости).
10. Корзина для наконечников KITD-SM4E - не более 10 шт. (при необходимости).
11. Корзина для инструментов малоинвазивной хирургии KITMIC10 - не более 10 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0148716

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 5

12. Корзина для хирургических инструментов, в исполнениях:

- 12.1. CSK1 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 12.2. CSK1/3 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 12.3. CSK1/6 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 12.4. CSK2 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 12.5. CSKDIN - не более 10 шт. (при необходимости).
- 12.6. CSKL - не более 10 шт. (при необходимости).

13. Тележка для корзинок, в исполнениях

- 13.1. D-CS1, верхняя - не более 10 шт. (при необходимости).
- 13.2. D-CS2, нижняя - не более 10 шт. (при необходимости).

14. Руководство пользователя - 1 шт.

Принадлежности:

1. Бак дополнительный для деминерализованной воды, в исполнениях:

- 1.1. PD50, 50 л - 1 шт.
- 1.2. SDA50, 50 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.
- 1.3. SDA100, 100 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.

2. Бумага для принтера WD-PAPER - не более 30 рулонов.

3. Картридж для принтера INKDP24 - не более 12 шт.

4. Комплект для подключения KITCON232 в составе: - 1 шт.

- USB - конвертер RS232;

- соединительный кабель male-female;

- соединительный кабель female-female;

- кабель USB;

- USB-флэш-накопитель.

5. Набор переходников для инструментов с канюлями KITLUER в составе - не более 10 шт.:

- силиконовые трубки - 3 шт.
- переходники Луер-Лок - 3 шт.
- силиконовые переходники диаметром 1 мм - 3 шт.
- силиконовые переходники диаметром 6 мм - 3 шт.
- силиконовые переходники диаметром 10 мм - 3 шт.
- конусообразные силиконовые переходники - 3 шт.

6. Насос бустерный для деминерализованной воды, в исполнениях:

6.1. PAD - 1 шт.

6.2. PAD1 - 1 шт.

6.3. PAD2X, из нержавеющей стали - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0148717

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 6

7. Принтер внешний WD-PRINTE - 1 шт.
8. Реле для насоса бустерного для деминерализованной воды PAD2R - 1 шт.
- III. WD4060, WD4060D, WD4060-1, WD4060D1 в составе:
 1. Машина моюще-дезинфицирующая - 1 шт.
 2. Карта коммуникации WD-LANE - 1 шт. (при необходимости).
 3. Крышка для моющих машин TOP60I - 1 шт. (при необходимости).
 4. Датчик уровня моющего средства LS5010 - не более 5 шт. (при необходимости).
 5. Насос перистальтический для дезинфицирующего средства P34060H - не более 5 шт. (при необходимости).
 6. Устройство управления дозированием для дополнительных насосов перистальтических FLUX 4060 - не более 5 шт. (при необходимости).
 7. Держатель, в исполнениях:
 - 7.1. BFS, для расширителей - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.2. SA3, для 3-х почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.3. SBAS5, для 5-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.4. SBAS6, для 6-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.5. SCVO, для оптического кабеля - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.6. D-LCN2, для канюль - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.7. D-SM1260E, для наконечников 12-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.8. D-SM4E, для наконечников 4-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.9. D-SM8E, для наконечников 8-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.10. D-SB2, для 2-х корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.11. D-SB3, для 3-х корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.12. D-SCT8I, для 8-ми крышек - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.13. D-SIMS, для 6-ти IMS корзин или 12 1/2 IMS корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.14. D-ST10, для 10-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.15. D-ST11, для 11-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.16. D-ST16, для 16-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 7.17. SPD, для щипцов - не более 10 шт. (при необходимости).
 8. Корзина для детских бутылочек, в исполнениях:
 - 8.1. CB18 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 8.2. CB18/100 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 8.3. CB18/120 - не более 10 шт. (при необходимости).
 9. Корзина для сосок CPS20 - не более 10 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова
0148718


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 7

10. Корзина вертикальная D-SV - не более 10 шт. (при необходимости).
11. Корзина для инструментов высокая D-CM1 - не более 10 шт. (при необходимости).
12. Корзина для мелкого инструментария, в исполнениях:
 - 12.1. CSMICRO1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.2. CSMICRO2 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.3. CSMICRO3 - не более 10 шт. (при необходимости).
13. Корзина для наконечников KITD-SM4E - не более 10 шт. (при необходимости).
14. Корзина для инструментов малоинвазивной хирургии KITMIC10 - не более 10 шт. (при необходимости).
15. Корзина для хирургических инструментов, в исполнениях:
 - 15.1. CSK1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 15.2. CSK1/3 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 15.3. CSK1/6 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 15.4. CSK2 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 15.5. CSKDIN - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 15.6. CSKL - не более 10 шт. (при необходимости).
16. Тележка для корзин, в исполнениях:
 - 16.1. CS1-1, верхняя - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 16.2. CS2, нижняя - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 16.3. CS3, универсальная - не более 10 шт. (при необходимости).
17. Тележка загрузочная, в исполнениях:
 - 17.1. AE2BDS, для анестезиологии - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.2. CM3, для хирургических масок - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.3. CSKSTOV, для посуды - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.4. CPC1B, для контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.5. CPCENDO, для эндоскопических контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.6. CSK4B, двухуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.7. CSK4BMIC, двухуровневая для инструментов малоинвазивной хирургии - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.8. CSK6B, трехуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.9. CSK8B, четырехуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
18. Тележка разгрузочная с подставкой DIS-WD5 - не более 10 шт. (при необходимости).
19. Тележка для операционной обуви, в исполнениях:
 - 19.1. ZCS1 - не более 10 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

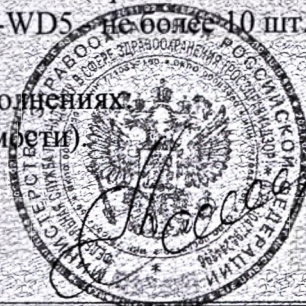

А.В. Самойлова
0148719

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 8

- 19.2. ZCS2 - не более 10 шт. (при необходимости).
19.3. ZCS3 - не более 10 шт. (при необходимости).
20. Тележка для лапароскопов и жестких эндоскопов EF5DS - не более 10 шт. (при необходимости).
21. Тележка для цитоуретроскопов CS1CYST - не более 10 шт. (при необходимости).
22. Руководство пользователя - 1 шт.
- Принадлежности:
1. Бак дополнительный для деминерализованной воды, в исполнениях:
1.1. PD50, 50 л - 1 шт.
1.2. SDA50, 50 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.
1.3. SDA100, 100 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.
2. Бумага для принтера WD-PAPER - не более 30 рулонов.
3. Картридж для принтера, в исполнениях:
3.1. INKDP24 - не более 12 шт.
3.2. SGRINK, для термопринтера - не более 12 шт.
4. Комплект для подключения KITCON232 в составе: - 1 шт.
- USB - конвертер RS232;
- соединительный кабель male-female;
- соединительный кабель female-female;
- кабель USB;
- USB-флэш-накопитель.
5. Набор переходников для инструментов с канюлями KITLUER в составе - не более 10 шт.:
- силиконовые трубки - 3 шт.
- переходники Луер-Лок - 3 шт.
- силиконовые переходники диаметром 1 мм - 3 шт.
- силиконовые переходники диаметром 6 мм - 3 шт.
- силиконовые переходники диаметром 10 мм - 3 шт.
- конусообразные силиконовые переходники - 3 шт.
6. Насос бустерный для деминерализованной воды, в исполнениях:
6.1. PAD - 1 шт.
6.2. PAD1 - 1 шт.
6.3. PAD2 - 1 шт.
6.4. PAD2X, из нержавеющей стали - 1 шт.
7. Подставка для моющих машин B6040L - 1 шт.
8. Принтер внешний WD-PRINTE - 1 шт.

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0148720

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 9

9. Реле для насоса бустерного для деминерализованной воды PAD2R - 1 шт.
IV. WD4190, WD4190-1 в составе:
1. Машина моюще-дезинфицирующая - 1 шт.
 2. Карта коммуникации WD-LANE - 1 шт. (при необходимости).
 3. Крышка для моющих машин TOP90IB - 1 шт. (при необходимости).
 4. Датчик уровня моющего средства LS5010 - не более 5 шт. (при необходимости).
 5. Держатель канистр моющих средств TANKBSK - не более 10 шт. (при необходимости).
 6. Насос перистальтический для моющего средства P34190H - не более 5 шт. (при необходимости).
 7. Принтер панельный WD-PRINT9 - 1 шт. (при необходимости).
 8. Устройство управления дозированием для дополнительных насосов перистальтических FLUX 4060 - не более 5 шт. (при необходимости).
 9. Держатель, в исполнениях:
 - 9.1. BFS, для расширителей - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.2. SA3, для 3-х почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.3. SBAS5, для 5-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.4. SBAS6, для 6-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.5. SCVO, для оптического кабеля - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.6. D-LCN2, для канюль - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.7. D-SM1260E, для наконечников 12-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.8. D-SM4E, для наконечников 4-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.9. D-SM8E, для наконечников 8-позиционный - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.10. D-SB2, для 2-х корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.11. D-SB3, для 3-х корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.12. D-SCT8I, для 8-ми крышек - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.13. D-SIMS, для 6-ти IMS корзин или 12 1/2 IMS корзин - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.14. D-ST10, для 10-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.15. D-ST11, для 11-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.16. D-ST16, для 16-ти контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 9.17. SPD, для шипцов - не более 10 шт. (при необходимости).
 10. Корзина для детских бутылочек, в исполнениях:
 - 10.1. CB18 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 10.2. CB18/100 - не более 10 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова
0150641


ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 10

- 10.3. CB18/120 - не более 10 шт. (при необходимости).
11. Корзина для сосок CPS20 - не более 10 шт. (при необходимости).
12. Корзина вертикальная D-SV - не более 10 шт. (при необходимости).
13. Корзина для инструментов высокая D-CM1 - не более 10 шт. (при необходимости).
14. Корзина для мелкого инструментария, в исполнениях:
- 14.1. CSMICRO1 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 14.2. CSMICRO2 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 14.3. CSMICRO3 - не более 10 шт. (при необходимости).
15. Корзина для наконечников KITD-SM4E - не более 10 шт. (при необходимости).
16. Корзина для инструментов малоинвазивной хирургии KITMIC10 - не более 10 шт. (при необходимости).
17. Корзина для хирургических инструментов, в исполнениях:
- 17.1. CSK1 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 17.2. CSK1/3 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 17.3. CSK1/6 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 17.4. CSK2 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 17.5. CSKDIN - не более 10 шт. (при необходимости).
- 17.6. CSKL - не более 10 шт. (при необходимости).
18. Тележка для корзин, в исполнениях:
- 18.1. CS1-1, верхняя - не более 10 шт. (при необходимости).
- 18.2. CS2, нижняя - не более 10 шт. (при необходимости).
- 18.3. CS3, универсальная - не более 10 шт. (при необходимости).
19. Тележка загрузочная, в исполнениях:
- 19.1. AE2BDS, для анестезиологии - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19.2. CM3, для хирургических масок - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19.3. CSKSTOV, для посуды - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19.4. CPC1B, для контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19.5. CPCENDO, для эндоскопических контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19.6. CSK4B, двухуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19.7. CSK4BMIC, двухуровневая для инструментов малоинвазивной хирургии - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19.8. CSK6B, трехуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19.9. CSK8B, четырехуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
20. Тележка разгрузочная с подставкой DIS-WD5 - не более 10 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

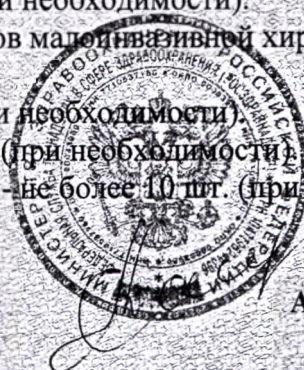

А.В. Самойлова
0150642

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 11

21. Тележка для операционной обуви, в исполнениях:
- 21.1. ZCS1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 21.2. ZCS2 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 21.3. ZCS3 - не более 10 шт. (при необходимости).
22. Тележка для лапароскопов и жестких эндоскопов EF5DS - не более 10 шт. (при необходимости).
23. Тележка для цитоуретроскопов CS1CYST - не более 10 шт. (при необходимости).
24. Руководство пользователя - 1 шт.
- Принадлежности:
- 1. Бак дополнительный для деминерализованной воды, в исполнениях:
 - 1.1. PD50, 50 л - 1 шт.
 - 1.2. SDA50, 50 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.
 - 1.3. SDA100, 100 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.
 - 2. Бумага для принтера WD-PAPER - не более 30 рулонов.
 - 3. Картридж для принтера, в исполнениях:
 - 3.1. INKDP24 - не более 12 шт.
 - 3.2. SGRINK, для термопринтера - не более 12 шт.
 - 4. Комплект для подключения KITCON232 в составе: - 1 шт.
 - USB - конвертер RS232;
 - соединительный кабель male-female;
 - соединительный кабель female-female;
 - кабель USB;
 - USB-флэш-накопитель.
 - 5. Набор переходников для инструментов с канюлями KITLUER в составе - не более 10 шт.:
 - силиконовые трубки - 3 шт.
 - переходники Луер-Лок - 3 шт.
 - силиконовые переходники диаметром 1 мм - 3 шт.
 - силиконовые переходники диаметром 6 мм - 3 шт.
 - силиконовые переходники диаметром 10 мм - 3 шт.
 - конусообразные силиконовые переходники - 3 шт.
 - 6. Насос бустерный для деминерализованной воды, в исполнениях:
 - 6.1. PAD - 1 шт.
 - 6.2. PAD1 - 1 шт.
 - 6.3. PAD2 - 1 шт.
 - 6.4. PAD2X, из нержавеющей стали - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0148723


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 12

7. Подставка для моющих машин B9040L - 1 шт.
8. Рама стальная для моющих машин T9040 - 1 шт.
9. Реле для насоса бустерного для деминерализованной воды PAD2R - 1 шт.
- V. WD6010, WD6010T, WD6010TM, WD6010M в составе:
 1. Машина моюще-дезинфицирующая - 1 шт.
 2. Карта коммуникации WD-LAN60 - 1 шт. (при необходимости).
 3. Датчик проводимости IC6010 - 1 шт. (при необходимости).
 4. Датчик уровня моющего средства LS5010 - не более 5 шт. (при необходимости).
 5. Клапан сливной двухходовой WD-VDS6010 - 1 шт. (при необходимости).
 6. Конденсор пара STEAMCO60 - 1 шт. (при необходимости).
 7. Насос перистальтический для моющего средства P36010H - не более 5 шт. (при необходимости).
 8. Насос перистальтический для смазки P46010H - не более 5 шт. (при необходимости).
 9. Принтер для «чистой стороны» WD-PRINTP6010 - 1 шт. (при необходимости).
 10. Принтер для «грязной стороны» WD-PRINTS6010 - 1 шт. (при необходимости).
 11. Устройство управления дозированием для дополнительных насосов перистальтических WD-FLUX6010 - не более 5 шт. (при необходимости).
 12. Держатель, в исполнениях:
 - 12.1. BFS, для расширителей - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.2. SA3, для 3-х почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.3. SBAS5, для 5-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.4. SBAS6, для 6-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.5. SCVO, для оптического кабеля - не более 10 шт. (при необходимости).
 13. Корзина для детских бутылочек, в исполнениях:
 - 13.1. CB18 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 13.2. CB18/100 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 13.3. CB18/120 - не более 10 шт. (при необходимости).
 14. Корзина для сосок CPS20 - не более 10 шт. (при необходимости).
 15. Корзина вертикальная D-SV - не более 10 шт. (при необходимости).
 16. Корзина для инструментов высокая D-CM1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 17. Корзина для мелкого инструментария, в исполнениях:
 - 17.1. CSMICRO1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.2. CSMICRO2 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.3. CSMICRO3 - не более 10 шт. (при необходимости).
 18. Корзина для наконечников KITD-SM4E - не более 10 шт. (при необходимости).
 19. Корзина для инструментов малоинвазивной хирургии KITMIC10 - не более 10 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

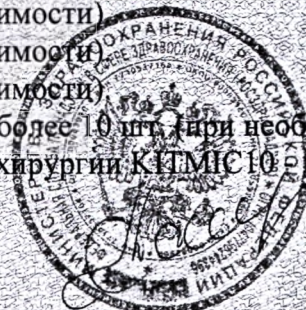

А.В. Самойлова
0150643

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 13

(при необходимости).

20. Корзина для хирургических инструментов, в исполнениях:

20.1. CSK1 - не более 10 шт. (при необходимости).

20.2. CSK1/3 - не более 10 шт. (при необходимости).

20.3. CSK1/6 - не более 10 шт. (при необходимости).

20.4. CSK2 - не более 10 шт. (при необходимости).

20.5. CSKDIN - не более 10 шт. (при необходимости).

20.6. CSKL - не более 10 шт. (при необходимости).

21. Тележка загрузочная, в исполнениях:

21.1. CSKAE810, для анестезиологии - не более 10 шт. (при необходимости).

21.2. SCDIN10, для контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).

21.3. INSPMIC10, для инструментов малоинвазивной хирургии - не более 10 шт. (при необходимости).

21.4. CSK1010, пятиуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).

21.5. CSK1010FLEX, пятиуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).

21.6. CSK1210, шестиуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).

21.7. CSK1210FLEX, шестиуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).

21.8. CSK1210UNIV - не более 10 шт. (при необходимости).

22. Тележка разгрузочная с подставкой DIS-WD6010 - не более 10 шт. (при необходимости).

23. Тележка для операционной обуви SZ1010 - не более 10 шт. (при необходимости).

24. Руководство пользователя - 1 шт.

Принадлежности:

1. Бак дополнительный для деминерализованной воды, в исполнениях:

1.1. PD50, 50 л - 1 шт.

1.2. SDA50, 50 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.

1.3. SDA100, 100 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.

2. Бумага для принтера, в исполнениях:

2.1. WD-PAPER - не более 30 рулонов.

2.2. CARTADP24 - не более 30 рулонов.

3. Дополнительный уровень PLAV10 - не более 10 шт.

4. Картридж для принтера, в исполнениях:

4.1. INKDP24 - не более 12 шт.

4.2. SGRINK, для термопринтера - не более 12 шт.

5. Комплект для подключения KITCON232 в составе: 1 шт.

- USB - конвертер RS232;

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0148725

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 14

- соединительный кабель male-female;
- соединительный кабель female-female;
- кабель USB;
- USB-флэш-накопитель;
- 6. Лента для принтера WD-RIBBON - не более 12 рулонов.
- 7. Набор переходников для инструментов с канюлями KITLUER в составе - не более 10 шт.:
 - силиконовые трубки - 3 шт.
 - переходники Луер-Лок - 3 шт.
 - силиконовые переходники диаметром 1 мм - 3 шт.
 - силиконовые переходники диаметром 6 мм - 3 шт.
 - силиконовые переходники диаметром 10 мм - 3 шт.
 - конусообразные силиконовые переходники - 3 шт.
- 8. Насос бустерный для деминерализованной воды, в исполнениях:
 - 8.1. PAD - 1 шт.
 - 8.2. PAD2 - 1 шт.
 - 8.3. PAD2X, из нержавеющей стали - 1 шт.
- 9. Принтер внешний WD-PRINTEINK - 1 шт.
- 10. Реле для насоса бустерного для деминерализованной воды PAD2R - 1 шт.
- VI. WD7010, WD7010T WD7010M, WD7010TM в составе:
 - 1. Машина моюще-дезинфицирующая - 1 шт.
 - 2. Карта коммуникации WD-LAN60 - 1 шт. (при необходимости).
 - 3. Датчик проводимости IC6010 - 1 шт. (при необходимости).
 - 4. Датчик уровня моющего средства LS5010 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 5. Клапан сливной двухходовой WD-VDS6010 - 1 шт. (при необходимости).
 - 6. Конденсор пара STEAMCO60 - 1 шт. (при необходимости).
 - 7. Насос перистальтический для моющего средства P36010H - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 8. Насос перистальтический для смазки P46010H - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 9. Принтер для «чистой стороны» WD-PRINTP7010 - 1 шт. (при необходимости).
 - 10. Принтер для «грязной стороны» WD-PRINTS7010 - 1 шт. (при необходимости).
 - 11. Устройство управления дозированием для дополнительных насосов перистальтических WD-FLUX6010 - не более 5 шт. (при необходимости).
 - 12. Держатель, в исполнениях:
 - 12.1. BFS, для расширителей - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.2. SA3, для 3-х почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).

Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

А.В. Самойлова

0147559


**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 15

- 12.3. SBAS5, для 5-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
- 12.4. SBAS6, для 6-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
- 12.5. SCVO, для оптического кабеля - не более 10 шт. (при необходимости).
- 13. Корзина для детских бутылочек, в исполнениях:
 - 13.1. CB18 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 13.2. CB18/100 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 13.3. CB18/120 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 14. Корзина для сосок CPS20 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 15. Корзина вертикальная D-SV - не более 10 шт. (при необходимости).
- 16. Корзина для инструментов высокая D-CM1 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 17. Корзина для мелкого инструментария, в исполнениях:
 - 17.1. CSMICRO1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.2. CSMICRO2 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.3. CSMICRO3 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 18. Корзина для наконечников KITD-SM4E - не более 10 шт. (при необходимости).
- 19. Корзина для инструментов малоинвазивной хирургии KITMIC10 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 20. Корзина для хирургических инструментов, в исполнениях:
 - 20.1. CSK1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 20.2. CSK1/3 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 20.3. CSK1/6 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 20.4. CSK2 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 20.5. CSKDIN - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 20.6. CSKL - не более 10 шт. (при необходимости).
- 21. Тележка загрузочная, в исполнениях:
 - 21.1. CSKAE810, для анестезиологии - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 21.2. SCDIN10, для контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 21.3. INSPMIC10, для инструментов малоинвазивной хирургии - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 21.4. CSK1010, пятиуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 21.5. CSK1010FLEX, пятиуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 21.6. CSK1210, шестиуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 21.7. CSK1210FLEX, шестиуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 21.8. CSK1210UNIV - не более 10 шт. (при необходимости).
- 22. Тележка для операционной обуви SZ1010 - не более 10 шт. (при необходимости).
- 23. Руководство пользователя - 1 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

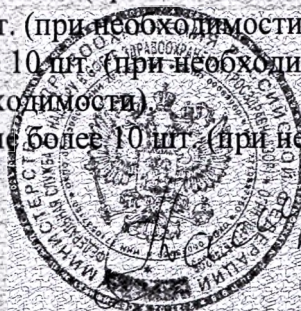

А.В. Самойлова

0150644

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 16

Принадлежности:

1. Бак дополнительный для деминерализованной воды, в исполнениях:
 - 1.1. PD50, 50 л - 1 шт.
 - 1.2. SDA50, 50 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.
 - 1.3. SDA100, 100 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.
2. Бумага для принтера, в исполнениях:
 - 2.1. WD-PAPER - не более 30 рулонов.
 - 2.2. CARTADP24 - не более 30 рулонов.
3. Дополнительный уровень PLAV10 - не более 10 шт.
4. Картридж для принтера, в исполнениях:
 - 4.1. INKDP24 - не более 12 шт.
 - 4.2. SGRINK, для термопринтера - не более 12 шт.
5. Комплект для подключения KITCON232 в составе: - 1 шт.
 - USB - конвертер RS232;
 - соединительный кабель male-female;
 - соединительный кабель female-female;
 - кабель USB;
 - USB-флэш-накопитель.
6. Лента для принтера WD-RIBBON - не более 12 рулонов.
7. Набор переходников для инструментов с канюлями KITLUER в составе - не более 10 шт.:
 - силиконовые трубки - 3 шт.
 - переходники Луер-Лок - 3 шт.
 - силиконовые переходники диаметром 1 мм - 3 шт.
 - силиконовые переходники диаметром 6 мм - 3 шт.
 - силиконовые переходники диаметром 10 мм - 3 шт.
 - конусообразные силиконовые переходники - 3 шт.
8. Насос бустерный для деминерализованной воды PAD - 1 шт.
9. Принтер внешний WD-PRINTEINK - 1 шт.
- VII. WD7015, WD7015T, WD7015TM, WD7015M в составе:
 1. Машина моюще-дезинфицирующая - 1 шт.
 2. Карта коммуникации WD-LAN60 - 1 шт. (при необходимости).
 3. Датчик проводимости IC6010 - 1 шт. (при необходимости).
 4. Датчик уровня моющего средства LS5010 - не более 5 шт. (при необходимости).
 5. Клапан сливной двухходовой WD-VDS6010 - 1 шт. (при необходимости).
 6. Конденсор пара STEAMCO15 - 1 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147558

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 17

7. Насос перистальтический для моющего средства P36010H - не более 5 шт. (при необходимости).
8. Насос перистальтический для смазки P46010H - не более 5 шт. (при необходимости).
9. Принтер для «чистой стороны» WD-PRINTP7010 - 1 шт. (при необходимости).
10. Принтер для «грязной стороны» WD-PRINTS7010 - 1 шт. (при необходимости).
11. Устройство управления дозированием для дополнительных насосов перистальтических WD-FLUX6010 - не более 5 шт. (при необходимости).
12. Держатель, в исполнениях:
 - 12.1. BFS, для расширителей - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.2. SA3, для 3-х почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.3. SBAS5, для 5-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.4. SBAS6, для 6-ти почкообразных лотков - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 12.5. SCVO, для оптического кабеля - не более 10 шт. (при необходимости).
13. Корзина для детских бутылочек, в исполнениях:
 - 13.1. CB18 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 13.2. CB18/100 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 13.3. CB18/120 - не более 10 шт. (при необходимости).
14. Корзина для сосок CPS20 - не более 10 шт. (при необходимости).
15. Корзина вертикальная D-SV - не более 10 шт. (при необходимости).
16. Корзина для инструментов высокая D-CM1 - не более 10 шт. (при необходимости).
17. Корзина для мелкого инструментария, в исполнениях:
 - 17.1. CSMICRO1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.2. CSMICRO2 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 17.3. CSMICRO3 - не более 10 шт. (при необходимости).
18. Корзина для наконечников KITD-SM4E - не более 10 шт. (при необходимости).
19. Корзина для инструментов малоинвазивной хирургии KITMIC10 - не более 10 шт. (при необходимости).
20. Корзина для хирургических инструментов, в исполнениях:
 - 20.1. CSK1 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 20.2. CSK1/3 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 20.3. CSK1/6 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 20.4. CSK2 - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 20.5. CSKDIN - не более 10 шт. (при необходимости).
 - 20.6. CSKL - не более 10 шт. (при необходимости).
21. Тележка загрузочная, в исполнениях:
 - 21.1. CSAE1015, для анестезиологии - не более 10 шт. (при необходимости).

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**

А.В. Самойлова

0147555

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 18

- 21.2. CPCDIN415, для контейнеров - не более 10 шт. (при необходимости).
21.3. INSPMIC15, для инструментов малоинвазивной хирургии - не более 10 шт. (при необходимости).
21.4. CSK1215FLEX, четырехуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
21.5. CSK1515FLEX, пятиуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
21.6. CSK1815FLEX, шестиуровневая - не более 10 шт. (при необходимости).
21.7. CSK1815UNIV - не более 10 шт. (при необходимости).
22. Тележка загрузочная для хирургического комплекса Да Винчи, в исполнениях:
22.1. CSKDAVSI1215, 12-позиционная - не более 10 шт. (при необходимости).
22.2. CSKDAVSI615, 6-позиционная - не более 10 шт. (при необходимости).
22.3. CSKDAVXISI15, 12-позиционная - не более 10 шт. (при необходимости).
23. Тележка разгрузочная с подставкой DIS-WD7015 - не более 10 шт. (при необходимости).

24. Руководство пользователя - 1 шт.

II. Принадлежности:

1. Бак дополнительный для деминерализованной воды, в исполнениях:

1.1. PD50, 50л - 1 шт.

1.2. SDA50, 50 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.

1.3. SDA100, 100 л, с автоматическим контролем уровня - 1 шт.

2. Бумага для принтера, в исполнениях:

2.1. WD-PAPER - не более 30 рулонов.

2.2. CARTADP24 - не более 30 рулонов.

3. Картридж для принтера, в исполнениях:

3.1. INKDP24 - не более 12 шт.

3.2. SGRINK, для термопринтера - не более 12 шт.

4. Комплект для подключения KITCON232 в составе: - 1 шт.

- USB - конвертер RS232;

- соединительный кабель male-female;

- соединительный кабель female-female;

- кабель USB;

- USB-флэш-накопитель.

5. Лента для принтера WD-RIBBON - не более 12 рулонов.

6. Набор переходников для инструментов с канюлями KAUER в составе - не более 10 шт.:

- силиконовые трубки - 3 шт.

- переходники Луер-Лок - 3 шт.

**Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



А.В. Самойлова

0147558

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 28 августа 2024 года № РЗН 2024/23487

Лист 19

- силиконовые переходники диаметром 1 мм - 3 шт.
- силиконовые переходники диаметром 6 мм - 3 шт.
- силиконовые переходники диаметром 10 мм - 3 шт.
- конусообразные силиконовые переходники - 3 шт.
- 7. Насос бустерный для деминерализованной воды PAD - 1 шт.
- 8. Принтер внешний WD-PRINTEINK - 1 шт.



Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения



А.В. Самойлова

0148731