



17, Krylatskaya str., bld. 2
Krylatskoe municipal district, Moscow, 121614
Tel.: +7 495 139 26 89

121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2
Тел: +7 495 139 26 89

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации

ООО «ЛайфСкан Раша»



М.В. Нэйман

2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Тест-полоски OneTouch Select® Plus

1. Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 25 штук во флаконе



2. Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 50 штук во флаконе



3. Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 100 штук (2 флакона по 50 штук)



Макеты маркировки: организация-изготовитель LifeScan Scotland Ltd.:

Маркировка флаконов (первичной упаковки) медицинского изделия Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 25 штук во флаконе



ONETOUCH
Select® Plus
Тест-полоски

Дата ред. макета: 10/2023
© 2018–2023 LifeScan IP Holdings, LLC

 **Производитель:**
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт
IV2 3ED Инвернесс
Шотландия
Великобритания

 30°C
5°C

Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

25 тест-полосок Plus - Плюс.


0344

 **LOT**

OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07273102A

Диапазон контрольных значений


07273102A


Маркировка картонных упаковок медицинского изделия Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 25 штук во флаконе



ONETOUCH

Для диагностики *in vitro*. Для самотестирования. Прочтите инструкцию. Не хранить тест-полоски вне флакона. Пределы температуры хранения от 5°C до 30°C. Не хранить в холодильнике. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Не использовать повторно.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).



2 флакона по 50 тест-полосок

ONETOUCH
Select® Plus

Тест-полоски OneTouch Select Plus

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови серии OneTouch Select Plus для количественного измерения глюкозы в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца



Точность, которой можно доверять

100
ТЕСТ-ПОЛОСОК



ONETOUCH
Select® Plus

Тест-полоски
OneTouch Select Plus

Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



AW 07272703A



Пер. уд. № P3H 2017/6149
от 25.09.2024

ONETOUCH
Select® Plus

Тест-полоски OneTouch Select Plus

⚠ Не использовать по истечении срока годности.
Утилизировать после даты, указанной на флаконе.
Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови серии OneTouch Select Plus для количественного измерения глюкозы в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца

Патент
<https://www.onetouch.com/patents>
121614 г. Москва, инт.г.
Муниципальный округ
Крылатское,
ул. Крылатская, д. 17, к. 2
Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичуа Парк Норт
IV2 3ED Инвересс
Шотландия, Великобритания
Lifescan Scotland Ltd.
Beechwood Park North
IV2 3ED Inverness
Scotland, United Kingdom
Дата ред. макета: 09/2024
AW 07272703A 023-895
© 2018-2024 Lifescan
IP Holdings, LLC



Горячая линия OneTouch®
(звонок по России бесплатный)
8-800-200-83-53

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Лиг, Швейцария
Lifescan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug, Switzerland

Plus - Плюс.
Plus - Плюс.



7 613427 014012

Маркировка картонных упаковок медицинского изделия
Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки
50 штук во флаконе

ONETOUCH Select® Plus

Тест-полоски
OneTouch Select Plus

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови серии OneTouch Select Plus для количественного измерения глюкозы в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца

Горячая линия OneTouch® (звонок по России бесплатный) 8-800-200-83-53

Уполномоченный представитель в России: ООО «ЛайфСкан Раша»
121614 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Организация-изготовитель: «ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт IV2 3ED Инвернесс Шотландия, Великобритания
LifeScan Scotland Ltd.
Beechwood Park North, IV2 3ED Inverness, Scotland, United Kingdom
Plus - Плюс.

Патент
<https://www.onetouch.com/patents>

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария
LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug, Switzerland

Дата ред. макета: 09/2024
AW 07272803A 023-893
OneTouch®
© 2018-2024 LifeScan
IP Holdings, LLC

ONETOUCH

Для диагностики *in vitro*.
Для самотестирования. Прочтите инструкцию. Не хранить тест-полоски вне флакона. Пределы температуры хранения от 5°C до 30°C. Не хранить в холодильнике. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Не использовать повторно.

1 флакон
с 50 тест-полосками

ONETOUCH Select® Plus

Тест-полоски
OneTouch Select Plus

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови серии OneTouch Select Plus для количественного измерения глюкозы в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца



Точность, которой
можно доверять

50
тест-полосок



AW 07272803A

Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.
ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ


ONETOUCH Select® Plus

Тест-полоски
OneTouch Select Plus

⚠ Не использовать по истечении срока годности. Утилизировать после даты, указанной на флаконе. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

CE 0344 5°C 30°C



Lifescan

Per. уд. № P3H 2017/6149 от 25.09.2024



7 613427 013879

Маркировка флаконов (первичной упаковки) медицинского изделия Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 50 штук во флаконе



Тест-полоски

Дата ред. макета: 10/2023
© 2018–2023 LifeScan IP Holdings, LLC

 **Производитель:**
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт
IV2 3ED Инвернесс
Шотландия
Великобритания



Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

50 тест-полосок Plus - Плюс.



0344

 **IVD**

OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07273002A

LOT

Диапазон контрольных значений



07273002A

Макеты маркировки: организация-изготовитель LifeScan Scotland Ltd, упаковщик ОАО «Фармстандарт-Лексредства»:


Маркировка флаконов (первичной упаковки) медицинского изделия Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 50 штук во флаконе



Дата ред. макета: 10/2023
© 2018–2023 LifeScan
IP Holdings, LLC

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт
IV2 3ED Инвернесс
Шотландия
Великобритания



Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

50 тест-полосок Plus - Плюс.



LOT



OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07272402A

Диапазон контрольных значений



07272402A

Маркировка флаконов (первичной упаковки) медицинского изделия Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 25 штук во флаконе




Тест-полоски

Дата ред. макета: 10/2023
© 2018-2023 LifeScan
IP Holdings, LLC

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт
IV2 3ED Инвернесс
Шотландия
Великобритания



Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

25 тест-полосок Plus - Плюс.




0344

LOT



OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07272502A

Диапазон контрольных значений

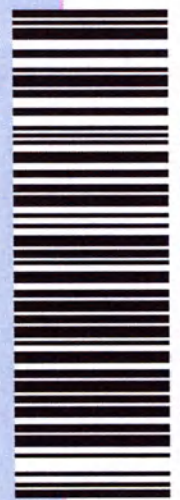

07272502A

ONETOUCH Select® Plus

Тест-полоски OneTouch Select Plus

⚠ Не использовать по истечении срока годности.
Утилизировать после даты, указанной на флаконе.
Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

ONETOUCH

Для диагностики *in vitro*. Для самотестирования. Прочтите инструкцию. Не хранить тест-полоски вне флакона. Пределы температуры хранения от 5°C до 30°C. Не хранить в холодильнике. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Не использовать повторно.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).



IVD 2 флакона по 50 тест-полосок



ONETOUCH Select® Plus

Тест-полоски OneTouch Select Plus

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови серии OneTouch Select Plus для количественного измерения глюкозы в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца



Точность, которой можно доверять

100
тест-полосок




ONETOUCH
Select® Plus
Тест-полоски
OneTouch Select Plus

Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



AW 07272103A



Per. уд. № P3H 2017/6149
от 25.09.2024



7 613427 014012

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови серии OneTouch Select Plus для количественного измерения глюкозы в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца

Патент
https://www.onetouch.com/patents
Упаковано:
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Россия, 305022, г. Курск
ул. 2-я Агретная, д. 1а/1б
Горячая линия OneTouch®
(звонок по России бесплатный)
8-800-200-85-53
Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрасе 19
6300 Цурт, Швейцария
Lifescan Europe GmbH
Dammtasse 19
6300 Zug, Switzerland
Plus - Плюс:
© 2018-2024 Lifescan
IP Holdings, LLC

Уполномоченный
представитель в России:
ОАО «ЛайфСкан Раша»
121614 г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ
Крылатское,
ул. Крылатская, д. 17, к. 2
Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт
192 3ED Инвернесс
Шотландия, Великобритания
Lifescan Scotland Ltd.
Beechwood Park North
192 3ED Inverness
Scotland, United Kingdom
Дата ред. макета: 09/2024
AW 07272103A 023-895
OneTouch®

Маркировка картонных упаковок медицинского изделия Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 50 штук во флаконе



Маркировка картонных упаковок медицинского изделия Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 25 штук во флаконе



Макеты маркировки: организация-изготовитель ОАО «Фармстандарт-Лексредства»:

Маркировка флаконов (первичной упаковки) медицинского изделия Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 25 штук во флаконе



Тест-полоски

Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

25 тест-полосок Plus - Плюс.



0344

Дата ред. макета: 10/2023
© 2018–2023 LifeScan IP Holdings, LLC

 **Производитель:**
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

 5°C – 30°C

 **LOT**


  

  **IVD**

OneTouch Select® Plus
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07056307A

Организация-изготовитель:
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Россия, 305022, г. Курск
ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

Диапазон контрольных значений

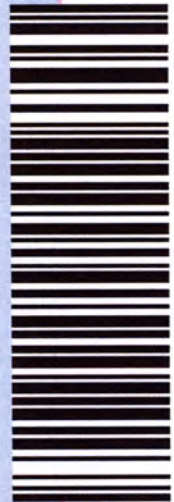

07056307A

Маркировка картонных упаковок медицинского изделия Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки 25 штук во флаконе

ONETOUCH Select® Plus

Тест-полоски
OneTouch Select Plus

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови серии OneTouch Select Plus для количественного измерения глюкозы в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца

Горячая линия OneTouch®
(звонок по России бесплатный)
8-800-200-83-53

Уполномоченный представитель
в России: ООО «ЛайфСкан Раша»
121614 г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Крылатское,
ул. Крылатская, д. 17, к. 2

Организация-изготовитель:
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Россия, 305022, г. Курск
ул. 2-я Артегатная, д. 1а/18
Plus - Плюс.

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария
LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug, Switzerland
Дата ред. макета: 10/2024
AW 07056410A
023-700
OneTouch®
© 2018-2024 LifeScan IP Holdings, LLC
Патент
<https://www.onetouch.com/patents>

ONETOUCH®

Для диагностики *in vitro*.
Для самотестирования. Прочтите
инструкцию. Не хранить
тест-полоски вне флакона.
Пределы температуры хранения
от 5°C до 30°C. Не хранить в
холодильнике. Закройте крышку
сразу после извлечения
тест-полоски из флакона.
Не использовать повторно.

**1 флакон
с 25 тест-полосками**

ONETOUCH Select® Plus

Тест-полоски
OneTouch Select Plus

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови серии OneTouch Select Plus для количественного измерения глюкозы в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца



Точность, которой
можно доверять

25
тест-полосок



CE
0344



7 613427 013800



AW 07056410A

Не использовать при отсутствии или
нарушении целостности пломбы.

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



LOT

ONETOUCH Select® Plus

Тест-полоски
OneTouch Select Plus

⚠ Не использовать по истечении
срока годности. Утилизировать
после даты, указанной на
флаконе. Правильно утилизируйте
использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок
хранения тест-полосок составляет
21 месяц (но не позднее
окончания срока годности,
указанного на упаковке).

Lifescan

Per. уд. № P3H 2017/6149 от 25.09.2024

ONETOUCH

Для диагностики *in vitro*. Для самотестирования. Прочтите инструкцию. Не хранить тест-полоски вне флакона. Пределы температуры хранения от 5°C до 30°C. Не хранить в холодильнике. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Не использовать повторно.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

CE 0344 5°C 30°C
IVD  
2 флакона по
50 тест-полосок

ONETOUCH
Select® Plus

Тест-полоски OneTouch Select Plus

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови серии OneTouch Select Plus для количественного измерения глюкозы в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца



Точность, которой
можно доверять

100
тест-полосок



ONETOUCH
Select® Plus
Тест-полоски
OneTouch Select Plus

Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.

ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ



AW 07056510A



Пер. уд. № P3H 2017/6149
от 25.09.2024

ONETOUCH
Select® Plus
Тест-полоски OneTouch Select Plus

⚠ Не использовать по истечении срока годности.
Утилизировать после даты, указанной на флаконе.
Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови серии OneTouch Select Plus для количественного измерения глюкозы в образцах свежей цельной капиллярной крови из пальца

Патент
<https://www.onetouch.com/patents>
Lifescan

Горячая линия OneTouch®
(звонок по России бесплатный)
8-800-200-83-53

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цур. Швейцария
Lifescan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug, Switzerland
Plus - Плюс.

Уполномоченный
представитель в России:
ООО «ЛайфСкан Раша»
121614 г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ
Крымское, ул. Крымская,
д. 17, к. 2
ОАО «Фармстандарт-
Лексредства»
Россия, 305022, г. Курск
ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18
Дата ред. макета: 09/2024
AW 07056510A
023-895
OneTouch®
© 2018-2024 Lifescan
IP Holdings, LLC



7 613427 014012

Маркировка картонных упаковок медицинского изделия
Тест-полоски OneTouch Select® Plus – вариант поставки
50 штук во флаконе



Маркировка флаконов (первичной упаковки) медицинского изделия Тест-полоски OneTouch Select®Plus – вариант поставки 50 штук во флаконе



Тест-полоски

Для количественного измерения уровня глюкозы в крови глюкометрами серии OneTouch Select Plus. Для самотестирования. Закройте крышку сразу после извлечения тест-полоски из флакона. Хранить только во флаконе. Не хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 21 месяц (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке).

50 тест-полосок Plus - Плюс.



0344

Дата ред. макета: 10/2023
© 2018-2023 LifeScan IP Holdings, LLC

 **Производитель:**
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария

 30°C
5°C

 **LOT**

  **OneTouch Select® Plus**
Контрольный раствор
средней концентрации
AW 07058307A

Организация-изготовитель:
ОАО «Фармстандарт-Лексредства»
Россия, 305022, г. Курск
ул. 2-я Агрегатная, д. 1а/18

Диапазон контрольных значений



07058307A

ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
19 (девятнадцать) ЛИСТОВ
МЕНЕДЖЕР ПО РЕГИСТРАЦИИ

ООО «ЛайфСкан Раша»

И. В. Хитяев

