



17, Krylatskaya str., bld. 2  
Krylatskoe municipal district, Moscow, 121614  
Tel.: +7 495 139 26 89

121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ  
Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2  
Тел: +7 495 139 26 89

**УТВЕРЖДАЮ**

Менеджер по регистрации  
ООО «ЛайфСкан Раша»



М.В. Нэйман


*Верноре* 2024 г.

## **Фотографические изображения медицинского изделия**

**Глюкометр для измерения уровня глюкозы в крови УанТач Селект  
Плюс Симпл (OneTouch Select Plus Simple®)**

1. Глюкометр для измерения уровня глюкозы в крови УанТач Селект Плюс Симпл (OneTouch Select Plus Simple®)



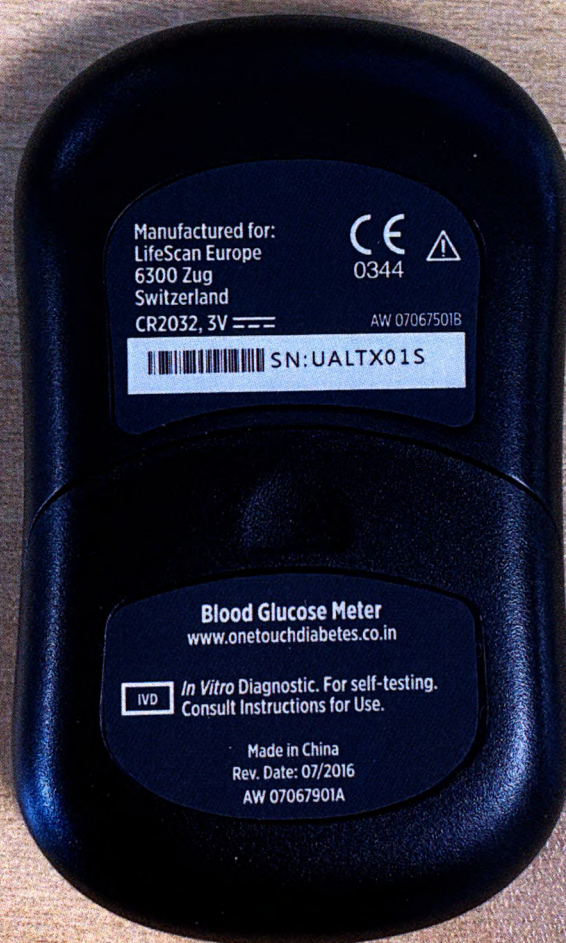

Manufactured for:  
LifeScan Europe  
6300 Zug  
Switzerland  
CR2032, 3V

CE  
0344

AW 07067501B

SN: UALT01S

**Blood Glucose Meter**  
[www.onetouchdiabetes.co.in](http://www.onetouchdiabetes.co.in)

IVD

*In Vitro* Diagnostic. For self-testing.  
Consult Instructions for Use.

Made in China  
Rev. Date: 07/2016  
AW 07067901A

2. Глюкометр для измерения уровня глюкозы в крови УанТач Селект Плюс Симпл (OneTouch Select Plus Simple®) в пластиковой коробке



3. Глюкометр для измерения уровня глюкозы в крови УанТач Селект Плюс Симпл (OneTouch Select Plus Simple®) в пластиковой коробке (открытый вид)



4. Макет картонной упаковки Глюкометра для измерения уровня глюкозы в крови УанТач Селект Плюс Симпл (OneTouch Select Plus Simple®) см. на следующей странице в формате печати А3.



Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.

# ONETOUCH

## Select Plus Simple®

Глюкометр для измерения уровня глюкозы  
в крови УанТач Селект Плюс Симпл  
(OneTouch Select Plus Simple®)

Большой экран с крупными  
цифрами

Без кнопок, кодирования  
и настройки

Простое тестирование в 2 шага.  
Результат за 5 секунд



Цветовые подсказки ColourSure® помогают понять с одного взгляда,  
какой результат: низкий, высокий или в целевом диапазоне\*



Низкий



В целевом  
диапазоне



Высокий

\*Решения должны основываться на численном результате измерения  
уровня глюкозы и рекомендациях лечащего врача.

## ONETOUCH®

Используются тест-полоски  
и контрольный раствор  
OneTouch Select® Plus  
(продаются отдельно).  
Не требует кодирования.

Для диагностики *in vitro*. Для  
самотестирования. Ознакомьтесь  
с Руководством пользователя.  
Для количественного измерения  
уровня глюкозы в свежих образцах  
цельной капиллярной крови,  
взятой из кончика пальца.


Пер.уд. №РЗН 2024/22244 от  
30.09.2024

Горячая линия OneTouch®:  
8-800-200-83-53  
(звонок по России бесплатный).

**ОСТОРОЖНО:** Содержит  
литиевые батареи. Храните в  
недоступном для детей месте.

Узнайте больше о возможностях  
глюкометра на [www.onetouch.ru](http://www.onetouch.ru)  
Plus - Плюс.

**Lifescan**



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

## ONETOUCH Select Plus Simple®

Глюкометр для измерения уровня глюкозы  
в крови УанТач Селект Плюс Симпл  
(OneTouch Select Plus Simple®)



\*ГОСТ Р ИСО 15197-2015

Тест-системы для диагностики in vitro.  
Требования к системам мониторинга  
глюкозы в крови для самоконтроля  
при лечении сахарного диабета.



Использовать с тест-полосками  
OneTouch Select® Plus

## ONETOUCH Select Plus Simple®

Глюкометр для измерения уровня глюкозы  
в крови УанТач Селект Плюс Симпл  
(OneTouch Select Plus Simple®)



Реальный размер

ColourSure®

- Простой в использовании
- Легко понять результат

См. состав на боковой стороне упаковки

Производитель:  
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»  
Даммштрассе 19  
6300 Цуг, Швейцария  
LifeScan Europe GmbH  
Dammstrasse 19  
6300 Zug, Switzerland


Сделано в Китае.  
Уполномоченный представитель  
в России: ООО «ЛайфСкан Раша»  
121614 г. Москва, вн.тер.г.  
муниципальный округ Крылатское,  
ул. Крылатская, д. 17, к. 2  
Патент <https://www.onetouch.com/patents>



OneTouch®  
AW 07314101A  
Дата редакции макета: 10/2024  
© 2018-2024 LifeScan  
IP Holdings, LLC  
024-371

### Состав:

- Глюкометр УанТач Селект Плюс Симпл (OneTouch Select Plus Simple®) – 1 шт;
- Руководство пользователя на глюкометр УанТач Селект Плюс Симпл (OneTouch Select Plus Simple®) – 1 шт.



SN

LOT

5. Маркировка Глюкометра для измерения уровня глюкозы в крови УанТач Селект Плюс Симпл (OneTouch Select Plus Simple®)



ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО  
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ  
8/805116) ЛИСТОВ  
МЕНЕДЖЕР ПО РЕГИСТРАЦИИ

ООО «ЛайфСкан Раша»  
Ген. Дир. Г. В. Голубин

