



17, Krylatskaya str., bld. 2
Krylatskoe municipal district, Moscow, 121614
Tel.: +7 495 139 26 89

121614, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ
Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, корп. 2
Тел: +7 495 139 26 89

УТВЕРЖДАЮ

Менеджер по регистрации

ООО «ЛайфСкан Раша»



М.В. Нэйман

2024 г.

Фотографические изображения медицинского изделия

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная
УанТач Верию Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)


1. Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)





1.2 Тест-полоски УанТач Верии (OneTouch Verio®) (10 шт. в уп.)



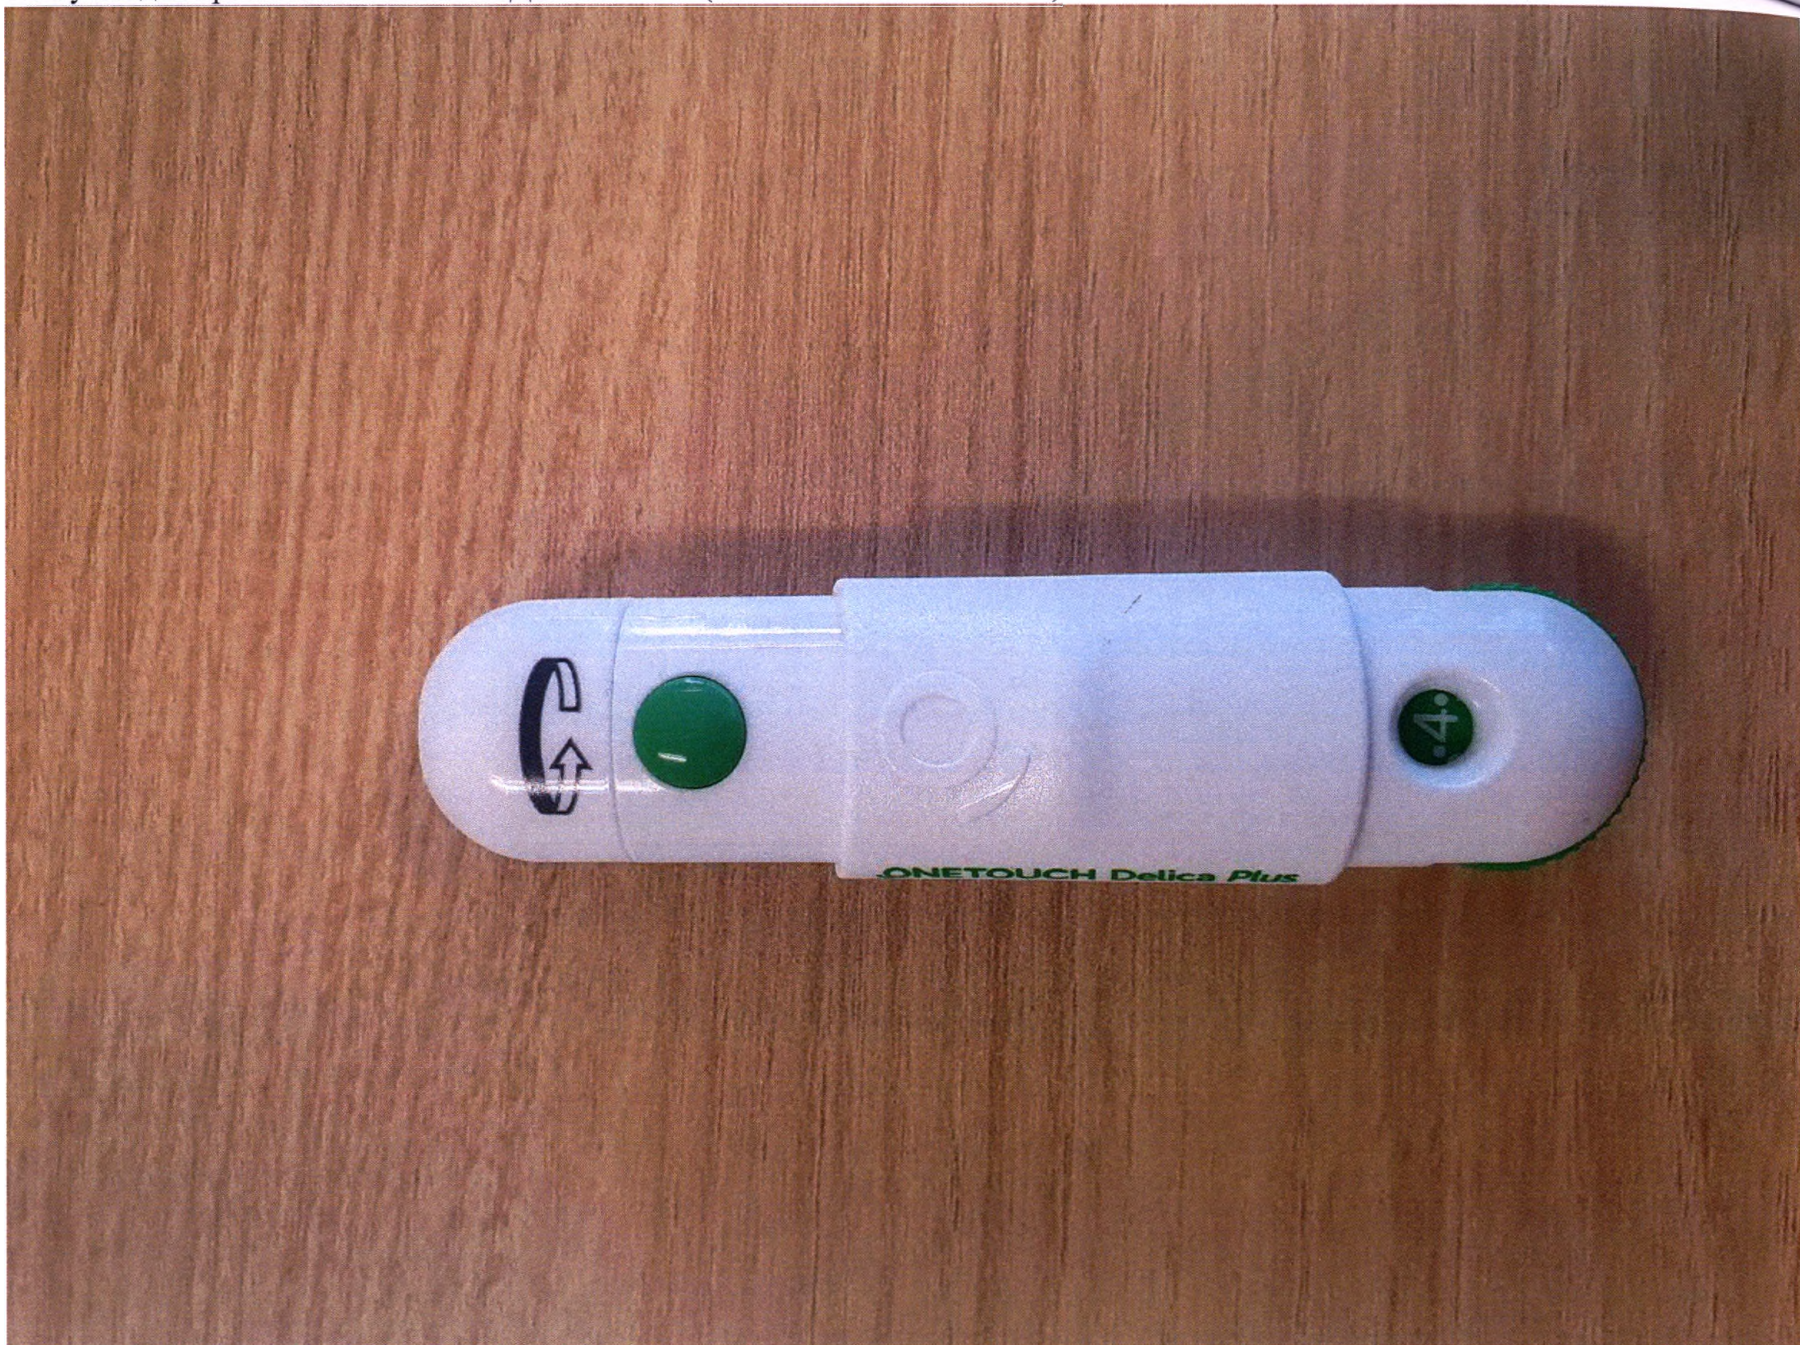



LANCETS • LANCETAS • LANCETTES

Lot No:
Lote n.º:
Nº de lot :



LOT W19E282
EXP 05/2024

Exp. Date:
Fecha de vencimiento:
Date de péremption :

Sterilized by irradiation
Esterilizado por irradiación
Stérilisées par irradiation


Lancets for single use only
Las lancetas deben utilizarse
solo una vez
Lancettes à usage unique
exclusivement

Manufactured by: / Fabricado por: /
Fabriqué par :
Asahi Polyslider Co., Ltd.
860-2 Misaki, Maniwa
Okayama 719-3226, Japan

Read Instructions.
Lea las instrucciones.
Lire les instructions.

Lancets Made in Japan
Lancetas Fabricado en Japón
Lancettes fabriquées au Japon

AW 07173701A
013-027
© 2018 LifeScan, Inc.
Rev. Date: / Fecha de revisión: /
Date rév. : 06/2018

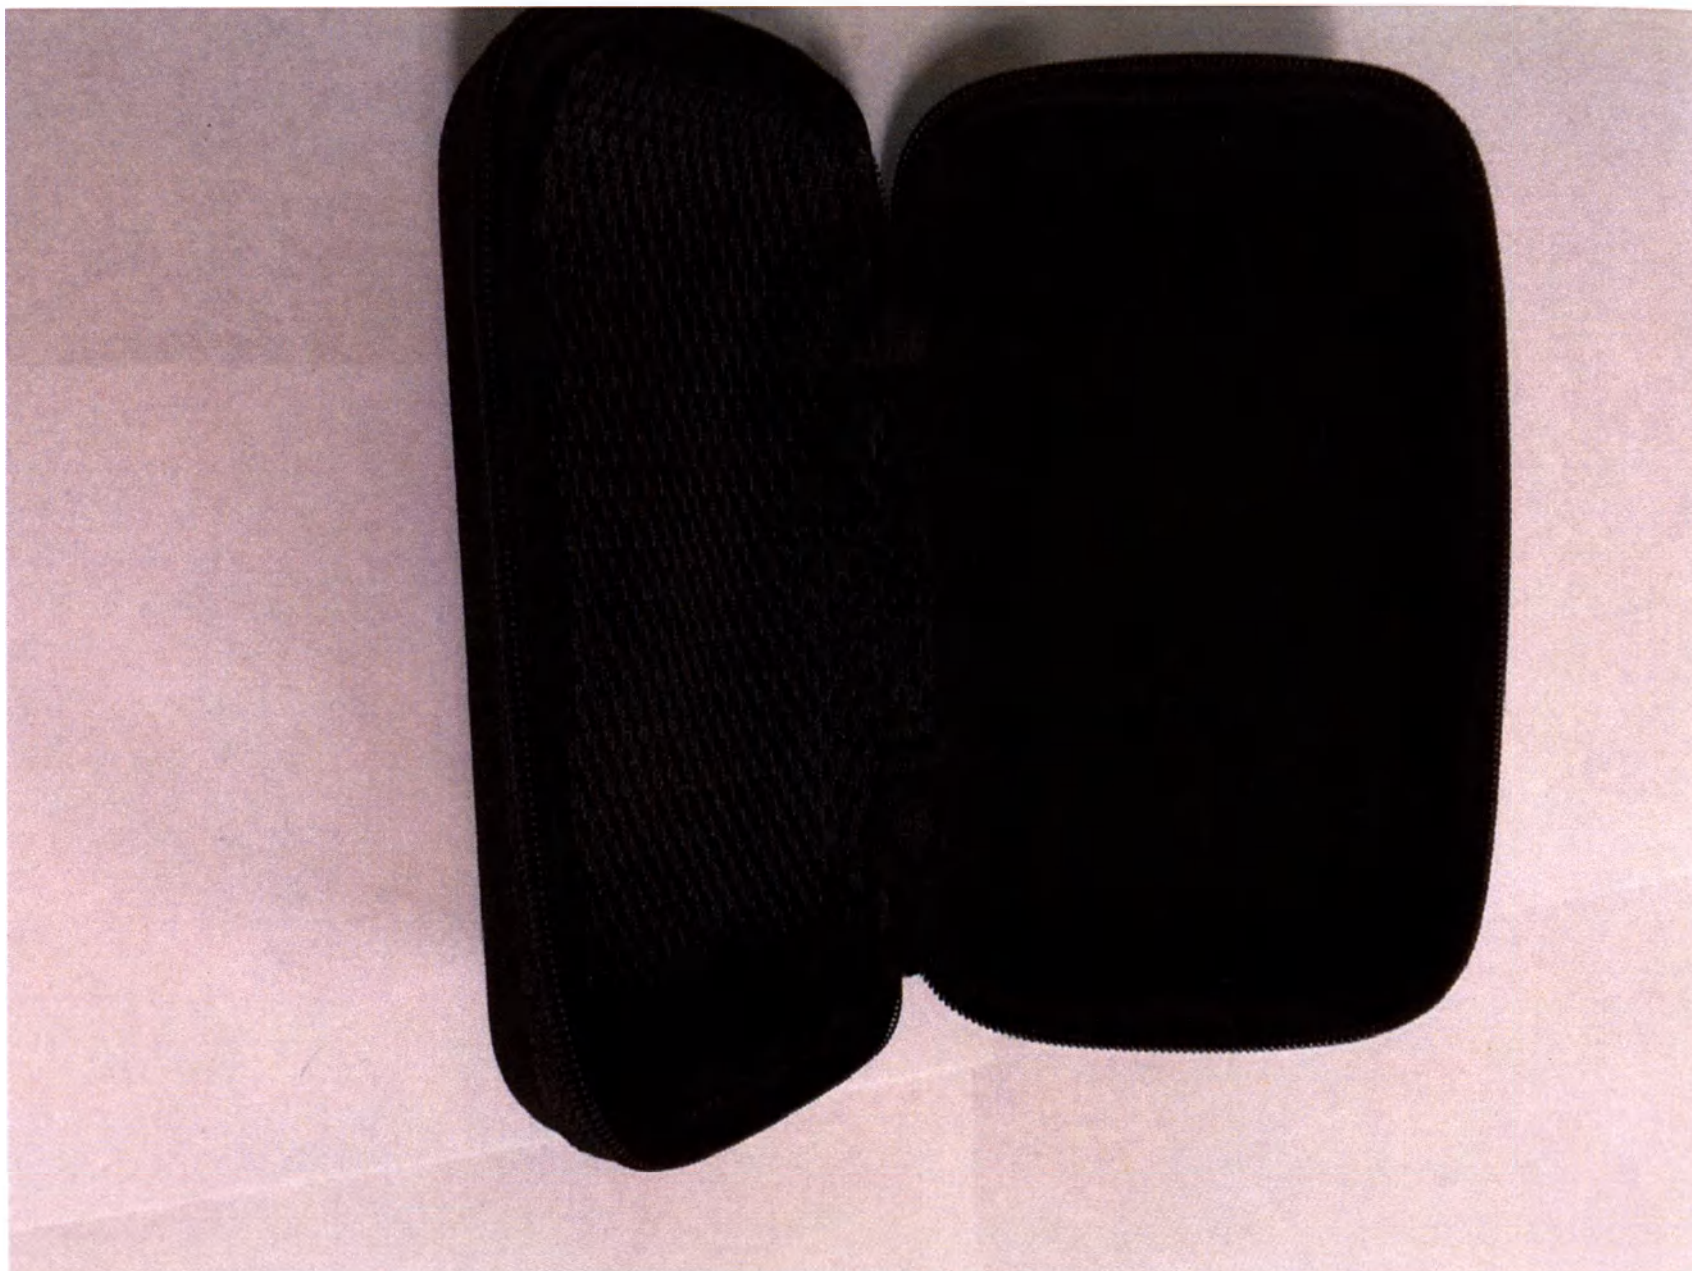










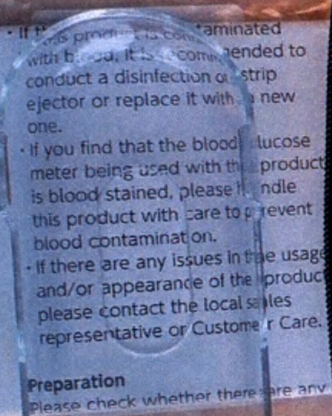





Принадлежность: Устройство для извлечения тест-полосок «стрип эджектор» (OneTouch® meter strip ejector) с инструкцией по применению устройства для извлечения тест-полосок «стрип эджектор» (OneTouch® meter strip ejector)\



ONETOUCH
Verio Reflect®

Глюкометр

www.OneTouch.ru



Для диагностики *in vitro*.

Для самотестирования.

Ознакомьтесь с руководством
пользователя



CE
0344

Дата редакции макета: 02/2020
© 2019-20 LifeScan IP Holdings, LLC
AW 07218701B



3 V  15 mA

Производитель:

«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»

Даммштрассе 19

6300 Цуг, Швейцария

AW 07218802A



ONETOUCH
Verio®

Тест-полоски

Для использования с системами контроля уровня глюкозы в крови (глюкометрами) серии OneTouch Verio® для количественного измерения уровня глюкозы (сахара) в свежих образцах цельной капиллярной крови, взятой из кончика пальца, и венозной крови. Для диагностики in vitro. Для самотестирования. Хранить тест-полоски во флаконе. Немедленно закрывать крышку. Не использовать повторно. Пределы температуры хранения от 5 °C до 30 °C. НЕ хранить в холодильнике. Правильно утилизируйте использованные тест-полоски.

50 тест-полосок

CE
0344



LOT



IVD



Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария



После вскрытия флакона срок хранения тест-полосок составляет 6 месяцев (но не позднее окончания срока годности, указанного на упаковке)
дата утилизации:

Организация-изготовитель:
«ЛайфСкан Скотланд Лтд.»
Бичвуд Парк Норт, IV2 3ED Инвернесс
Шотландия, Великобритания

Дата ред.: 08/2023
© 2018-2023 LifeScan IP Holdings, LLC

AW 07036504A



07036504A

SEAL

ONETOUCH® Delica® Plus

Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus)

10 стерильных ланцетов

Для использования с Ручкой для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) и Ручкой для прокалывания ВанТач Делика (OneTouch® Delica®)

Не использовать, если упаковка или защитная крышка отсутствует или повреждена. Только для одноразового использования. Не использовать повторно.

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53
(звонок по России бесплатный).

Посетите наш сайт www.onetouch.ru



Производитель:
Asahi Polyslider Co., Ltd.
Japan (Япония)

Уполномоченный
представитель в России:
ООО «ЛайфСкан Раша»
121614 г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный
округ Крылатское,
ул. Крылатская, д. 17, к. 2

OneTouch®
AW 07253704A
© 2018-2024 LifeScan
IP Holdings, LLC
Дата ред.: 06/2024
013-039



LOT



STERILE R

0,32 MM

SEAL

Маркировка Устройства для извлечения тест-полосок «стрип эджектор» (OneTouch® meter strip ejector)

Устройство для извлечения тест-полосок стрип эджектор
(OneTouch® meter strip ejector)

 LifeScan Europe GmbH, Dammstrasse 19, 6300 Zug, Switzerland

Уполномоченный представитель в России: ООО «ЛайфСкан Раша»
Российская Федерация, 121614, г.Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

 <Штрих-код>
Сделано в Японии.

Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.

ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)

Персональные советы и мотивирующие сообщения

11.1
ммоль/л

Вышел тренд

Ваш уровень глюкозы в это время за последние 5 дней "по-прежнему"

OK

3.1
ммоль/л

Низкий уровень

Помните меры. Подкорректируйте диету. Проверьте тест-полоску 15 минут.

OK

5.8
ммоль/л

Отлично!

Вернулись в диапазон после 2-х дней результатов теста.

OK

Сообщения функции Помощника Blood Sugar Mentor



Динамический индикатор диапазона ColourSure® позволяет мгновенно узнать, находится ли ваш результат в пределах диапазона и насколько он близок к верхней или нижней границе

Plus - плюс, Blood Sugar - глюкоза крови, Mentor - помощник.

Установите мобильное приложение **ONETOUCH Reveal®**



Позволяет взглянуть на результаты тестирования по-новому!

- Соединяется с глюкометром OneTouch Verio Reflect® с помощью Bluetooth®
- Собирает и сохраняет результаты автоматически
- Показывает данные в удобном формате
- Помогает принимать решения для управления диабетом

Доступно в магазинах приложений:

App Store | Google Play

Мобильное устройство не входит в комплект.

Используется с тест-полосками OneTouch Verio® и контрольным раствором средней концентрации OneTouch Verio® (продаются отдельно).

Для диагностики *in vitro*. Для самотестирования. Ознакомьтесь с руководством пользователя. Для количественного измерения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови. Пределы температуры хранения от 5 °C до 30 °C. Не хранить в холодильнике.

ВНИМАНИЕ! Совершите плоские круглые батарейки. Хранить в недоступном для детей месте.

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53 (звонок по России бесплатный).

Рег. № РЗН 2021/14349 от 30.09.2024

Число 0098120 MW

ЧТО ПРИБАВЛЯЕТ ЗНАЧЕНИЕ

ONETOUCH Verio Reflect®


Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)

ГОСТ Р ИСО 15197-2015

Используется только с тест-полосками УанТач Верлио (OneTouch Verio®)

ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)

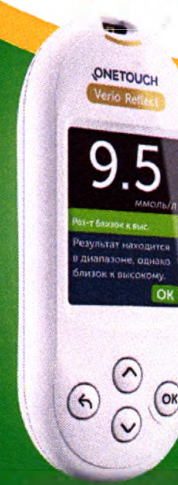

с функцией Помощника Blood Sugar Mentor

Функция Помощник Blood Sugar Mentor дает советы, как нужно действовать!

Получите бесплатную помощь и поддержку!

• Видеонструкция
• Бесплатное мобильное приложение
• Поддержка Горячей линии

Bluetooth®

См. состав на боковой стороне упаковки

ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови (глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®)

Состав:

1. Глюкометр (OneTouch Verio Reflect (OneTouch Verio Reflect®)) - 1 шт.
2. Рука для прокалывания (OneTouch Verio Reflect (OneTouch Verio Reflect®)) - 1 шт.
3. Лампы светодиодные (OneTouch Verio Reflect (OneTouch Verio Reflect®)) - 1 шт.
4. Батарейки - 1 шт.
5. Руководство пользователя на русском языке (OneTouch Verio Reflect (OneTouch Verio Reflect®)) - 1 шт.

Уполномоченный представитель в России:

ООО «ЛайфСкан Раша»
121641 г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 2

OneTouch®
AW 07218604A
Дата редакции: май 2024
© 2018-2024 Lifescan IP Holdings, LLC
074-015
Патент
https://www.onetouch.com/patents

Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даннеларпассе 10
6300 Lipp, Linschlag
Lifescan Europe GmbH
Darmstadt 10
6300 Zug, Switzerland
Сделано в Китае

CE 0344 IVD

7 613427 003795

Lifescan


Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.

Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.


ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови
(глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект
(OneTouch Verio Reflect®)


Персональные советы и мотивирующие сообщения



Анализ



Советы



Мотивация

Сообщения функции Помощника
Blood Sugar Mentor



Динамический индикатор диапазона ColourSure® позволяет мгновенно узнать, находится ли ваш результат в пределах диапазона и насколько он близок к верхней или нижней границе

ColourSure®
PLUS

Plus - плюс, Blood Sugar - глюкоза крови, Mentor - помощник.

Установите мобильное приложение


ONETOUCH Reveal®



Позволяет взглянуть на результаты тестирования по-новому!

- Соединяется с глюкометром OneTouch Verio Reflect® с помощью Bluetooth®
- Собирает и сохраняет результаты автоматически
- Показывает данные в удобном формате
- Помогает принимать решения для управления диабетом

Доступно в магазинах приложений:



Мобильное устройство не входит в комплект.

Используется с тест-полосками OneTouch Verio® и контрольным раствором средней концентрации OneTouch Verio® (продаются отдельно).

Для диагностики *in vitro*. Для самотестирования. Ознакомьтесь с руководством пользователя. Для количественного измерения уровня глюкозы в цельной капиллярной крови. Пределы температуры хранения от 5 °C до 30 °C. Не хранить в холодильнике.

ВНИМАНИЕ! Содержит плоские круглые батарейки. Хранить в недоступном для детей месте.

Горячая линия OneTouch®: 8-800-200-83-53 (звонок по России бесплатный).

Пер.уд № РЗН 2021/14349 от 30.09.2024



ОТКРЫВАТЬ ЗДЕСЬ

ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови
(глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект
(OneTouch Verio Reflect®)




*ГОСТ Р ИСО 15197:2015
Тест-системы для диагностики in vitro.
Требования к системам мониторинга
глюкозы в крови для самоконтроля
при лечении сахарного диабета

Используется только с тест-
полосками УанТач Верлио
(OneTouch Verio®)

ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы в крови
(глюкометр) портативная УанТач Верлио Рефлект
(OneTouch Verio Reflect®)

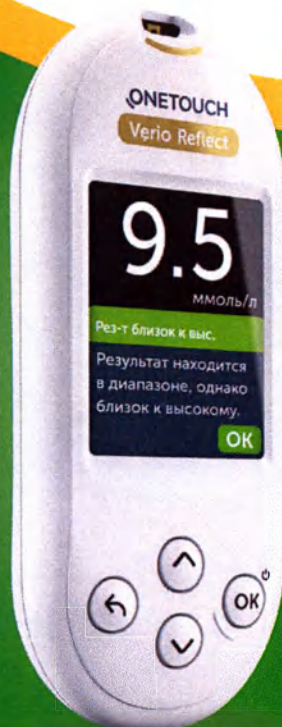

с функцией
**Помощника
Blood Sugar
Mentor**

• **Функция Помощник
Blood Sugar Mentor
дает советы, как
нужно действовать!**

Получите бесплатную
помощь и поддержку!



- Видеоинструкция
- Бесплатное
мобильное
приложение
- Поддержка
Горячей линии

См. состав на боковой стороне упаковки



Уполномоченный представитель
в России:
ООО «ЛайфСкан Раша»
121614 г. Москва, вн.тер.г.
муниципальный округ Крылатское,
ул. Крылатская, д. 17, к. 2
OneTouch®
AW 072186044
Дата редакции
макета: 10/2024
© 2018-2024 LifeScan
IP Holdings, LLC
024-055
Патент
<https://www.onetouch.com/patents>



Не использовать при отсутствии или нарушении целостности пломб.



Производитель:
«ЛайфСкан Юроп ГмбХ»
Даммштрассе 19
6300 Цуг, Швейцария
LifeScan Europe GmbH
Dammstrasse 19
6300 Zug, Switzerland
Сделано в Китае.

ONETOUCH Verio Reflect®

Система контроля уровня глюкозы
в крови (глюкометр) портативная
УанТач Верлио Рефлект
(OneTouch Verio Reflect®)

Состав:

1. Глюкометр УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®) - 1 шт.
2. Ручка для прокалывания УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) - 1 шт.
3. Ланцеты одноразовые УанТач Делика Плюс (OneTouch® Delica® Plus) - 10 шт./уп.
4. Футляр - 1 шт.
5. Руководство пользователя на Глюкометр УанТач Верлио Рефлект (OneTouch Verio Reflect®) - 1 шт.



ВСЕГО ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО

И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Ильина Валерия Сергеевна

МЕНЕДЖЕР ПО РЕГИСТРАЦИИ

ООО «ЛайфСкан Раша»

Ильин

И. В. Ильин

