ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
_____ Сюн Вэй.
«25» декабря 2023 г.

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 30.11.22Г
СМОЛЕВА П.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Набор калибраторов для диагностики in vitro для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»
129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39
ИНН 7705815069 КПП 770201001

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Рисунок 1. Внешняя упаковка. Набор калибраторов для диагностики in vitro для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в сыворотке и плазме человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (вид 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 2. Внешняя упаковка. Набор калибраторов для диагностики in vitro для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (вид 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 3. Внешняя упаковка. Набор калибраторов для диагностики in vitro для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в сыворотке и плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (вид 3)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

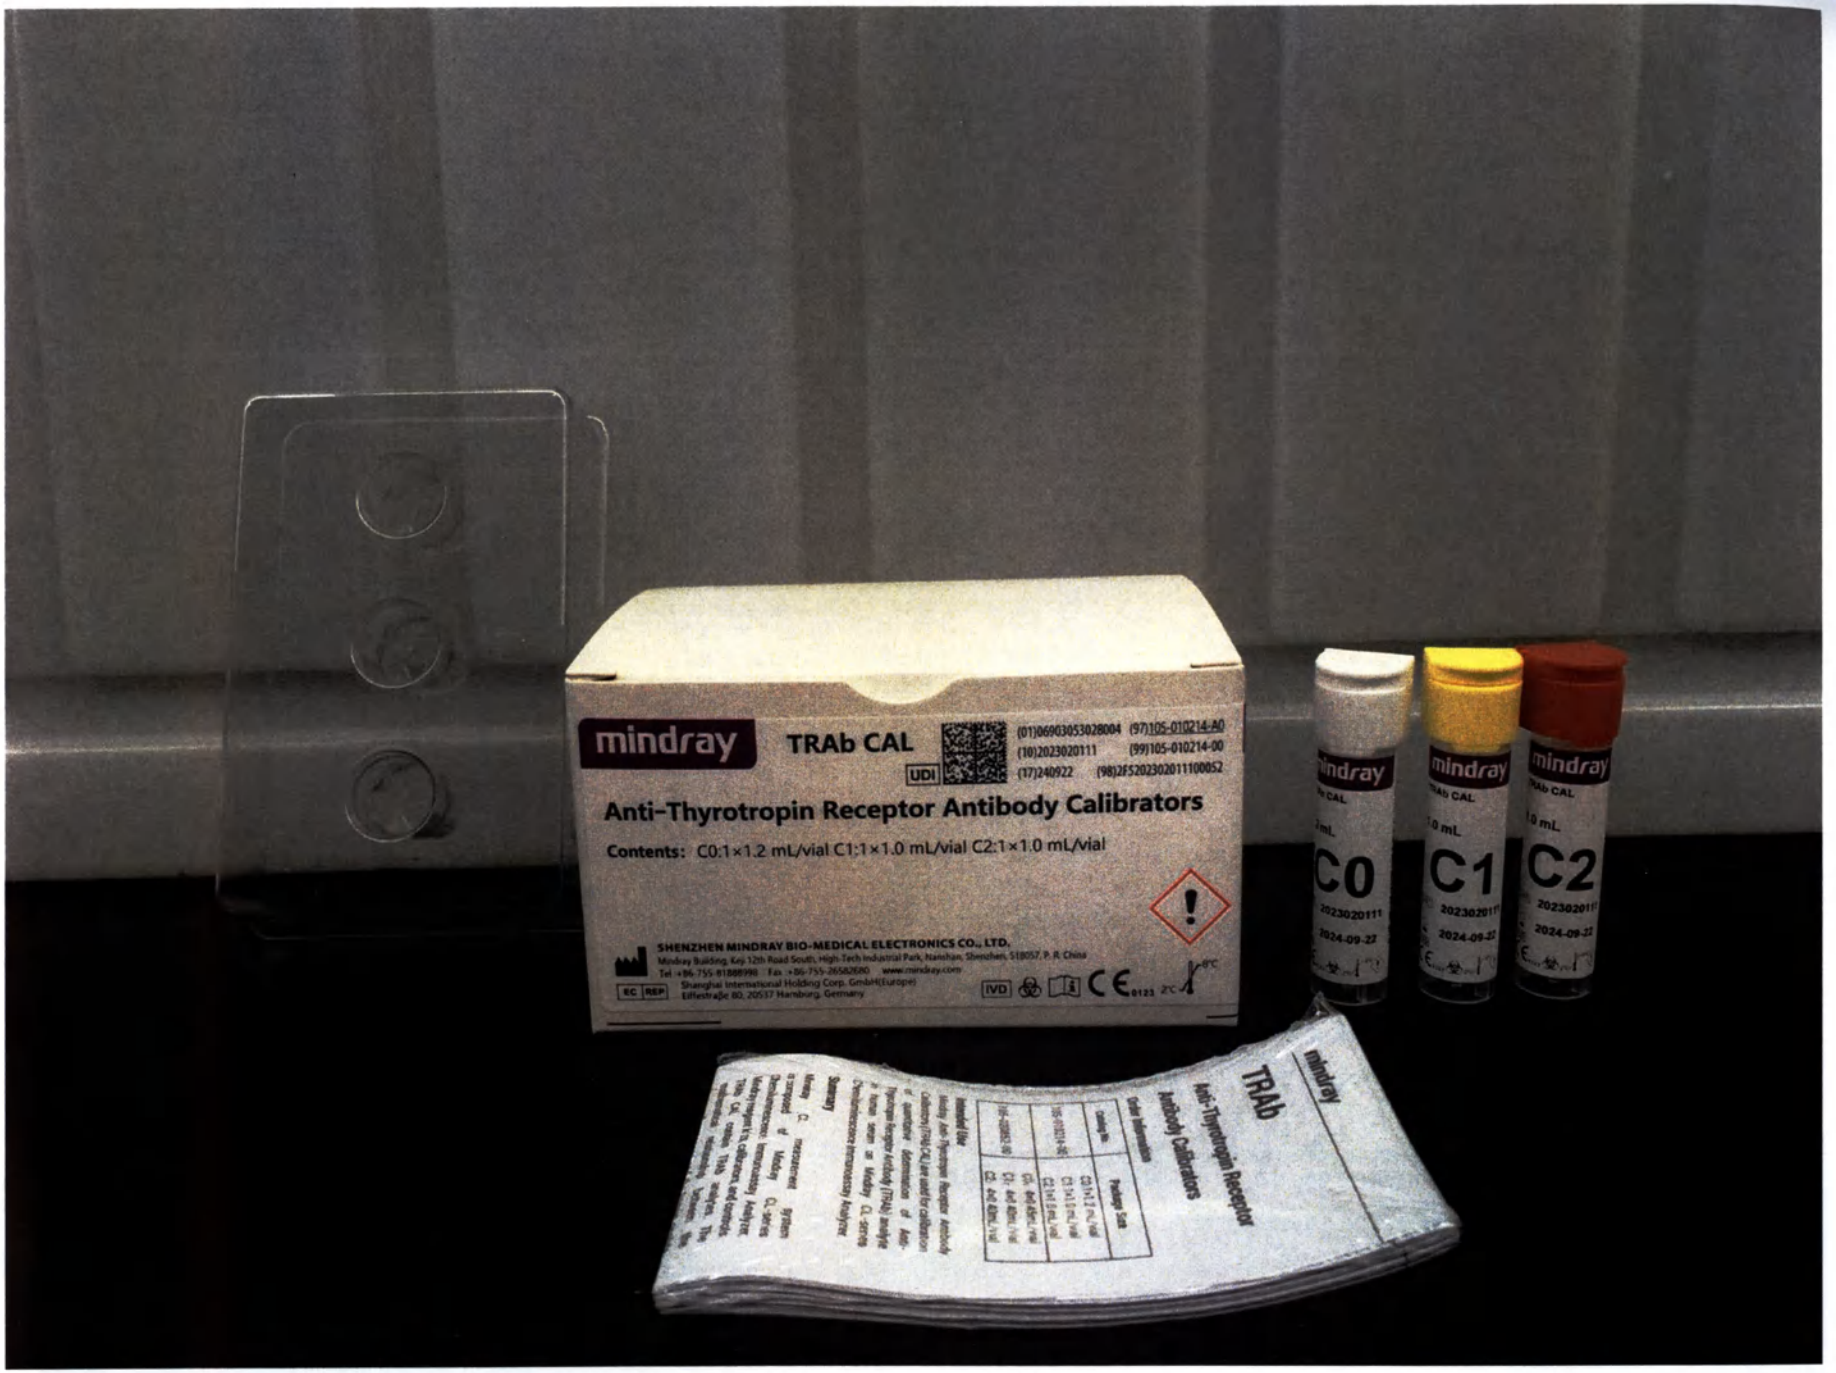

Рисунок 4. Общий вид. Набор калибраторов для диагностики in vitro для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

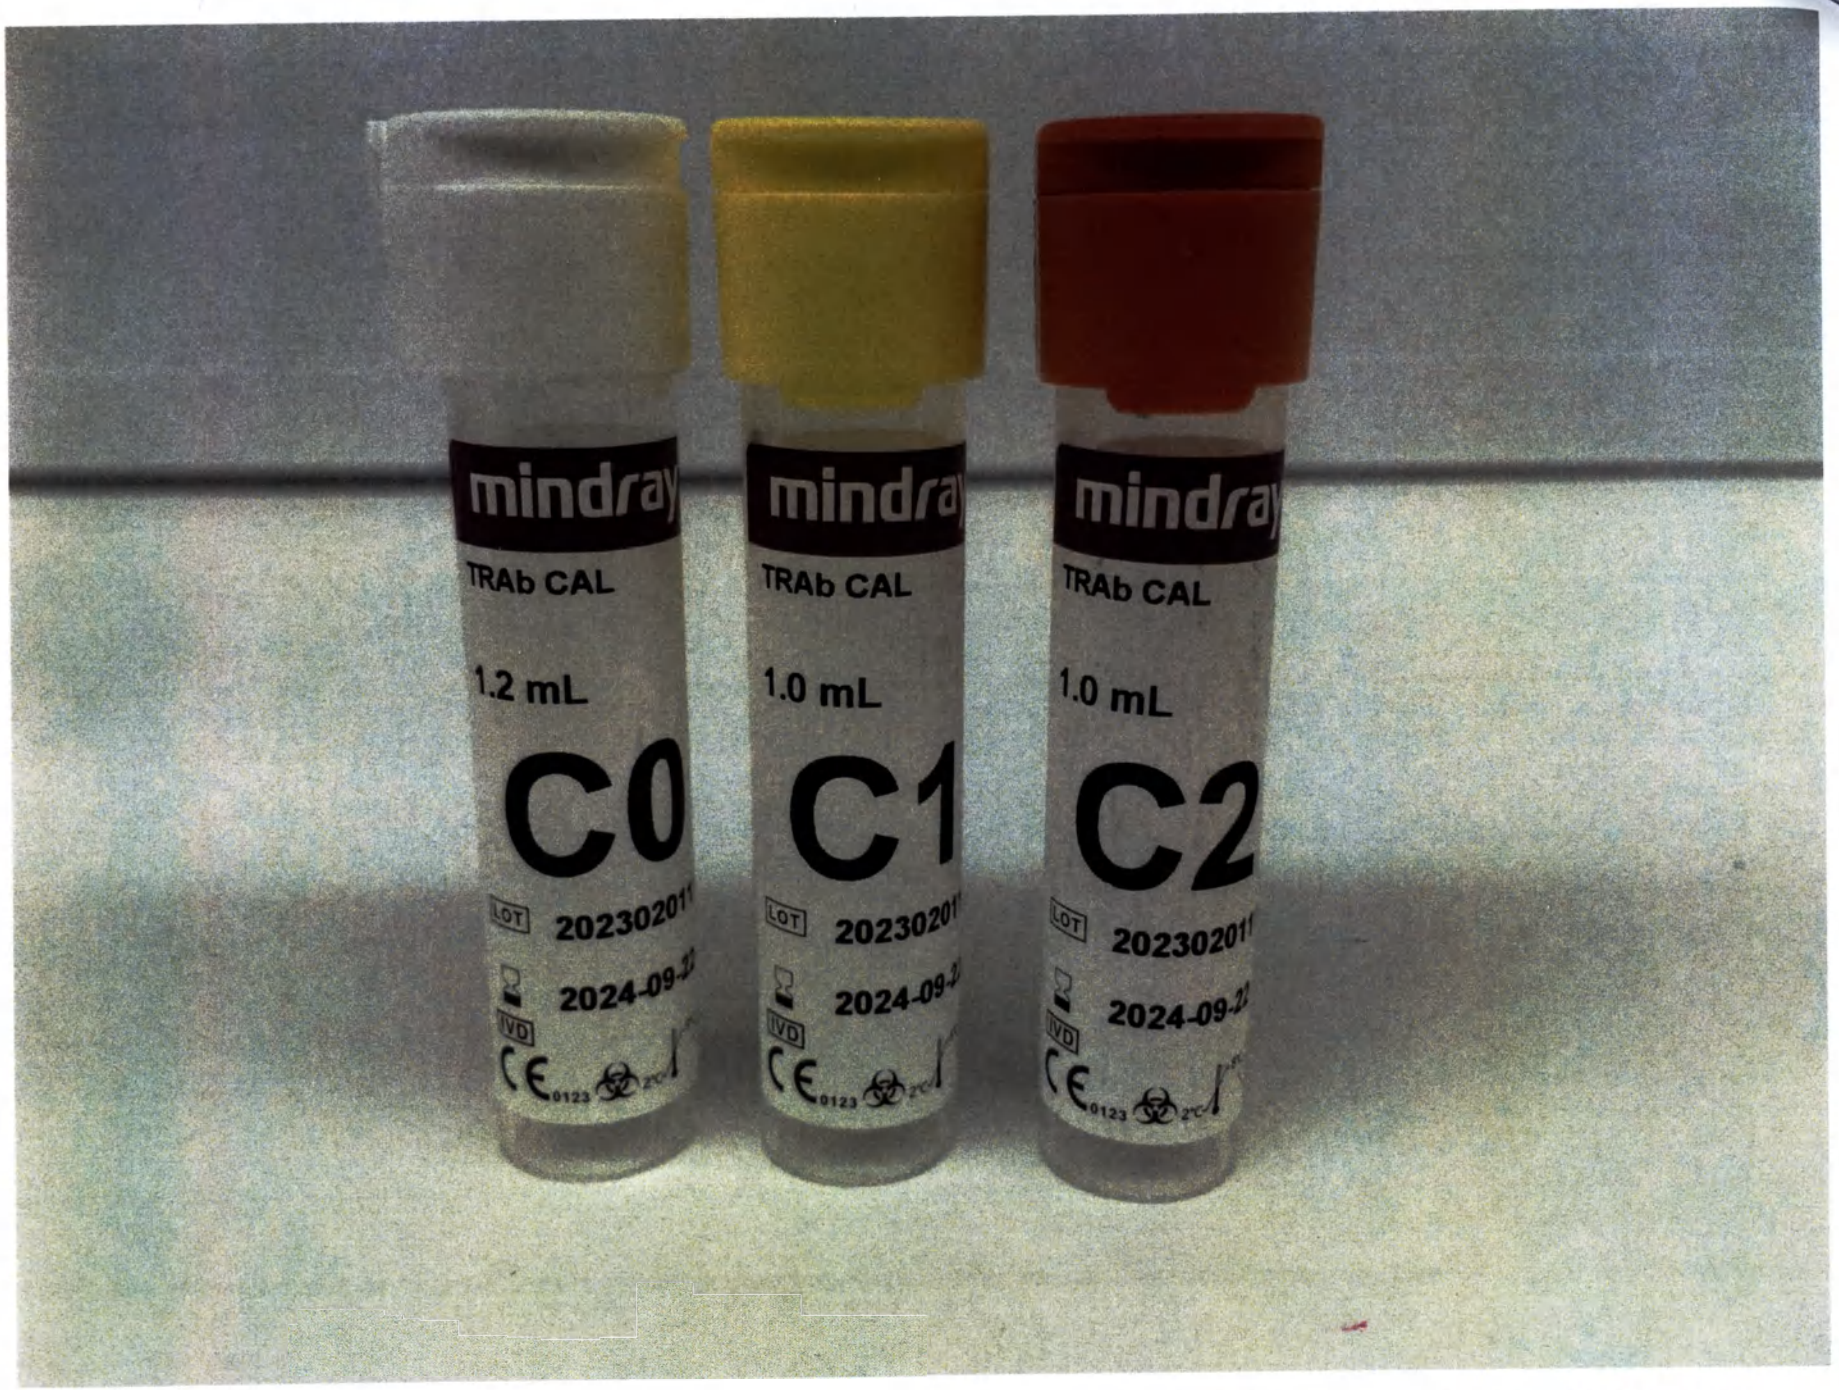

Рисунок 5. Калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 0 (C0) – 1 флакон, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 1 (C1) – 1 флакон, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 2 (C2) – 1 флакон (вид 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

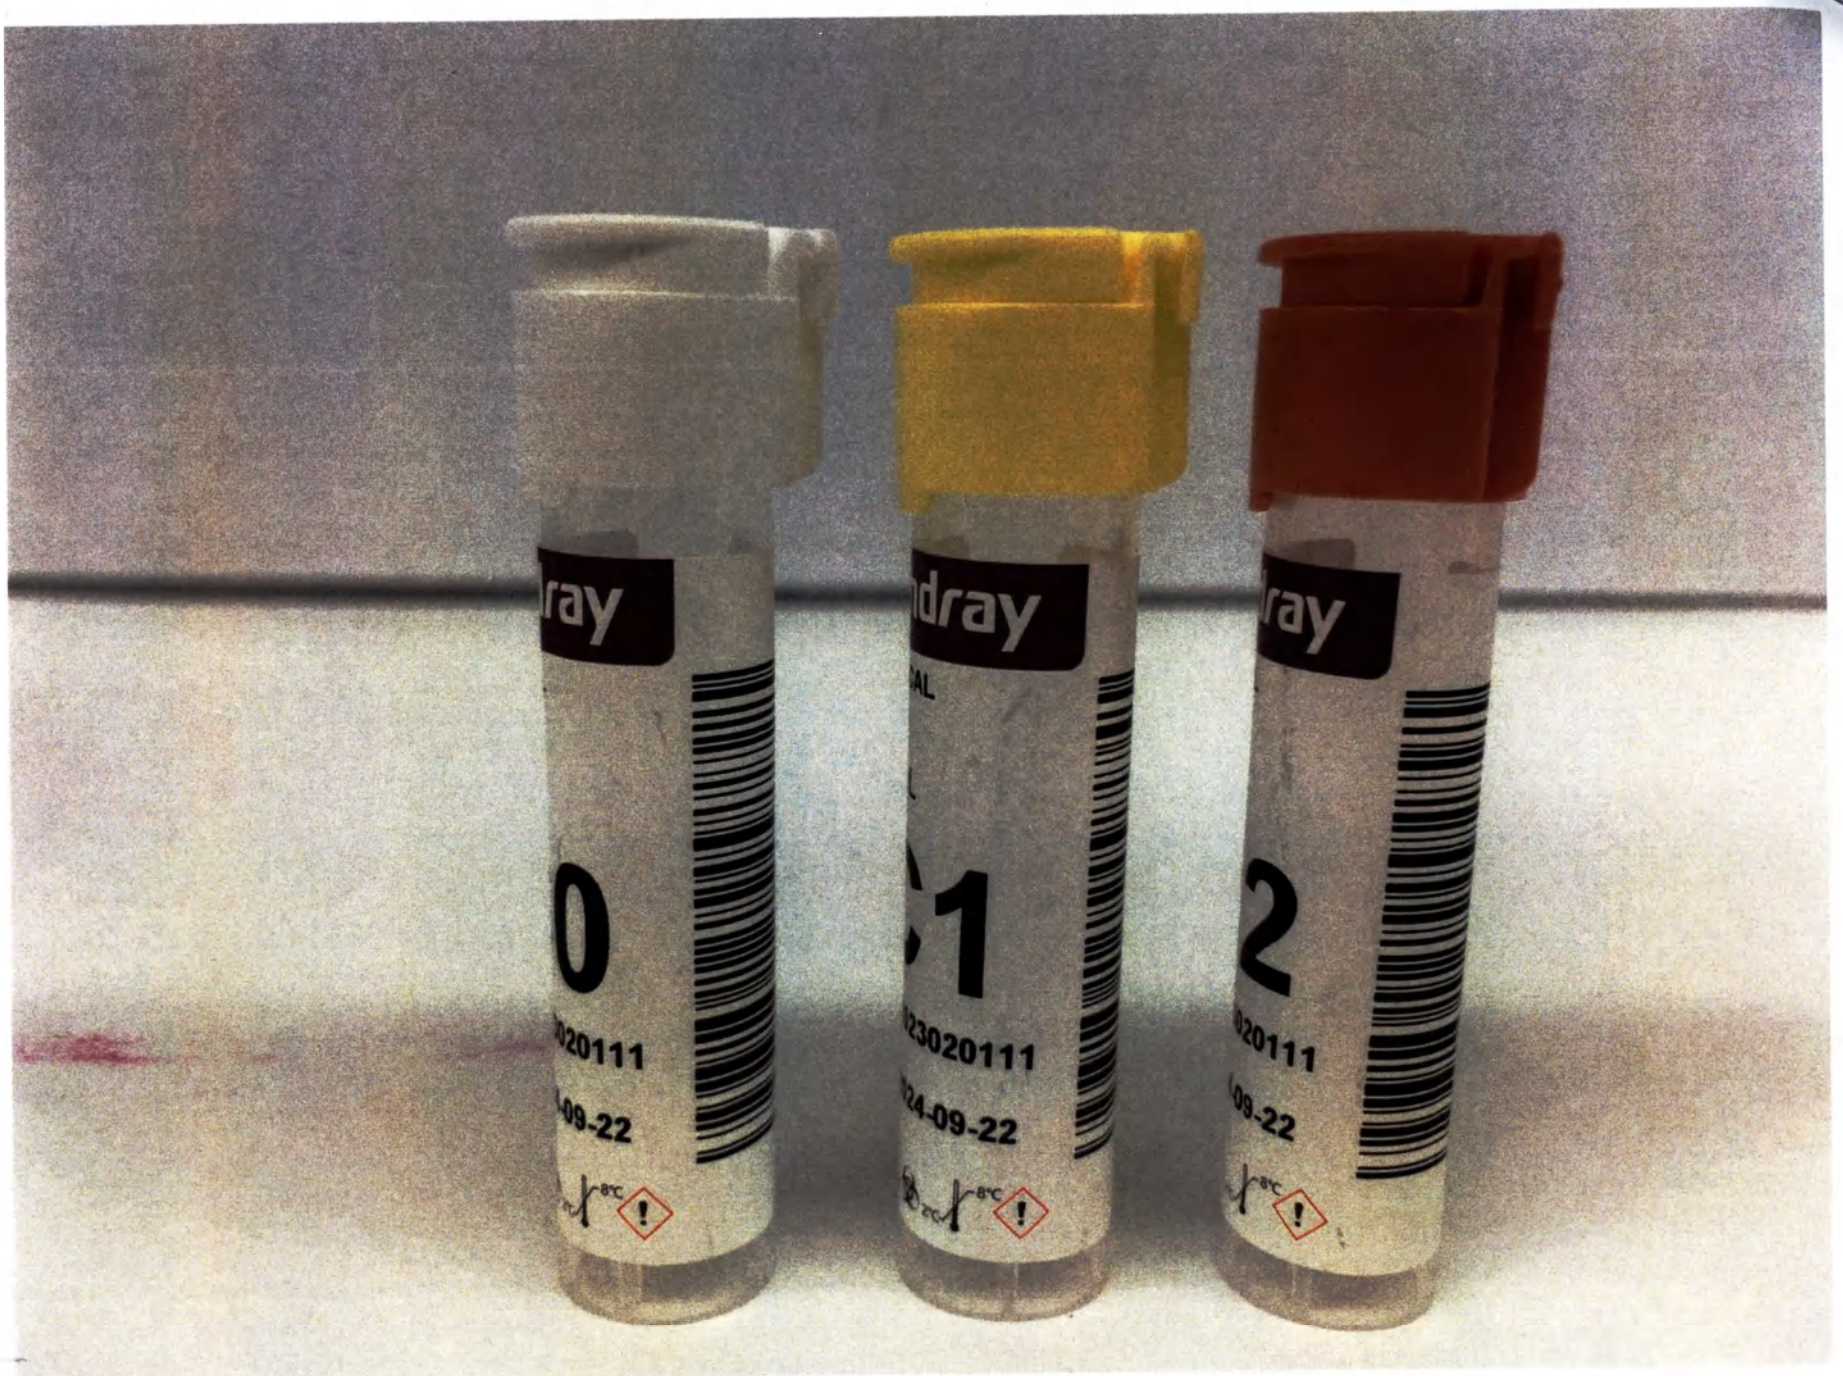

Рисунок 6. Калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 0 (C0) – 1 флакон, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 1 (C1) – 1 флакон, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 2 (C2) – 1 флакон (вид 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

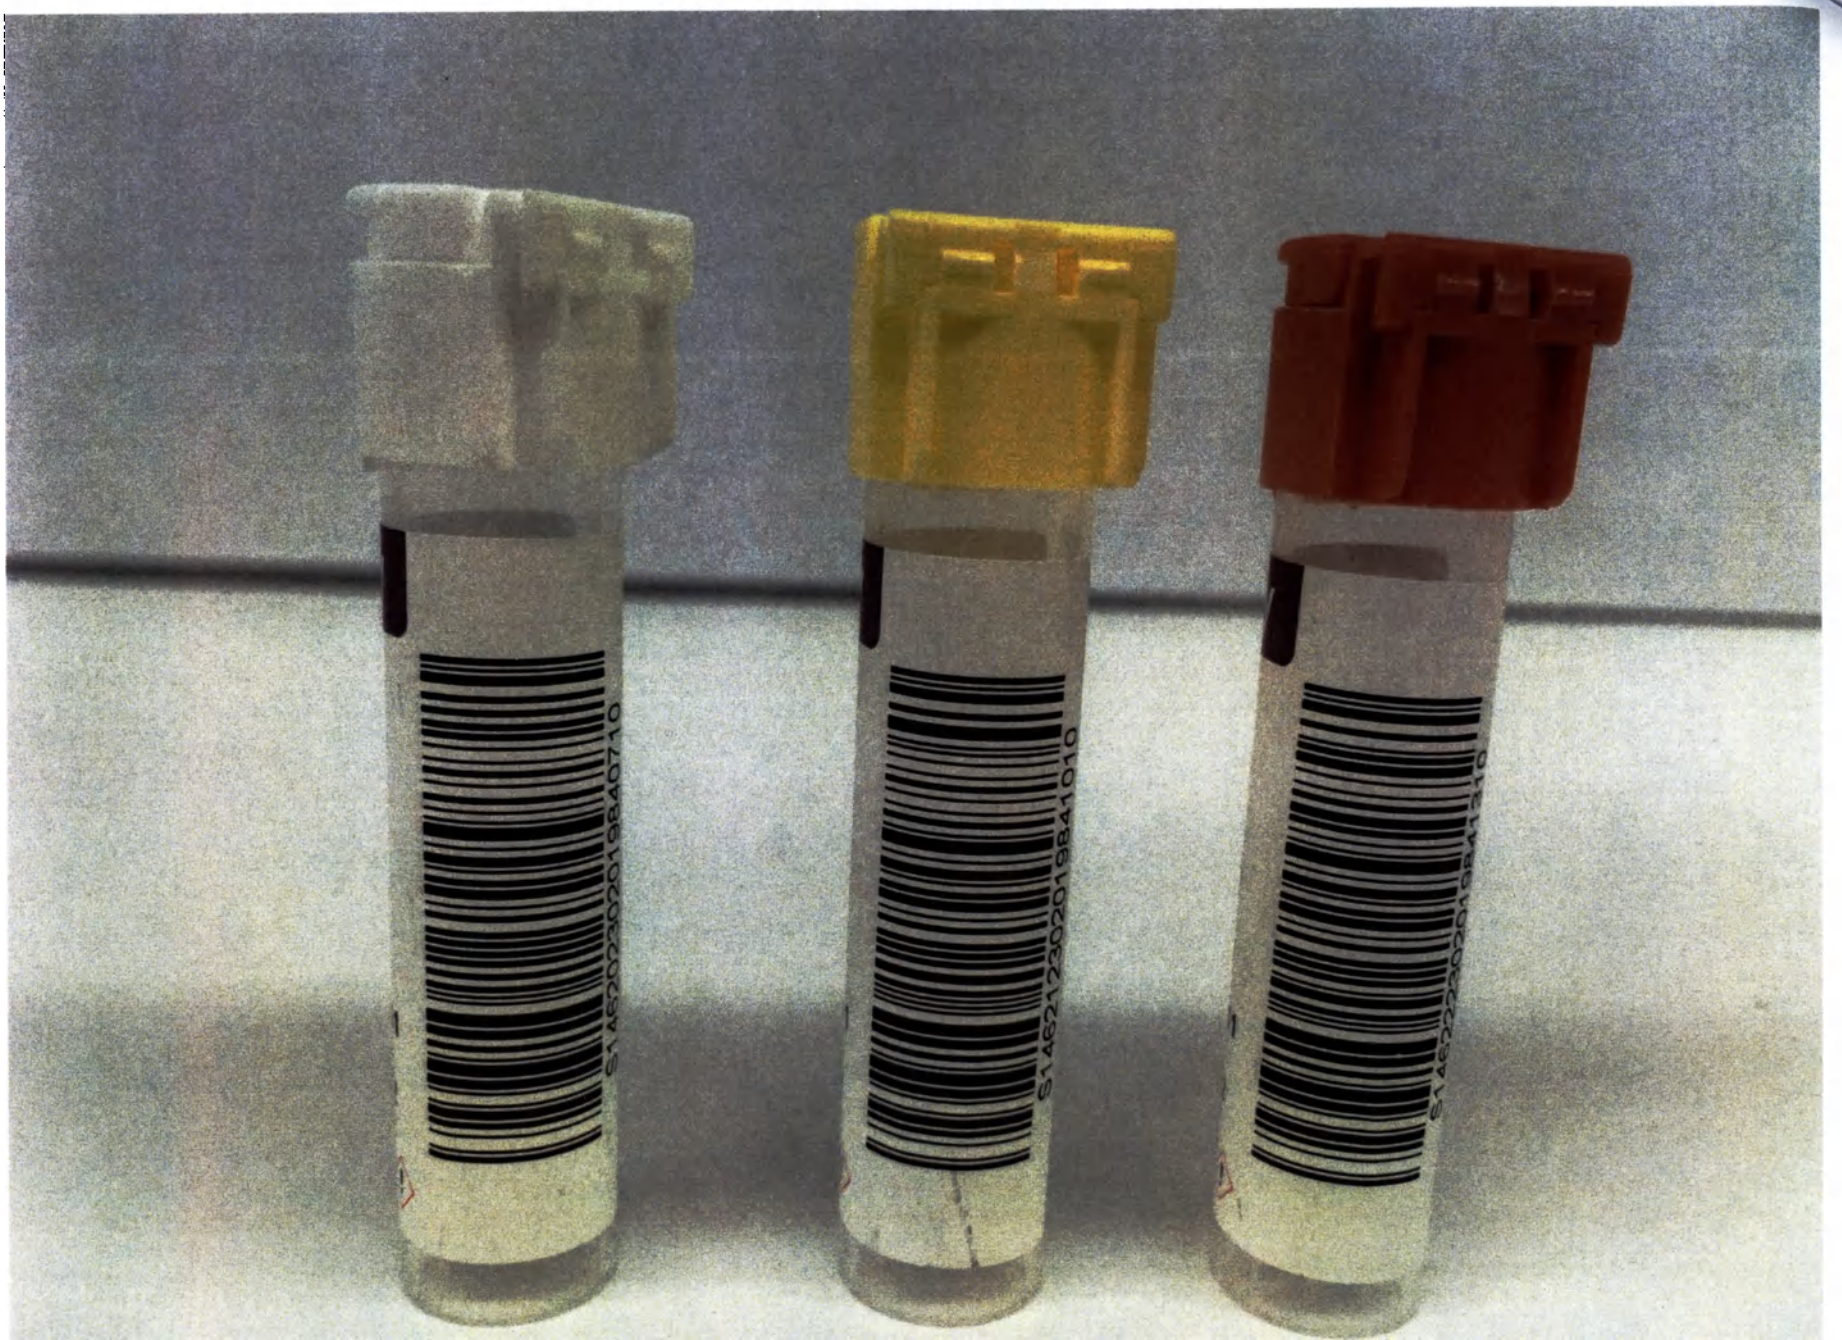

Рисунок 7. Калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 0 (C0) – 1 флакон, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 1 (C1) – 1 флакон, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 2 (C2) – 1 флакон (вид 3)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 8. Внешняя упаковка. Набор калибраторов для диагностики in vitro для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (ТТГ) в сыворотке и плазме человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (вид 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

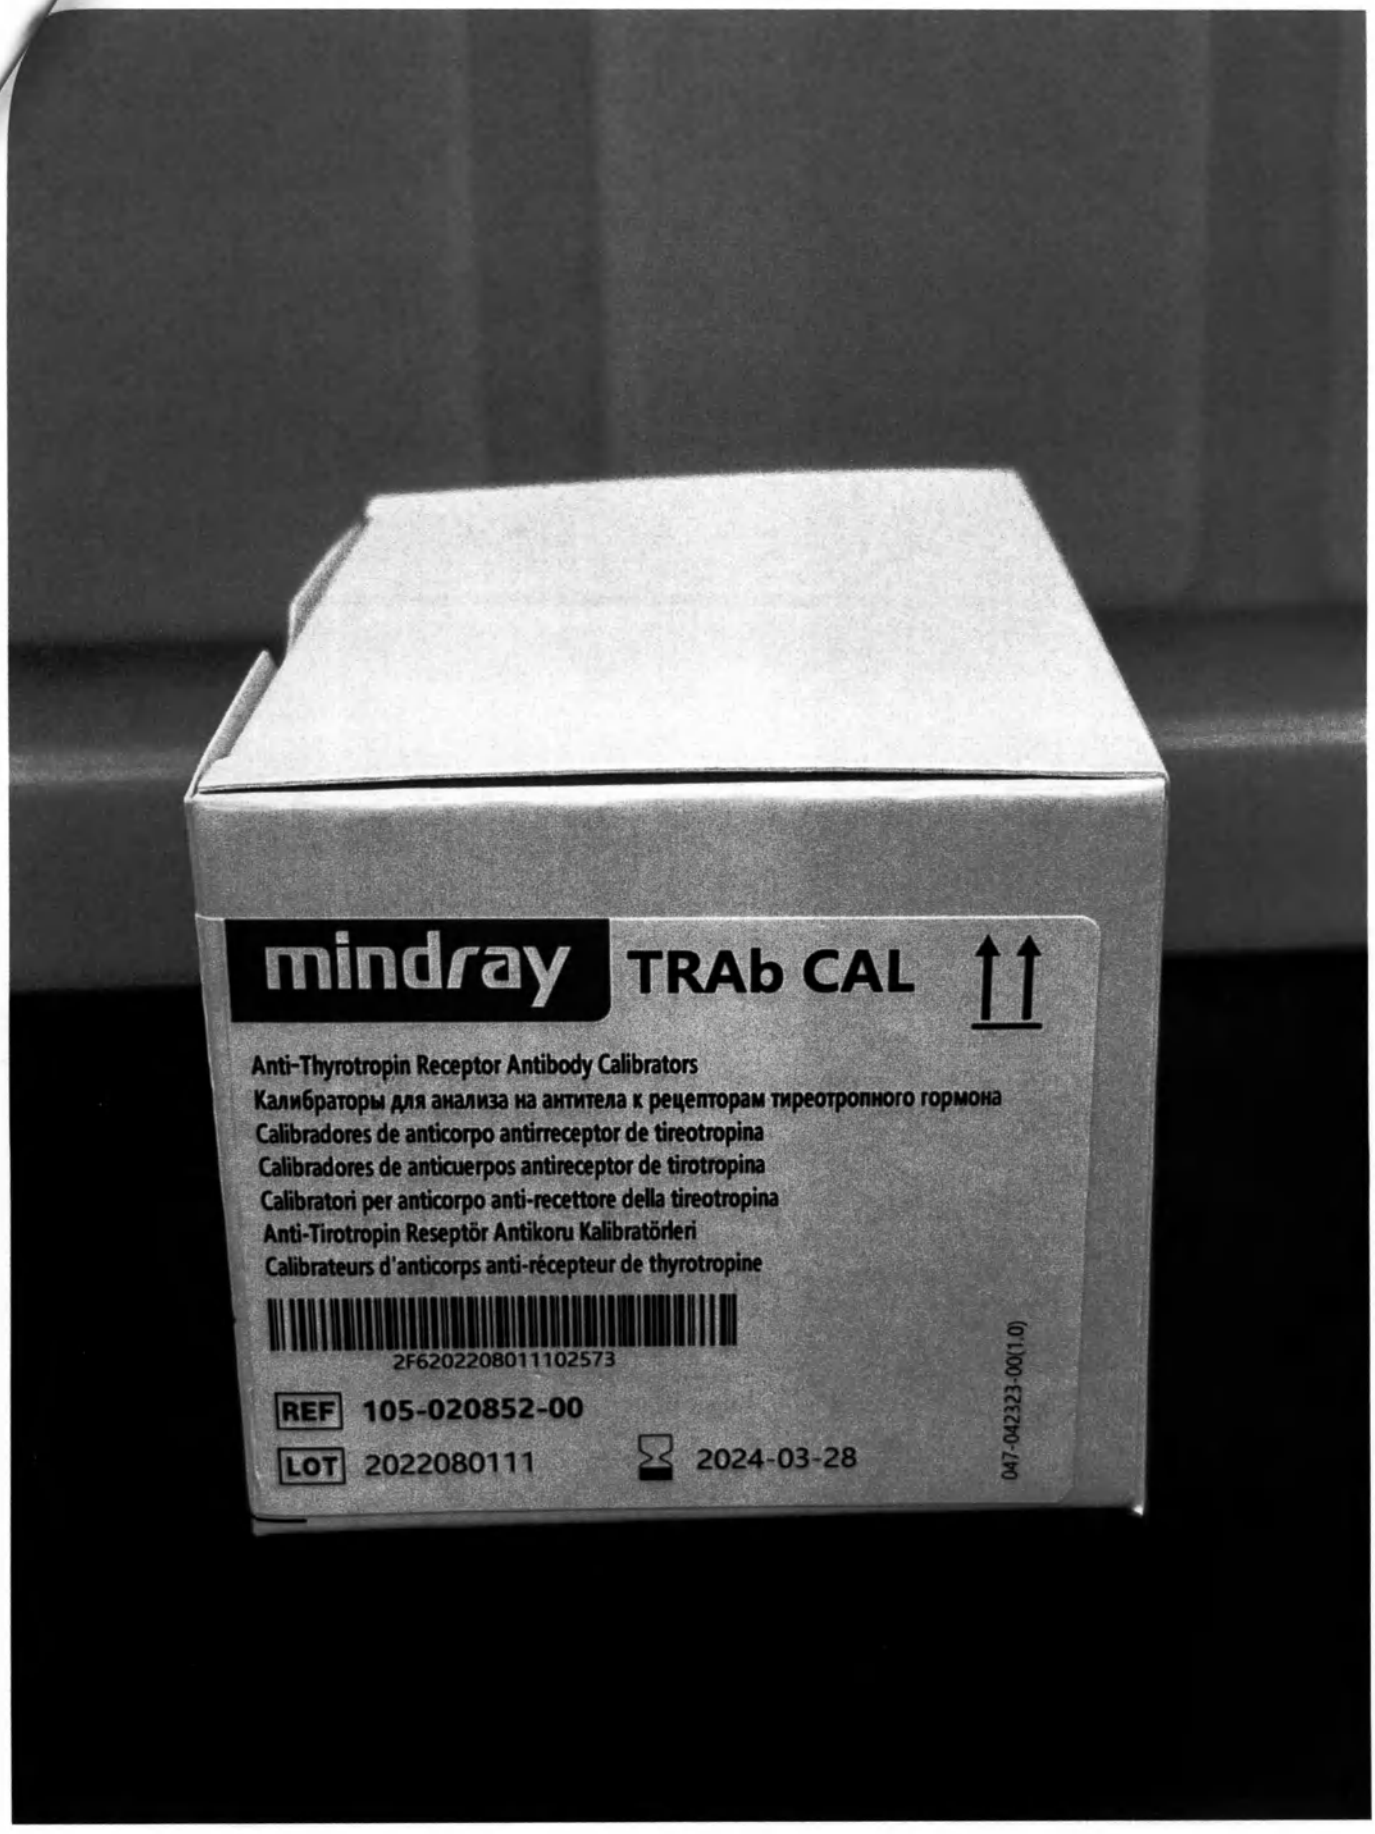

Рисунок 9. Внешняя упаковка. Набор калибраторов для диагностики in vitro для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (вид 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Рисунок 10. Внешняя упаковка. Набор калибраторов для диагностики in vitro для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (вид 3)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Набор калибраторов для диагностики in vitro для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

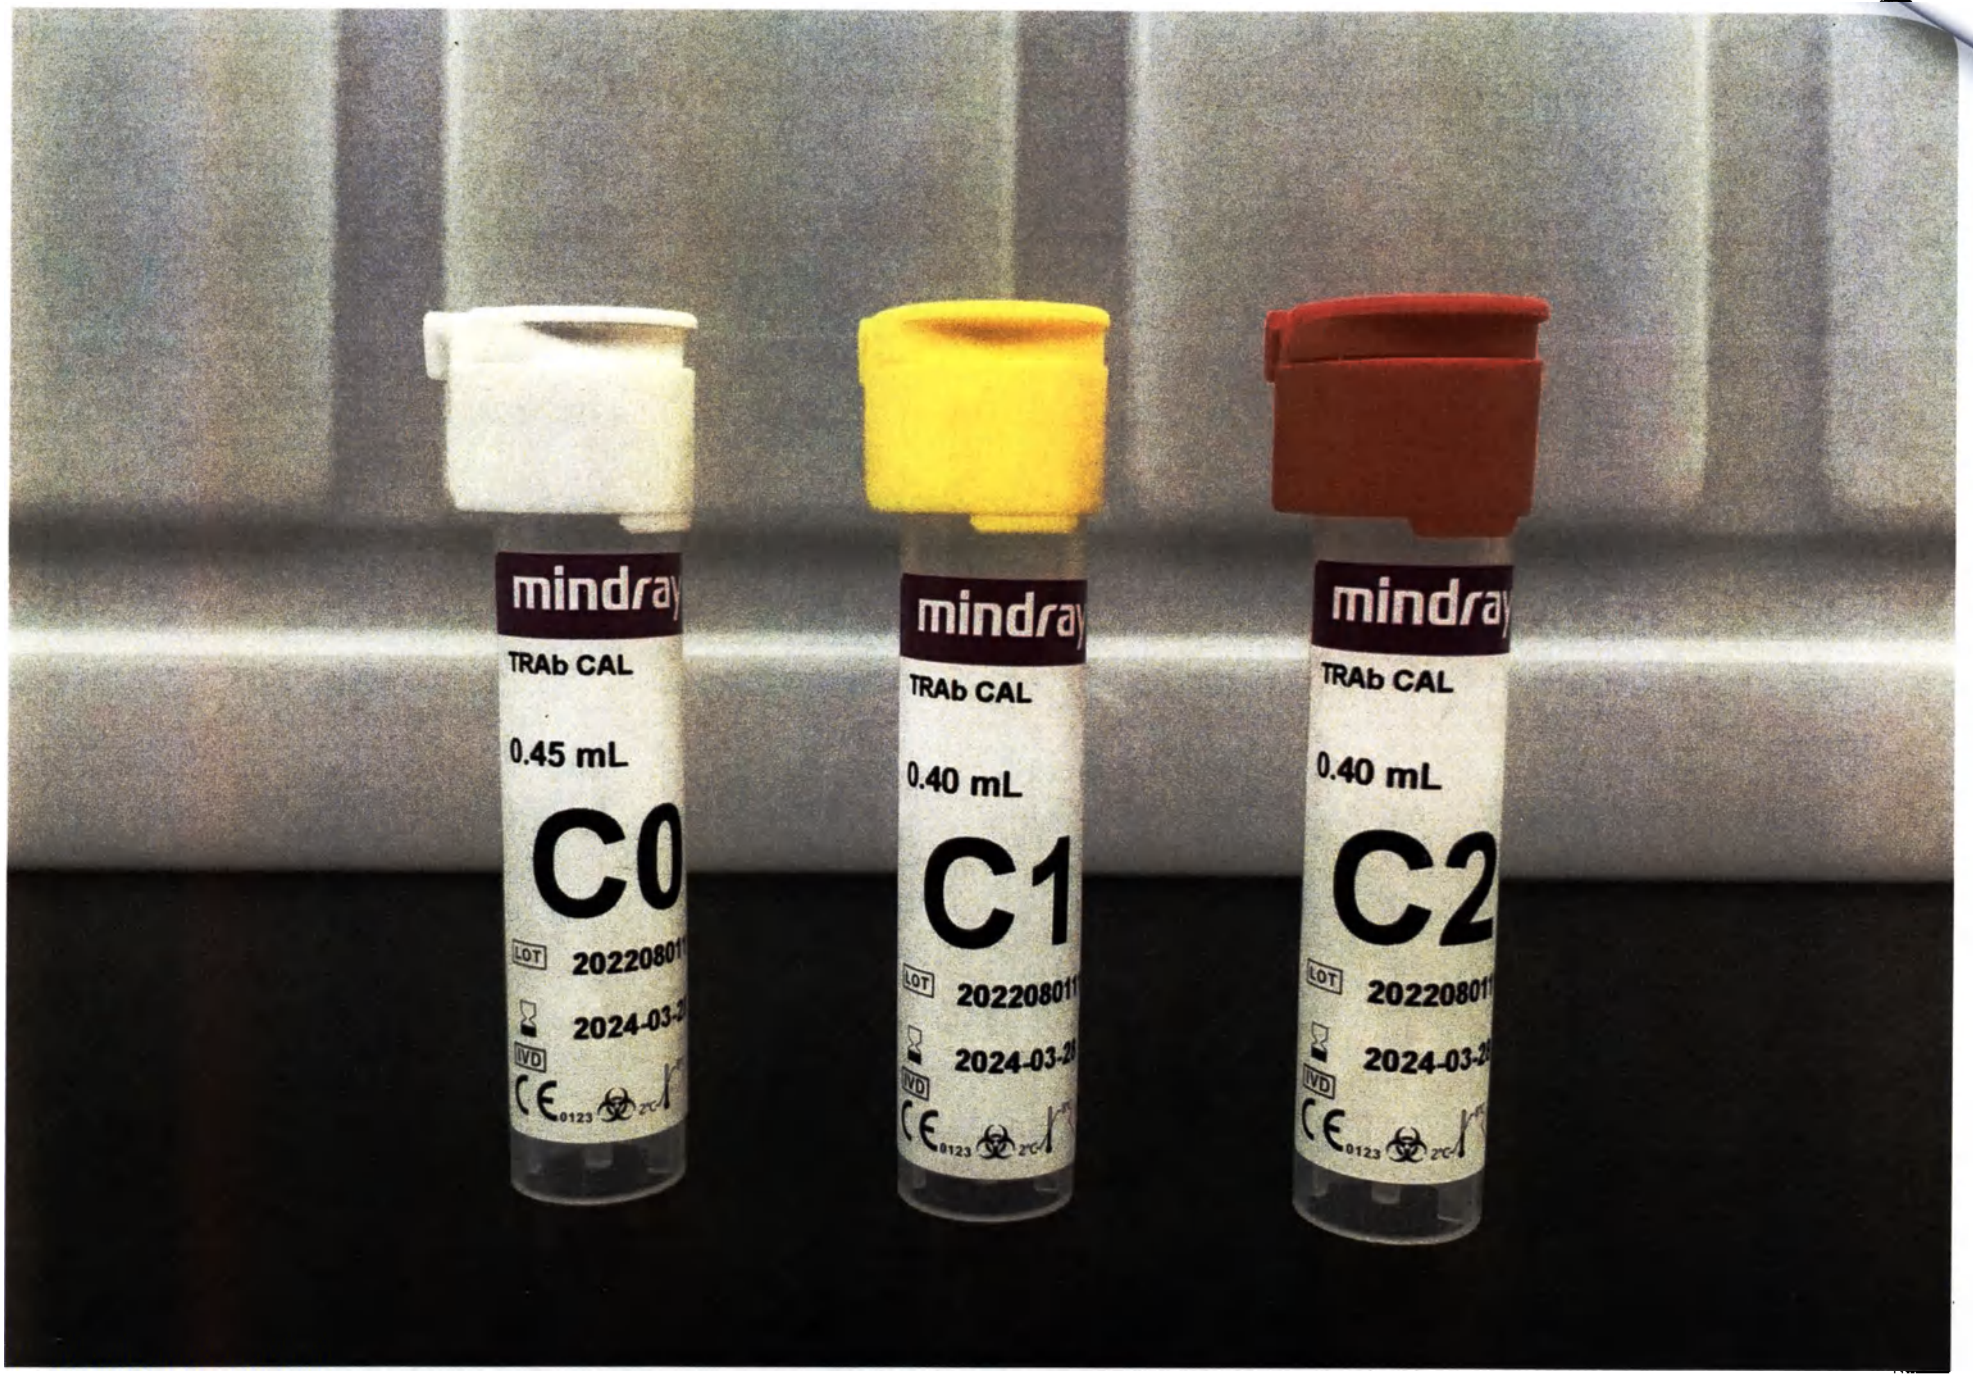

Рисунок 12. Калибраторы для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 0 (C0) – 4 флакона, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 1 (C1) – 4 флакона, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 2 (C2) – 4 флакона (вид 1)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

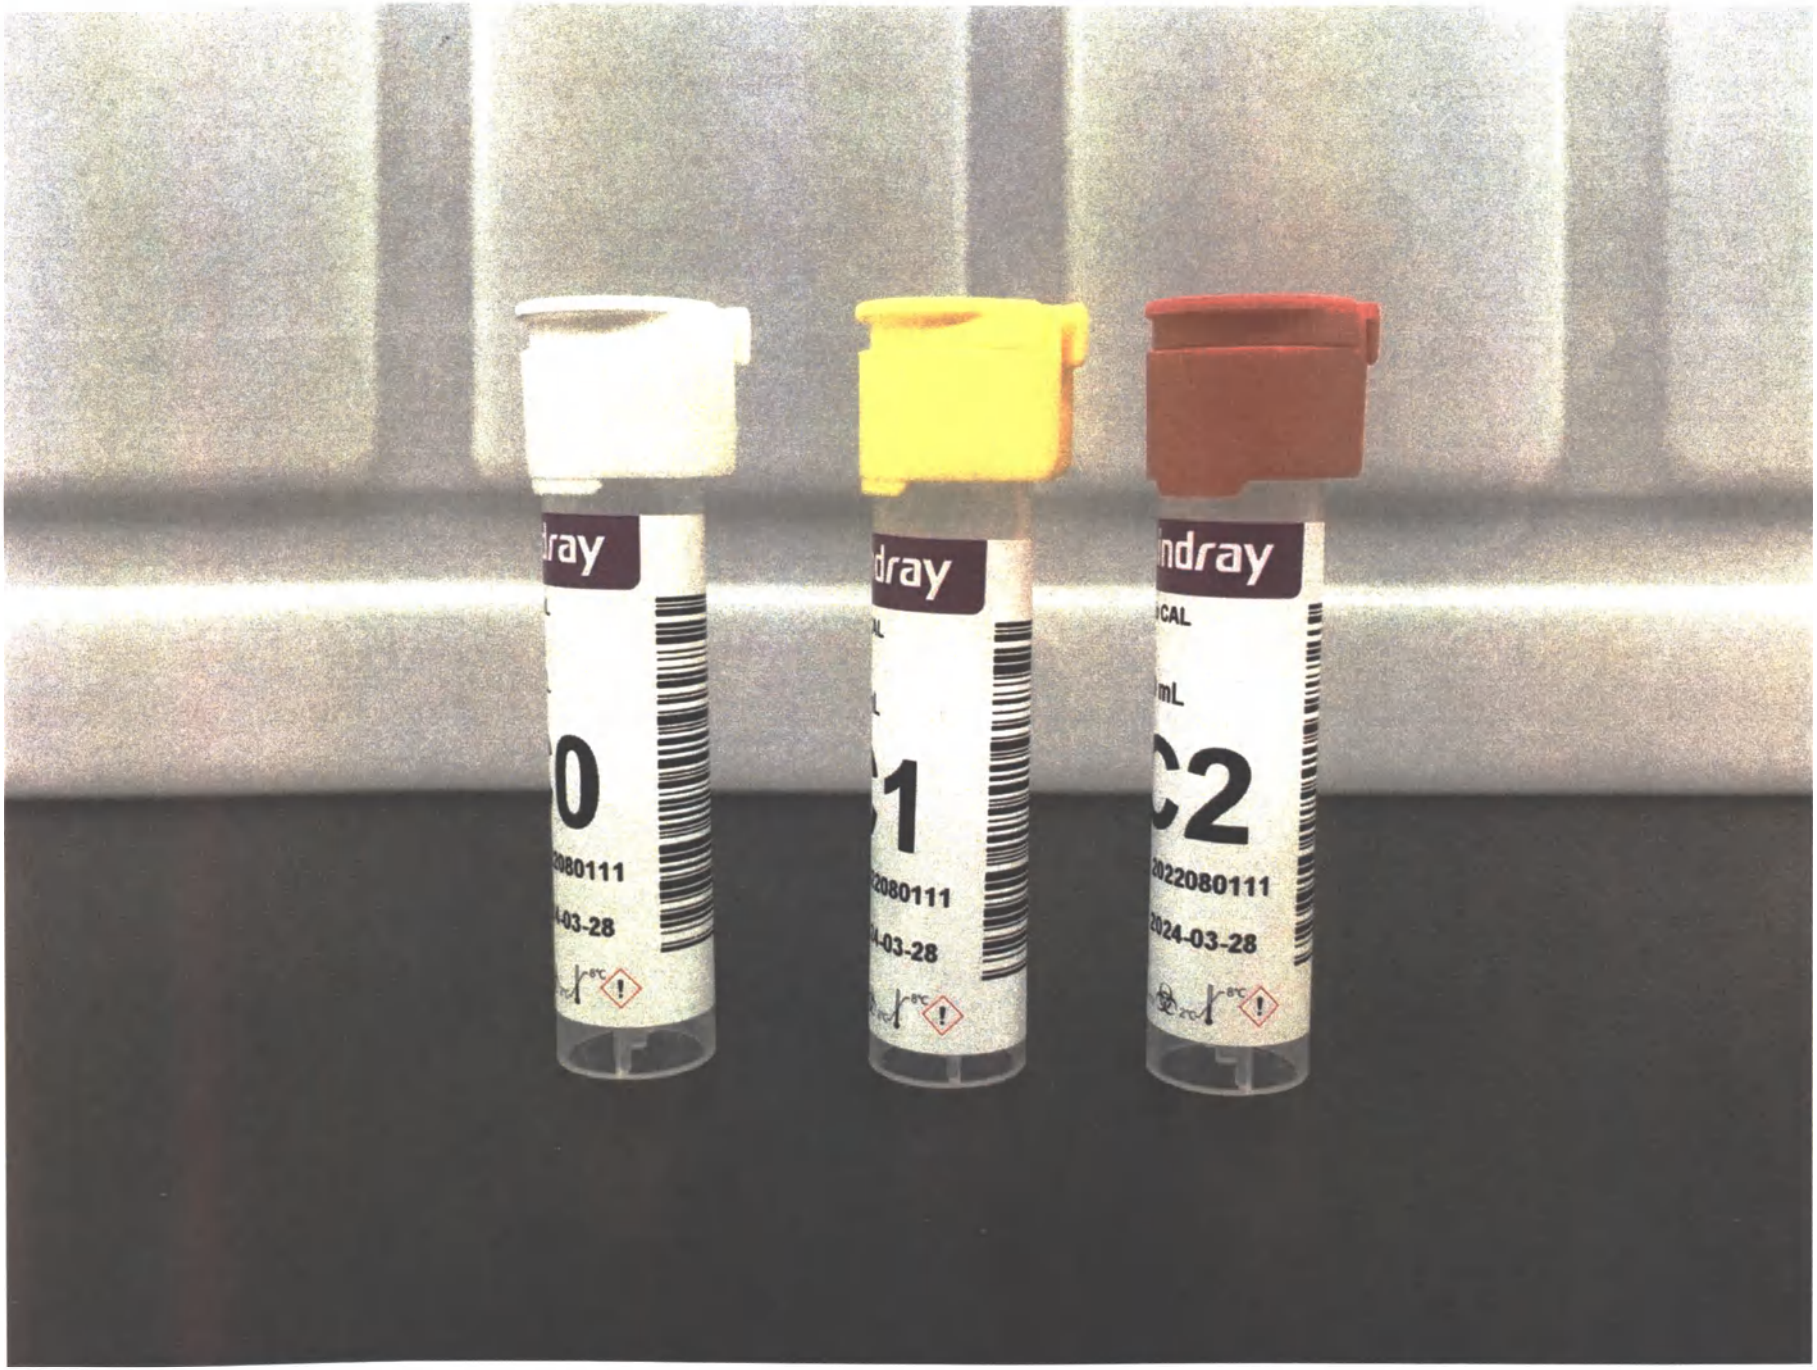

Рисунок 13. Калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 0 (C0) – 4 флакона, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 1 (C1) – 4 флакона, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 2 (C2) – 4 флакона (вид 2)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

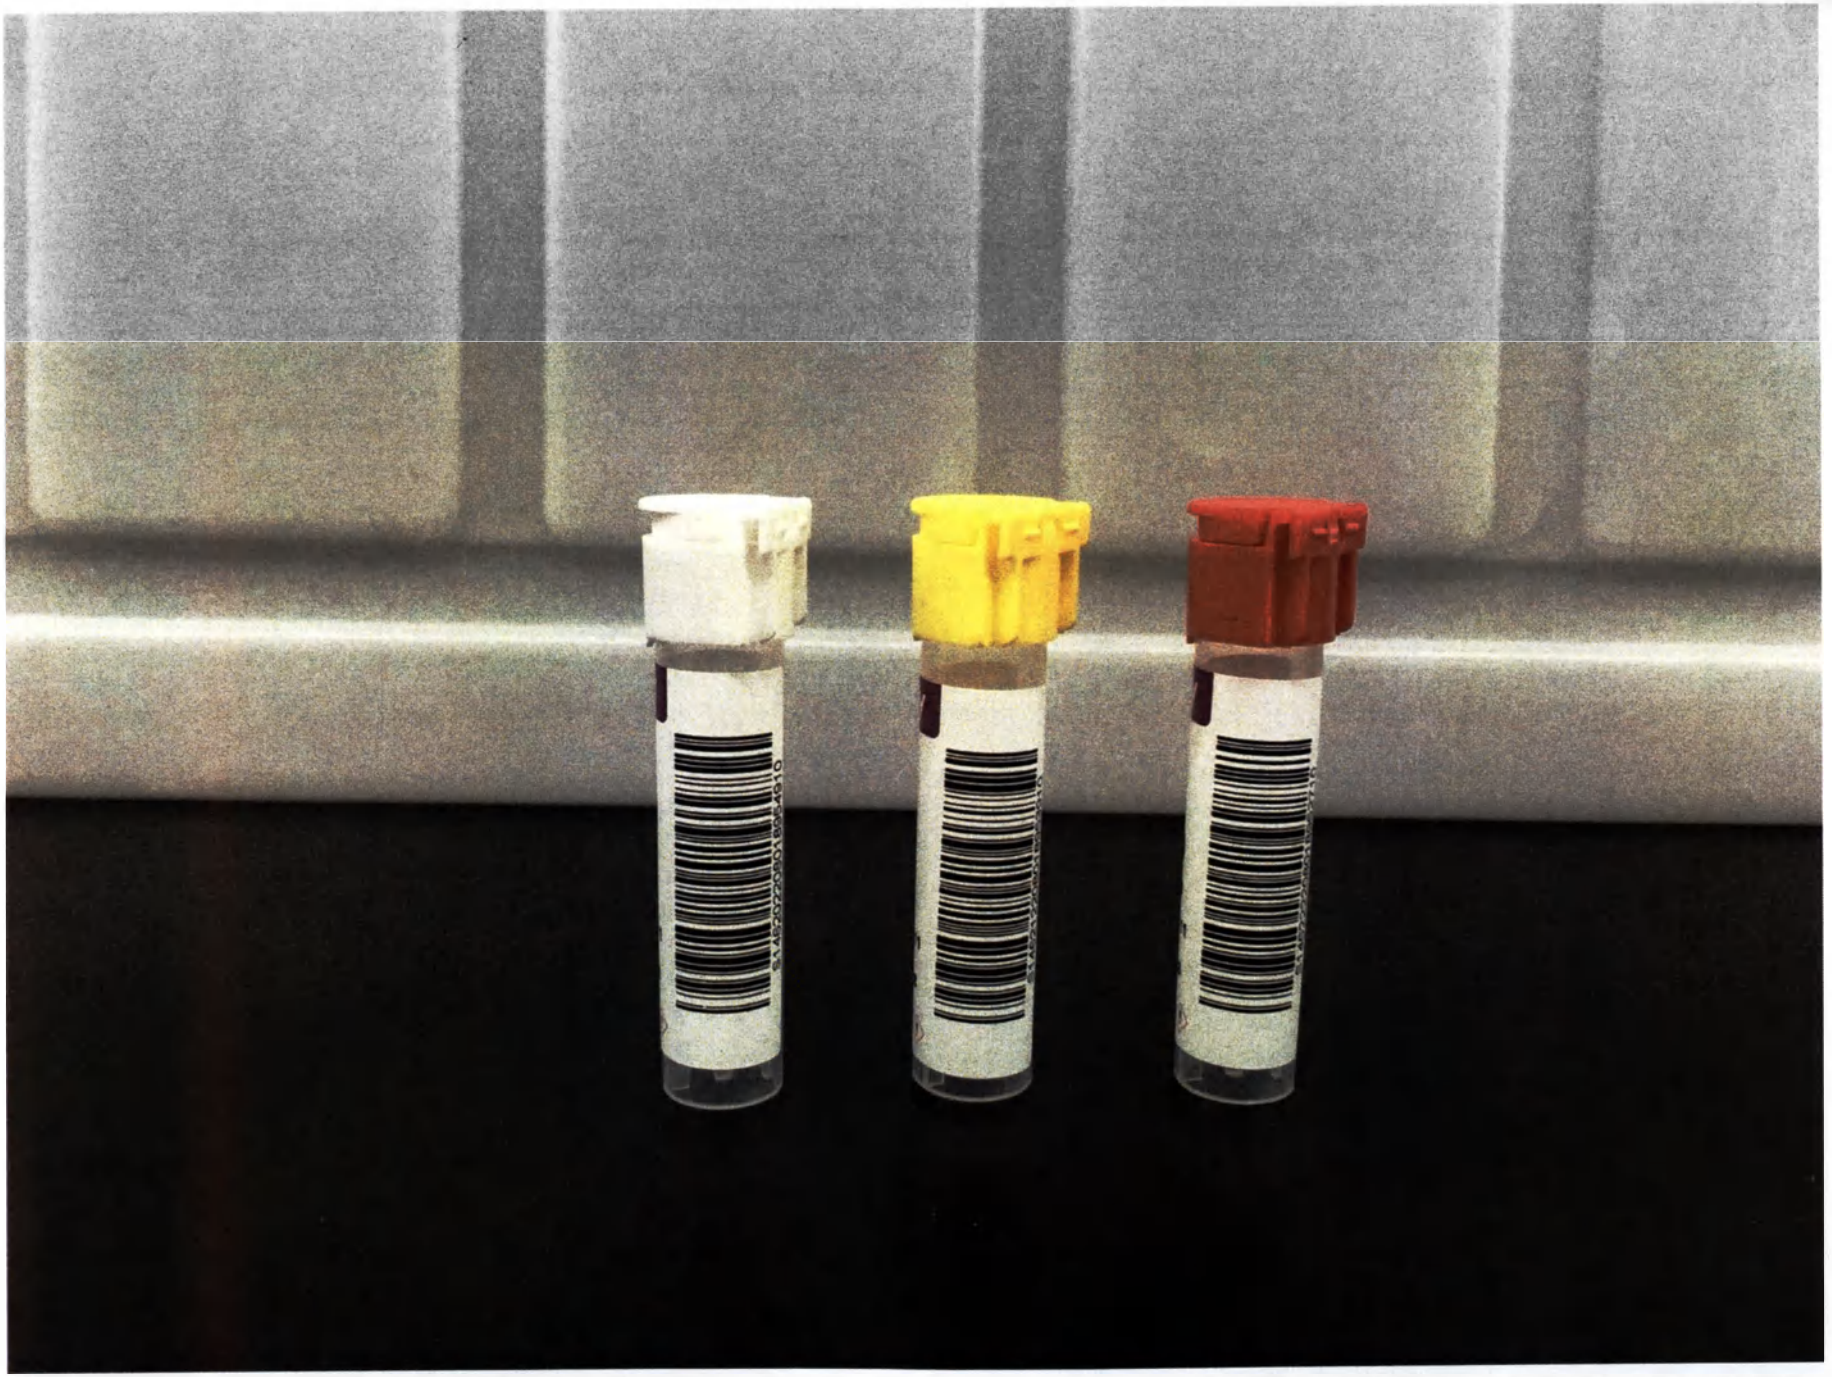

ственного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 0 (C0) – 4 флакона, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 1 (C1) – 4 флакона, калибратор для количественного определения антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb), уровень 2 (C2) – 4 флакона (ед. 3)

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
15 ЛИСТ

ПО ДОВЕРЕННОСТИ ОТ 20.11.2020
СЫСОЕВА Н.В.
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
РЕГИСТРАЦИИ

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU