



ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»

С. В. Сусова Сусова С. Вэй.
«25» декабря 2023 г.

по доверенности от 30.11.22г
Сусова Н. В.
руководитель отдела
регистрации

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики in vitro для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL

*Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»
129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39
ИНН 7705815069 КПП 770201001*

mindray

II

UDI




(01)06903053028073 (97)105-010221-A0
(10)2022100111 (99)105-010221-00
(17)240510 (98)2F7202210011100202

Anti-thyroid Antibodies Control

Contents: 3×2.0 mL/vial

L



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel : +86-755-81888998 Fax : +86-755-26582680 www.mindray.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

IVD



CONTROL



CE 0123 2°C 8°C

Рисунок 1. Внешняя упаковка. Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (L), 2 мл - 3 флакона (вид 1)

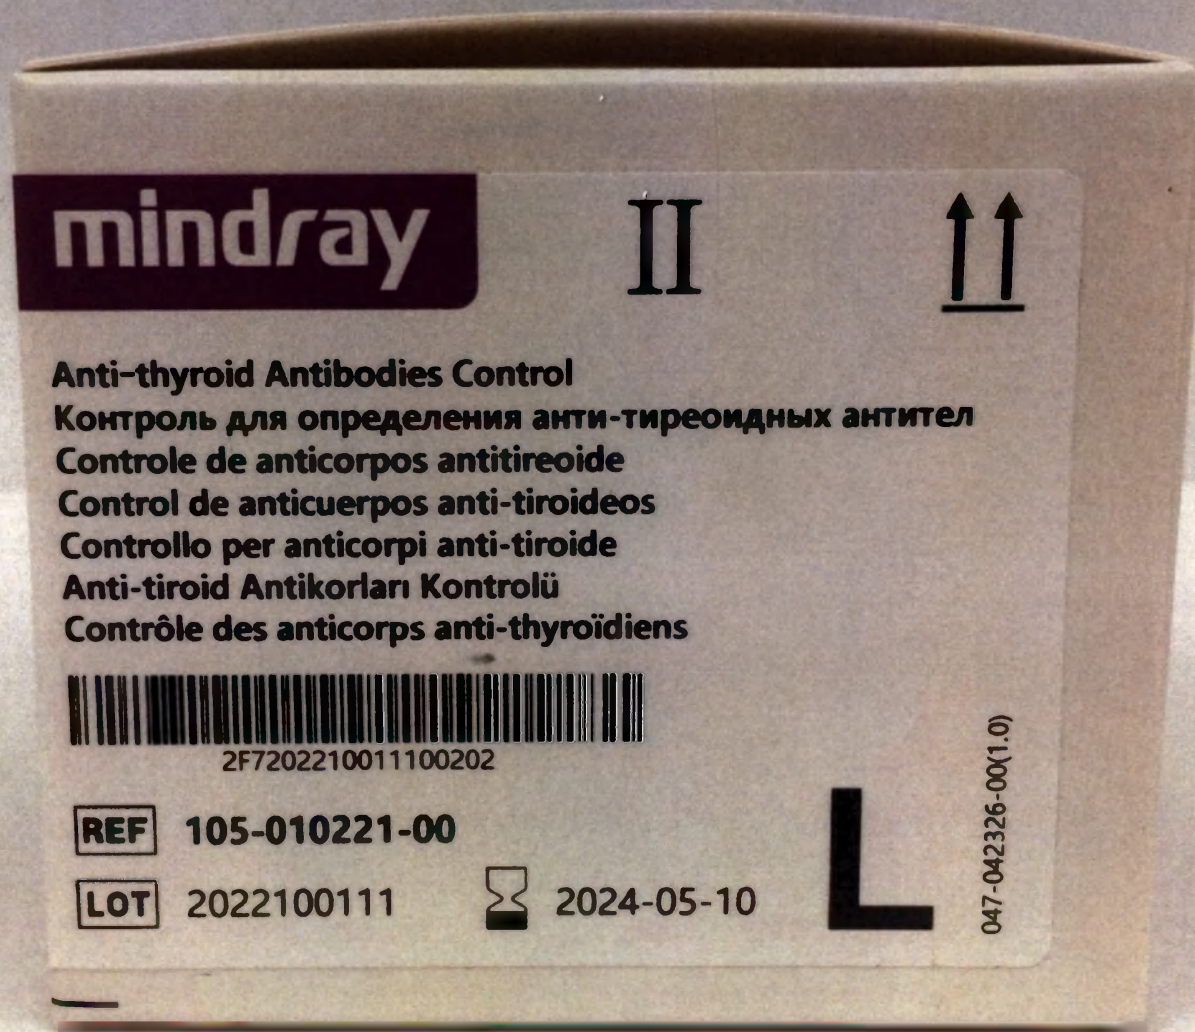


Рисунок 1. Внешняя упаковка Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (L), 2 мл - 3 флакона (вид 2)

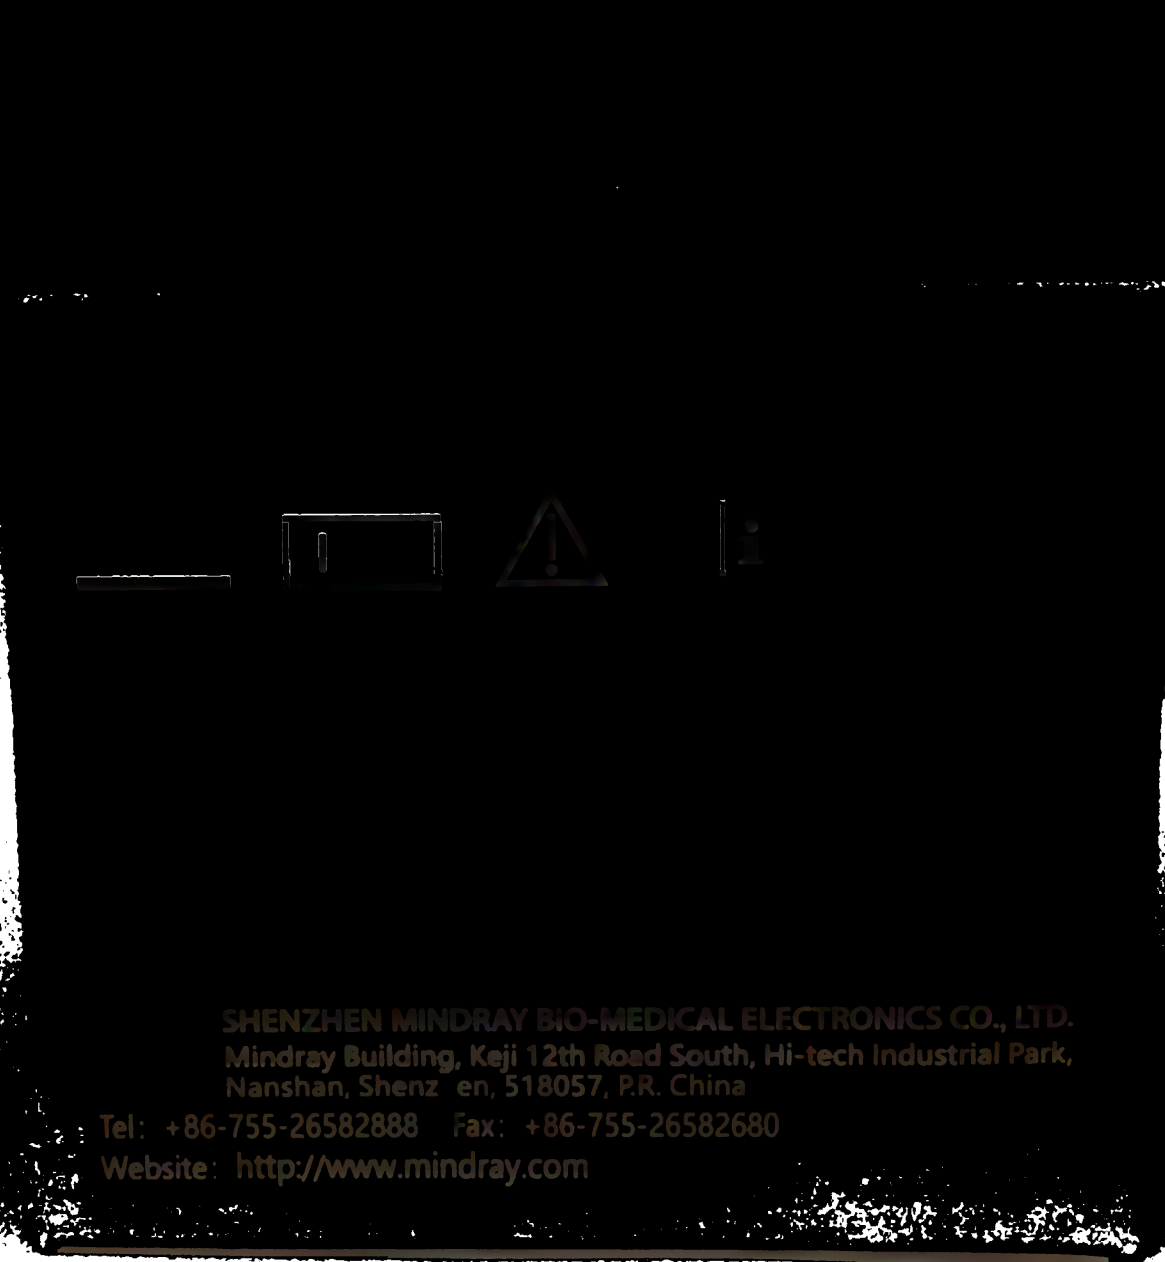


Рисунок 2. Внешняя упаковка Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (L), 2 мл - 3 флакона (вид 3)

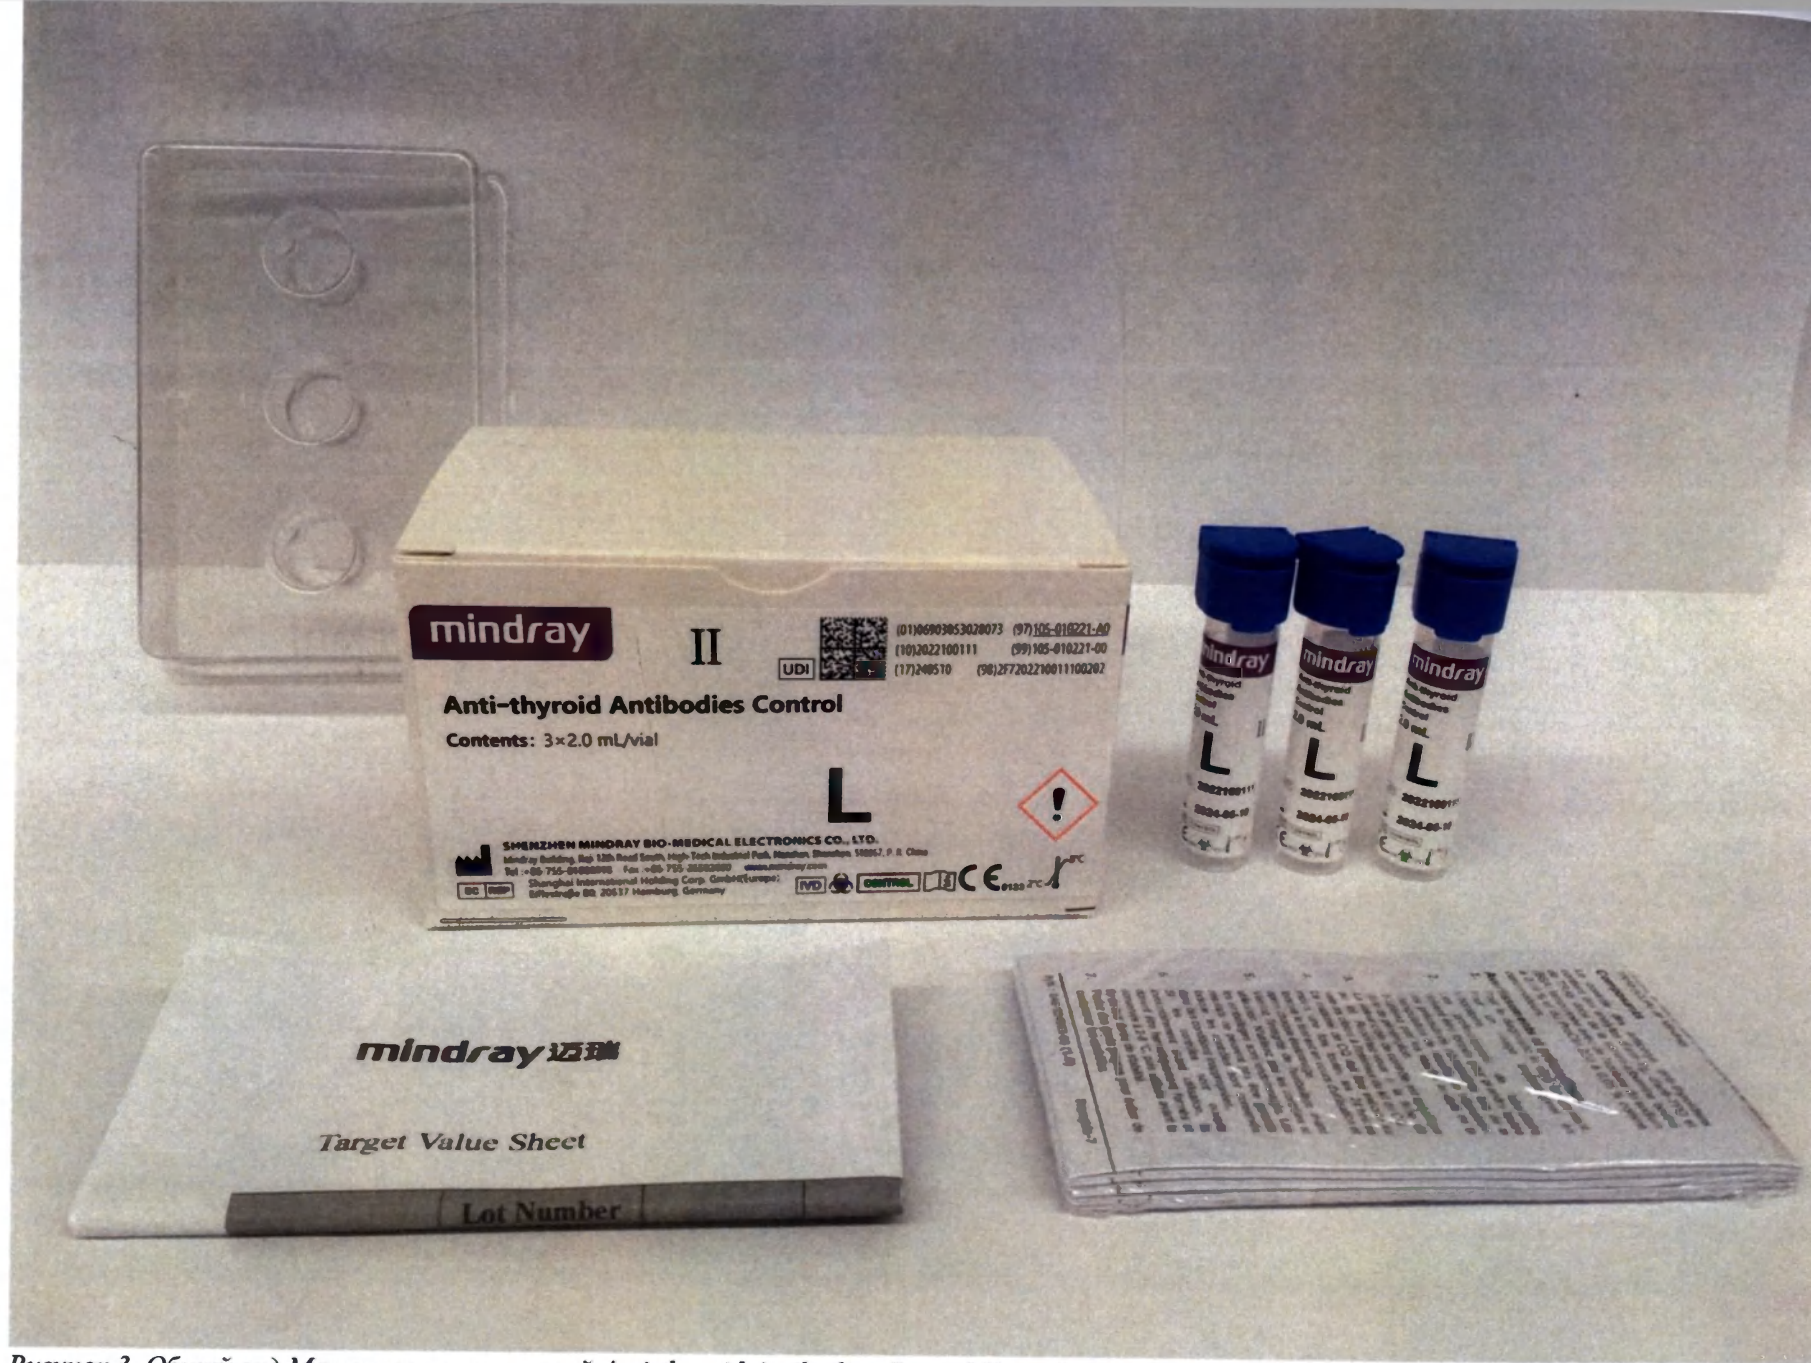


Рисунок 3. Общий вид Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (L), 2 мл - 3 флакона



Рисунок 5. Материал контрольный (Anti-thyroid Antibodies Control II) (L), 2 мл – 3 флакона (вид 1)

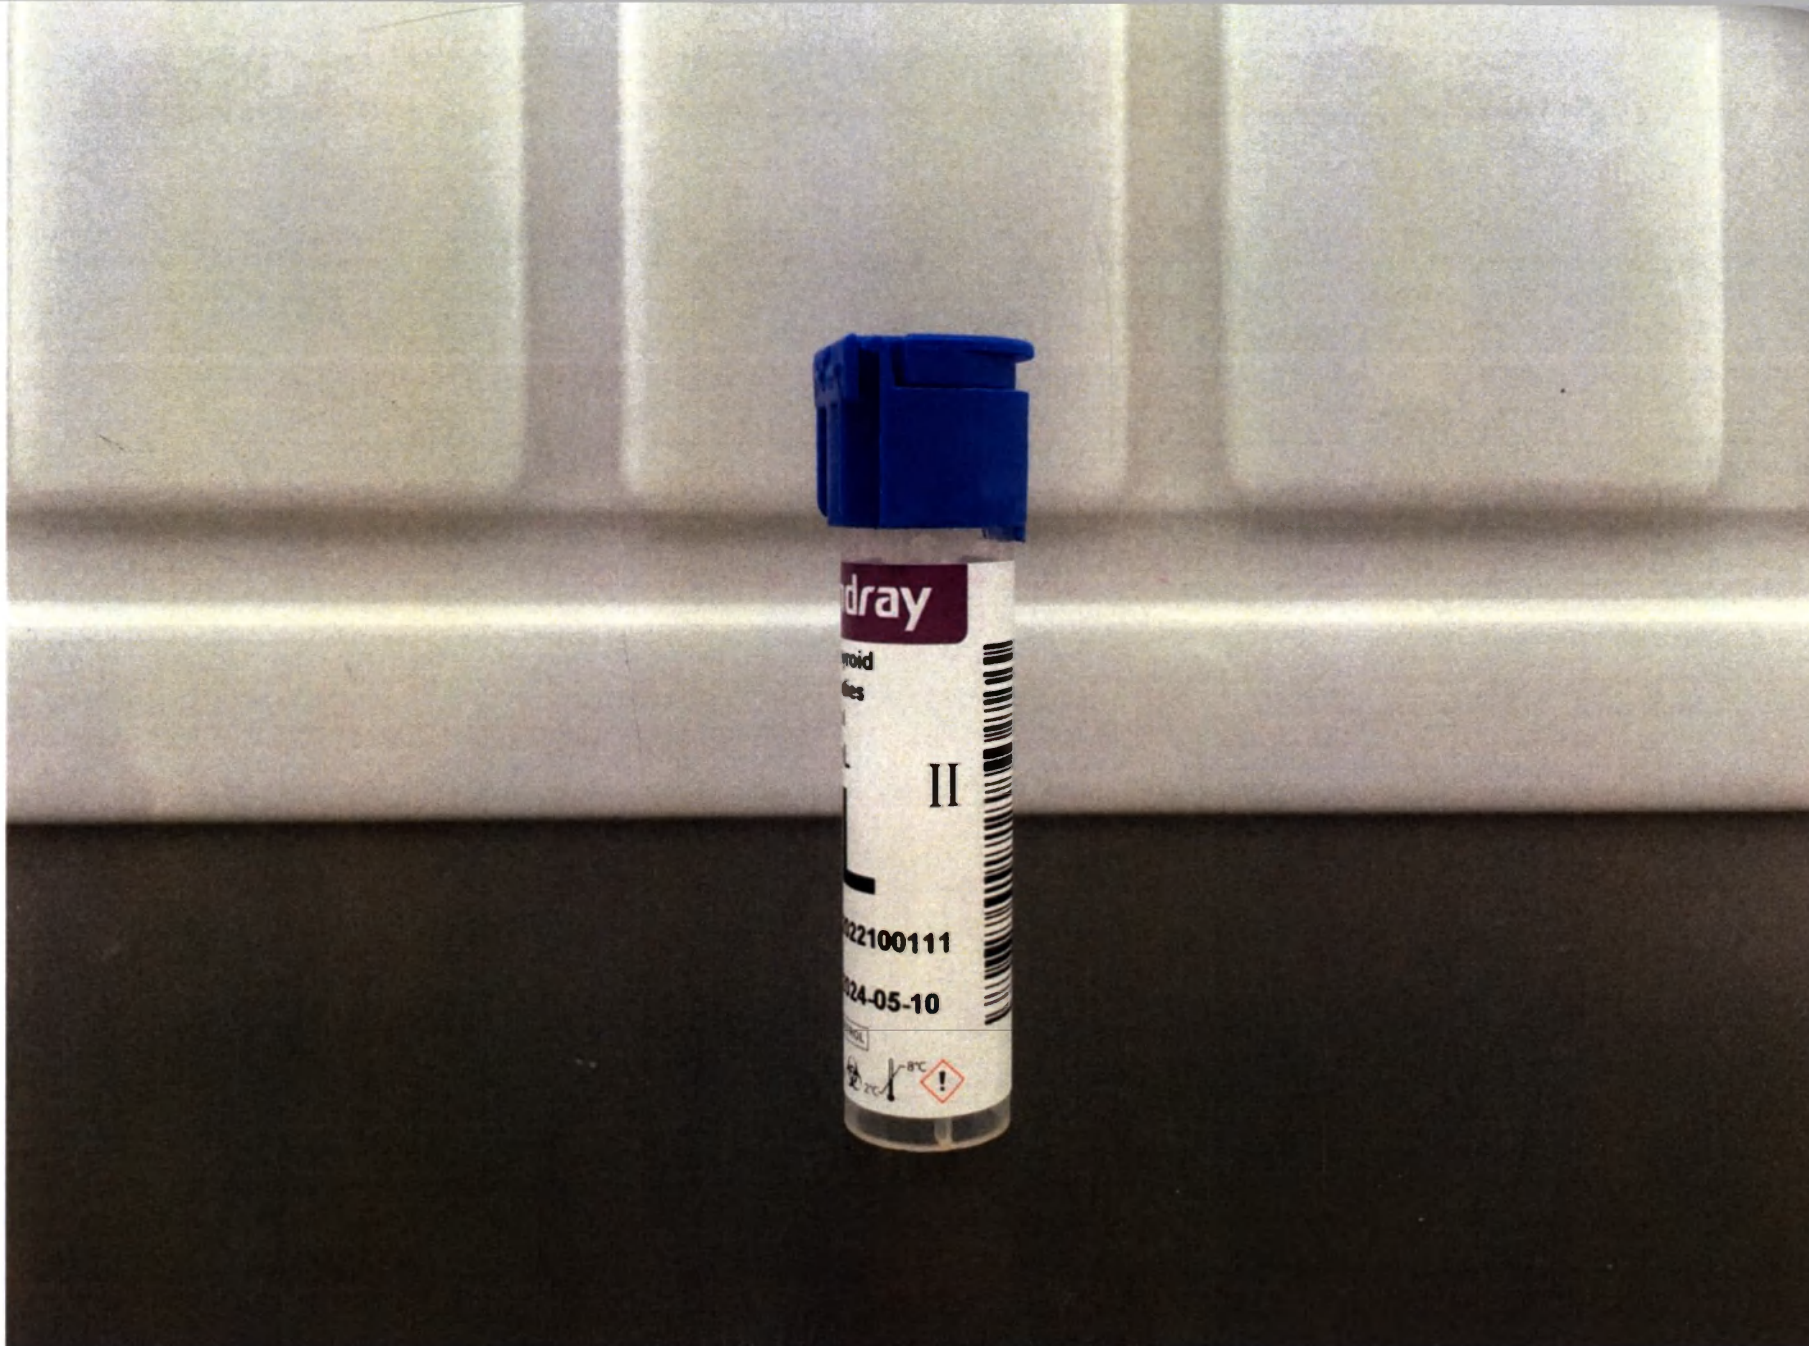


Рисунок 4. Материал контрольный (Anti-thyroid Antibodies Control II) (L), 2 мл – 3 флакона (вид 2)


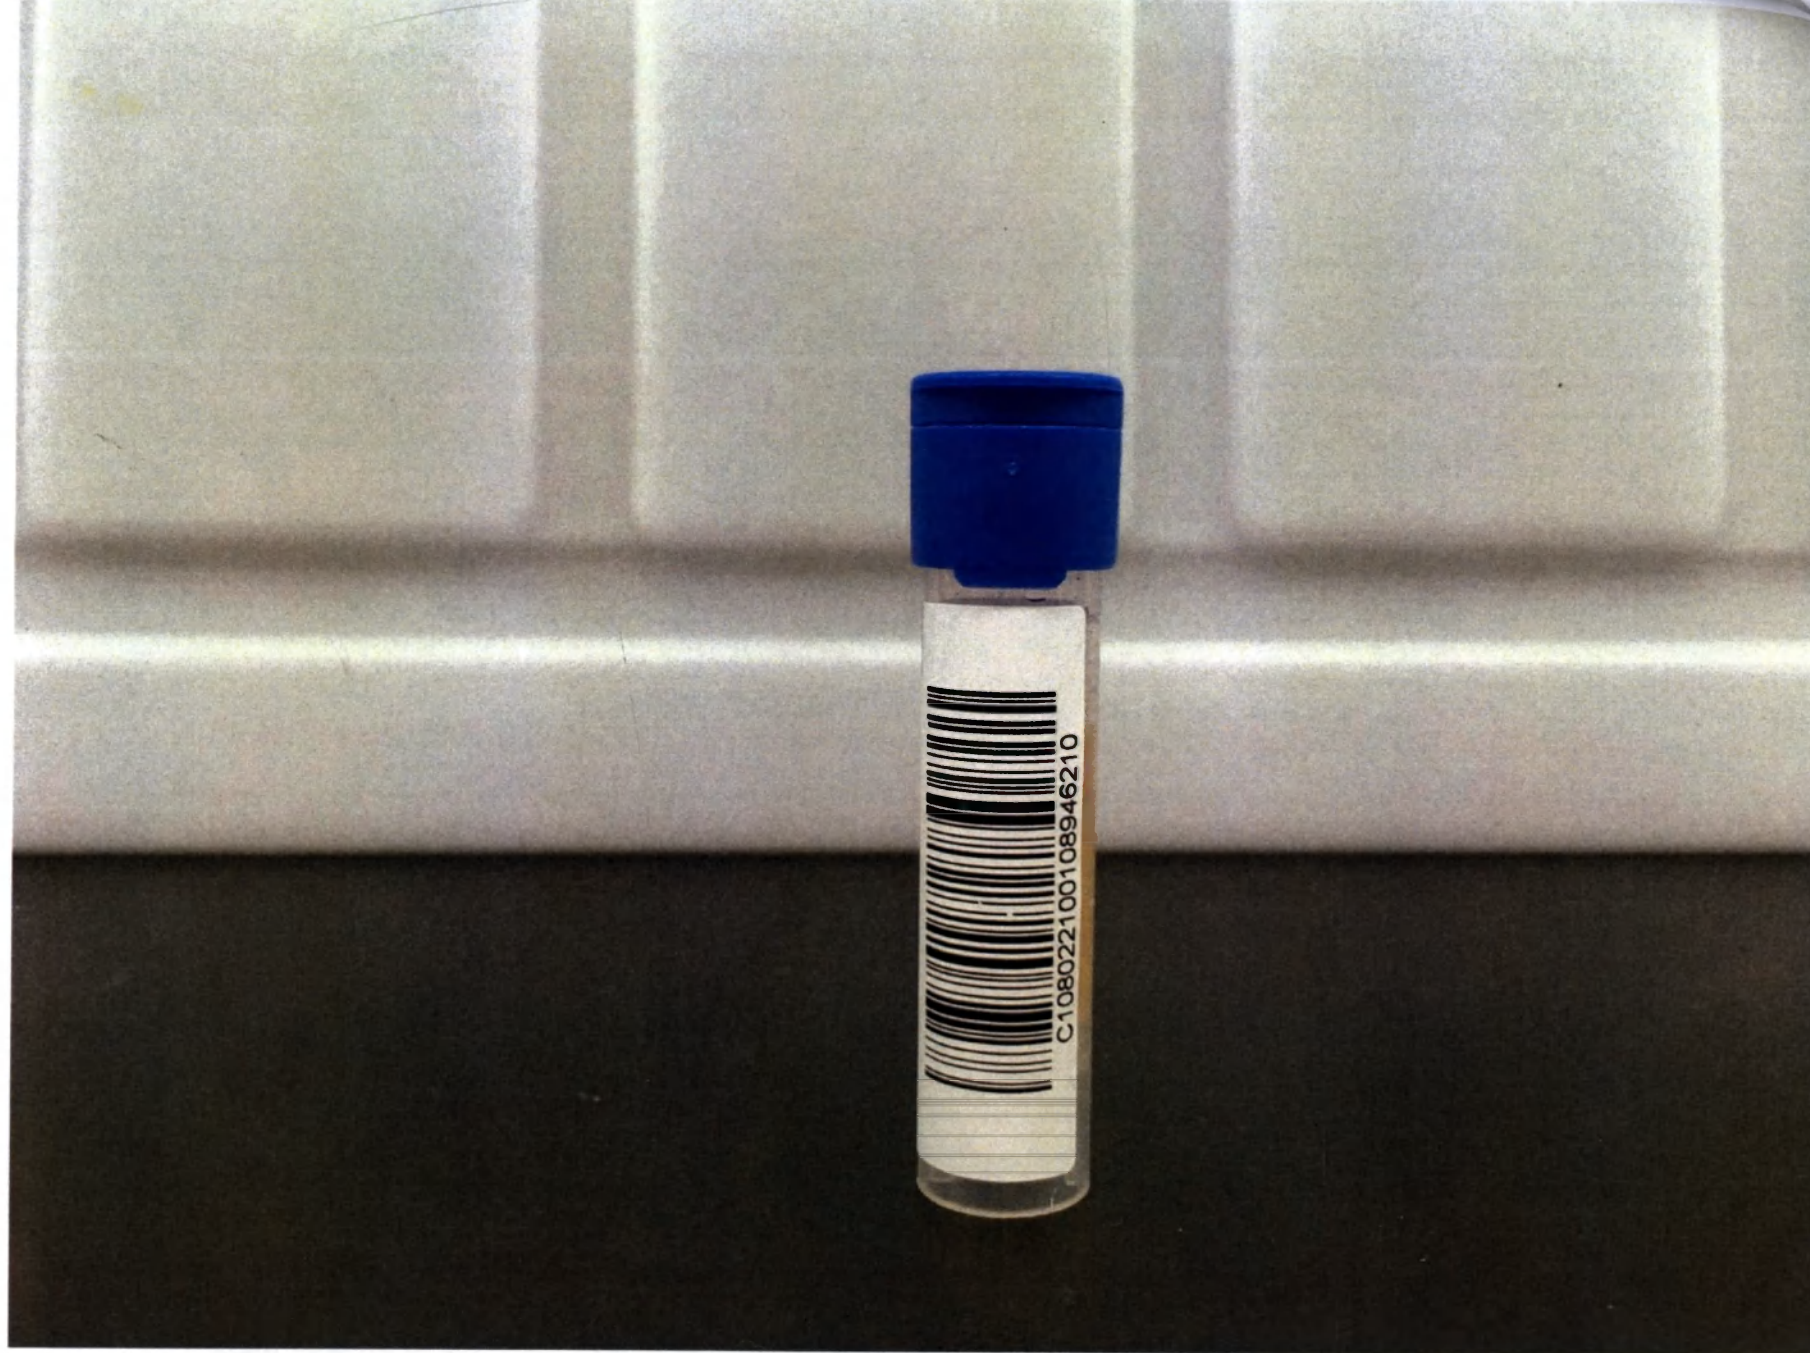


Рисунок 7. Материал контрольный (Anti-thyroid Antibodies Control II) (L), 2 мл – 3 флакона (вид 3)

mindray

II

UDI



(01)06903053028189 (97)105-010241-A0


(10)2022100111 (99)105-010241-00

(17)240510 (98)2F9202210011100052

Anti-thyroid Antibodies Control

Contents: 6×2.0 mL/vial


L



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel : +86-755-81888998 Fax : +86-755-26582600 www.mindray.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



CONTROL




0123 2°C 8°C

Рисунок 8. Внешняя упаковка Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (L), 2 мл - 6 флаконов (вид I)

mindray

II



Anti-thyroid Antibodies Control

Контроль для определения анти-тиреоидных антител

Controle de anticorpos antitireoide

Control de anticuerpos anti-tiroideos

Controllo per anticorpi anti-tiroide

Anti-tiroid Antikorları Kontrolü

Contrôle des anticorps anti-thyroïdiens



2F9202210011100052

REF 105-010241-00

LOT 2022100111




2024-05-10



047-042326-00(1.0)

Рисунок 9. Внешняя упаковка Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (L), 2 мл - 6 флаконов (вид 2)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

Tel: +86-755-26582888 Fax: +86-755-26582680

Website: <http://www.mindray.com>

Рисунок 10. Внешняя упаковка Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (L), 2 мл - 6 флаконов (вид 3)

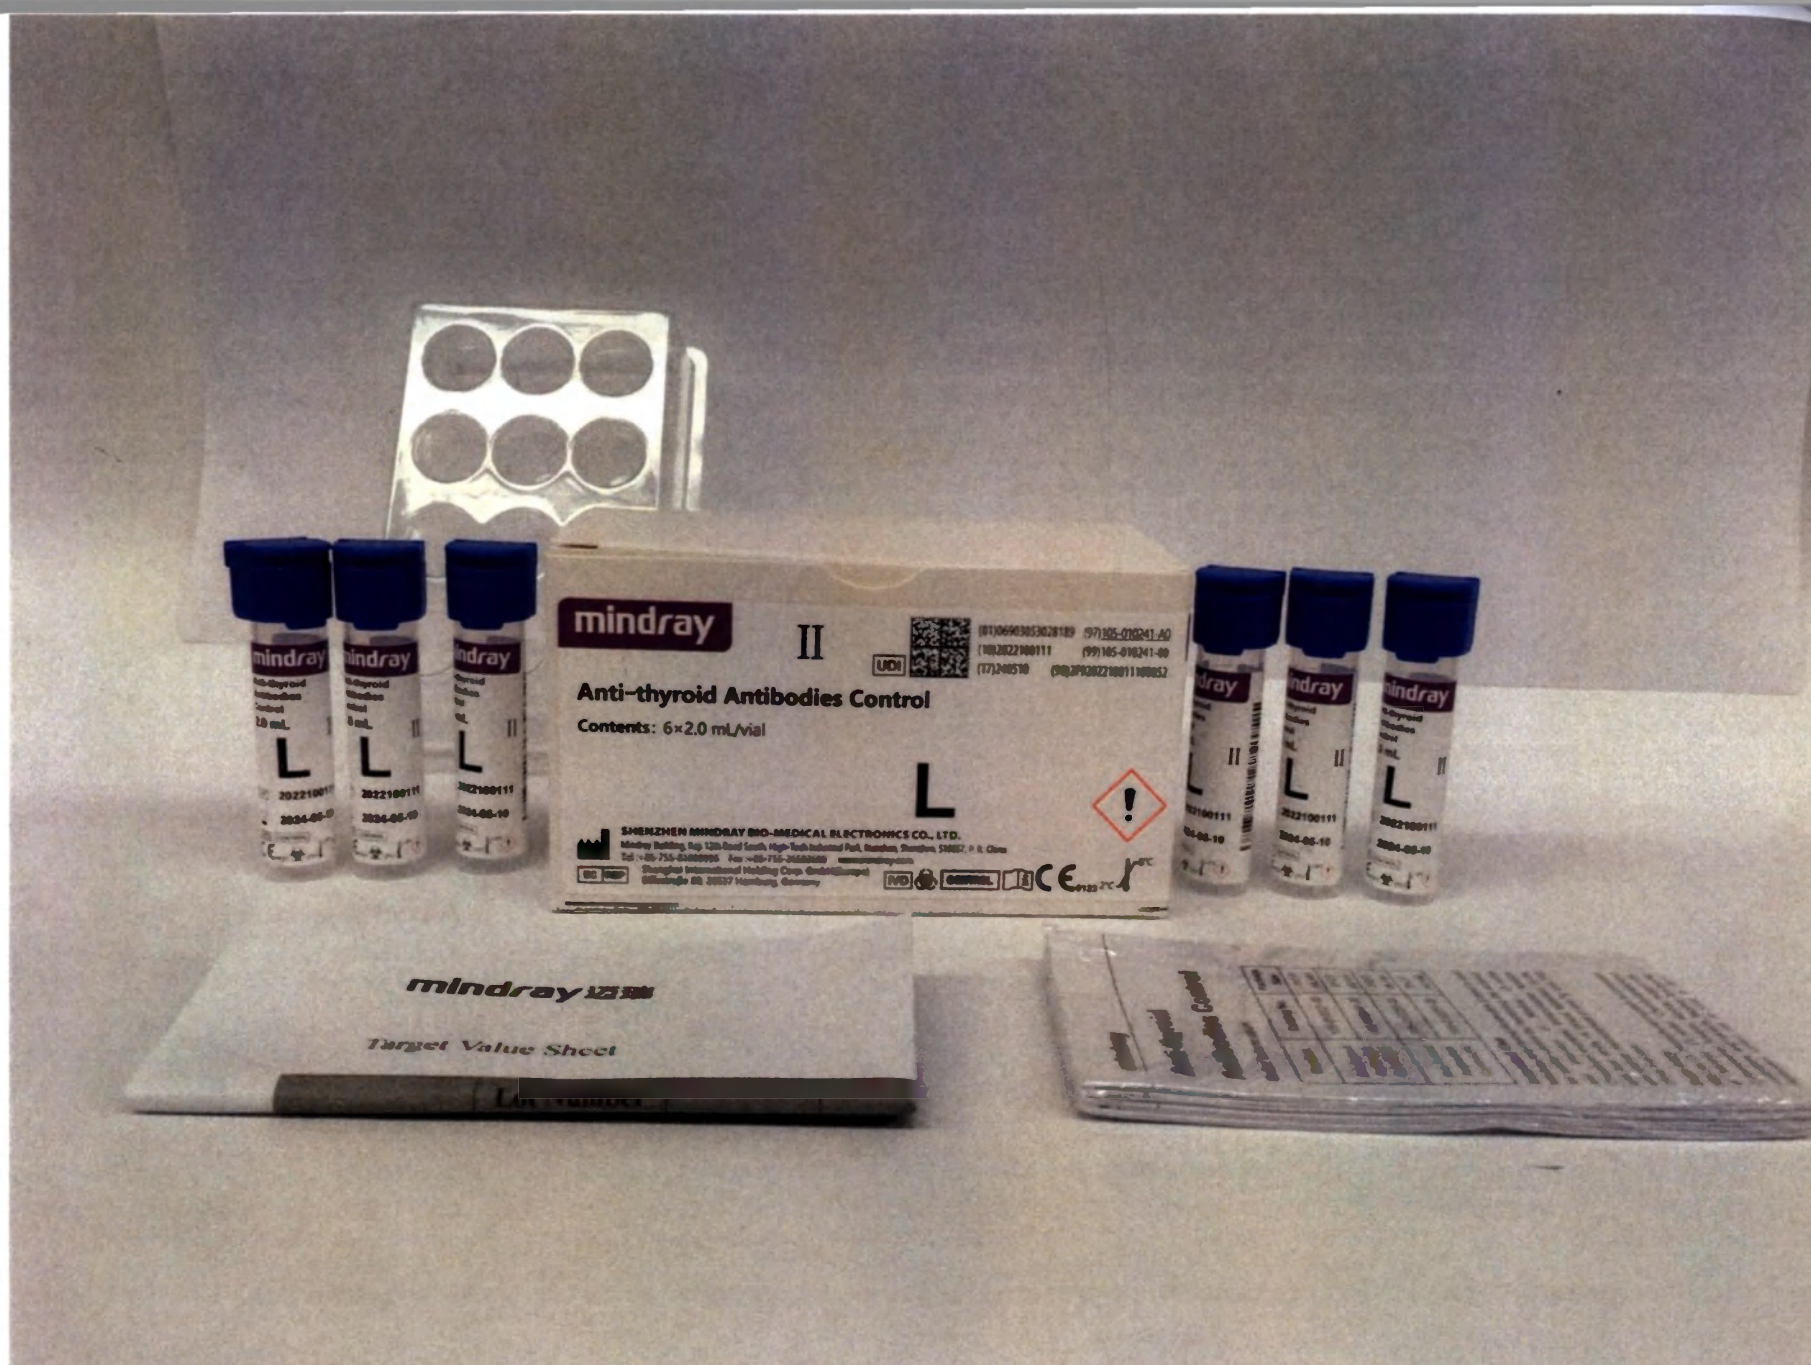


Рисунок 11. Общий вид. Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (L), 2 мл - 6 флаконов



mindray

II

UDI



(01)06903053028134 (97)105-010231-A0

(10)2022100111 (99)105-010231-00

(17)240510 (98)2F8202210011100202

Anti-thyroid Antibodies Control

Contents: 3×2.0 mL/vial


H



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel : +86-755-81888998 Fax : +86-755-26582680 www.mindray.com



Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany



CONTROL



0123

2°C





Рисунок 13. Внешняя упаковка Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (H), 2 мл - 3 флакона (вид 1)

mindray

II



Anti-thyroid Antibodies Control

Контроль для определения анти -тиреоидных антител

Controle de anticorpos antitireoide

Control de anticuerpos anti -tiroideos

Controllo per anticorpi anti-tiroide

Anti-tiroid Antikorları Kontrolü

Contrôle des anticorps anti -thyroïdiens



2F8202210011100202

REF 105-010231-00

LOT 2022100111



2024-05-10

H

047-042327-00(1.0)

Рисунок 14. Внешняя упаковка Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилуминесцентным методом на анализаторах серии CL (H), 2 мл - 3 флакона (вид 2)

SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.
Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

Tel: +86-755-26582888 Fax: +86-755-26582680

Website: <http://www.mindray.com>

Рисунок 15. Внешняя упаковка *Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II* для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (H), 2 мл - 3 флакона (вид 3)

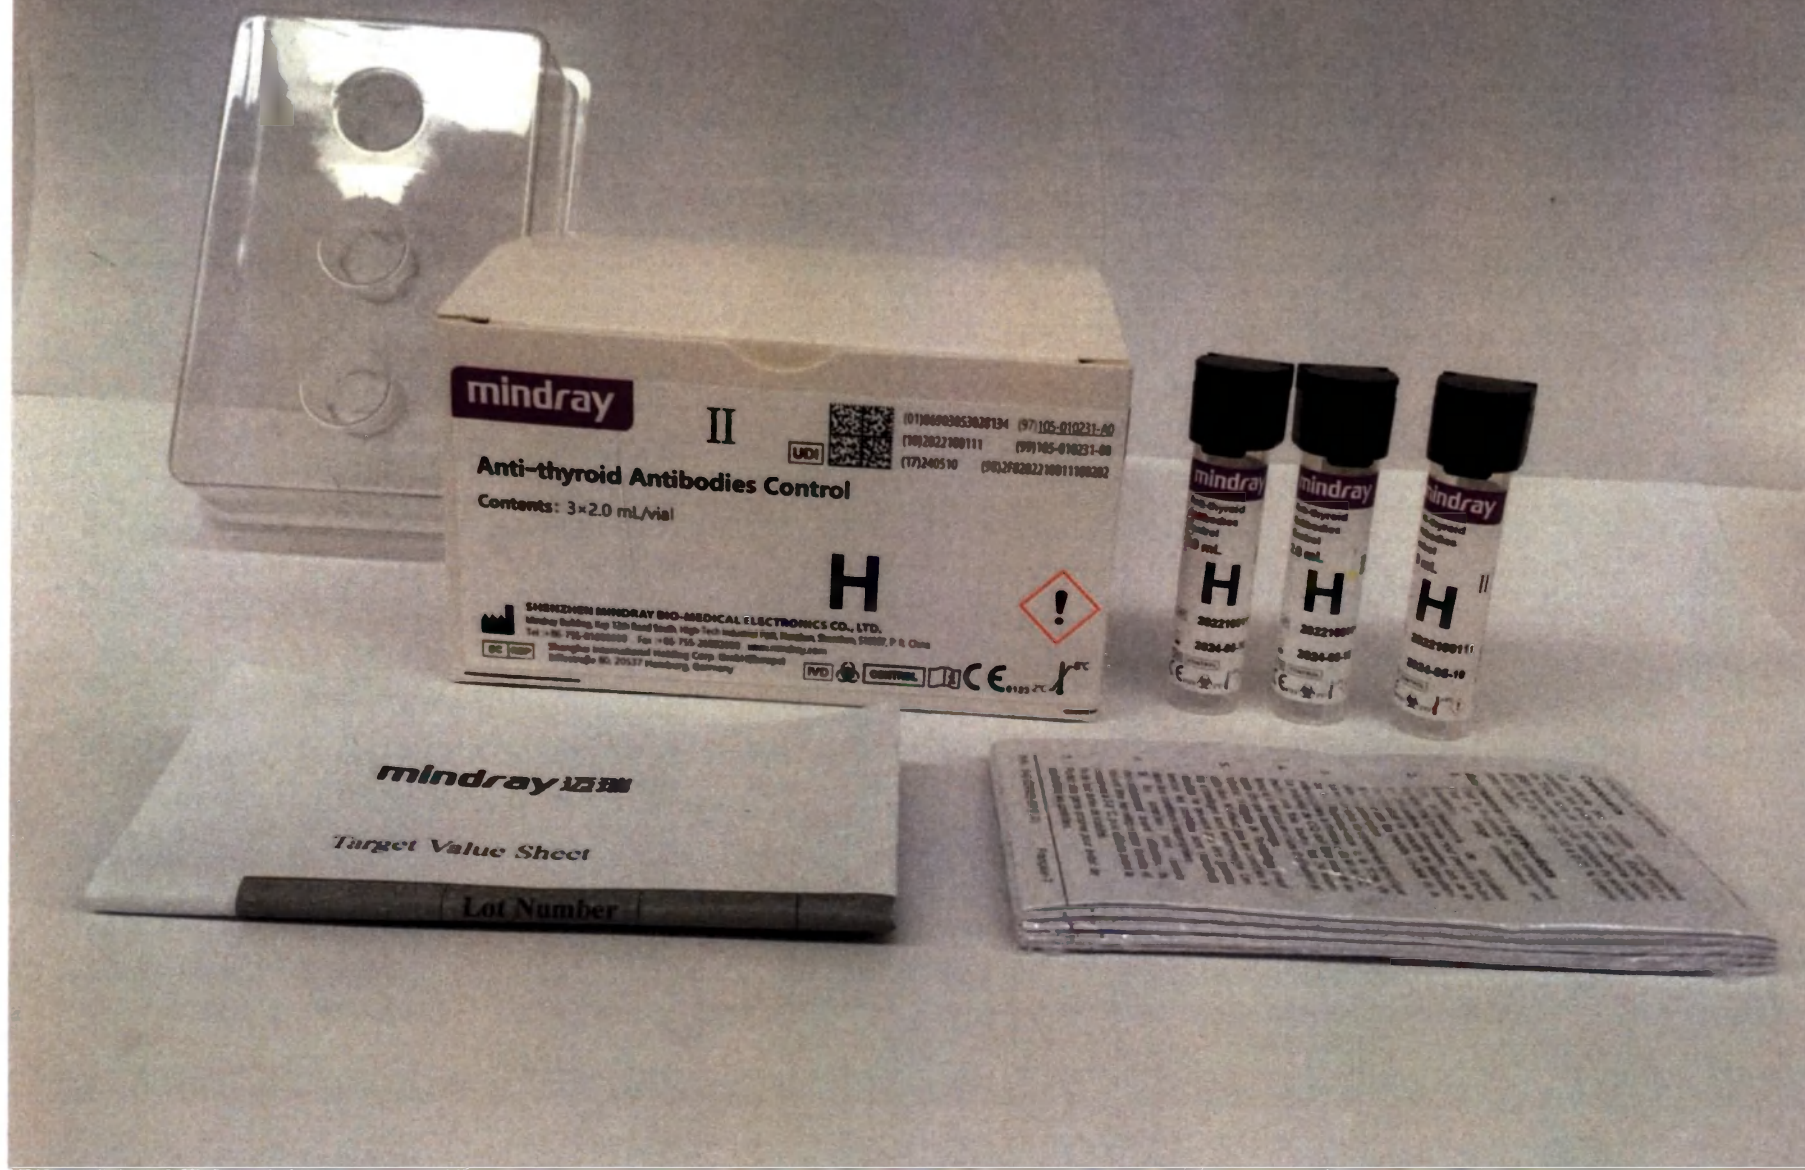


Рисунок 16. Общий вид. Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (H), 2 мл - 3 флакона



Рисунок 17. Материал контрольный (Anti-thyroid Antibodies Control II) (H), 2 мл – 3 флакона

mindray

II

UDI



(01)06903053028226 (97)105-010251-AC


(10)2022100111 (99)105-010251-00

(17)240510 (98)2GA202210011100029

Anti-thyroid Antibodies Control

Contents: 6×2.0 mL/vial

H



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057, P. R. China

Tel : +86-755-81888998 Fax : +86-755-26582680 www.mindray.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

IVD



CONTROL



CE

0123

2°C




Рисунок 18. Внешняя упаковка Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (H), 2 мл - 6 флаконов (вид 1)

mindray

II



Anti-thyroid Antibodies Control

Контроль для определения анти - тиреоидных антител

Controle de anticorpos antitireoide

Control de anticuerpos anti - tiroideos

Controllo per anticorpi anti-tiroide

Anti-tiroid Antikorları Kontrolü

Contrôle des anticorps anti - thyroïdiens




2GA202210011100029

REF 105-010251-00

LOT 2022100111




2024-05-10



047-042327-00(1.0)

Рисунок 19. Внешняя упаковка Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (H), 2 мл - 6 флаконов (вид 2)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, Hi-tech Industrial Park,
Nanshan, Shenzhen, 518057, P.R. China

Tel: +86-755-26582888 Fax: +86-755-26582680

Website: <http://www.mindray.com>

Рисунок 20. Внешняя упаковка Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (H), 2 мл - 6 флаконов (вид 3)

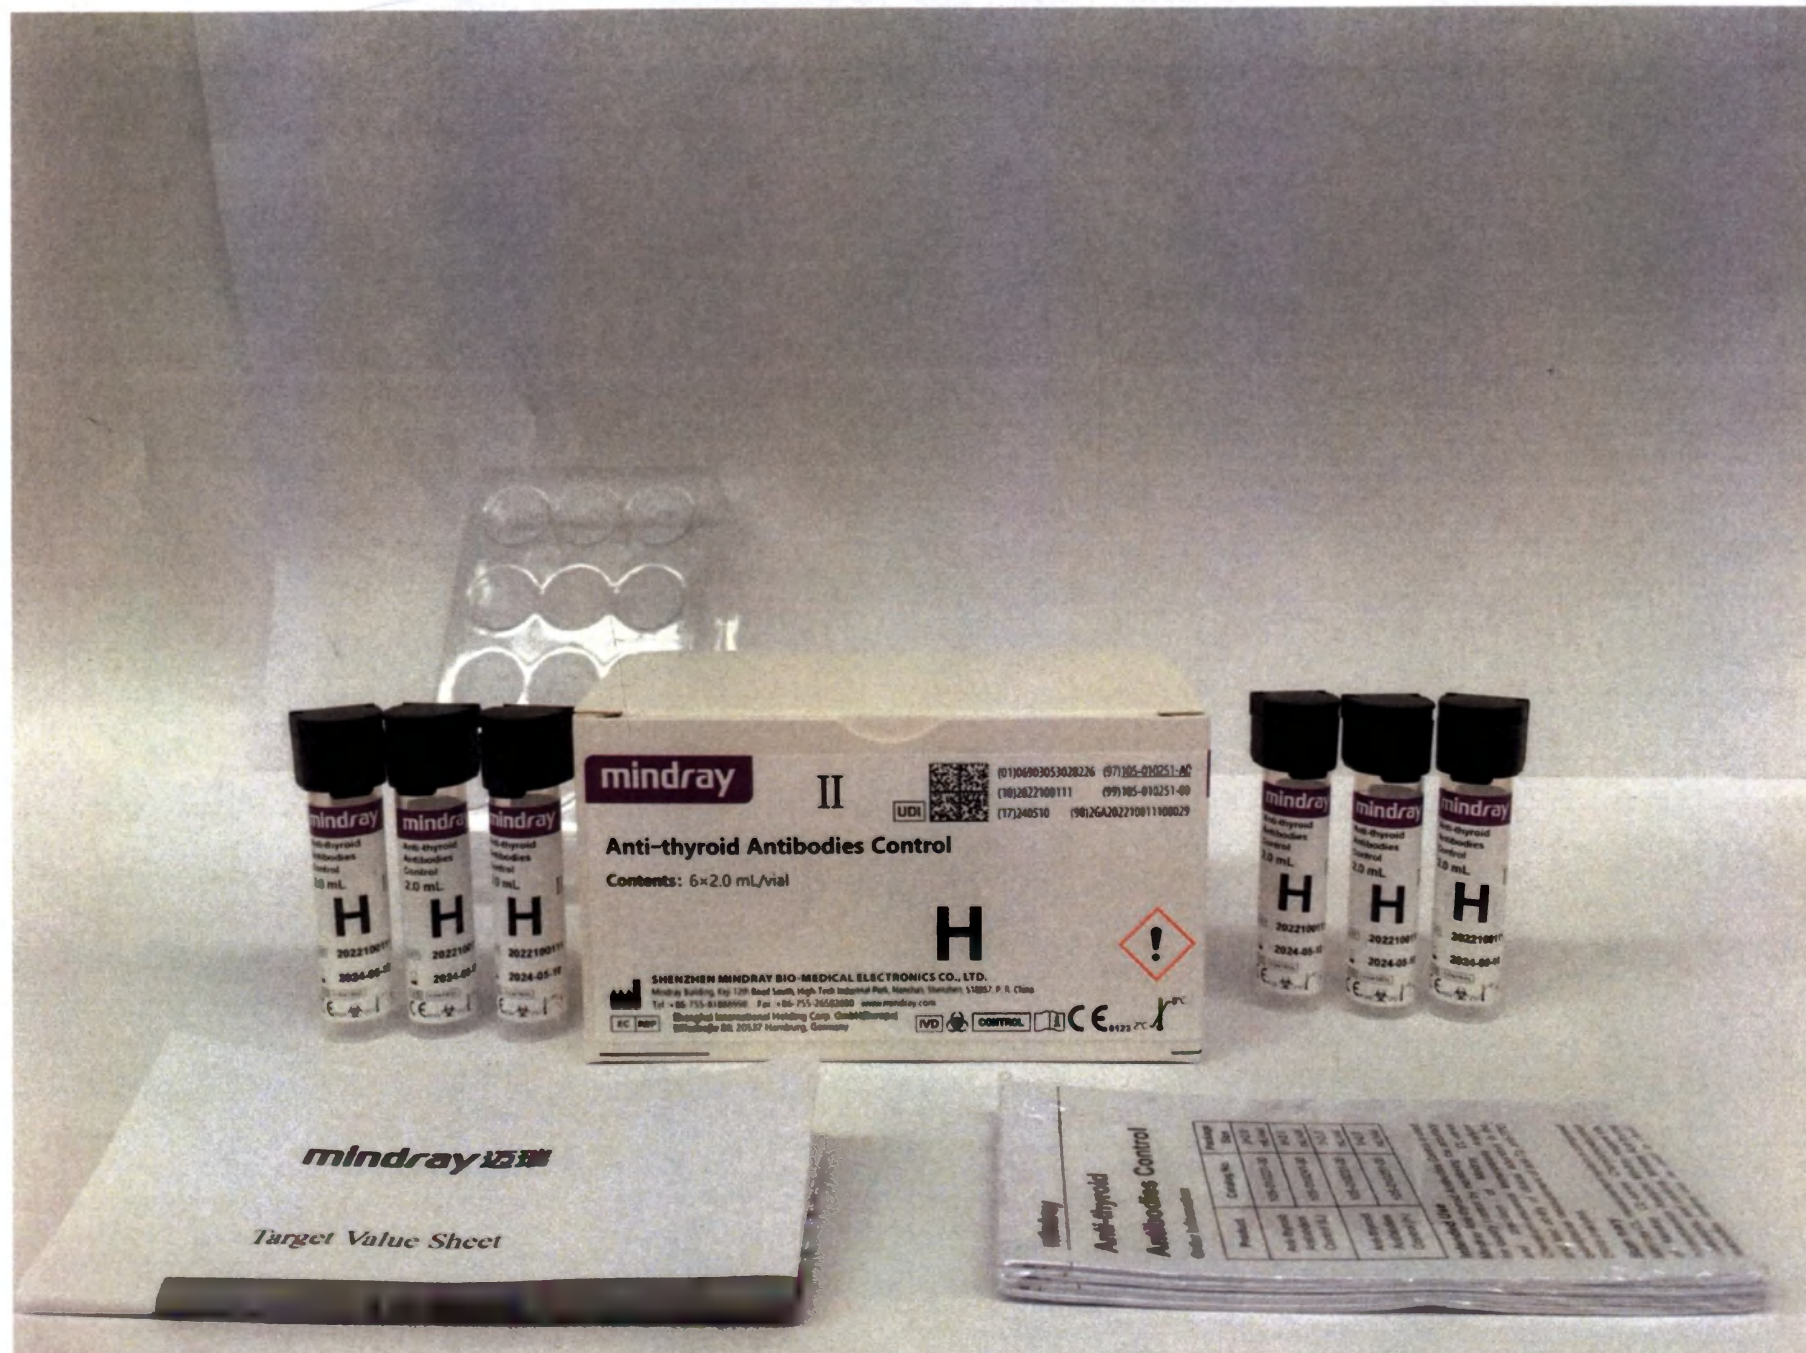


Рисунок 21. Общий вид Материал контрольный Anti-thyroid Antibodies Control II для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антител к тиреоглобулину (Anti-Tg), антител к тиреоидной пероксидазе (Anti-TPO) и антител к рецепторам тиреотропного гормона (TRAb) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (H), 2 мл - 6 флаконов



Рисунок 22. Материал контрольный (Anti-thyroid Antibodies Control II) (H), 2 мл – 6 флаконов

ПРОШТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
83 ЛИСТ

Сусоева

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
СЫСоеВА
РУКОВОДИТЕЛЬ
РЕГИСТРАЦИИ

