

ПОДТВЕРЖДАЮ



**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики
in vitro**

Материал контрольный (AMH Control) для диагностики in vitro для оценки качества количественного определения антимюллера гормона (AMH) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL

*Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»
129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский,
пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39
ИНН 7705815069 КПП 770201001*

mindray



PLW202208011100065

AMH Control (L)

Contents : 3×2.0 mL

Контроль для определения АМГ (L)

Controle AMH (C)

Control AMH (L)

Controllo per AMH (L)

AMH Kontrolü (L)

Contrôle de l'AMH (L)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057 P.R.China

Tel : +86-755-81888998 Fax : +86-755-26582680 www.mindray.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

L



IVD



CONTROL



CE 0123 2°C

UDI



(01)06936415925475 (97)105-018808-A0

(10)2022080111 (99)105-018808-00

(17)240314 (98)PLW202208011100065

REF

105-018808-00

LOT

2022080111



2024-03-14

047-039629-00(1.0)

Рисунок 1 Внешняя упаковка. Материал контрольный (AMH Control) для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения
ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (L), 2 мл - 3 флакона
(вид 1)

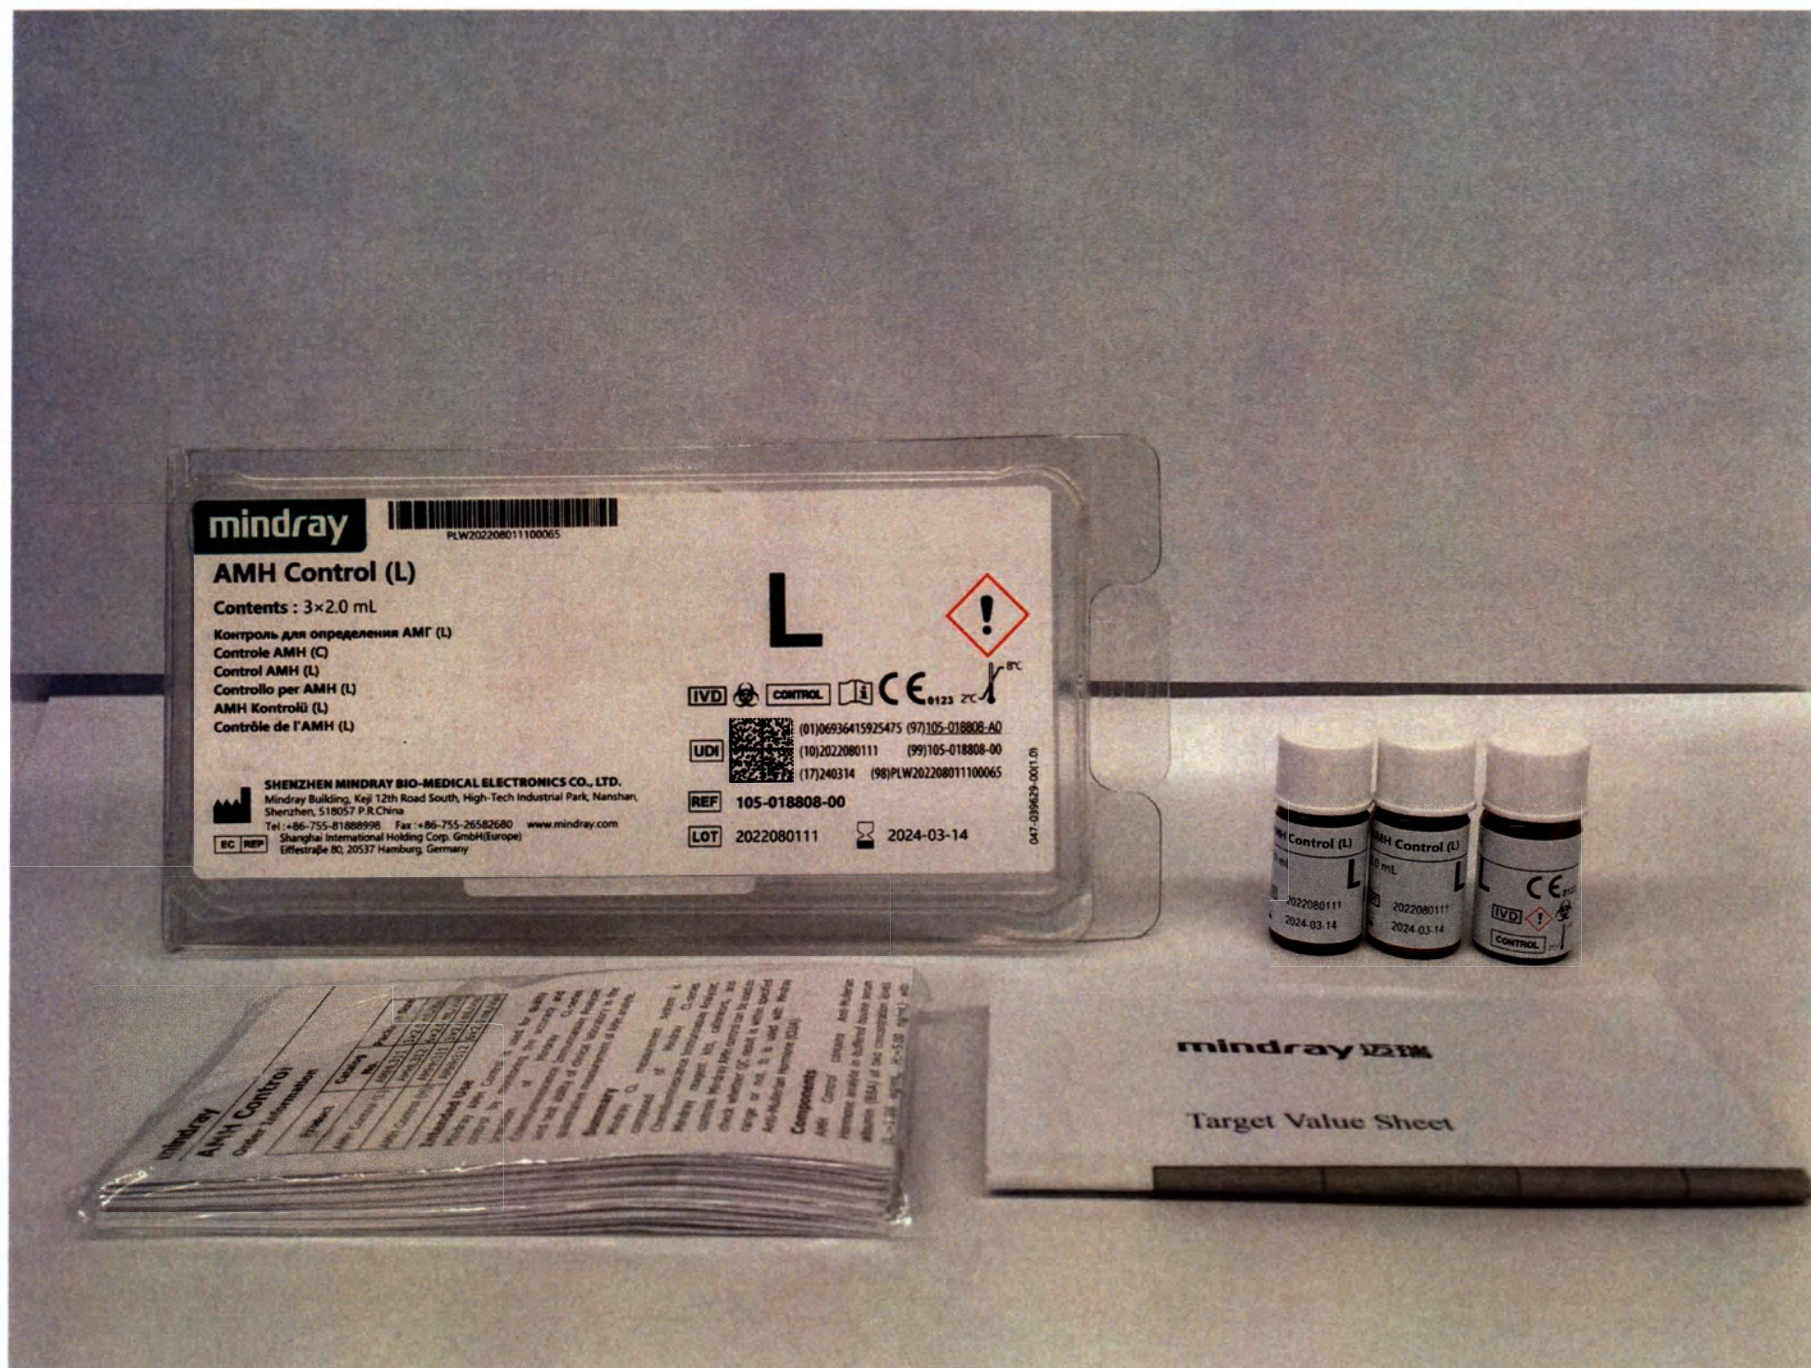


Рисунок 2. Общий вид Материал контрольный (AMH Control) для диагностики in vitro для оценки качества количественного определения антимюллерова



Рисунок 3. Материал контрольный (AMH Control) (L), 2 мл – 3 флакона.

mindray



PLU202211012100066

AMH Control (L)

Contents : 6×2.0 mL

Контроль для определения АМГ (L)

Controle AMH (C)

Control AMH (L)

Controllo per AMH (L)

AMH Kontrollü (L)

Contrôle de l'AMH (L)

L



IVD



CONTROL



CE

0123

2°C



UDI



(01)06936415925482 (97)105-018809-A0

(10)2022110121 (99)105-018809-00

(17)240625 (98)PLU202211012100066

REF

105-018809-00

LOT

2022110121



2024-06-25

047-039629-00(1.0)



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057 P.R.China

Tel : +86-755-81888998 Fax : +86-755-26582680 www.mindray.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

Рисунок 4. Внешняя упаковка Материал контрольный (AMH Control) для диагностики in vitro для оценки качества количественного определения

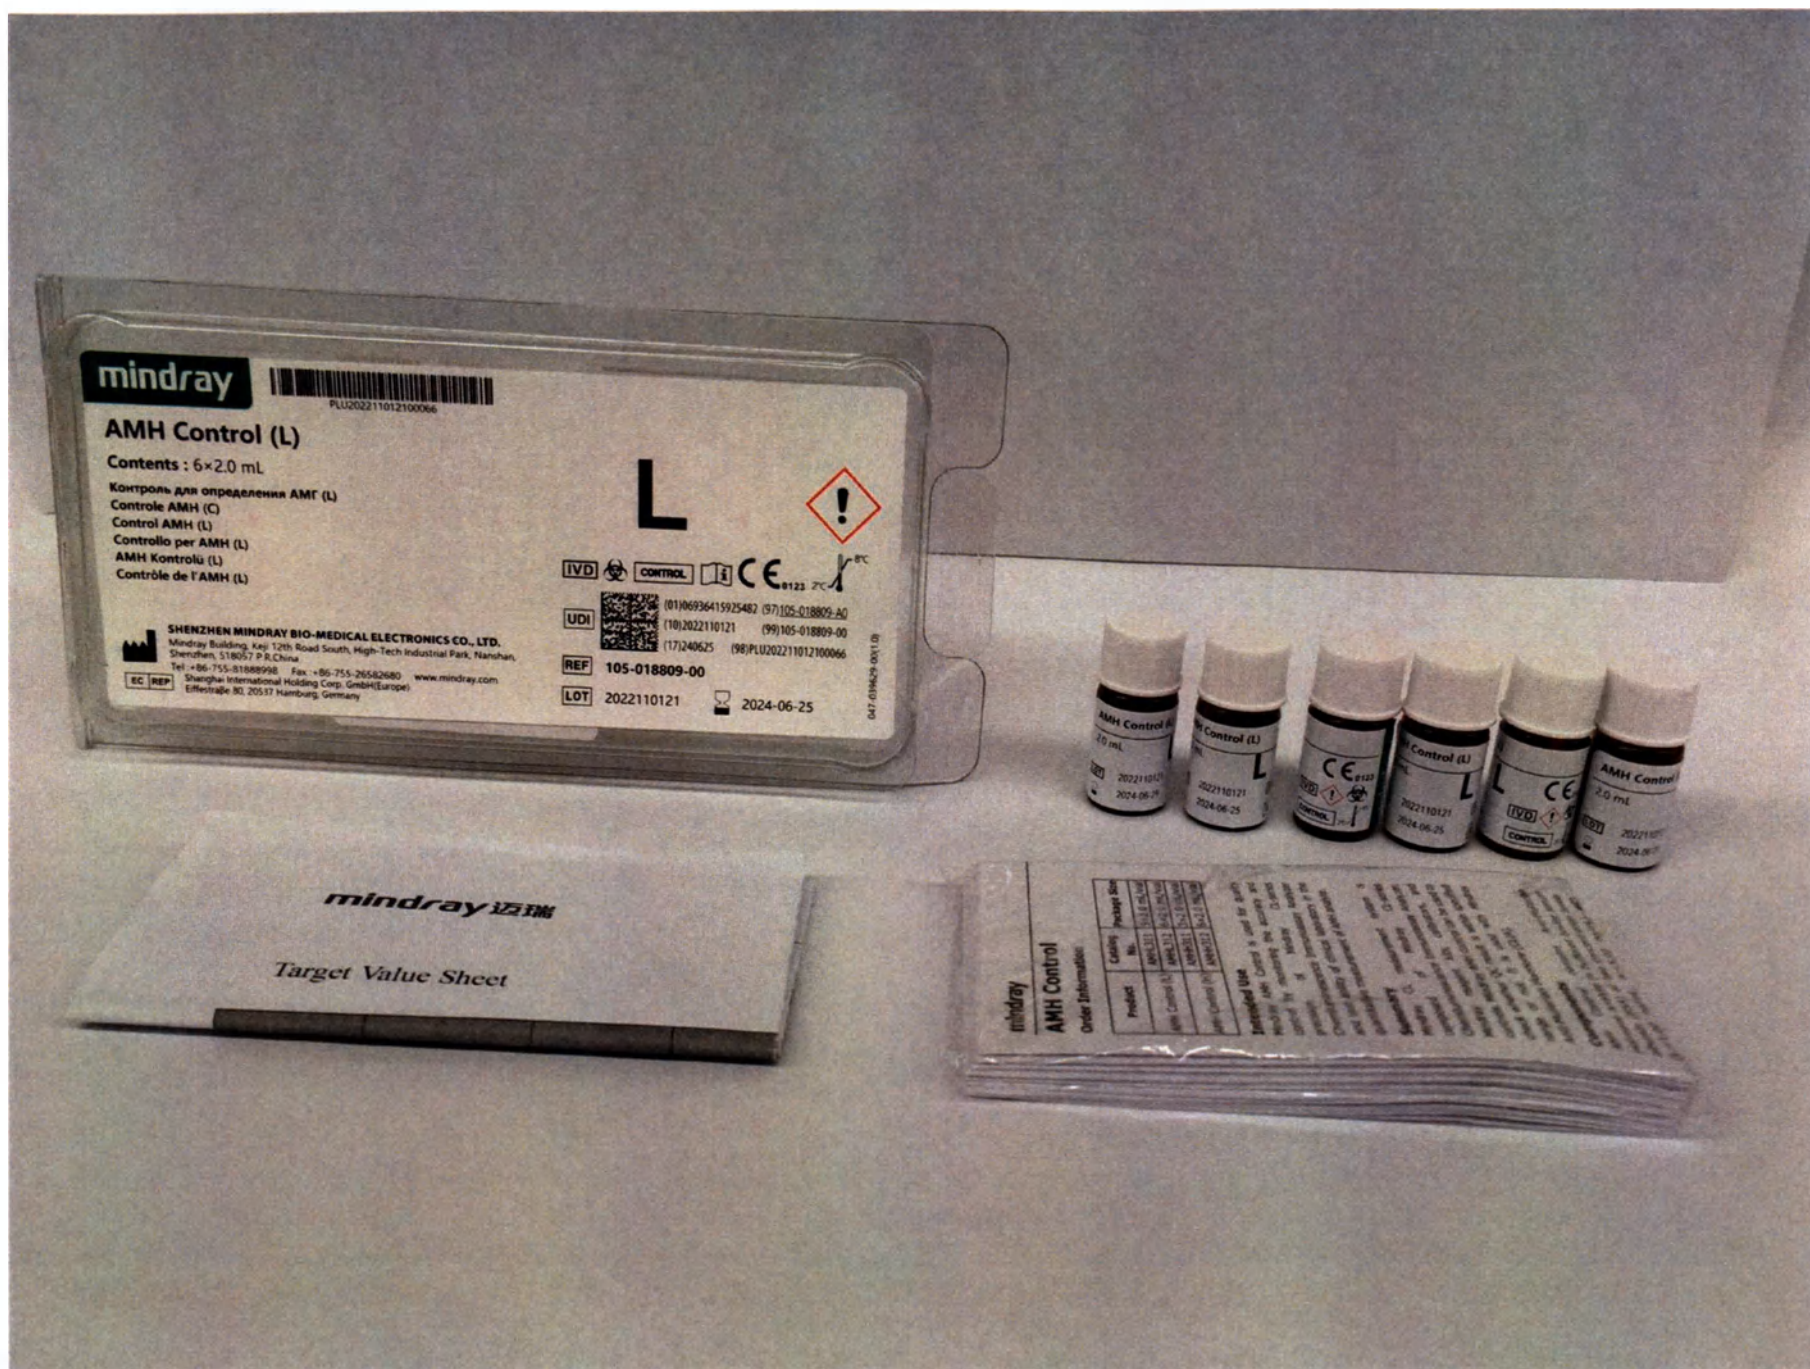


Рисунок 5. Общий вид Материал контрольный (AMH Control) для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антимюллера

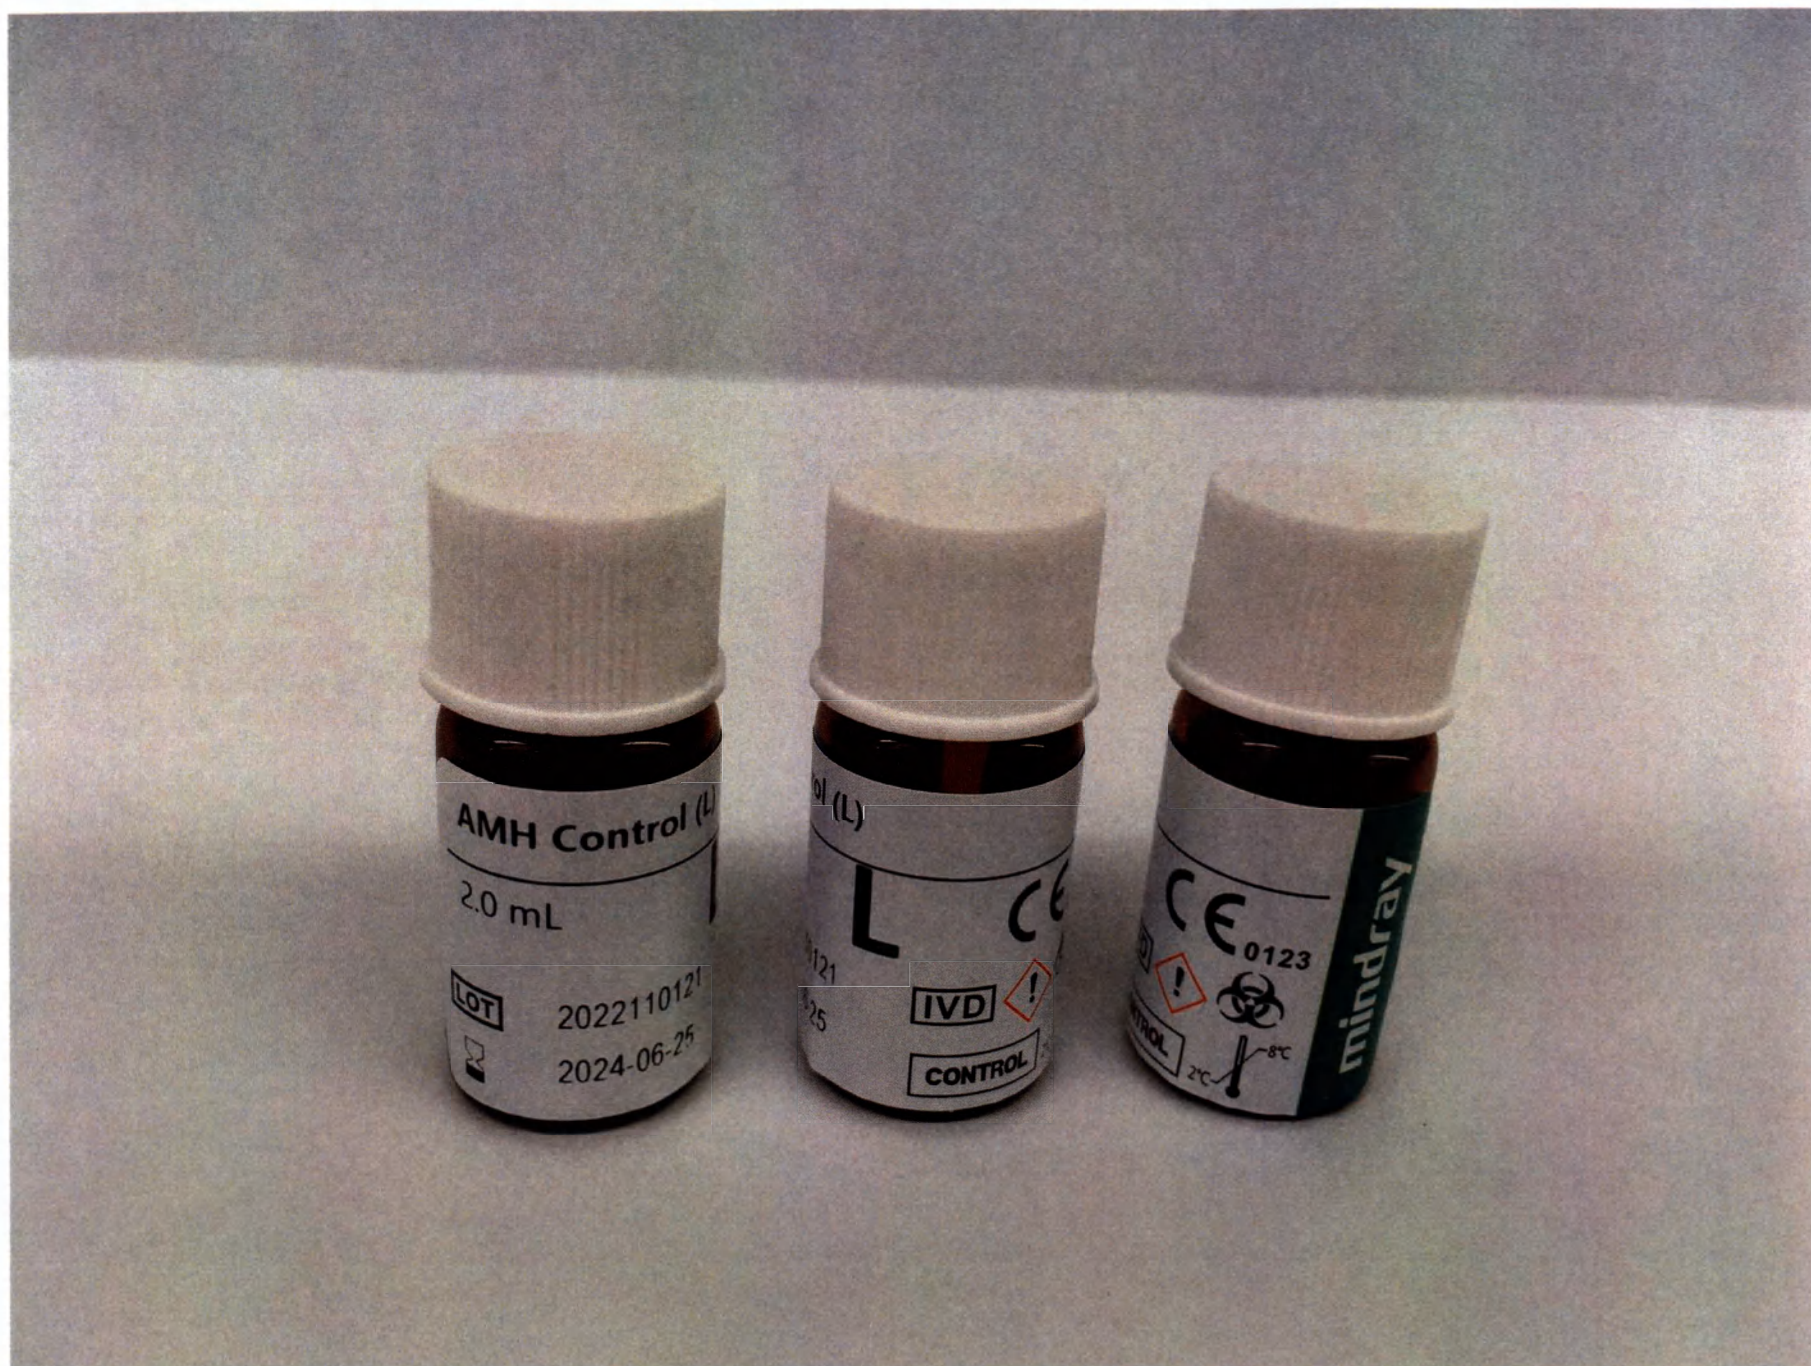


Рисунок 6. Материал контрольный (AMH Control) (L), 2 мл – 6 флаконов

mindray



PLS202211011100067

AMH Control (H)

Contents : 3×2.0 mL

Контроль для определения АМГ (H)

Controle AMH (A)

Control AMH (H)

Controllo per AMH (H)

AMH Kontrolü (H)

Contrôle de l'AMH (H)

H



8°C

IVD



CONTROL



CE

0123 2°C

UDI



(01)06936415925499 (97)105-018810-A0

(10)2022110111 (99)105-018810-00

(17)240625 (98)PLS202211011100067

REF

105-018810-00

LOT

2022110111



2024-06-25



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan,
Shenzhen, 518057 P.R.China

Tel : +86-755-81888998 Fax : +86-755-26582680 www.mindray.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

047-039630-00(1.0)

Рисунок 7. Внешняя упаковка Материал контрольный (AMH Control) для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения лютеинизирующего гормона (АМГ) в клиническом образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (H), 2 мл - 3 флакона

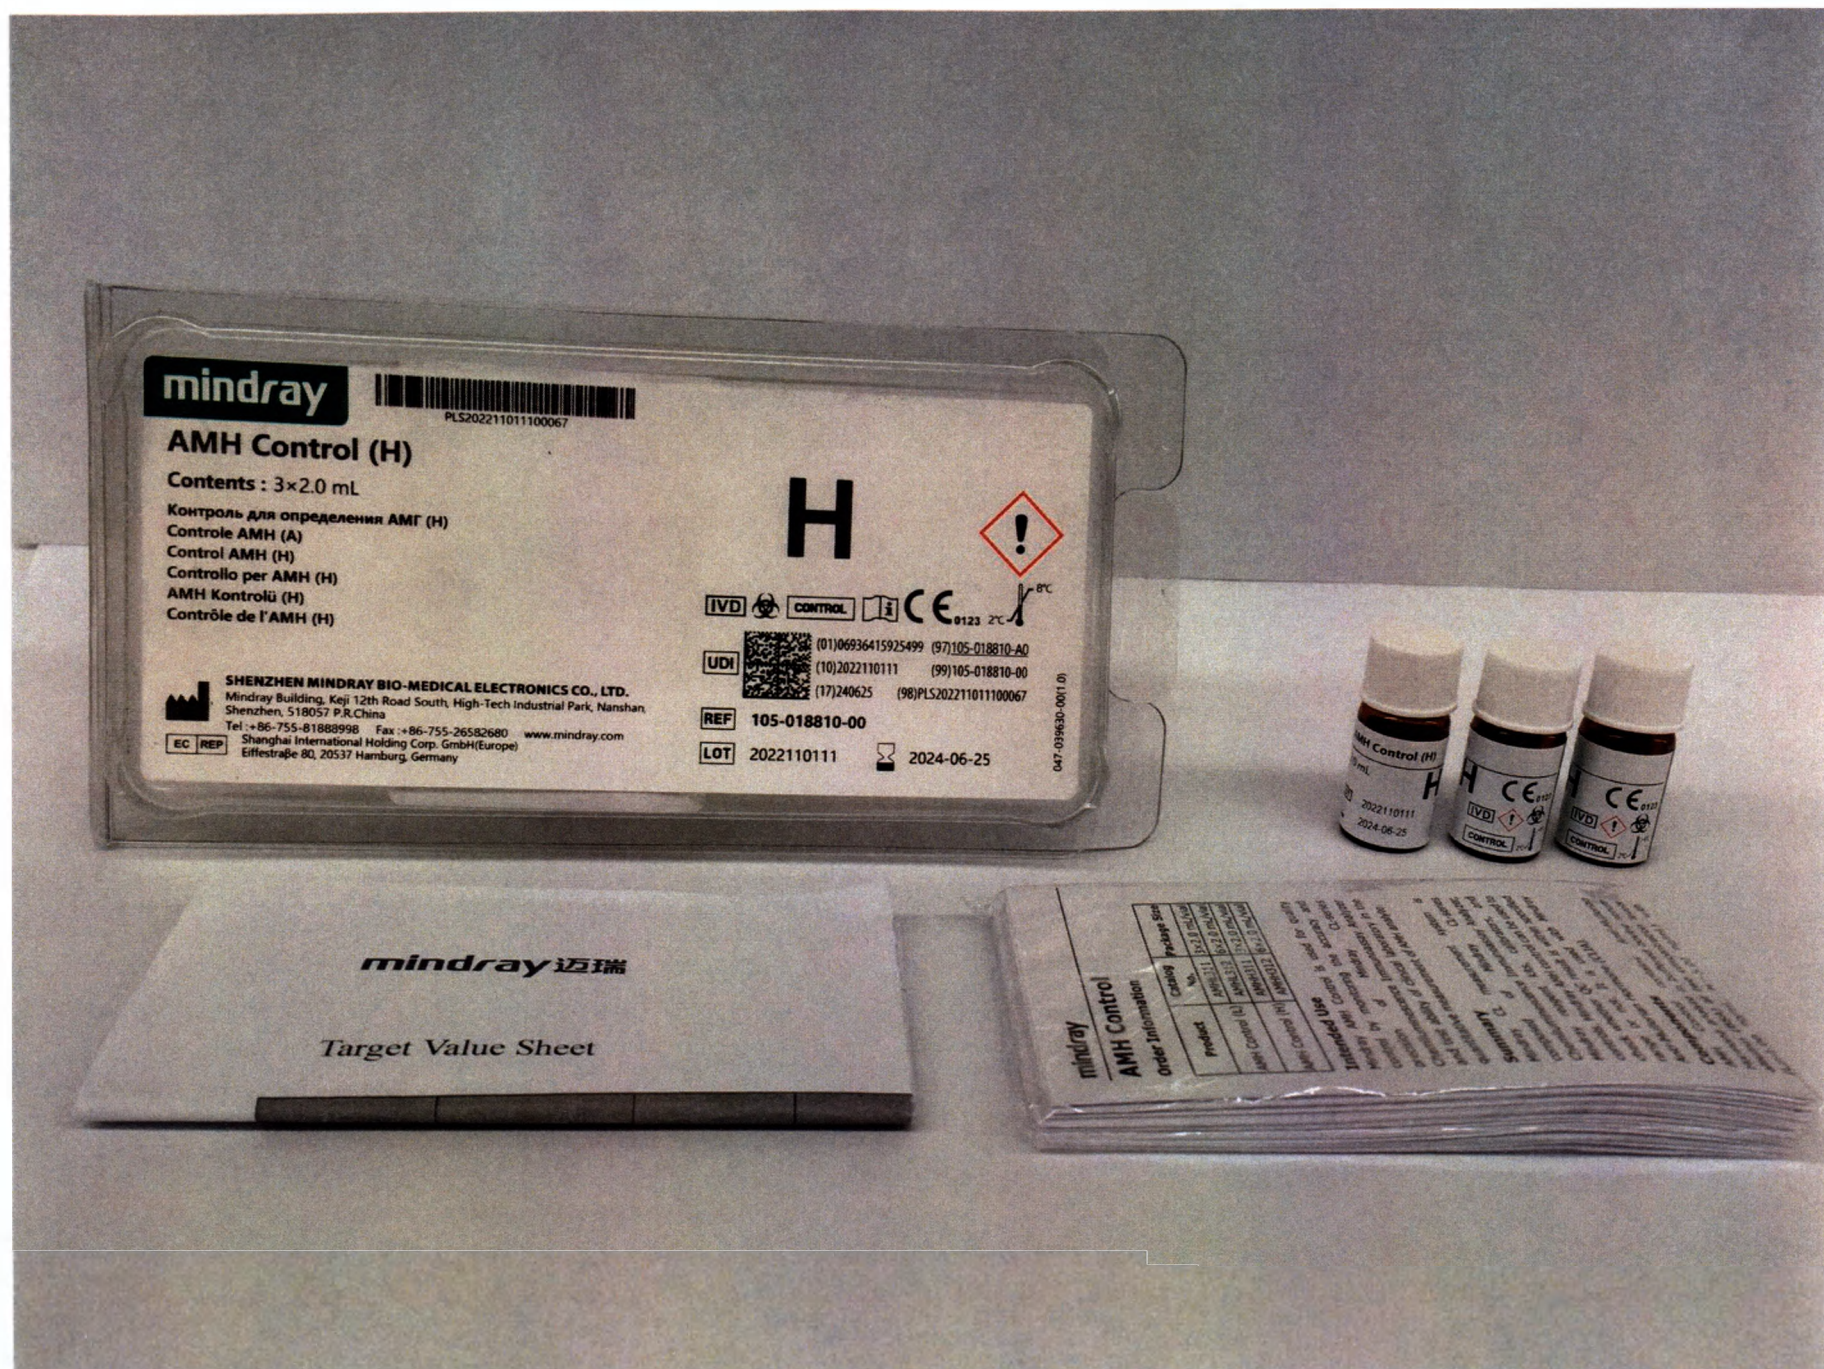


Рисунок 8. Общий вид Материал контрольный (AMH Control) для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения антимюллера (AMH) в плазменном образце человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL (H), 2 мл - 3 флакона



mindray



PLQ202211011100068

AMH Control (H)

Contents : 6×2.0 mL

Контроль для определения АМГ (H)

Controle AMH (A)

Control AMH (H)

Controllo per AMH (H)

AMH Kontrolü (H)

Contrôle de l'AMH (H)

H



8°C

IVD



CONTROL



CE

0123

2°C

8°C

UDI



(01)06936415925505 (97)105-018811-A0

(10)2022110111

(99)105-018811-00

(17)240625

(98)PLQ202211011100068

REF

105-018811-00

LOT

2022110111



2024-06-25



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R.China

Tel : +86-755-81888998 Fax : +86-755-26582680 www.mindray.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)

Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

EC REP

047-039630-00(1.0)

Рисунок 10. Внешняя упаковка Материал контрольный (AMH Control) для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения

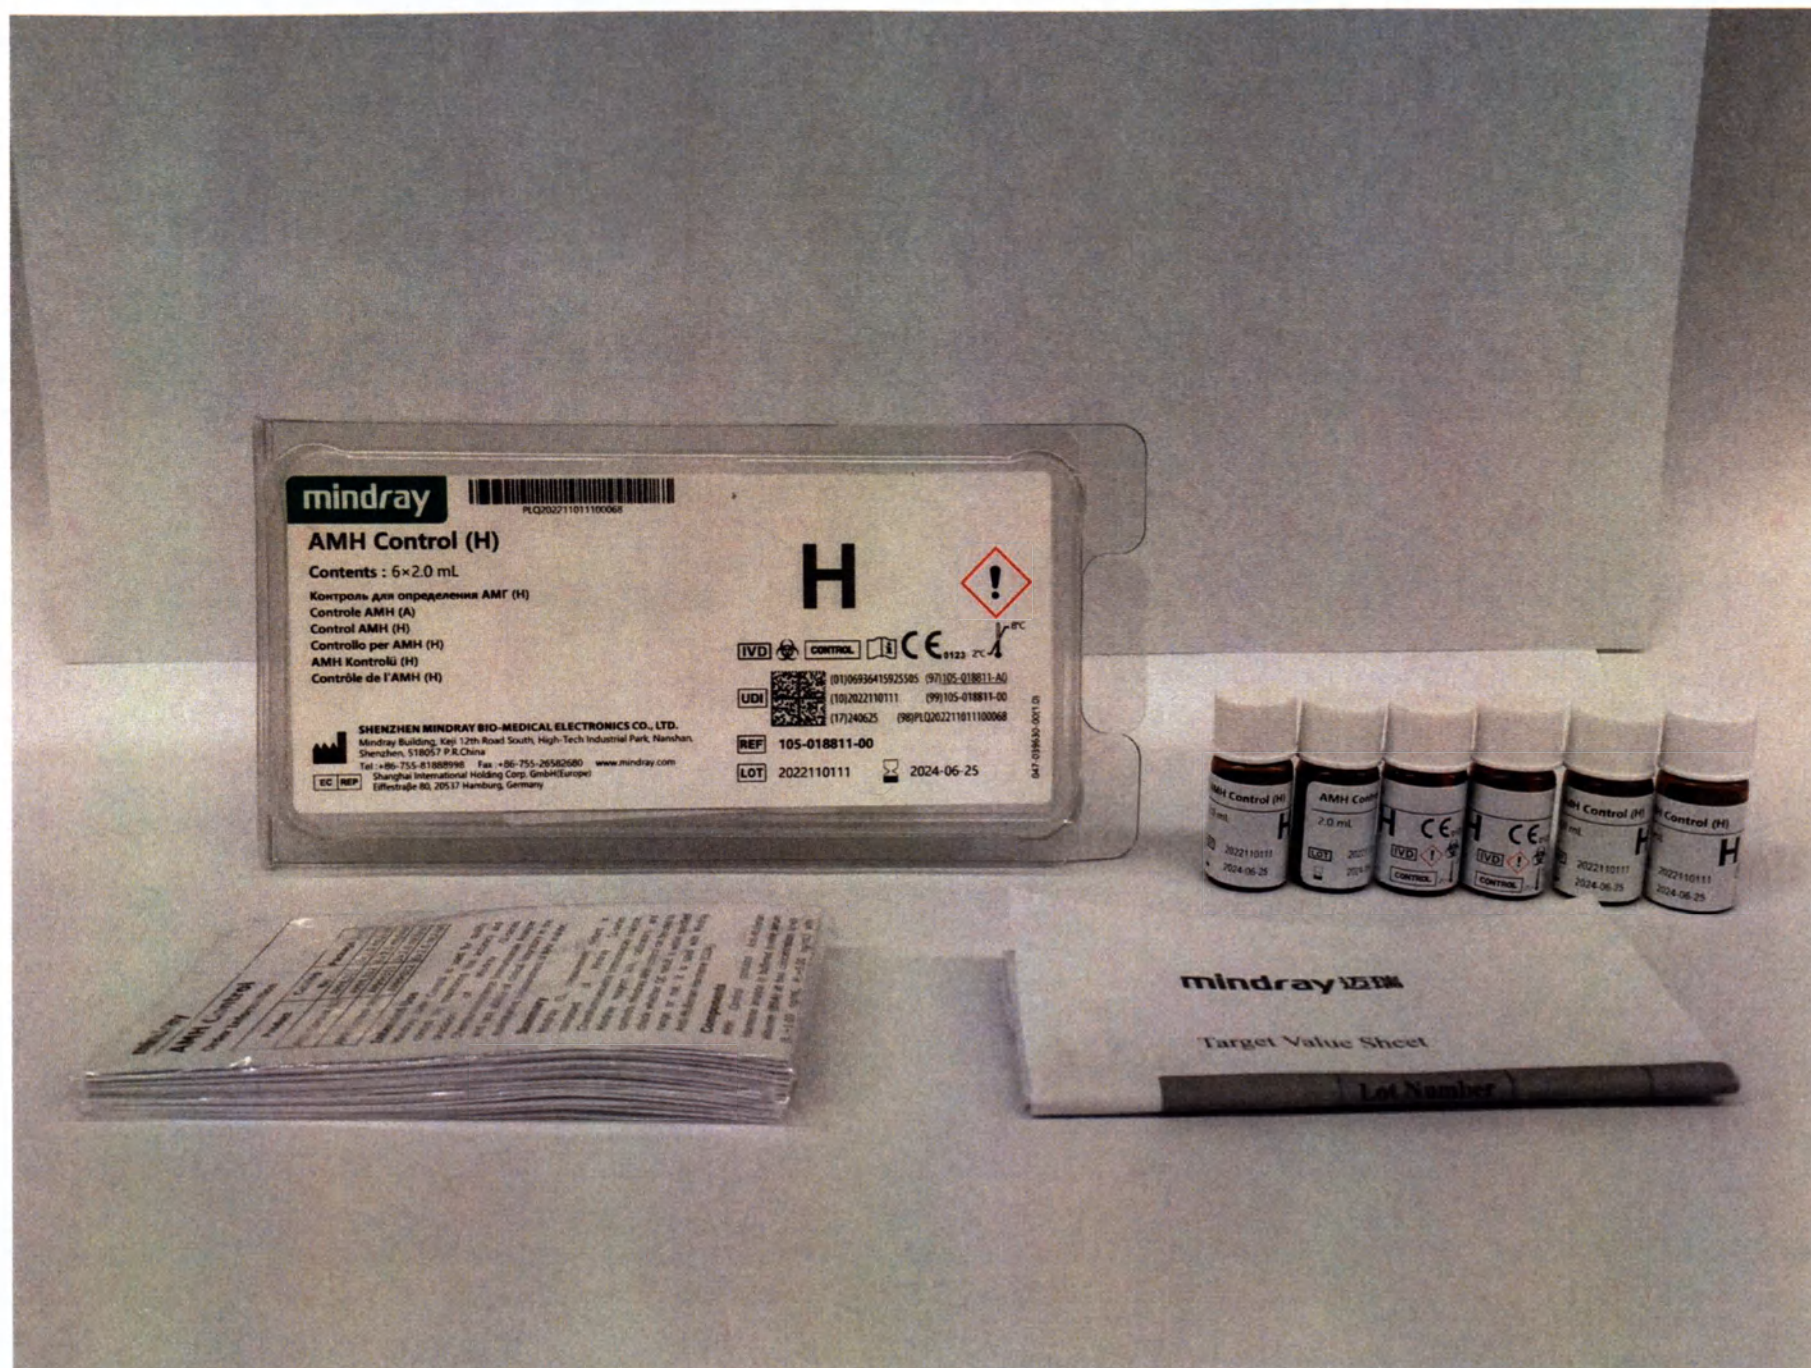


Рисунок 11. Общий вид Материал контрольный (AMH Control) для диагностики *in vitro* для оценки качества количественного определения



Рисунок 12. Материал контрольный (AMH Control) (H), 2 мл – 6 флаконов.

ПРОШИТО И
СКРЕПЛЕНО
ПЕЧАТЬЮ
13 ЛИСТ

Сысоев
ПО ДОВЕРЕННОСТИ
СЫСОВА
РУКОВОДИТЕЛЬ
РЕГИСТРАЦИИ

