

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Ортосмайл»

Борзов М.С.



ФОТОГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

«Сканер интраоральный «Пумпа» для создания цифровых снимков зубов»,

*производства Ziyang Freqty Medical Equipment Co., Ltd. (Цзыян Фректи
Медикал Эквипмент Ко., Лтд.), Китай*

**1. «Сканер интраоральный «Пумпа» для создания цифровых снимков зубов»
Фото 1 - Общий вид**



Фото 2 - Сканер интраоральный

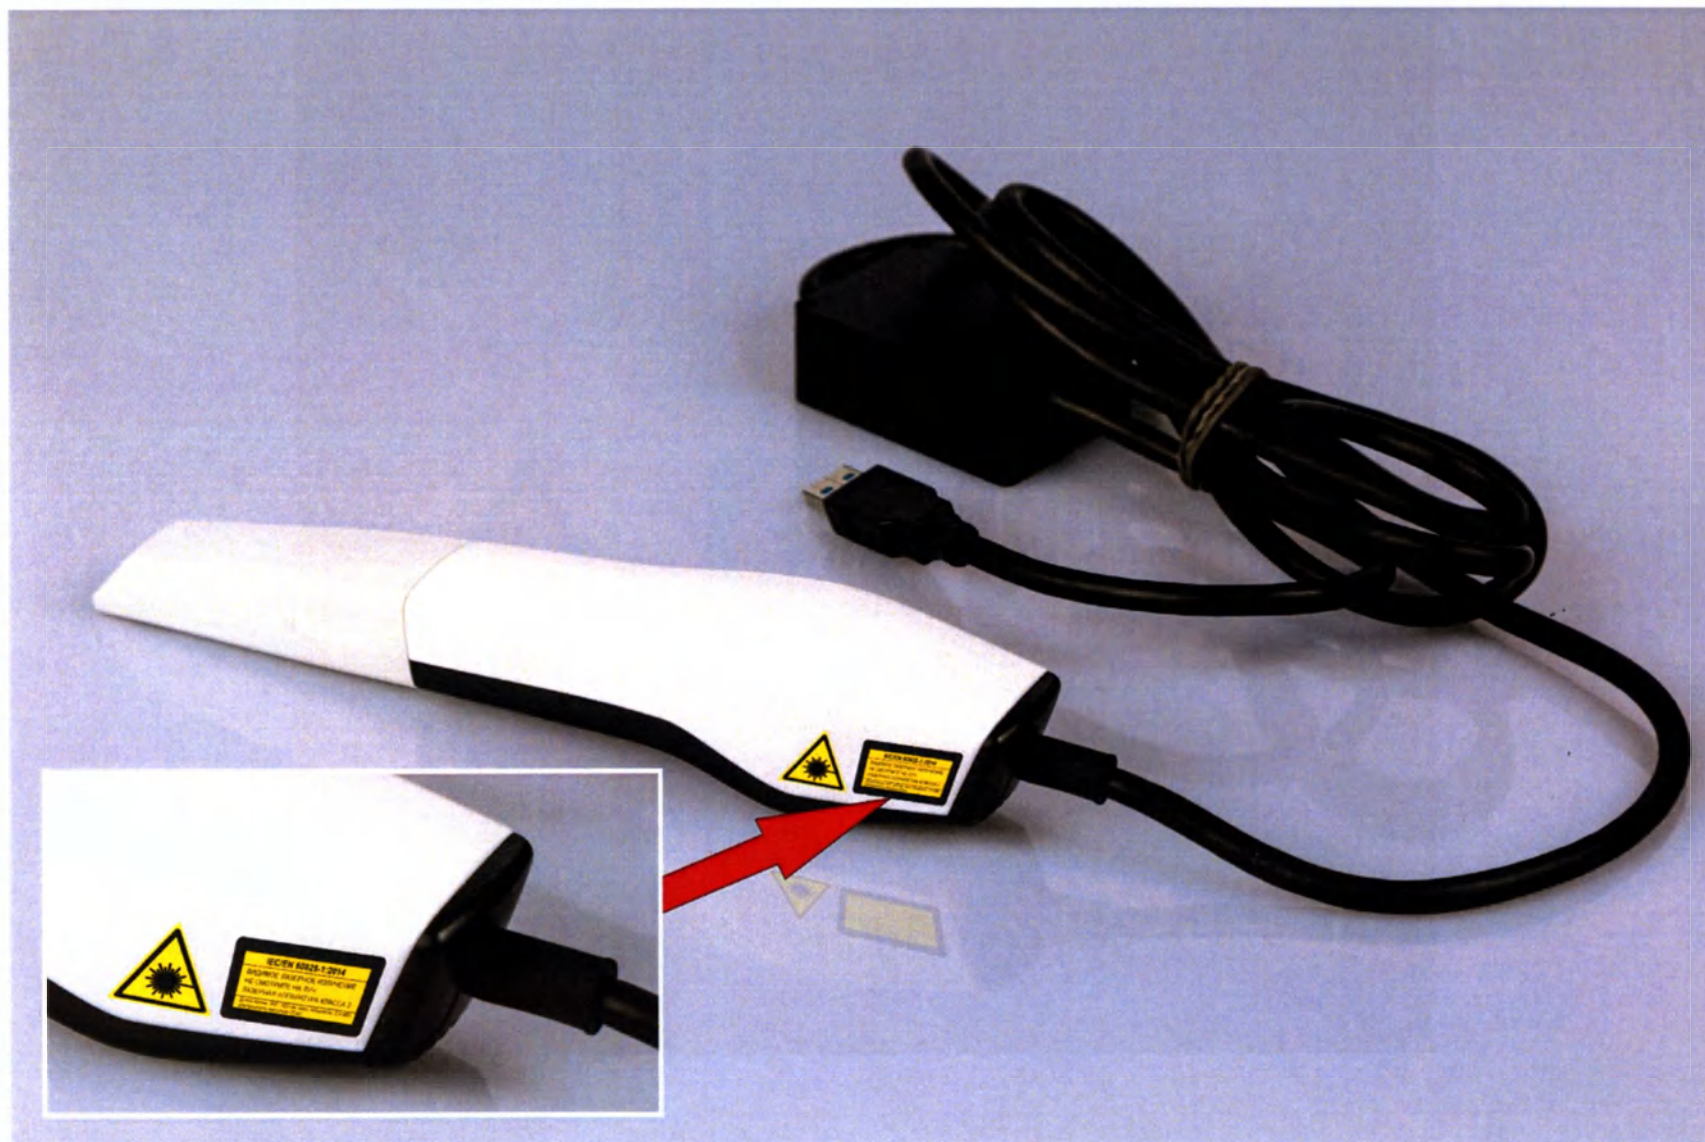


Фото 3 – Маркировка о лазерном излучении на сканере интраоральном (крупный план)



Фото 4 – Маркировка с серийным номером сканера на сканере интраоральном



Фото 5 - Насадка сканирующая
(с информацией о номере партии насадок)



Фото 6 - Насадка защитная

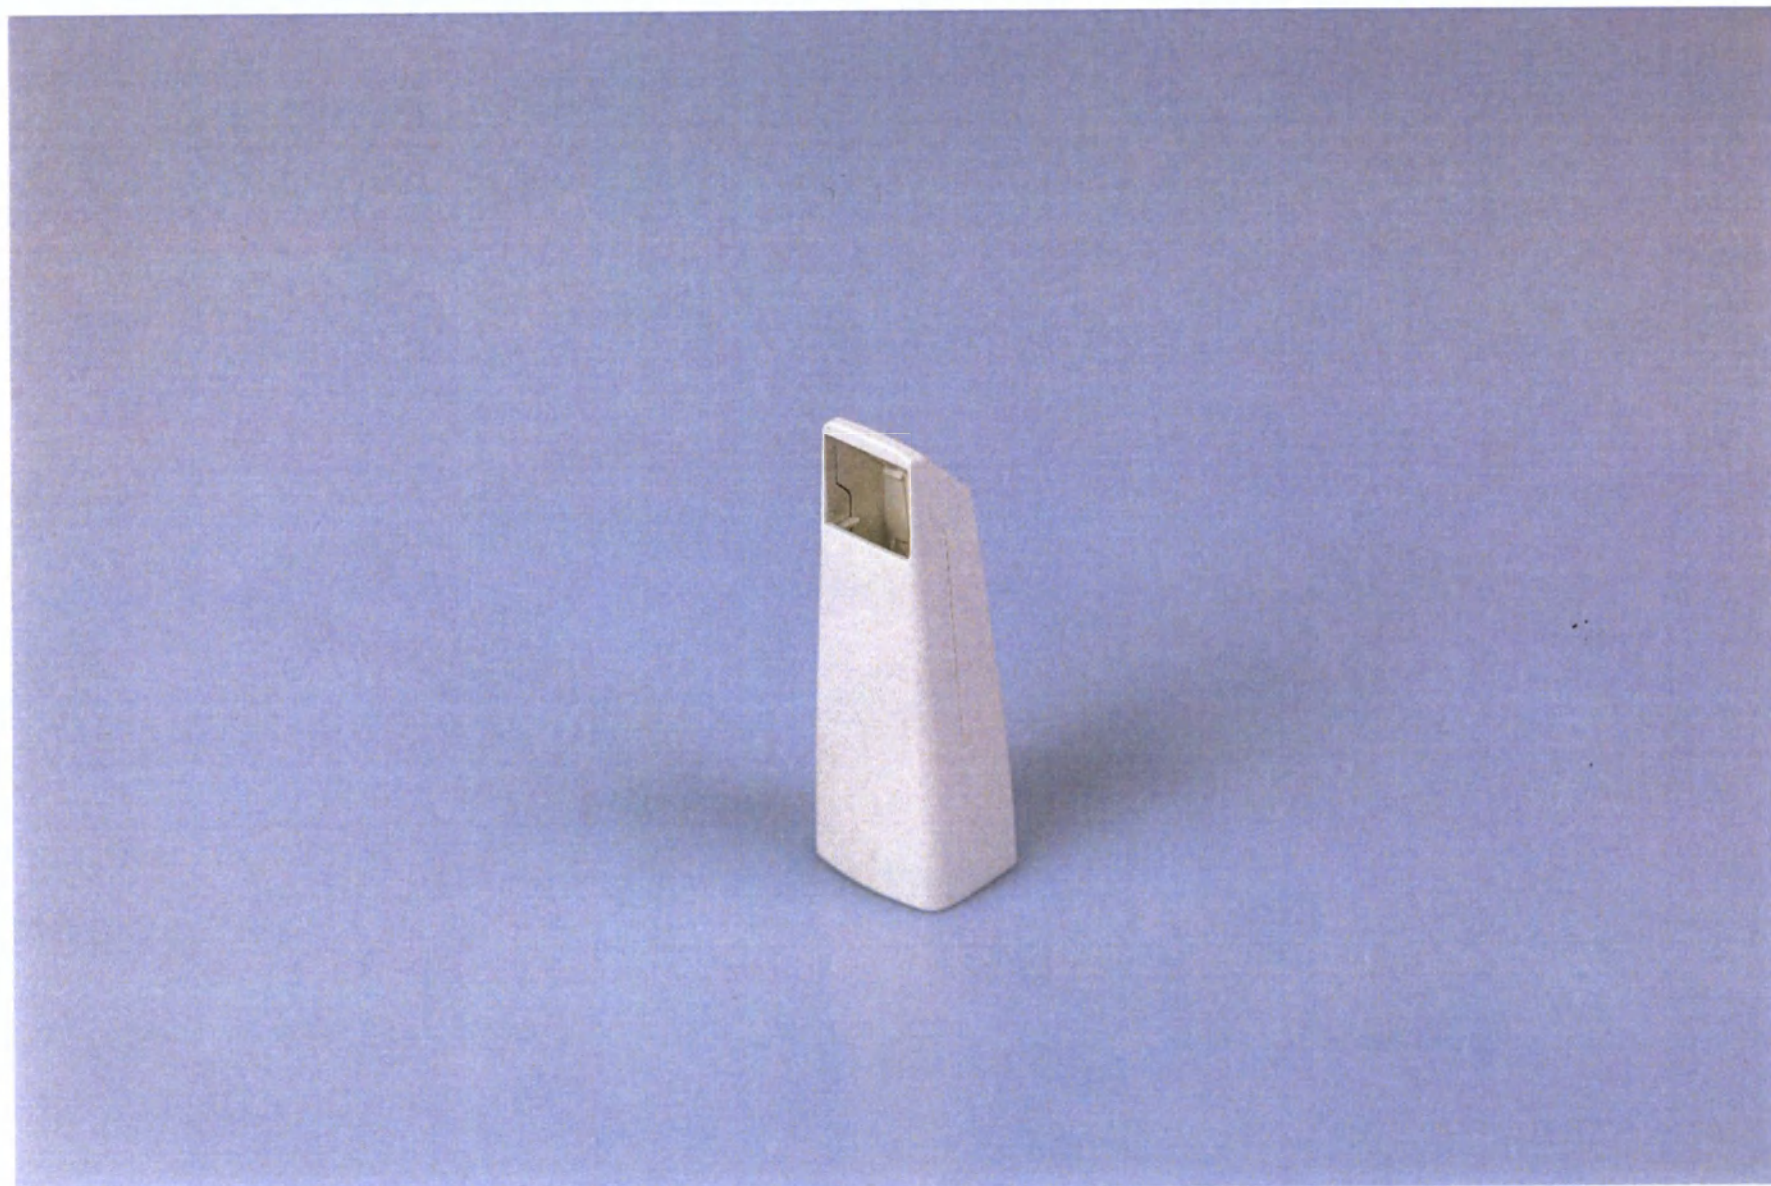


Фото 7 - Адаптер питания
(с информацией о серийном номере сканера)

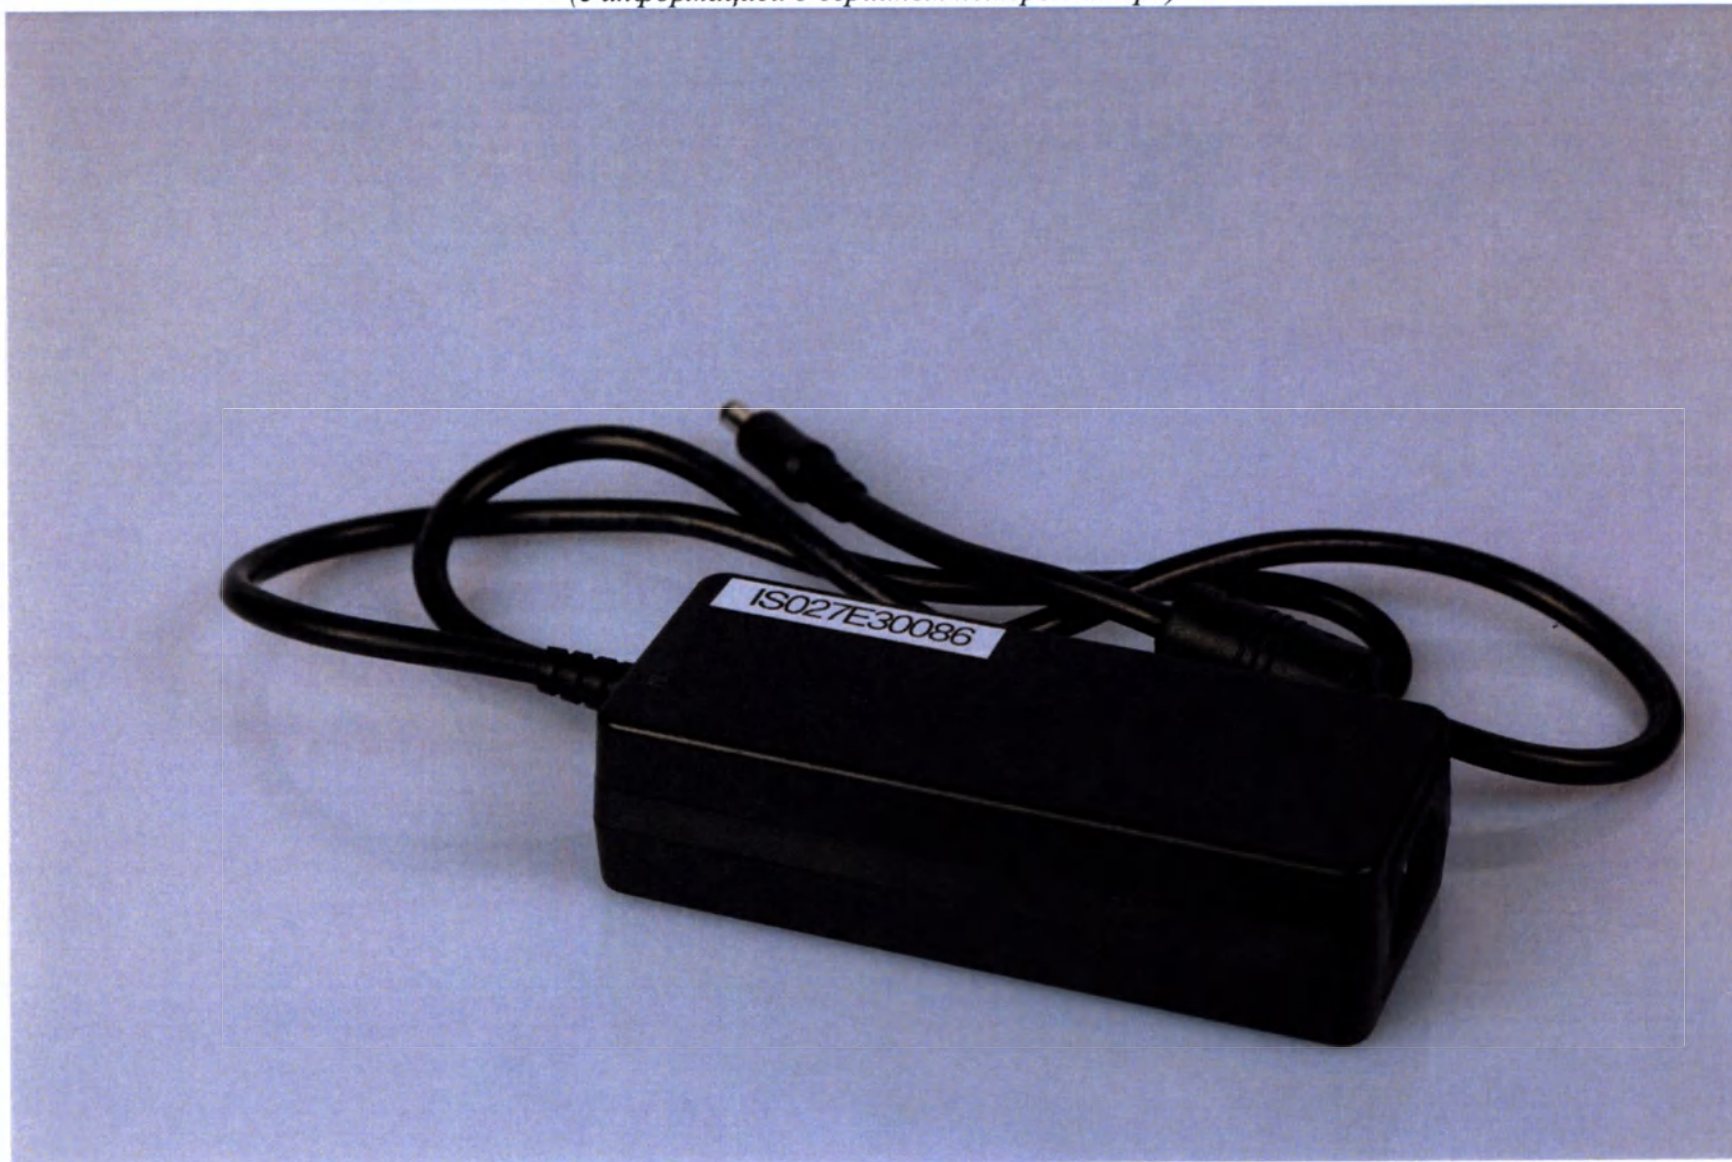


Фото 8 - Кабель питания



Фото 9 - Устройство калибровки

информация о серийном номере сканера и устройства калибровки



Фото 10 - USB-ключ

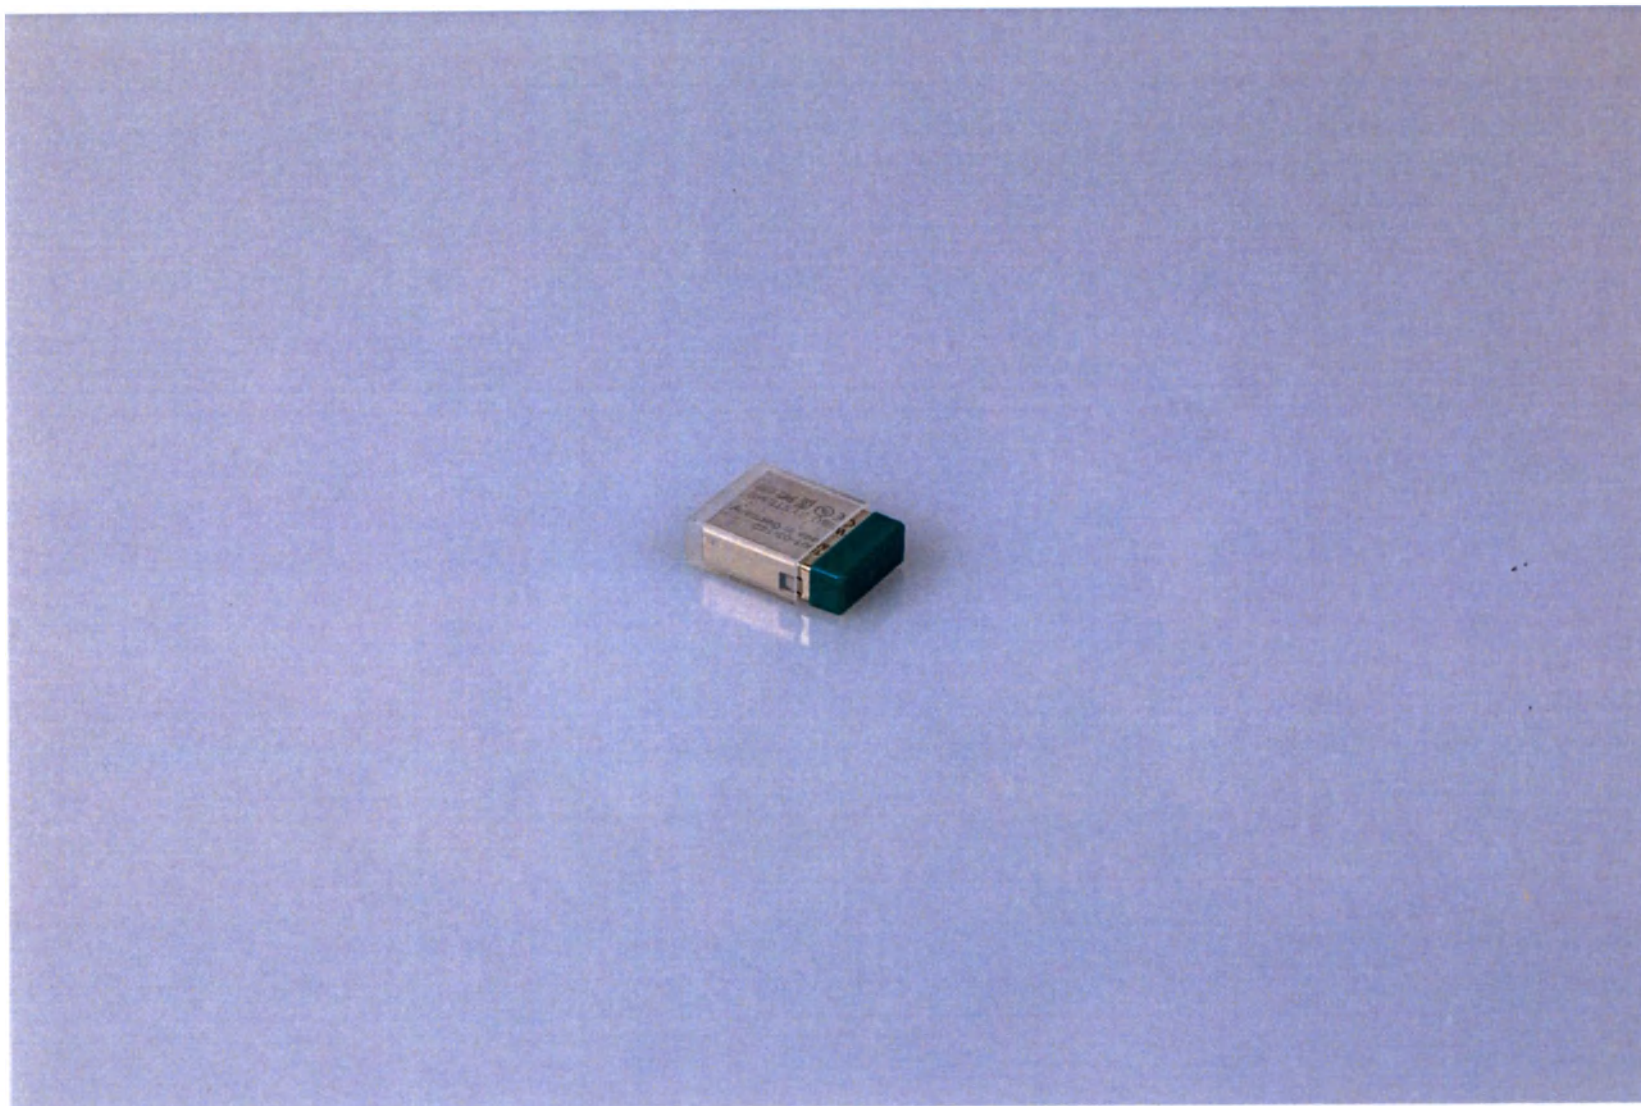


Фото 11 - Подставка для сканера


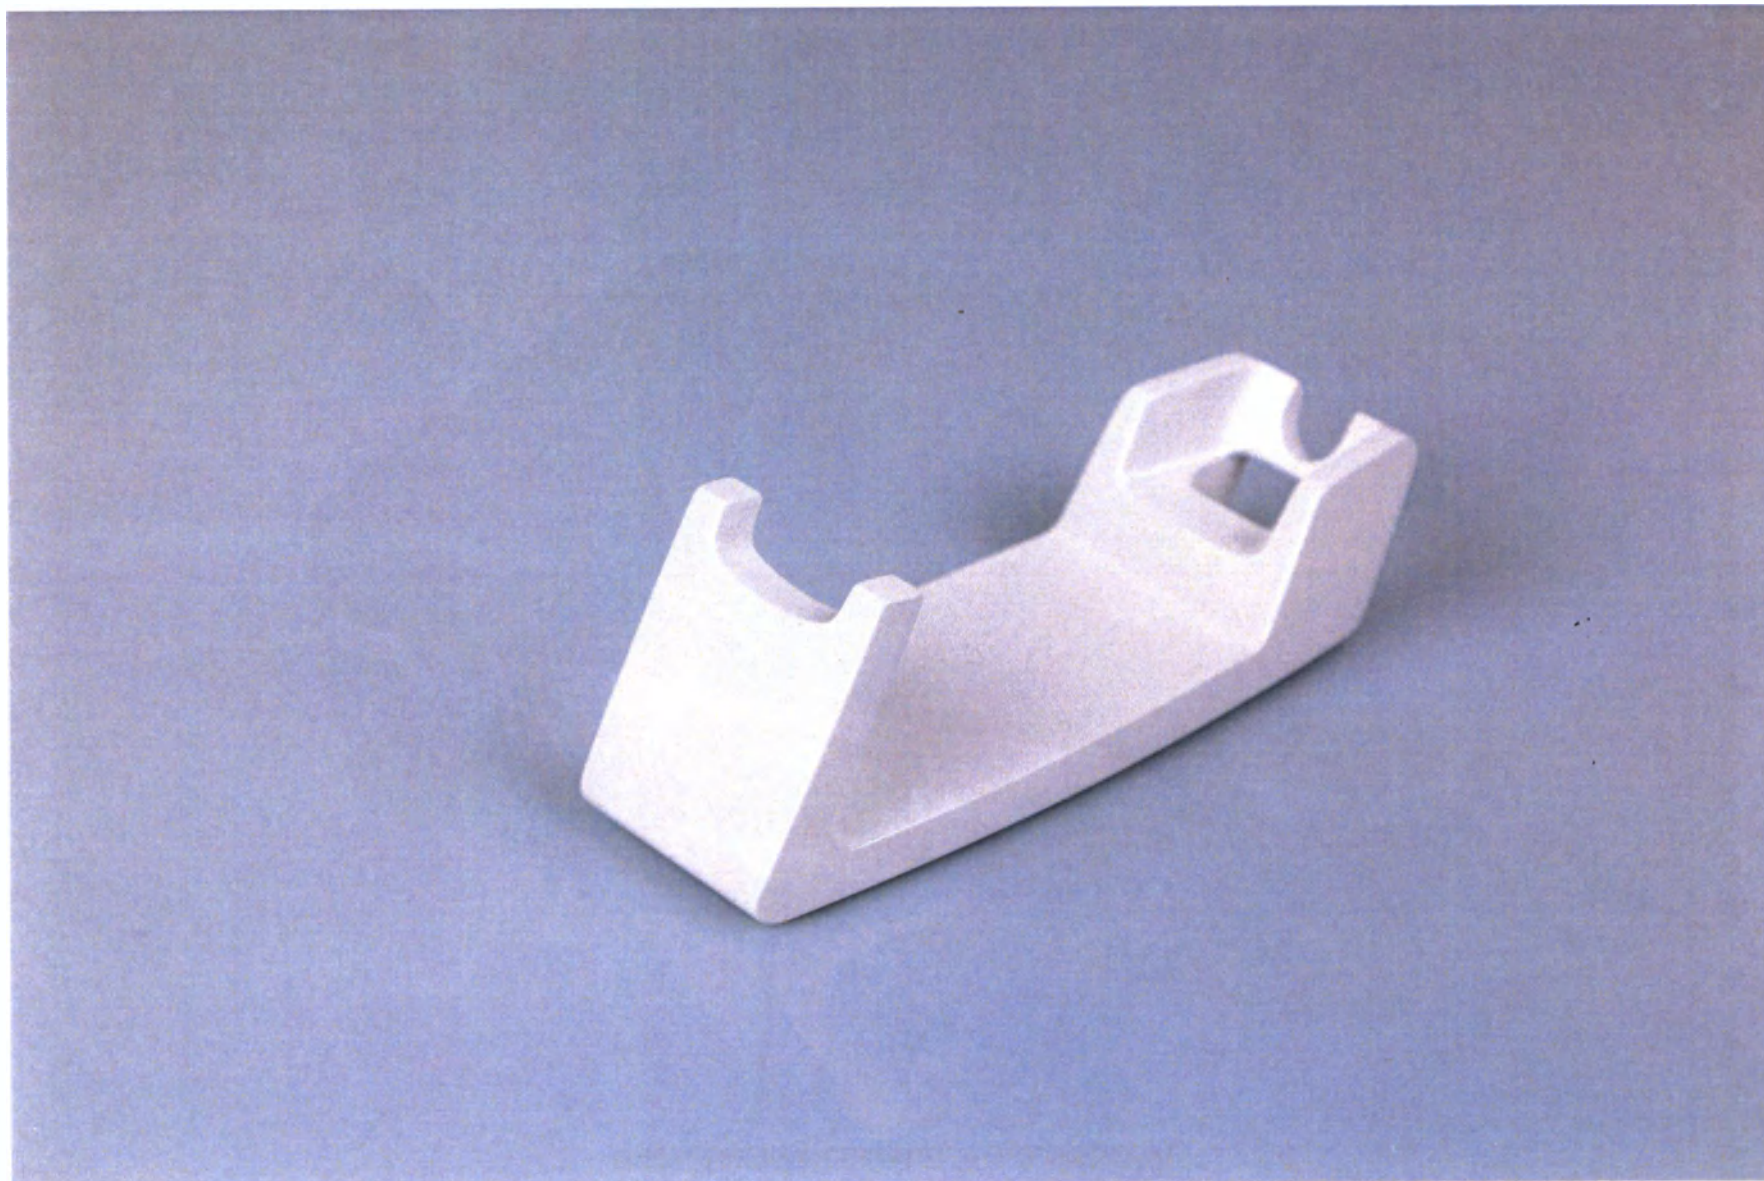


Фото 12 - Кейс для хранения (в закрытом виде)



информация о серийном номере сканера

Фото 13 - Кейс для хранения (в открытом виде)

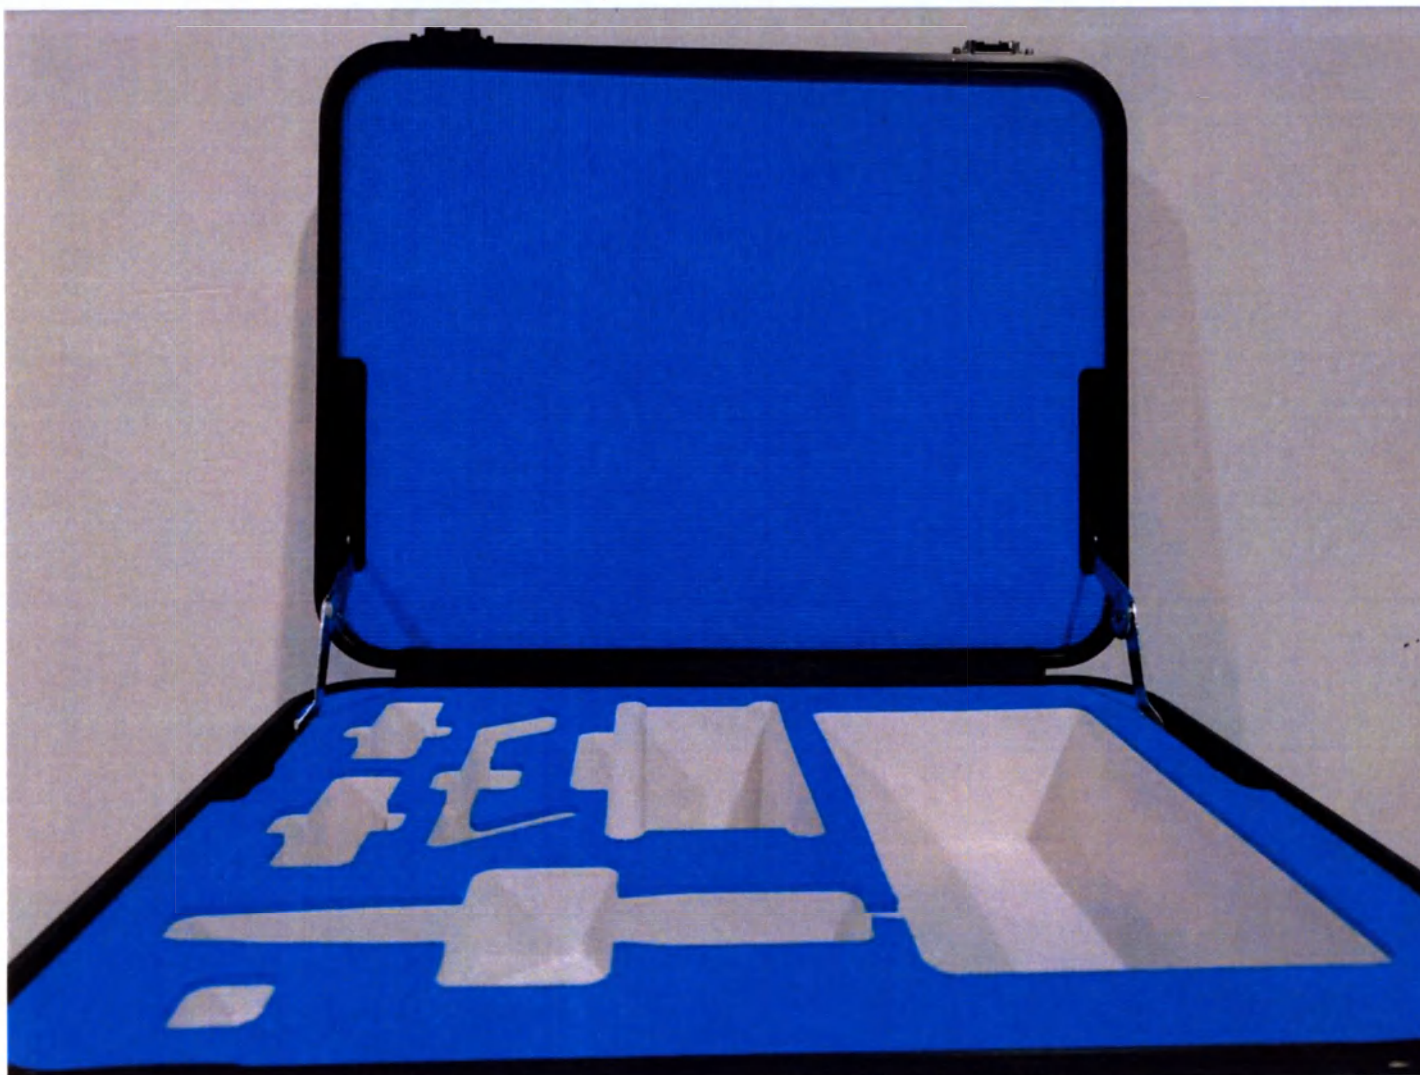

2. Сканер интраоральный «Пумпа» для создания цифровых снимков зубов, исполнение 2.0
Фото 14 - Общий вид / Кейс для хранения в открытом виде



Фото 15 - Сканер интраоральный (корпус желтого цвета)



Фото 16 - Сканер интраоральный (корпус серого цвета)

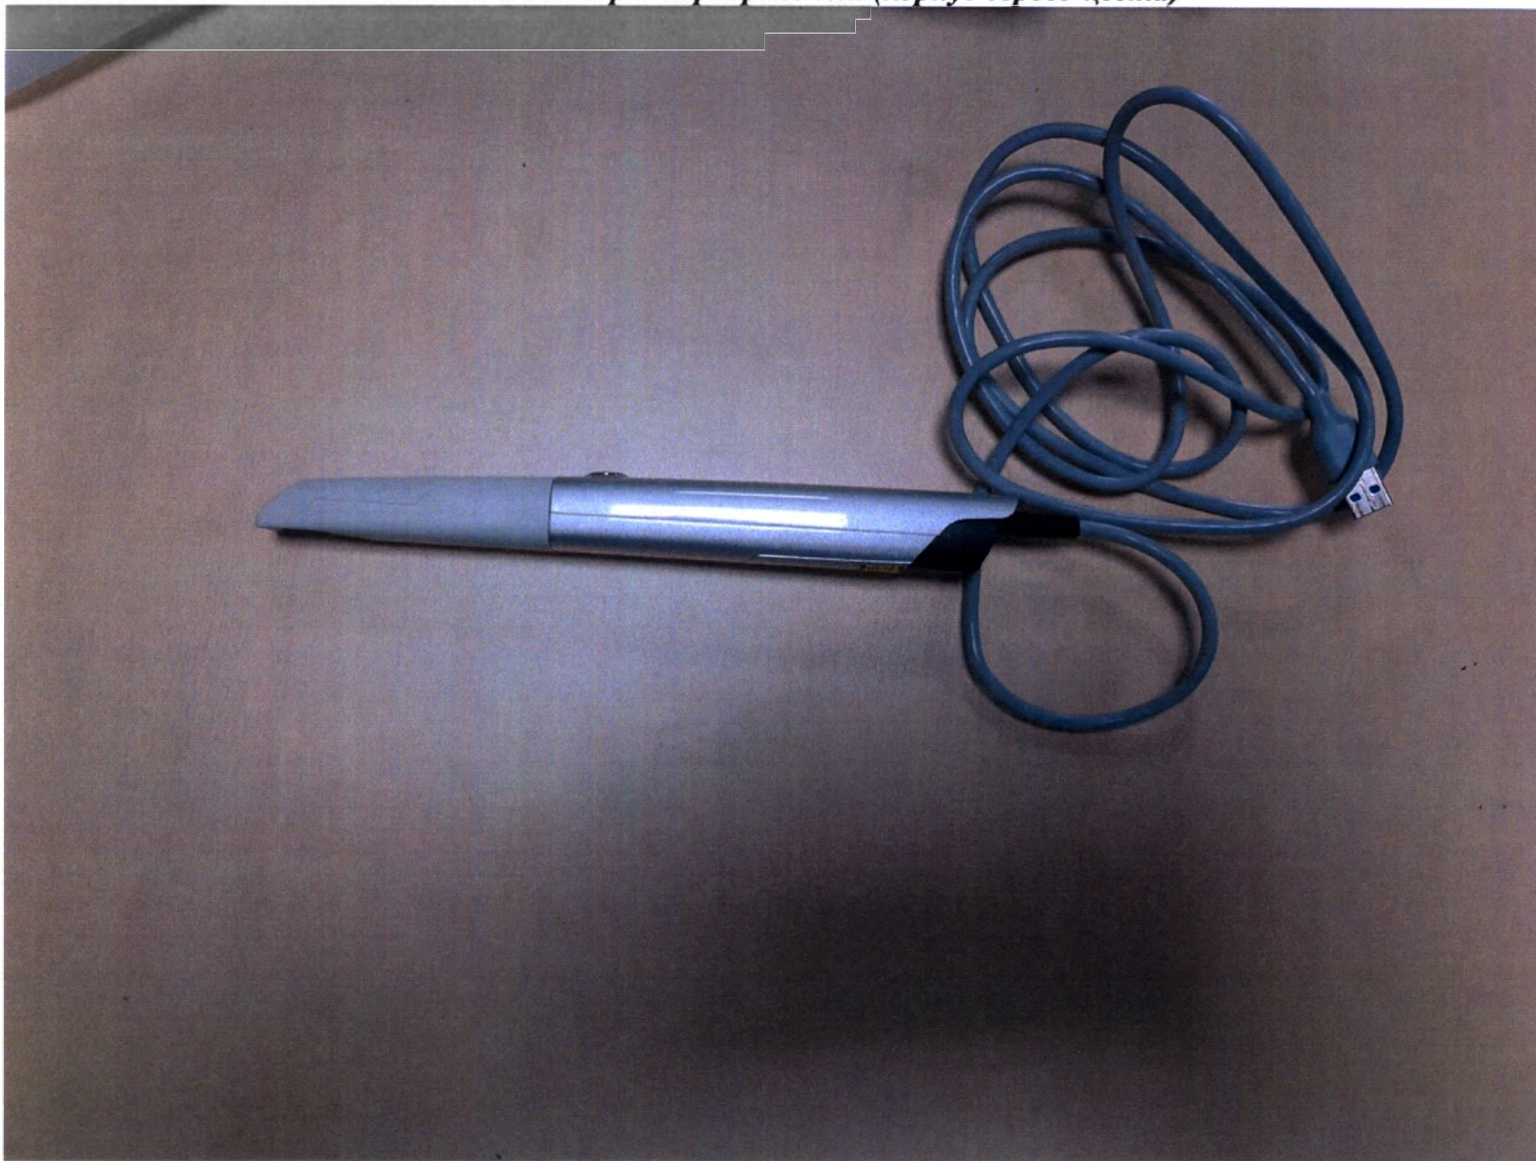


Фото 17 - Сканер интраоральный (корпус фиолетового цвета)

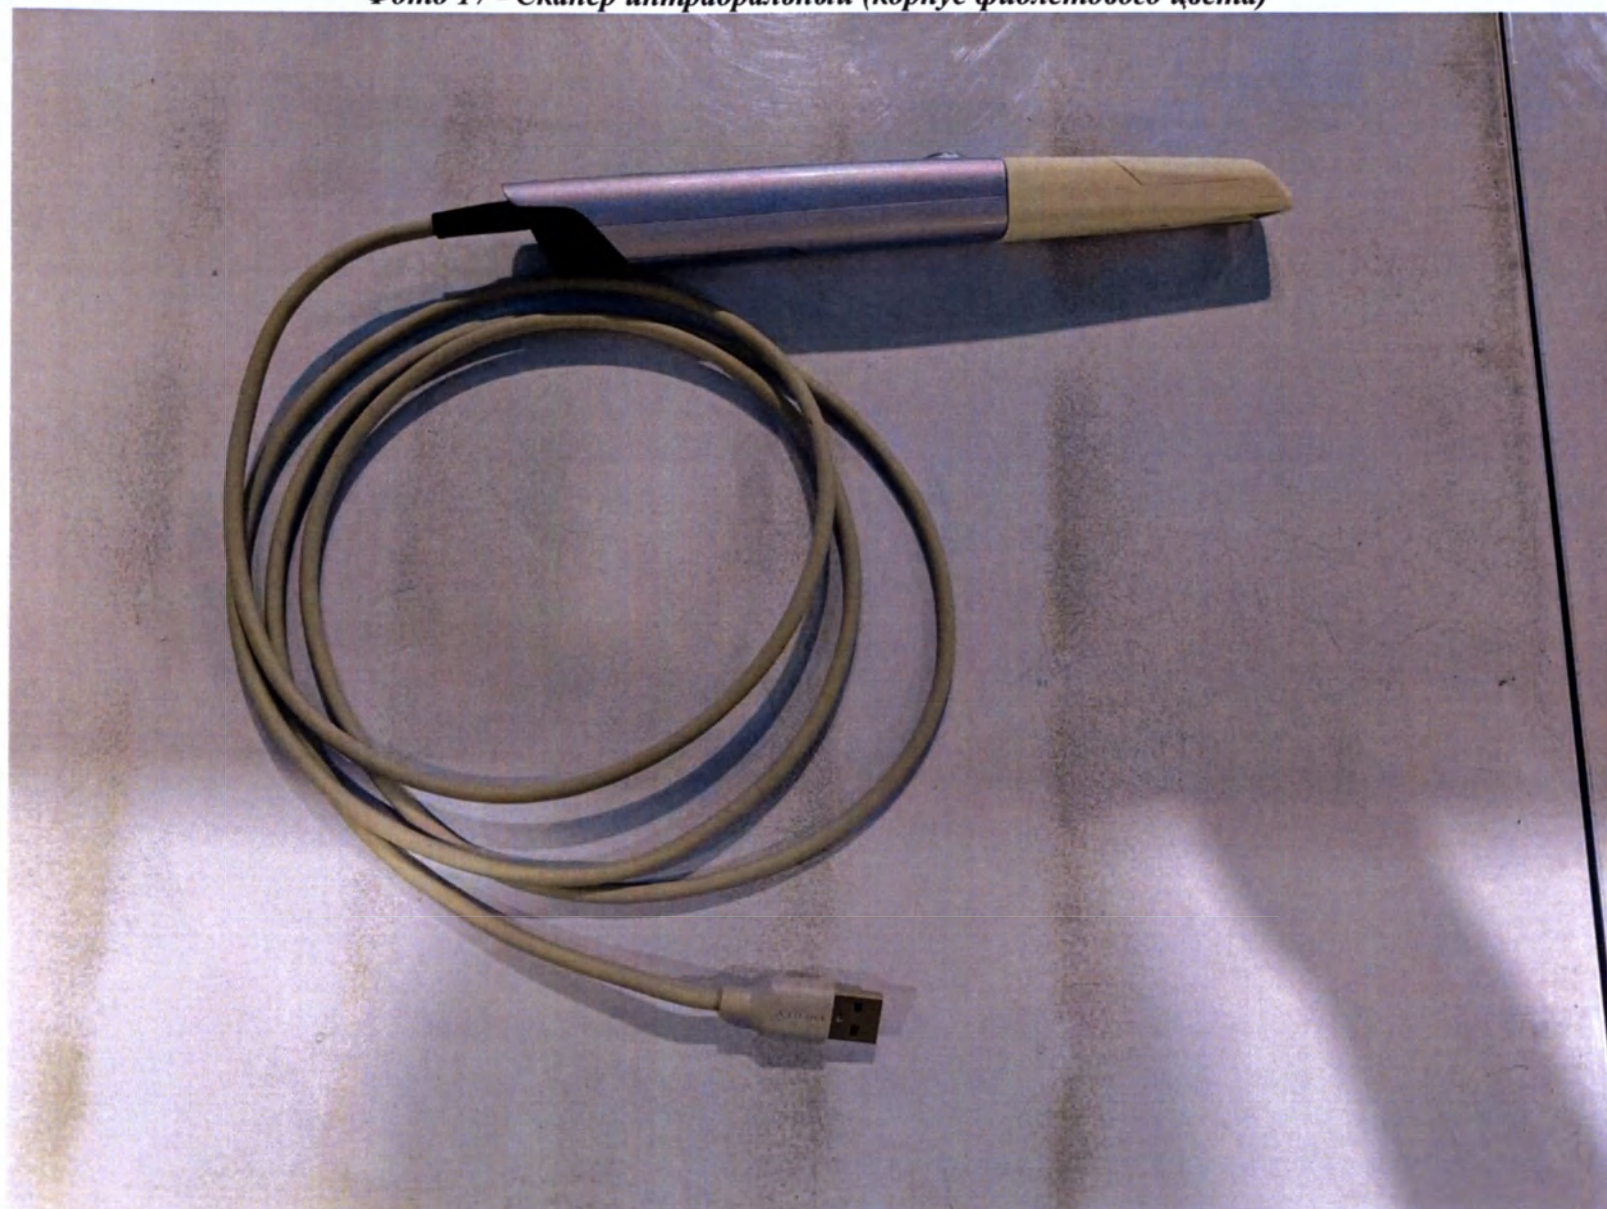


Фото 18 - Сканер интраоральный (корпус голубого цвета)

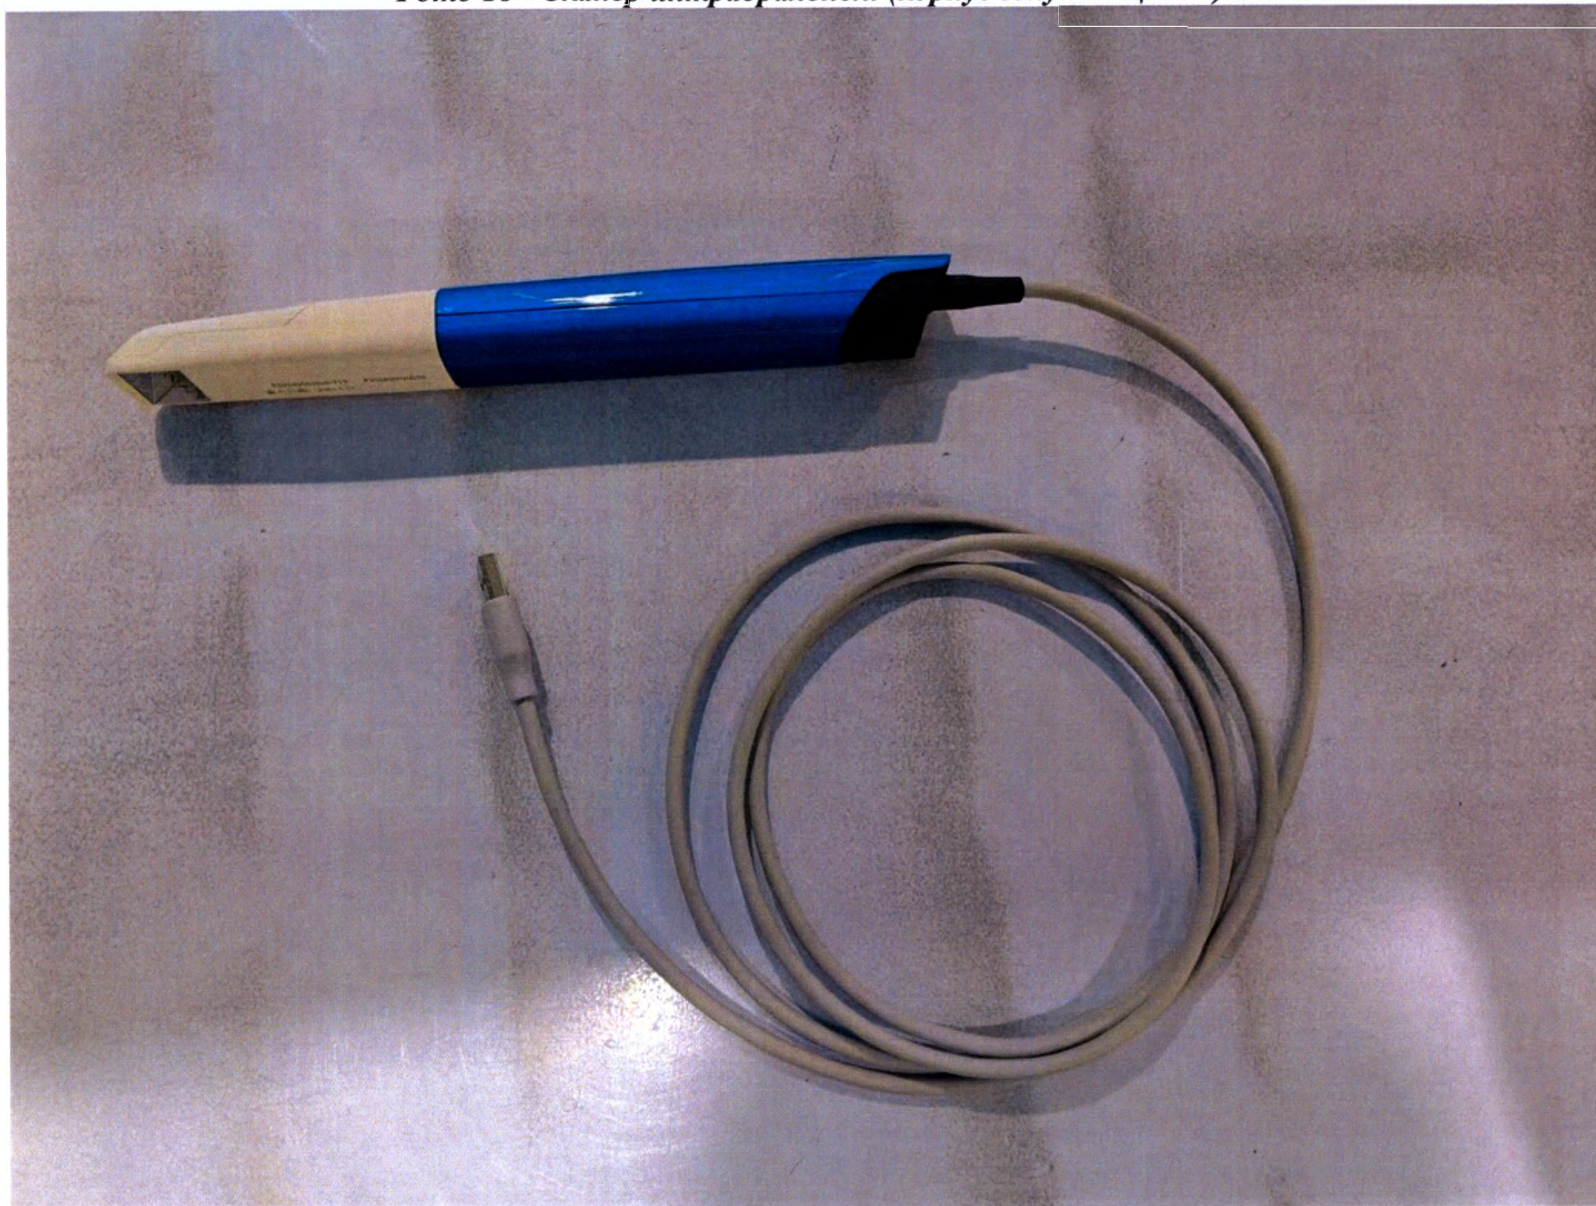


Фото 19 - Сканер интраоральный (корпус красного цвета)

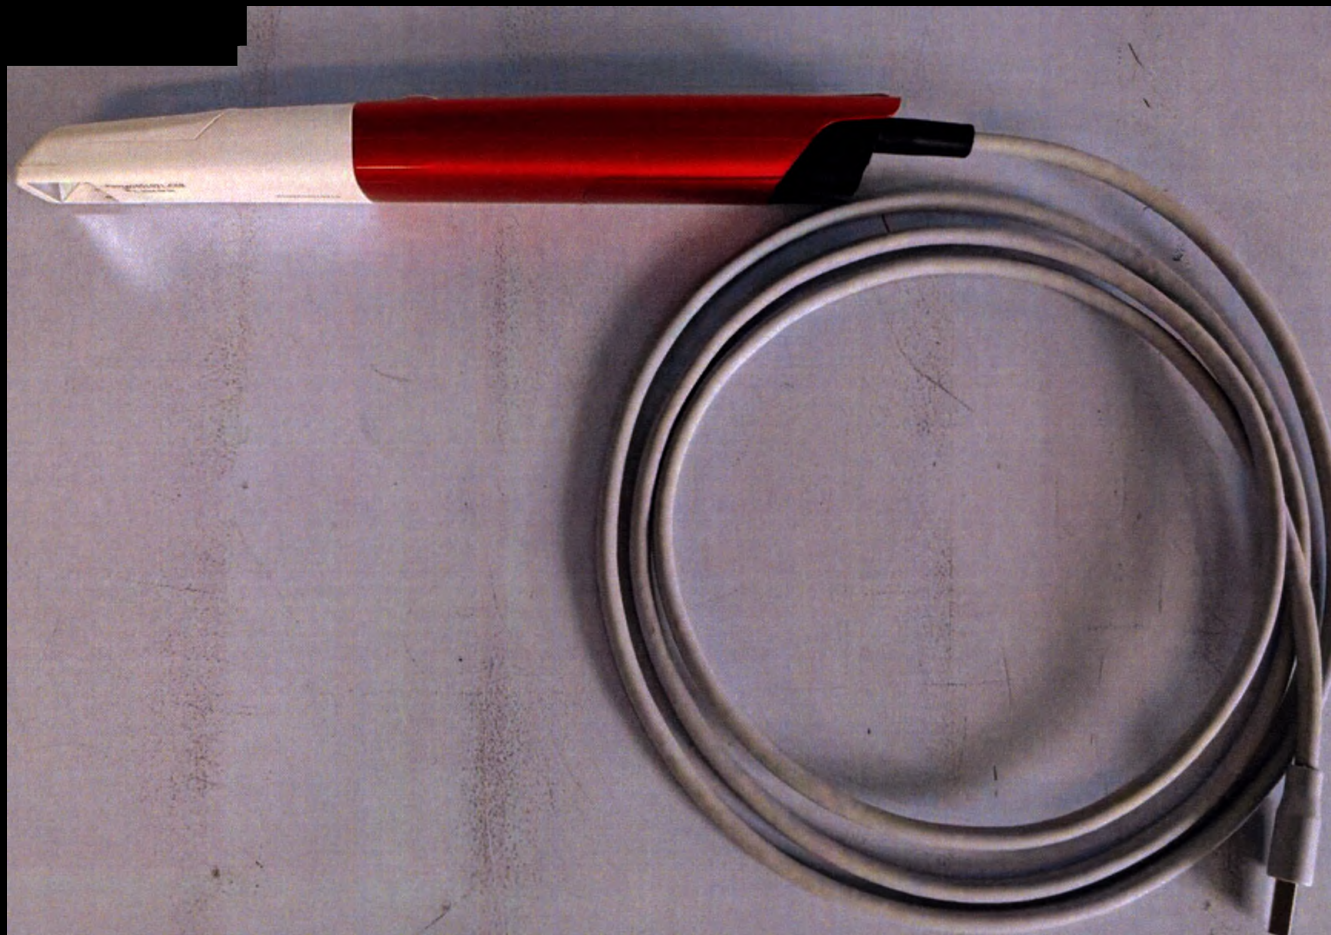


Фото 20 - Сканер интраоральный (корпус белого цвета)



Фото 21 - Сканер интраоральный (корпус бирюзового цвета)

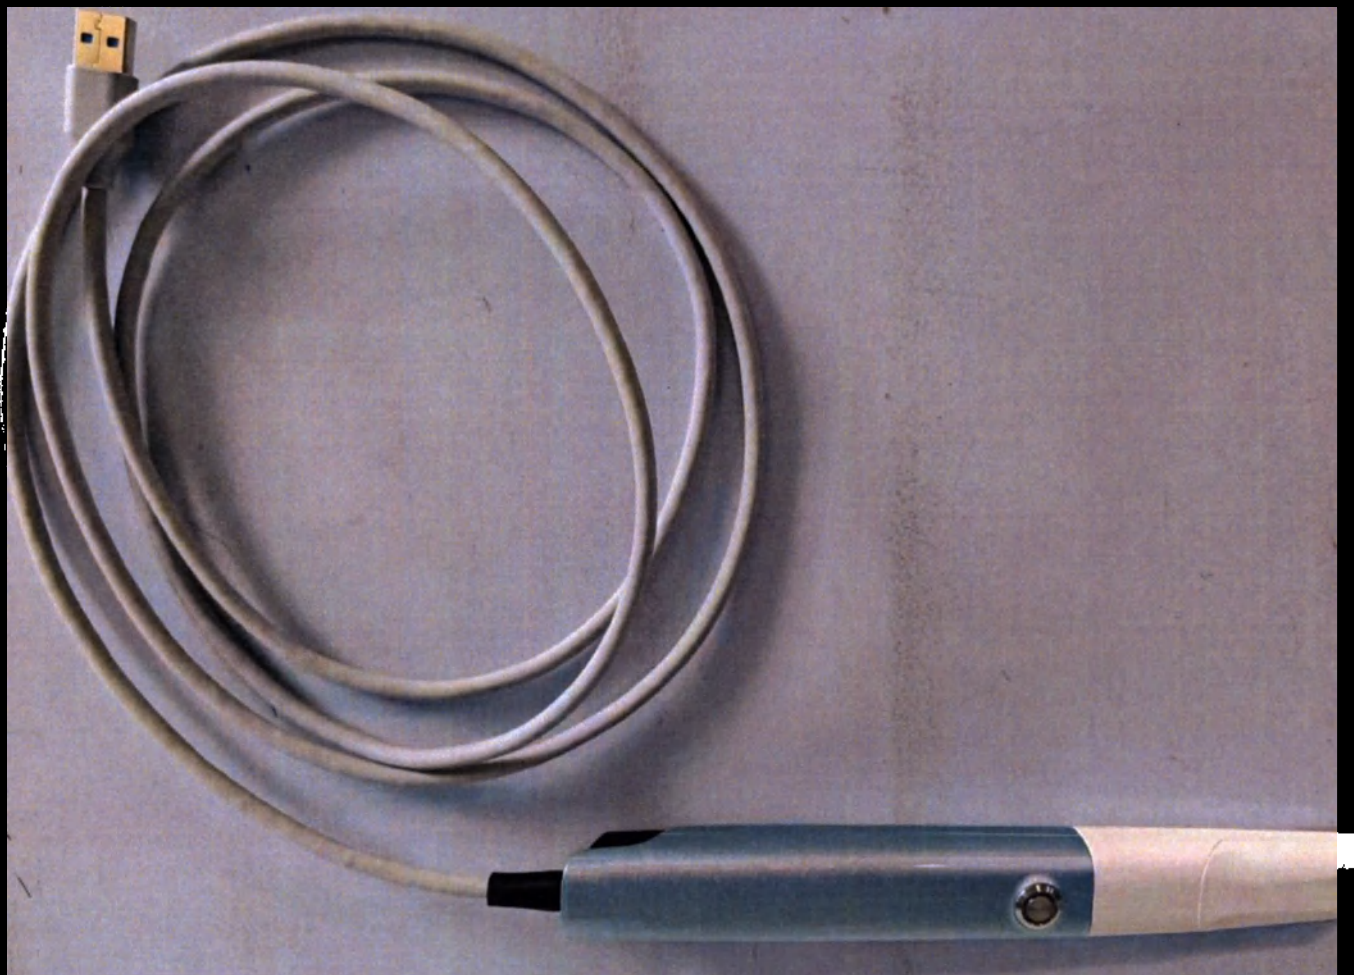


Фото 22 – Маркировка с серийным номером сканера на сканере интраоральном



*Фото 23 - Насадка сканирующая
(с информацией о номере партии насадок)*



Фото 24 - Насадка защитная



Фото 25 - Устройство калибровки
(с информацией о серийном номере сканера и устройства калибровки)



Фото 26 - Кабель устройства калибровки

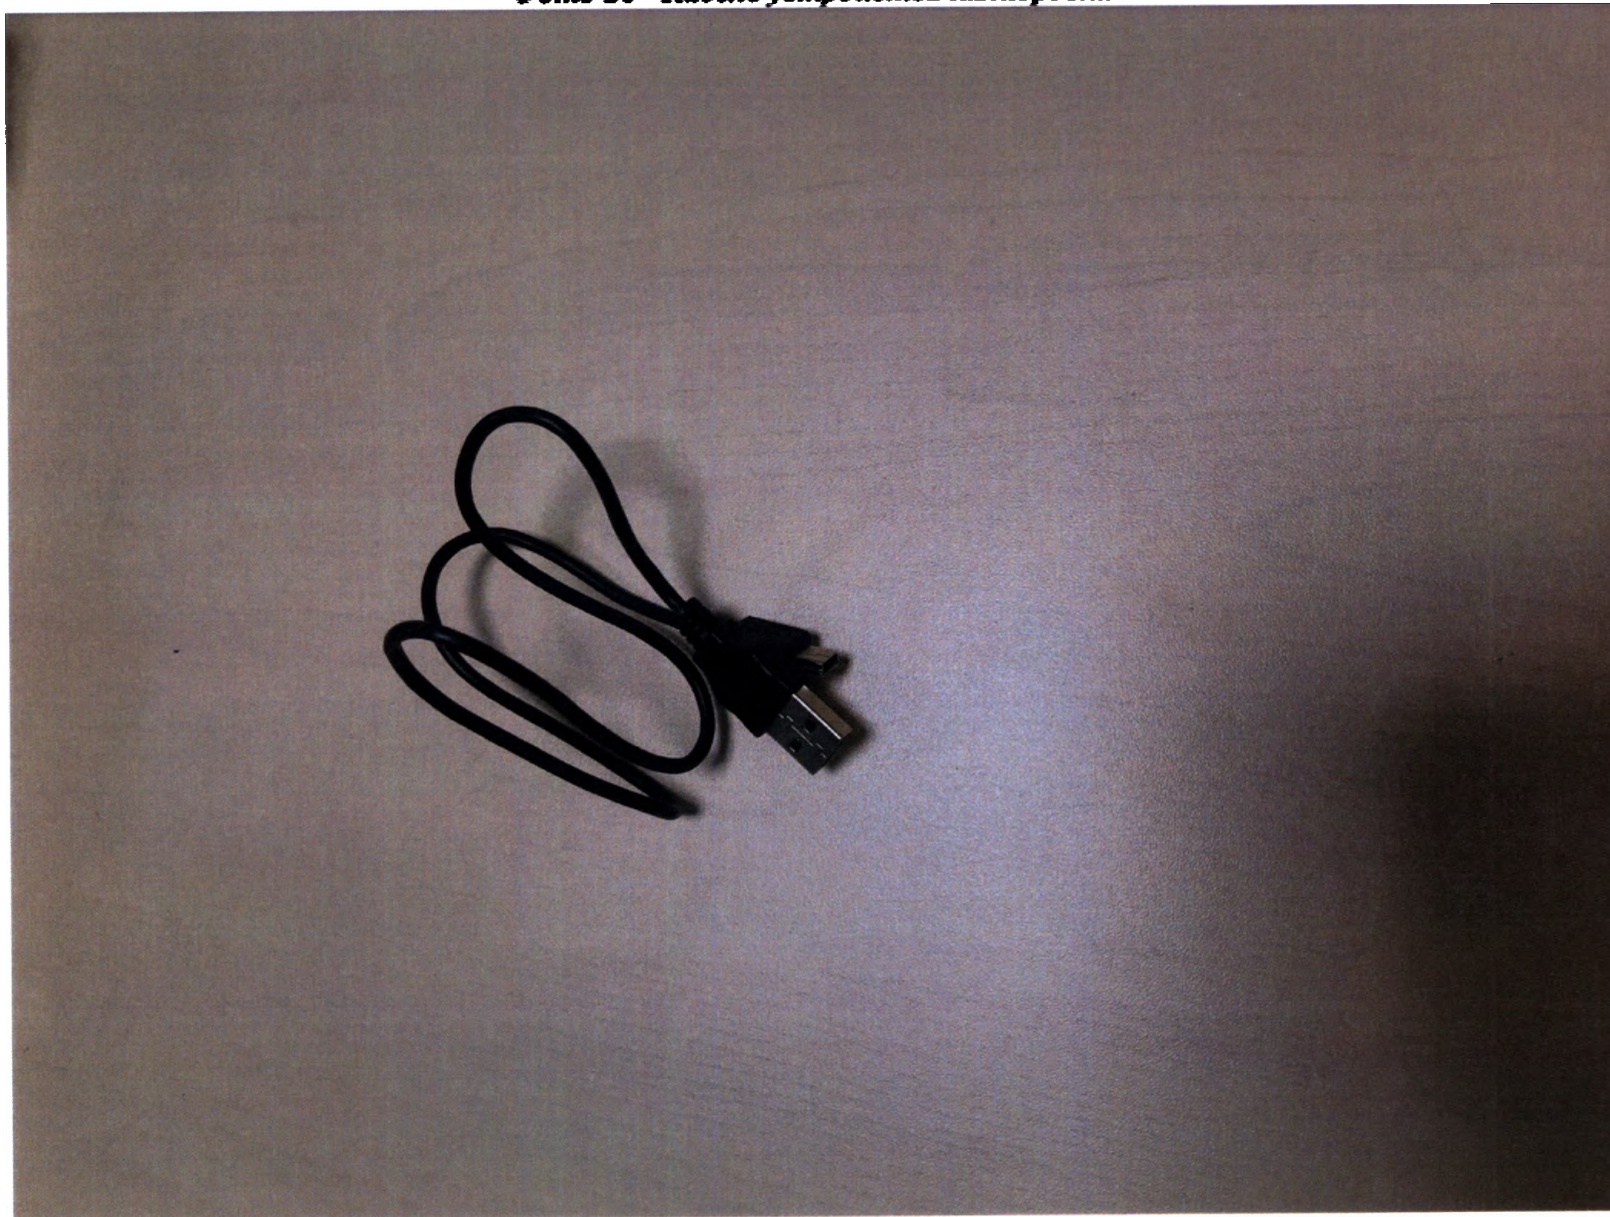


Фото 27 - USB-ключ



Фото 28 - Подставка для сканера



Фото 29 - Кейс для хранения (в закрытом виде)



3. *Транспортная упаковка*



4. Маркировка медицинского изделия

Маркировка на кейсе для хранения

Сканер интраоральный «Пумпа» для создания цифровых снимков зубов



XXXXXXXXXXXX

Напряжение: AC 100-240 В



XX.XX.XXXX

Мощность: 30 ВА



Цзяян Фректи Медикал
Эквипмент Ко., Лтд. (Китай)
(Ziyang Freqty Medical
Equipment Co., Ltd.)



Представитель производителя в РФ:
ООО «Ортосмайл» 105094, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,
наб. Семеновская, д. 2/1, стр. 1, кв. 57
тел.: +7 (495) 966-03-04
e-mail: orthosmile@pumpagroup.ru

ПУ №

Сканер интраоральный «Пумпа» для создания цифровых снимков зубов, исполнение 2.0



XXXXXXXXXXXX

Источник питания USB 3.0
порт компьютера: 5 В $\pm$, 0.9 А



XX.XX.XXXX



Цзяян Фректи Медикал
Эквипмент Ко., Лтд. (Китай)
(Ziyang Freqty Medical
Equipment Co., Ltd.)



Представитель производителя в РФ:
ООО «Ортосмайл» 105094, г. Москва,
вн.тер.г. муниципальный округ Басманный,
наб. Семеновская, д. 2/1, стр. 1, кв. 57
тел.: +7 (495) 966-03-04
e-mail: orthosmile@pumpagroup.ru

ПУ №

*Маркировка на сканере интраоральном «Пумпа» для создания цифровых снимков
зубов, исполнение 2.0*

Сканер интраоральный «Пумпа» для создания
цифровых снимков зубов, исполнение 2.0

Представитель производителя в РФ: ООО «Ортосмайл»
105094, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный
округ Басманный, наб. Семеновская, д. 2/1, стр. 1, кв. 57
e-mail: orthosmile@pumpragroup.ru



Цзыян Фректи Медикал Экуипмент Ко., Лтд.
Этаж 2-3, корпус 7, дом 3, No. 222, Западный сектор 3,
улица Внешнего кольца, район Янцзы, город Цзыян,
провинция Сычуань, Китай


Сканер интраоральный «Пумпа» для создания
цифровых снимков зубов, исполнение 2.0



XXXXXXXXXXXX



XX.XX.XXXX



Источник питания USB 3.0
порт компьютера 5B --- 0,9A

ПРОНУМЕРОВАНО

И

ПРОШНУРОВАНО

33

ЛИСТОВ

Борзов

