

УТВЕРЖДАЮ

**Генеральный директор
ООО «ВИТАНТА»**

**П. Барсуков**
«22» 2024 г.

**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

«Трансммиттер ТачКеар (TouchCare), варианты исполнения:

- I. Трансммиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1160,**
- II. Трансммиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1158»**

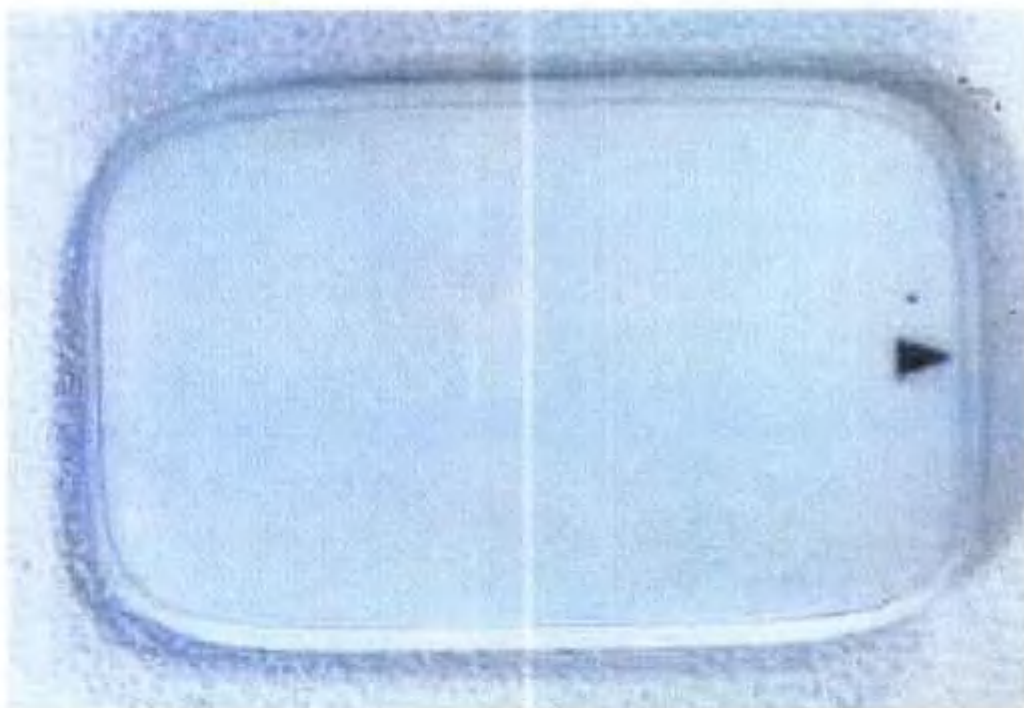


Фото 1



Фото 2

Фото 1-2 – Общий вид изделия «Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1158»



**Фото 3 – «Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1158»:
картонная упаковка – трансмиттер модель MD1158 в пластиковом
держателе и USB-кабель для зарядки трансмиттера**



Фото 4



Фото 5



Фото 6

Фото 4 – 6 – «Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1158»:

USB-кабель для зарядки трансмиттера



**Фото 7 - «Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1158» -
трансмиссер модель MD1158 в пластиковом держателе**

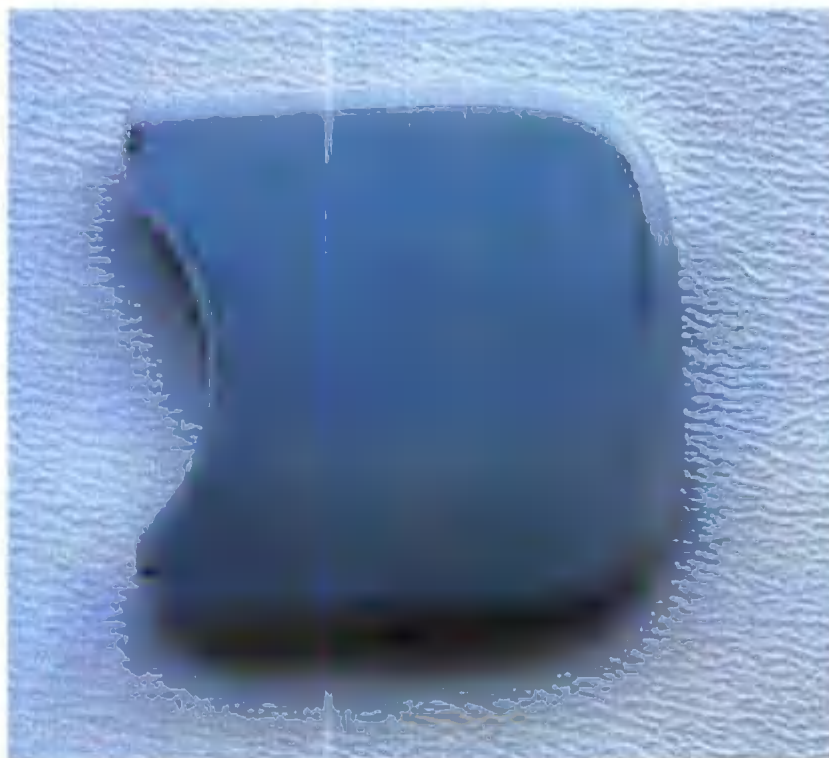


Фото 8



Фото 9

Фотографические изображения 8-9 – Общий вид изделия «Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1160»



Фото 10 – «Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1160»: картонная упаковка – трансмиттер модель MD1160 в пластиковом держателе



Фото 11 - «Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MDI 160» -
трансммиттер модель MDI 160 в пластиковом держателе



Фото 12



Фото 13



Фото 14



Фото 15

Фото 12 – 15 - «Трансммиттер ТачКеар (Touch Care)»: картонная упаковка



Фото 16 - Маркировка картонной упаковки Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1158

**Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), вариант исполнения:
Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1158,**

В составе:

1. Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1158 – 1 шт.;
2. Программное обеспечение Medtrum EasySense mmol/L (iOS/Android)
3. USB-кабель для зарядки трансмиттера - 1 шт.;
4. Инструкция по применению.

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАНТА» (ООО «ВИТАНТА»),

Адрес места нахождения: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, III/42/410

Фактический/почтовый адрес: 121596, г. Москва, Можайское шоссе, д. 165, стр. 1

Тел: 8-800-200-77-48, touchcare.ru

Регистрационное удостоверение: XXXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

Фото 17 - Проект маркировки Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1158 для применения на территории РФ



Фото 18 - Маркировка картонной упаковки Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1160

Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), вариант исполнения:

Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1160,

В составе:

1. Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1160 – 1 шт.;
2. Программное обеспечение Medtrum EasySense mmol/L (iOS/Android)
3. Инструкция по применению.

Уполномоченный представитель в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ВИТАНТА» (ООО «ВИТАНТА»),

Адрес места нахождения: 117420, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 57, III/42/410

Фактический/почтовый адрес: 121596, г. Москва, Можайское шоссе, д.165, стр.1

Тел: 8-800-200-77-48, touchcare.ru

Регистрационное удостоверение: XXXX/XXXXXX от XX.XX.XXXX

Фото 19 - Проект маркировки Трансмиттер ТачКеар (TouchCare), модель MD1160 для применения на территории РФ

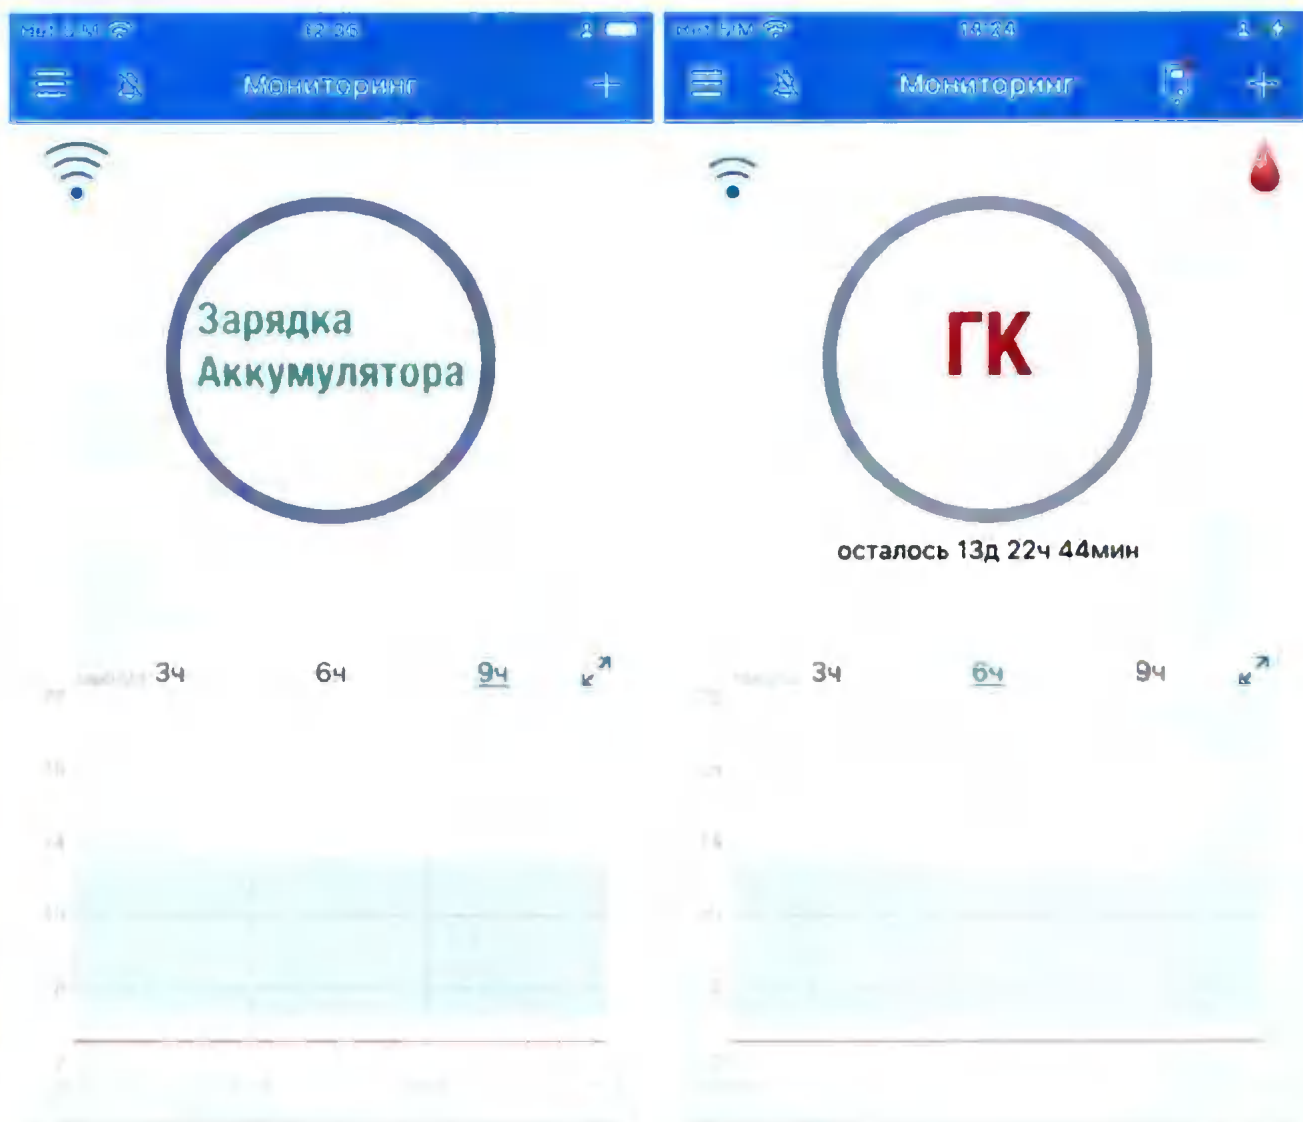


Фото 20

Фото 21



Фото 22

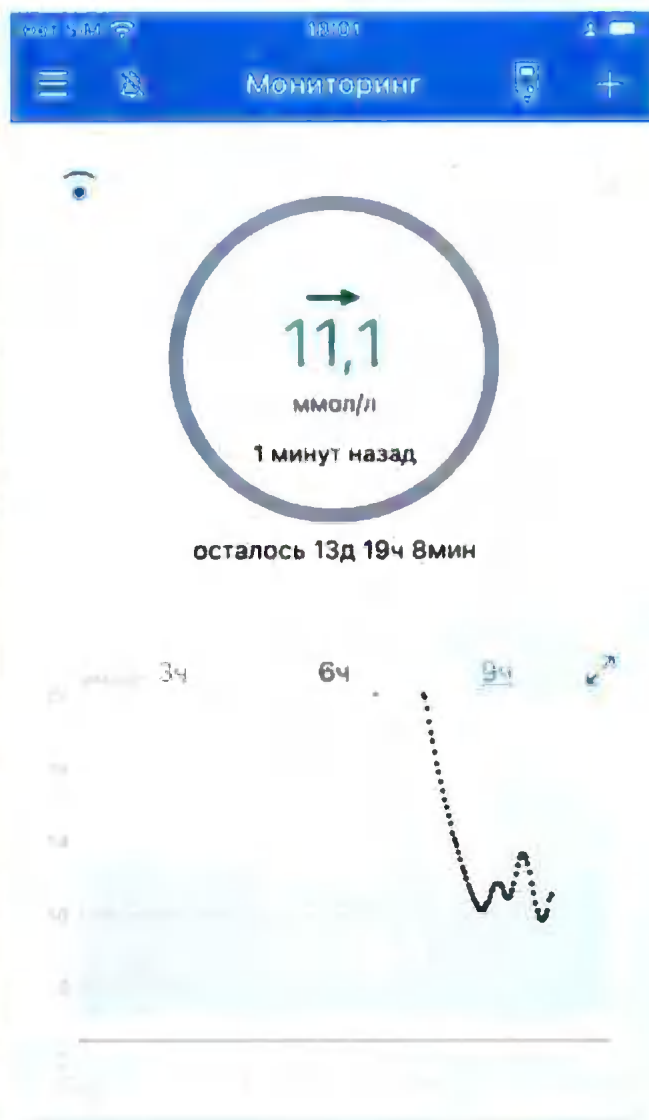


Фото 23



Фото 24



Фото 25



Фото 26



Фото 27



Фото 28



Фото 29



Ежедневный отчет о работе сенсора



28.05.2017 19:34



Фото 30



Ежедневный отчет о работе сенсора



28.05.2017 20:20

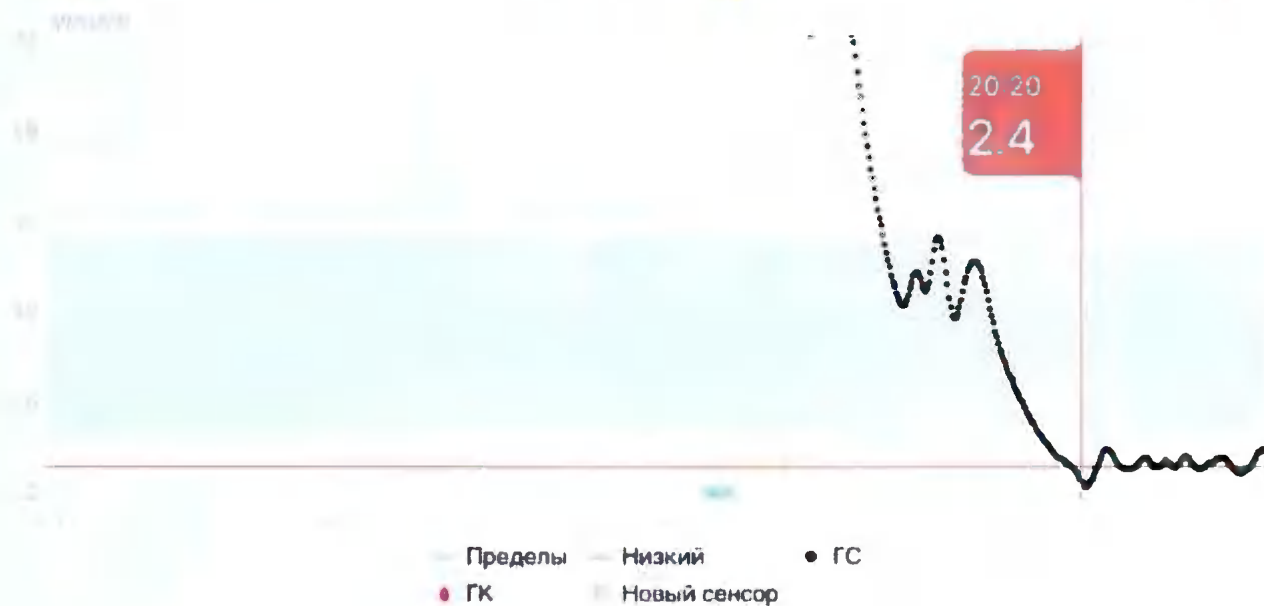


Фото 31



Фото 32

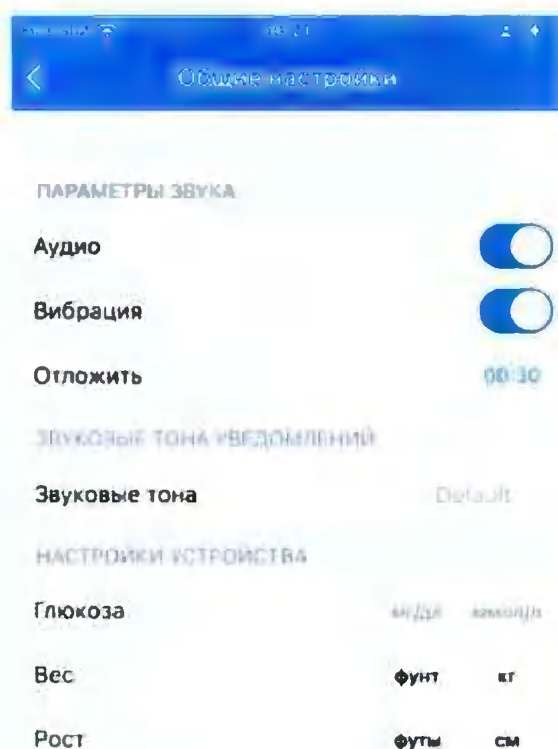


Фото 33

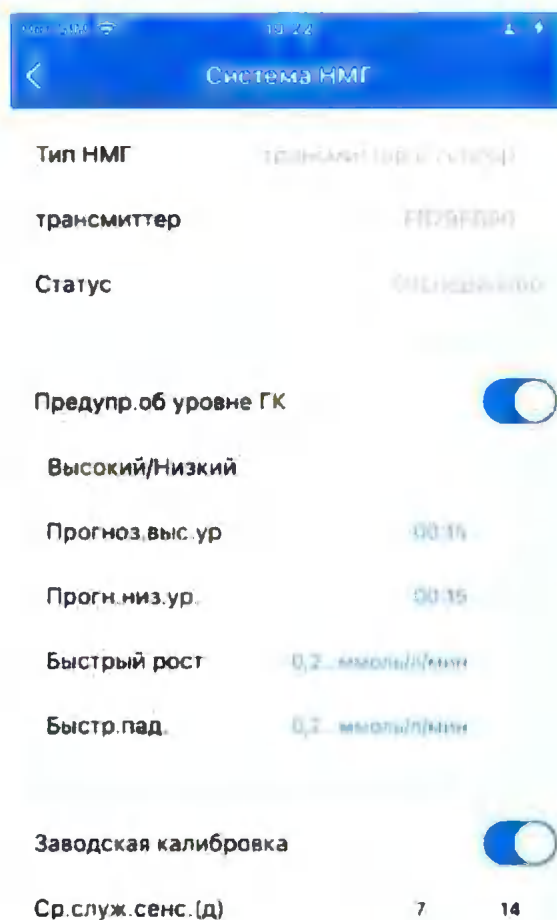


Фото 34




понедельник, 13 ноября 2023 г.

понедельник, 23 октября 2023 г.

Уведомление: Ниже 3.1mmol/L	21:04
Уведомление: Низкий Уровень Глюкозы	20:40
Уведомление: Ниже 3.1mmol/L	20:08
Уведомление: Низкий Уровень Глюкозы	19:34
Уведомление: Высокий Уровень Глюкозы	17:28
Уведомление: Высокий Уровень Глюкозы	16:10
Уведомление: Высокий Уровень Глюкозы	15:38
Уведомление: Высокий Уровень Глюкозы	15:32
Уведомление: Высокий Уровень Глюкозы	15:02
Уведомление: измерьте ур.ГК прямо сейчас	14:15
Уведомление: измерьте ур.ГК прямо сейчас	14:09

Фото 35



понедельник, 13 ноября 2023 г.

понедельник, 23 октября 2023 г.

Уведомление: Низкий Уровень Глюкозы	23:42
Уведомление: Ниже 3.1mmol/L	23:18
Уведомление: Низкий Уровень Глюкозы	22:46
Уведомление: Ниже 3.1mmol/L	22:32
Уведомление: Низкий Уровень Глюкозы	22:16
Уведомление: Ниже 3.1mmol/L	22:08
Уведомление: Низкий Уровень Глюкозы	21:54
Уведомление: Ниже 3.1mmol/L	21:44
Уведомление: Низкий Уровень Глюкозы	21:26
Уведомление: Ниже 3.1mmol/L	21:04
Уведомление: Низкий Уровень Глюкозы	20:40
Уведомление: Ниже 3.1mmol/L	20:08

Фото 36

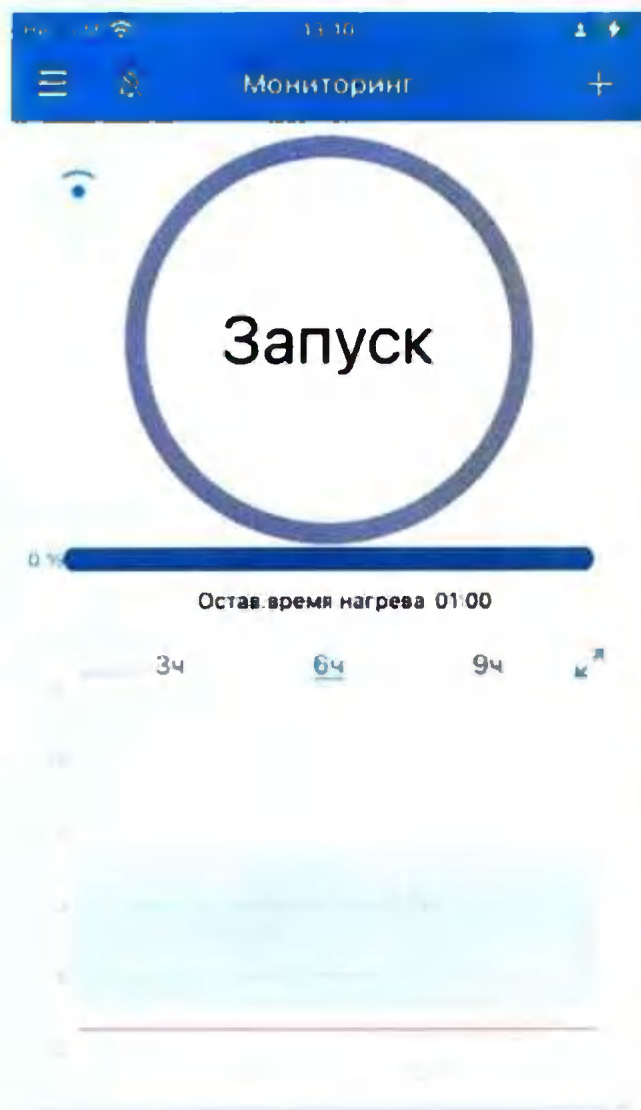


Фото 37

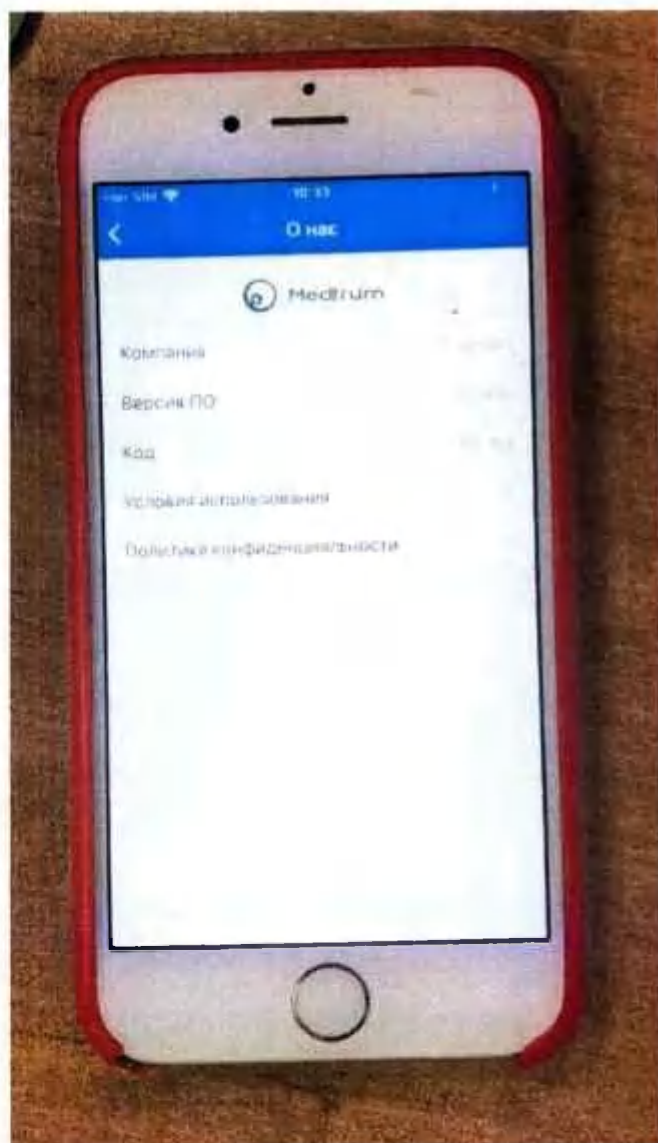


Фото 38

Фото 20-38 – Возможности при работе в ПО Medtrum EasySense mmol/L для IOS



Фото 39

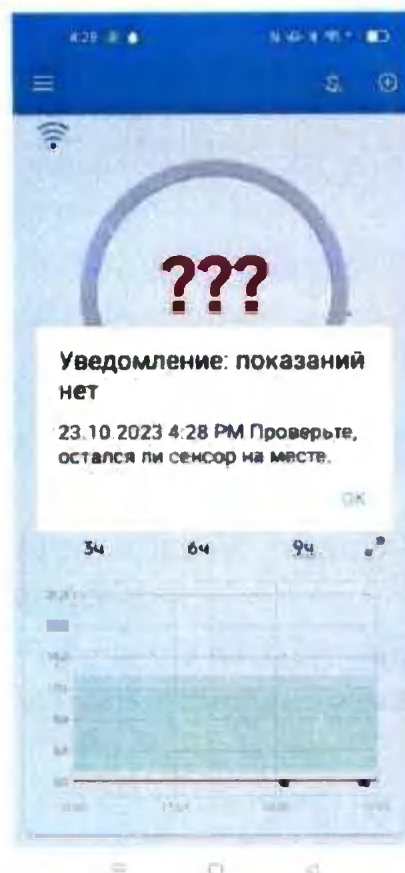


Фото 40



Фото 41



Фото 42



осталось 13д 7ч 2мин

3ч 6ч 9ч



Фото 43




Уведомление: ошибка сенсора

12.10.2023 11:59 AM Ошибка сенсора. Необходимо заменить сенсор.

OK

3ч 6ч 9ч

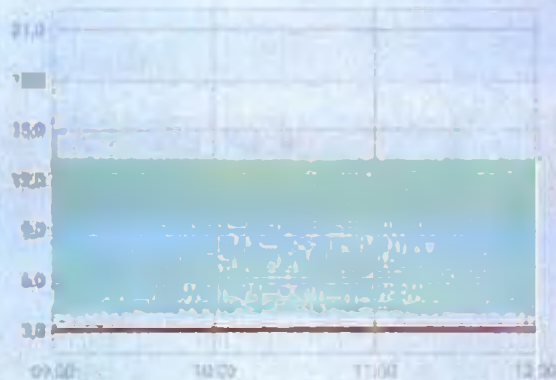

Фот 44



Фото 45

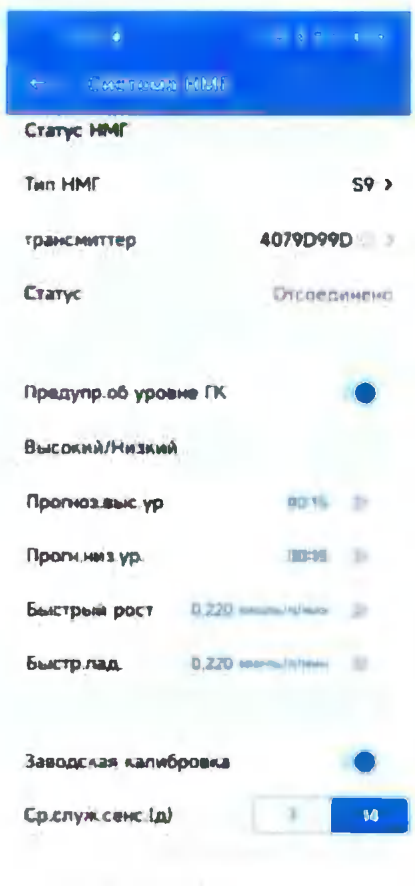


Фото 47



Фото 46

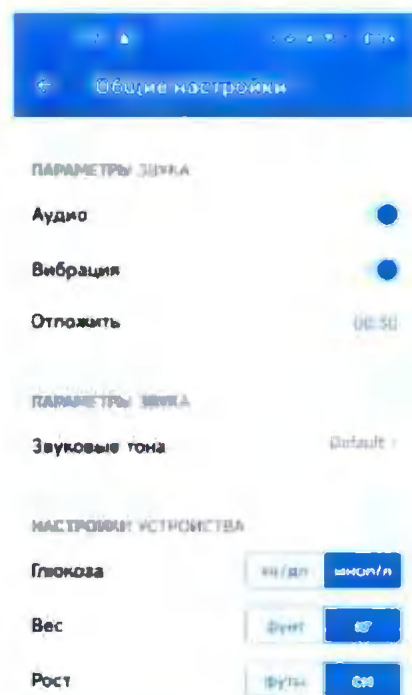


Фото 48

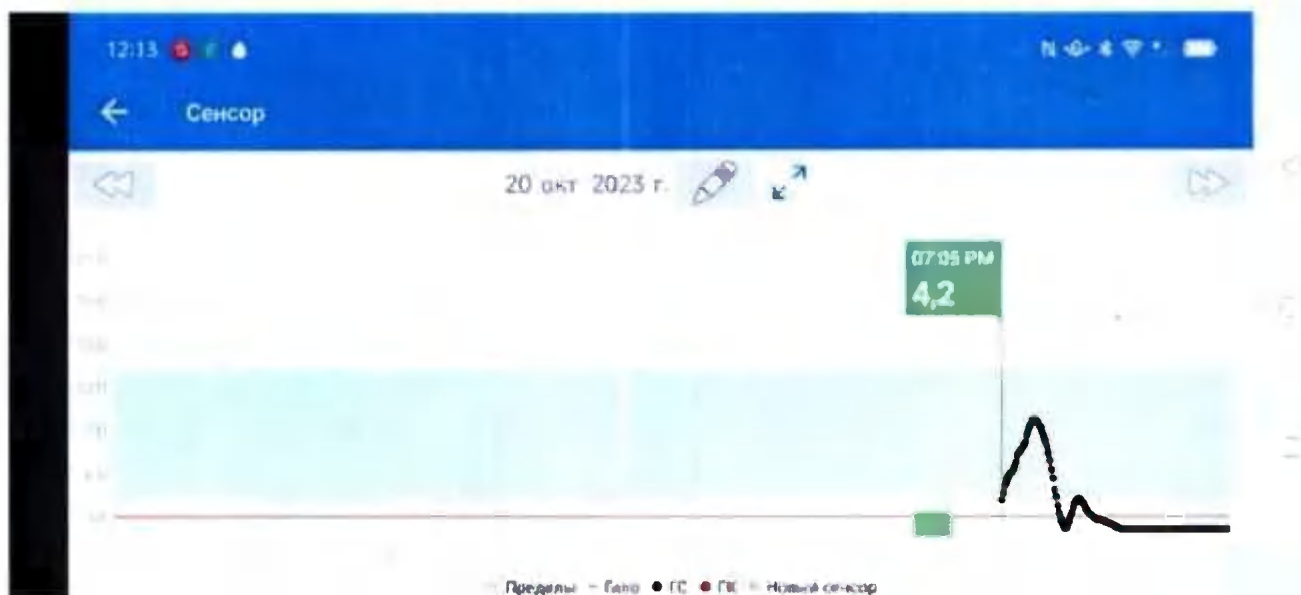


Фото 49



Фото 50



Фото 51



Фото 52



Фото 53



Фото 54

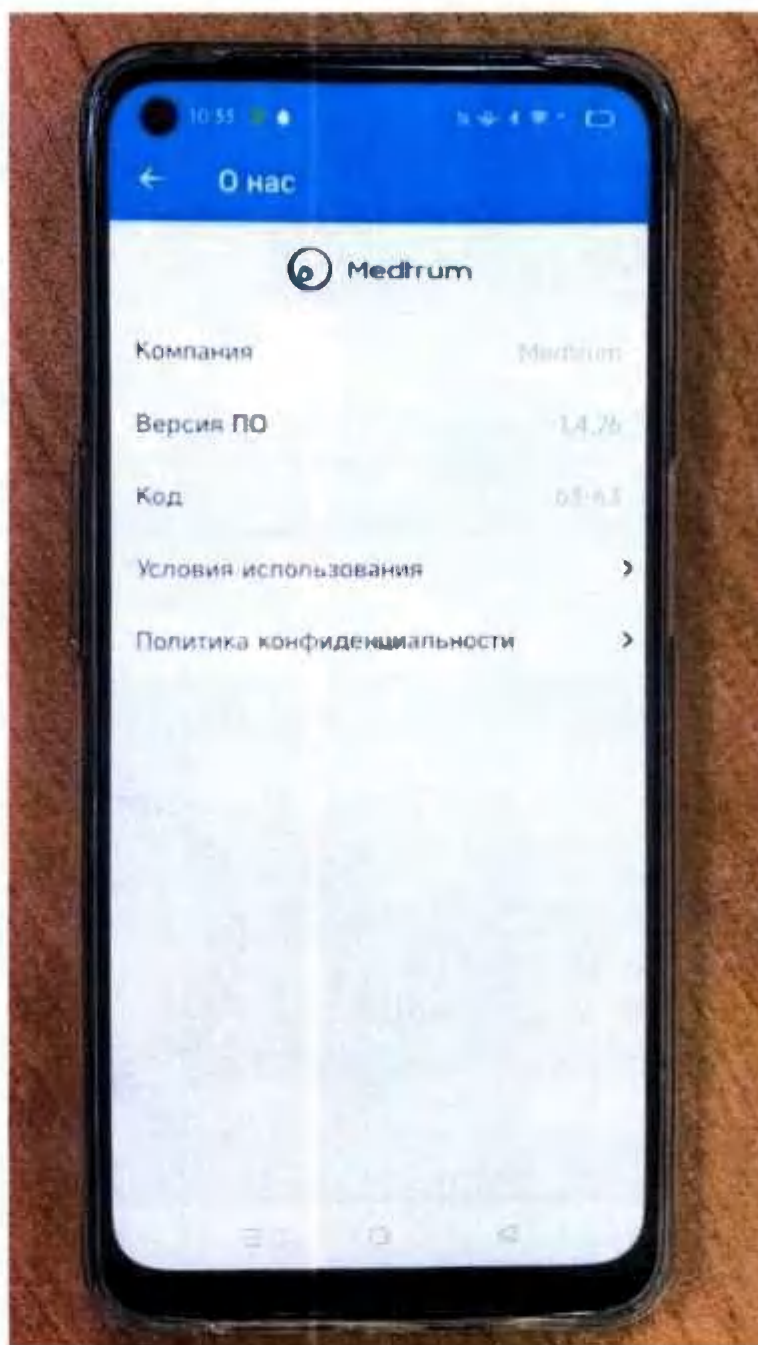


Фото 55

Фото 39-55 – Возможности при работе в ПО Medtrum EasySense mmol/L для Android

1
Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 28 (Барсуков Алексей) листов
Генеральный директор
ООО «ВИТАНТА»

Дата 11 июля 2024

Барсуков А.П.

