



Общество с ограниченной ответственностью "Неврокор"
Москва тел. +7 (495) 7403534 www.neurocor.ru

Генеральный директор

ООО «Неврокор»

Ишутин Д.В.

« 31 » октября 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия

**Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный с
диагностическими возможностями «БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-
007-63704475-2023**

г.Москва

2024

Содержание

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями «БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023:

1. Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями «БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023, в составе:

- 1.1. Датчик биомеханический носимый – не более 16 шт.
- 1.2. Дисплей Модуля БОС в вариантах исполнения - 1 шт. (при необходимости):
 - 1.2.1. Дисплей (модель БОС30) – 1 шт. (при необходимости);
 - 1.2.2. Дисплей (модель БОС40) – 1 шт. (при необходимости);
 - 1.2.3. Дисплей (модель БОС50) – 1 шт. (при необходимости).
- 1.3. Стойка Модуля БОС – 1 шт. (при необходимости).
- 1.4. Стабилоплатформа – не более 2 шт. (при необходимости).
- 1.5. Зарядное устройство в вариантах исполнения (при необходимости):
 - 1.5.1. Зарядное устройство (модель 1) – не более 16 шт. (при необходимости);
 - 1.5.2. Зарядное устройство (модель 2) с блоком питания (модель 1) – 1 шт. (при необходимости).
- 1.6. ПО «Биомеханика Неврокор» на электронном носителе – 1 шт.
- 1.7. ПО «Стабилометрия Неврокор» на электронном носителе – 1 шт. (при необходимости).
- 1.8. Блок управления и анализа информации в вариантах исполнения – 1 шт. (при необходимости):
 - 1.8.1. Блок управления и анализа информации в версии ПК – 1 шт. (при необходимости):
 - системный блок – 1 шт.;
 - монитор – не более 2 шт.;
 - клавиатура – 1 шт.;
 - мышь – 1 шт.;
 - кабель питания C13 – не более 3 шт.;
 - кабель питания C13-C14 – не более 5 шт.;
 - кабель видеосигнала – не более 3 шт.;
 - адаптер – 1 шт.
 - 1.8.2. Блок управления и анализа информации в версии ноутбук – 1 шт. (при необходимости):
 - ноутбук – 1 шт.;
 - адаптер – 1 шт.;
 - кабель видеосигнала – 1 шт.;
 - кабель питания – не более 2 шт.;
 - мышь – 1 шт.
- 1.9. Пандус с перилами для стабилоплатформы – 1 шт. (при необходимости).
- 1.10. ПО «3D сканер Неврокор» на электронном носителе - 1 шт. (при необходимости).
- 1.11. ПО «Программа для управления базой данных Неврокор» на электронном носителе - 1 шт. (при необходимости).
- 1.12. Кабель отведений (модель 1) в вариантах исполнения:
 - 1.12.1 Кабель отведений (модель 1) размер: 100 мм - не более 16 шт. (при необходимости);


- 1.12.2 Кабель отведений (модель 1) размер: 200 мм - не более 16 шт. (при необходимости);
- 1.12.3 Кабель отведений (модель 1) размер: 300 мм - не более 16 шт. (при необходимости);
- 1.12.4 Кабель отведений (модель 1) размер: 500 мм - не более 16 шт. (при необходимости);
- 1.12.5 Кабель отведений (модель 1) размер: 1000 мм - не более 16 шт. (при необходимости).
- 1.13. Кабель отведений (модель 2) в вариантах исполнения:
 - 1.13.1 Кабель отведений (модель 2) размер: 100 мм - не более 16 шт. (при необходимости);
 - 1.13.2 Кабель отведений (модель 2) размер: 200 мм - не более 16 шт. (при необходимости);
 - 1.13.3 Кабель отведений (модель 2) размер: 300 мм - не более 16 шт. (при необходимости);
 - 1.13.4 Кабель отведений (модель 2) размер: 500 мм - не более 16 шт. (при необходимости);
 - 1.13.5 Кабель отведений (модель 2) размер: 1000 мм - не более 16 шт. (при необходимости).
- 1.14. Крепежное устройство датчика – не более 32 шт. (при необходимости).
- 1.15. Сенсор тензометрический (модель 1) с крепежным устройством – не более 2 шт. (при необходимости).
- 1.16. Сенсор тензометрический (модель 2) – 1 шт. (при необходимости).
- 1.17. Кабель интерфейсный USB – 1 шт. (при необходимости).
- 1.18. Система видеорегистрации – не более 2 шт. (при необходимости):
 - стойка видеорегистрации – 1 шт.;
 - основание – 1 шт.;
 - опора регулировочная – 4 шт.;
 - адаптер USB – не более 2 шт.;
 - блок питания (модель 2) – не более 2 шт.
- 1.19. Коврик – не более 2 шт. (при необходимости).
- 1.20. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
- 1.21. Паспорт – 1 шт.

Фото транспортной упаковки составных частей Комплекса

Фото транспортных упаковок позиций из состава медицинского изделия, которые поставляется в отдельной транспортной упаковке

Макеты маркировок

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями «БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023 (Общий вид изделия)

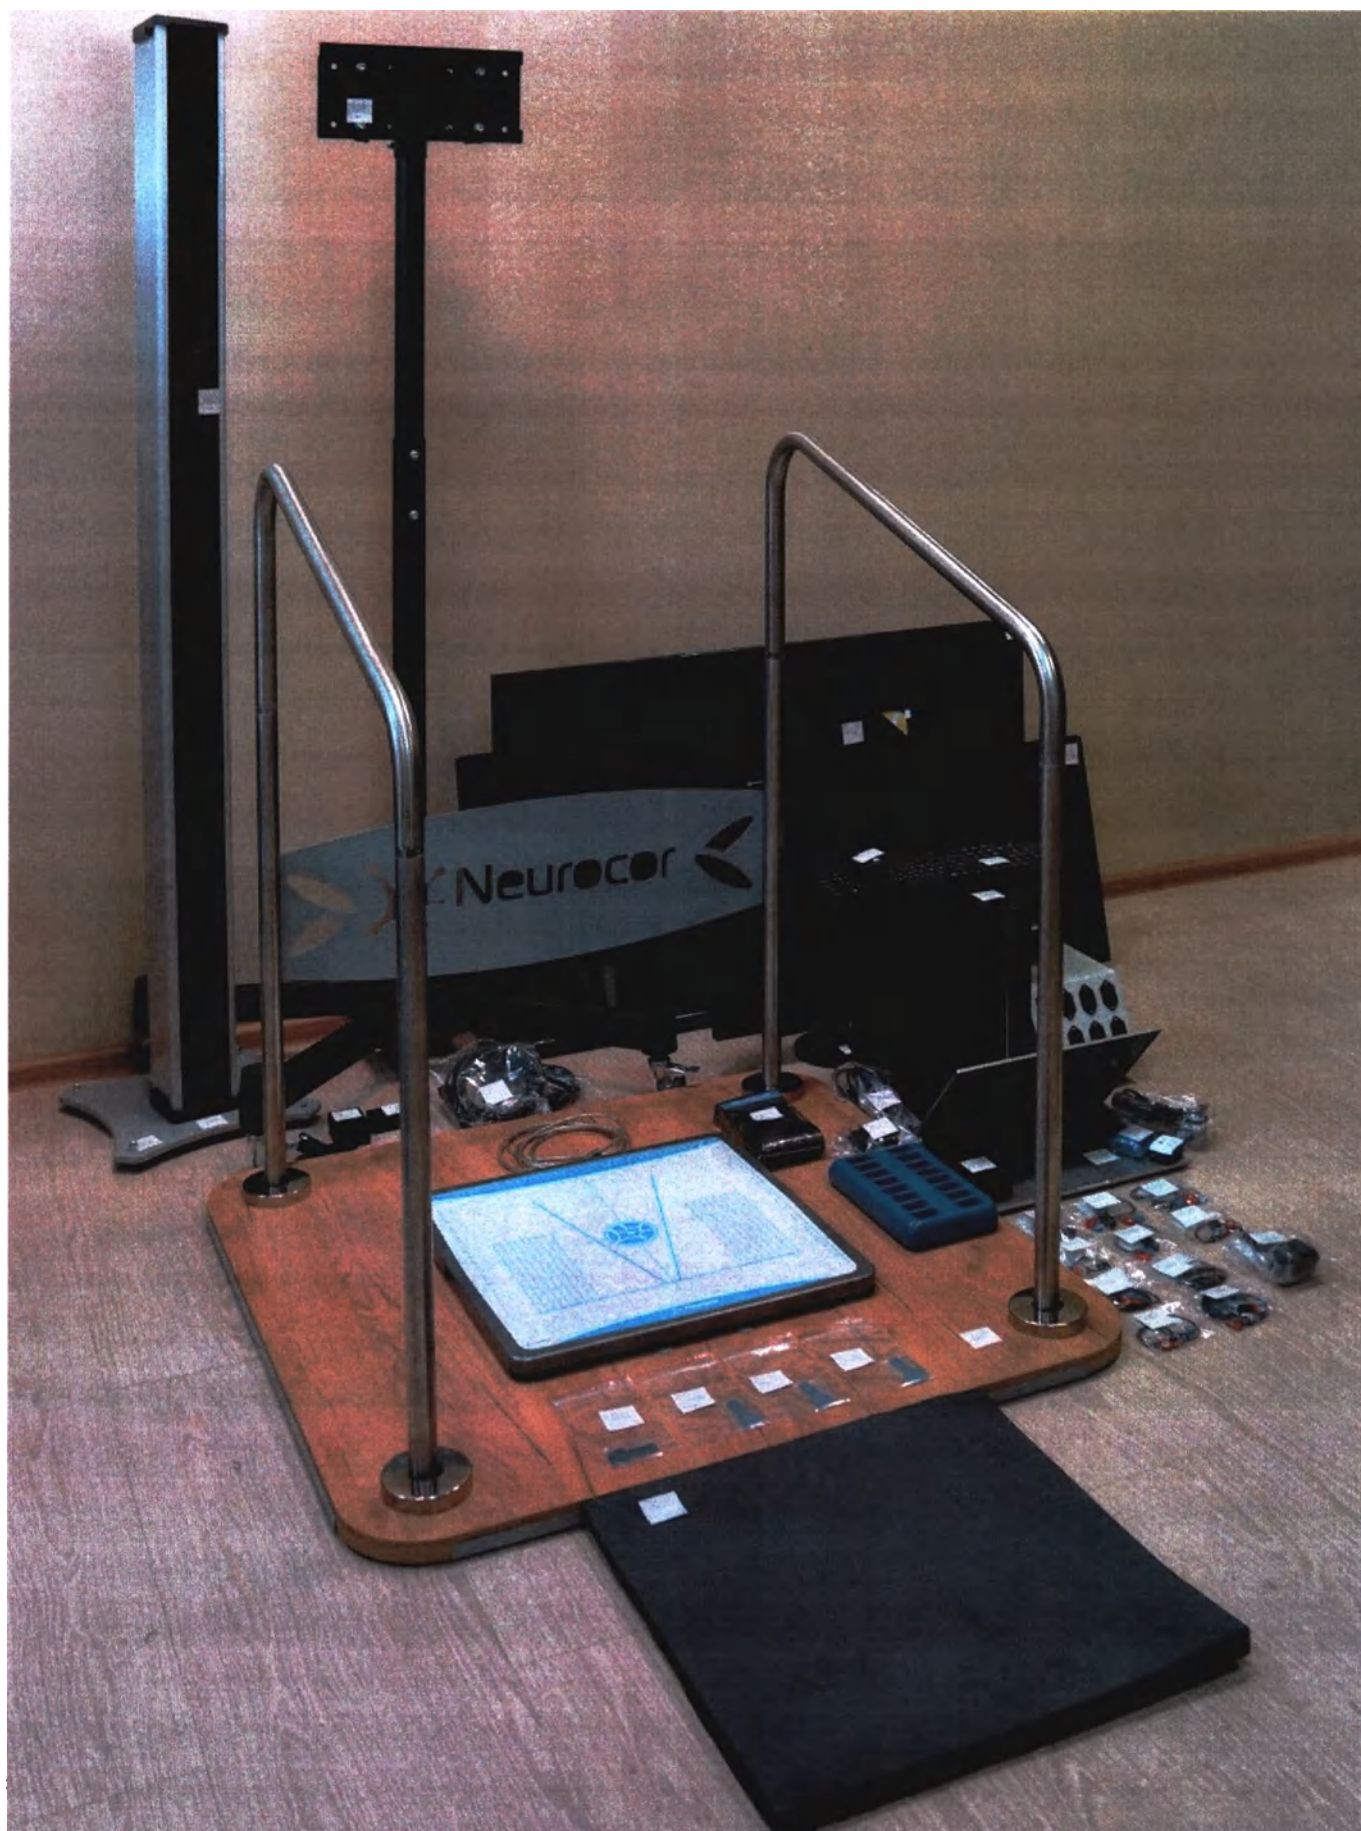

1.1. Датчик биомеханический носимый – не более 16 шт.



1.2. Дисплей Модуля БОС в вариантах исполнения - 1 шт. (при необходимости):

1.2.1. Дисплей (модель БОС30) – 1 шт. (при необходимости);

1.2.2. Дисплей (модель БОС40) – 1 шт. (при необходимости);

1.2.3. Дисплей (модель БОС50) – 1 шт. (при необходимости).



1.3. Стойка Модуля БОС – 1 шт. (при необходимости).




1.4. Стабилоплатформа – не более 2 шт. (при необходимости).



1.5. Зарядное устройство в вариантах исполнения (при необходимости):

1.5.1. Зарядное устройство (модель 1) – не более 16 шт. (при необходимости);

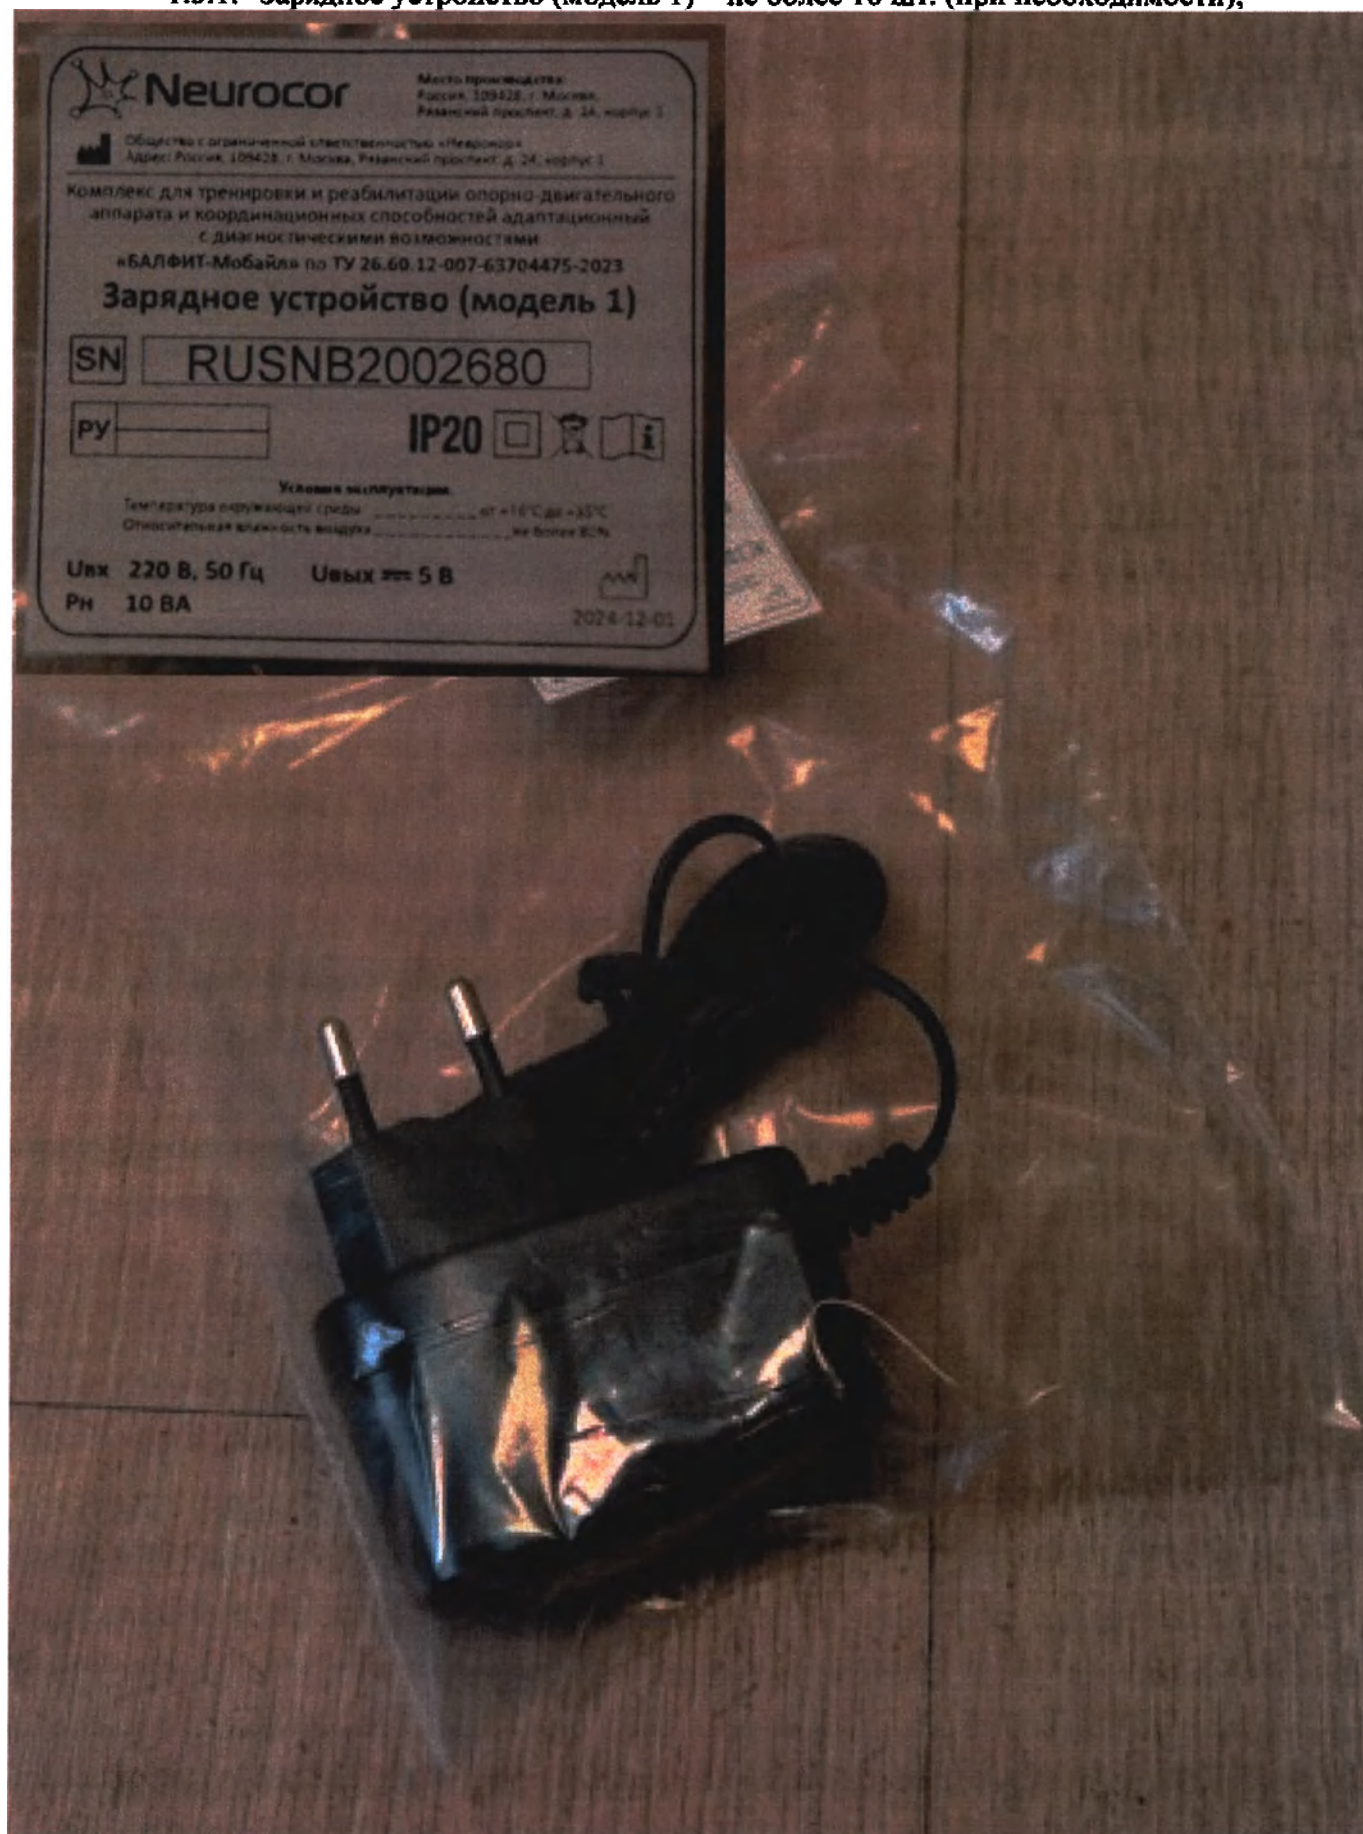





 **Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 26, корпус 1

Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 26, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями
«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок питания (модель 1)

SN **RUSNB2003029**

ПУ


IP20    


Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды от +10°C до +35°C
Относительная влажность воздуха не более 80%

Uвх 220 В, 50 Гц Uвых 18 В
Pн 40 ВА

 2024-12-01

1.6. ПО «Биомеханика Неврокор» на электронном носителе – 1 шт.

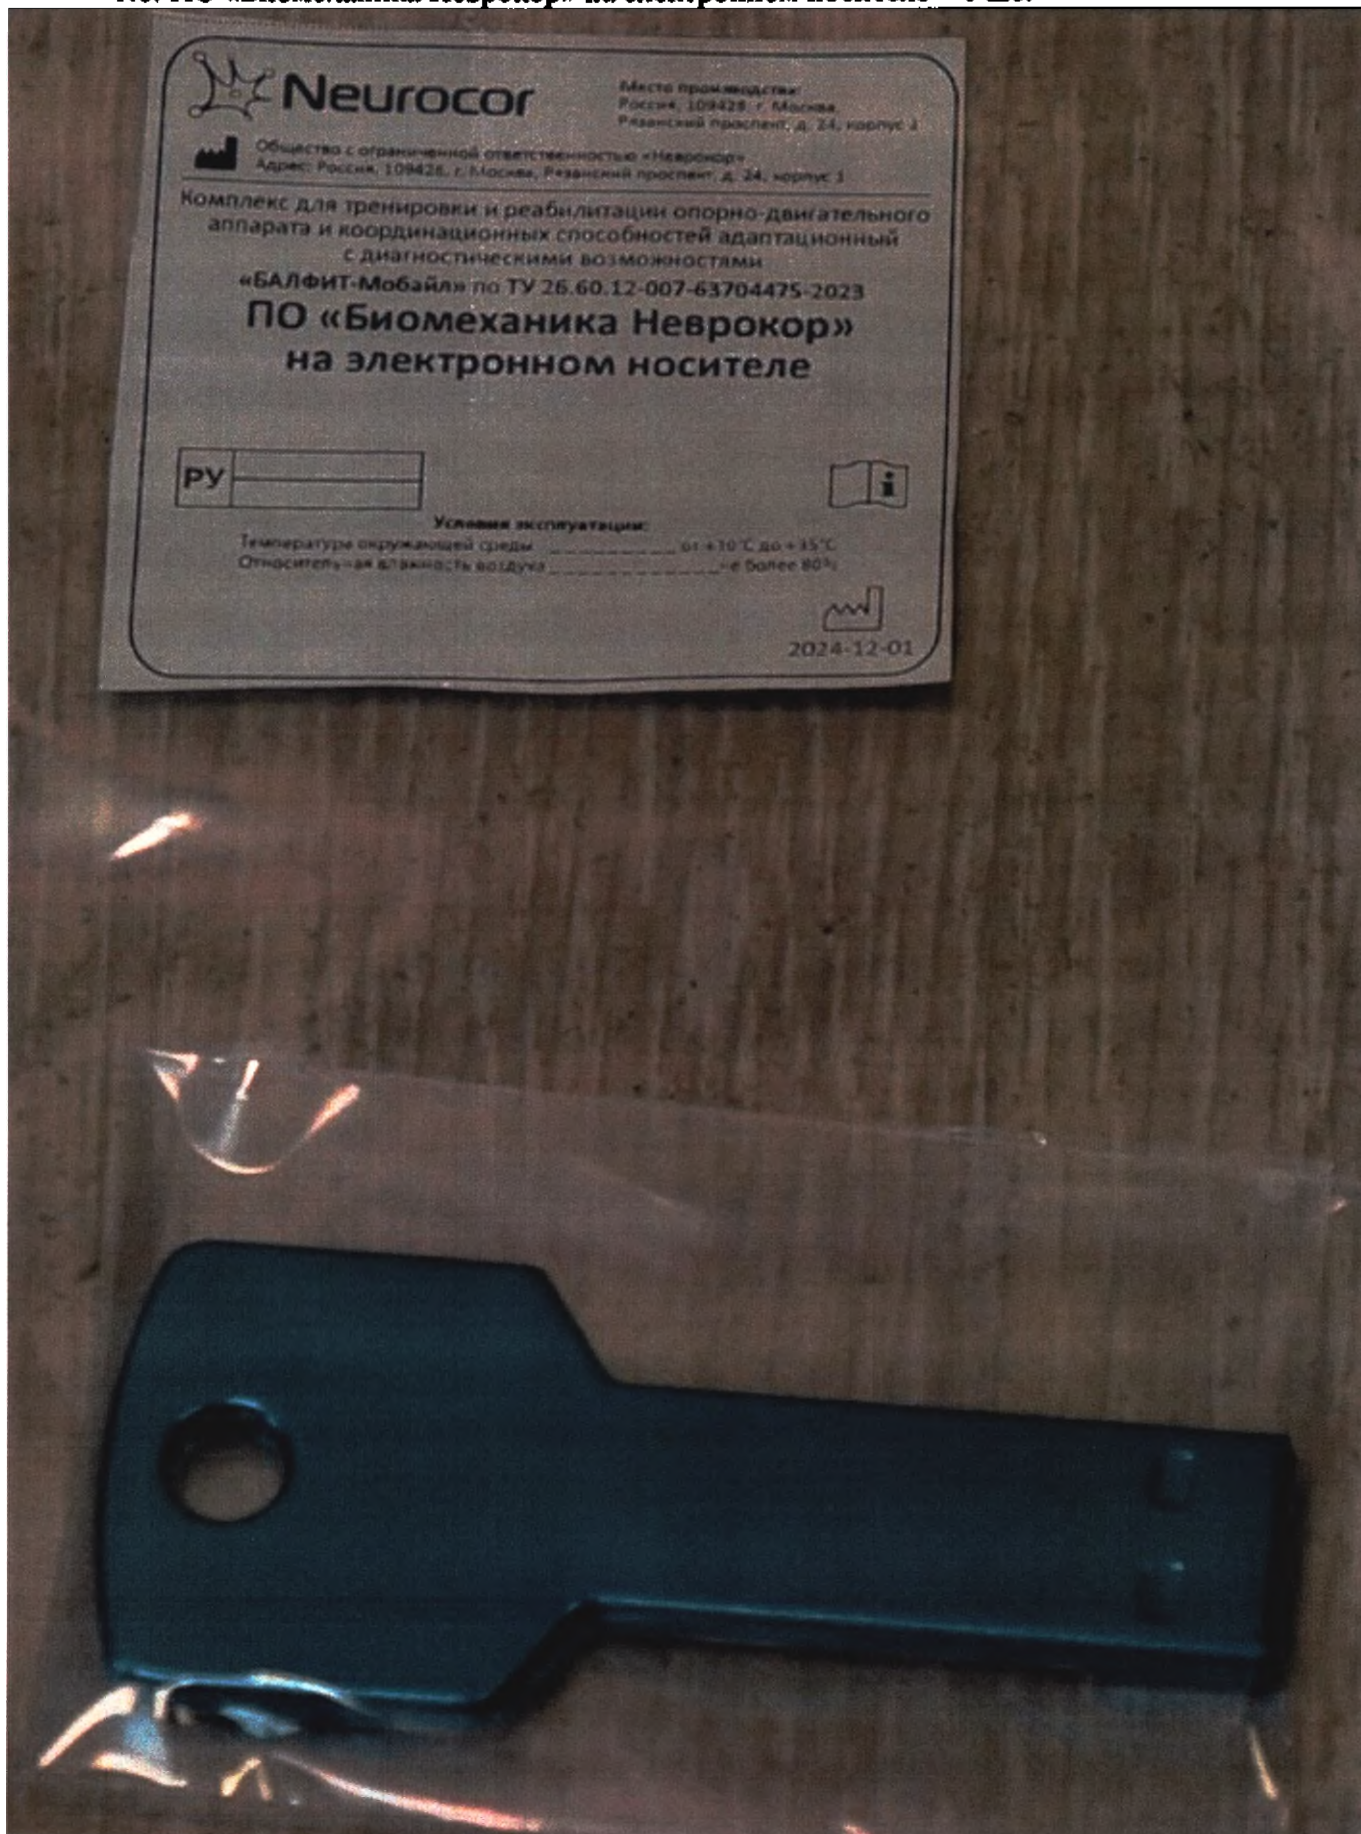

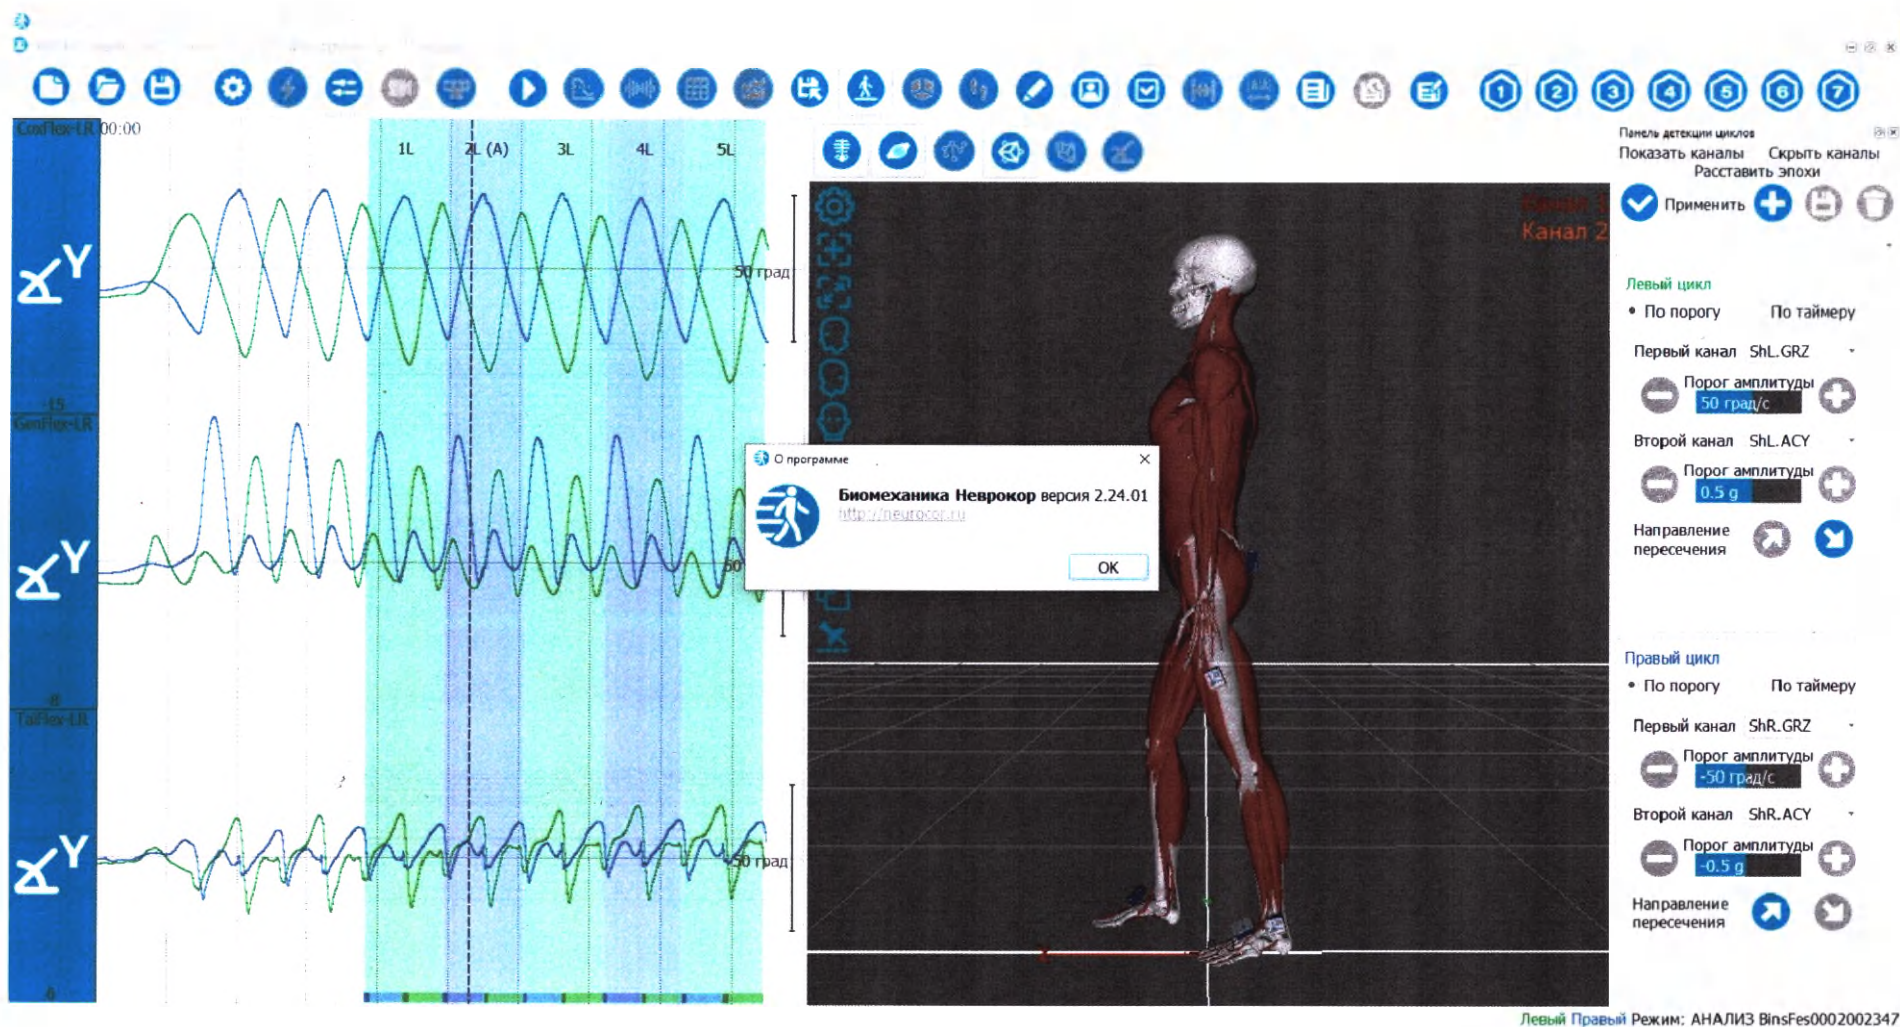

О программе


Биомеханика Неврокор версия 2.24.01

www.neurokor.ru

OK

1.7. ПО «Стабилометрия Неврокор» на электронном носителе – 1 шт. (при необходимости).



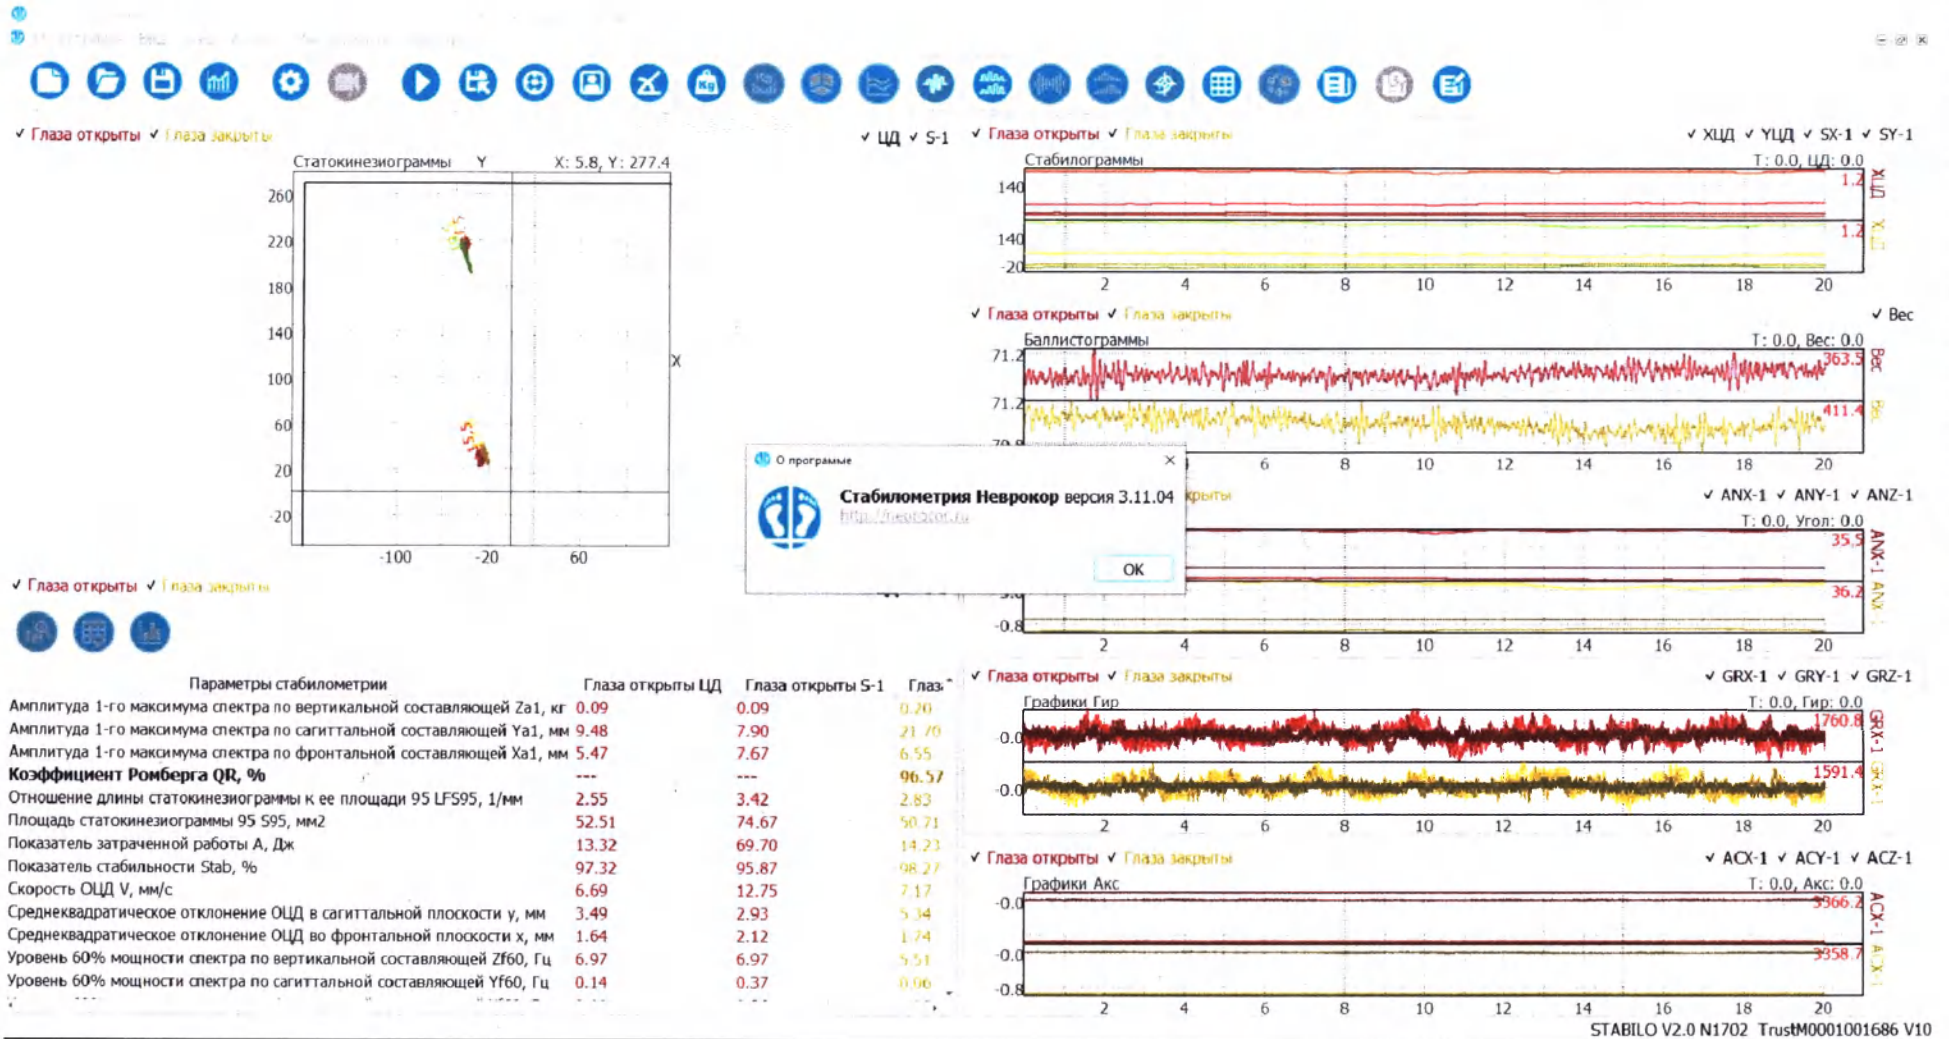


1.8. Блок управления и анализа информации в вариантах исполнения – 1 шт. (при необходимости):

1.8.1. Блок управления и анализа информации в версии ПК – 1 шт. (при необходимости):


- системный блок – 1 шт.;



- монитор – не более 2 шт.;

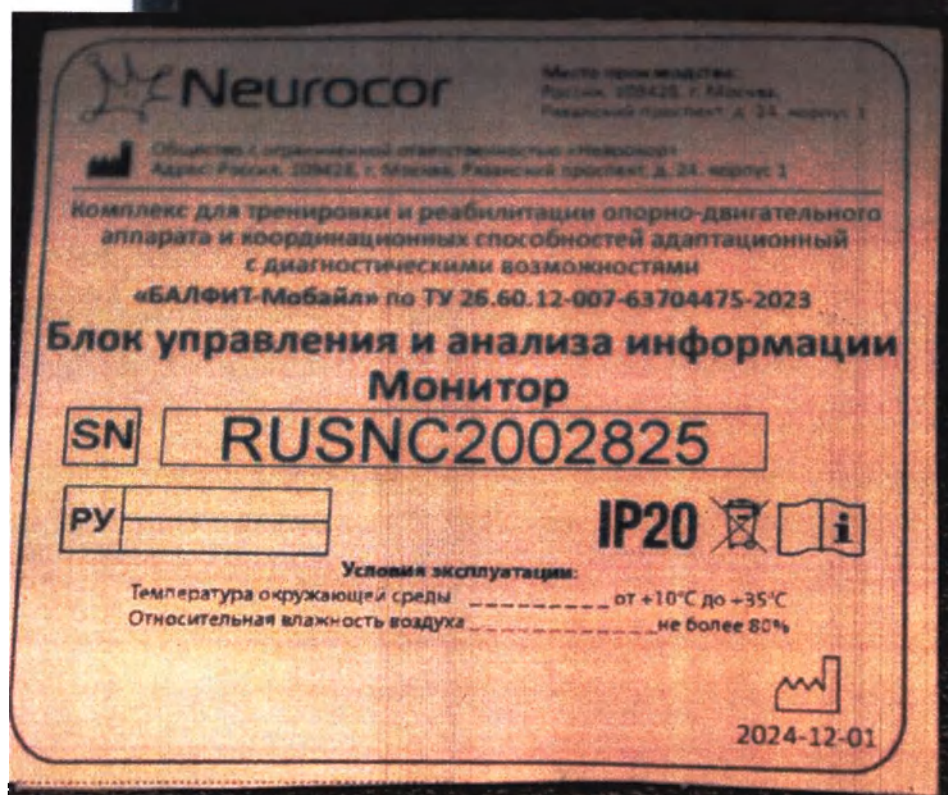

- клавиатура – 1 шт.;

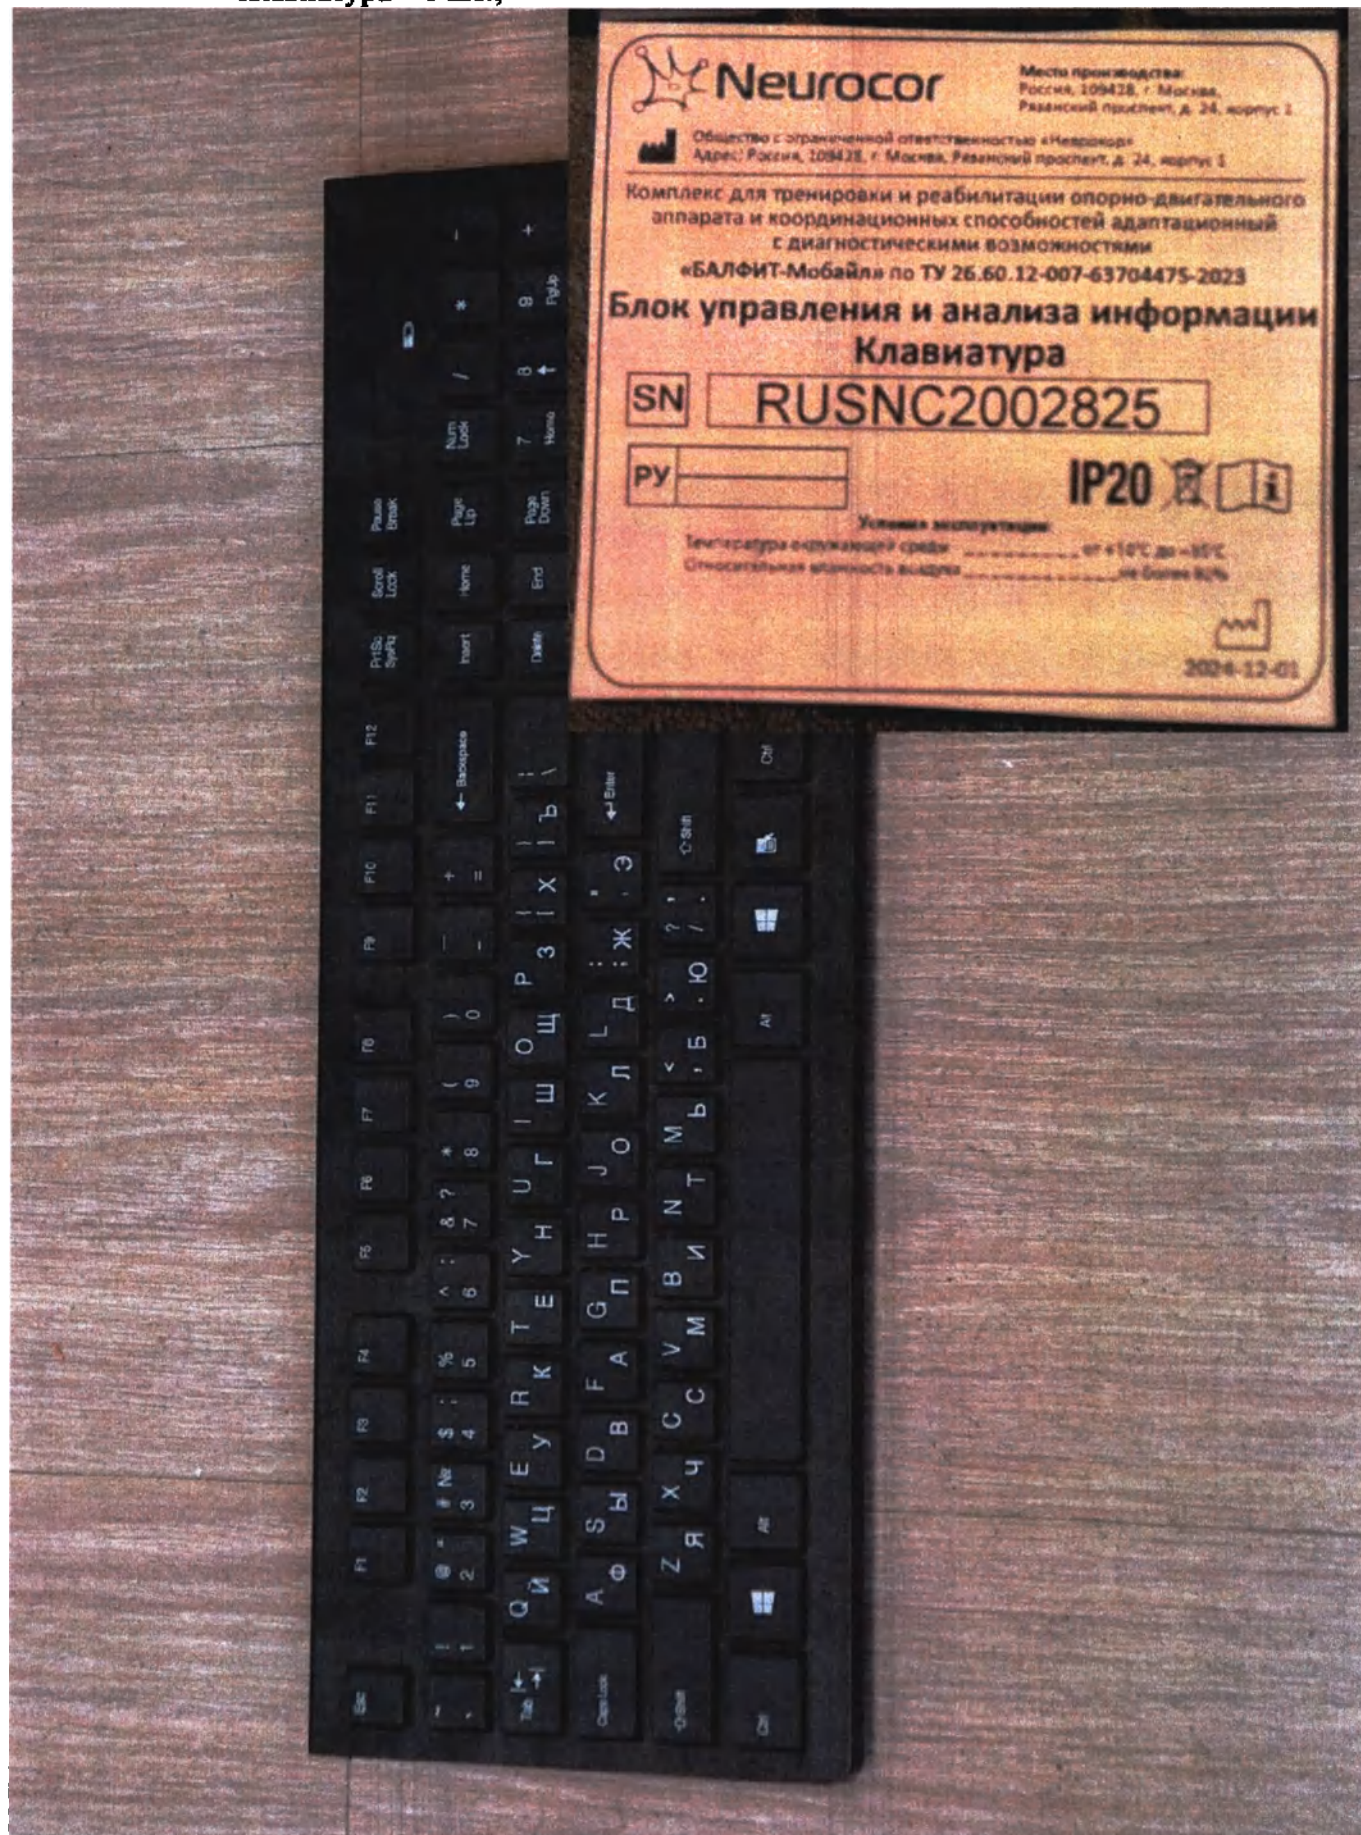

- мышь - 1 шт.;



 **Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями
«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок управления и анализа информации
Мышь

SN

PU

IP20  


Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды _____ от +10°C до +35°C
Относительная влажность воздуха _____ не более 80%


2024-12-01

- кабель питания C13 – не более 3 шт.;



- кабель питания C13-C14 – не более 5 шт.;

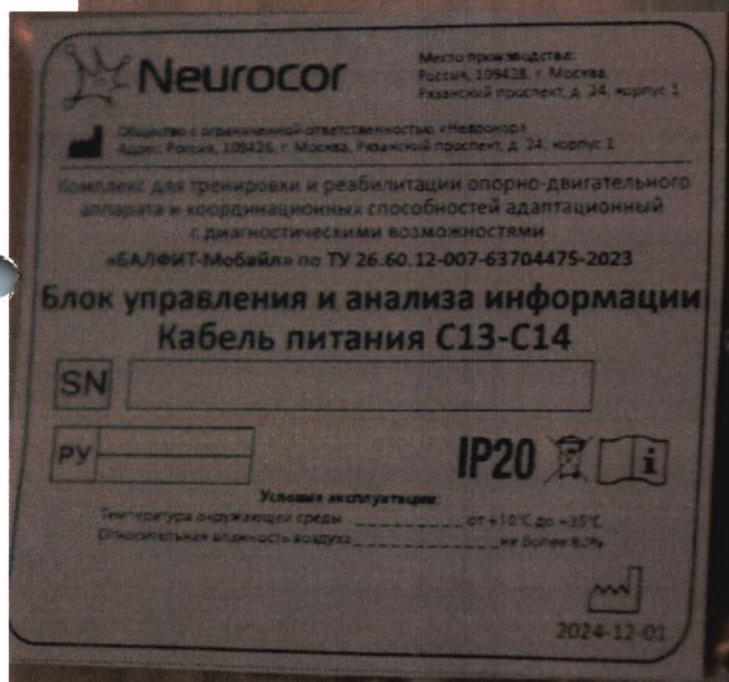

- кабель видеосигнала – не более 3 шт.;



 **Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями
«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок управления и анализа информации
Кабель видеосигнала

SN

PU

IP20  


Условия эксплуатации:
Температура окружающей среды _____ от +10 °C до +35 °C
Относительная влажность воздуха _____ не более 80%


2024-12-01

- адаптер – 1 шт.




- 1.8.2. Блок управления и анализа информации в версии ноутбук – 1 шт. (при необходимости):
- ноутбук – 1 шт.;

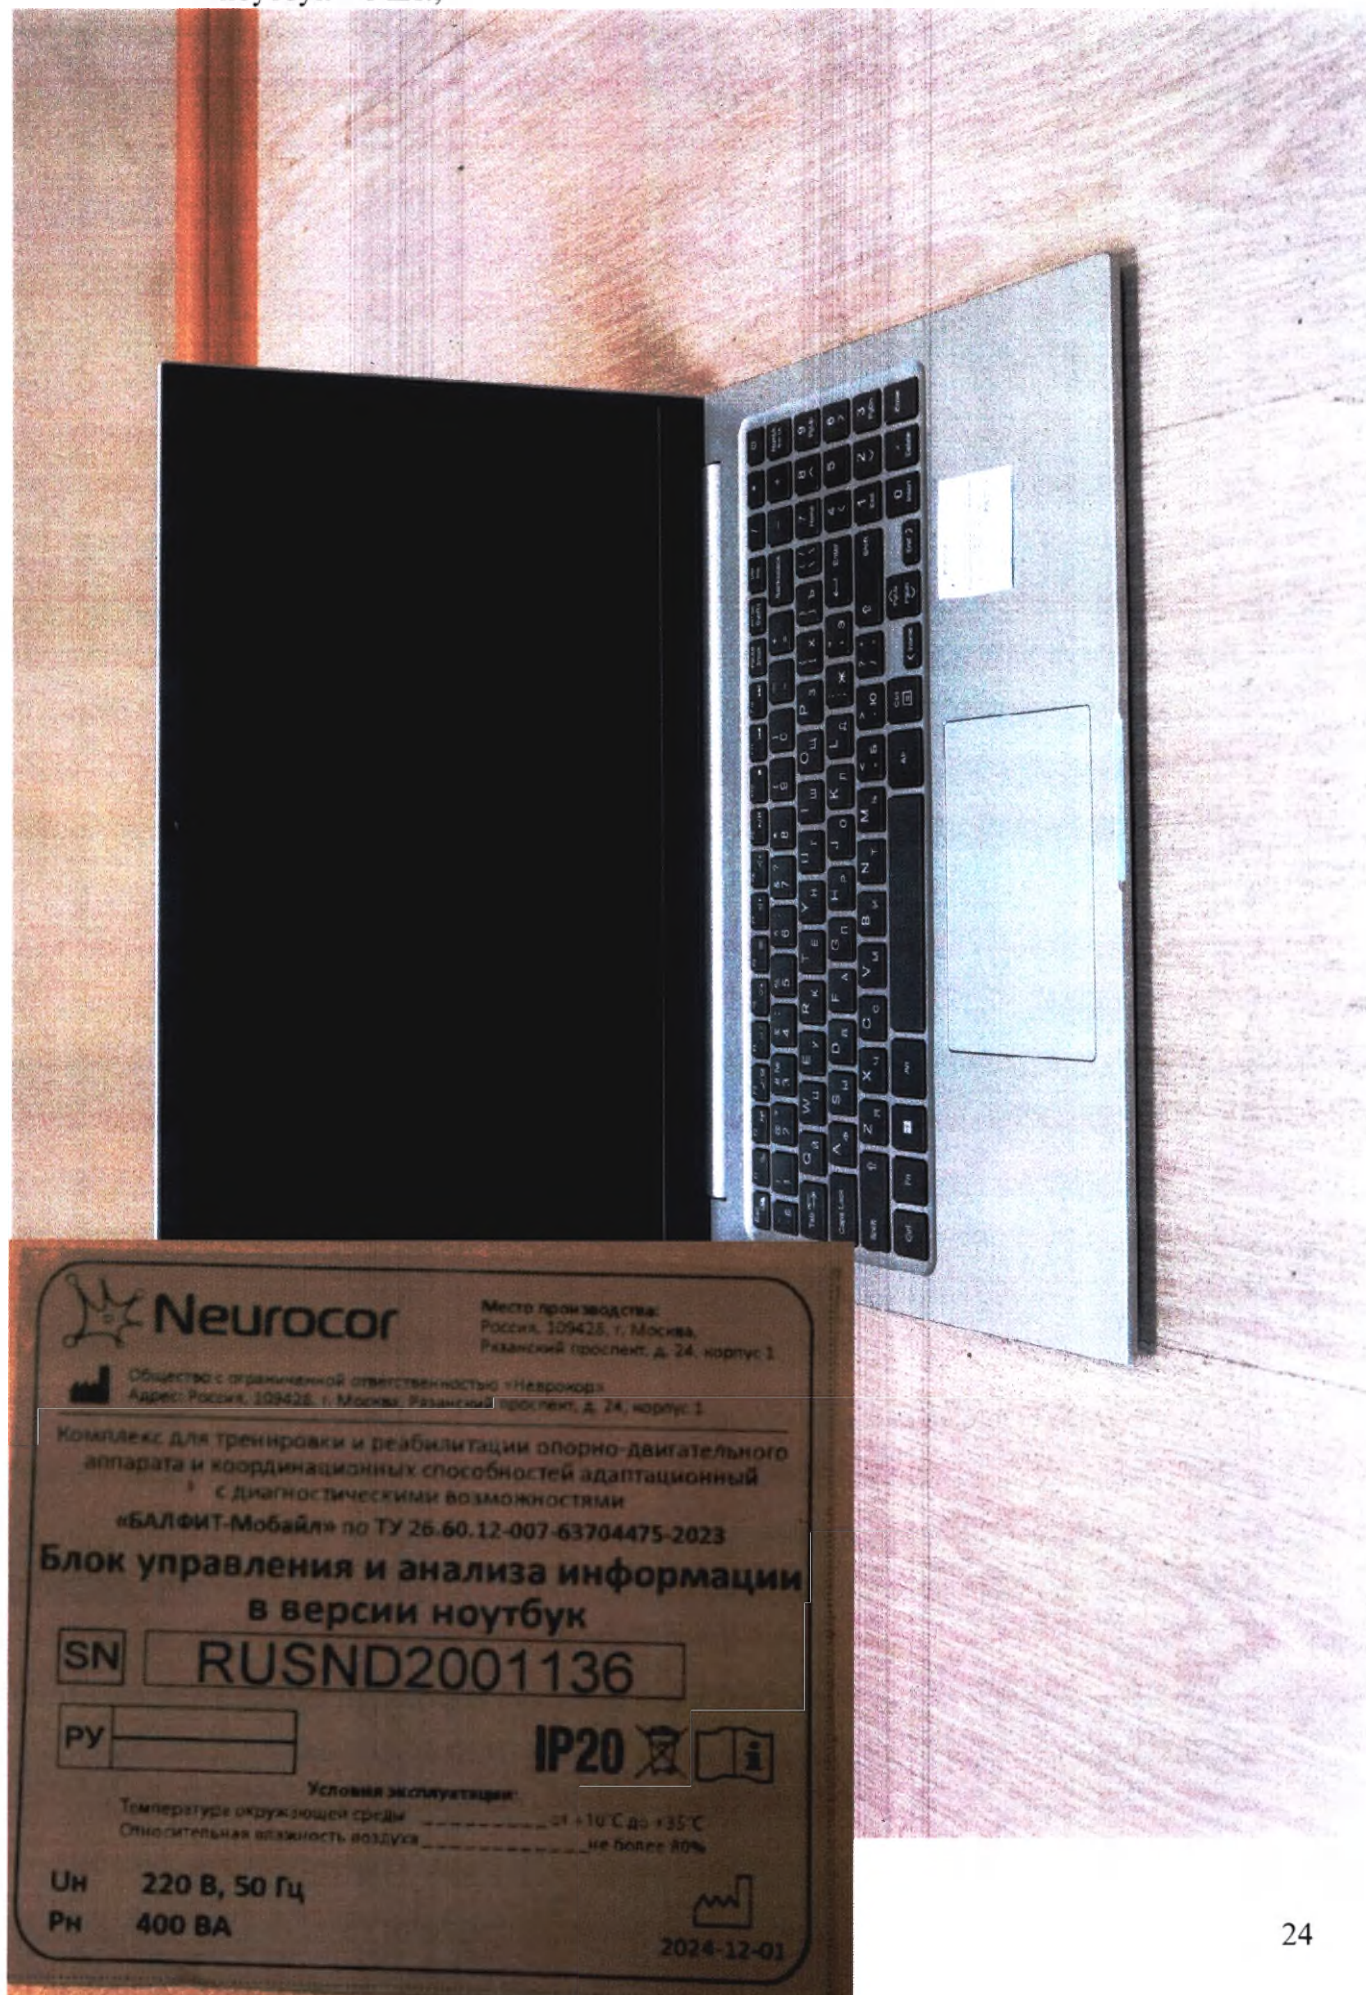



- адаптер – 1 шт.;



- кабель видеосигнала – 1 шт.;

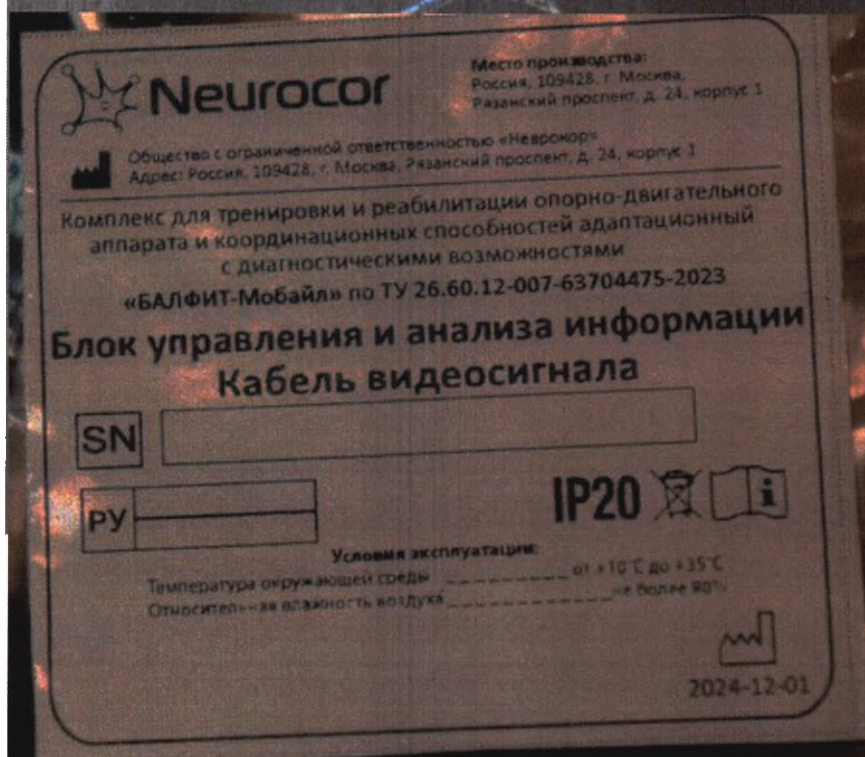

- кабель питания – не более 2 шт.;

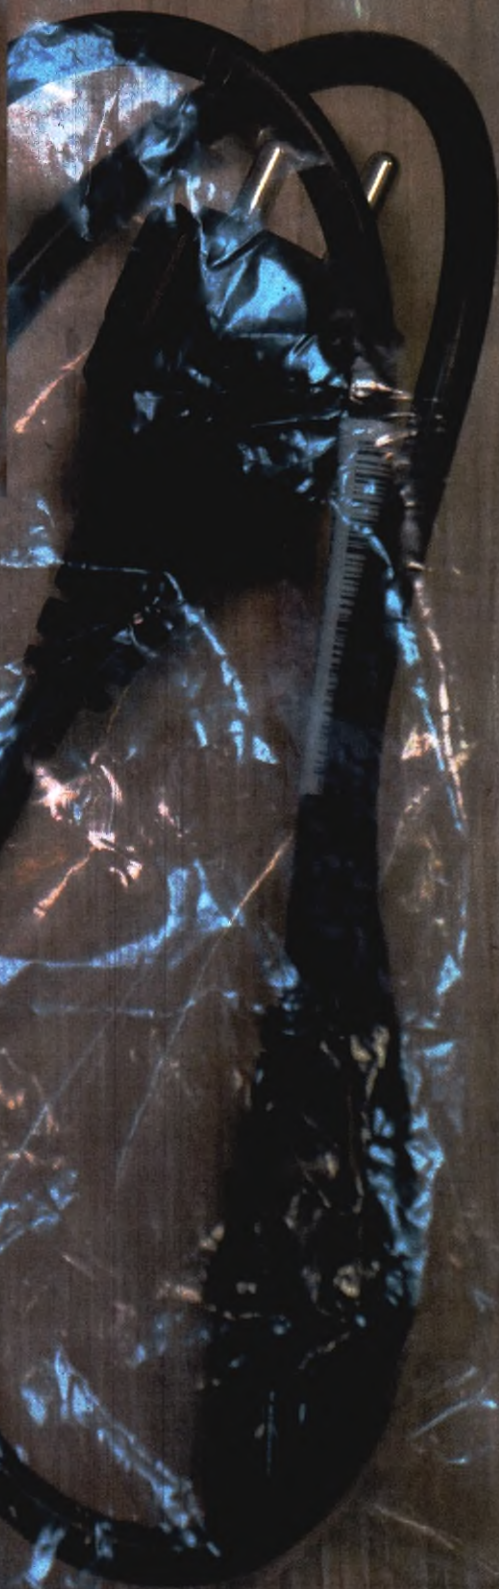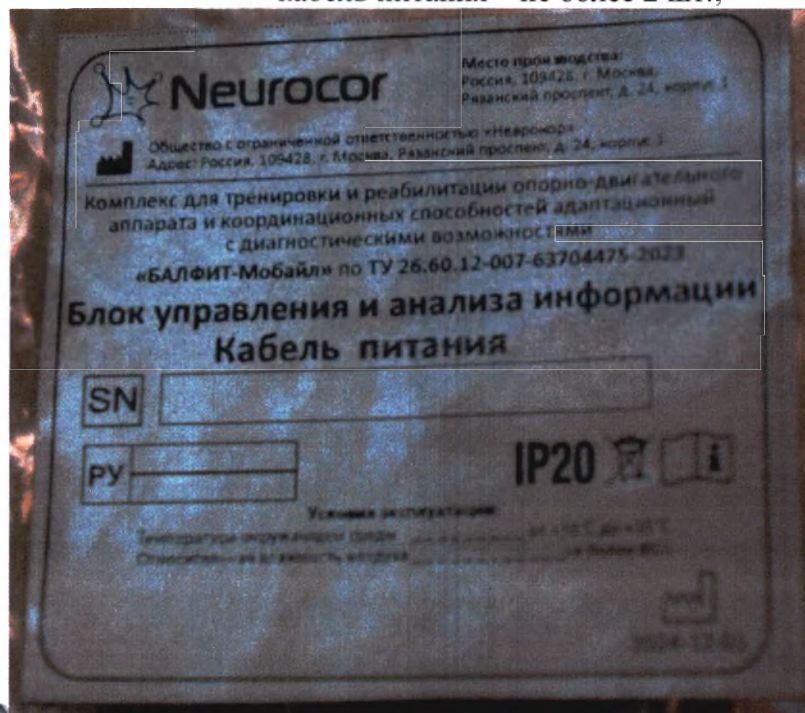

- мышь - 1 шт.





	Neurocor	Место производства: Россия, 109428, г. Москва, Рахмановский проспект, д. 24, корпус 1
	Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор» Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рахмановский проспект, д. 24, корпус 1	
Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями «БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023		
Блок управления и анализа информации		
Мышь		
SN		
PU		
IP20		 
Условия эксплуатации:		
Температура окружающей среды		от +10°C до +35°C
Относительная влажность воздуха		не более 85%
		
2024-12-01		

1.9. Пандус с перилами для стабиллоплатформы – 1 шт. (при необходимости).




1.10. ПО «3D сканер Неврокор» на электронном носителе - 1 шт. (при необходимости).

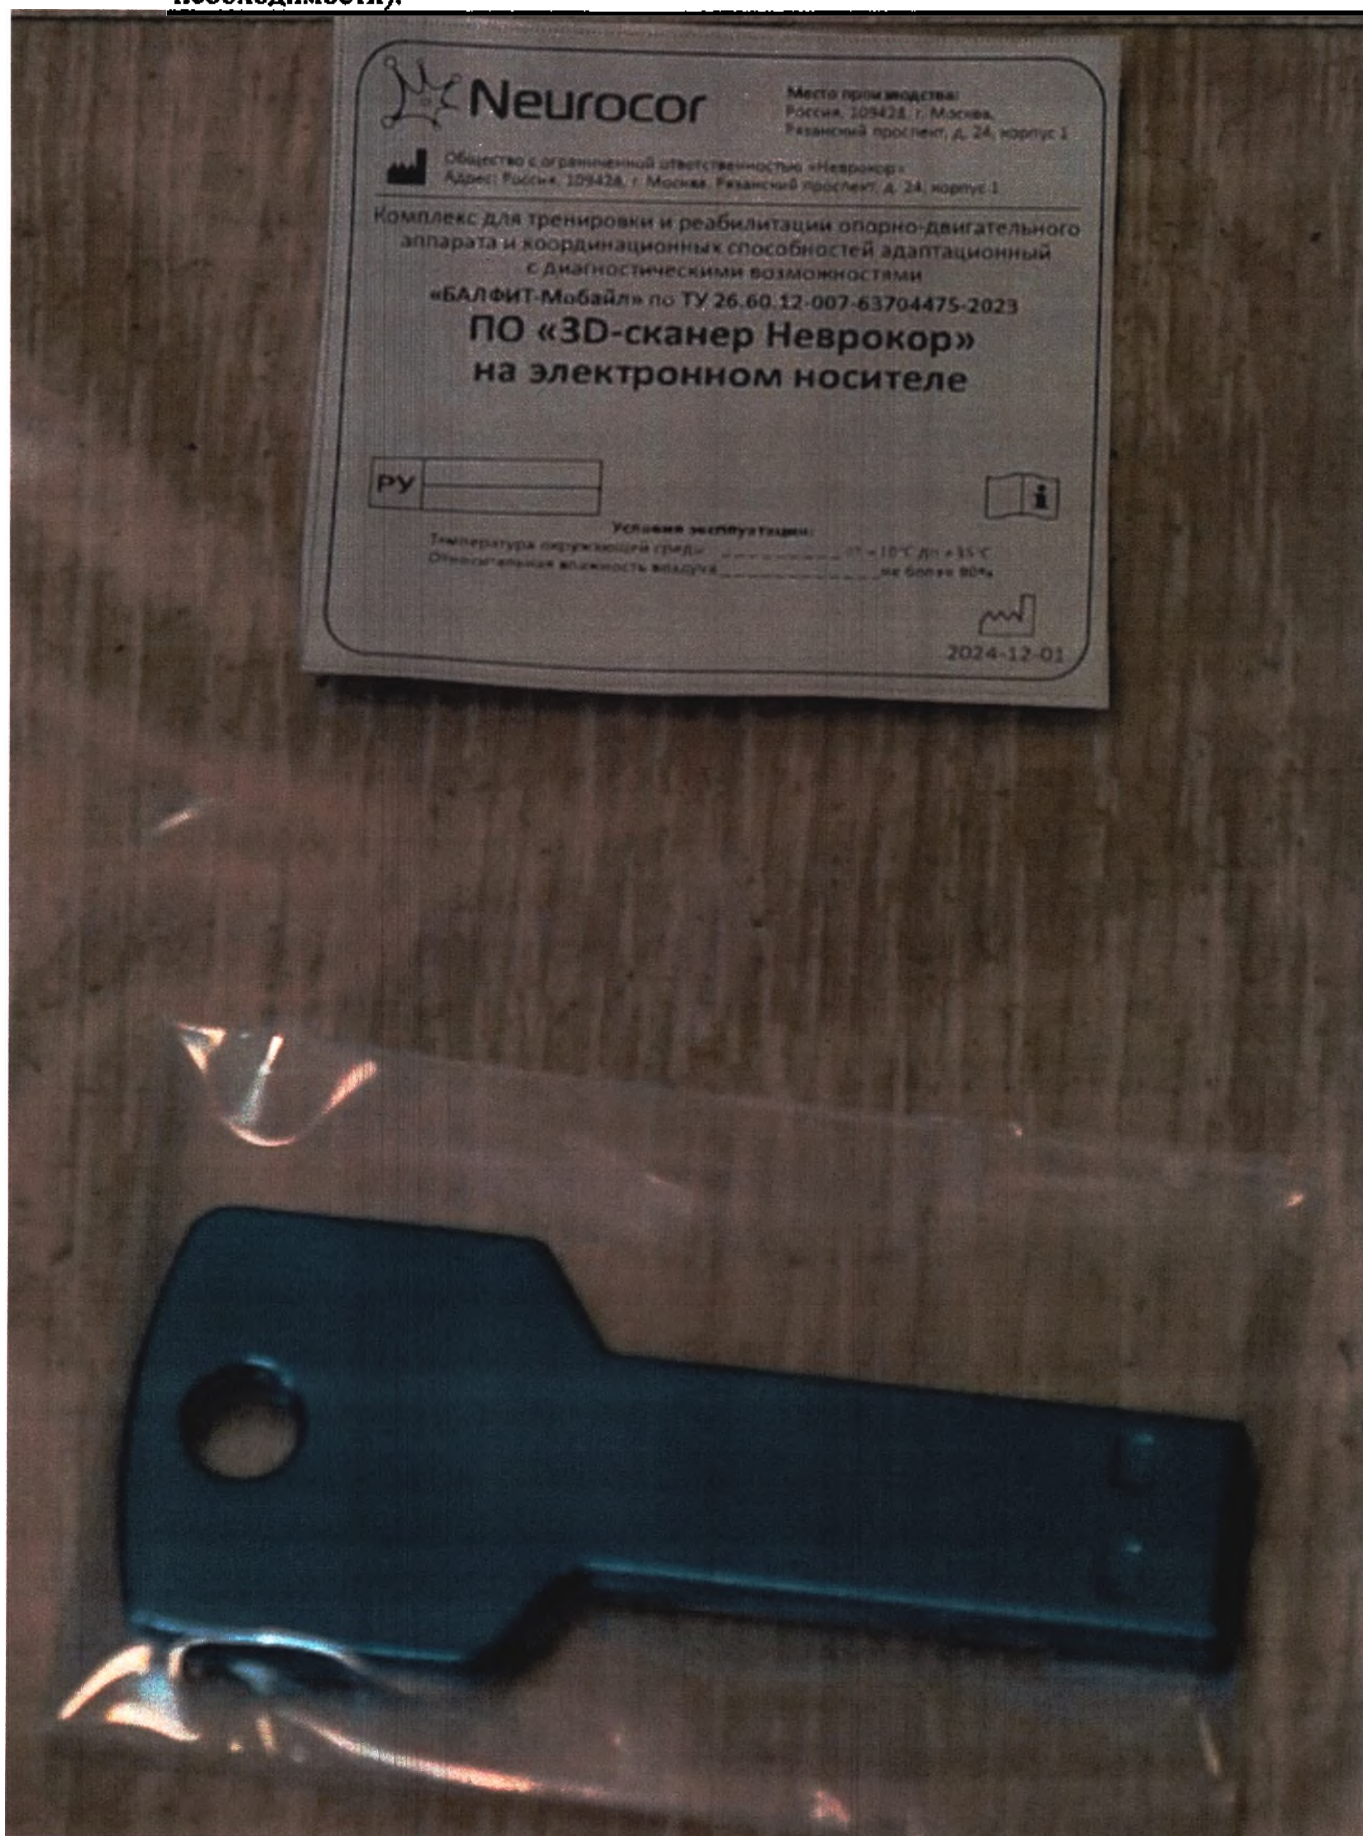

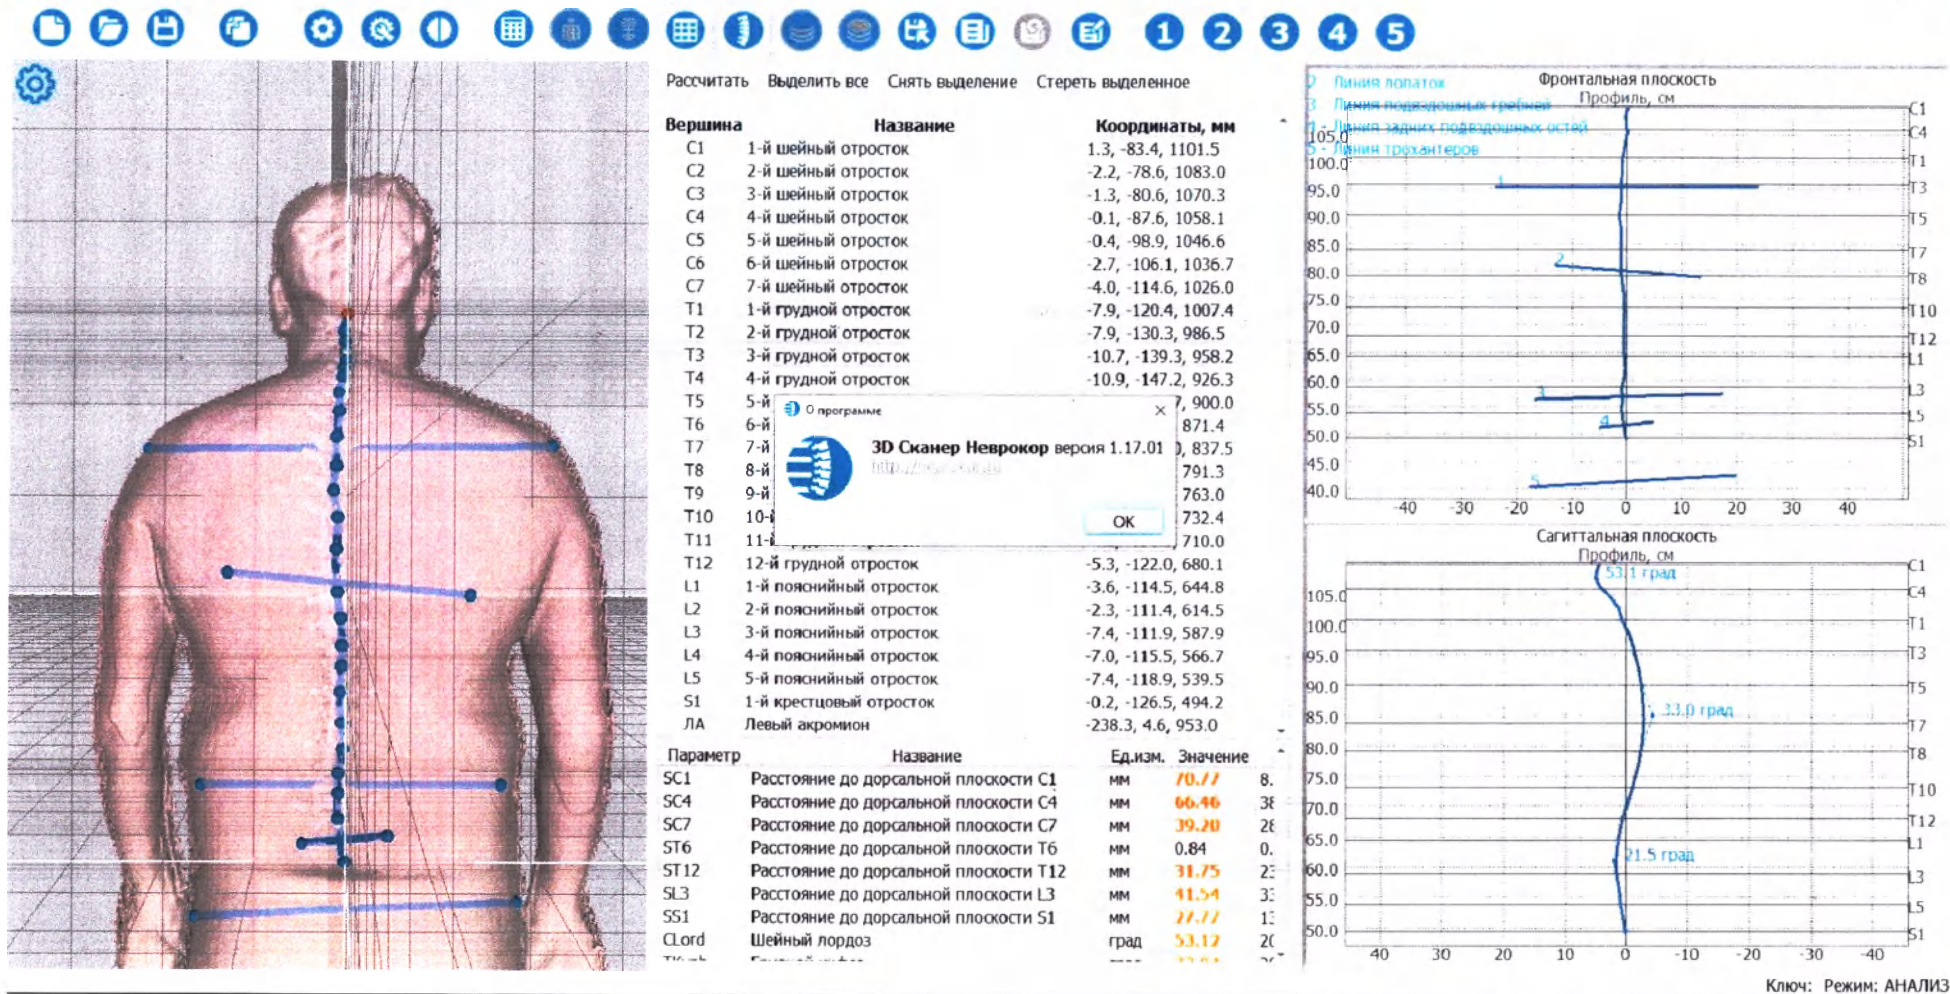

1.11. ПО «Программа для управления базой данных Неврокор» на электронном носителе - 1 шт. (при необходимости).

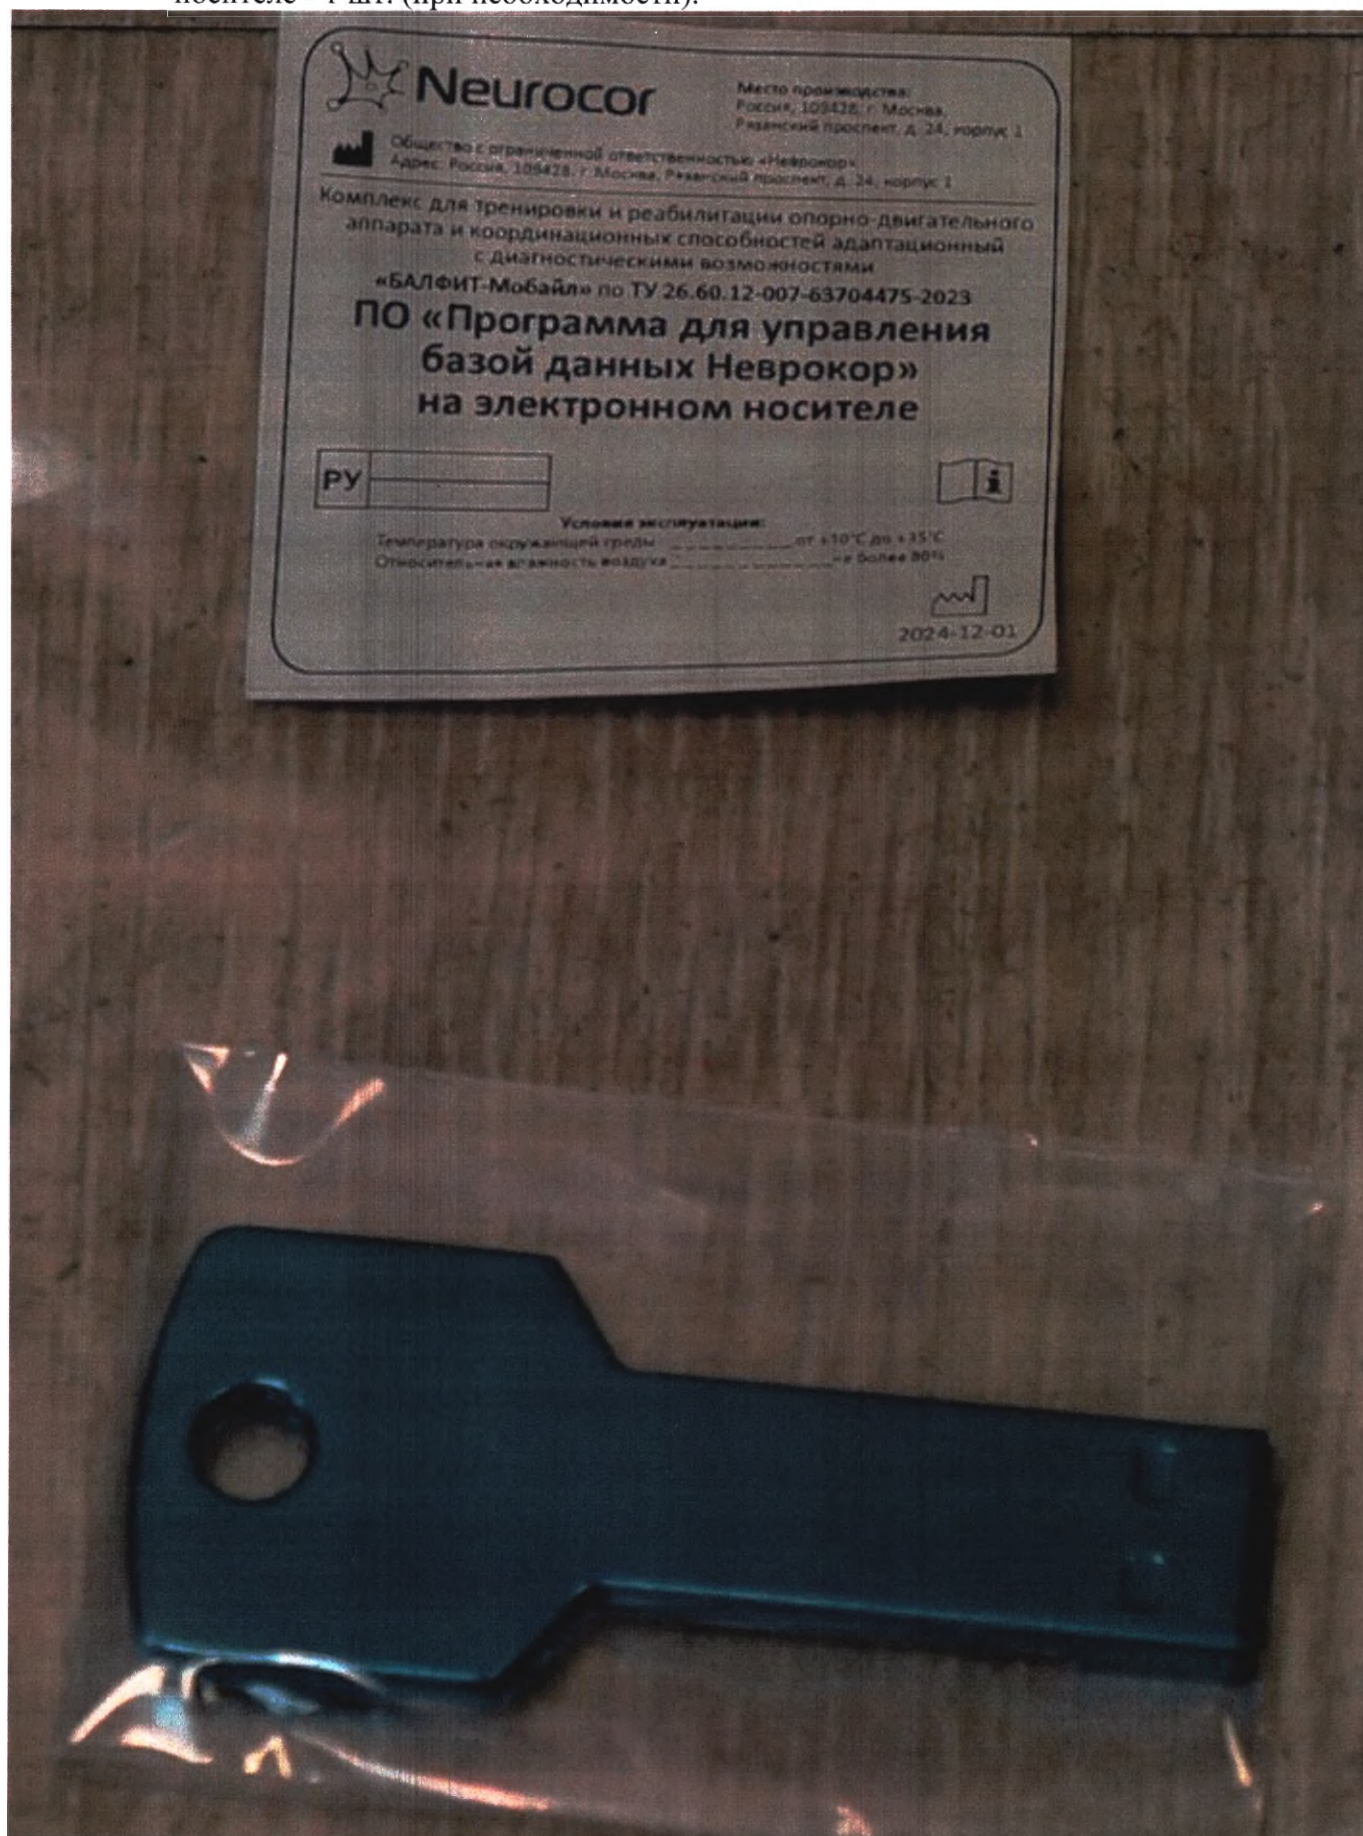

Пациент: **Фильтр:** все пациенты

Поиск:

	Фамилия	Имя	Отчество	Пол	Дата рождения	Характеристика полости рта	Дата регистрации	Номер карты	Врач	Диагноз
1	sve	123		M	1980-01-01		2024-10-08	swe-123--01011980		
2	dfg	234		M	1980-01-01		2024-10-08	dfg-234--01011980		
3	4	24		M	1980-01-31		2024-09-06	4-24--31011980		
4	Тестов	Тест		M	1980-01-01		2024-10-10	Тестов-Тест--01011980		

База данных пациентов
Версия 1.05.05
ООО «Неврокор»
[www.neurocor.ru](#)


OK

Диагностика:


Номер регистрации	Тип	Методика	Статус	Заключение	Дата и время регистрации	Экземпляр (МБай)	Примечание кatalogу реги
1 БИОМЕХАНИКА-06092024-145213	БИОМЕХАНИКА	гепстех	Продиагн...	Проанализировано	2024-06-09 14:52	1.07067	C:...
2 БИОМЕХАНИКА-06092024-145819	БИОМЕХАНИКА	гепстех	Продиагн...	Не проанализировано	2024-09-06 14:58	0.986668	C:...
3 СТАБИЛО-17102024-131448	СТАБИЛО	не определена	Продиагн...	Не проанализировано	2024-10-17 13:14	0.23547	C:...

1.12. Кабель отведений (модель 1) в вариантах исполнения:


1.12.1 Кабель отведений (модель 1) размер: 100 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

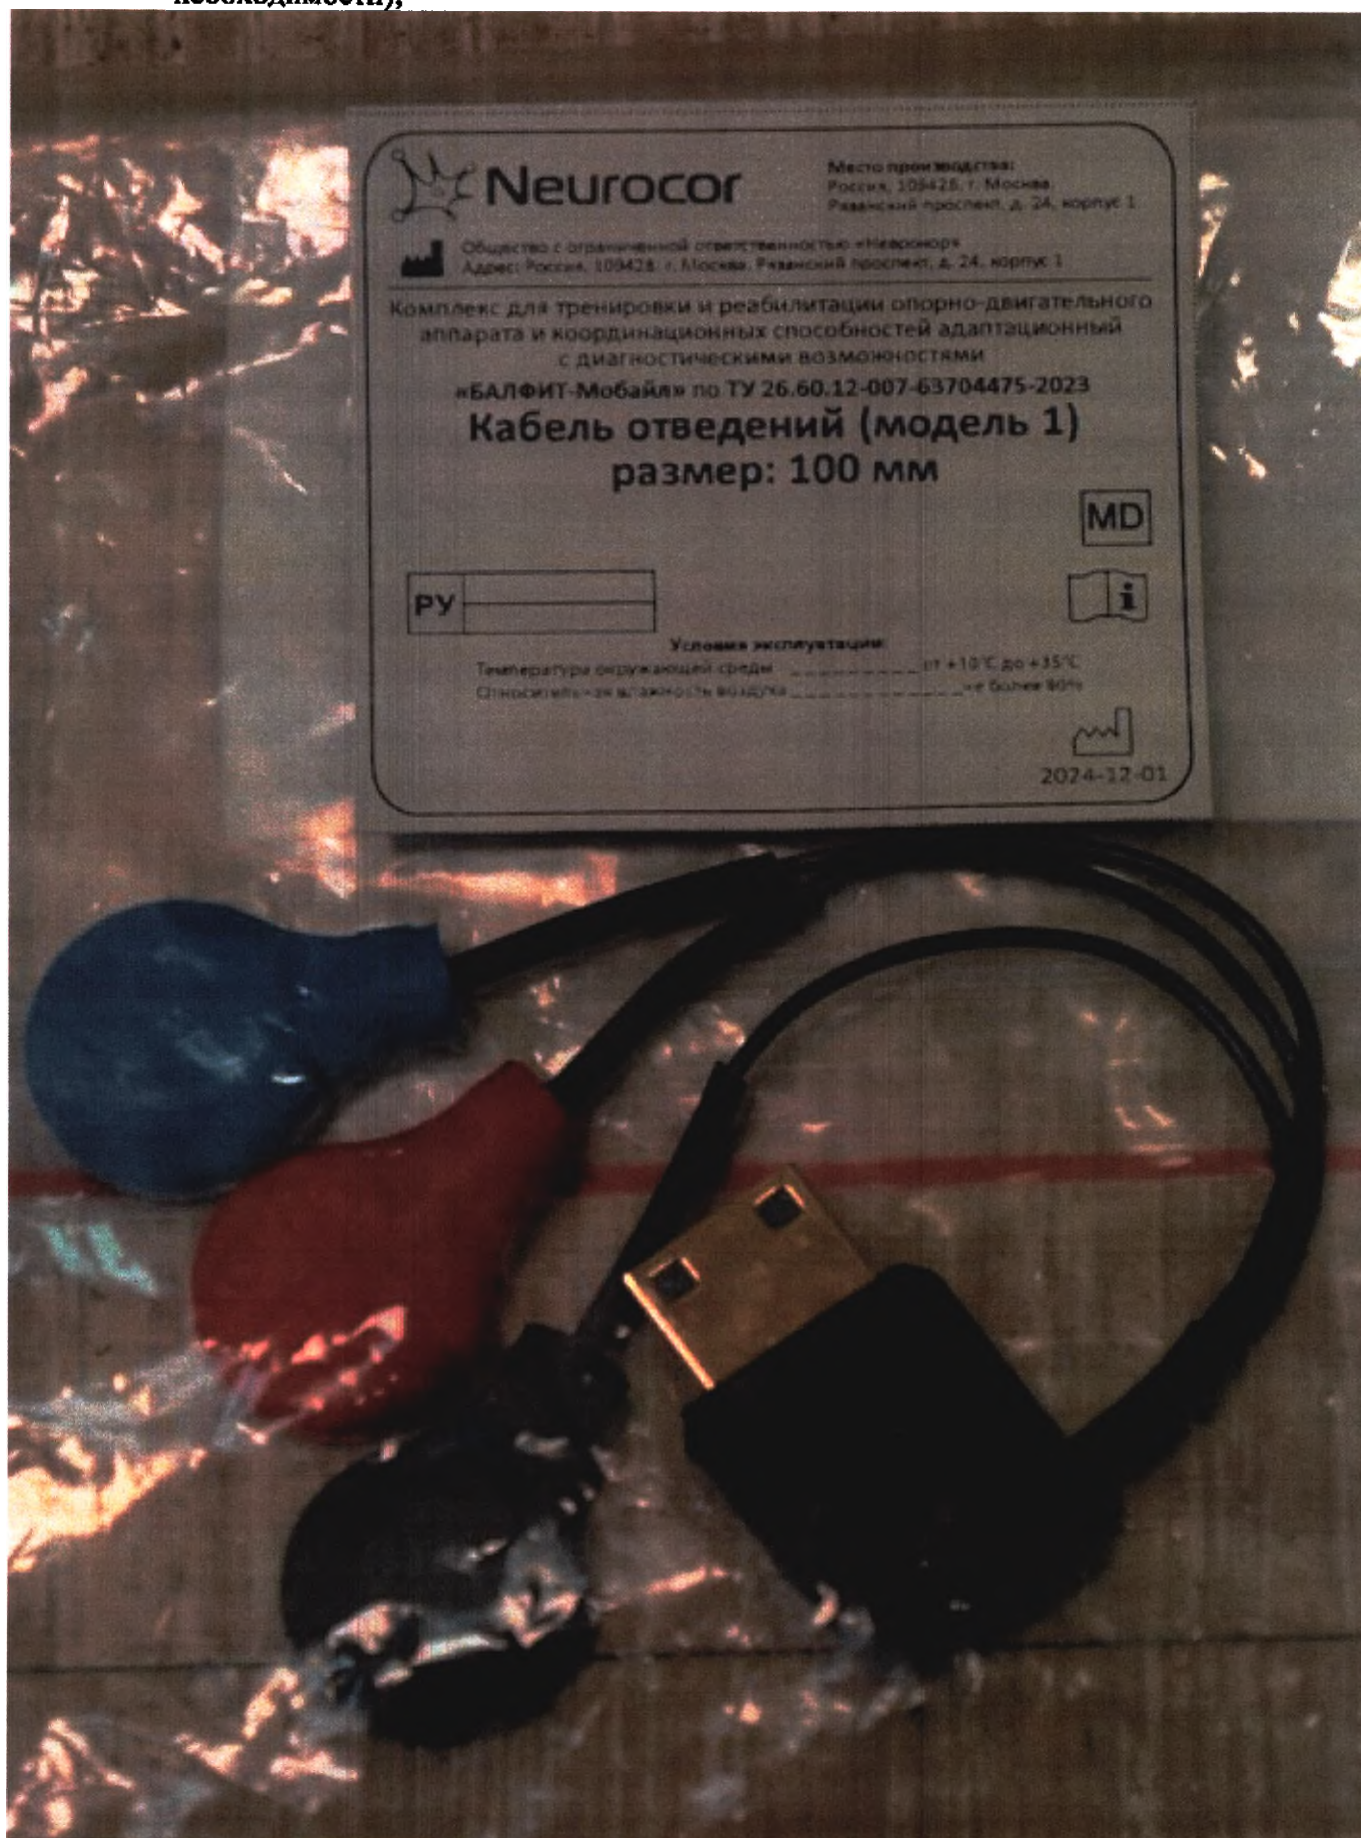


1.12.2 Кабель отведений (модель 1) размер: 200 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

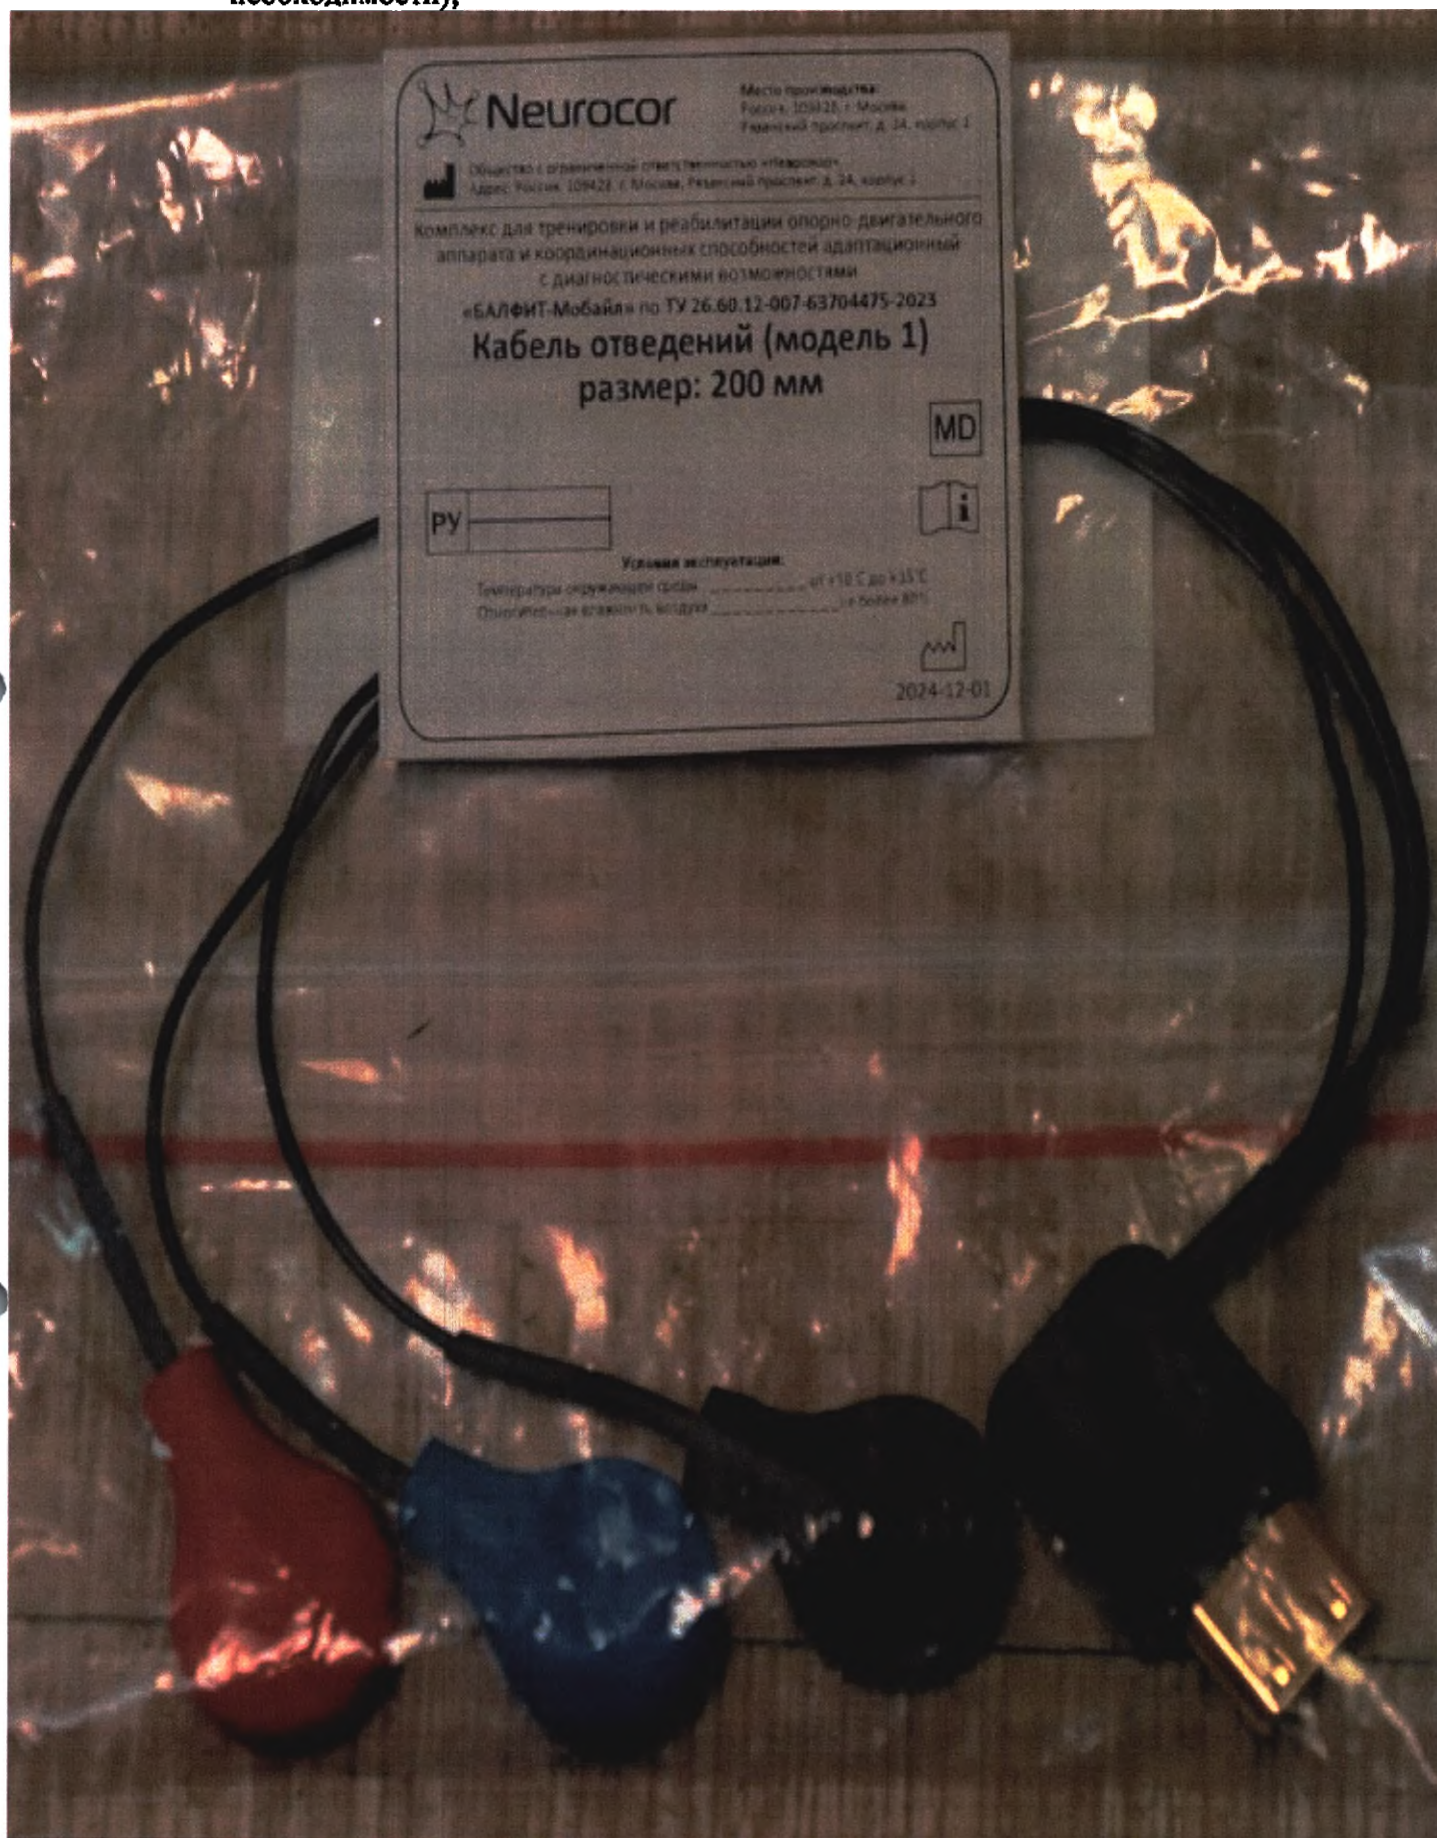

1.12.3 Кабель отведений (модель 1) размер: 300 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

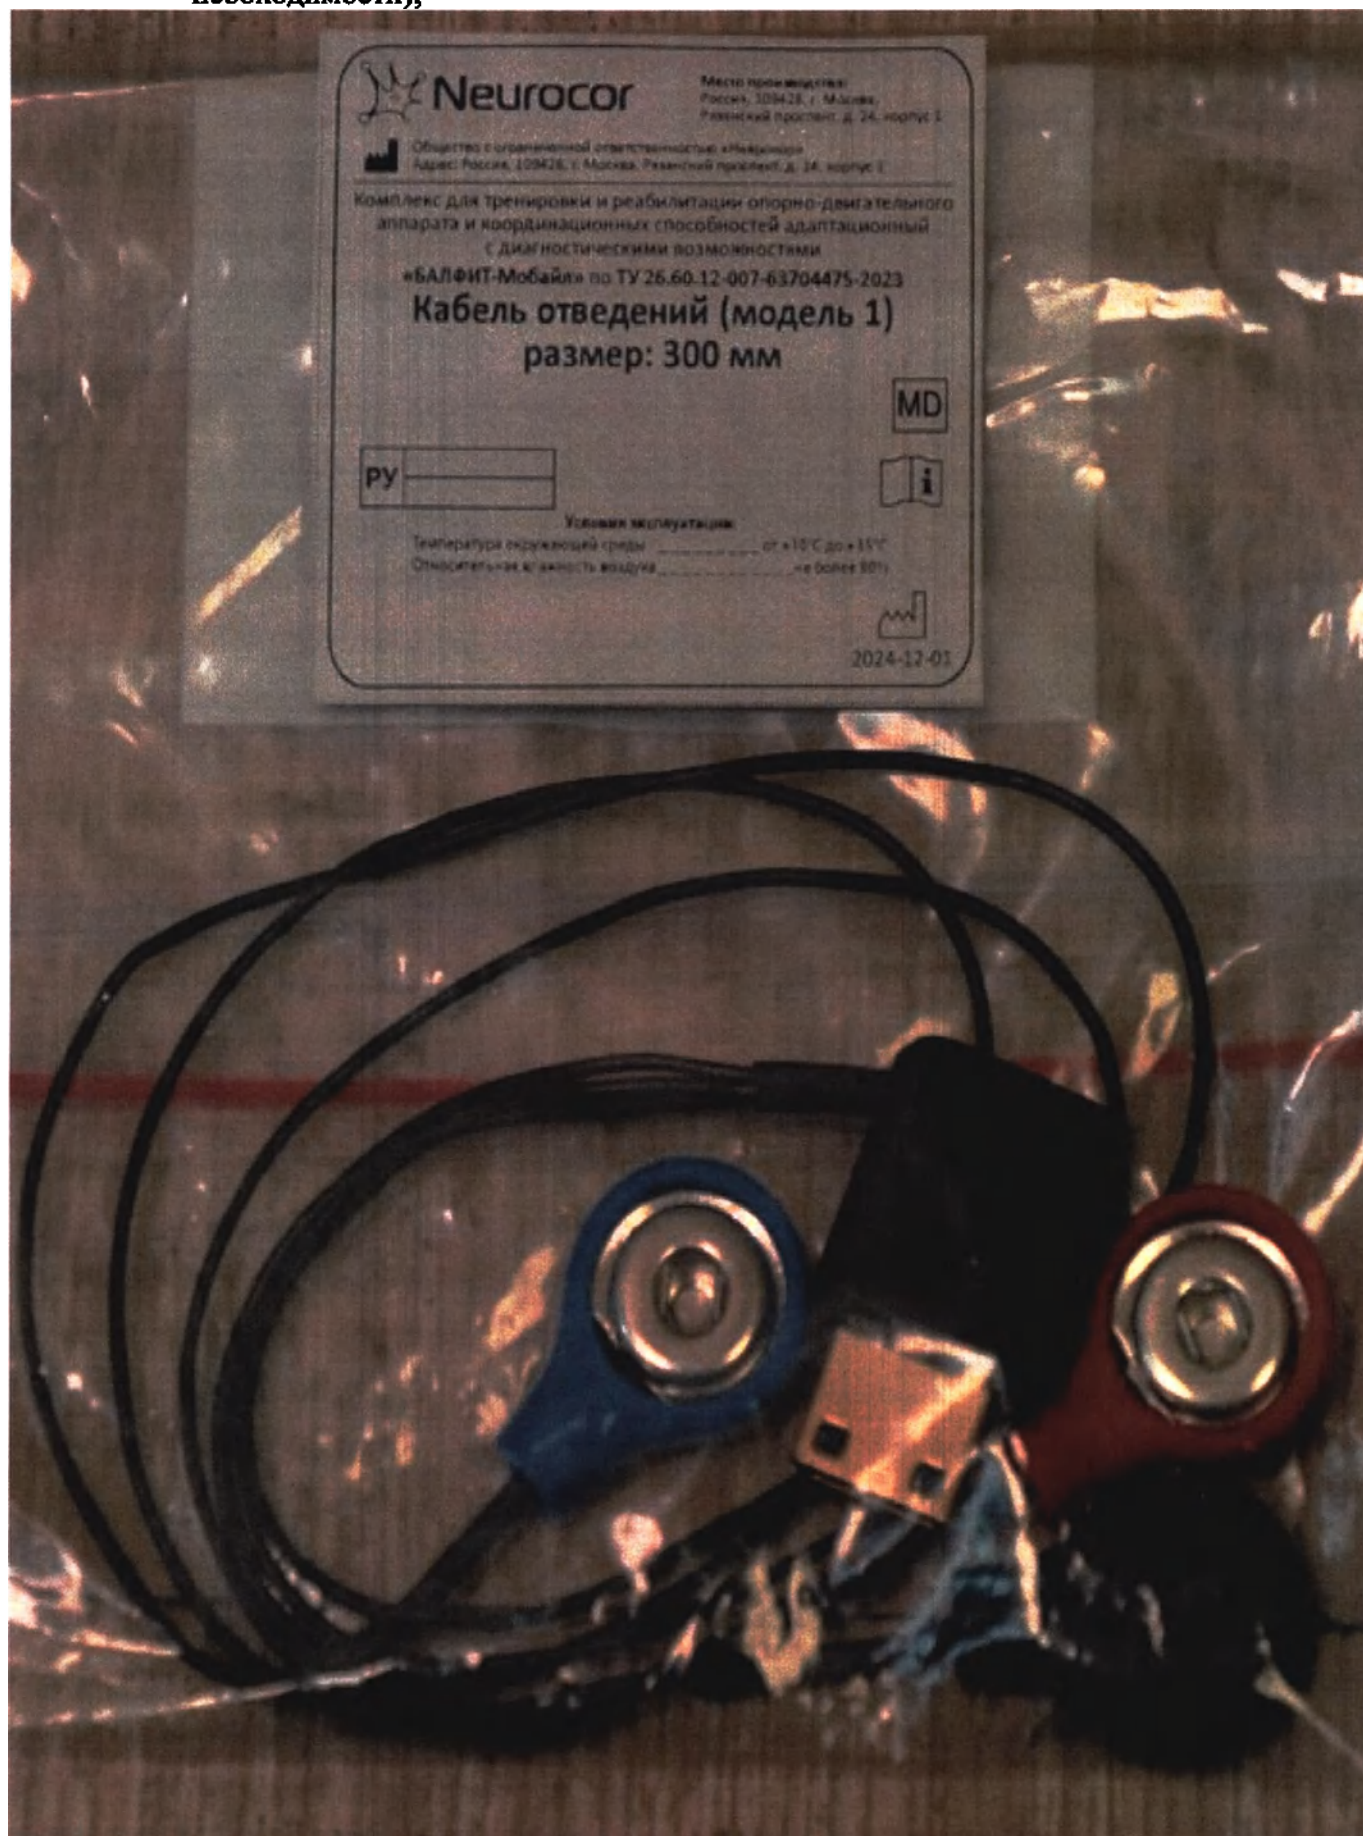

1.12.4 Кабель отведений (модель 1) размер: 500 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

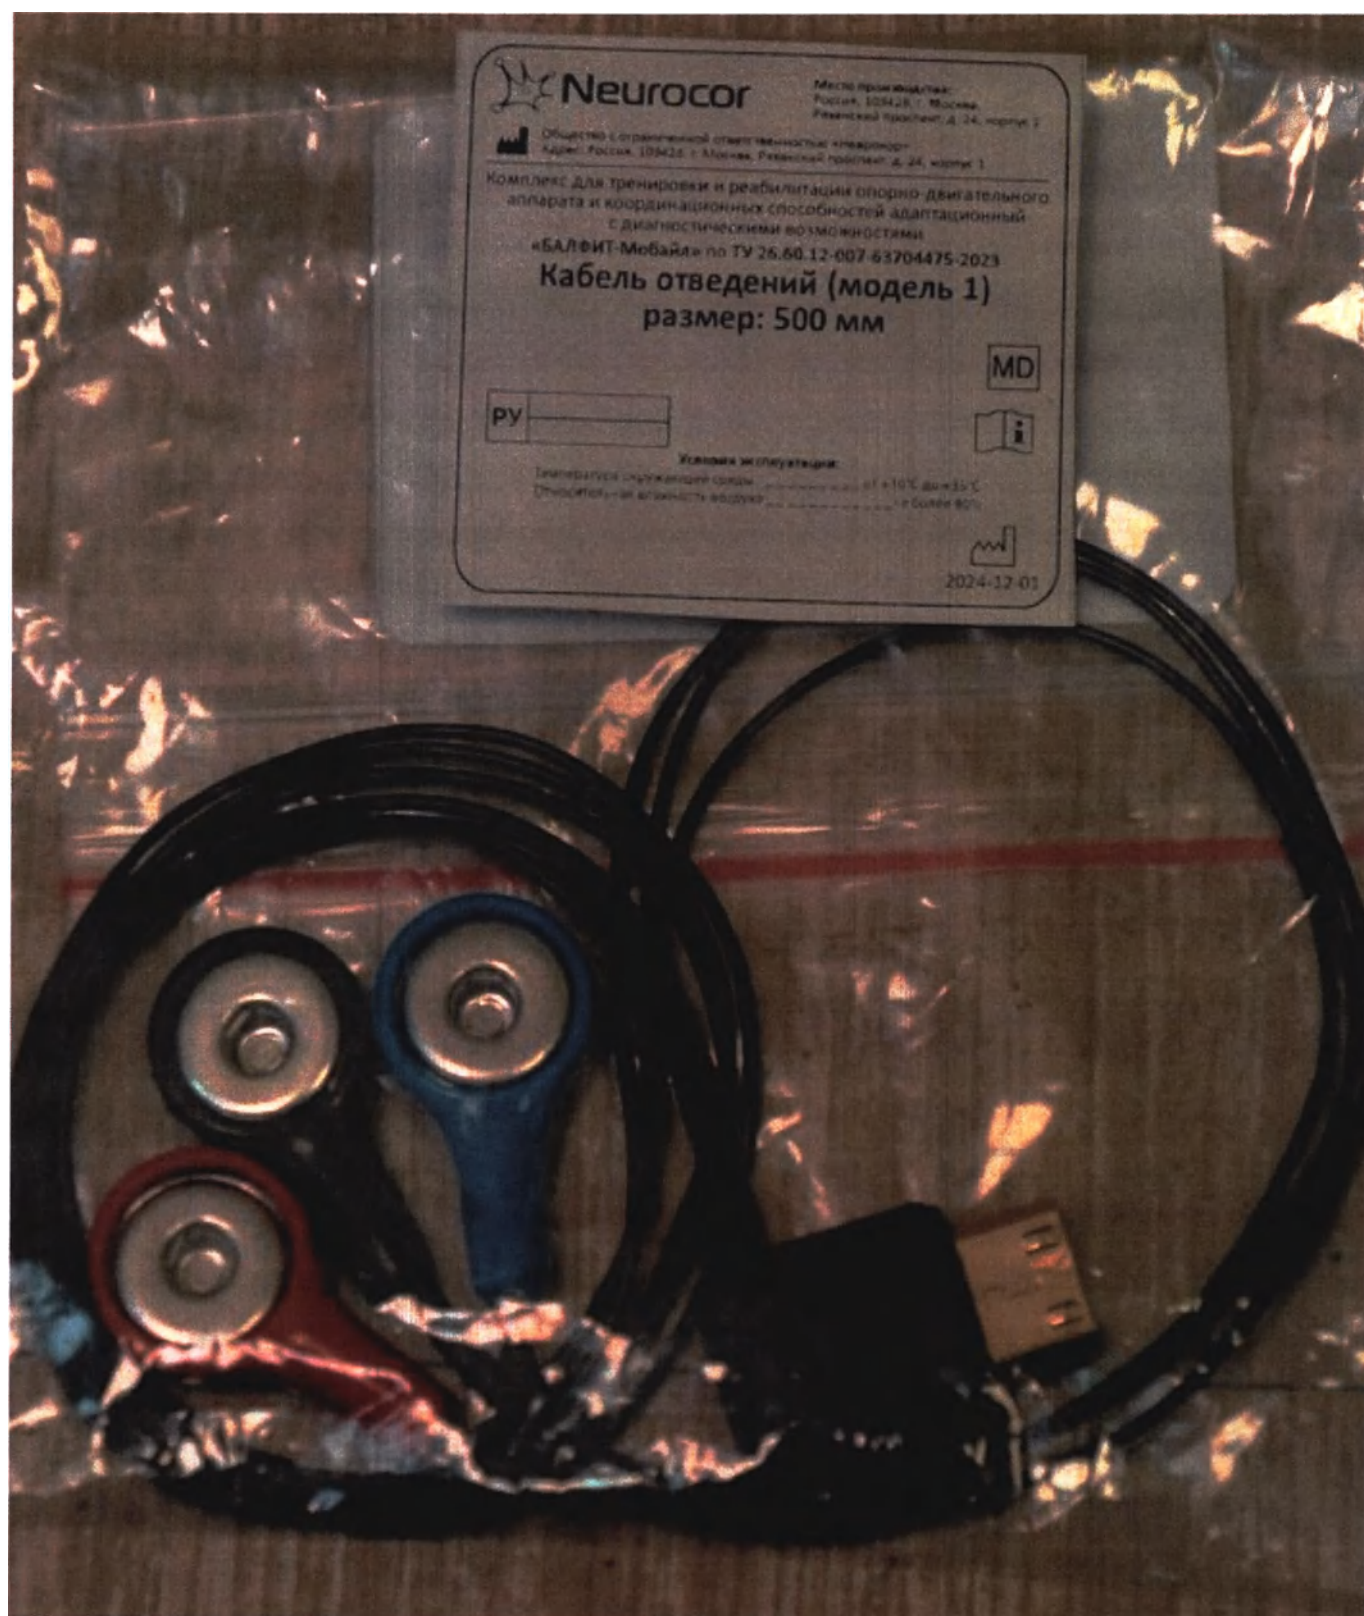


1.12.5 Кабель отведений (модель 1) размер: 1000 мм - не более 16 шт. (при необходимости).




1.13. Кабель отведений (модель 2) в вариантах исполнения:


1.13.1 Кабель отведений (модель 2) размер: 100 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

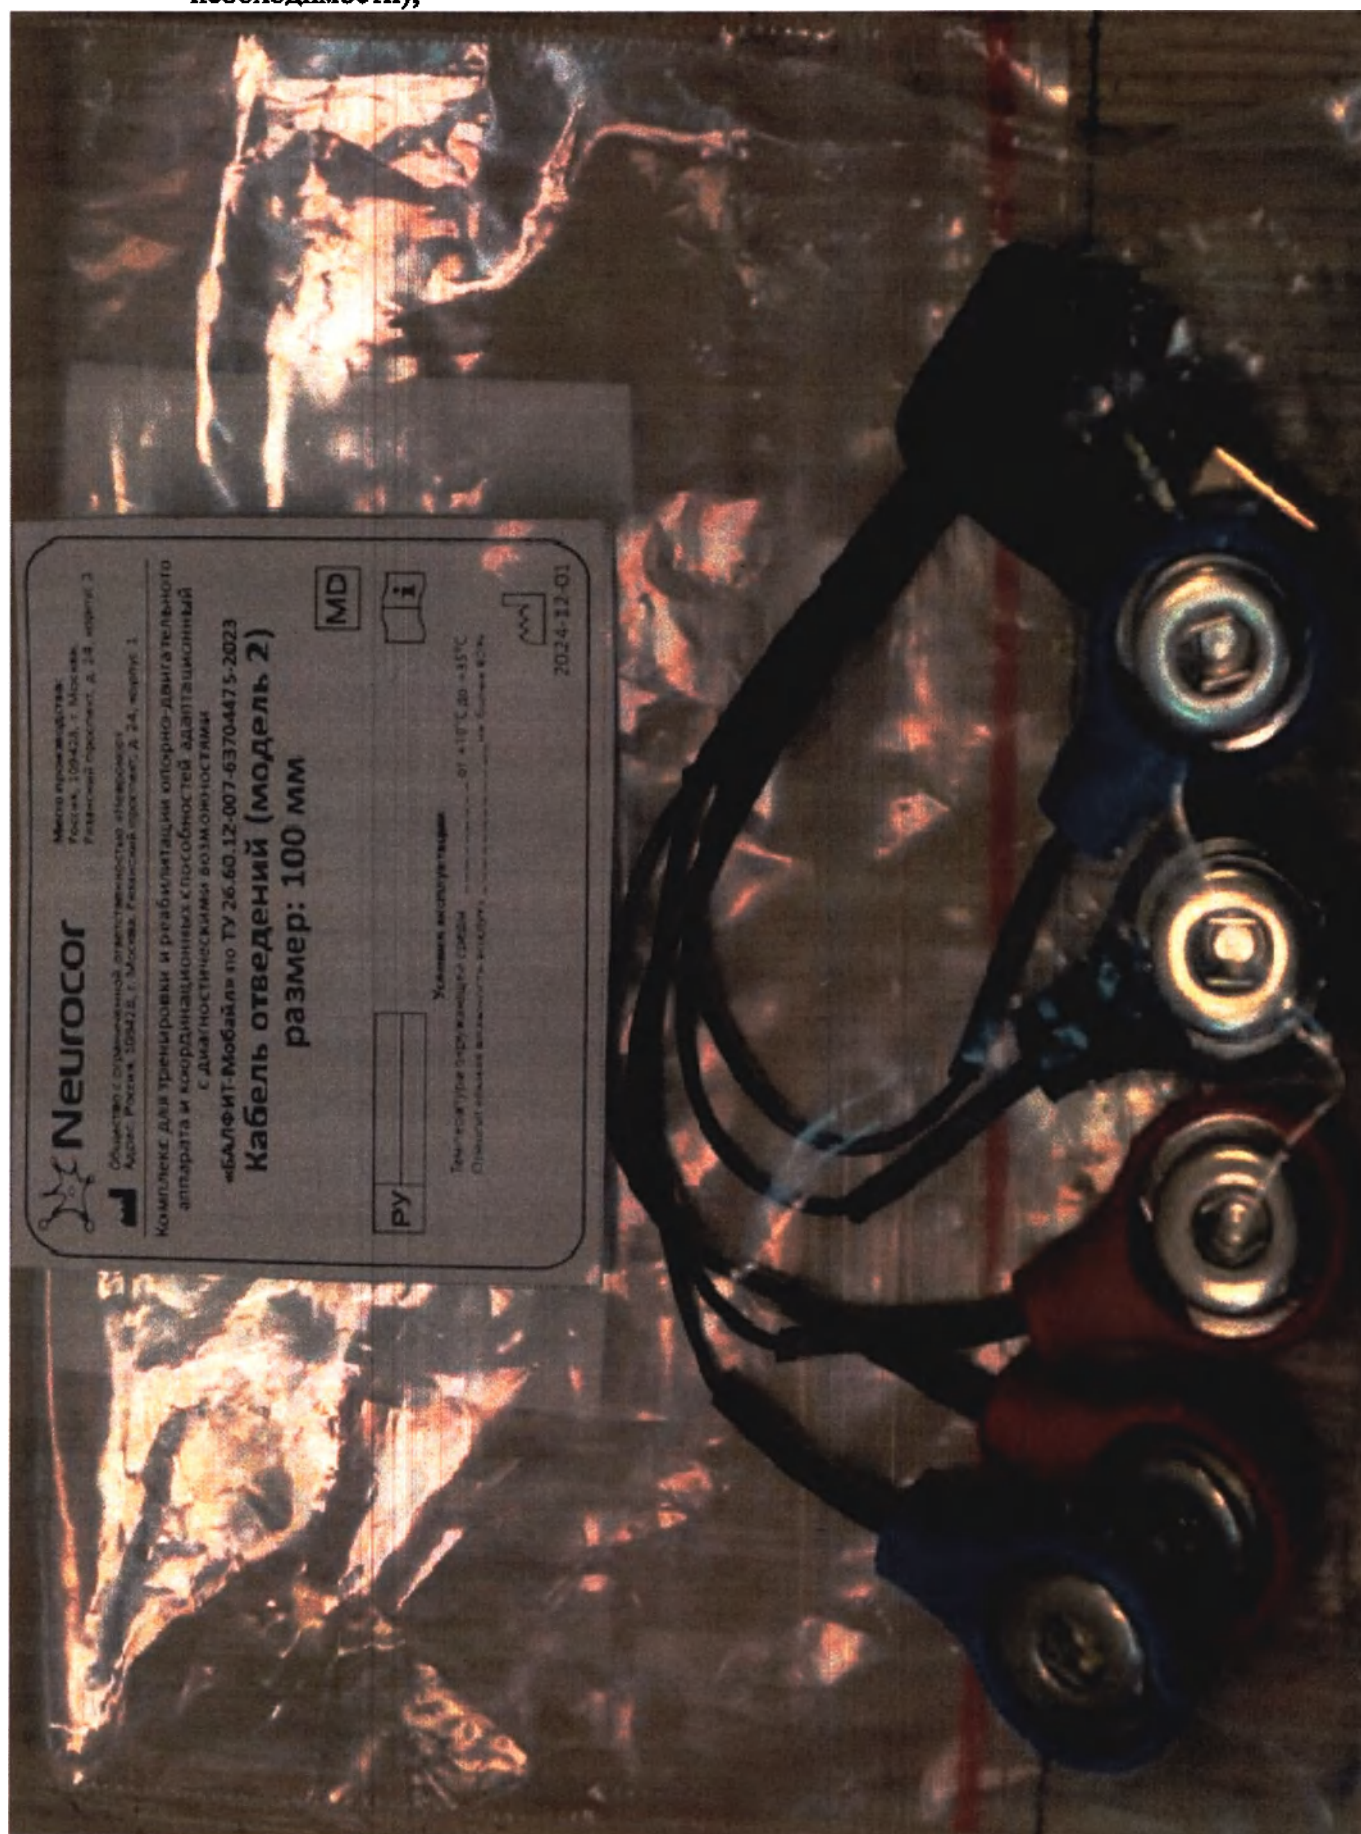


1.13.2 Кабель отведений (модель 2) размер: 200 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

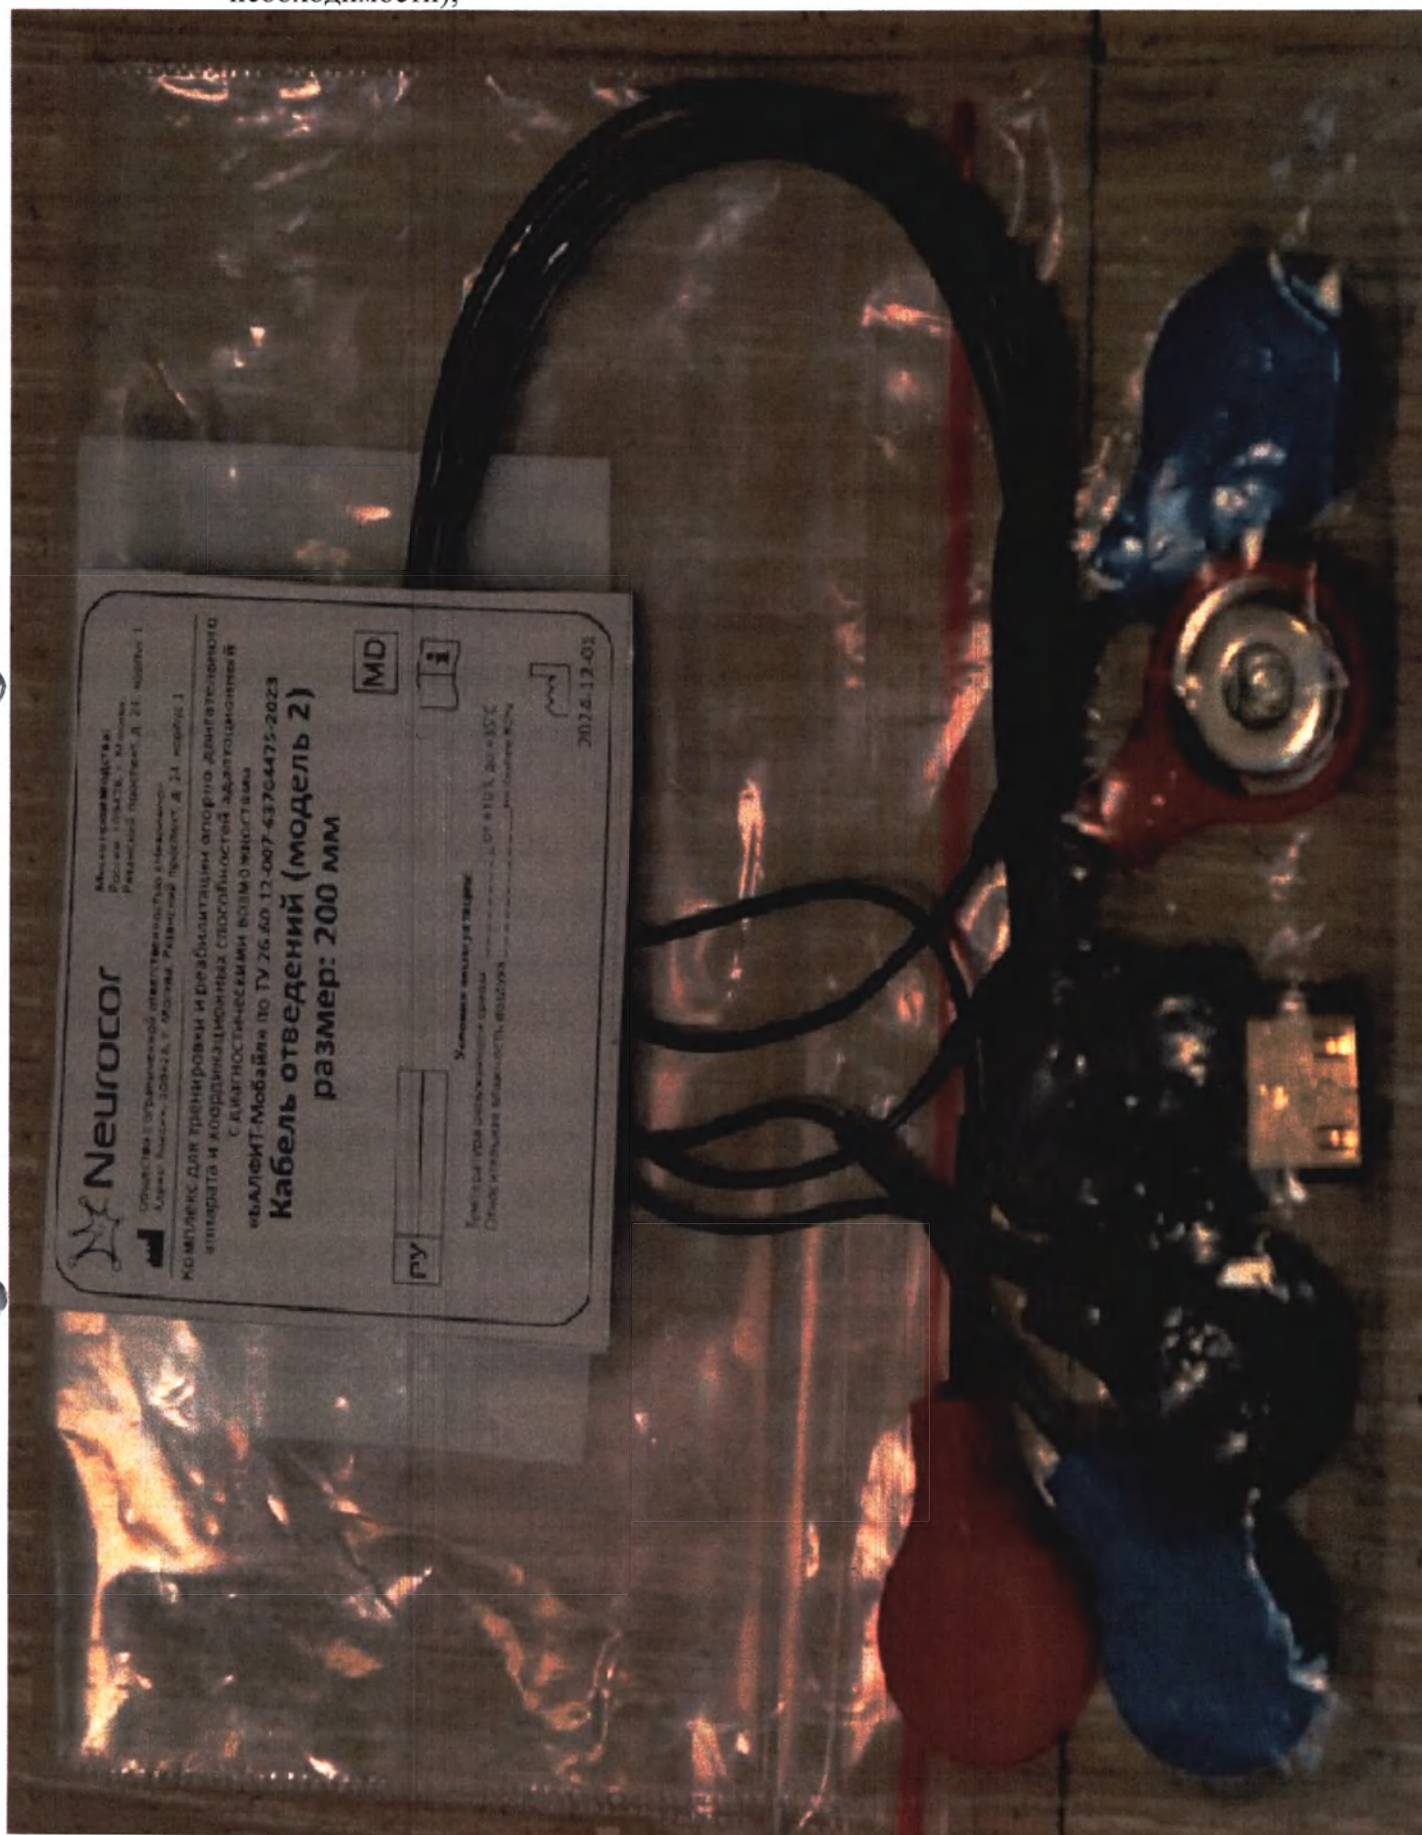


1.13.3 Кабель отведений (модель 2) размер: 300 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

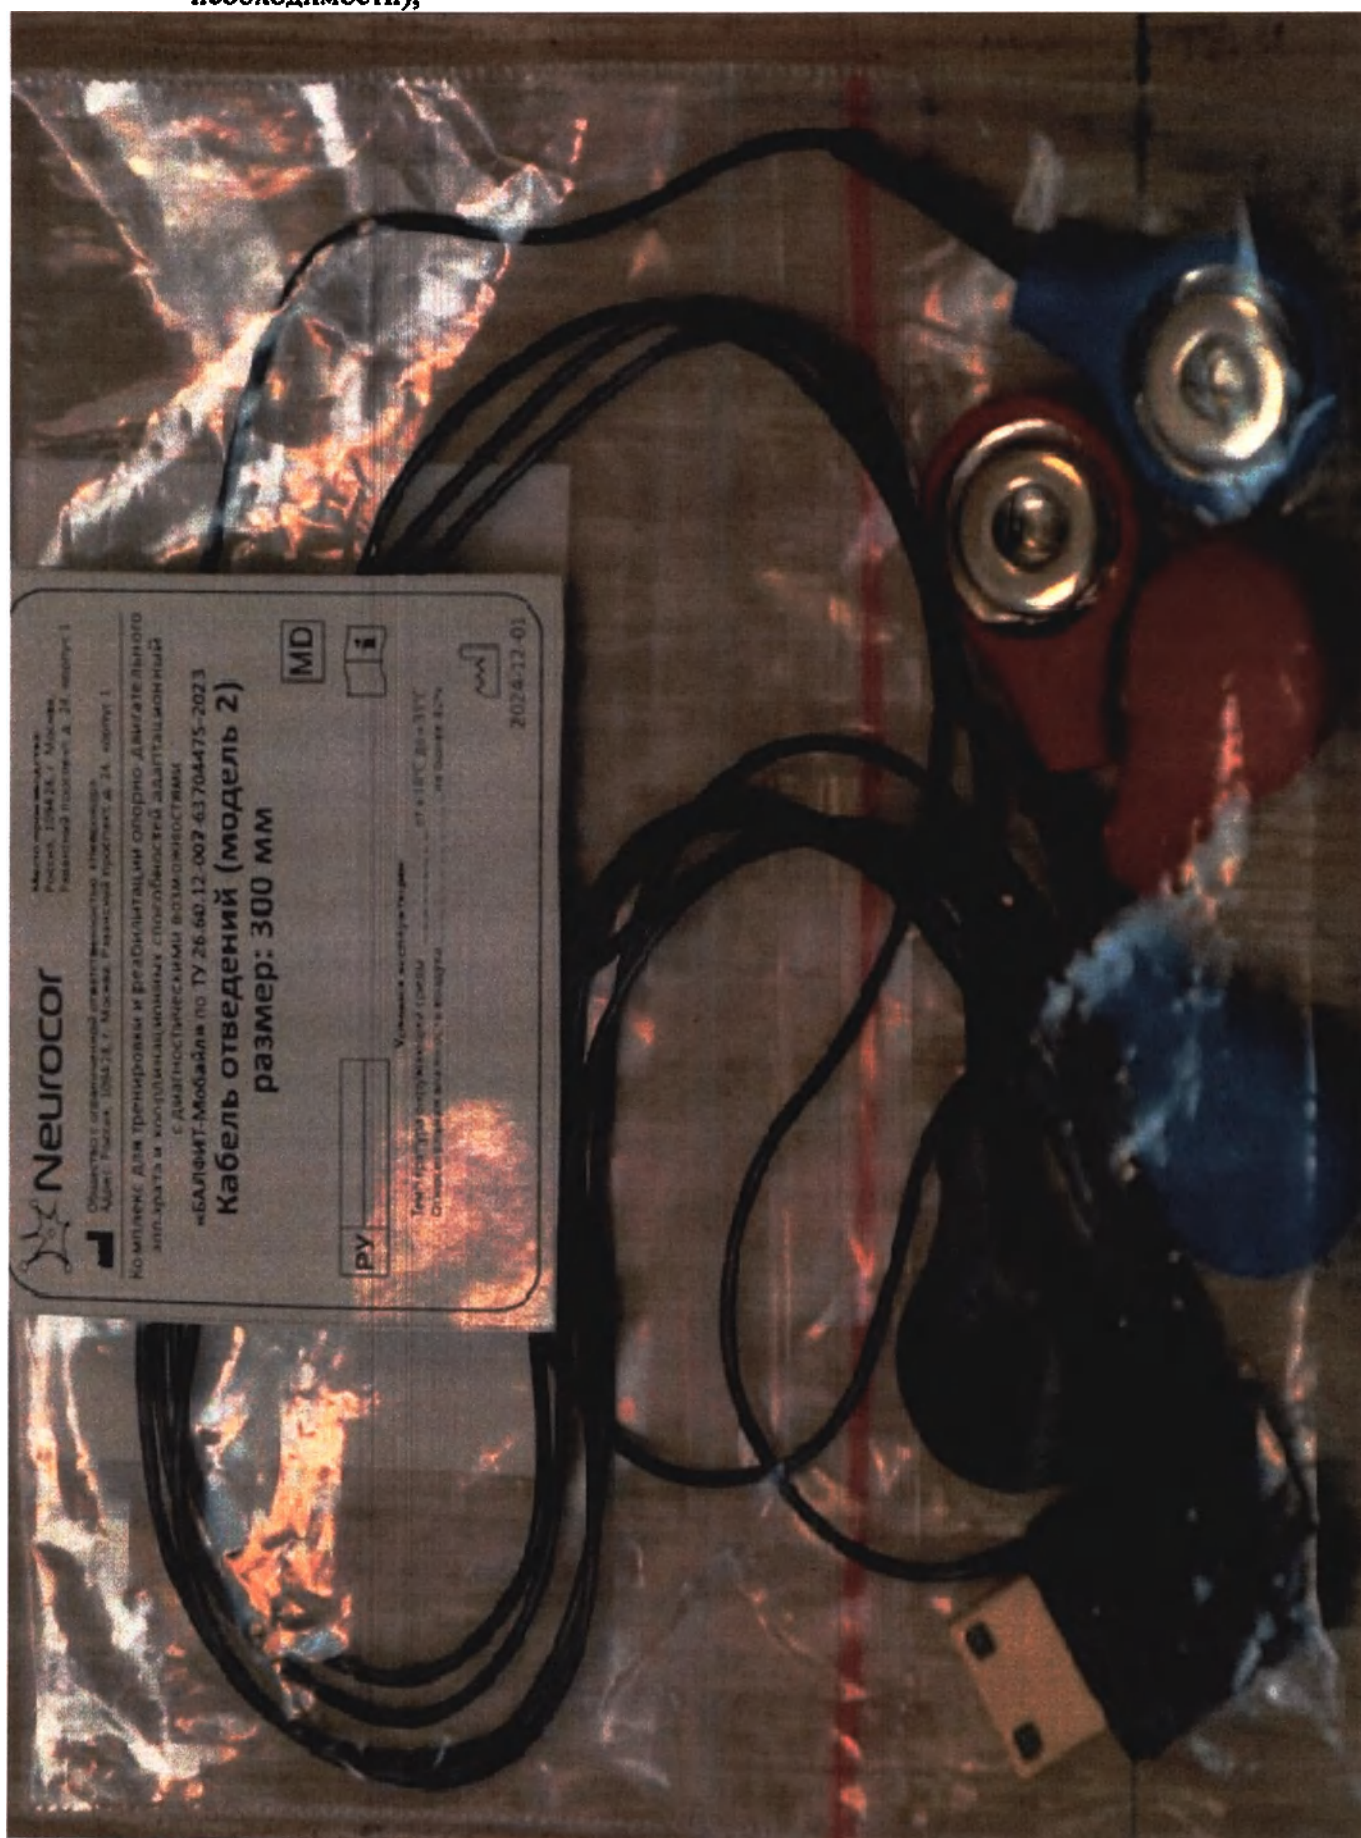

1.13.4 Кабель отведений (модель 2) размер: 500 мм - не более 16 шт. (при необходимости);

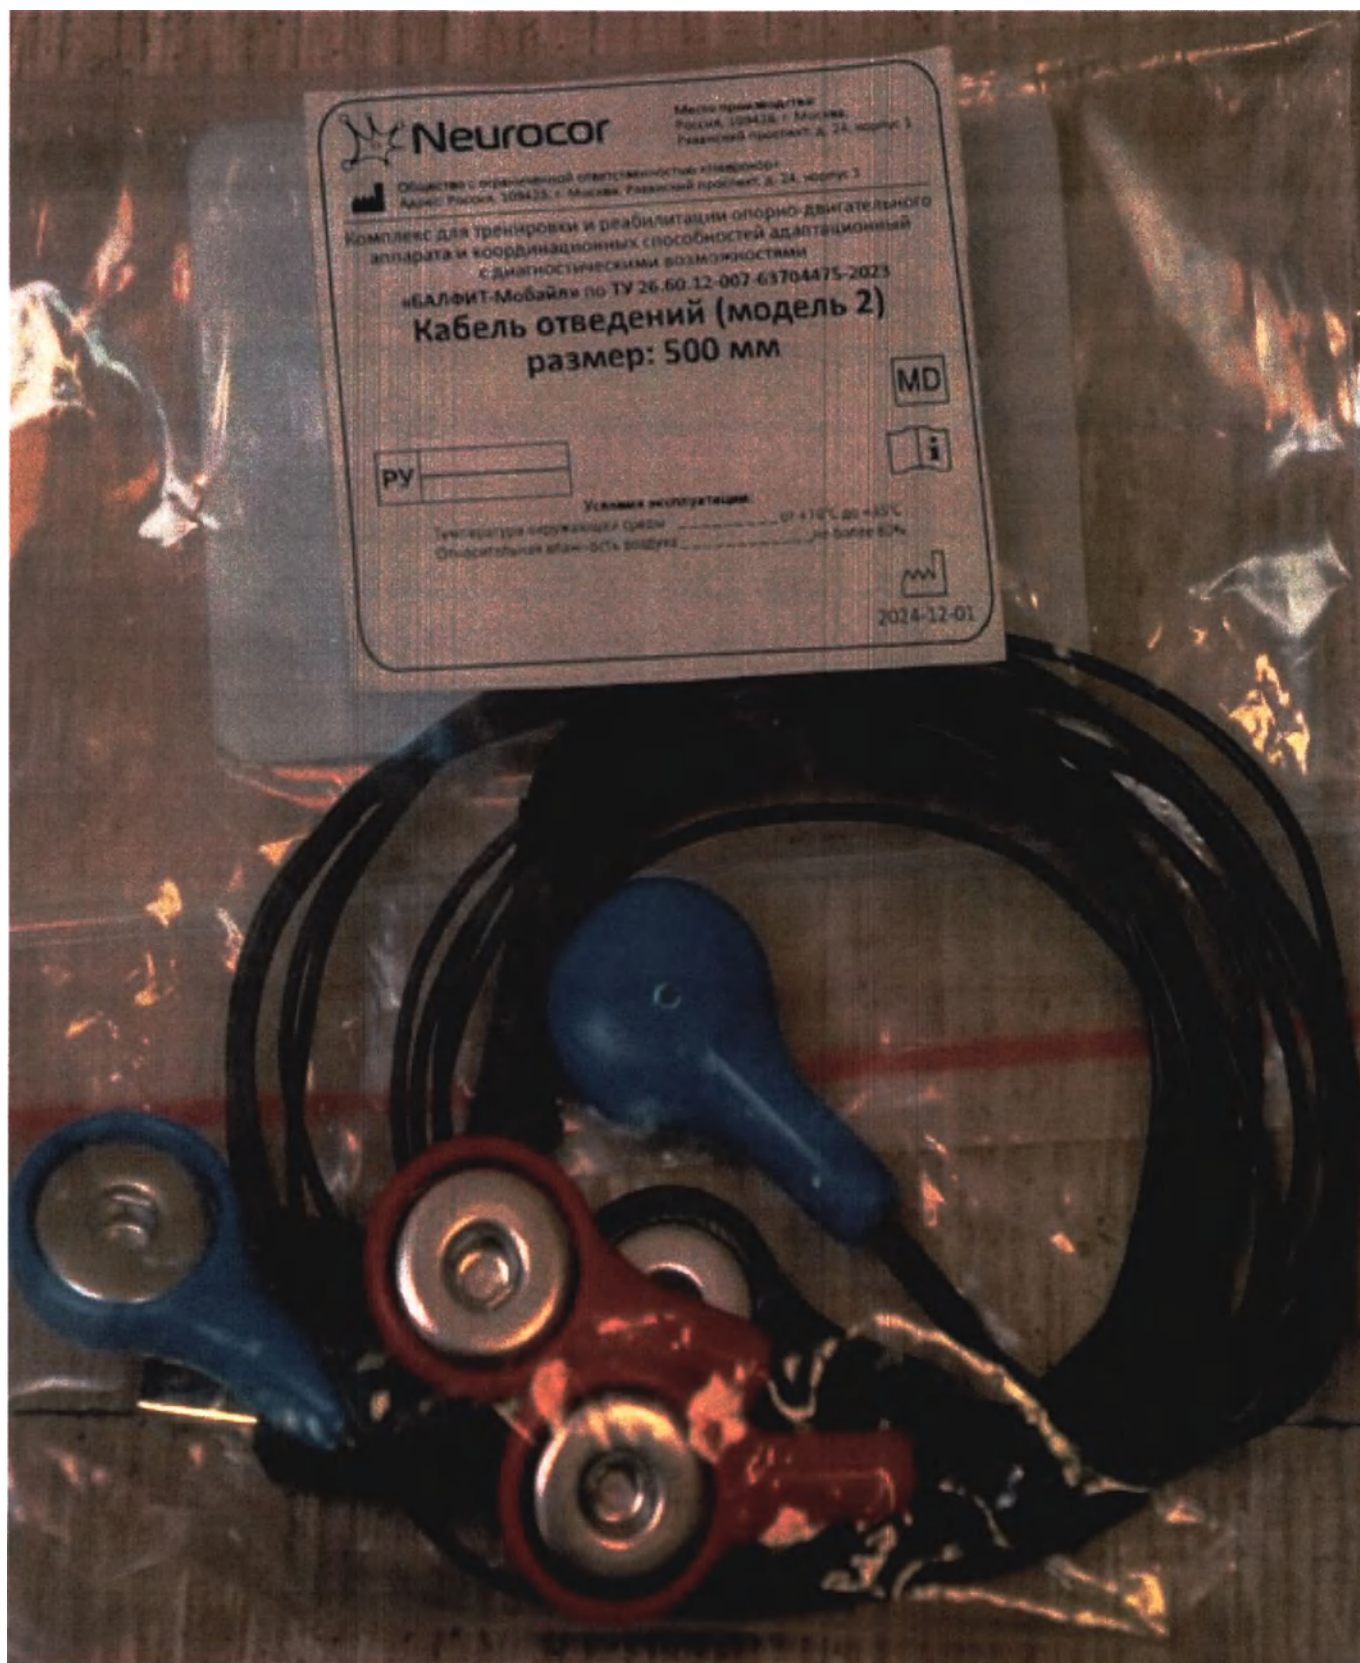

1.13.5 Кабель отведений (модель 2) размер: 1000 мм - не более 16 шт. (при необходимости).

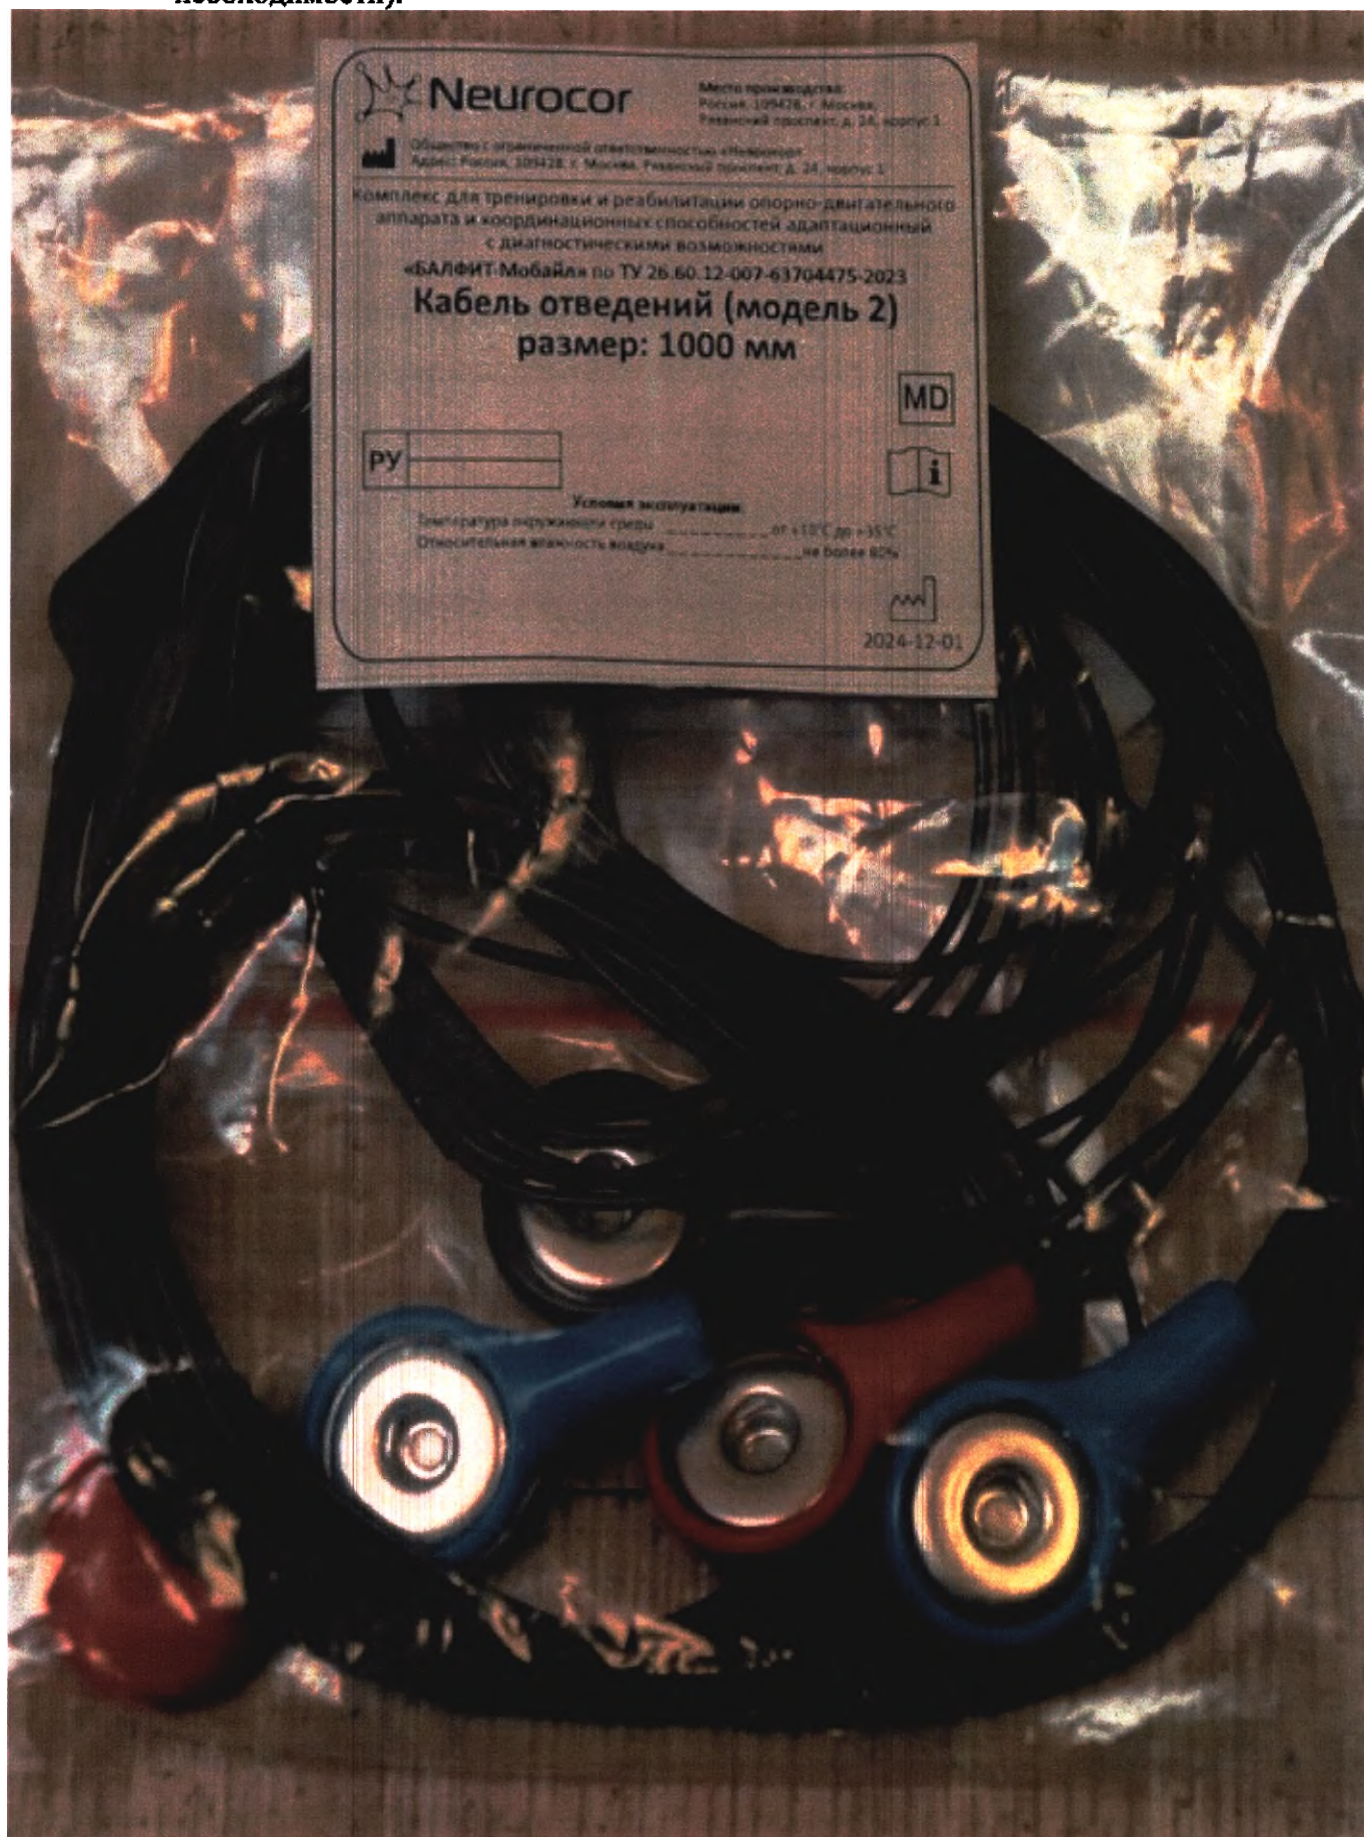

1.14. Крепежное устройство датчика – не более 32 шт. (при необходимости).



 **Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями
«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023
Крепежное устройство датчика

РУ


Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды от +10°C до +35°C
Относительная влажность воздуха не более 80%





2024-12-01


1.15. Сенсор тензометрический (модель 1) с крепежным устройством – не более 2 шт.
(при необходимости).

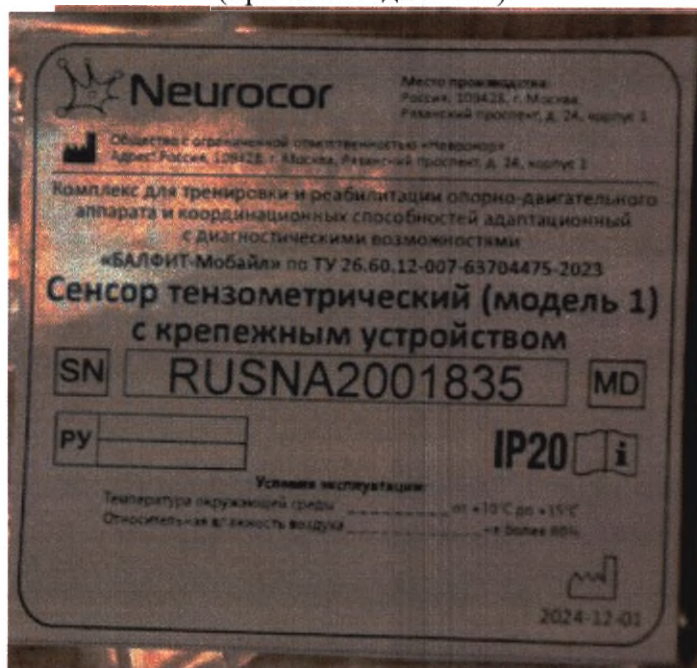

1.16. Сенсор тензометрический (модель 2) – 1 шт. (при необходимости).

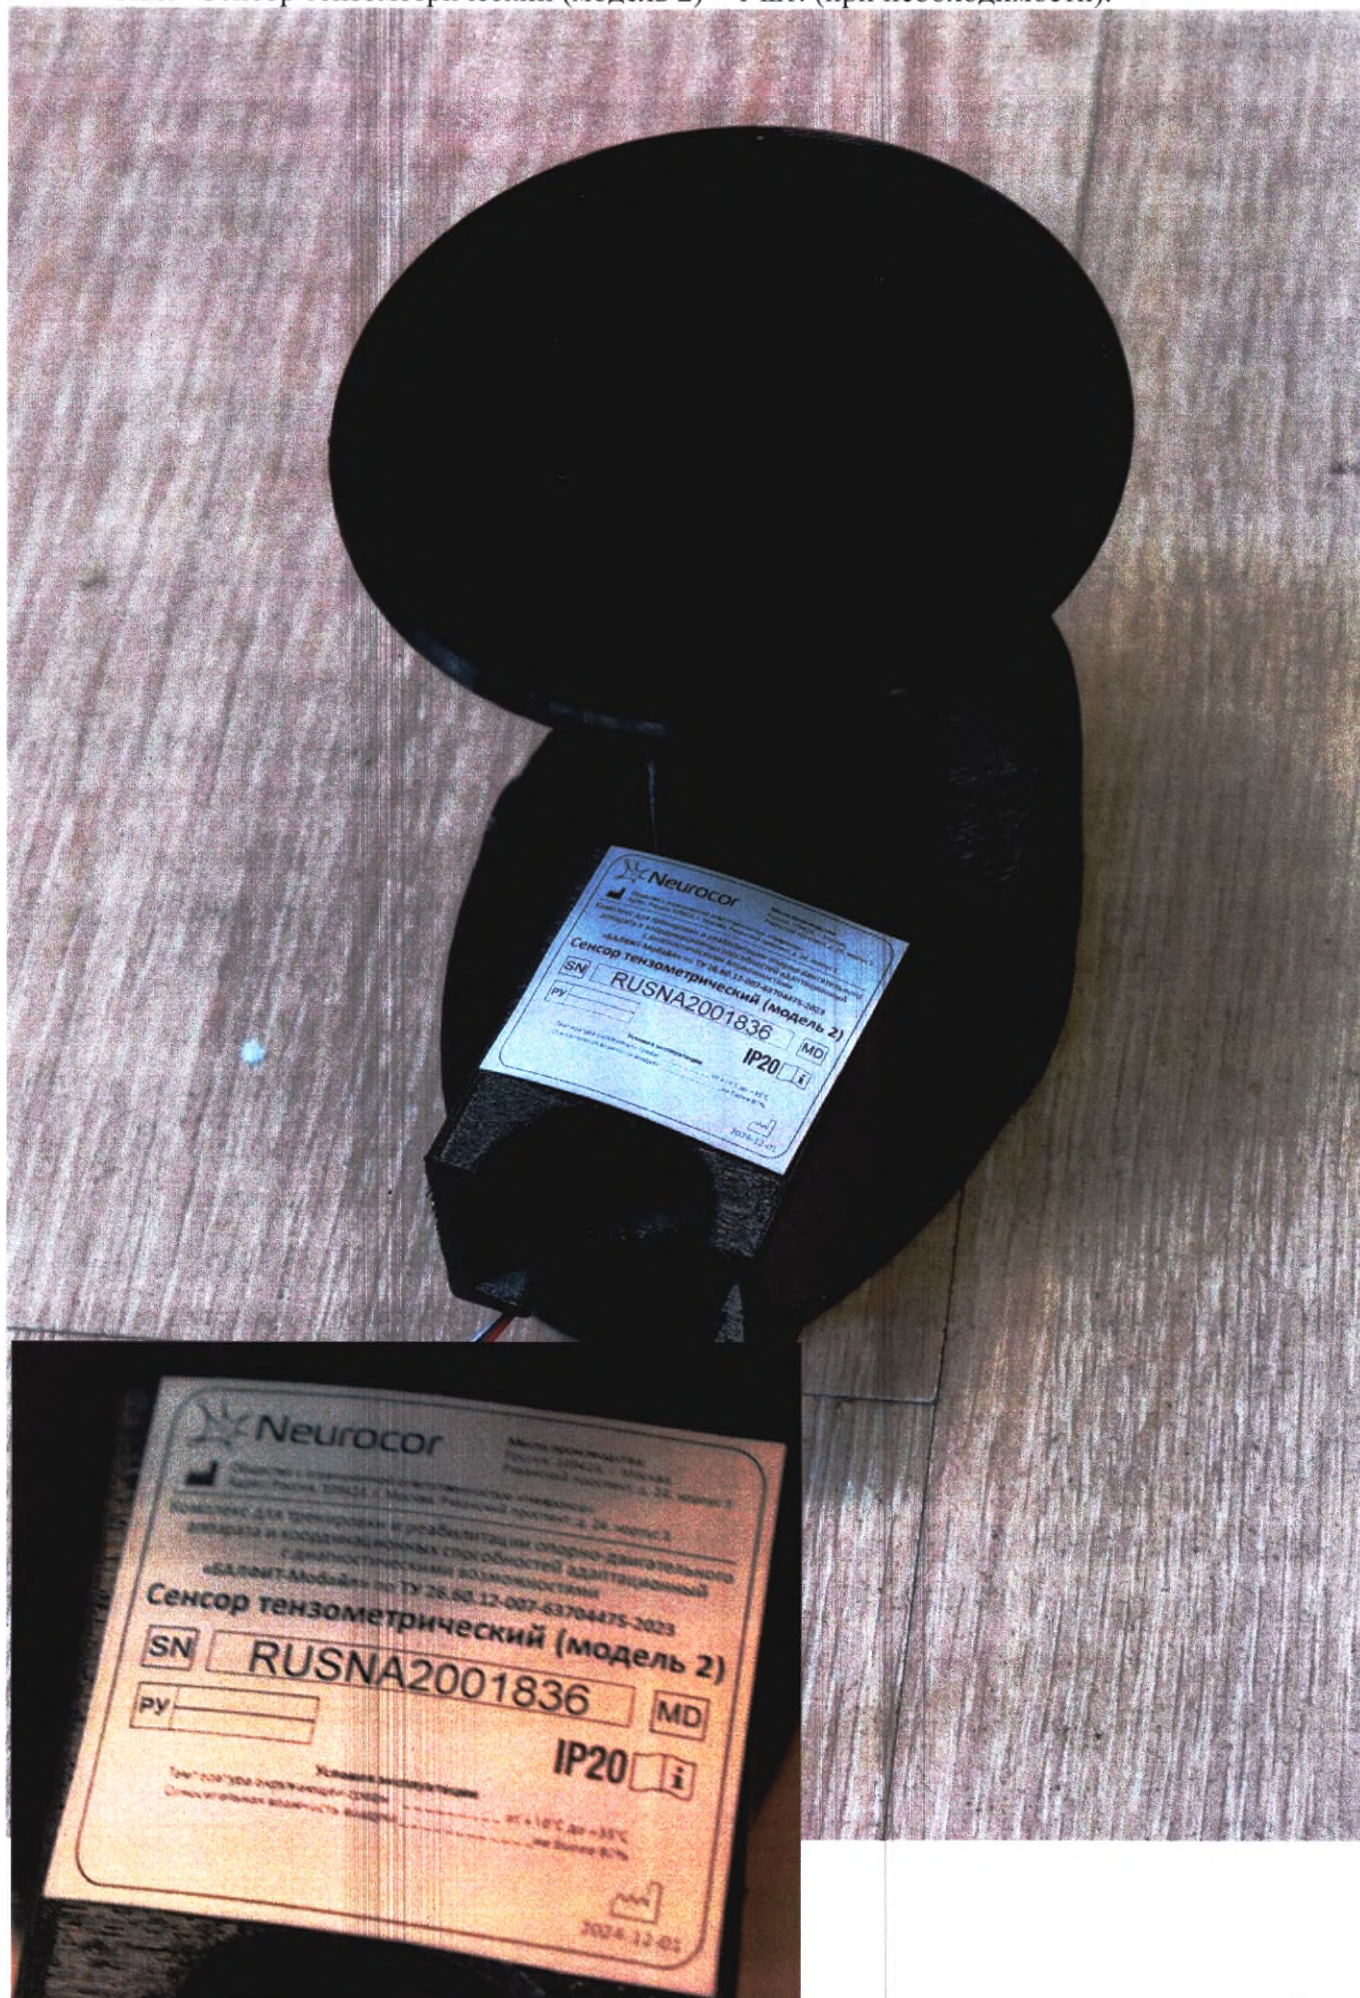


1.17. Кабель интерфейсный USB – 1 шт. (при необходимости).

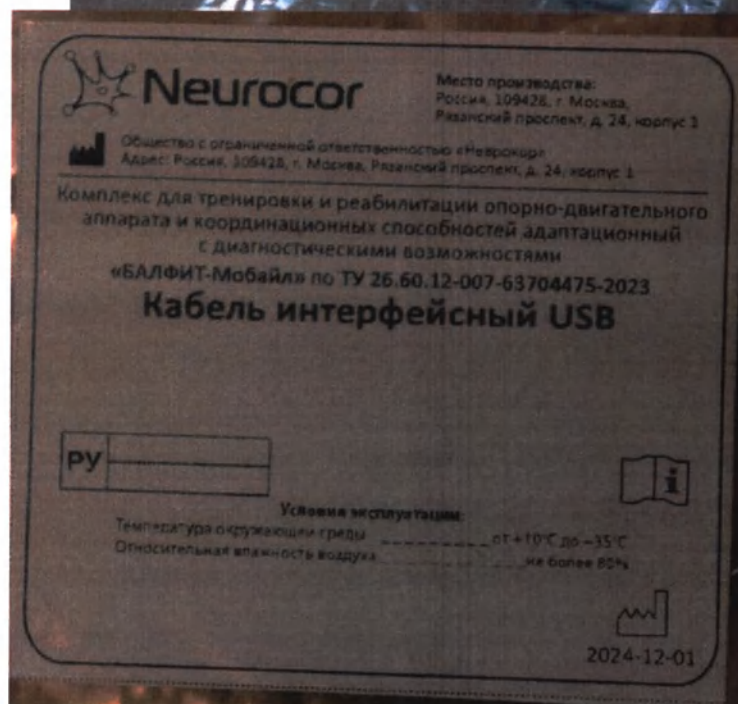

- 1.18. Система видеорегистрации – не более 2 шт. (при необходимости):
- стойка видеорегистрации – 1 шт.;



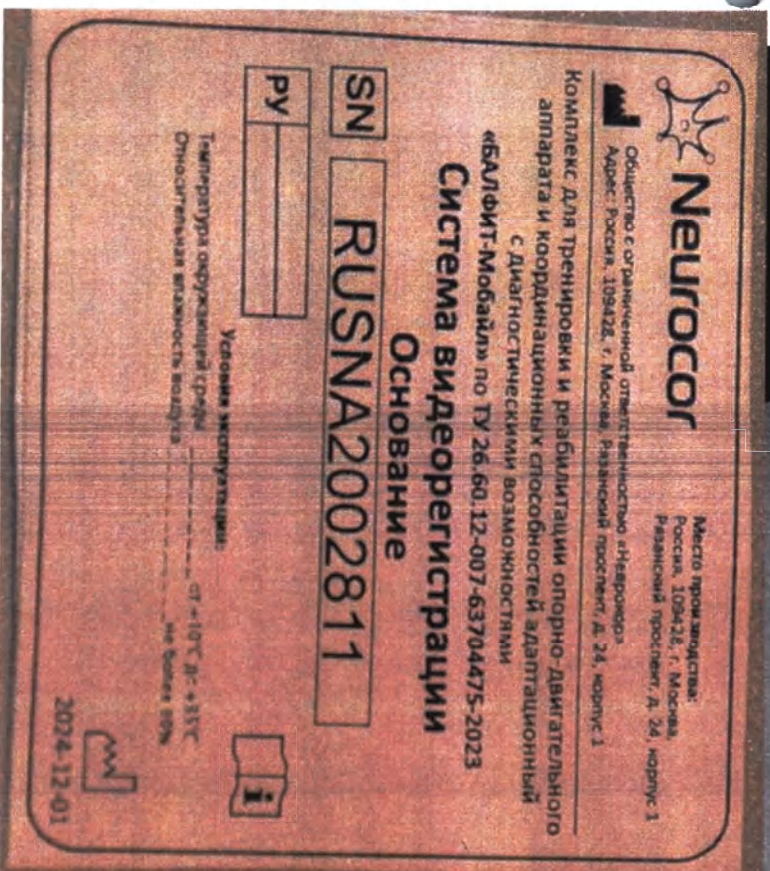



Место производства:
Россия 109428, г. Москва
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Нейрокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Система видеорегистрации Опора регулировочная

SN


RUSNA2002811

РУ



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды _____ от +10°C до +35°C
Относительная влажность воздуха _____ не более 80%



2024-12-01



- адаптер USB – не более 2 шт.;



- блок питания (модель 2) – не более 2 шт.



1.19. Коврик – не более 2 шт. (при необходимости).



1.20. Руководство по эксплуатации – 1 шт.



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Москва тел.: +7 (495) 607-6370 www.neurocor.ru

ООО «Неврокор» 109428 Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 1, к. 34 e-mail: info@neurocor.ru www.neurocor.ru	Эксплуатационная документация на МИ	26.60.12-007-63704475-2023 РЭ	
Комплекс для тренировки и реабилитации опорно- двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями «БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023		Версия: 2.0	Страница: 1 из 51
Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»		Дата выпуска: « 16 » сентября 2024 г.	

Руководство по эксплуатации

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и
координационных способностей адаптационный с диагностическими
возможностями «БАЛФИТ-Мобайл» по
ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

ООО «Неврокор»
г. Москва

26.60.12-007-63704475-2023 РЭ

1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Москва 125117, ул. Давыдовская, д. 14, стр. 1 www.neurocor.ru

ООО «Неврокор» 109428 Москва, Рязанский проспект, д. 24, корп. 1, к. 34 e-mail: info@neurocor.ru www.neurocor.ru	Эксплуатационная документация на МИ	
Комплекс для тренировки и реабилитации опорно- двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями «БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023		Версия: 1.0 Страница : 2 из 51
Предприятие-изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»		Дата выпуска: « 16 » сентября 2024 г.

Паспорт

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный с
диагностическими возможностями «БАЛФИТ-Мобайл» по
ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

ООО «Неврокор»
г. Москва

2 Фото транспортной упаковки составных частей Комплекса

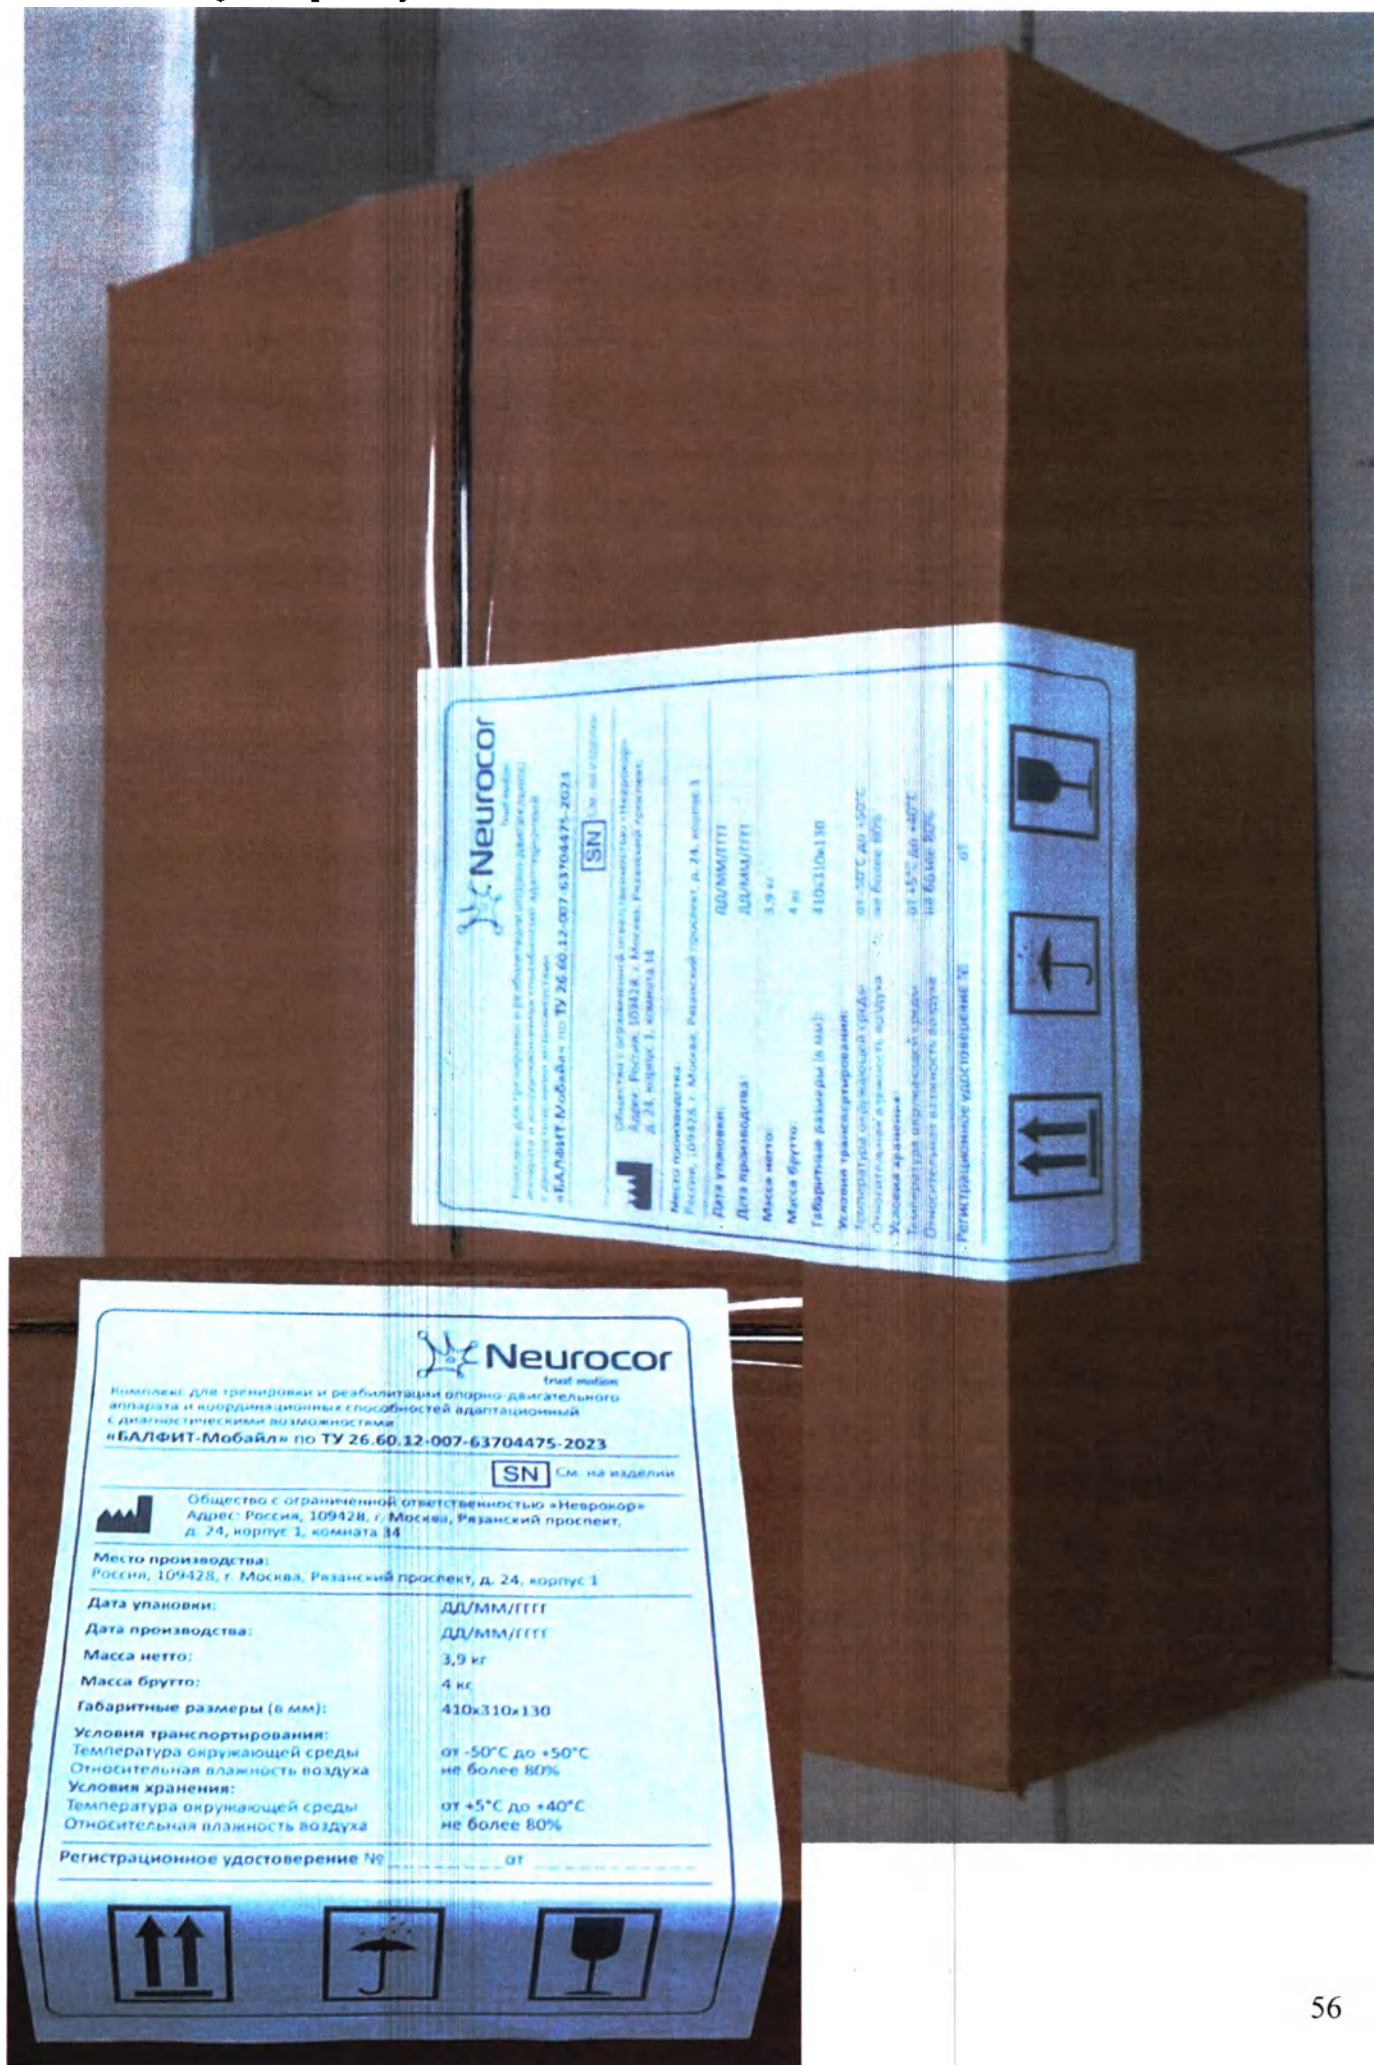




Фото транспортных упаковок позиций из состава медицинского изделия, которые поставляется в отдельной транспортной упаковке:

Фото транспортной упаковки

Дисплей Модуля БОС в вариантах исполнения:
(модель БОС30)



Фото транспортной упаковки
Дисплей Модуля БОС в вариантах исполнения:
(модель БОС40)

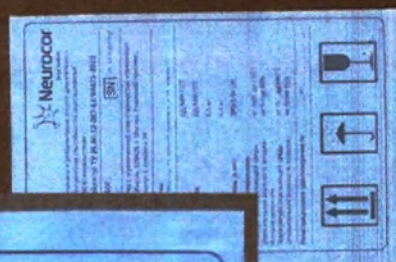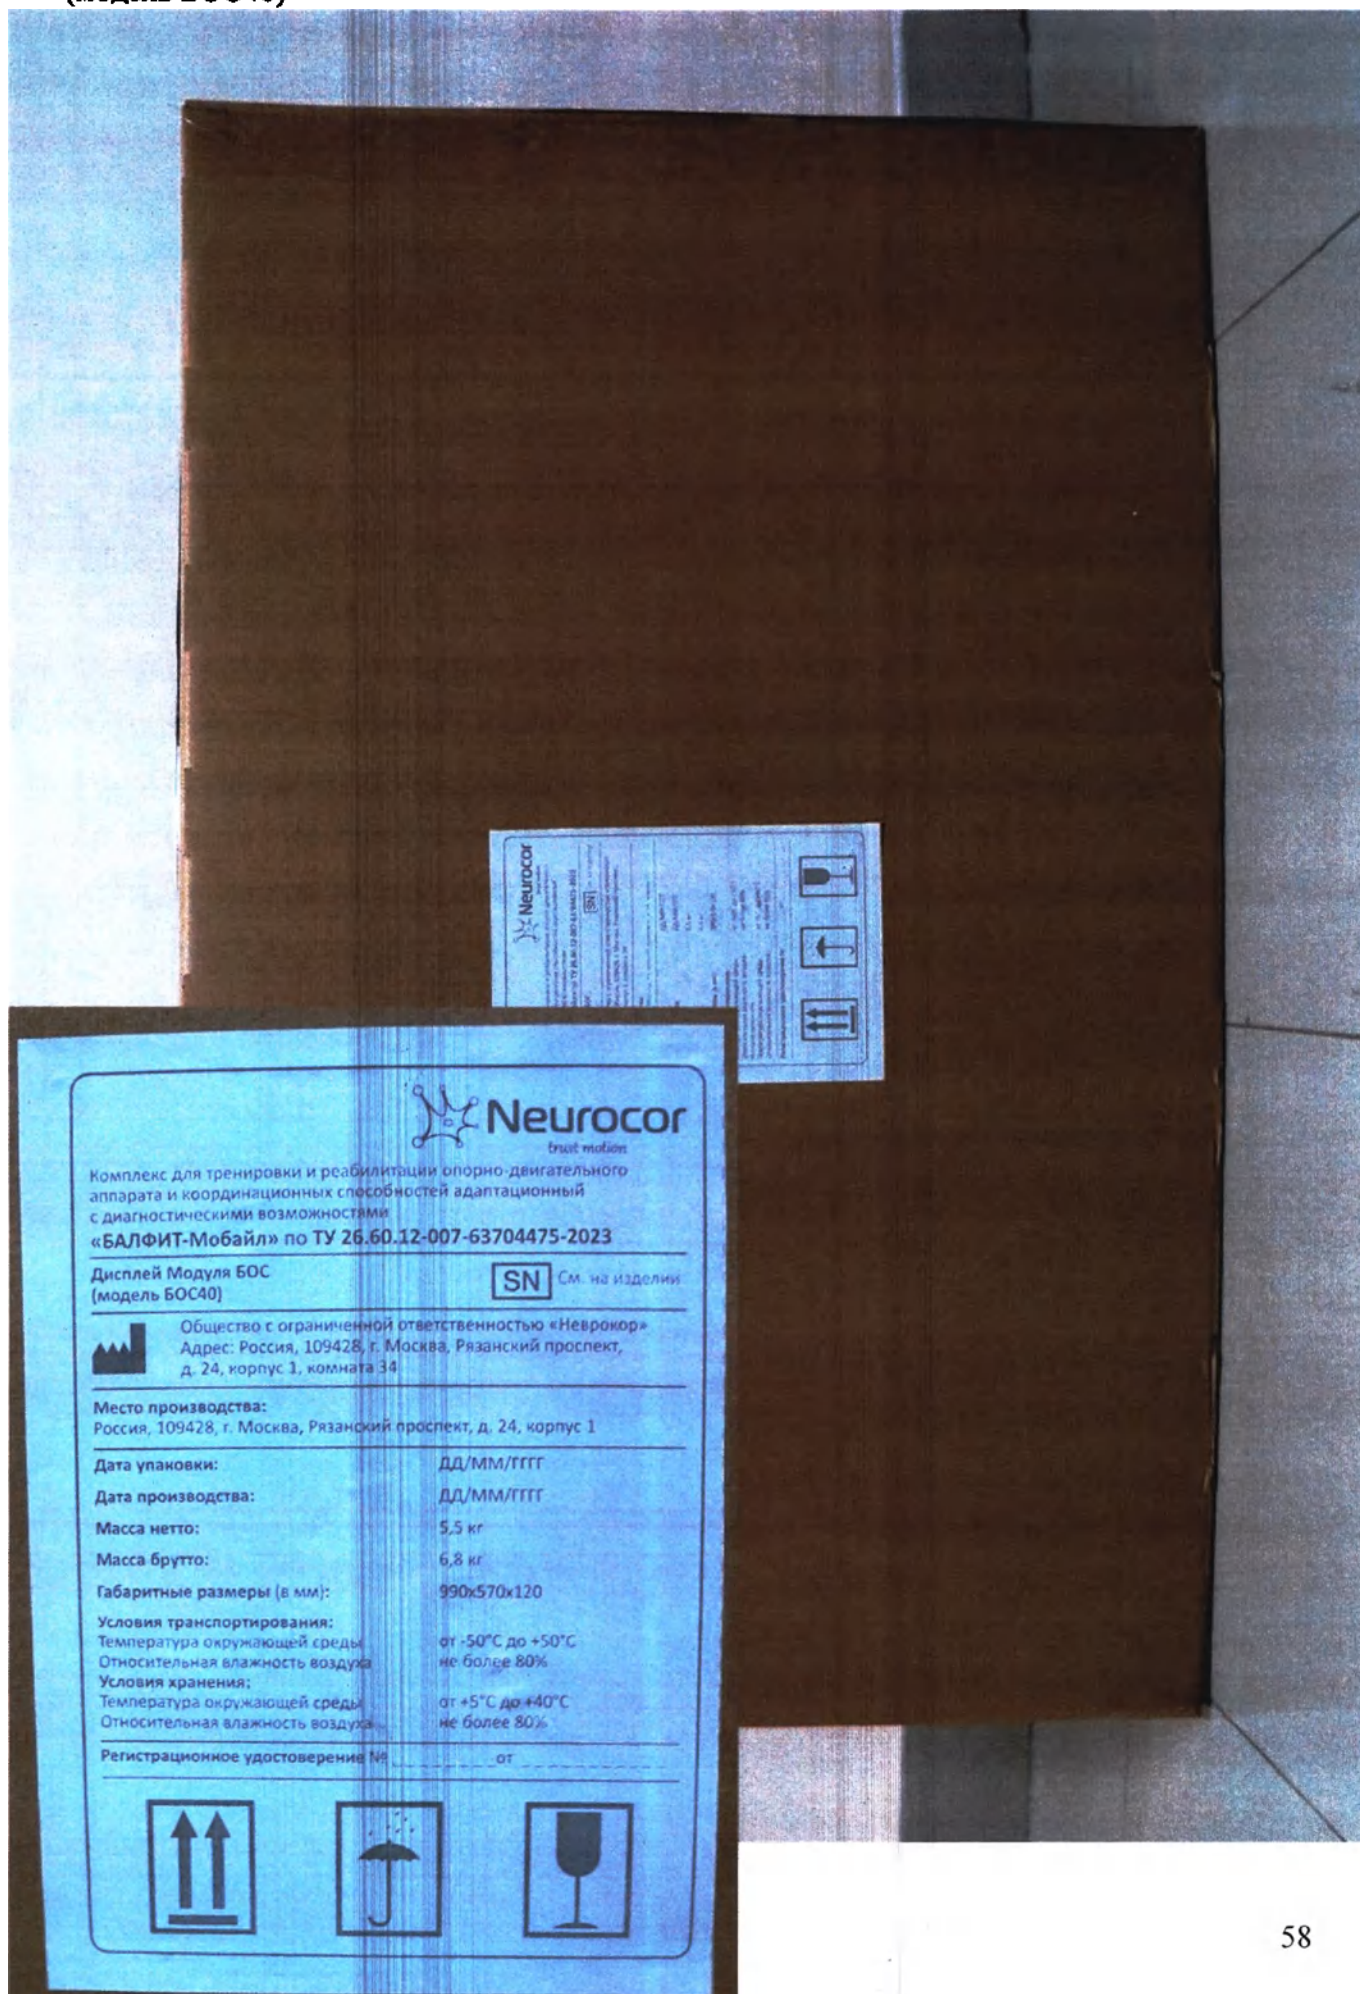

Neurocor
 fruit motion

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями
«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Дисплей Модуля БОС (модель БОС40) **SN** См. на изделии

Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
 Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1, комната 34

Место производства:
 Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Дата упаковки:	ДД/ММ/ГГГГ
Дата производства:	ДД/ММ/ГГГГ
Масса нетто:	5,5 кг
Масса брутто:	6,8 кг
Габаритные размеры (в мм):	990x570x120
Условия транспортирования:	
Температура окружающей среды	от -50°C до +50°C
Относительная влажность воздуха	не более 80%
Условия хранения:	
Температура окружающей среды	от +5°C до +40°C
Относительная влажность воздуха	не более 80%

Регистрационное удостоверение № _____ от _____



Фото транспортной упаковки
Дисплей Модуля БОС в вариантах исполнения:
(модель БОС50)



Фото транспортной упаковки

Стойка Модуля БОС

 **Neurocor**
trust union

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями
«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Стойка
Модуля БОС

SN СМ. на изделии

 Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1, комната 34

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Дата упаковки:	ДД/ММ/ГГГГ
Дата производства:	ДД/ММ/ГГГГ
Масса нетто:	17 кг
Масса брутто:	18 кг
Габаритные размеры (в мм):	300x250x1250
Условия транспортирования:	
Температура окружающей среды	от -50°C до +50°C
Относительная влажность воздуха	не более 80%
Условия хранения:	
Температура окружающей среды	от +5°C до +40°C
Относительная влажность воздуха	не более 80%

Регистрационное удостоверение № _____ от _____






Фото транспортной упаковки
Стабилоплатформа

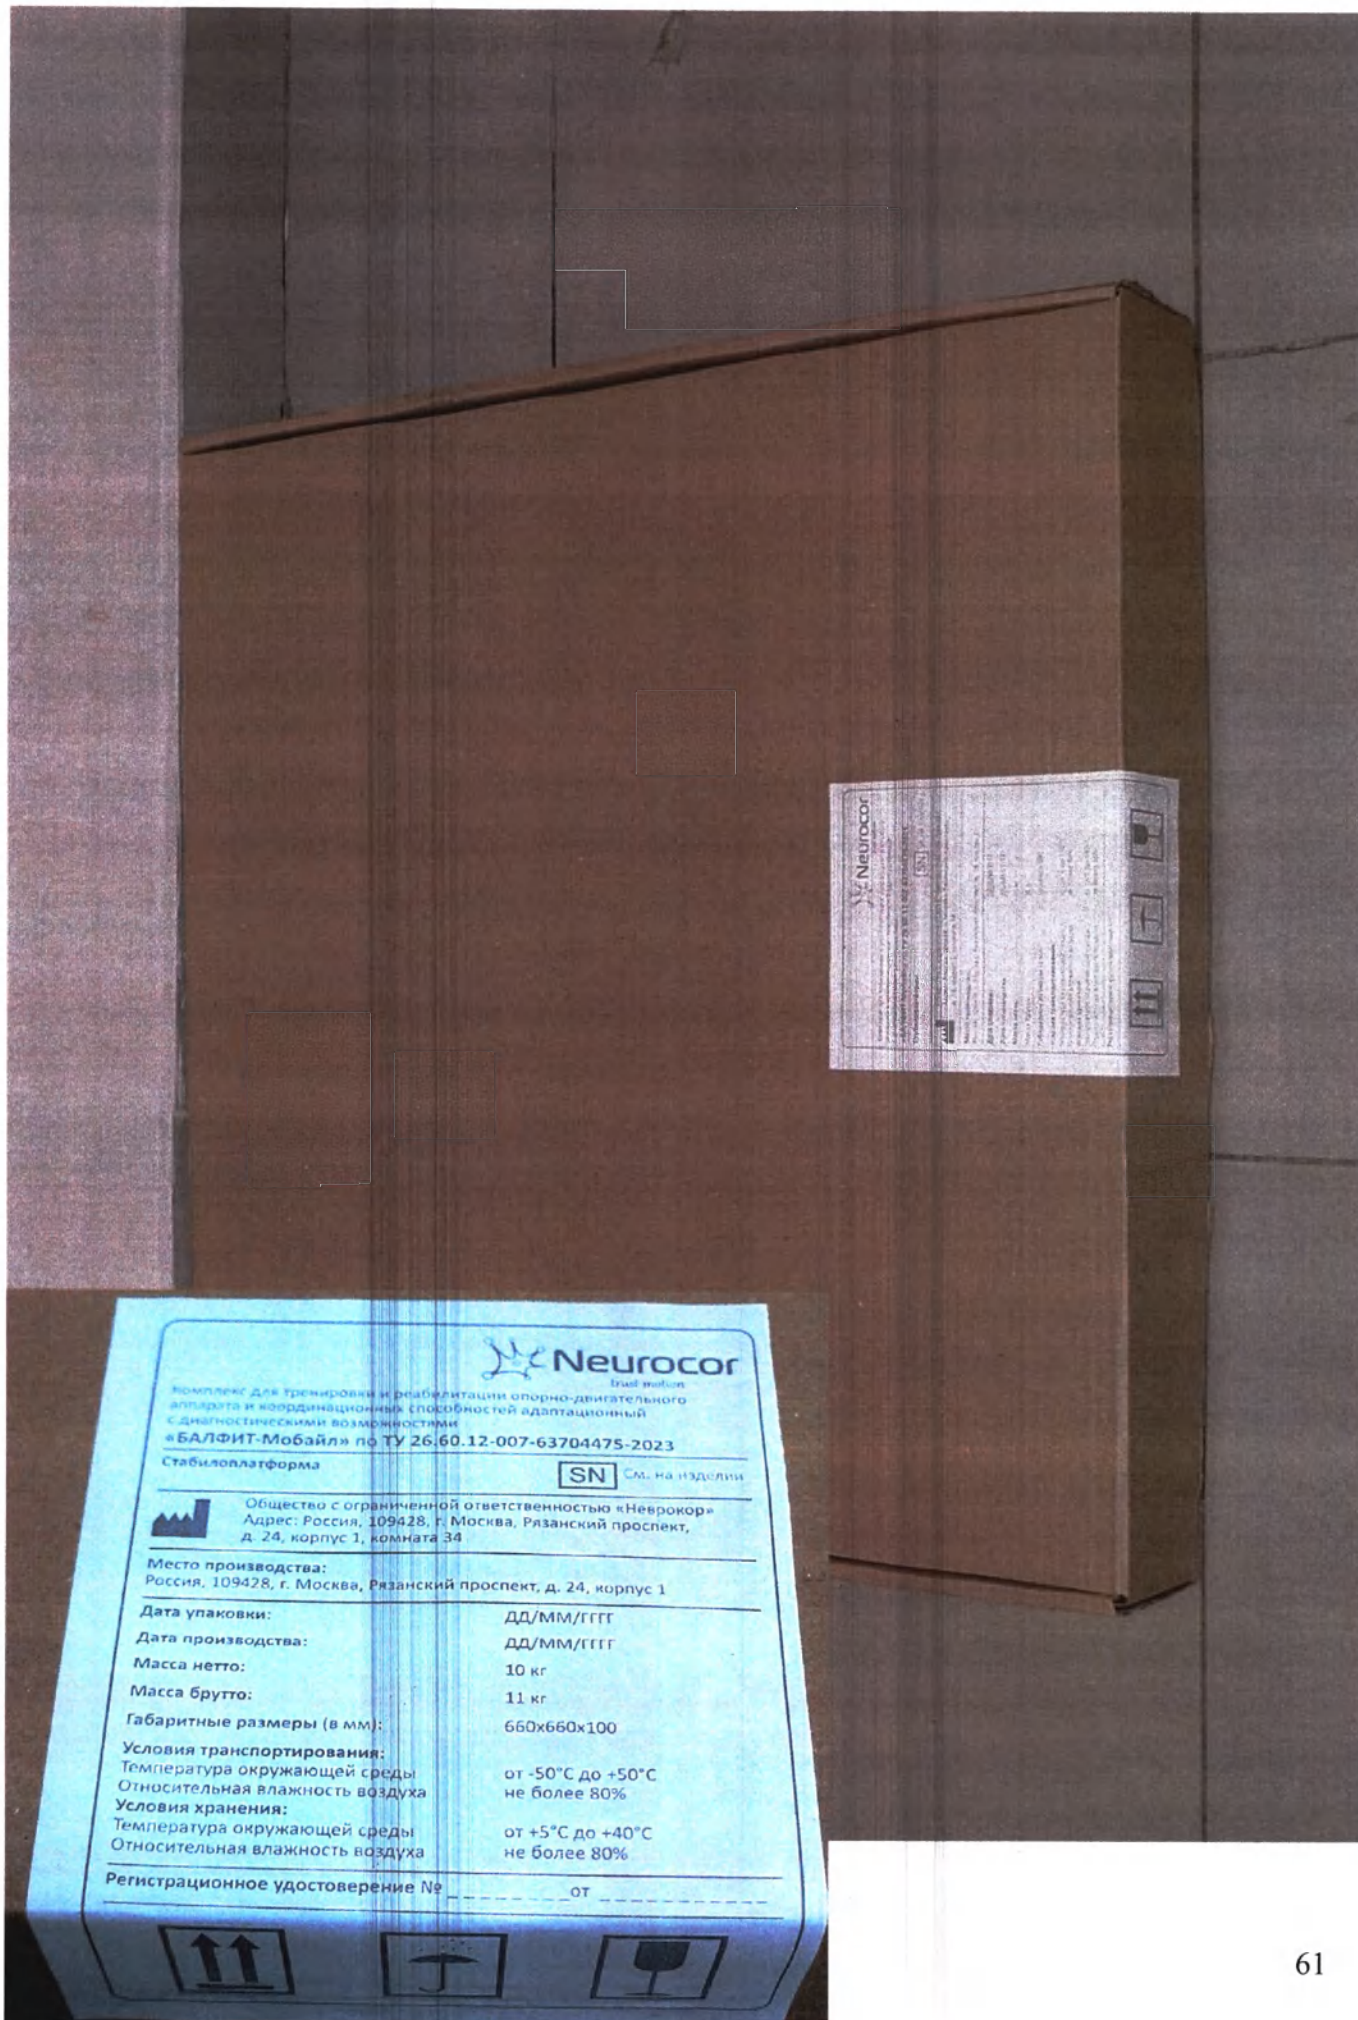


Фото транспортной упаковки

Блок управления и анализа информации в версии ПК

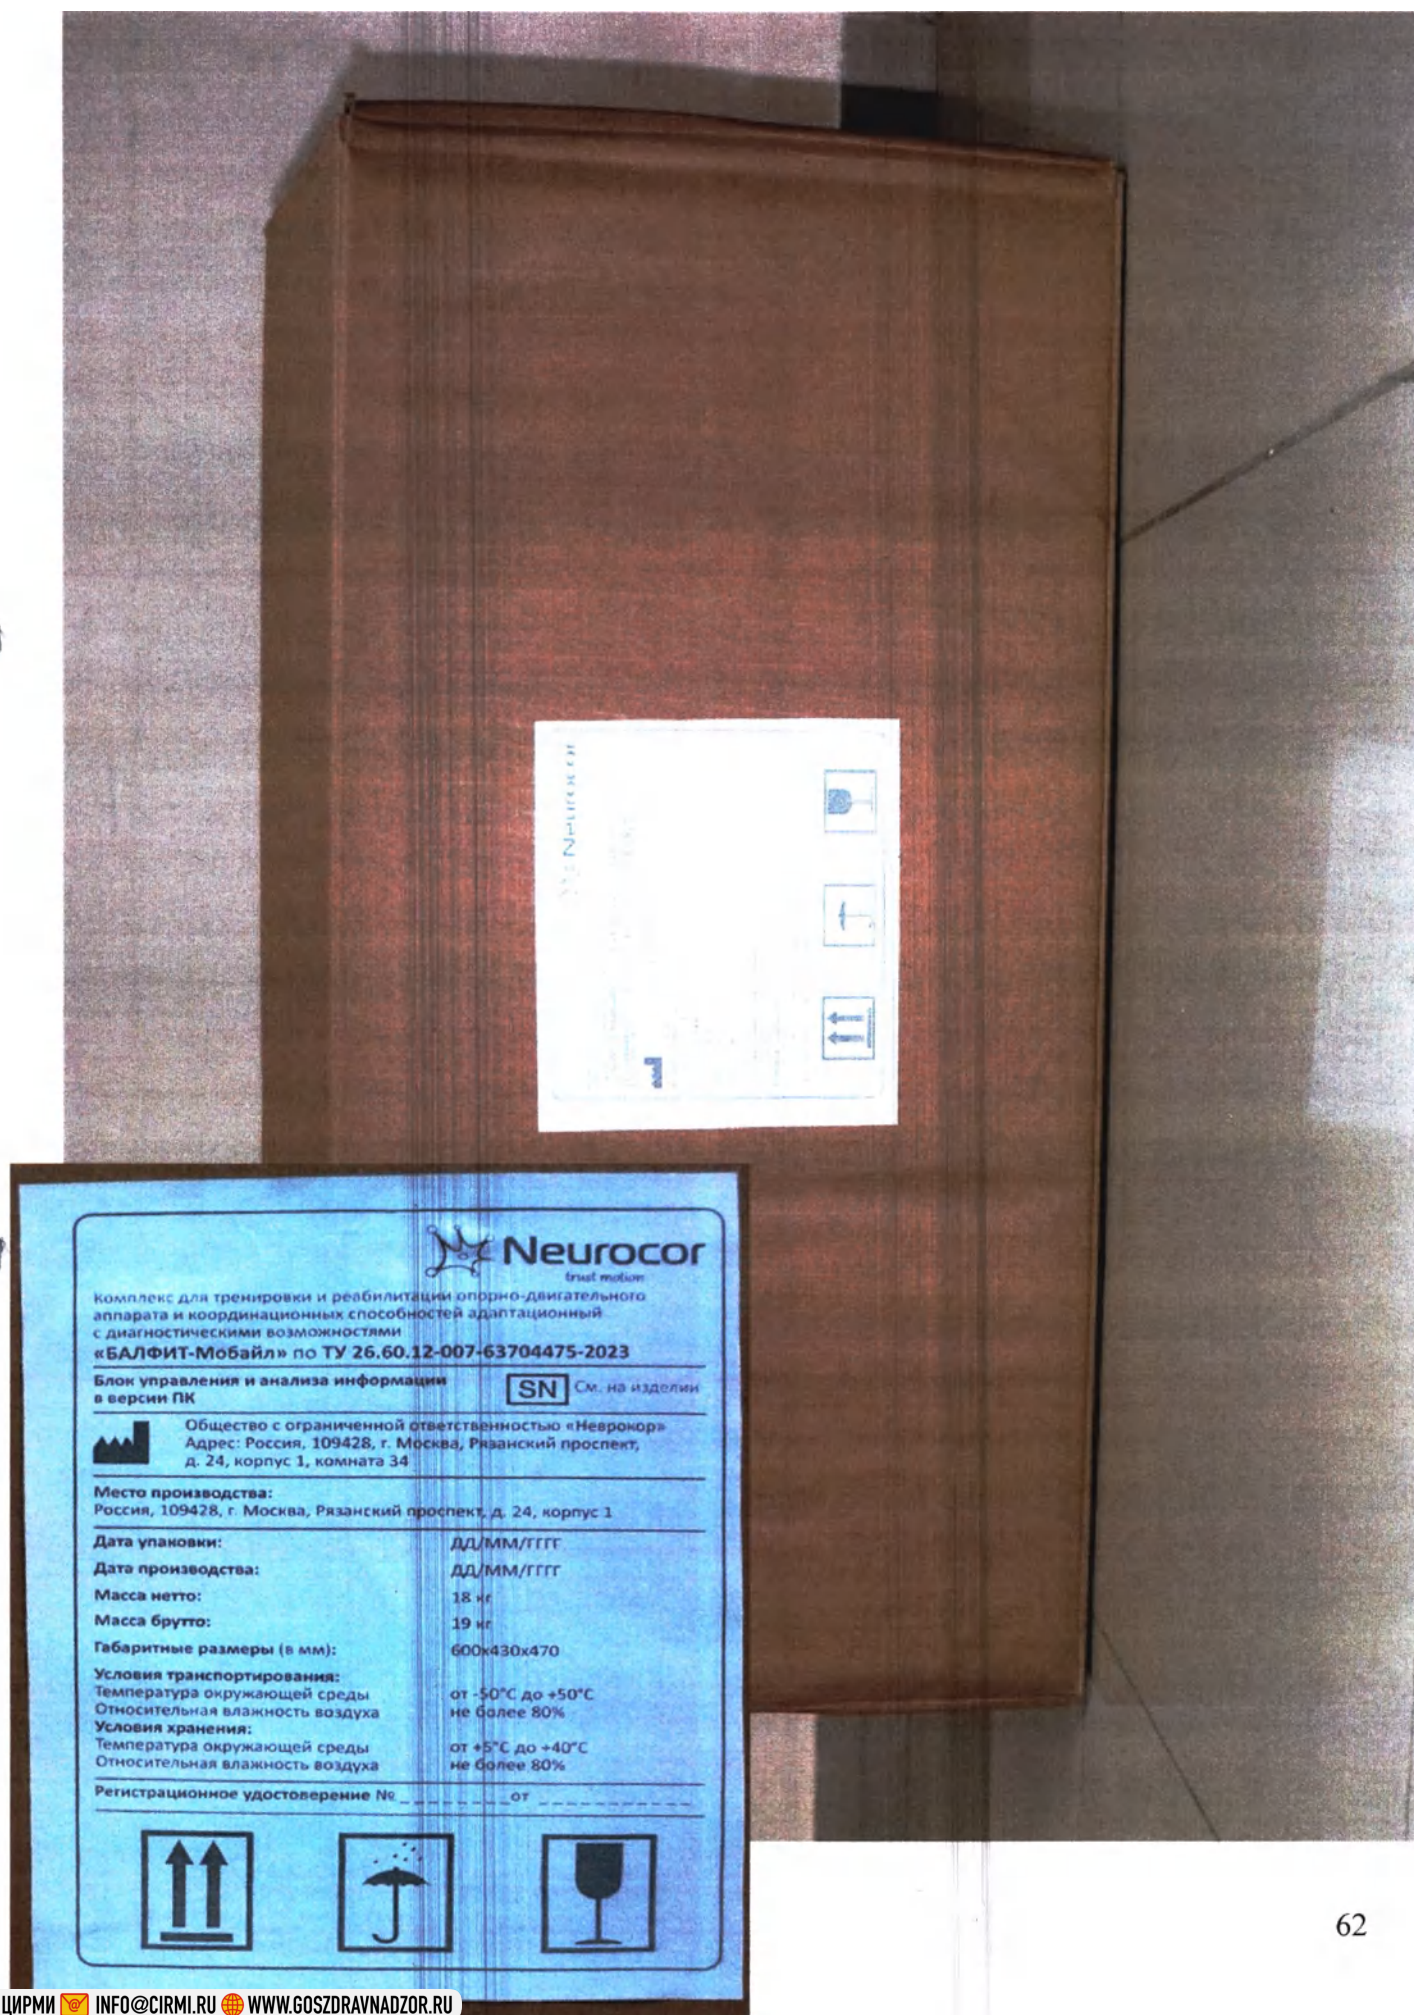


Фото транспортной упаковки

Блок управления и анализа информации в версии ноутбук



Фото транспортной упаковки

Пандус с перилами для стабилоплатформы



Neurocor
Trust motion

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Пандус с перилами
для стабилоплатформы

SN См. на изделии

Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект,
д. 24, корпус 1, комната 34

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Дата упаковки:	ДД/ММ/ГГГГ
Дата производства:	ДД/ММ/ГГГГ
Масса нетто:	32 кг
Масса брутто:	36 кг
Габаритные размеры (в мм):	1200x1100x170
Условия транспортирования:	
Температура окружающей среды	от -50°C до +50°C
Относительная влажность воздуха	не более 80%
Условия хранения:	
Температура окружающей среды	от +5°C до +40°C
Относительная влажность воздуха	не более 80%

Регистрационное удостоверение № _____ от _____





Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Датчик биомеханический носимый

SN

RUSNB2002109

MD

ру

IP20







Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды от +10 °C до -35 °C

Относительная влажность воздуха не более 80%



2024-12-01

Uвх = 5,0 В

Pн 2,5 ВА

Uвых = 3,3 В

Iнагр 0,45 А



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Дисплей Модуля БОС (модель БОС30)

SN

RUSNC2002826

ру

IP20





Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды от +10 °C до -35 °C

Относительная влажность воздуха не более 80%



2024-12-01

Uн 220 В, 50 Гц

Pн 100 ВА

**Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Дисплей Модуля БОС (модель БОС40)

SN**RUSNC2002826****РУ****IP20**

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 С до +35 С
не более 80%

Uн 220 В, 50 Гц**Pн** 100 ВА**2024-12-01****Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Дисплей Модуля БОС (модель БОС50)

SN**RUSNC2002826****РУ****IP20**

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 С до +35 С
не более 80%

Uн 220 В, 50 Гц**Pн** 100 ВА**2024-12-01**

**Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Стойка Модуля БОС

SN**RUSNC2002826****PU**

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%



2024-12-01

**Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Стабилоплатформа

SN**RUSNC2002158****MD****PU****IP20**

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%

Uн == 5 В

Pн 36 ВА



2024-12-01

**Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Зарядное устройство (модель 1)

SN**RUSNB2002680****PU****IP20**

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%

Uвх 220 В, 50 Гц**Uвых === 5 В****Рн 10 ВА****2024-12-01****Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Зарядное устройство (модель 2)

SN**RUSNB2002982****PU****IP20**

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%

Uн === 5 В**Рн 36 ВА****2024-12-01**



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок питания (модель 1)

SN

RUSNB2003029

РУ

IP20



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды

от +10 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха

не более 80 %

Uвх 220 В, 50 Гц

Uвых == 18 В

Pн 40 ВА



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

**ПО «Биомеханика Неврокор»
на электронном носителе**

РУ

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды

от +10 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха

не более 80 %



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

ПО «Стабилометрия Неврокор» на электронном носителе

РУ



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от -10 °C до +35 °C
не более 80 %



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок управления и анализа информации Системный блок

SN

RUSNC2002825

РУ

IP20



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от -10 °C до +35 °C
не более 80 %



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Невро-Эрп»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок управления и анализа информации Монитор

SN

RUSNC2002825

PU

IP20



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды

от -10 С до +35 С

Относительная влажность воздуха

не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Невро-Эрп»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок управления и анализа информации Клавиатура

SN

PU

IP20



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды

от -10 С до +35 С

Относительная влажность воздуха

не более 80%



2024-12-01

**Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок управления и анализа информации

Мышь

SN**PU****IP20**

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от -10 °C до +35 °C
не более 80%



2024-12-01

**Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок управления и анализа информации

Кабель питания C13

SN**PU****IP20**

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от -10 °C до +35 °C
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428 г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок управления и анализа информации

Кабель питания C13-C14

SN

RUSNC2002825

РУ

IP20



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428 г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок управления и анализа информации

Кабель видеосигнала

SN

РУ

IP20



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%



2024-12-01

**Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок управления и анализа информации

Адаптер

SN**RUSNC2002825****РУ****IP20**

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от -10 С до +35 С
не более 80%

Uн 220 В, 50 Гц**Рн** 400 ВА

2024-12-01

**Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок управления и анализа информации

в версии ноутбук

SN**RUSND2001136****РУ****IP20**

Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от -10 С до +35 С
не более 80%

Uн 220 В, 50 Гц**Рн** 400 ВА

2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Разанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Разанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Пандус с перилами для стабиллоплатформы

SN

RUSNC2002825

RU



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от -10°C до +35°C
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Разанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Разанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

ПО «3D-сканер Неврокор» на электронном носителе

RU



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10°C до +35°C
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Разанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Разанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

ПО «Программа для управления базой данных Неврокор» на электронном носителе



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Разанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Разанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Кабель отведений (модель 1) размер: 100 мм



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Нейрокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Кабель отведений (модель 1)

размер: 200 мм



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10°С до +35°С
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Нейрокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Кабель отведений (модель 1)

размер: 300 мм



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10°С до +35°С
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Нейрокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Кабель отведений (модель 1)
размер: 500 мм



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 50%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Нейрокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Кабель отведений (модель 1)
размер: 1000 мм



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 50%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Кабель отведений (модель 2)

размер: 100 мм



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от -10 С до +35 С
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Кабель отведений (модель 2)

размер: 200 мм



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от -10 С до +35 С
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Кабель отведений (модель 2)
размер: 300 мм



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от -10 °C до +35 °C
не более 80 %



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Кабель отведений (модель 2)
размер: 500 мм



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от -10 °C до +35 °C
не более 80 %



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Нейрокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Кабель отведений (модель 2)

размер: 1000 мм



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Нейрокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Крепежное устройство датчика



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428 г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Нейрокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Сенсор тензометрический (модель 1) с крепежным устройством

SN

RUSNA2001835

MD

РУ

IP20



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428 г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Нейрокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного аппарата и координационных способностей адаптационный с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Сенсор тензометрический (модель 2)

SN

RUSNA2001836

MD

РУ

IP20



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды
Относительная влажность воздуха

от +10 °C до +35 °C
не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Кабель интерфейсный USB



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды

от +10 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха

не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1


Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Система видеорегистрации

Стойка видеорегистрации

SN **RUSNA2002811**



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды

от +10 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха

не более 80%



Uн == 12 В

Pн 40 ВА

2024-12-01

**Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Система видеорегистрации Основание

SN**RUSNA2002811****PU****Условия эксплуатации:**

Температура окружающей среды

от +10 С до +35 С

Относительная влажность воздуха

не более 80%



2024-12-01

**Neurocor**

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Система видеорегистрации Опора регулировочная

SN**RUSNA2002811****PU****Условия эксплуатации:**

Температура окружающей среды

от +10 С до +35 С

Относительная влажность воздуха

не более 80%



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Разанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Разанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Система видеорегистрации Адаптер USB

SN

RUSNA2002811

ПУ

IP20



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды

от +10 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха

не более 80%

U_н == 12 В

P_н 40 ВА



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия, 109428, г. Москва,
Разанский проспект, д. 24, корпус 1



Общество с ограниченной ответственностью «Неврокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Разанский проспект, д. 24, корпус 1

Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Блок питания (модель 2)

SN

RUSNC2002805

ПУ

IP20



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды

от +10 °C до +35 °C

Относительная влажность воздуха

не более 80%

U_н == 12 В

P_н 40 ВА



2024-12-01



Neurocor

Место производства:
Россия 109428, г. Москва,
Рязанский проспект, д. 24, корпус 1




Общество с ограниченной ответственностью «Нейрокор»
Адрес: Россия, 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 24, корпус 1

**Комплекс для тренировки и реабилитации опорно-двигательного
аппарата и координационных способностей адаптационный
с диагностическими возможностями**

«БАЛФИТ-Мобайл» по ТУ 26.60.12-007-63704475-2023

Коврик



Условия эксплуатации:

Температура окружающей среды:

от +10 °С до +35 °С

Относительная влажность воздуха

не более 80 %



2024-12-01

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
86 лист(ов)

Генеральный директор
ООО "Неврокор"
Ишутин Д.В.

