

ПОДТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «Миндрей Медикал Рус»
С. В. Вэй Сюн Вэй.
«20» декабря 2023 г.



**Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики
in vitro**

Набор реагентов для диагностики in vitro для количественного определения
антимюллерова гормона (АМН) в сыворотке или плазме крови человека
иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL

Общество с ограниченной ответственностью «Миндрей Медикал Рус»
129110, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мецанский,
пр-кт Олимпийский, д. 16, стр. 5, ан./пом. 4/1, ком. 7, 11А.
Тел.: (499) 553-60-36, факс: (499) 553-60-39
ИНН 7705815069 КПП 770201001

mindray

AMH

UDI



(01)06936415922832 (97)105-010711-A0

(10)2022110121 (99)105-010711-00

(17)240529 (98)PLM202211012100048

Anti-Mullerian Hormone (CLIA)

2×50 tests(calibrators included)

Contents: Ra: 2×3.8 mL, Rb: 2×3.5 mL

C0: 1×0.6 mL, C1: 1×0.5 mL, C2: 1×0.5 mL



SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECTRONICS CO., LTD.

Mindray Building, Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, Nanshan, Shenzhen, 518057 P.R.China

Tel :+86-755-81888998 Fax :+86-755-26582680 www.mindray.com

EC REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)
Eiffestraße 80, 20537 Hamburg, Germany

IVD



CE

0123

2°C



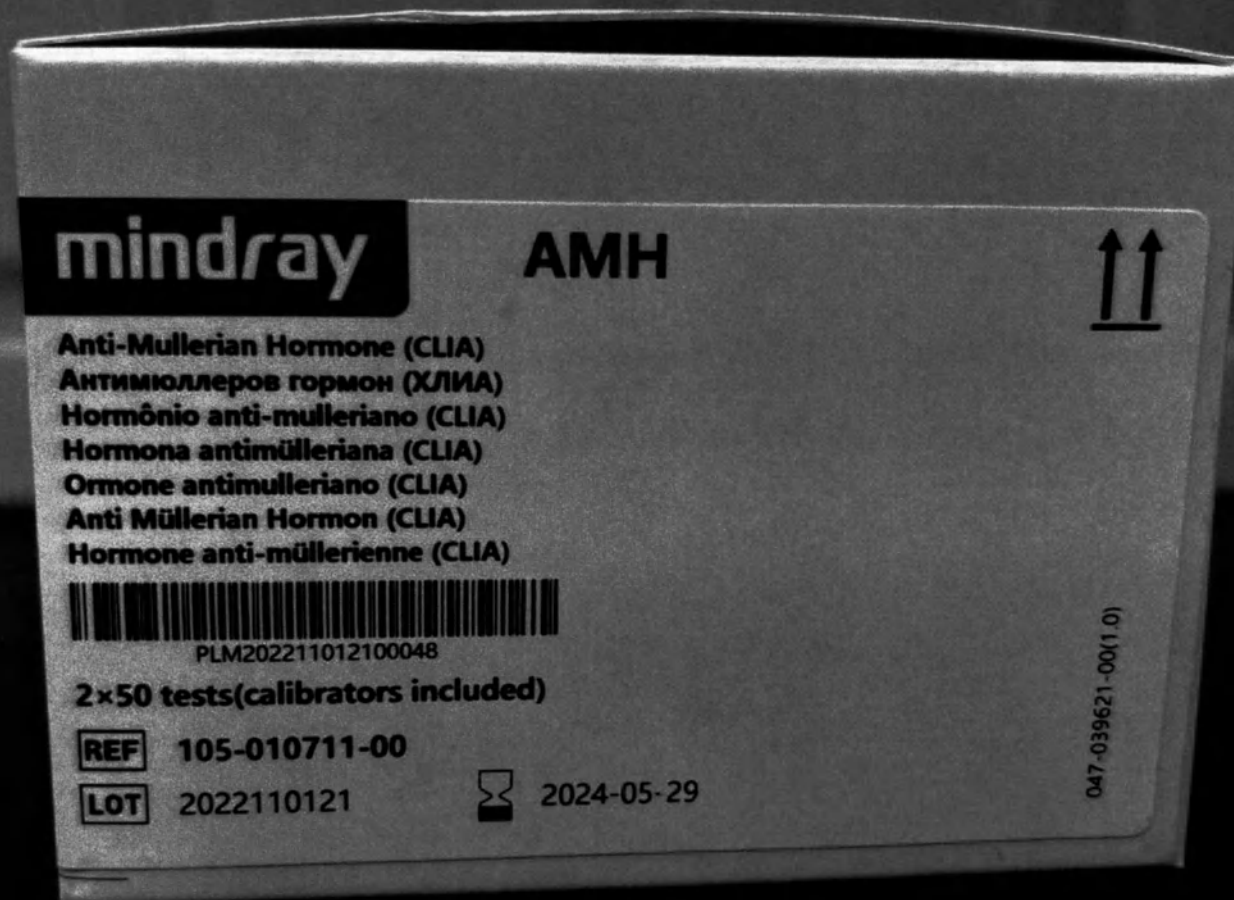


Рисунок 2. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллерова гормона (АМН) в сыворотке или

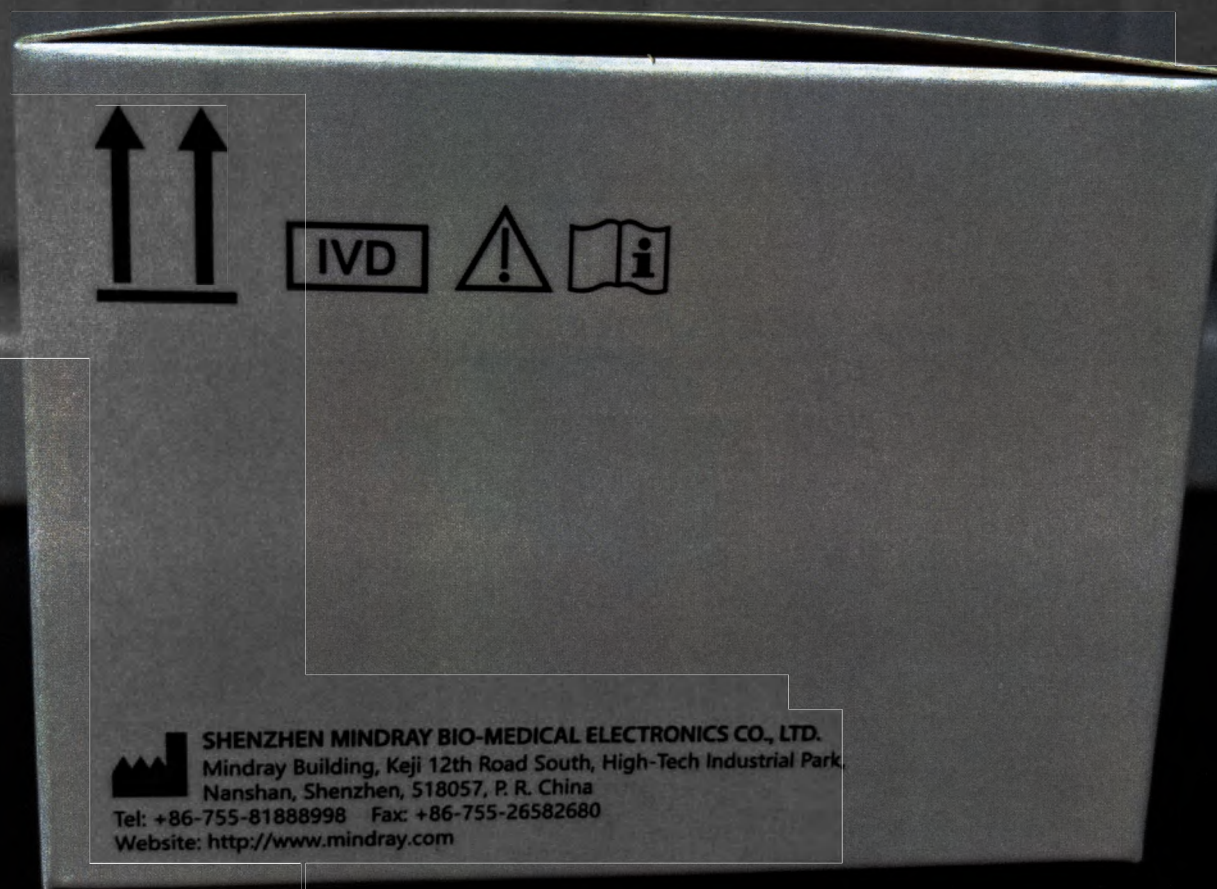


Рисунок 3. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллерова гормона (АМН) в сыворотке или

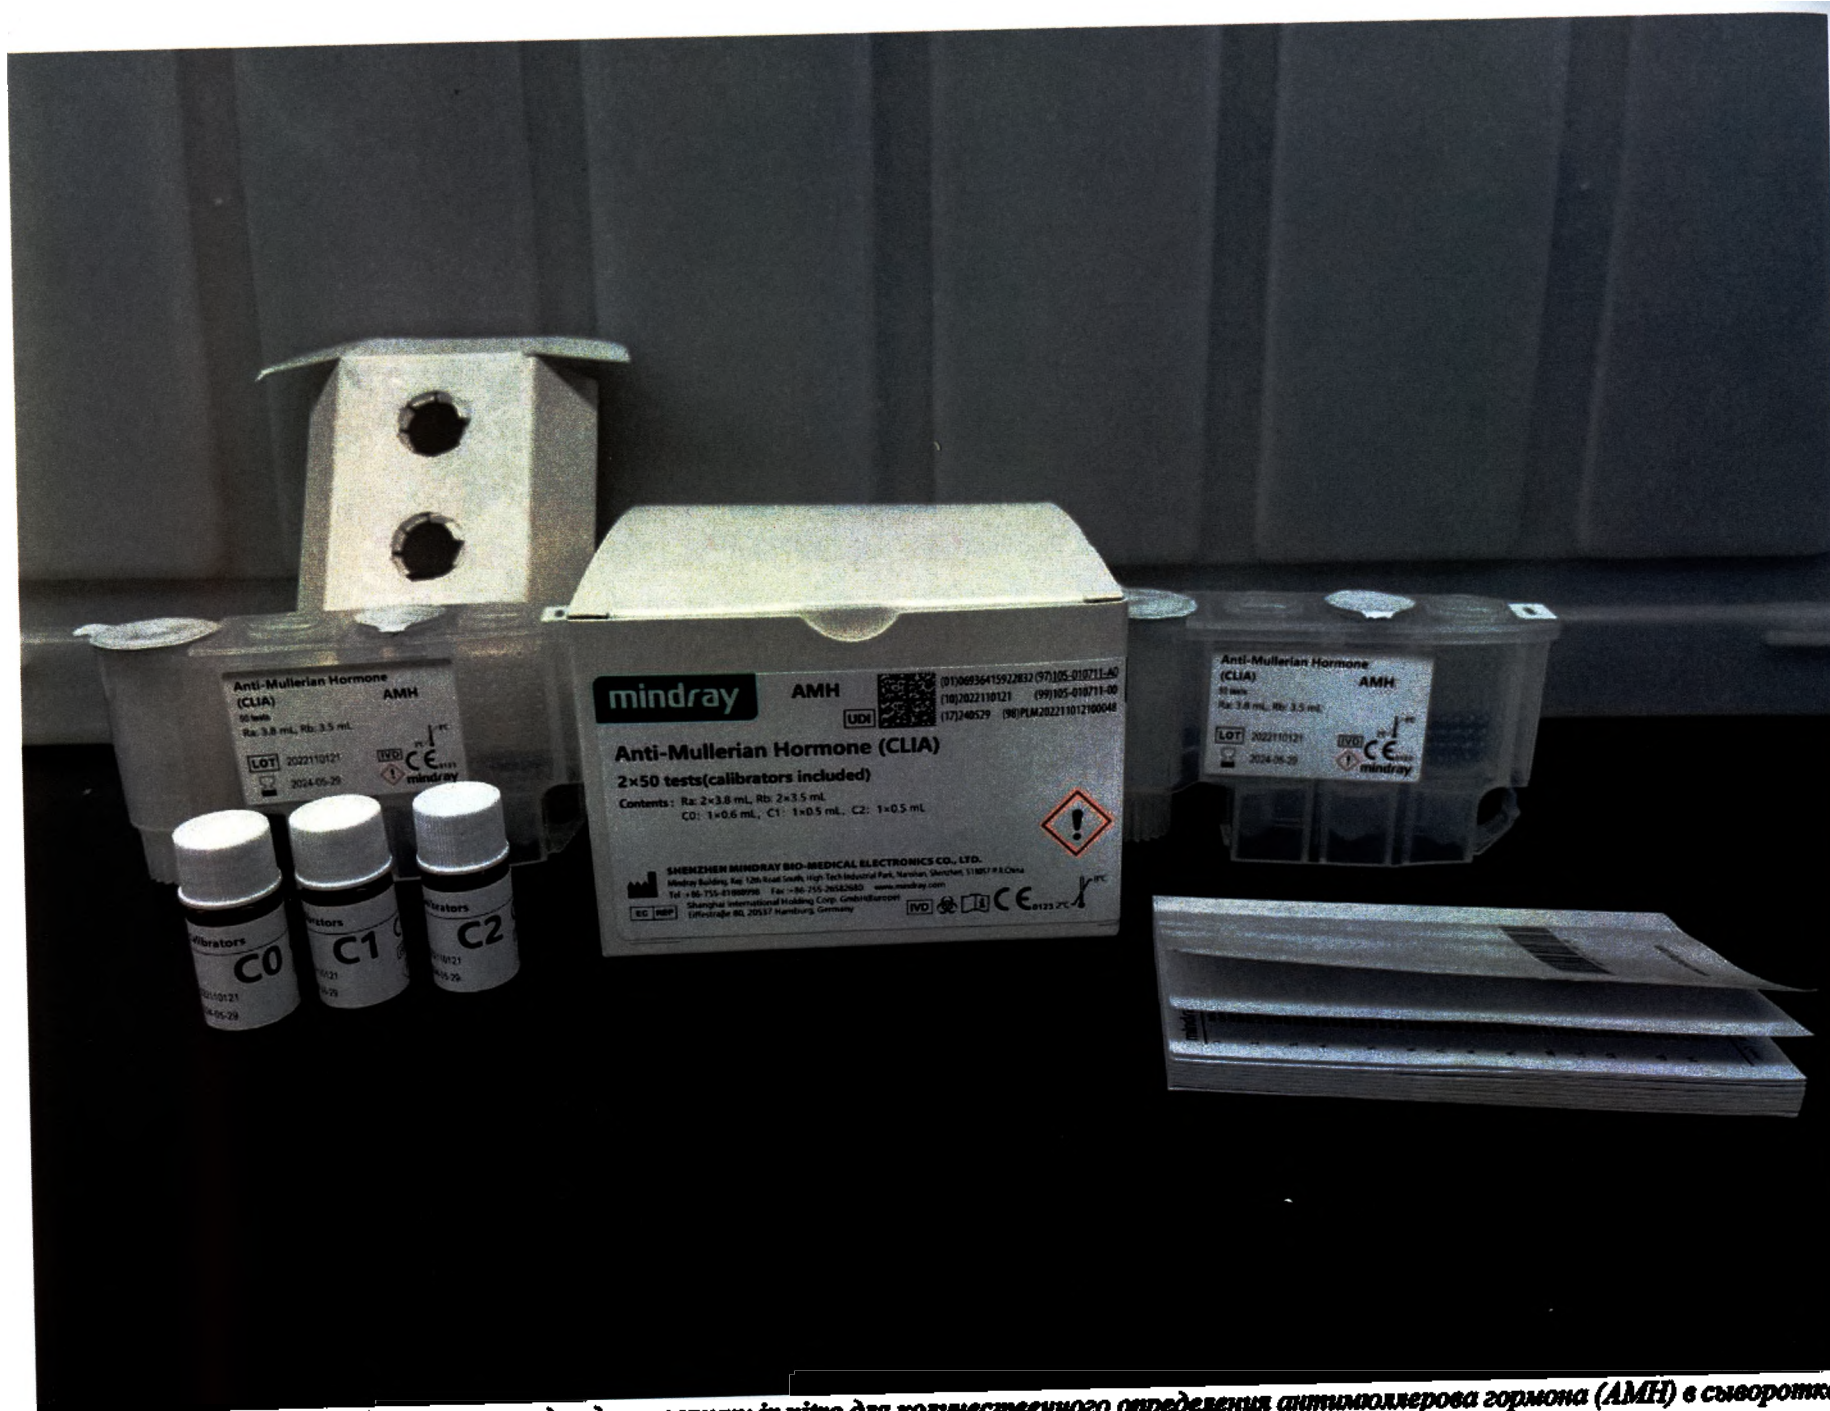


Рисунок 4. Общий вид Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллера гормона (АМН) в сыворотке или плазме



Рисунок 5. Кассета с реагентами - 2 шт. (вид 1)

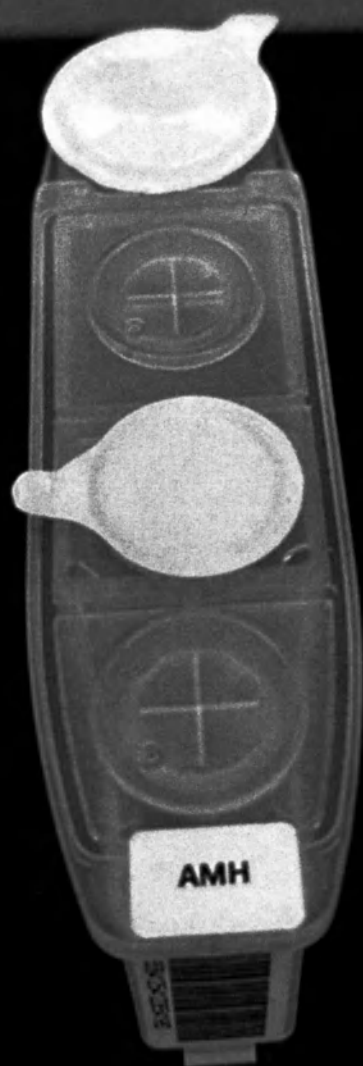


Рисунок 5. Кассета с реагентами - 2 шт. (вид 2)



Рисунок 7. Калибратор уровень 0 (C0) – 1 флакон, калибратор уровень 1 (C1) – 1 флакон, калибратор уровень 2 (C2) – 1 флакон (вид 1)

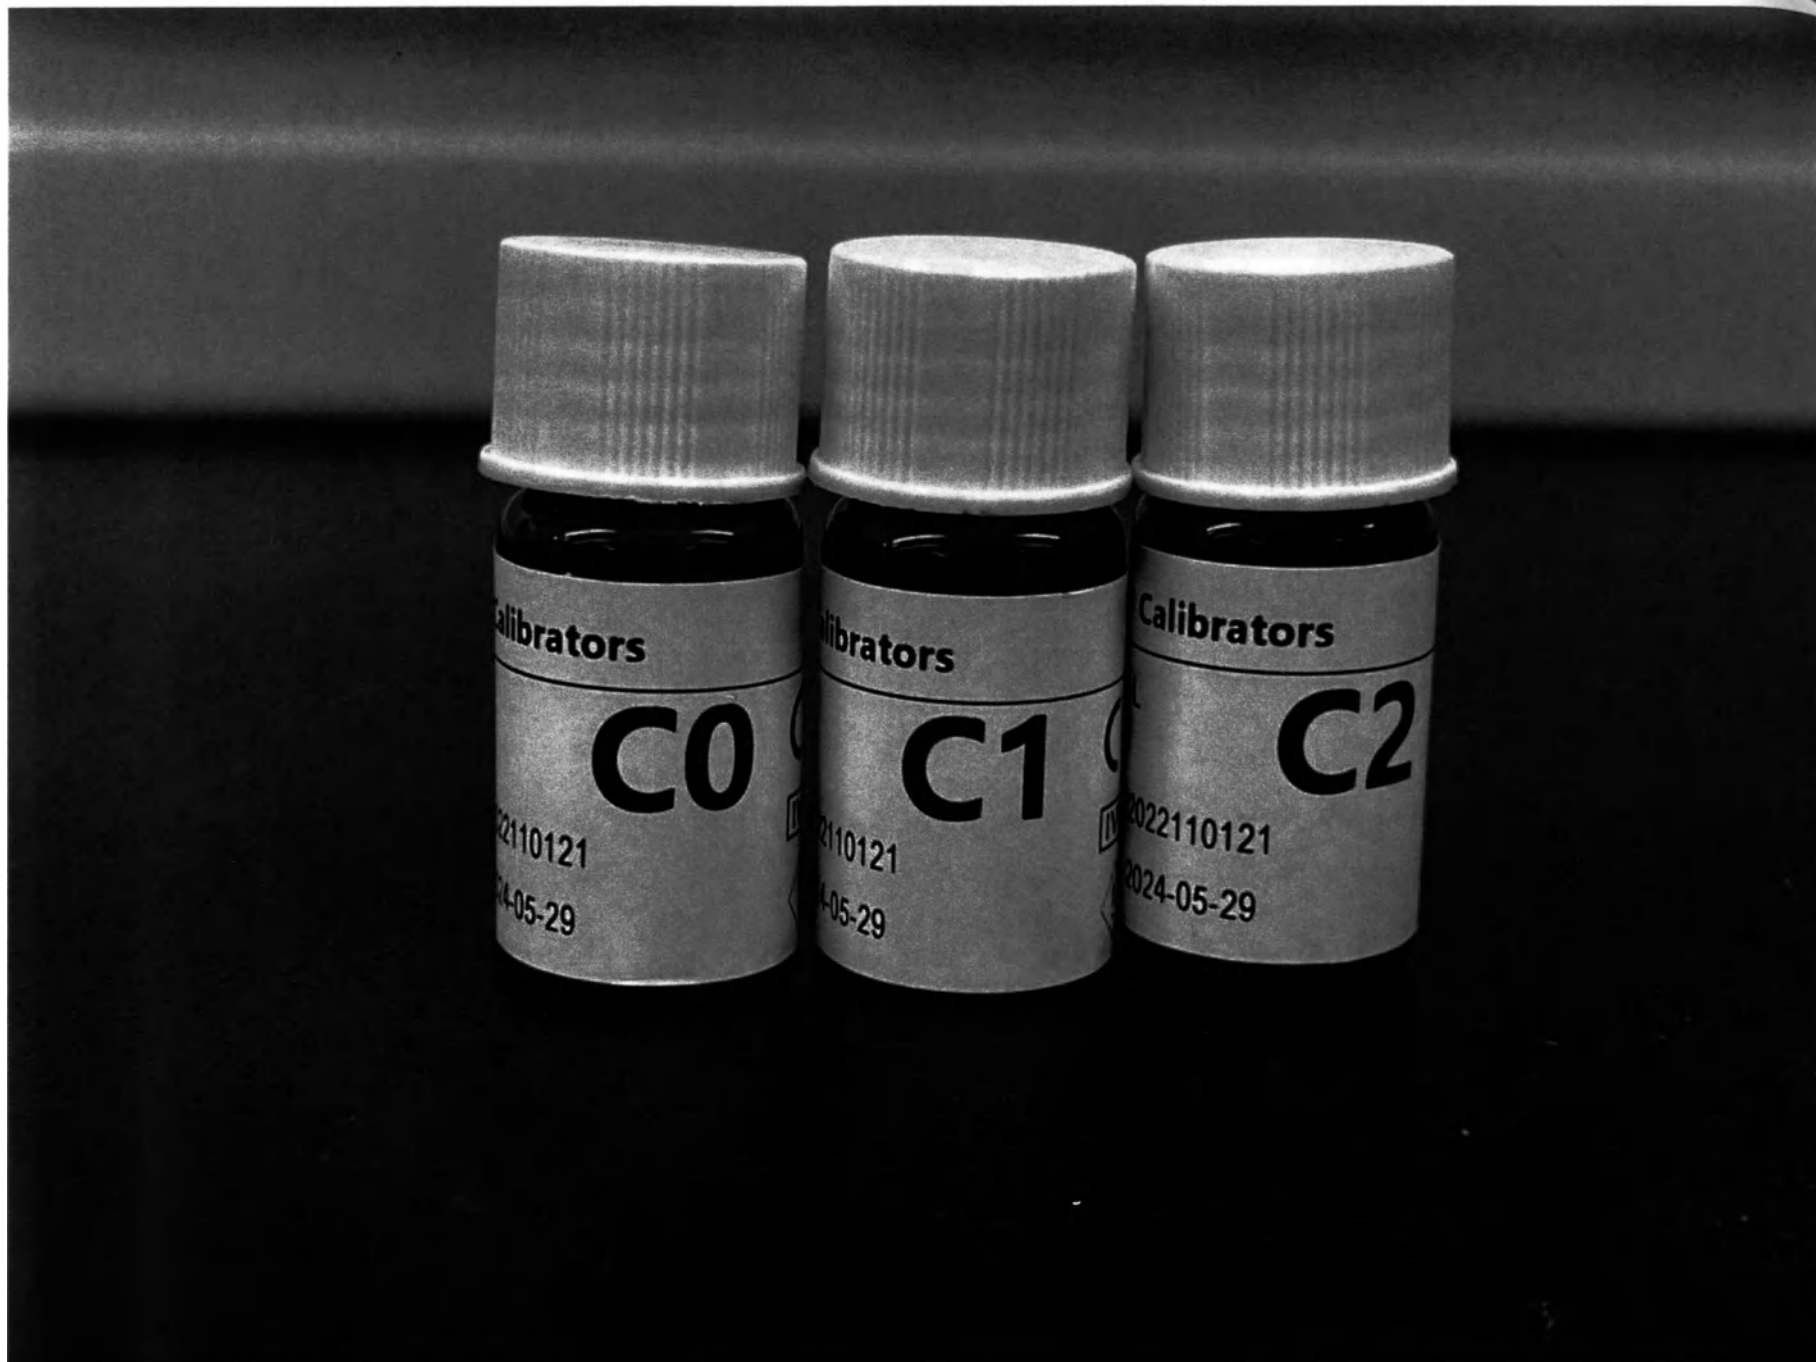


Рисунок 8. Калибратор уровень 0 (C0) – 1 флакон, калибратор уровень 1 (C1) – 1 флакон, калибратор уровень 2 (C2) – 1 флакон (вид 2)



Рисунок 9. Калибратор уровень 0 (C0) – 1 флакон, калибратор уровень 1 (C1) – 1 флакон, калибратор уровень 2 (C2) – 1 флакон (вид 3)

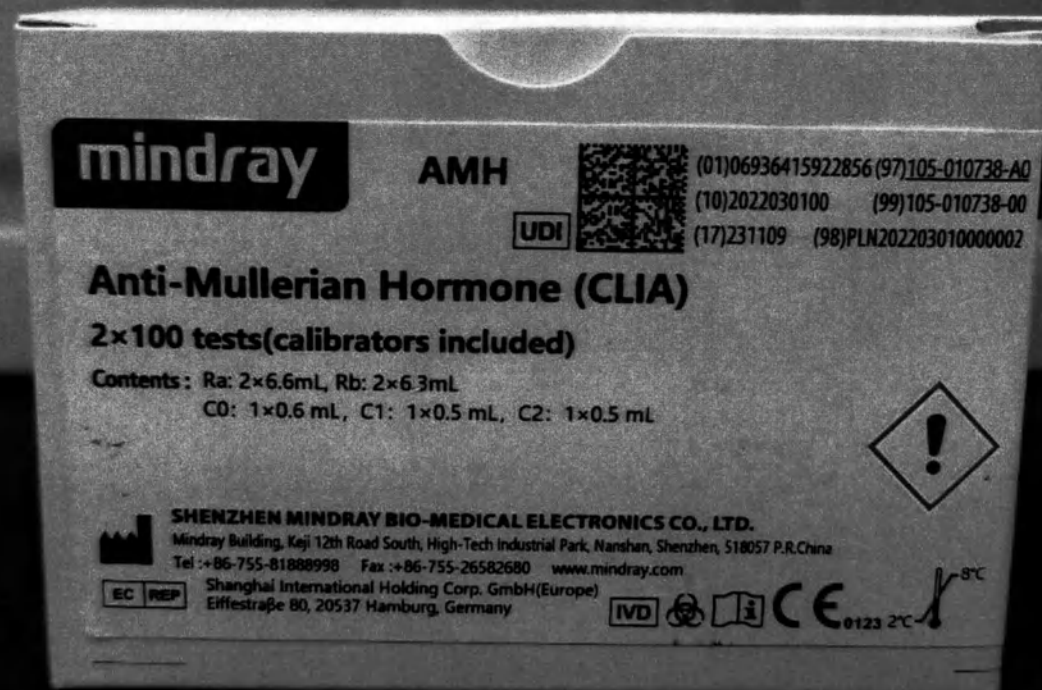


Рисунок 10. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллерова гормона (АМН) в сыворотке человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2x100 тестов (вид 1)

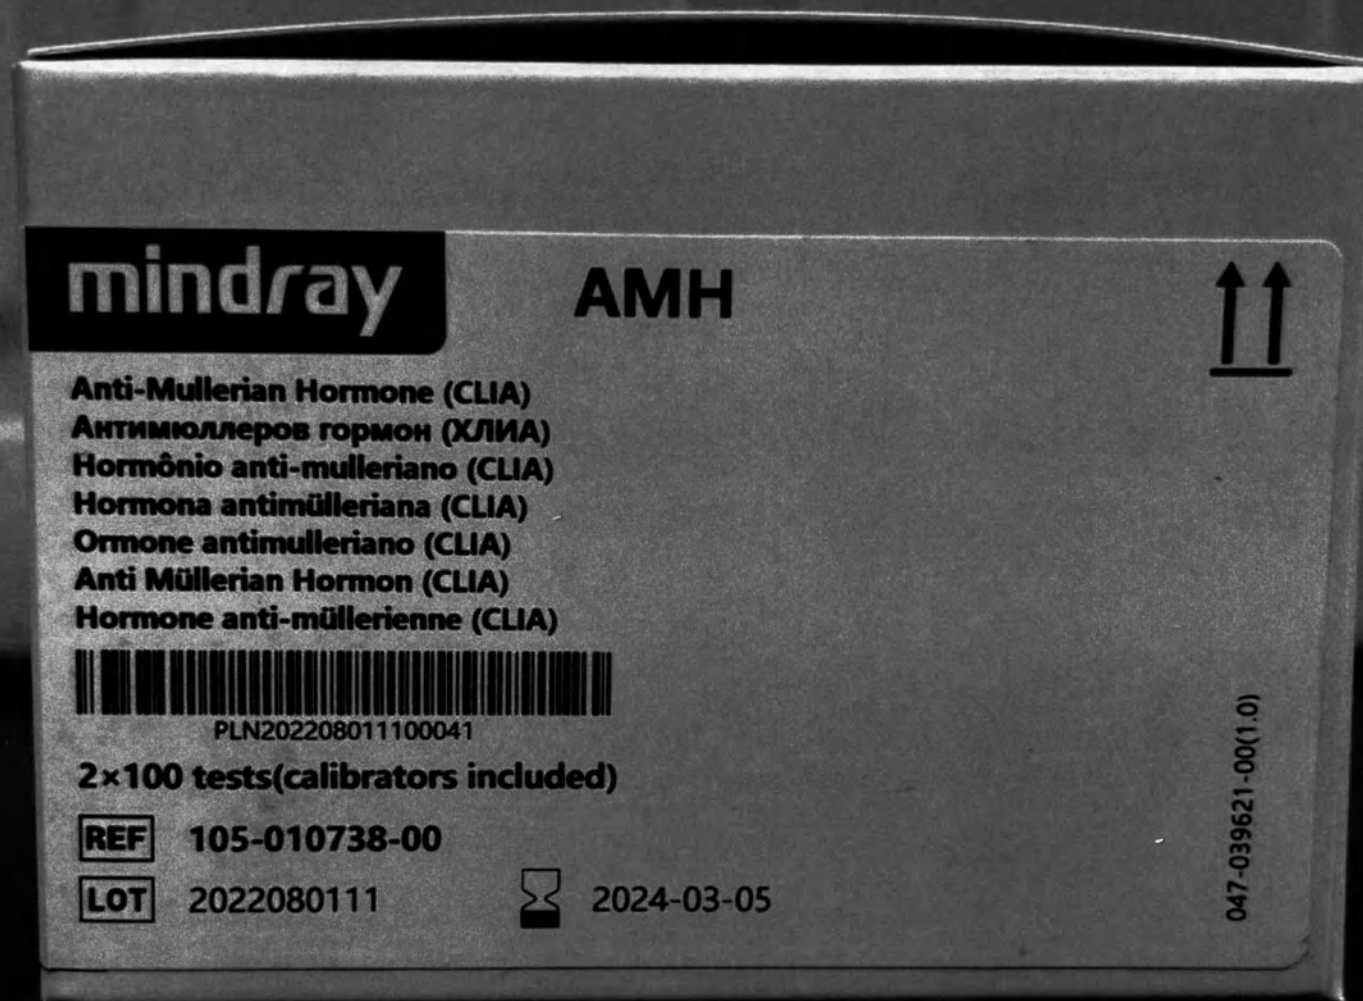


Рисунок 11. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллерова гормона (AMH) в

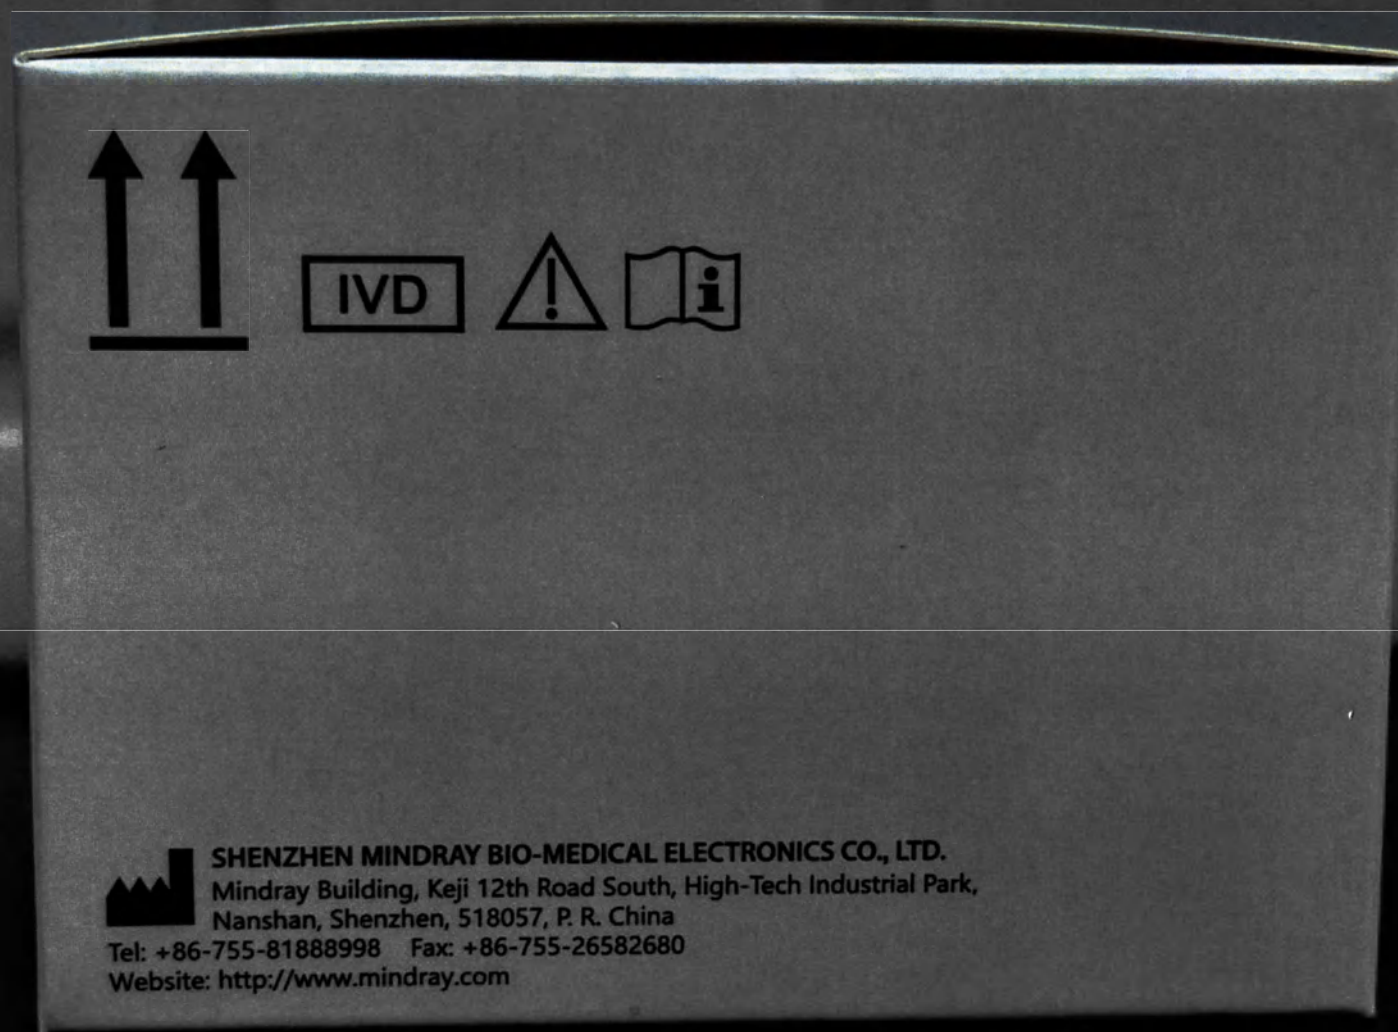


Рисунок 12. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллерова гормона (АМН) в сыворотке или плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2х100 тестов (вид 3)

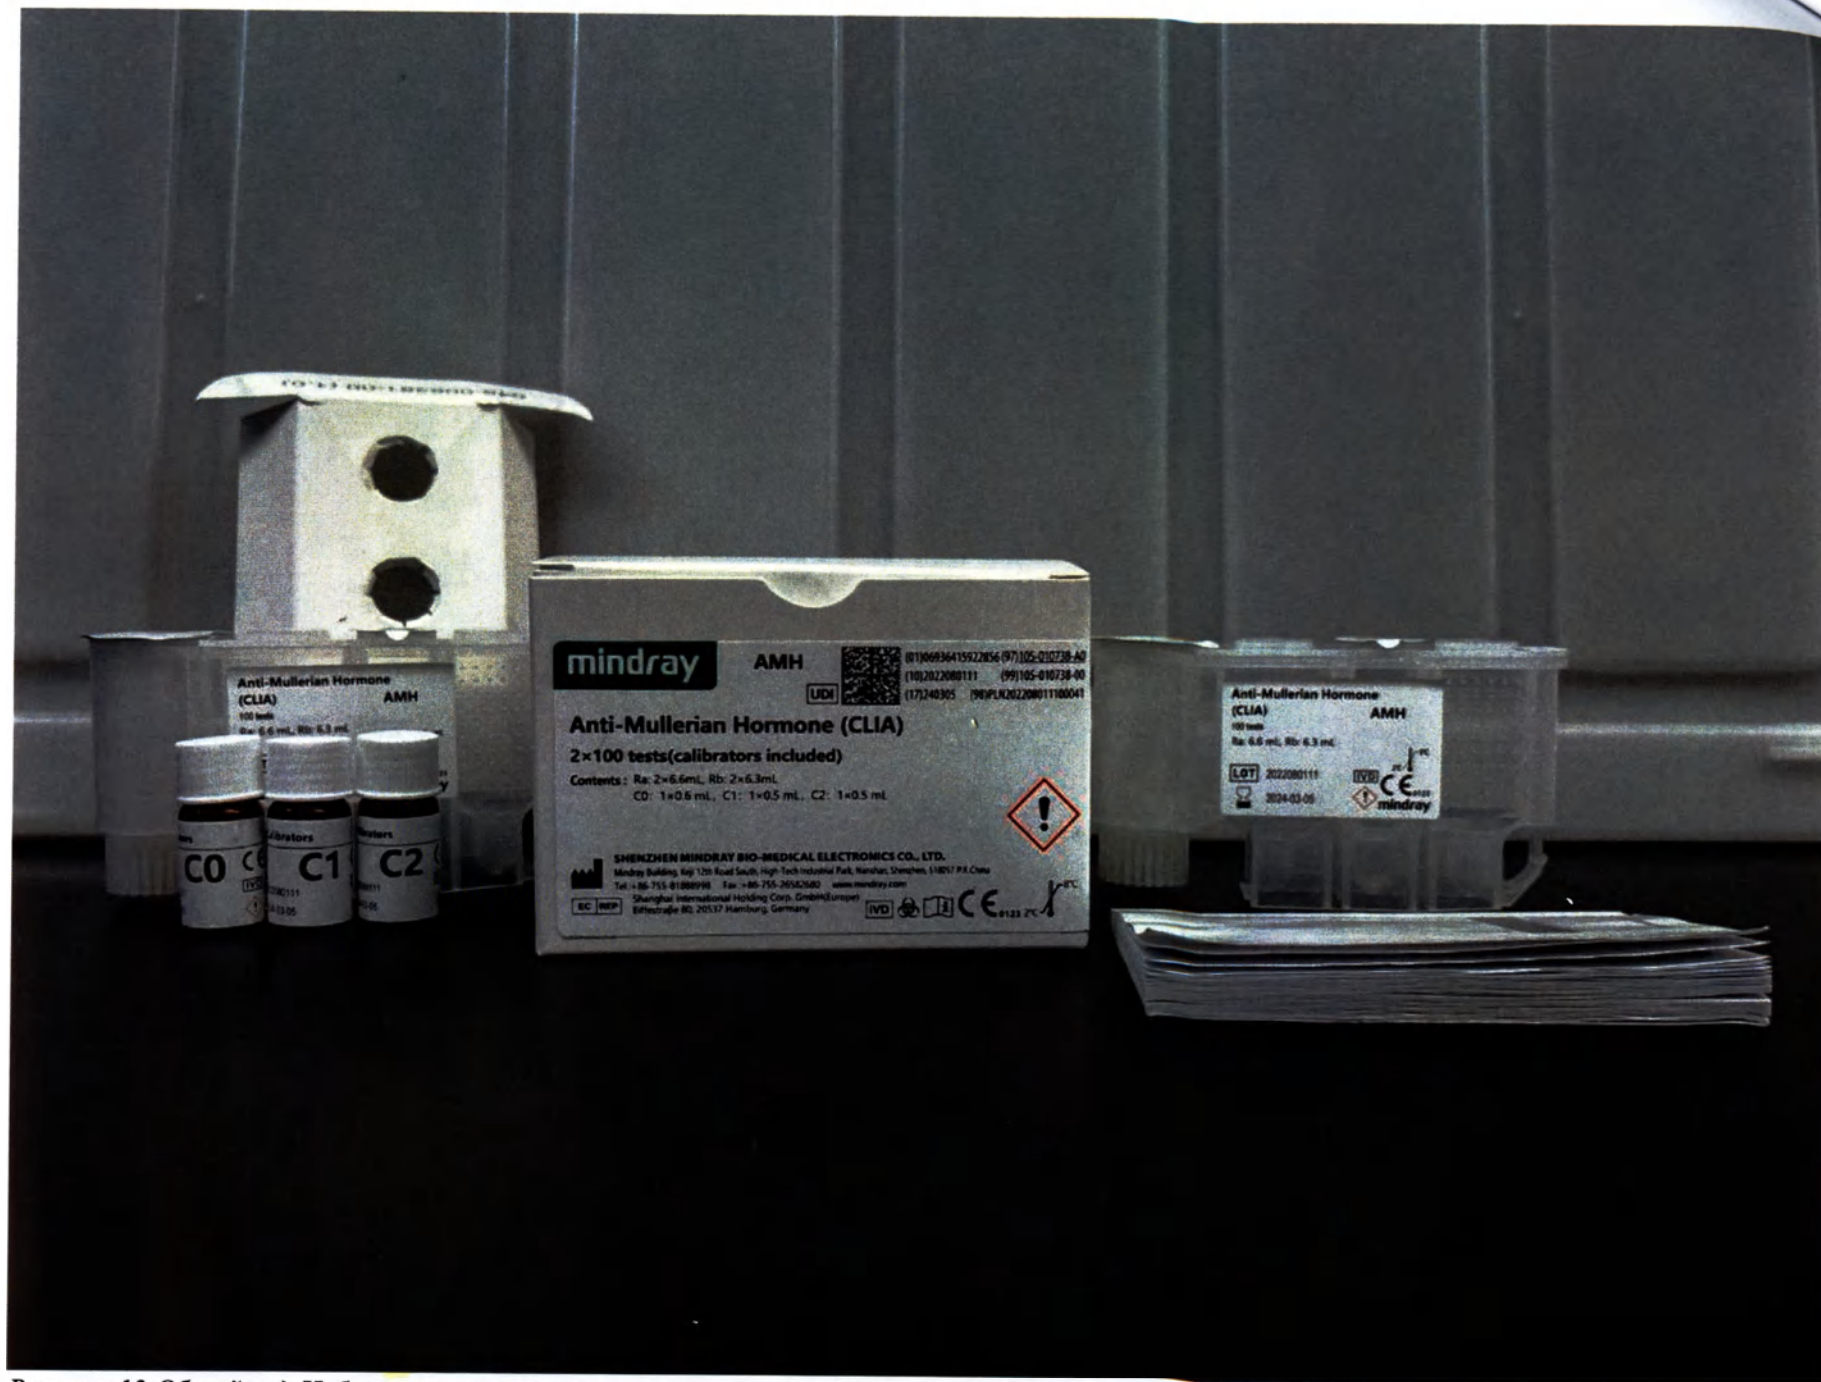


Рисунок 13 Общий вид Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллера гормона (АМН) в сыворотке или плазме крови человека иммунохемилюминесцентным методом на анализаторах серии CL, 2x100 тестов



Рисунок 14. Кассета с реагентами – 2 шт. (вид 1)

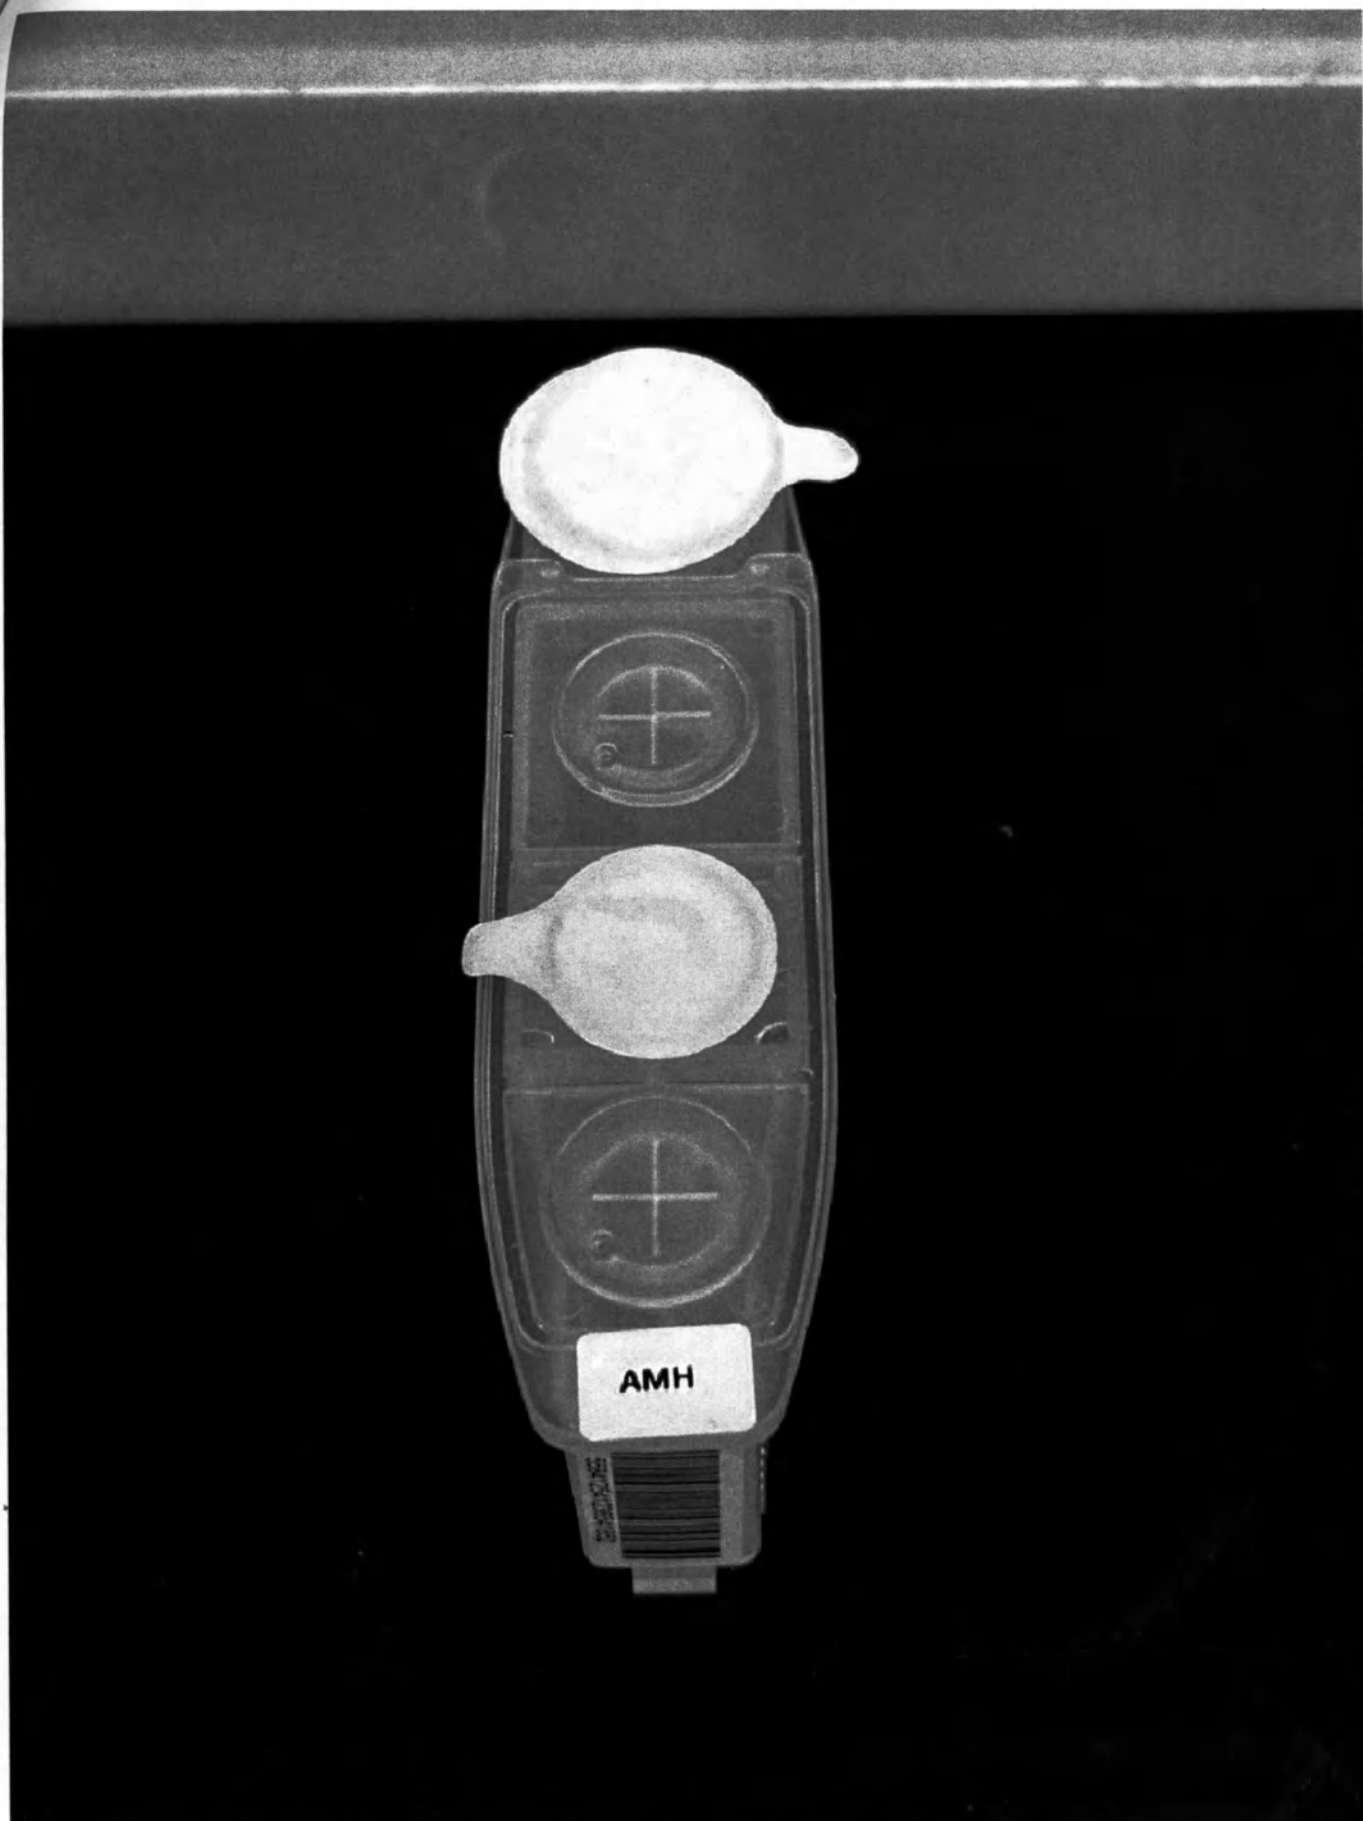


Рисунок 15. Кассета с реагентами – 2 шт. (вид 2)



Рисунок 16. Калибратор уровень 0 (C0) – 1 флакон, калибратор уровень 1 (C1) – 1 флакон, калибратор уровень 2 (C2) – 1 флакон (вид 1)



Рисунок 17. Калибратор уровень 0 (C0) – 1 флакон, калибратор уровень 1 (C1) – 1 флакон, калибратор уровень 2 (C2) – 1 флакон (вид 2)



Рисунок 18. Калибратор уровень 0 (C0) – 1 флакон, калибратор уровень 1 (C1) – 1 флакон, калибратор уровень 2 (C2) – 1 флакон (вид 3)

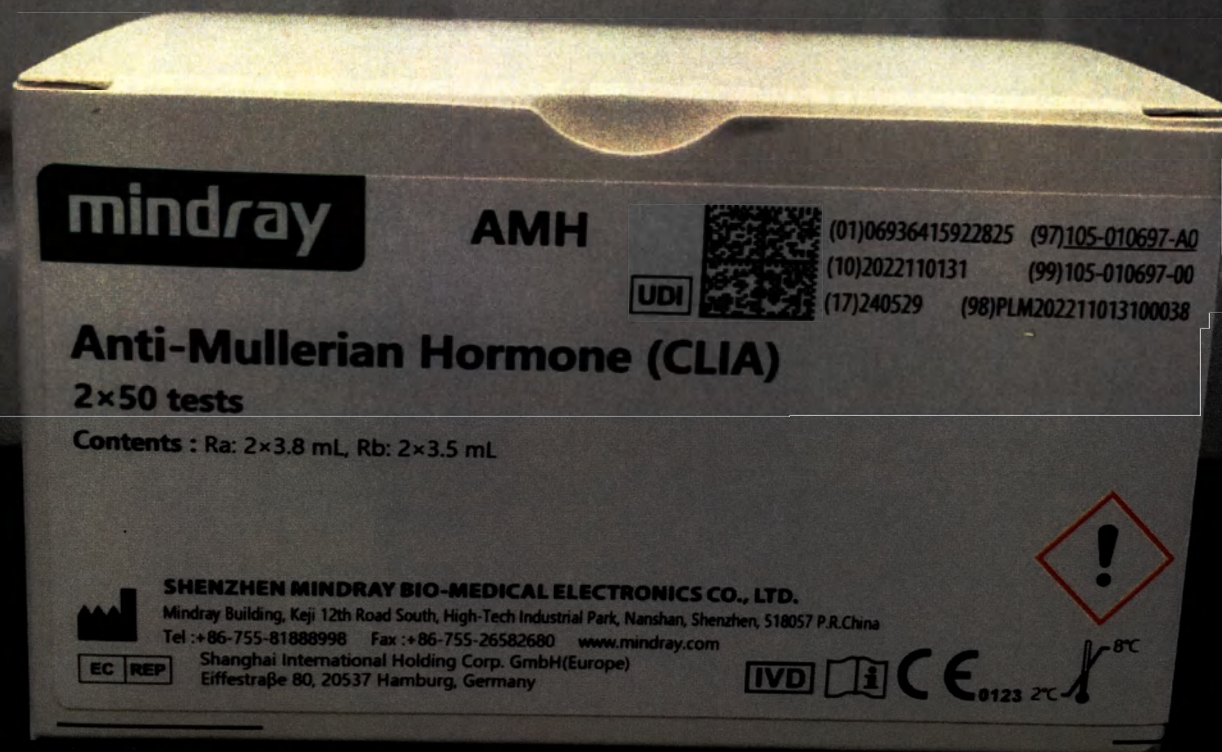


Рисунок 19. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллерова гормона (АМН) в сыворотке

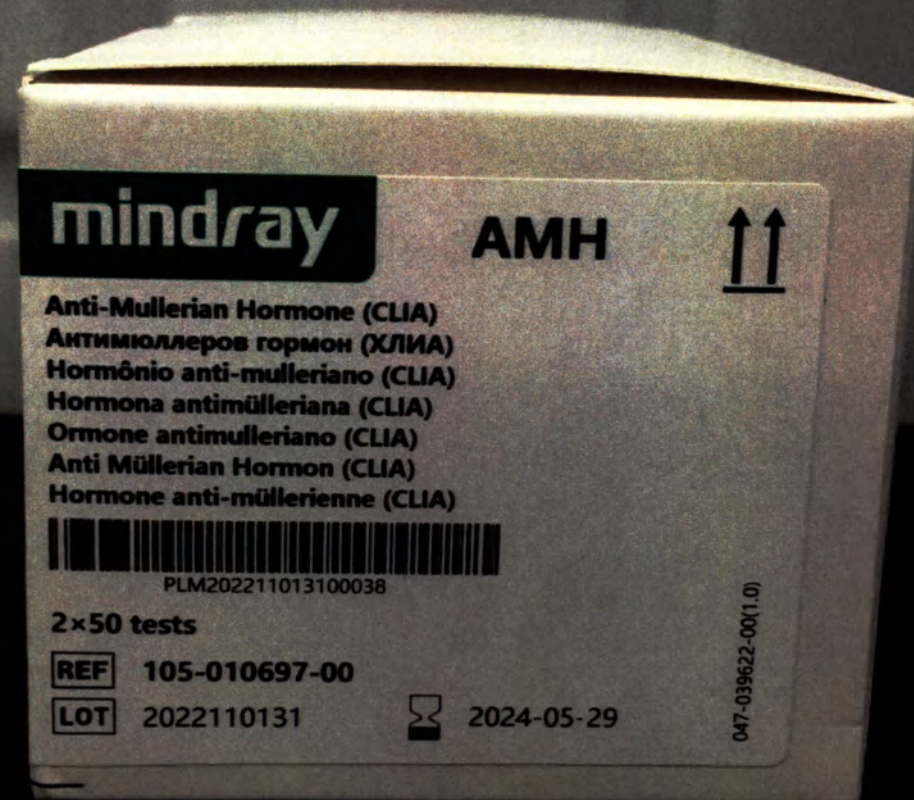


Рисунок 20. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллерова гормона (АМН) в сыворотке или плазме крови человека с использованием флуоресцентным методом на анализаторах серии CL, 2x50 тестов (вид 2)



Рисунок 21. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллерова гормона (АМН) в сыворотке



Рисунок 22. Общий вид Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллера гормона (АМН) в сыворотке или



Рисунок 23. Кассета с реагентами – 2 шт. (вид 1)

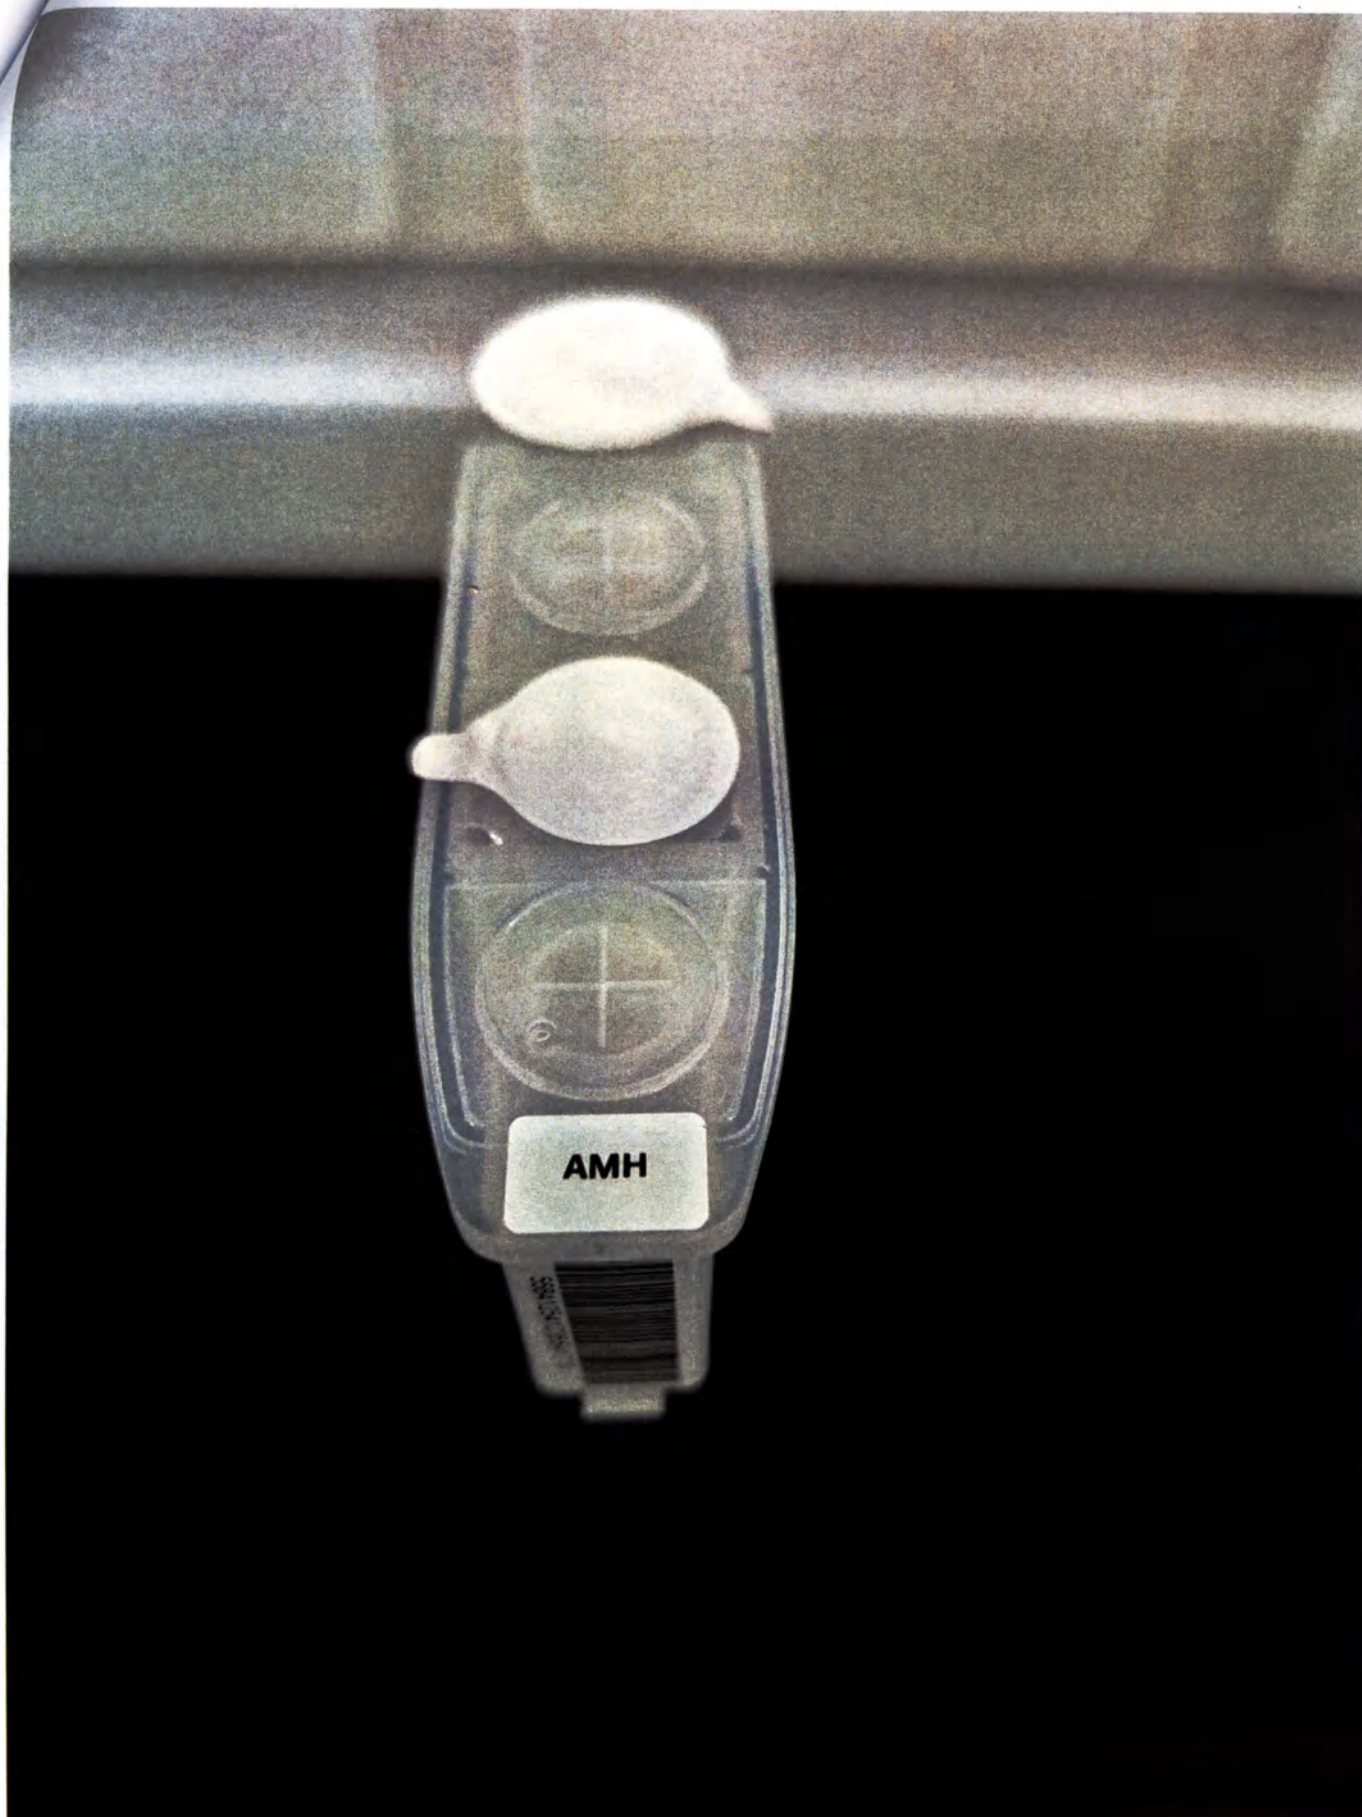


Рисунок 24. Кассета с реагентами – 2 шт. (вид 2)

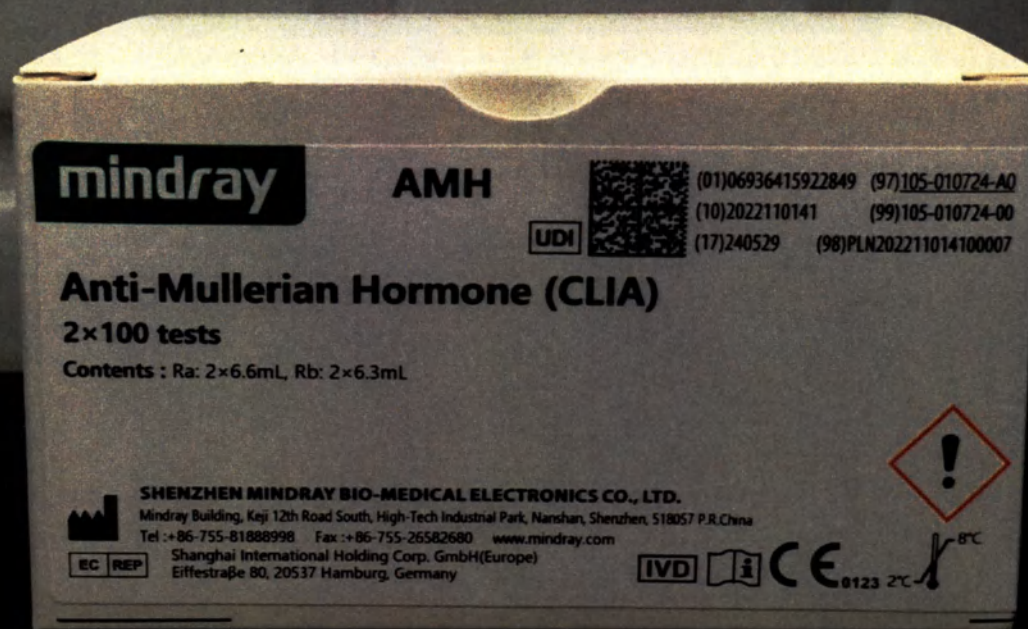


Рисунок 25. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллера гормона (АМН) в сыворотке

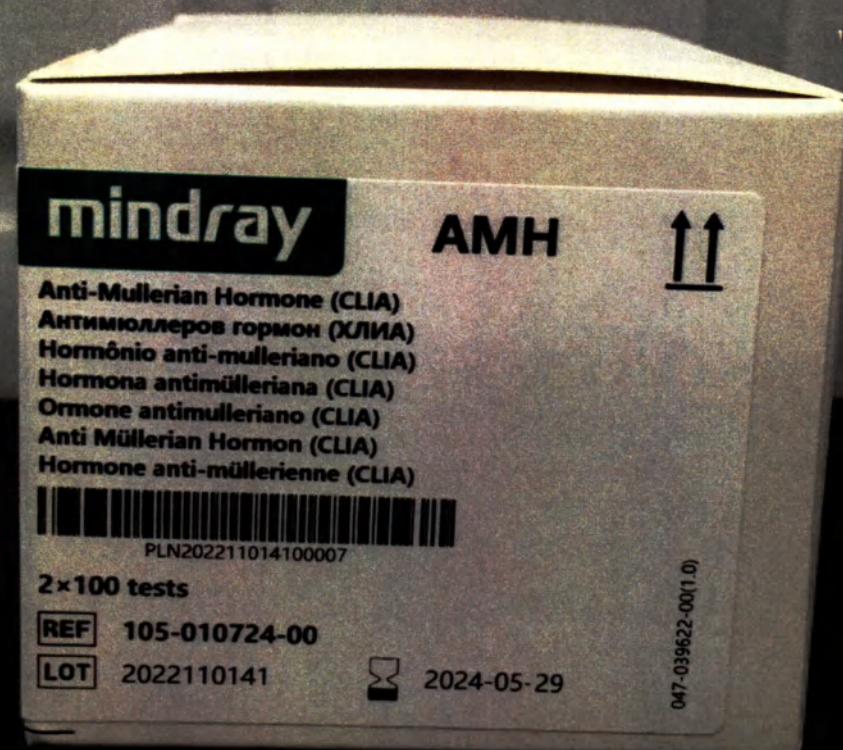


Рисунок 26. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллерова гормона (АМН) в сыворотке



Рисунок 27. Внешняя упаковка Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллера гормона (АМН) в сыворотке

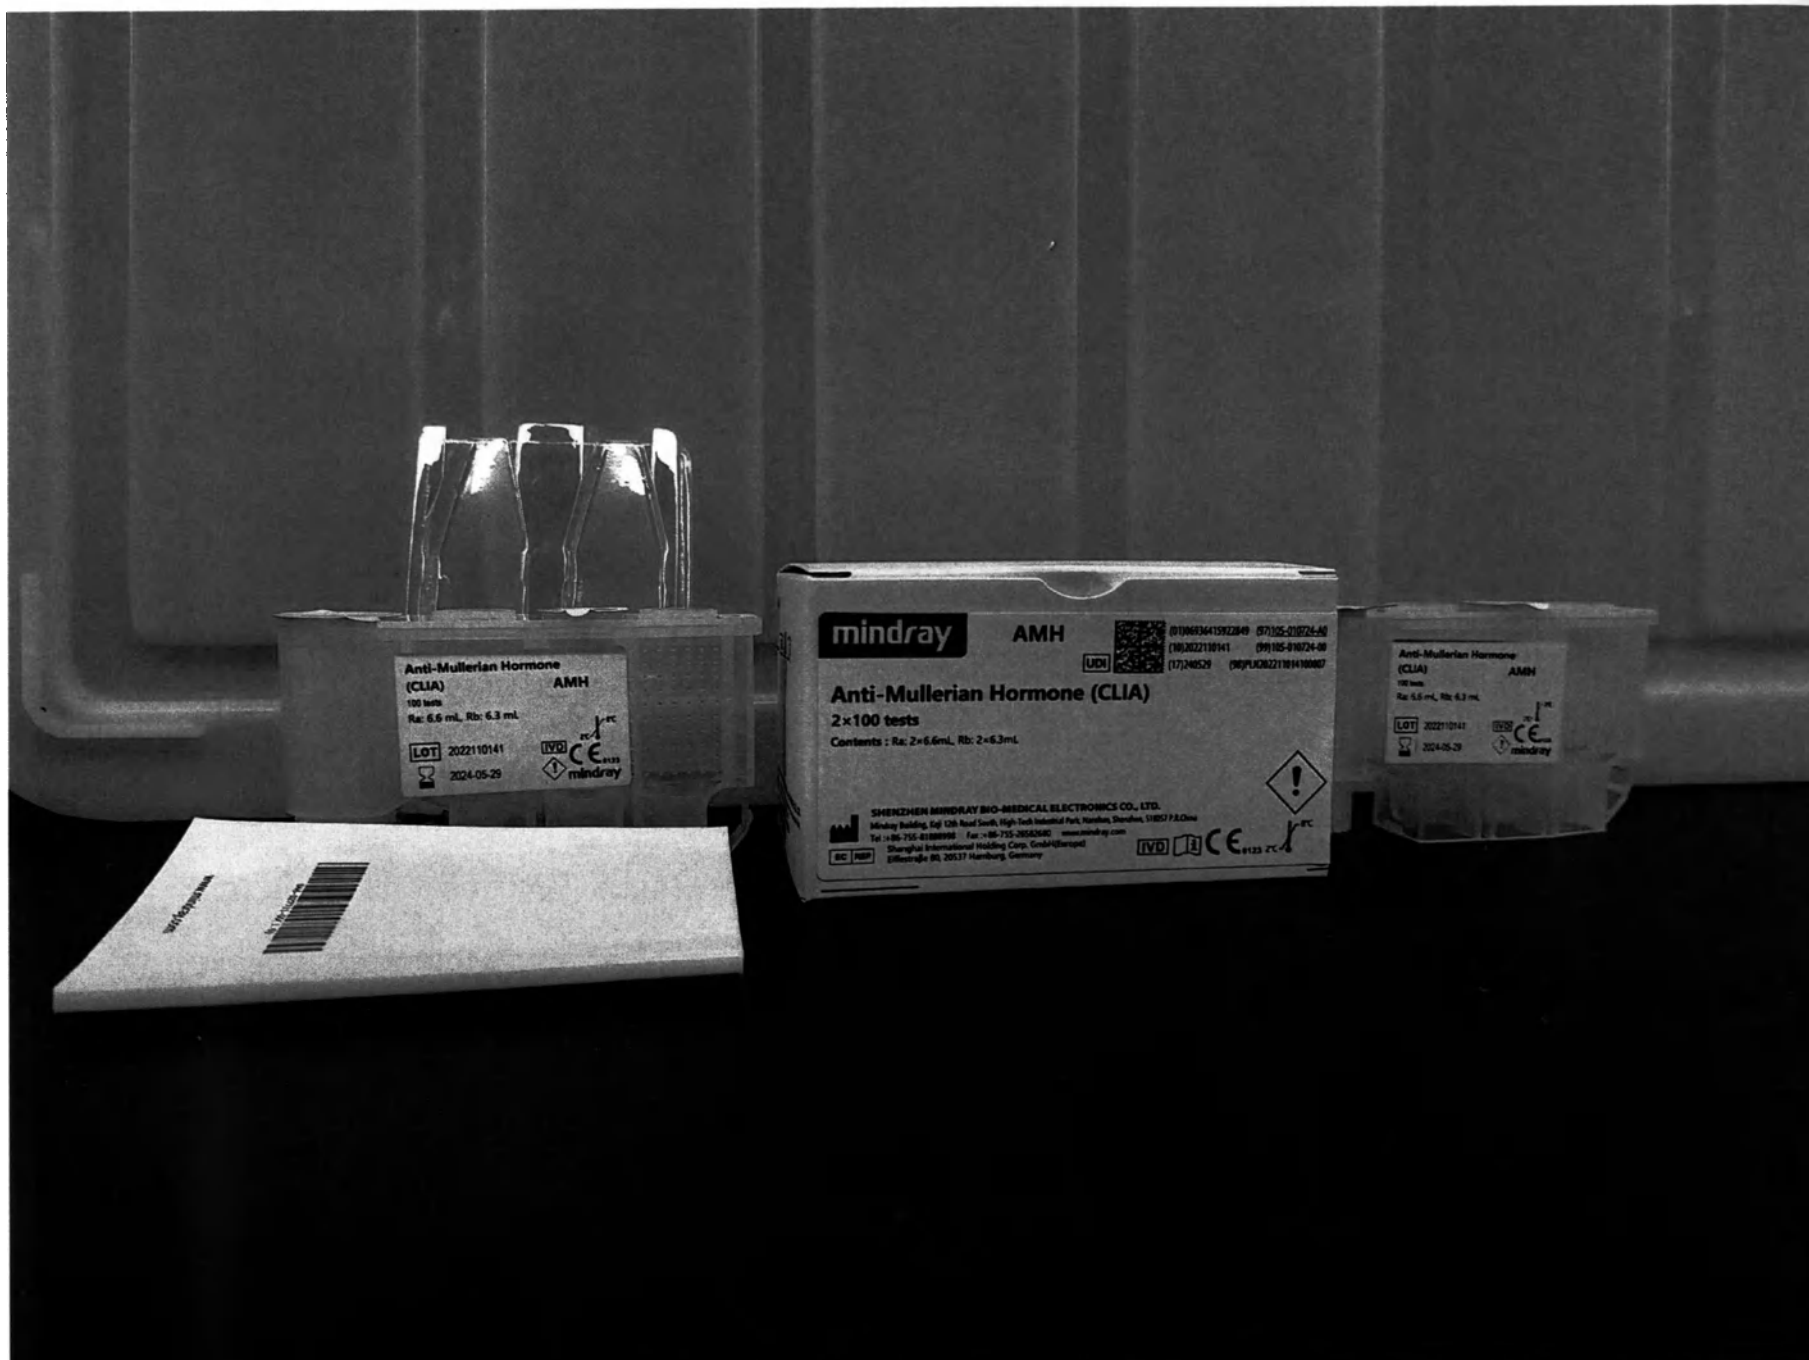


Рисунок 28. Общий вид Набор реагентов для диагностики *in vitro* для количественного определения антимюллера гормона (АМН) в сыворотке или плазме сыворотки с использованием люминесцентного метода на анализаторах серии CL, 2x100 тестов

**Anti-Mullerian Hormone
(CLIA) AMH**

100 tests

Ra: 6.6 mL, Rb: 6.3 mL

LOT 2022110141




2024-05-29

IVD



CE 0123
mindray



Рисунки 20 Кассета с перемешивателем – 2 шт. (шт 1)

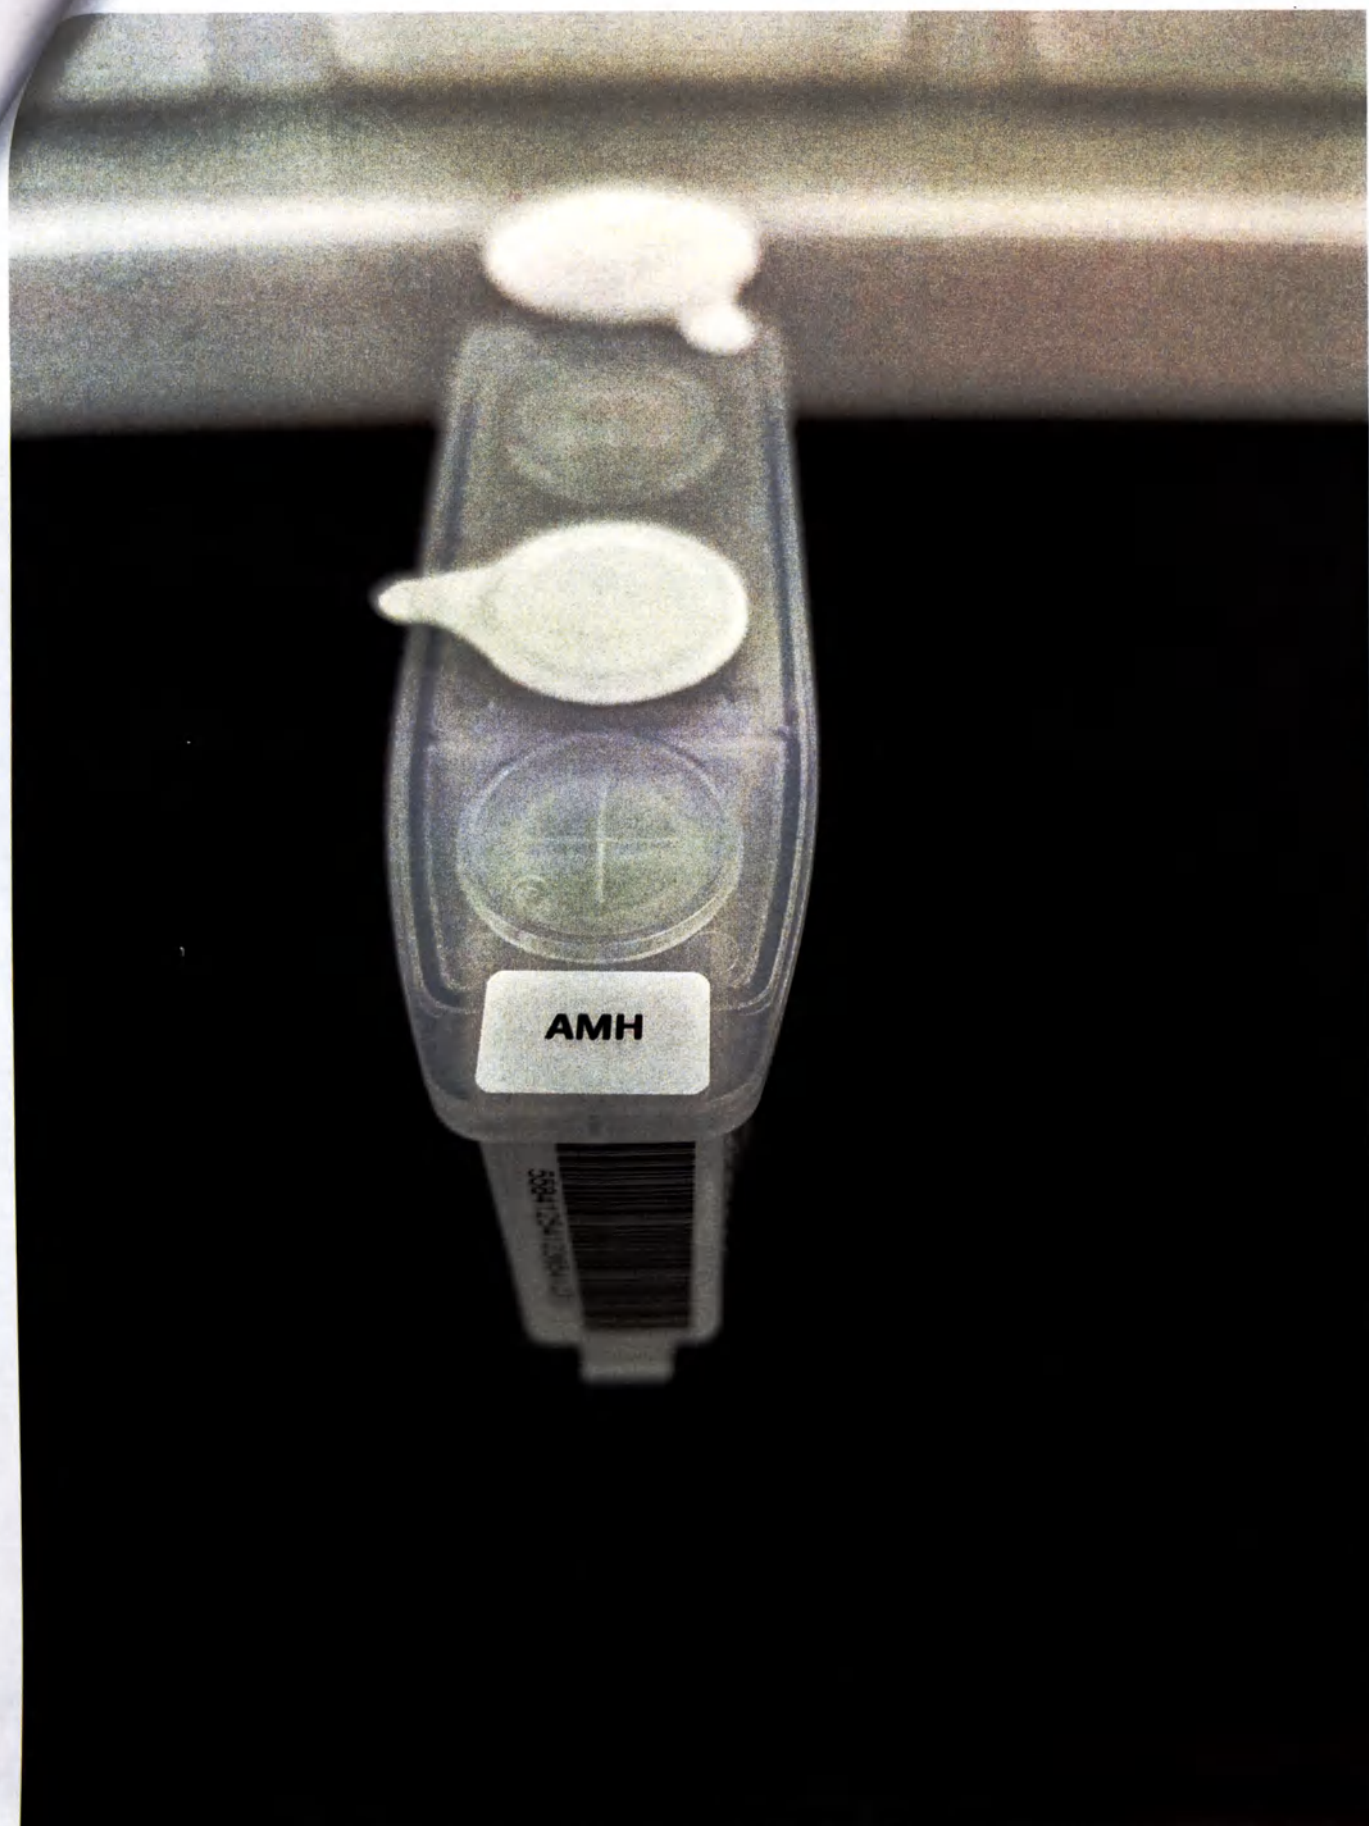


Рисунок 30. Кассета с реагентами – 2 шт. (вид 2)

ПРОШУ
СКРЕПЕНО
ПЕЧАТЬЮ
31 ЛЕСТ

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
СЫСОВЕВА
РУКОВОДИТЕЛЬ
РЕГИСТРАЦИИ

