

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «PMX»
Колышкин В.В.




«18» сентября 2024 г.


Фотографические изображения медицинского изделия
«Аппарат для искусственной вентиляции легких портативный с постоянным
положительным давлением RxiBreeze 20A Plus»



блок основной RXiBreeze 20A Plus

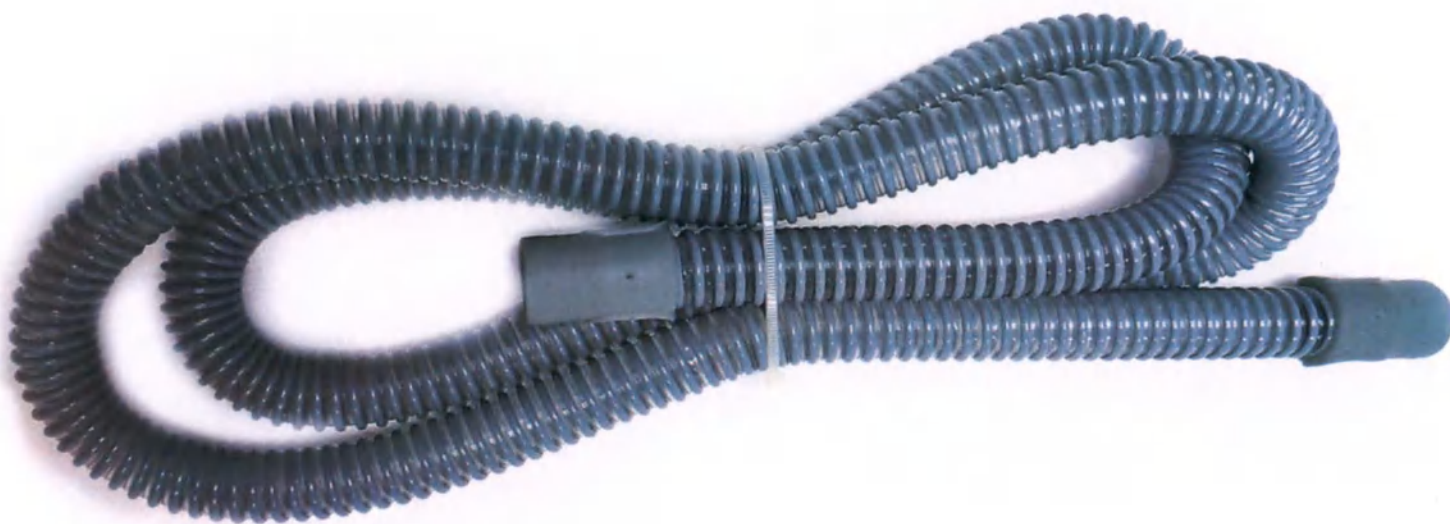

трубка дыхательная

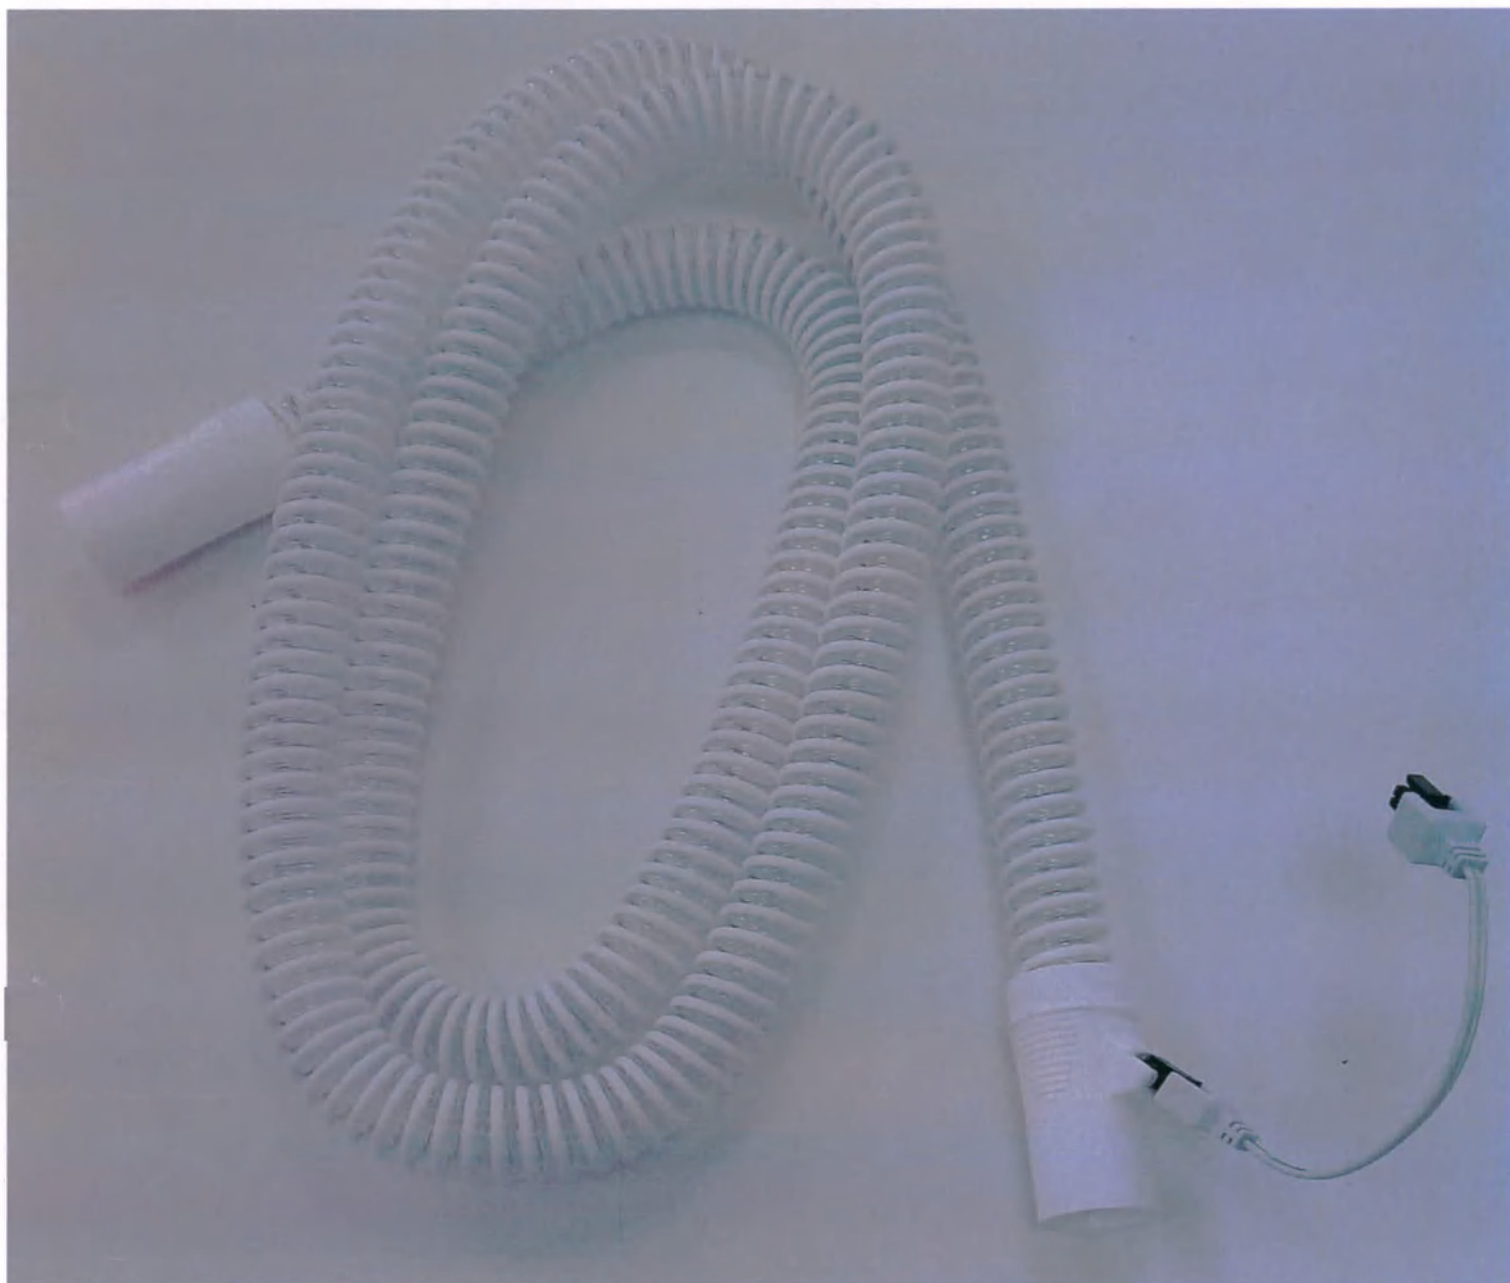

трубка нагреваемая дыхательная HYBERNITE



маска назальная



фильтр воздушный



сетевой адаптер




шнур питания



увлажнитель



Емкость увлажнителя

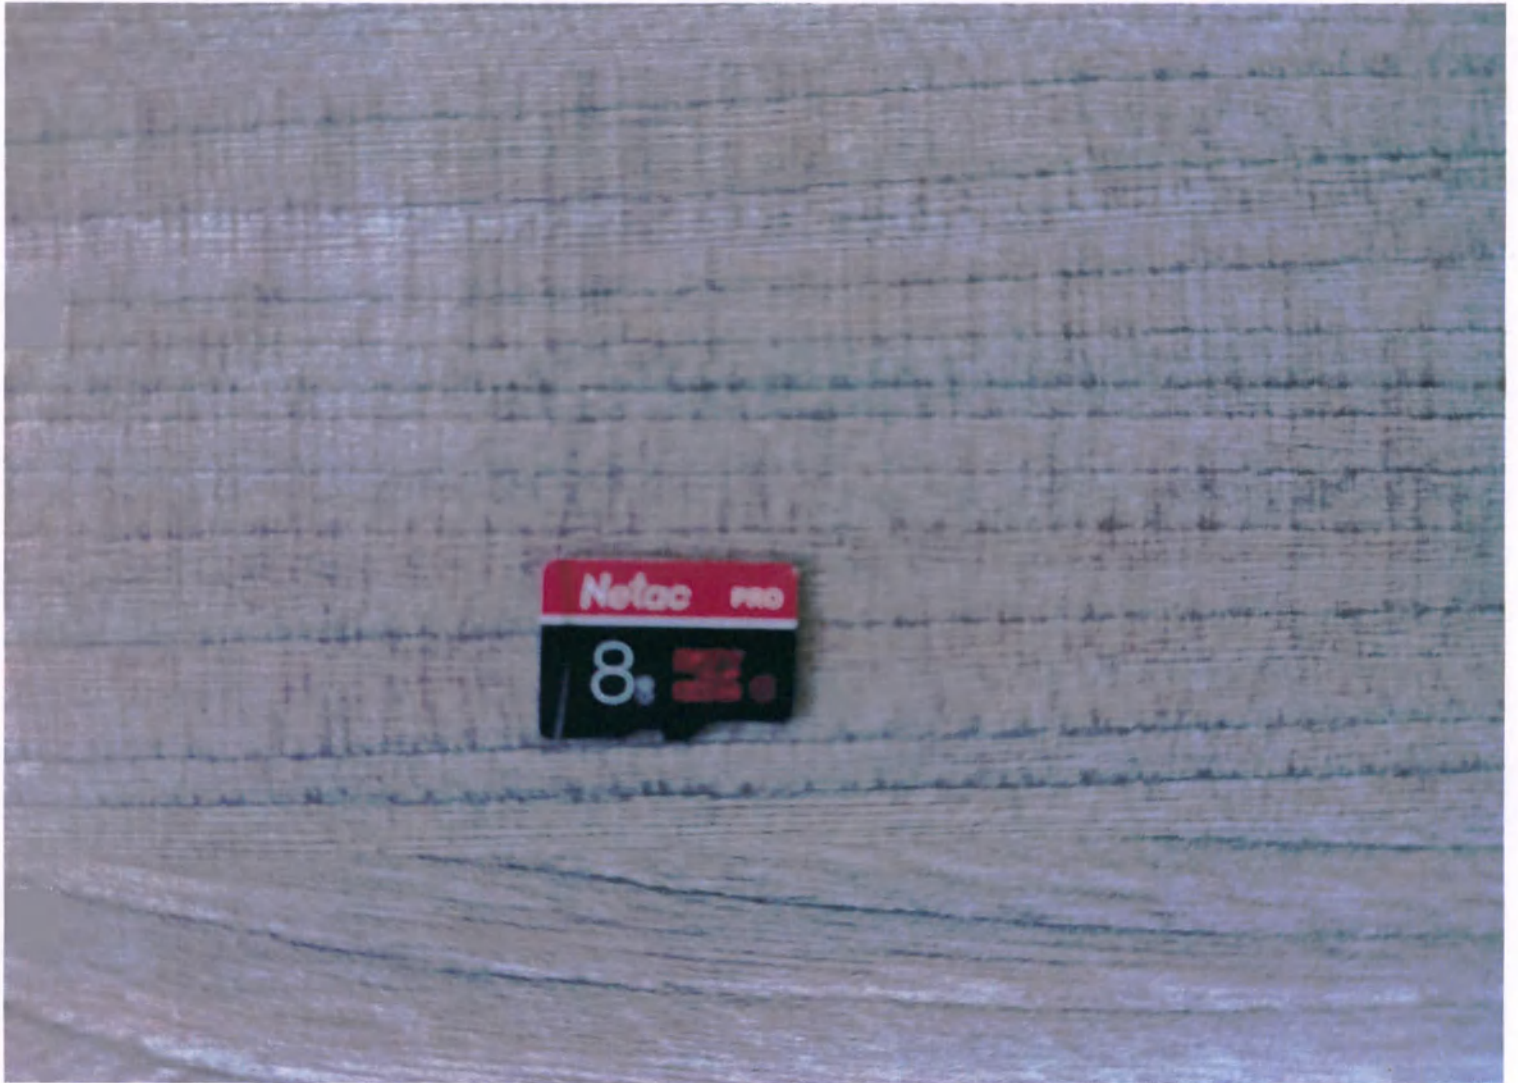

Карта памяти



батарея аккумуляторная



беспроводной датчик-индикатор SpO2 в составе:

- беспроводной датчик-индикатор SpO2, 1 шт
- кольцевой датчик, 1 шт
- кабель, 1 шт



шумопоглотитель



автомобильный адаптер



сумка жесткая



сумка для аксессуаров



сумка транспортировочная

Аппарат для искусственной вентиляции легких
портативный с постоянным положительным
давлением RxiBreeze 20A Plus

resvent

Блок основной



Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxinqi Industrial Park
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com.

Ресвент Медикал Текнолоджи Ко., Лтд., Офис 602, строение В&С, Гаосинь
Индастриал Парк, Люсянь № 1 Роуд, Сообщество СинДон, Баоан, 518100 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика, тел. +86-755-23027370, info@resvent.com.






Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:
Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ») 105203,
Г.МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ
12-Я ПАРКОВАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru.



Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____
24 В --- 2.71 А


Требования к условиям транспортирования и хранения



IP 22



Требования к условиям эксплуатации



XXXX-XX

LOT

XXXXXXXXXX

SN

XXXXXXXXXX

REF

XXXXXXXXXX-XX



XYZXYZXYZXYZXYZXYZ

Макет маркировки основного блока аппарата на русском языке

Батарея аккумуляторная

resvent

Модель: EP-02

Номинальная мощность: 14.4 В — 6.7 А 96.48 Вт·ч



Li-ion



IP 22



Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxinqi Industrial Park
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com

Ресвент Медикал Текнолоджи Ко., Лтд., Офис 602, строение В&С, Гаосинь
Индастриал Парк, Люсянь № 1 Роуд, Сообщество СинДон, Баоан, 518100 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика, тел. +86-755-23027370, info@resvent.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ») 105203,
Г.МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ
12-Я ПАРКОВАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru



XXXX-XX-XX

SN

XXXXXXXX



XYZXYZXYZXYZXYZXYZ

Макет маркировки батареи аккумуляторной на русском языке

Аппарат для искусственной вентиляции легких
портативный с постоянным положительным
давлением RxiBreeze 20A Plus

resvent

Увлажнитель



Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxinqi Industrial Park
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com.

Ресвент Медикал Текнолоджи Ко., Лтд., Офис 602, строение В&С, Гаосинь
Индастриал Парк, Люсянь № 1 Роуд, Сообщество СинДон, Баоан, 518100 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика, тел. +86-755-23027370, info@resvent.com.



Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ») 105203,
Г.МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ
12-Я ПАРКОВАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru.




Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____
24 В === 2.71 А

Требования к условиям транспортирования и хранения



IP 22

Требования к условиям
эксплуатации



XXXX-XX

LOT

XXXXXXXX

SN

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX-XX



XYZXYZXYZXYZXYZXYZ

Макет маркировки увлажнителя на русском языке

Аппарат для искусственной вентиляции легких
портативный с постоянным положительным
давлением RxiBreeze 20A Plus

resvent

Размер: мм х мм х мм

Масса нетто кг.

Масса брутто: кг

Количество: 1 шт.



XYZXYZXYZXYZXYZXYZ



Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxinqi Industrial Park
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com.


Ресвент Медикал Текнолоджи Ко., Лтд., Офис 602, строение В&С, Гаосинь
Индустриал Парк, Люсянь № 1 Роуд, Сообщество СинДон, Баоан, 518100 Шэньчжэнь,
Китайская Народная Республика, тел. +86-755-23027370, info@resvent.com.



Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ») 105203,
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ
12-Я ПАРКОВАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru.

Требования к условиям транспортирования и хранения

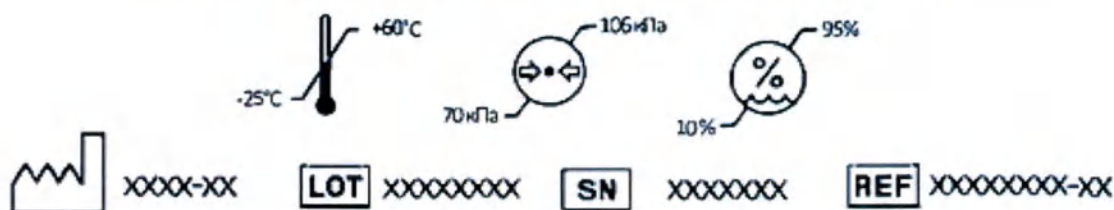

Макет маркировки транспортной упаковки на русском языке

~ сетевой адаптер

Модель ATM065T-A240

Вход: 100-240В~50-60 Гц, 1.6-0.7А

Выход: 24В, 2.71 А

Риск поражения электрическим током

Использовать только в сухом помещении

Использовать только внутри помещения

SN



Resvent Medical Technology Co., Ltd.

Room-602, Building B&C Gaoxinqi Industrial Park Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

+86-755-23027370 info@resvent.com

Ресвент Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.

518100 Китайская Народная Республика, г. Шэньчжень, община Син Дун, Боань, дорога Люйсянь №1, промышленный парк Гаосиньци, здание В&С, офис 602, тел. +86-755-23027370 info@resvent.com

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ: Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ»), 105203, Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, ул 12-я ПАРКОВАЯ, д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru.




Макет маркировки адаптера на русском языке

Шумопоглотитель

**Resvent Medical Technology Co., Ltd.
Room-602, Building B&C Gaoxinqi Industrial Park
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an
518100 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA**

SN

Макет маркировки шумопоглотителя на русском языке

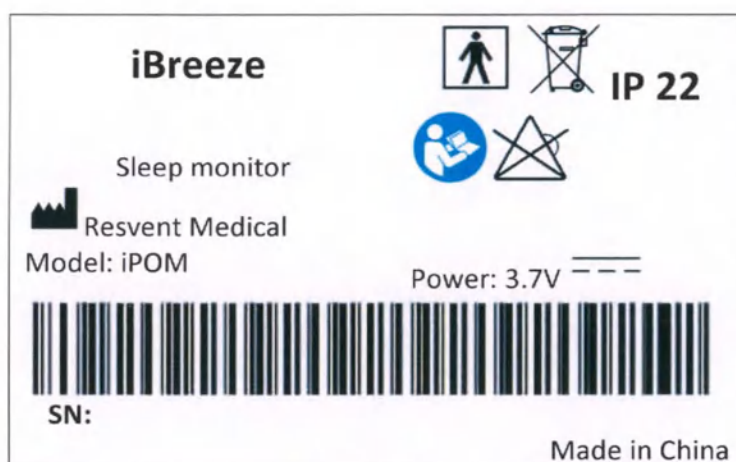

Макет маркировки беспроводного датчика-индикатора SpO2 на русском языке

resvent






Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxing Industrial Park
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Регистрационное удостоверение
№ _____ от _____



Требования к условиям эксплуатации



XXXX-XX



XXXXXX



~~~~~



XXXXXX-XX

XYZX YZX YZX YZX YZX YZX YZX YZX YZX YZX YZX

 ООО ЦИПМИ  [INFO@CIRMI.RU](mailto:info@cirmi.ru)  [WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU](http://WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU)

Аппарат для искусственной вентиляции легких  
портативный с постоянным положительным  
давлением RxiBreeze 20A Plus

**resvent**

**Трубка нагреваемая дыхательная  
HYBERNITE**

**Диаметр:**



Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxingqi Industrial Park  
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com.

Ресвент Медикал Текнолоджи Ко., Лтд., Офис 602, строение В&С, Гаосинь  
Индастриал Парк, Люсянь № 1 Роуд, Сообщество СинДон, Баоан, 518100 Шэньчжэнь,  
Китайская Народная Республика, тел. +86-755-23027370, info@resvent.com.



**Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:**




Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ») 105203,  
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ  
12-Я ПАРКОВАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru.





**IP21**

Регистрационное удостоверение  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Требования к условиям транспортирования и хранения**



**Требования к условиям  
эксплуатации**



XXXX-XX

**LOT**

XXXXXXXXXX

**SN**

XXXXXXXXXX

**REF**

XXXXXXXXXX-XX



XYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZ

Макет маркировки трубки нагреваемой дыхательной HYBERNITE на русском языке

Аппарат для искусственной вентиляции легких  
портативный с постоянным положительным  
давлением RxiBreeze 20A Plus

**resvent**

**Маска назальная**

**Размер:**



Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxingqi Industrial Park  
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com.

Ресвент Медикал Текнолоджи Ко., Лтд., Офис 602, строение В&С, Гаосинь  
Индустриал Парк, Люсянь № 1 Роуд, Сообщество СинДон, Баоан, 518100 Шэньчжэнь,  
Китайская Народная Республика, тел. +86-755-23027370, info@resvent.com.

**Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:**





Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ») 105203,  
Г.МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ  
12-Я ПАРКОВАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru.



Регистрационное удостоверение  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Требования к условиям транспортирования и хранения

Требования к условиям  
эксплуатации



XXXX-XX

**LOT**

XXXXXXXX

**SN**

XXXXXXXX

**REF**

XXXXXXXX-XX



XYZXYZXYZXYZXYZXYZXYZ

Макет маркировки маски назальной на русском языке

Аппарат для искусственной вентиляции легких  
портативный с постоянным положительным  
давлением RxiBreeze 20A Plus

**resvent**

### Фильтр воздушный



Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxinqi Industrial Park  
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com.

Ресвент Медиал Текнолоджи Ко., Лтд., Офис 602, строение В&С, Гаосинь  
Индастриал Парк, Люсянь № 1 Роуд, Сообщество СинДон, Баоан, 518100 Шэньчжэнь,  
Китайская Народная Республика, тел. +86-755-23027370, info@resvent.com.






### Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ») 105203,  
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ  
12-Я ПАРКОВАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru.




Регистрационное удостоверение  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Требования к условиям транспортирования и хранения



Требования к условиям  
эксплуатации



XXXX-XX

LOT

XXXXXXXX

SN

XXXXXXX

REF

XXXXXXXX-XX



XYZXYZXYZXYZXYZXYZ

Макет маркировки фильтра воздушного на русском языке

Аппарат для искусственной вентиляции легких  
портативный с постоянным положительным  
давлением RxiBreeze 20A Plus

**resvent**

### Емкость увлажнителя



Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxing Industrial Park  
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com.  
Ресвент Медикал Текнолоджи Ко., Лтд., Офис 602, строение В&С, Гаосинь  
Индастриал Парк, Люсянь №1 Роуд, Сообщество СинДон, Баоан, 518100 Шэньчжэнь,  
Китайская Народная Республика, тел. +86-755-23027370, info@resvent.com.




**Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:**  
Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ») 105203,  
Г.МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ  
12-Я ПАРКОВАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru



Регистрационное удостоверение  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Требования к условиям транспортирования и хранения



Требования к условиям  
эксплуатации



XXXX-XX

LOT

XXXXXXXX

SN

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX-XX



XYZXYZXYZXYZXYZXYZ

Макет маркировки емкости увлажнителя на русском языке

Аппарат для искусственной вентиляции легких  
портативный с постоянным положительным  
давлением RxiBreeze 20A Plus

**resvent**

**Сумка жесткая**




Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxinqi Industrial Park  
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com.  
Ресвент Медикал Текнолоджи Ко., Лтд., Офис 602, строение В&С, Гаосинь  
Индастриал Парк, Люсянь № 1 Роуд, Сообщество СинДон, Баоан, 518100 Шэньчжэнь,  
Китайская Народная Республика, тел. +86-755-23027370, info@resvent.com.

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:  
Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ») 105203,  
ГМОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ  
12-Я ПАРКОВАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru.





Регистрационное удостоверение  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Требования к условиям транспортирования и хранения

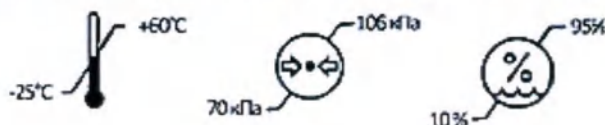

Требования к условиям  
эксплуатации



XXXX-XX

LOT

XXXXXXXX

SN

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX-XX



XYZXYZXYZXYZXYZXYZ

Макет маркировки сумки жесткой на русском языке

Аппарат для искусственной вентиляции легких  
портативный с постоянным положительным  
давлением RxiBreeze 20A Plus

**resvent**

### Сумка для аксессуаров



Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxingqi Industrial Park  
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com.

Ресвент Медикал Текнолоджи Ко., Лтд., Офис 602, строение В&С, Гаосинь  
Индастриал Парк, Люсянь № 1 Роуд, Сообщество СинДон, Баоан, 518100 Шэньчжэнь,  
Китайская Народная Республика, тел. +86-755-23027370, info@resvent.com.




### Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ») 105203,  
Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ  
12-Я ПАРКОВАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru.





Регистрационное удостоверение  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Требования к условиям транспортирования и хранения



Требования к условиям  
эксплуатации



XXXX-XX

LOT

XXXXXXXX

SN

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX-XX



XYZXYZXYZXYZXYZXYZ

Макет маркировки сумки для аксессуаров на русском языке

Аппарат для искусственной вентиляции легких  
портативный с постоянным положительным  
давлением RxiBreeze 20A Plus

**resvent**

### Сумка транспортировочная



Resvent Medical Technology Co., Ltd., Room-602, Building B&C Gaoxinqi Industrial Park  
Liuxian NO.1 Road XingDong community Bao'an 518100 Shenzhen, PEOPLE'S  
REPUBLIC OF CHINA, tel. +86-755-23027370, info@resvent.com.  
Ресвент Медикал Текнолоджи Ко., Лтд., Офис 602, строение В&С, Гаосинь  
Индастриал Парк, Люсянь № 1 Роуд, Сообщество СинДон, Баоан, 518100 Шэньчжэнь,  
Китайская Народная Республика, тел. +86-755-23027370, info@resvent.com.






#### Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «РУСМЕДХОЛДИНГ» (ООО «РМХ») 105203,  
Г.МОСКВА, ВН.ТЕРГ. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОСТОЧНОЕ ИЗМАЙЛОВО, УЛ  
12-Я ПАРКОВАЯ, Д. 7, ПОМЕЩ. 1, тел. 8 800 775-50-58, info@mfhc.ru.





Регистрационное удостоверение  
№ \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

#### Требования к условиям транспортирования и хранения



#### Требования к условиям эксплуатации



XXXX-XX

LOT

XXXXXXXX

SN

XXXXXXXX

REF

XXXXXXXX-XX



XYZXYZXYZXYZXYZXYZ

Макет маркировки сумки транспортировочной на русском языке

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 33 лист(ов) а

Генеральный директор ООО «РусМедХолдинг»  
В.В. Коляшкин *my*

