



Фотографические изображения медицинского изделия

Аппарат для искусственной вентиляции легких с
постоянным положительным давлением ResPlus

Аппарат для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus CPAP, модель C-20A. Общий вид



❶ основной блок C-20A ❷ увлажнитель H2O ❸ трубка , арт. 22050001 ❹ маска лицевая EaseFit FMI (размерный ряд S,M,L), ❺ адаптер питания LXCP61 ❻ Фильтр воздушный для аппарата искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus ❼ сумка для переноски ❽ TF-карта GMTS91KB7IT-MA

Аппарат для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus ВРАР,
модель В-25Т. Общий вид



① основной блок В-25Т ② увлажнитель Н2О ③ трубка , арт. 22050001 ④ маска лицевая EaseFit FMI (размерный ряд S,M,L), ⑤ адаптер питания LXCP61 ⑥ Фильтр воздушный для аппарата искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus ⑦ сумка для переноски ⑧ TF-карта GMTS91KB7IT-MA

Аппарат для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus ВРАР,
модель В-30Р. Общий вид



❶ основной блок В-30Р ❷ увлажнитель H2O ❸ трубка , арт. 22050001 ❹ маска лицевая EaseFit FMI (размерный ряд S,M,L), ❺ адаптер питания LXCP61 ❻ Фильтр воздушный для аппарата искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus ❼ сумка для переноски ❽ TF-карта GMTS91KB7IT-MA

Макет маркировки Аппарата для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus CPAP, модель C-20A



**Аппарат для искусственной вентиляции легких с
постоянным положительным давлением ResPlus CPAP**

модель C-20A

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Увлажнитель H2O

Производитель: Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. (Хьюнан Бьонд Медикал
Технолоджи Ко., Лтд.)

Адрес производителя: Beyong Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208
Changsha, China, (Бьонд Зон, Лицзяцзюнь роад, улица Сюэси, район Юэлу, 410208 Чанша,
КНР, Китай) Тел: +86-731-82564299, Сайт: www.csbeyond.com

Уполномоченный представитель в России: ООО «Криптомед»

Адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д.35, стр.1

Тел/факс: 8(495)608-08-01, E-mail: info@kriptomed.ru



**Аппарат для искусственной вентиляции легких с
постоянным положительным давлением ResPlus CPAP**

модель C-20A

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Основной блок

Производитель: Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. (Хьюнан Бьонд Медикал
Технолоджи Ко., Лтд.)

Адрес производителя: Beyong Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208
Changsha, China, (Бьонд Зон, Лицзяцзюнь роад, улица Сюэси, район Юэлу, 410208 Чанша,
КНР, Китай) Тел: +86-731-82564299, Сайт: www.csbeyond.com



Уполномоченный представитель в России: ООО «Криптомед»

Адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д.35, стр.1

Тел/факс: 8(495)608-08-01, E-mail: info@kriptomed.ru



Маркировка упаковки Apparata для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus CPAP, модель C-20A

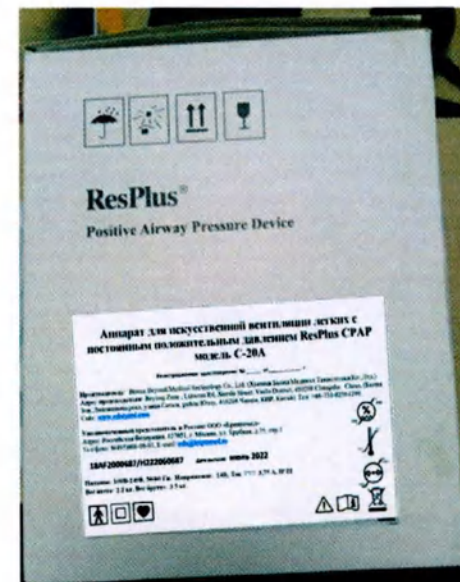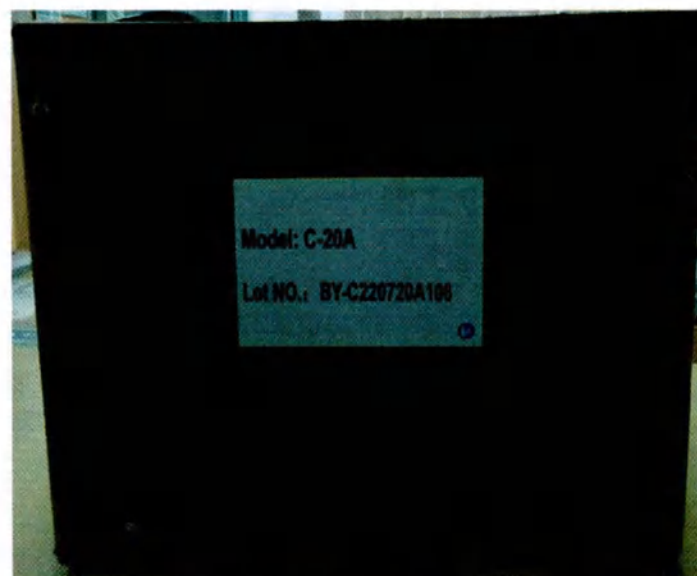

Аппарат для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus CPAP модель C-20A


Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Производитель: Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. (Хьюнан Бьонд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
Адрес производителя: Beyond Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuehu District, 410208 Changsha, China, (Бьонд Зон, Линцяцзюнь роад, улица Сюэши, район Юэху, 410208 Чанша, КНР, Китай), Тел: +86-731-82564299,
Сайт: www.csbeyond.com

Уполномоченный представитель в России: ООО «Криптомед»
Адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д.35, стр.1
Тел/факс: 8(495)608-08-01, E-mail: info@kriptomed.ru

18AF2000687/H222060687 дата выпуска июль 2022

Питание: 100В-240В, 50/60 Гц, Напряжение: 24В, Ток --- 3,75 А, IP 22
Вес нетто: 2.2 кг. Вес брутто: 3.5 кг.

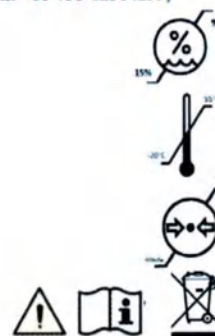

Макет маркировки Аппарата для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus BAP, модель B-25T



**Аппарат для искусственной вентиляции легких с
постоянным положительным давлением ResPlus ВРАР
модель В-25Т**

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Увлажнитель Н20

Производитель: Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. (Хьюнан Бьонд Медикал
Текнолоджи Ко. Лтд.)

Адрес производителя: Beyong Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208
Changsha, China, (Бьонд Зон, Лицзяцзюнь роад, улица Сюэси, район Юэлу, 410208 Чанша,
КНР, Китай) Тел: +86-731-82564299, Сайт: www.csbeyond.com

Уполномоченный представитель в России: ООО «Криптомед»

Адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д.35, стр.1

Тел/факс: 8(495)608-08-01, E-mail: info@kriptomed.ru



**Аппарат для искусственной вентиляции легких с
постоянным положительным давлением ResPlus ВРАР
модель В-25Т**

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Основной блок

Производитель: Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. (Хьюнан Бьонд Медикал Текнолоджи
Ко., Лтд.)

Адрес производителя: Beyong Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208 Changsha, China,
(Бьонд Зон, Лицзяцзюнь роад, улица Сюэси, район Юэлу, 410208 Чанша, КНР, Китай) Тел: +86-731-
82564299, Сайт: www.csbeyond.com

Уполномоченный представитель в России: ООО «Криптомед»

Адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д.35, стр.1

Тел/факс: 8(495)608-08-01, E-mail: info@kriptomed.ru



Маркировка упаковки Аппарата для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus BPAP, модель B-25T



Аппарат для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus BPAP модель B-25T


Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Производитель: Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. (Хьюнан Бьонд Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.)
Адрес производителя: Beyond Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208 Changsha, China, (Бьонд Зон, Лицзяцунь роад, улица Сюэши, район Юэлу, 410208 Чанша, КНР, Китай),
Тел: +86-731-82564299, Сайт: www.csbeyond.com

Уполномоченный представитель в России: ООО «Криптомед»
Адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д.35, стр.1
Тел/факс: 8(495)608-08-01, E-mail: info@kriptomed.ru

58AF2000688/H222060688 Дата выпуска ИЮЛЬ 2022

Питание: 100В-240В, 50/60 Гц, Напряжение: 24В, Ток --- 3,75 А, IP 22
Вес нетто: 2.2 кг. Вес брутто: 3.5 кг.

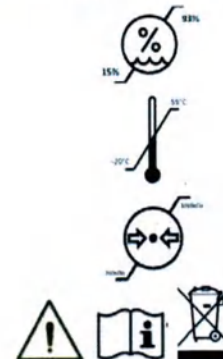

Макет маркировки Аппарата для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus ВРАР, модель В-30Р



**Аппарат для искусственной вентиляции легких с
постоянным положительным давлением ResPlus
ВРАР**

модель В-30Р

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Увлажнитель Н20

Производитель: Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. (Хьюнан Бьонд Медикал
Текнолоджи Ко.Лтд.)

Адрес производителя: Beyong Zone , Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208
Changsha, China, (Бьонд Зон, Лицзяцзюнь роад, улица Сюэси, район Юэлу, 410208 Чанша,
КНР, Китай), Тел: +86-731-82564299, Сайт: www.csbeyond.com

Уполномоченный представитель в России: ООО «Криптомед»

Адрес: Российская Федерация, 127051 г. Москва, ул. Трубная, д.35, стр.1

Тел/факс: 8(495)608-08-01, E-mail: info@kriptomed.ru



**Аппарат для искусственной вентиляции легких с
постоянным положительным давлением ResPlus ВРАР
модель В-30Р**

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Основной блок

Производитель: Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. (Хьюнан Бьонд Медикал Текнолоджи
Ко.,Лтд.)

Адрес производителя: Beyong Zone , Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208 Changsha, China,
(Бьонд Зон, Лицзяцзюнь роад, улица Сюэси, район Юэлу, 410208 Чанша, КНР, Китай), Тел: +86-731-
82564299, Сайт: www.csbeyond.com


Уполномоченный представитель в России: ООО «Криптомед»

Адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д.35, стр.1

Тел/факс: 8(495)608-08-01, E-mail: info@kriptomed.ru



Маркировка упаковки Аппарата для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus BAP, модель B-30P

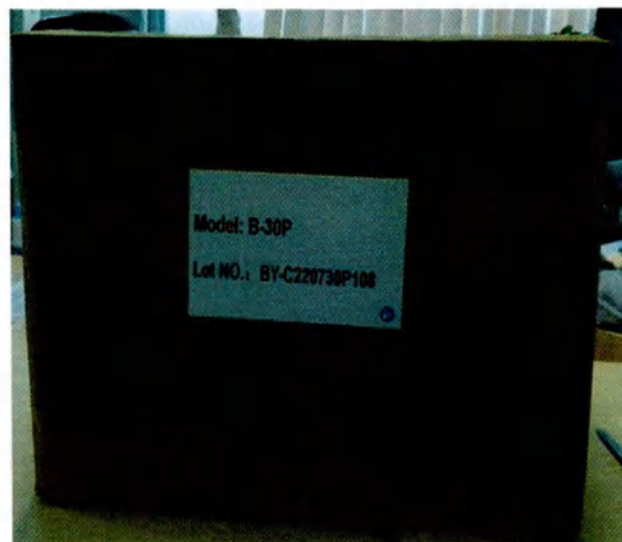

Аппарат для искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus BAP модель B-30P


Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Производитель: Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. (Хьюнан Бьонд Медикал Текнолоджи Ко.,Лтд.)
Адрес производителя: Beyond Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208 Changsha, China, (Бьонд Зон, Лицзяцунь роад, улица Сюэси, район Юэлу, 410208 Чанша, КНР, Китай),
Тел: +86-731-82564299, Сайт: www.csbeyond.com


Уполномоченный представитель в России: ООО «Криптомед»
Адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д.35, стр.1
Тел/факс: 8(495)608-08-01, E-mail: info@kriptomed.ru

SN 88AF2000689/H222060689 Дата выпуска июль 2022

Питание: 100В-240В, 50/60 Гц, Напряжение: 24В, Ток === 3,75 А, IP 22
Вес нетто: 2.2 кг. Вес брутто: 3.5 кг.

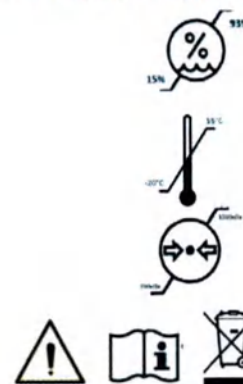

Трубка, арт. 22050001

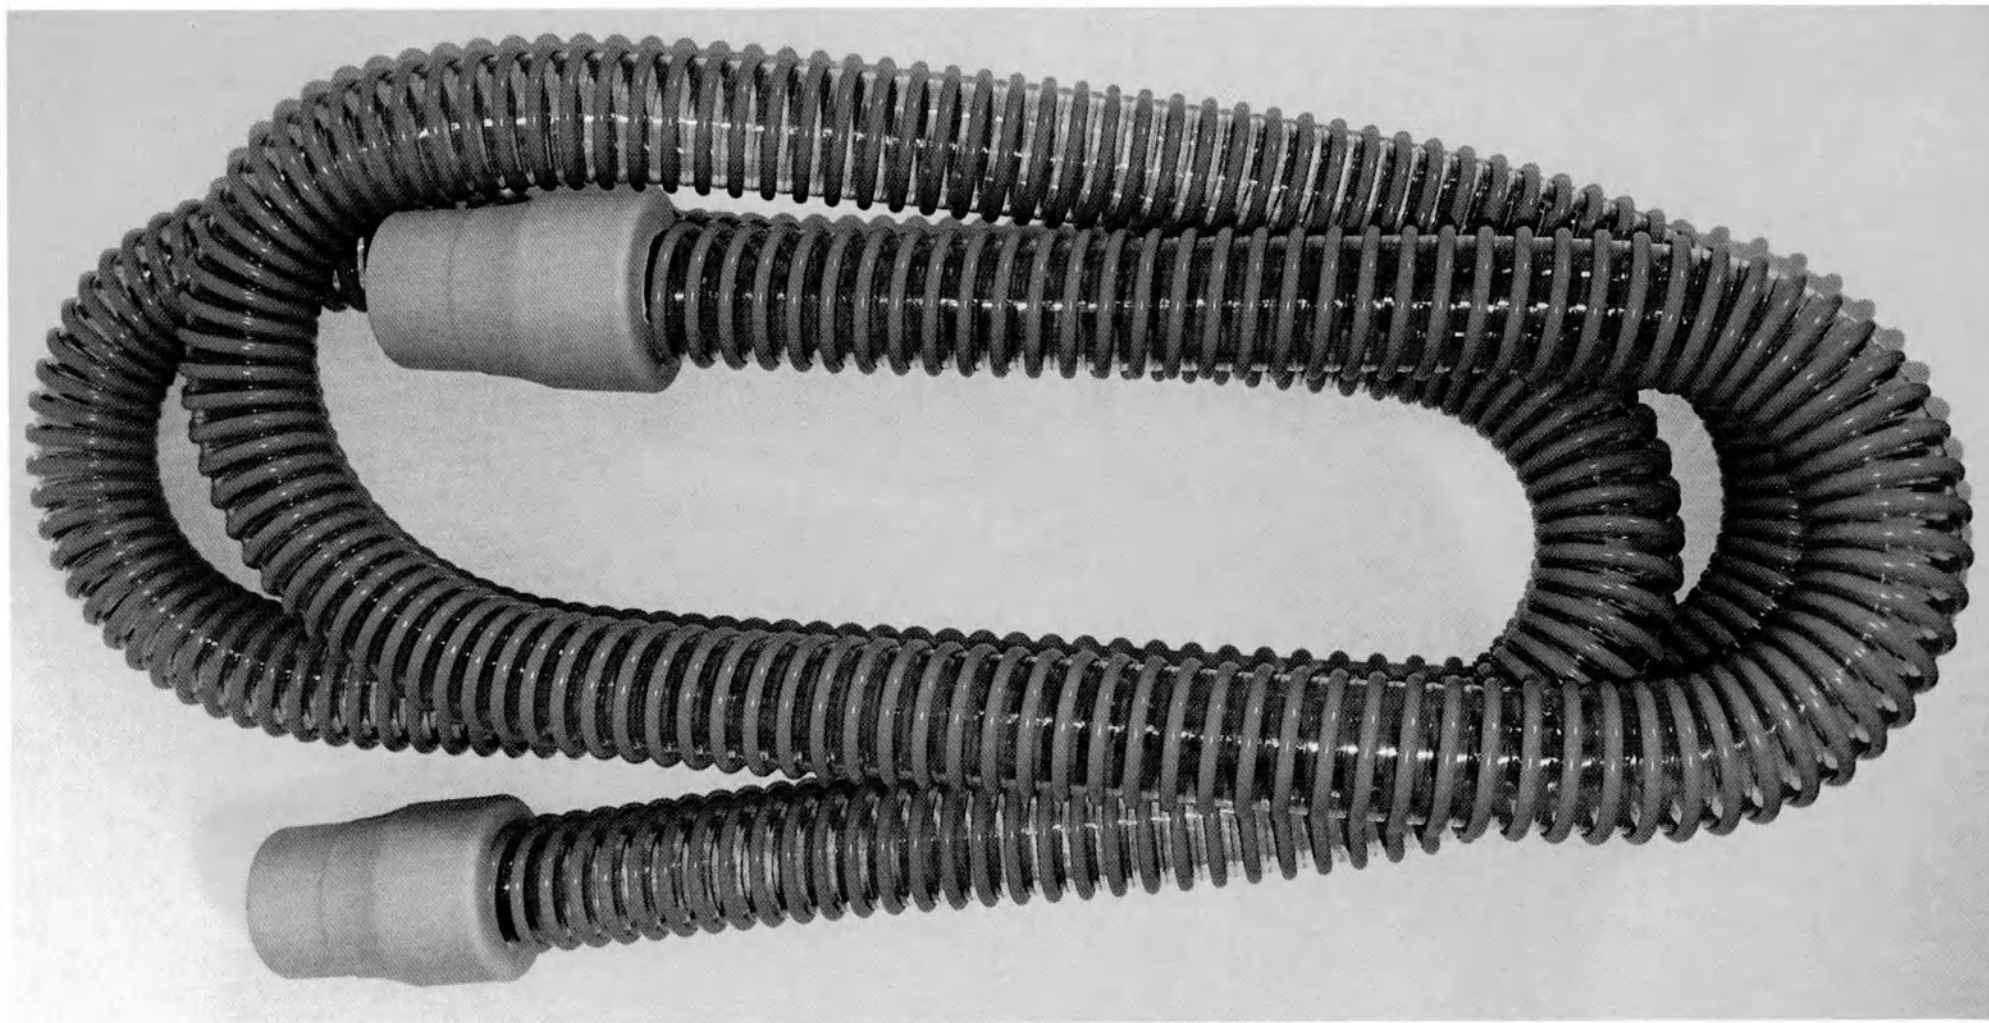

Маркировка упаковки Трубки, арт. 22050001



Аппарат для искусственной
вентиляции легких с постоянным
положительным давлением ResPlus
Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.

Трубка
арт. 22050001

Производитель: Mars Wellness,
1950 Rutgers University Blvd,
Lakewood, NJ 08701, США

Длина 1,8 м,
Диаметр 22 мм
Дата производства: 05.2024



Маска лицевая EaseFit FMI (размерный ряд S,M,L)



Маркировка упаковки Маски лицевой EaseFit FMI (размерный ряд S,M,L)

Аппарат для искусственной вентиляции легких с
постоянным положительным давлением ResPlus

Регистрационное удостоверение № _____ от _____ г.


МАСКА ЛИЦЕВАЯ EaseFit FMI

Производитель: Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd. (Хунань Бьонд Медикал Текнолоджи Ко., Лтд.)
Адрес производителя: Beyond Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street, Yuelu District, 410208 Changsha, China, (Бьонд
Зон, Лицзяцунь роад, улица Сюэши, район Юэлу, 410208 Чанша, КНР, Китай) Тел: +86-731-82564299,
Сайт: www.csbeyond.com

Уполномоченный представитель в России: ООО «Криптомед»
Адрес: Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул. Трубная, д.35, стр.1
Тел/факс: 8(495)608-08-01, E-mail: info@kriptomed.ru

Размер: M Дата выпуска: июль 2022

 2 года



BEYOND

CPAP/BIPAP Masks

EaseFit FMI

LOT

BY-C2207FMIM008

REF

57814M

CE

WellKang Ltd (www.CE-marking.eu)
Enterprise Hub, NW Business Complex,
1 Beraghmore Road, Derry, BT48 8SE,
Northern Ireland, UK



Hunan Beyond Medical Technology Co., Ltd.
Beyond Zone, Lijiacun Rd, Xueshi Street,
Yuelu District, 410208
Changsha, Hunan, China.



2022-07

Адаптер питания LXCP61



Маркировка Адаптера питания LXCP61

Medical Switching Power Supply

RoHS

MODEL/型号/型番/모델명: LXCP61(II)- 024375

INPUT/输入电压/入力電圧/정격입력: 100-240V~50/60Hz 1.8A Max.

OUTPUT/输出电压/出力電圧/정격출력: 24.0V $\equiv$ 3.75A

制造商: 深圳市龙星辰电源有限公司



製造元: 中國廣東省深圳市龍星辰電源有限會社


Manufactory: Shenzhen Longxing Power Supply Co., LTD.



Маркировка упаковки Адаптера питания LXCP61




Фильтр воздушный для аппарата искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus

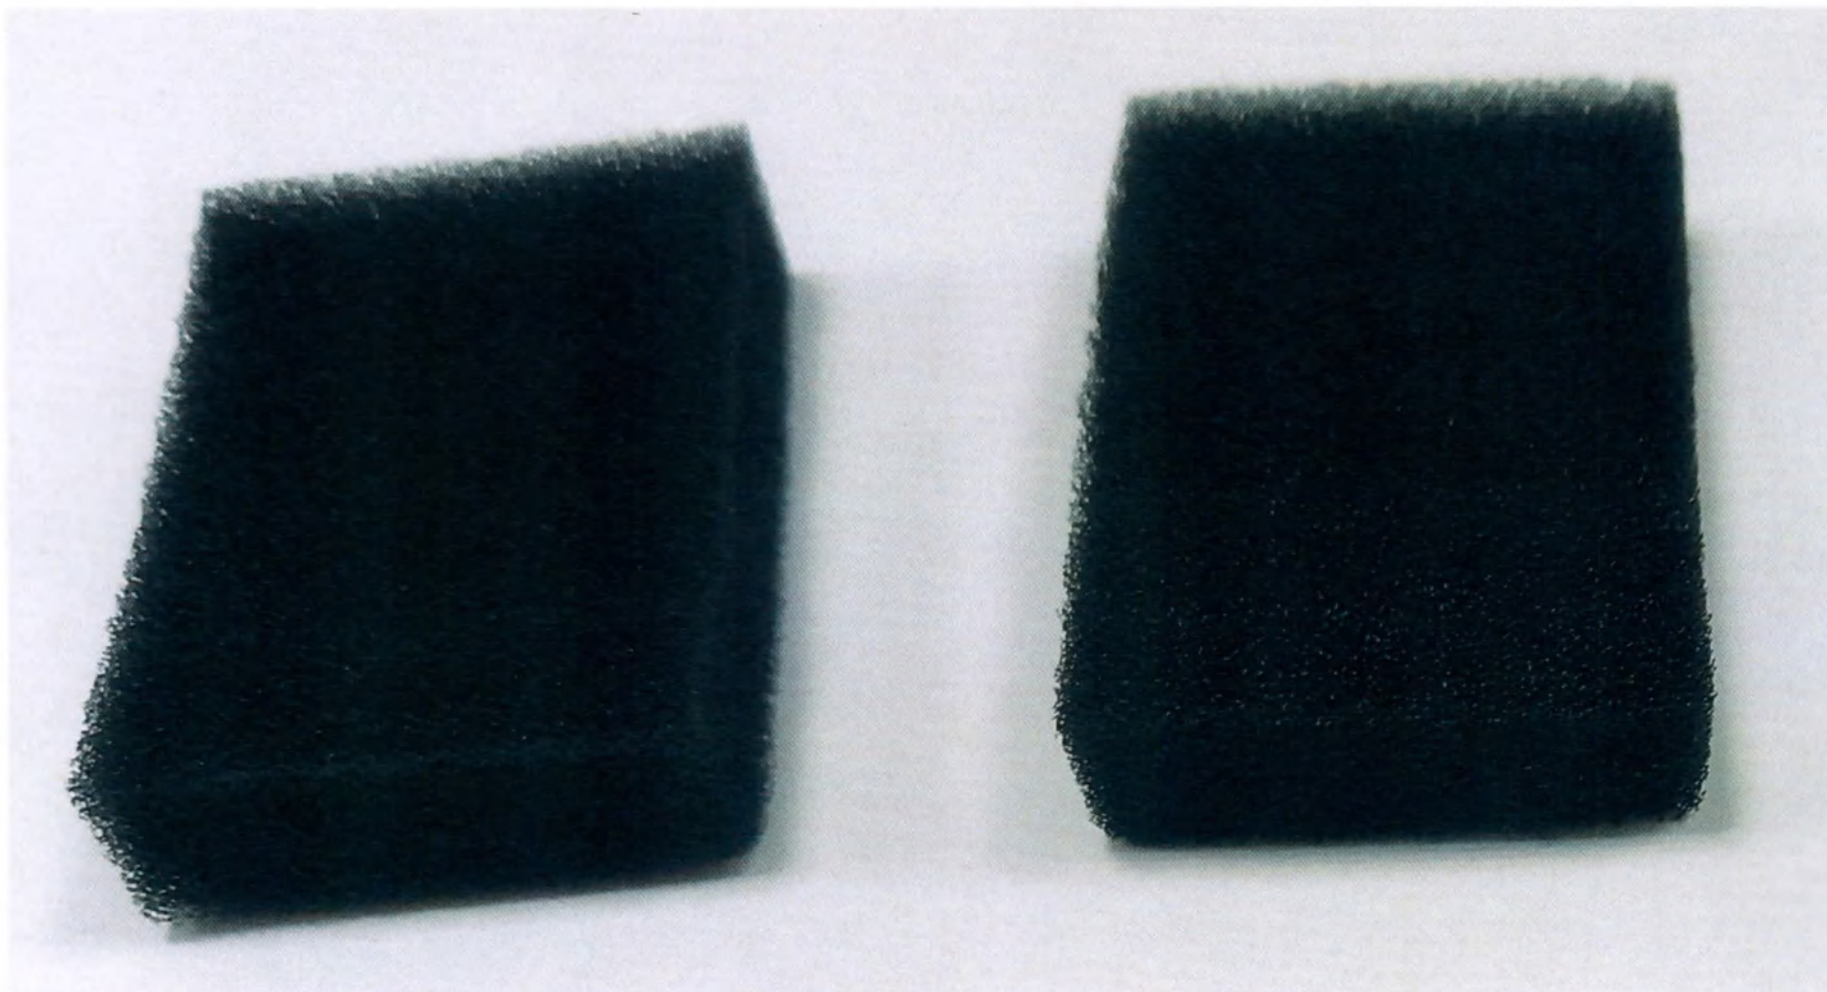

Маркировка упаковки Фильтра воздушного для аппарата искусственной вентиляции легких с постоянным положительным давлением ResPlus



TF-карта GMTS91KB7IT-MA

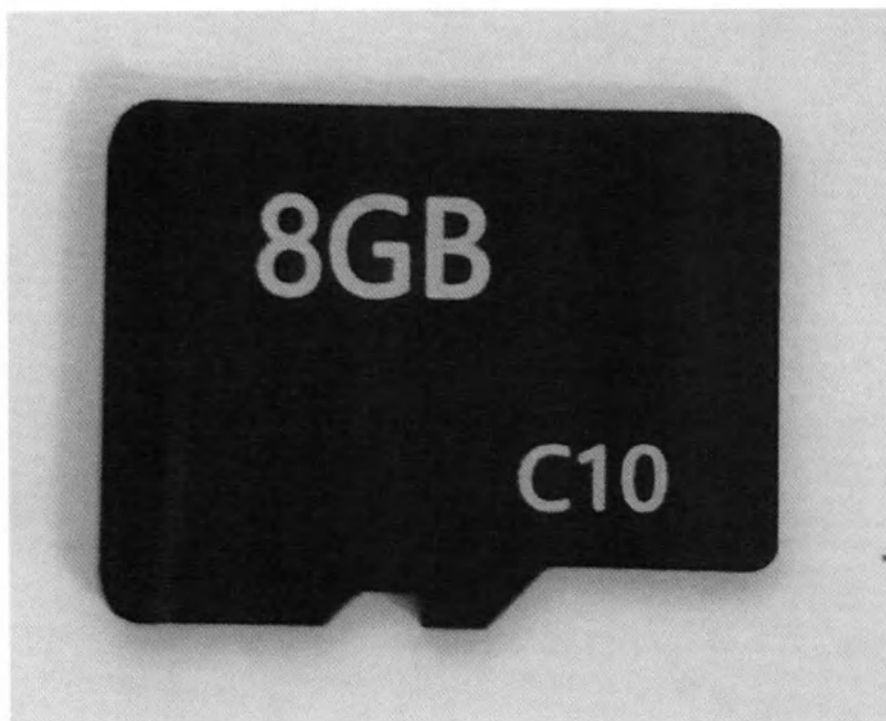

Сумка для переноски



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью
ООО «КРИПТОМЕД»



П.И. Климачев