

e-mail: info@advamedics.ru

web: www.advamedics.ru

skype: advamedics

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

ООО «Адвamedикс»

Сухарев И.В.



«10» октября 2024 г.

**ФОТОГРАФИИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**

Емкость торакальная дренажная Polyseal



Емкость торакальная дренажная Polyseal объемом 2000 мл (общий вид)



Емкость торакальная дренажная Polyseal объемом 1200 мл (общий вид)



Емкость торакальная дренажная Polyseal объемом 500 мл (общий вид)




Емкость для «водяного замка» 2000 мл с подвесами



Емкость для «водяного замка» 1200 мл




Емкость для «водяного замка» 500 мл

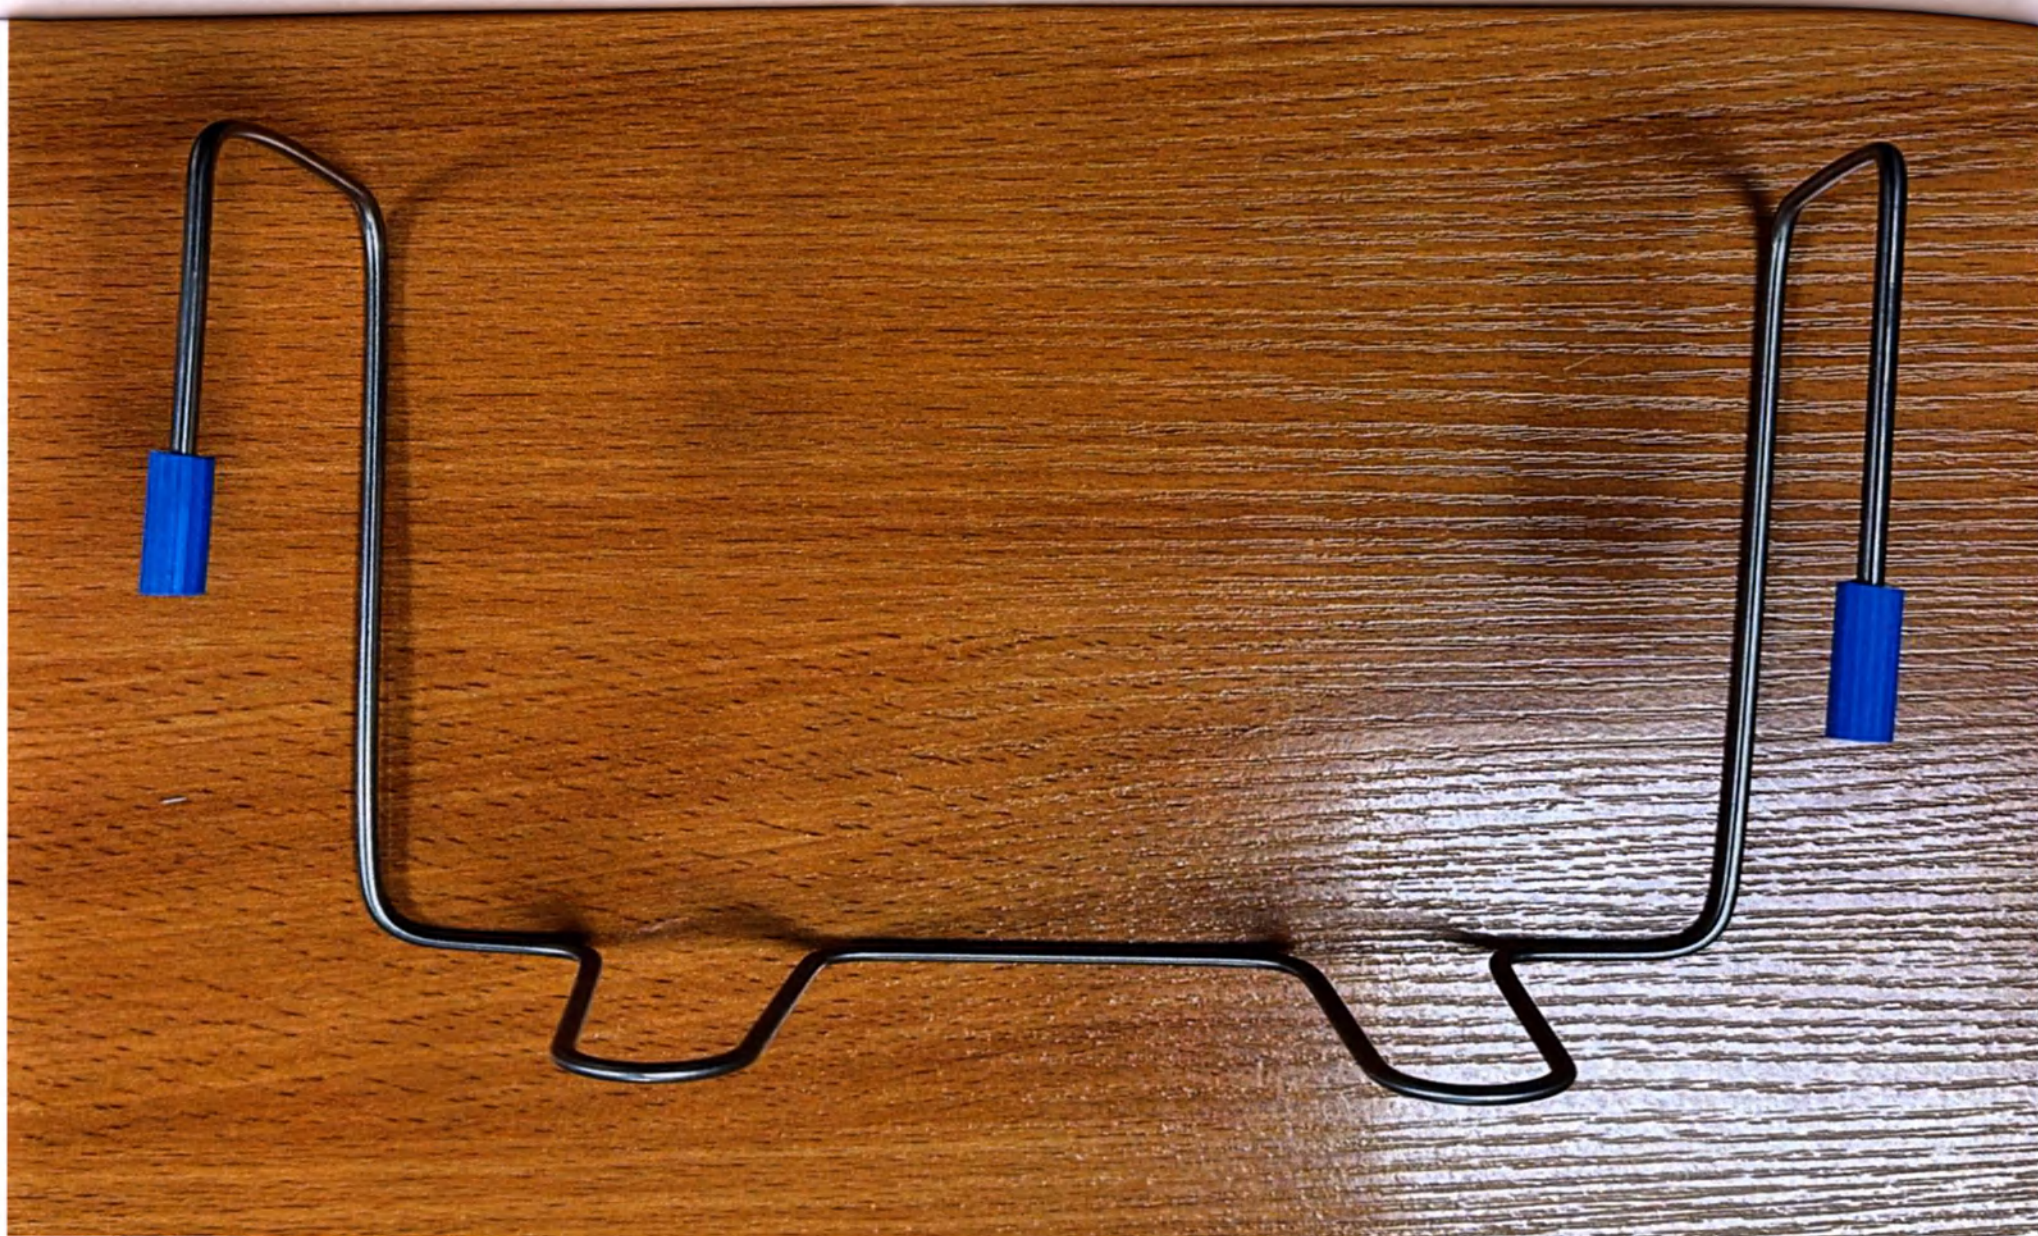


Подставка для емкости 1200 мл



Подставка для емкости 500 мл

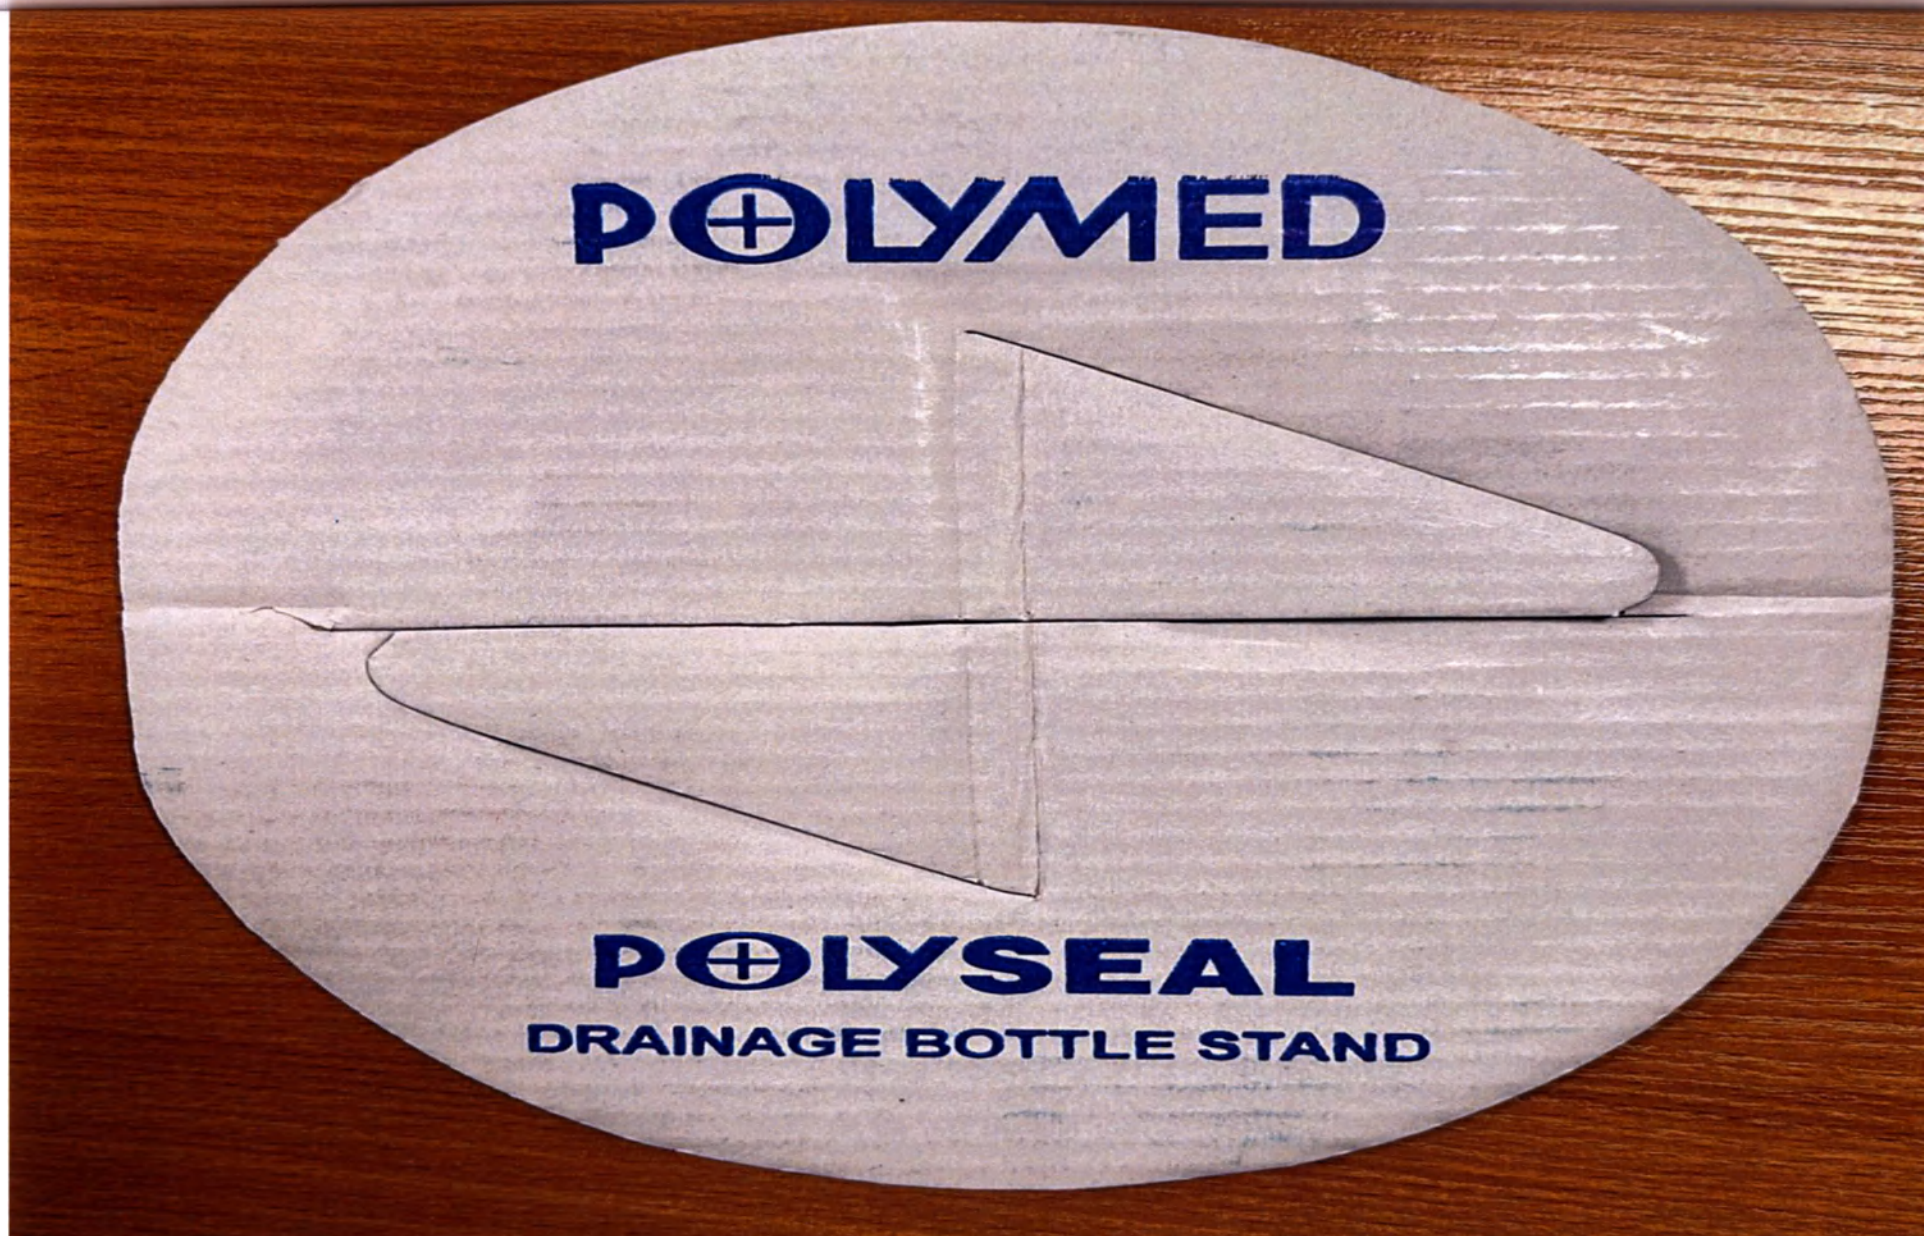

Подставка для емкости 2000 мл

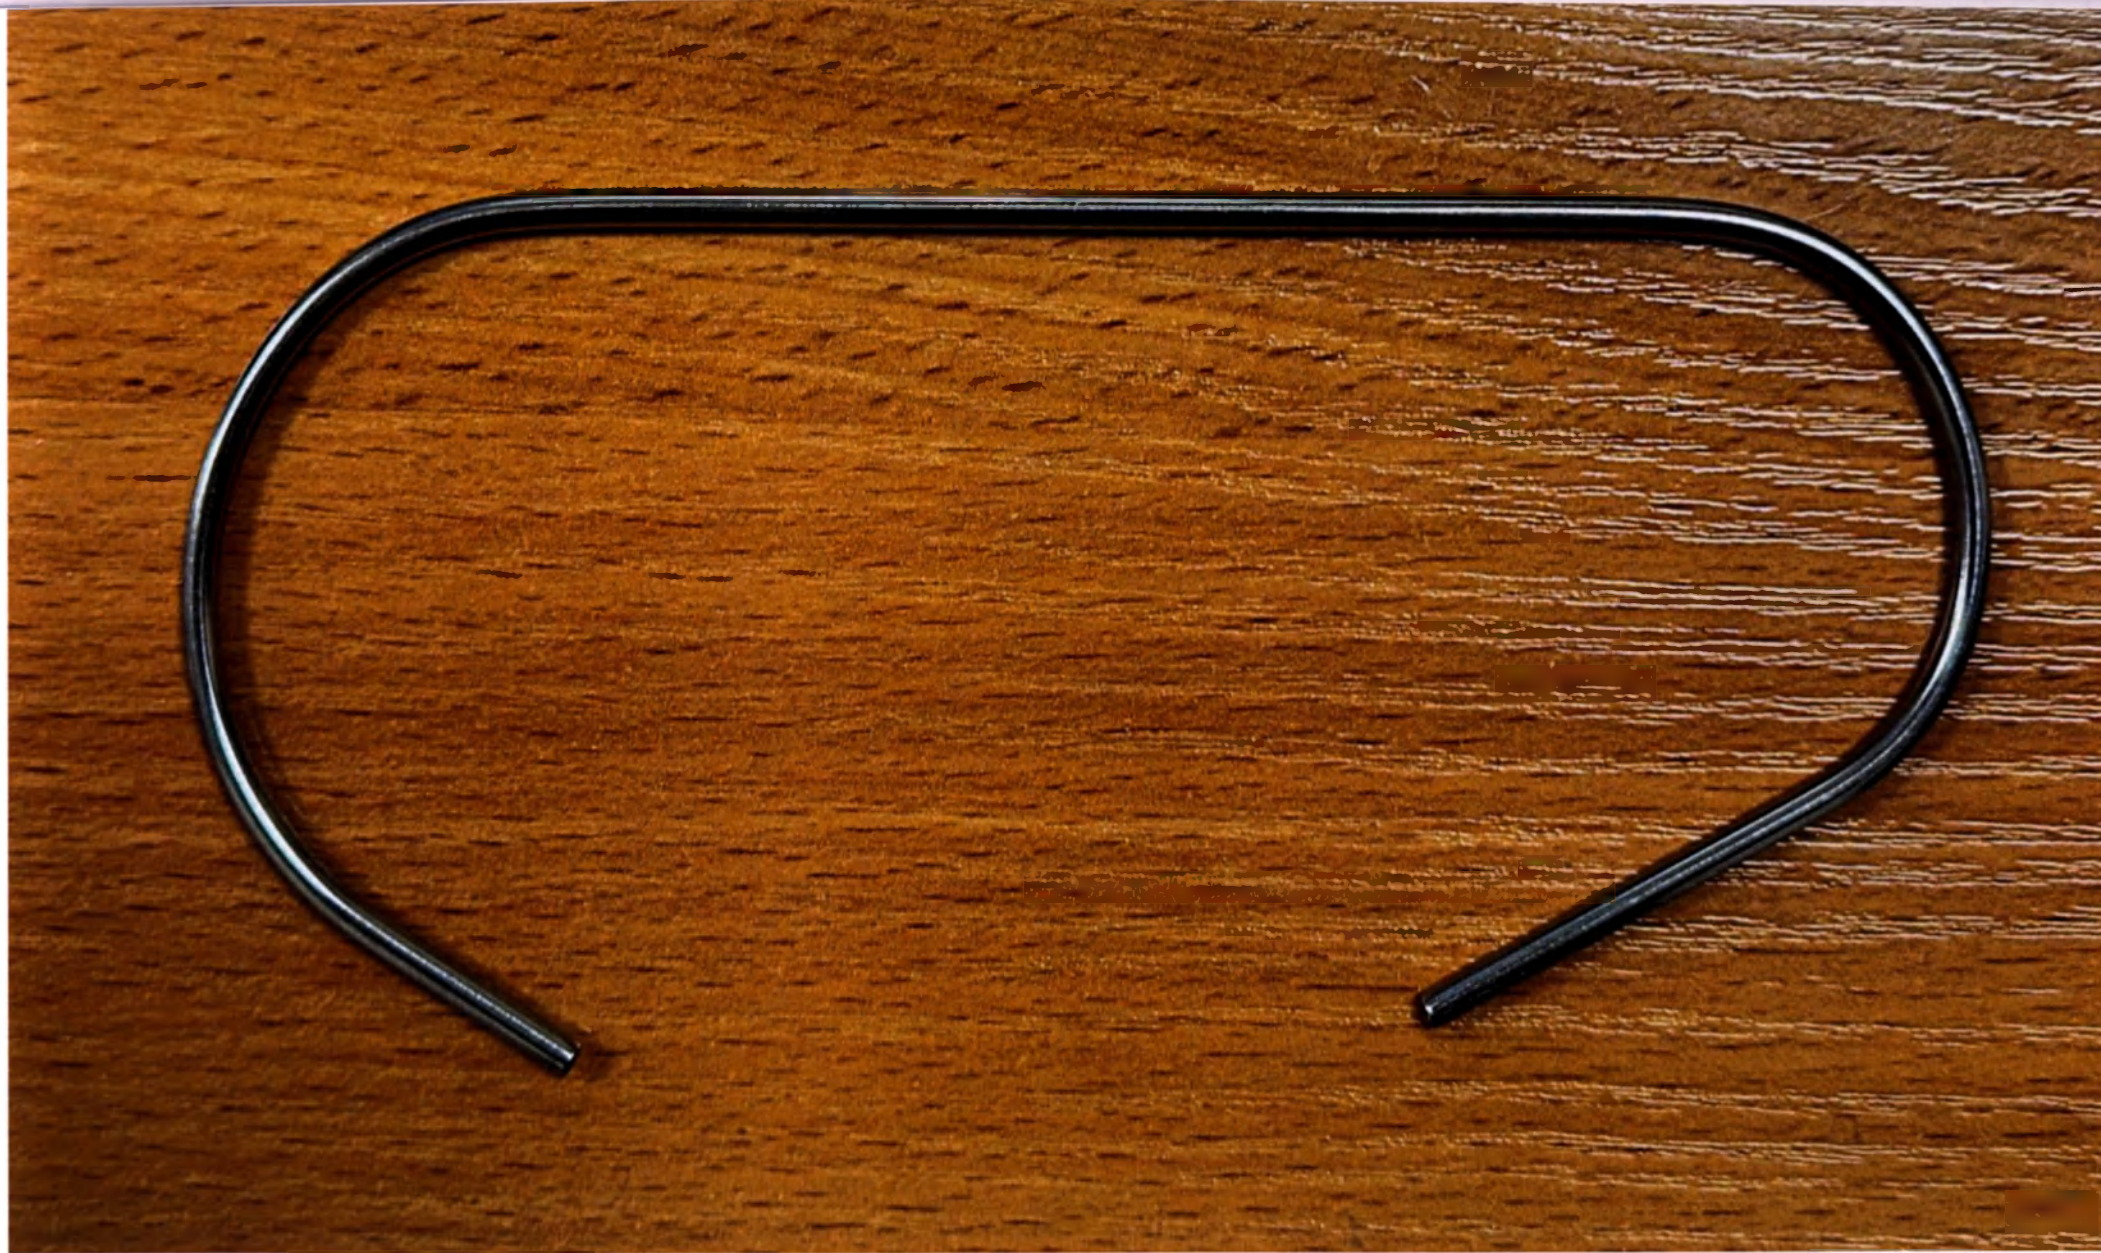

Подвес

POLYSEAL ADULT UNDER WATER SEAL DRAINAGE BOTTLE



EXAMPLE

(GB) • Disposable • Non-Toxic • Non-Pyrogenic
Caution :
• Discard after single use.
• Use only if the package is intact.

(ES) • Materiales • No Tóxico • No Pirogénico
desechables • Deseche después de un solo uso.
Atención : • Utilizar solo si el paquete está intacto.

(IT) • Monouso • Non Tossico • Non Pirrogenico
Attenzione : • Gettare dopo l'uso.
• Usare solo se la confezione è integra.

(FR) • Jetables • non Toxique • apyrétogène
Attention : • Jeter après usage.
• Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

STERILE EO



DEHP
FREE



MD



LATEX
FREE

0123

REF



00320

LOT



2311670D

Mfg.



2023-04

Exp.



2028-03

Code No.

WATERLOCK/01231/0001M

POLYMED
MEDICAL DEVICES

POLY MEDICURE LTD.

Plot No. 104-105, Sector-59, HSIDC Indl. Area,
Faridabad-121004, Haryana, INDIA
Customer Care No : +91-129-4287053
For Feedback : customercare@polymedicare.com

(EC) REP Oodis S.A.

Boulevard Général Wallys 52,
1000, Brussels, BELGIUM
Tel : +32(2) 2 732 59 54
E-mail : medicare@oodis.com

Маркировка производителя емкости для «водяного замка» с подвесом



Упаковка емкости для «водяного замка» с подвесом

Емкость торакальная дренажная Polyseal объемом 2000 мл, в составе:

- емкость для «водяного замка» 2000 мл – 1 шт.;

- подвесы – 2 шт.

Предупреждения: Не токсично, Апирогенно, Для одноразового применения,
Используйте только в том случае, если упаковка не повреждена

REF

LOT



Код № RJ/DEVICE/MFG/MD/2021/000139

POLYMED
MEDICAL DEVICES



Poly Medicure Limited/ Поли Медикьюр Лимитед

адрес: Plot No. 104-105, Sector – 59, HSIIDC Industrial Area, Ballabhgarh, Faridabad,
Haryana 121004, INDIA

STERILE



Не содержит
Диэтилгексилфталат

MD



Не содержит латекс

Макет маркировки емкости для «водяного замка» с подвесом для РФ на примере Емкости торакальной дренажной Polyseal объемом 2000 мл



EXAMPLE

POLYSEAL ADULT

TUBING SET

For Use with Under Water Seal
Drainage Bottle

[GB] • Disposables • Non-Toxic • Non-Pyrogenic
Caution :
• Discard after single use.
• Use only if the package is intact.

[ES] • Materiales • No Tóxico • No Pirogénico
desechables • Deseche después de un solo uso.
Atención : • Utilizar sólo si el paquete está intacto.

[IT] • Monouso • Non Tossico • Non Pirogenico
Attenzione : • Gettare dopo l'uso.
• Usare solo se la confezione e' integra.

[FR] • Jetables • non Toxique • apyrétogène
Attention : • Jeter après usage.
• Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé.

STERILE EO



DEHP
FREE

[MD]



LATEX
FREE

CE
0123

[REF] : 90320

[LOT] : 2311670D

[Mfg.] : 2023-04

[Exp.] : 2028-03

Code No. : RU/DEVCE/MFG/IND/2021/000139

POLYMED
MEDICAL DEVICES

POLY MEDICURE LTD.

Plot No. 104-105, Sector-59, HSIIDC Indl. Area,
Faridabad-121004, Haryana, INDIA
Customer Care No. : +91-129-4287053
For Feedback : customercare@polymedicaure.com

[EC] REP Odeitis s.r.l.
Boulevard Général Wallez 53,
1030, Brussels, BELGIUM
Tel : +32(0) 2 732 59 54
E-mail : mail@odeitis.net

Rev. 09-20/12

Маркировка производителя набора трубок с коннектором



Упаковка набора трубок с коннектором

Емкость торакальная дренажная Polyseal объемом 2000 мл, в составе:

- набор трубок с коннектором – 2 шт.

Предупреждения: Не токсично, Аспирогенно, Для одноразового применения,
Используйте только в том случае, если упаковка не повреждена

REF

LOT



STERILE/EO



Не содержит
Диэтилгексилфталат

MD



Не содержит латекс

Код № RJ/DEVICE/MFG/MD/2021/000139

POLYMED
MEDICAL DEVICES



Poly Medicure Limited/ Поли Медикьюр Лимитед

адрес: Plot No. 104-105, Sector – 59, HSIIDC Industrial Area, Ballabhgarh, Faridabad,
Haryana 121004, INDIA

Макет маркировки набора трубок с коннектором для РФ на примере Емкости торакальной дренажной Polyseal объемом 2000 мл

POLYMED
DISPOSAL KIT
(FOR POLYSEAL)

- **Screw Cap**
- **Snap Fit cap**

1 Pc.

1 Pc.

Маркировка производителя набора защитных крышечек



Упаковка набора защитных крышечек

Емкость торакальная дренажная Polyseal объемом 2000 мл, в составе:

- набор защитных крышечек –2 шт.

Дополнительная красная крышка для емкости 1 шт.

Красная сменная крышка для вакуум-порта 1 шт.

Макет маркировки набора защитных крышечек для РФ на примере Емкости торакальной дренажной Polyseal объемом 2000 мл

Промышленности,
включительно с

