«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
_____ Полынцев Д.Г.
«__» _____ 2024 г.

Макет этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*

«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA свободный Тестостерон», по ТУ 21.20.23-708-98539446-2023», производства ООО «Компания Алкор Био»

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA свободный Тестостерон», по ТУ 21.20.23-708-98539446-2023»	Макет этикеток	ГРУППА КОМПАНИЙ АЛКОР БИО

Вариант исполнения 1

Кат. № 1540101

На коробку:

MagnoLIA

Набор реагентов для калибровки
«Калибраторы MagnoLIA свободный Тестостерон»,
по ТУ 21.20.23-708-98539446-2023

Комплект поставки:

Калибратор 1	1 фл.
Калибратор 2	1 фл.
Калибратор 3	1 фл.
Калибратор 4	1 фл.
Инструкция	1 шт.
Паспорт	1 шт.

Готово к использованию
Для профессионального применения

LOT E004 2024-06-24 2℃ 8℃
REF 1540101 2025-06-24
IVD Σ 10

ТУ 21 20 23-708-98539446-2023
РУ № XXXXXXXXXXXXX

ООО «Компания Алкор Био,
192148,Россия, г. Санкт-Петербург,
Железнодорожный пр., д. 40, лит А
тел./факс:+7(812)6778779; 6772162
info@alkorbio.ru, www.alkorbio.ru

На флаконы:

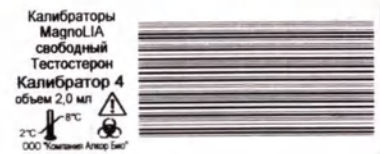

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы свободный Тестостерон», по ТУ 21.20.23-708-98539446-2023»	Макет этикеток	ГРУППА КОМПАНИЙ АЛКОР БИО

Вариант исполнения 2

Кат. № 1540105

На коробку:

На флаконы:

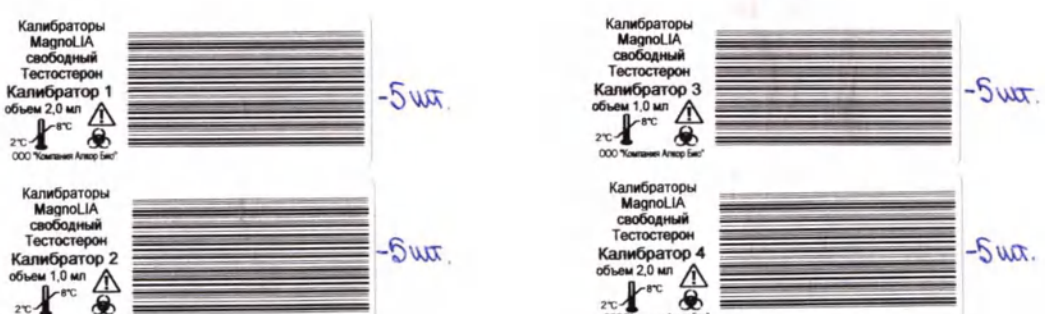

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
3 (Три) лист 9
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
_____ Д.Г. Полынцев

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
_____ Полынцев Д.Г.
«09» 10 2024 г.

Фотографии медицинского изделия для диагностики *in vitro*

«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA свободный Тестостерон», по ТУ 21.20.23-708-98539446-2023», производства ООО «Компания Алкор Био»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

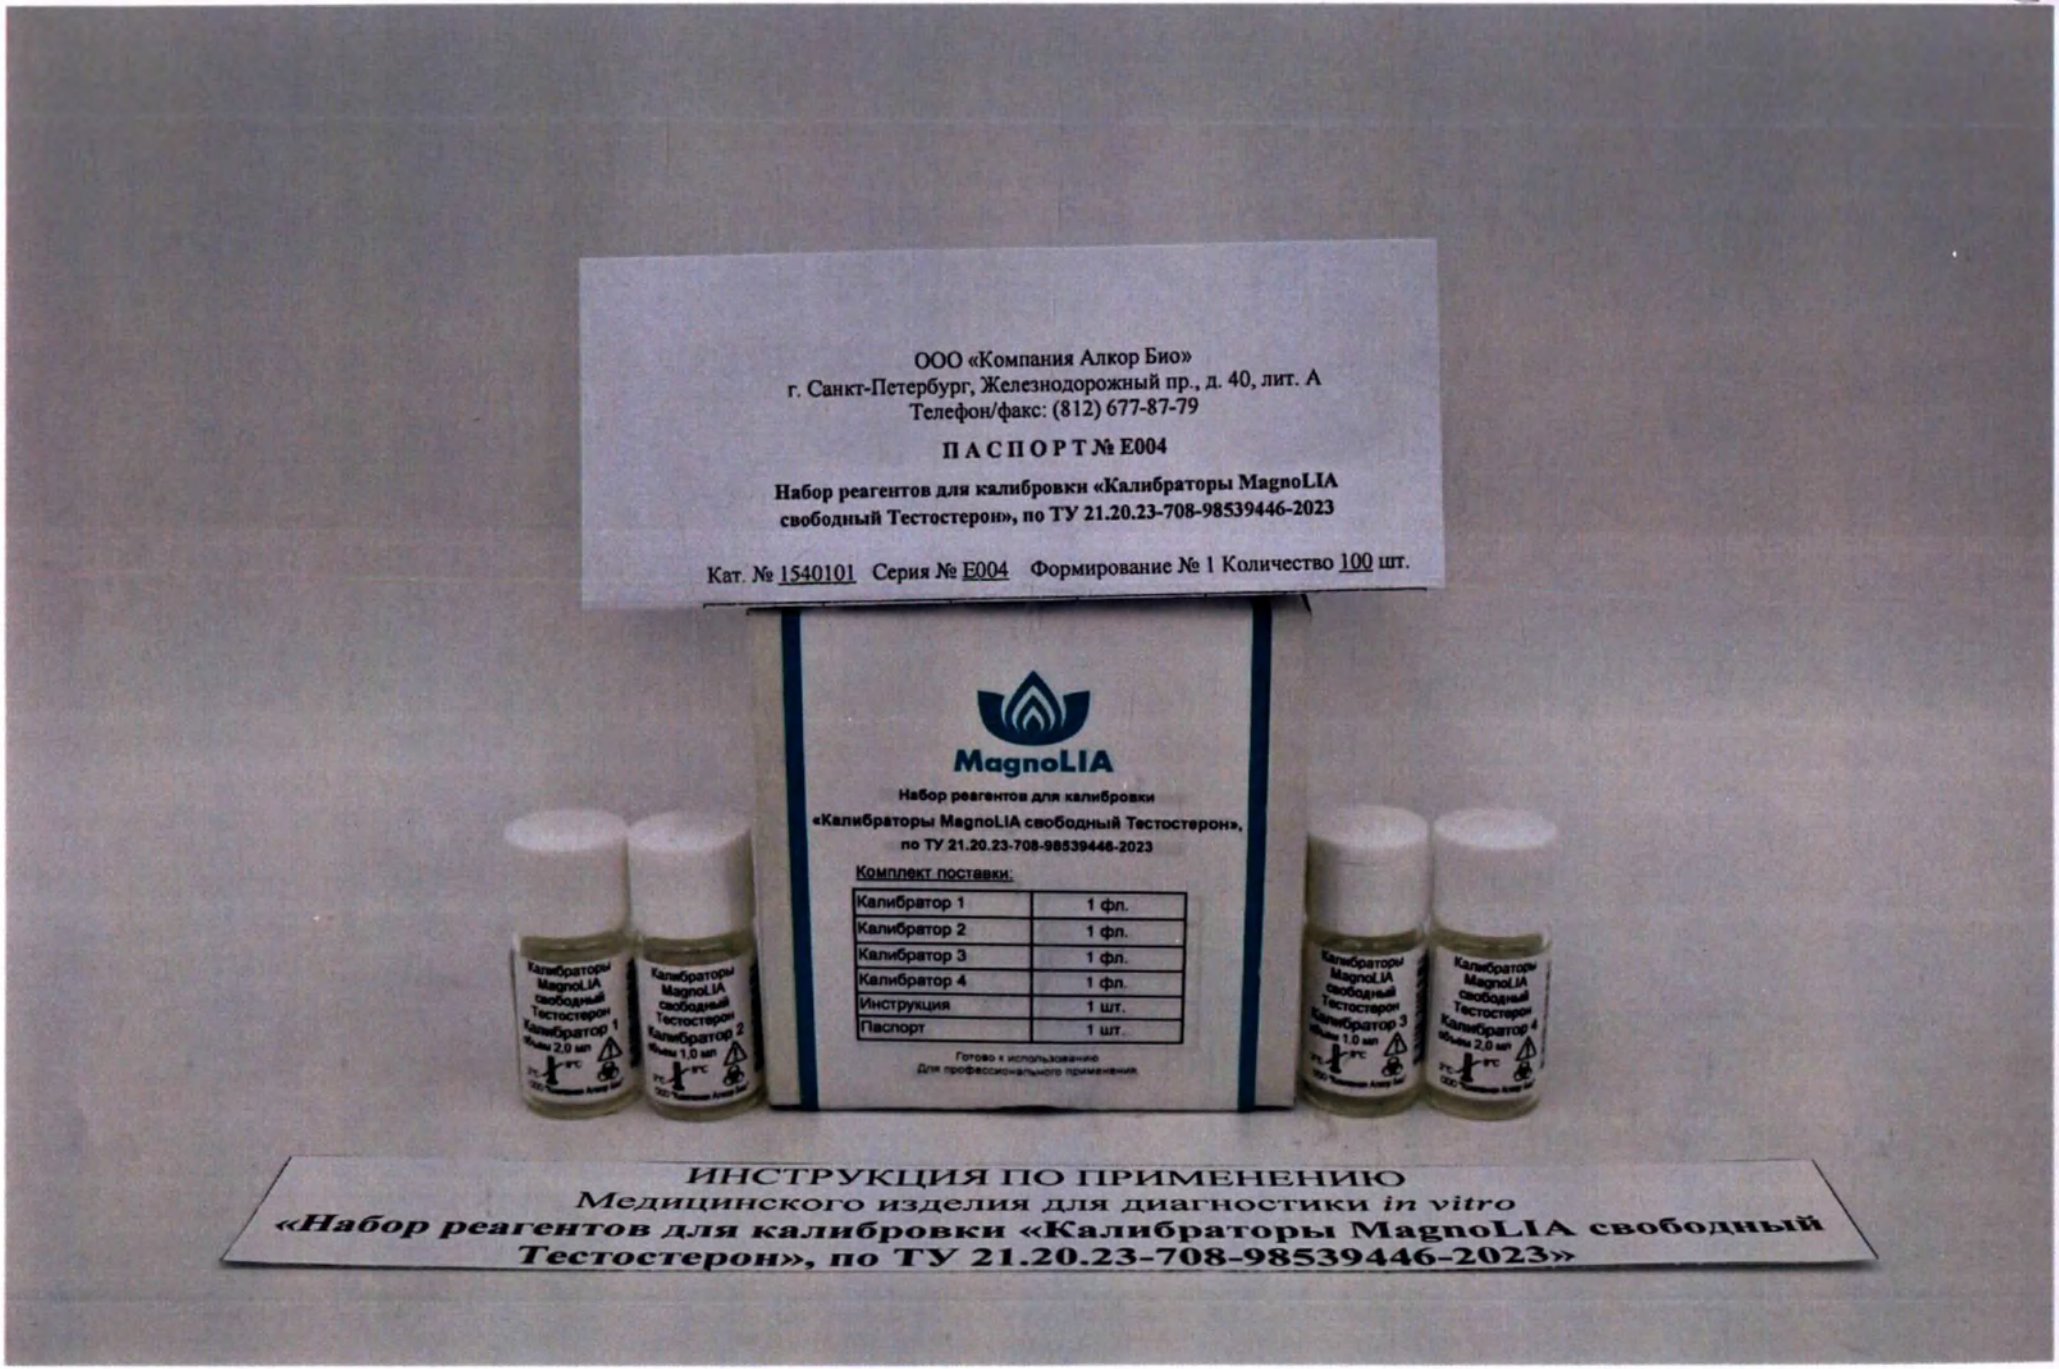

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

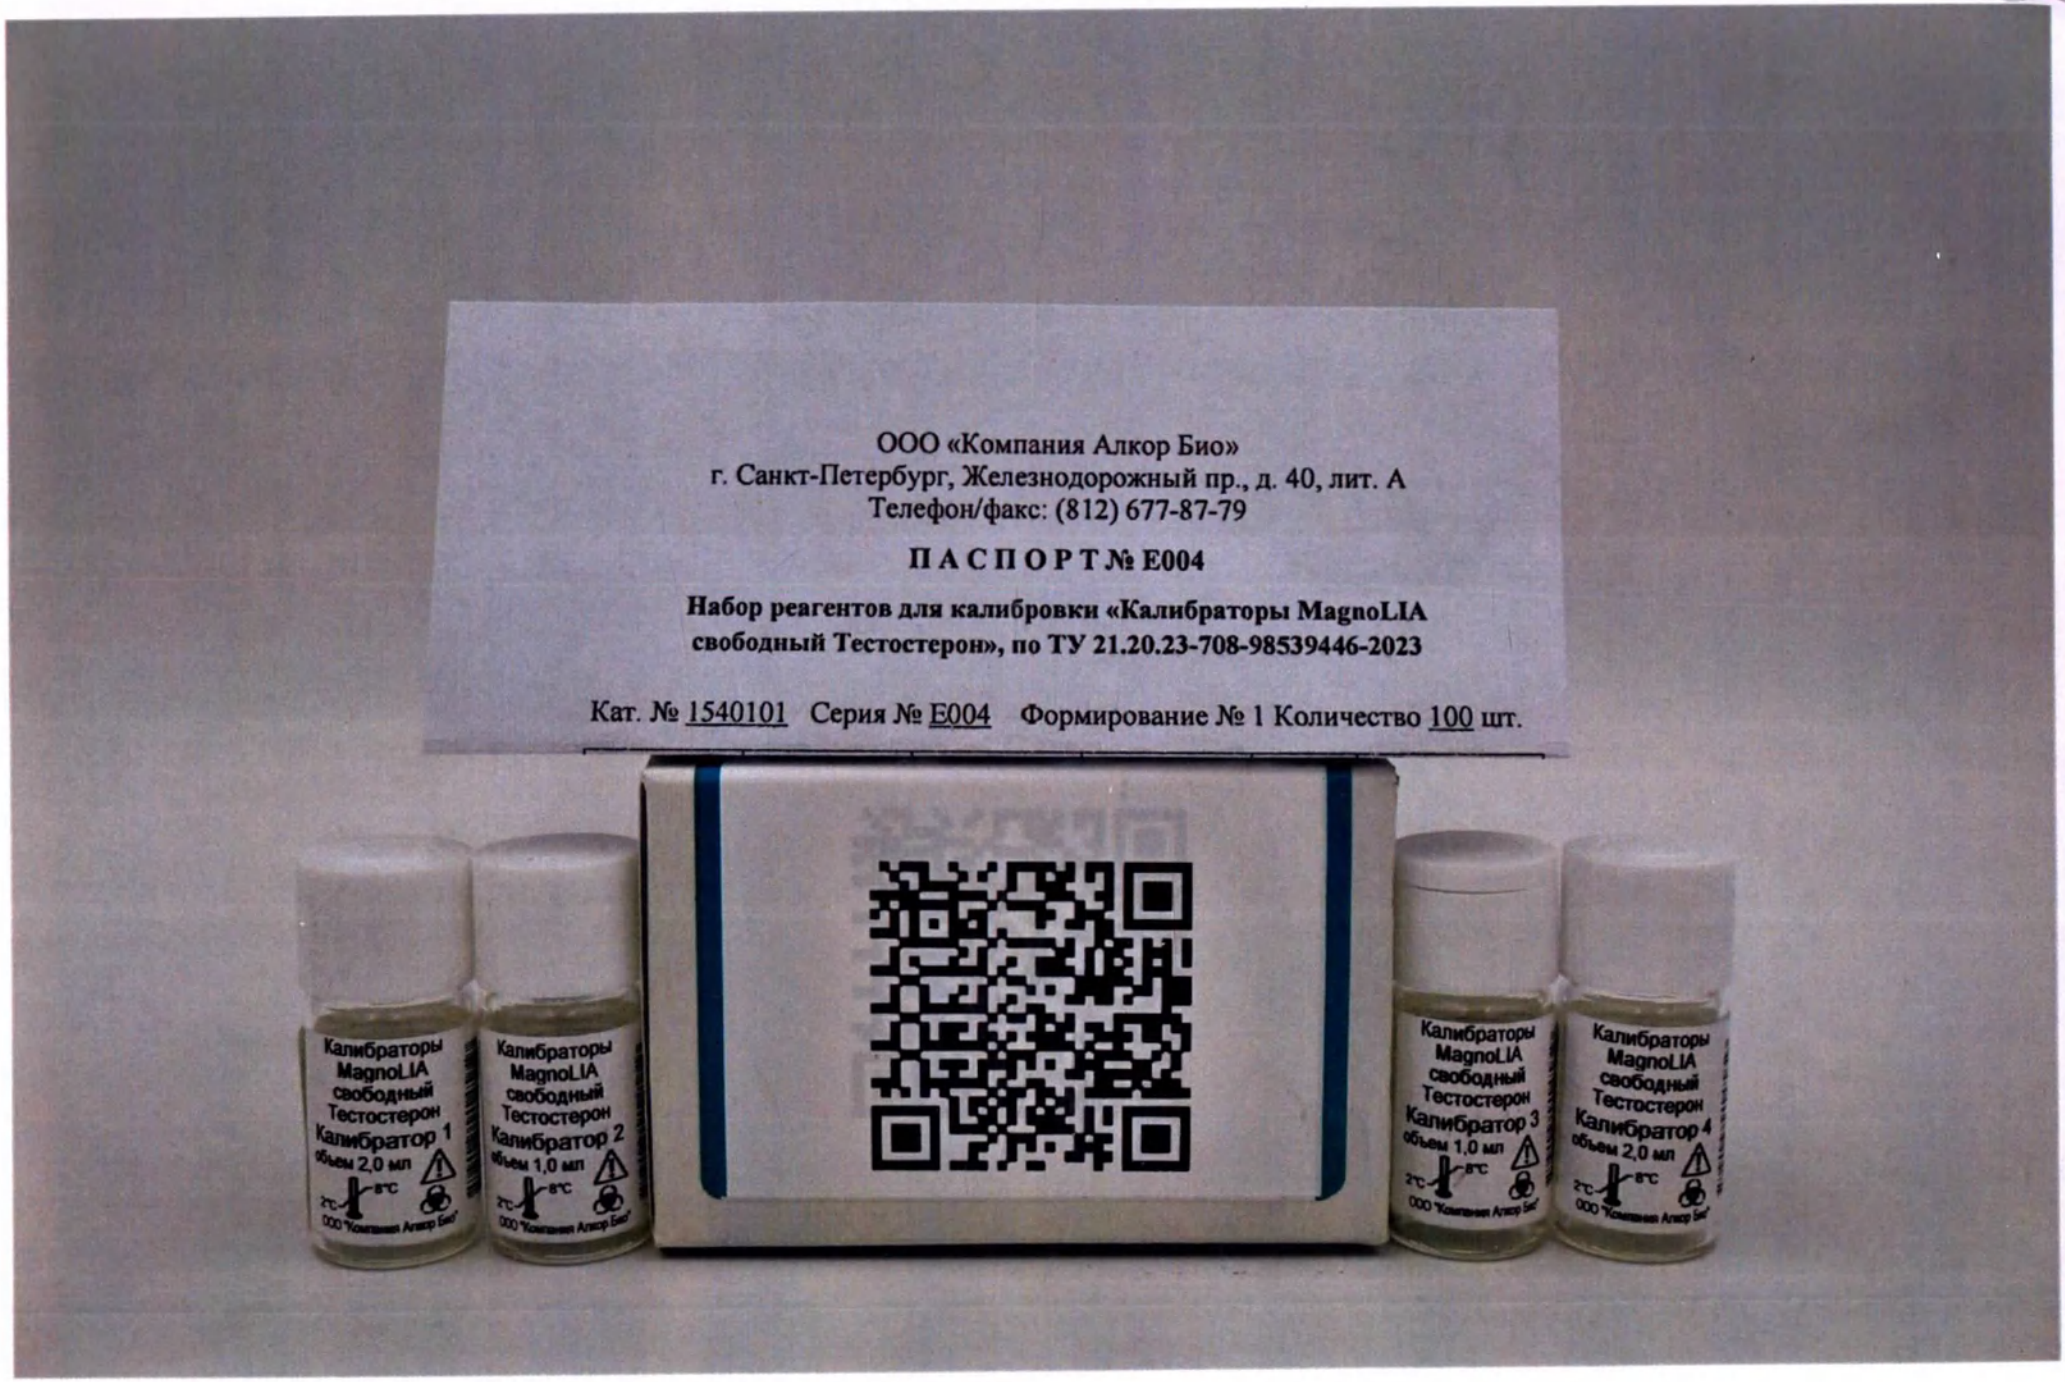

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Медицинского изделия для диагностики *in vitro*
«Набор реагентов для калибровки «Калибраторы MagnoLIA свободный Тестостерон», по ТУ 21.20.23-708-98539446-2023»

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

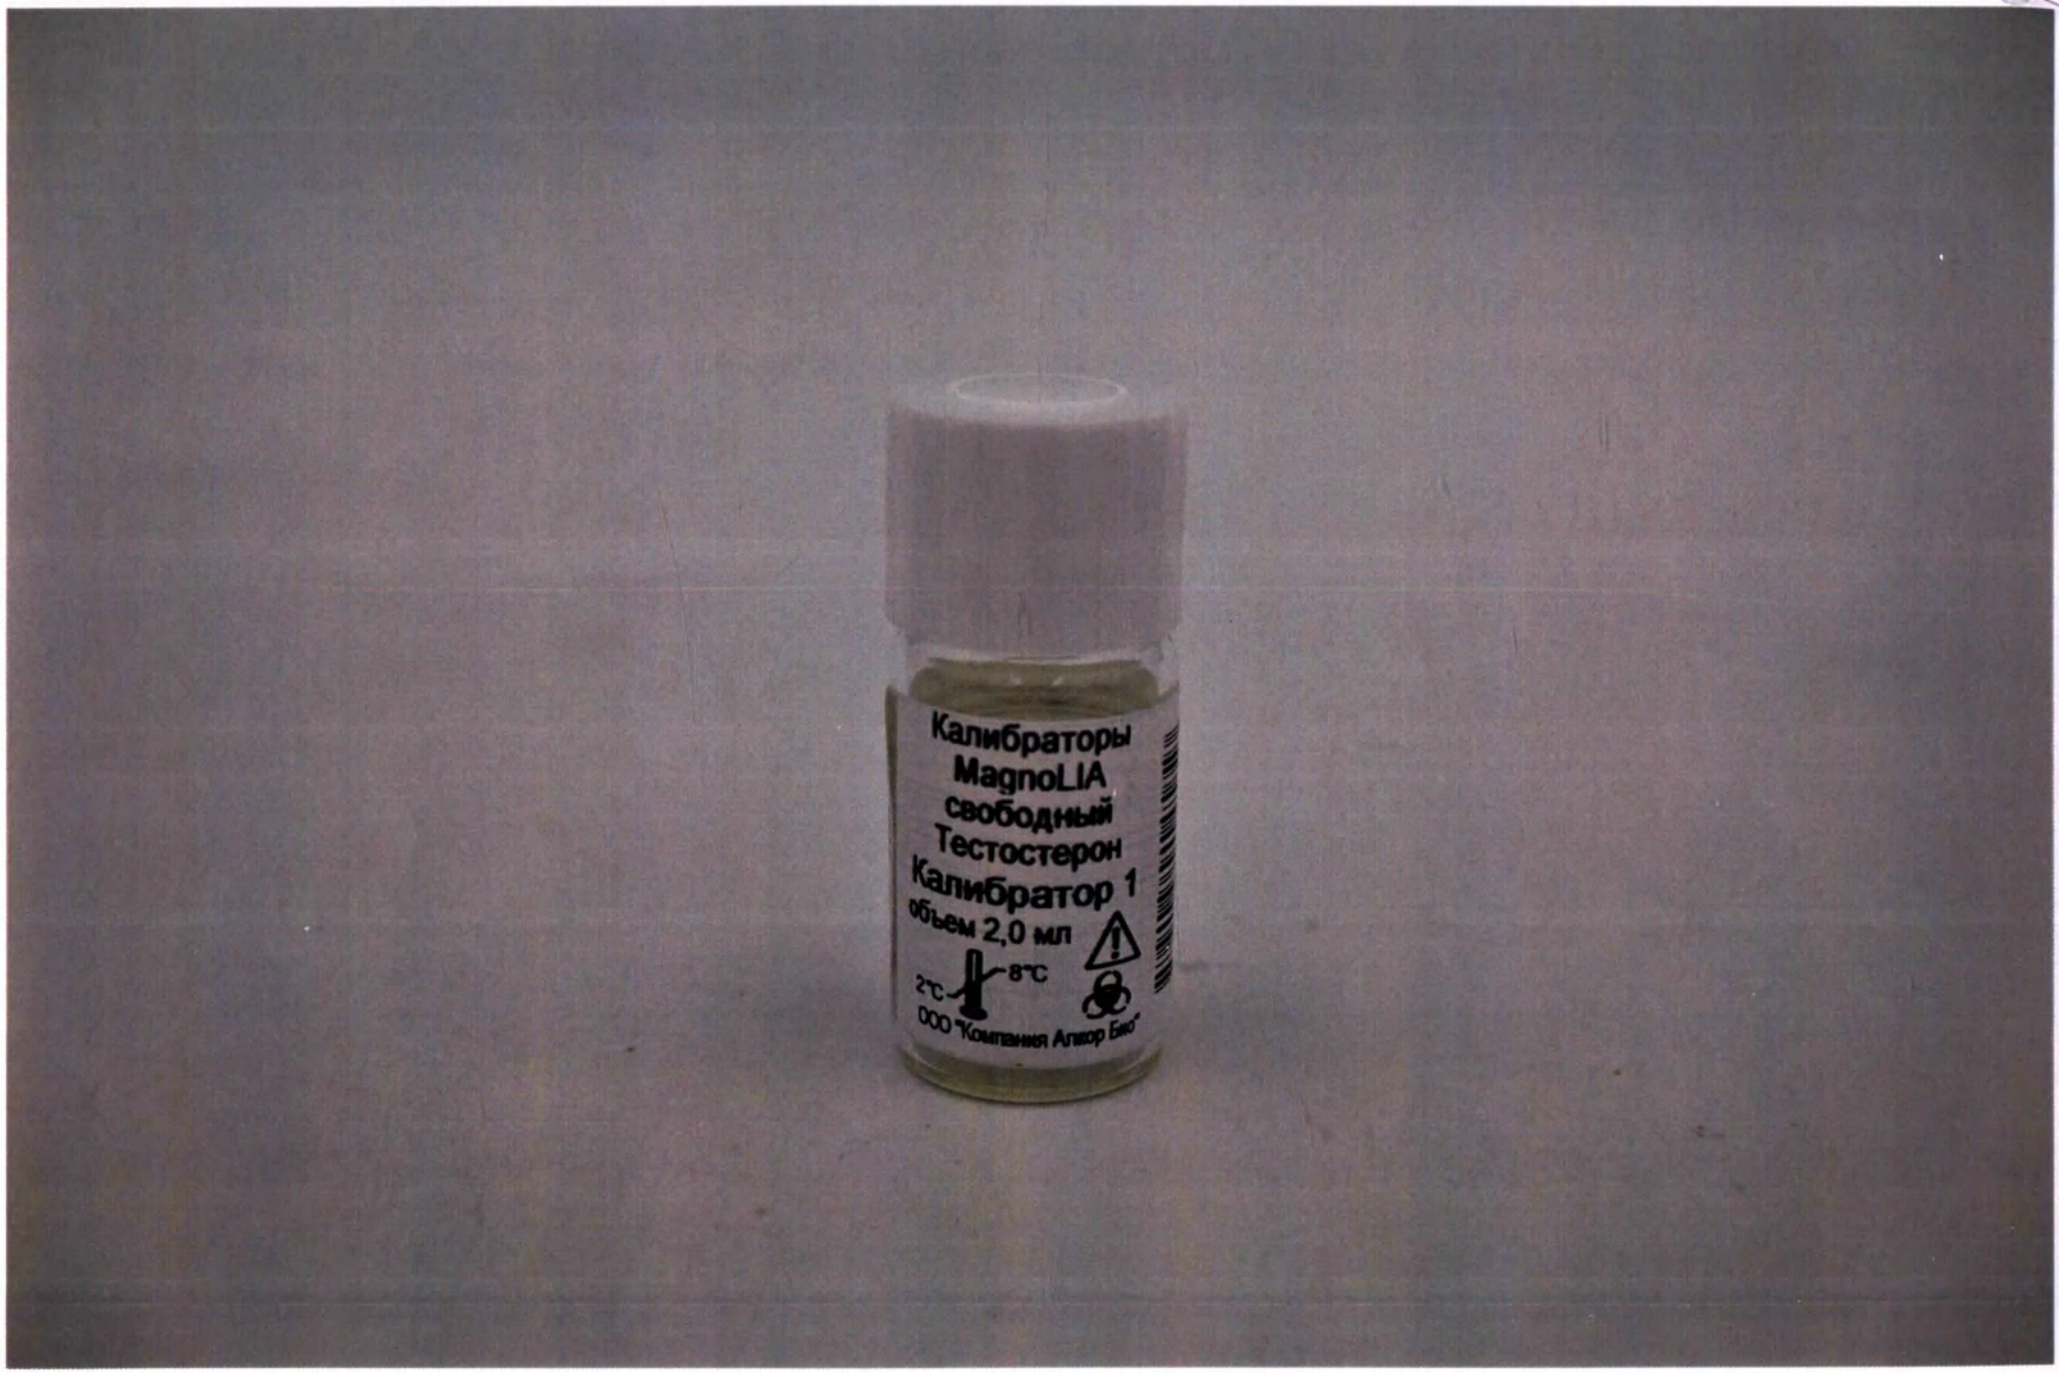

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

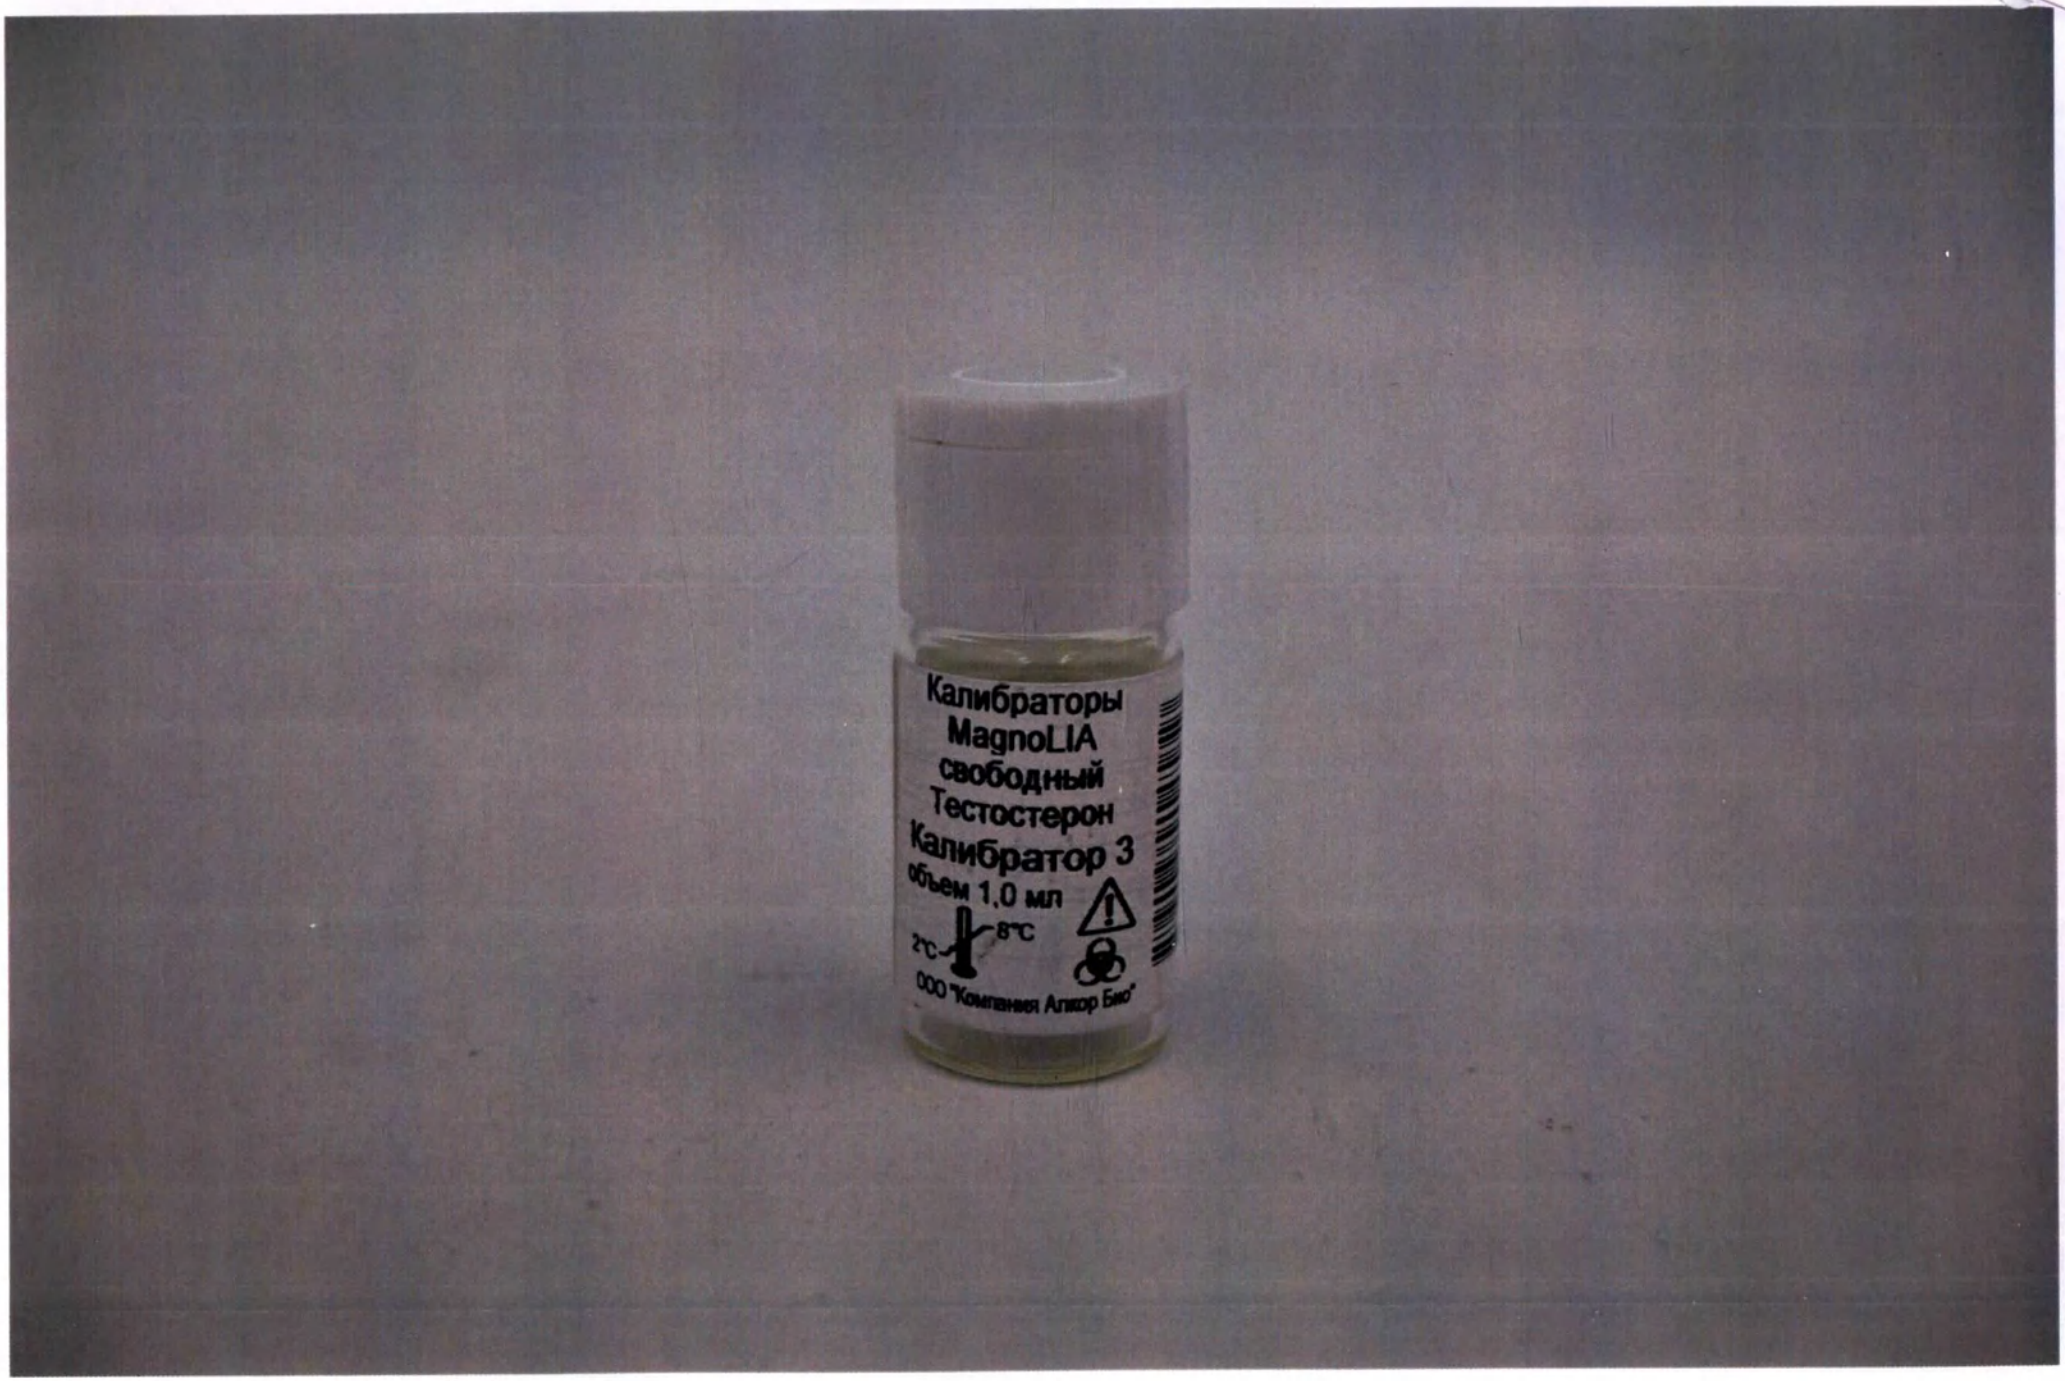

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

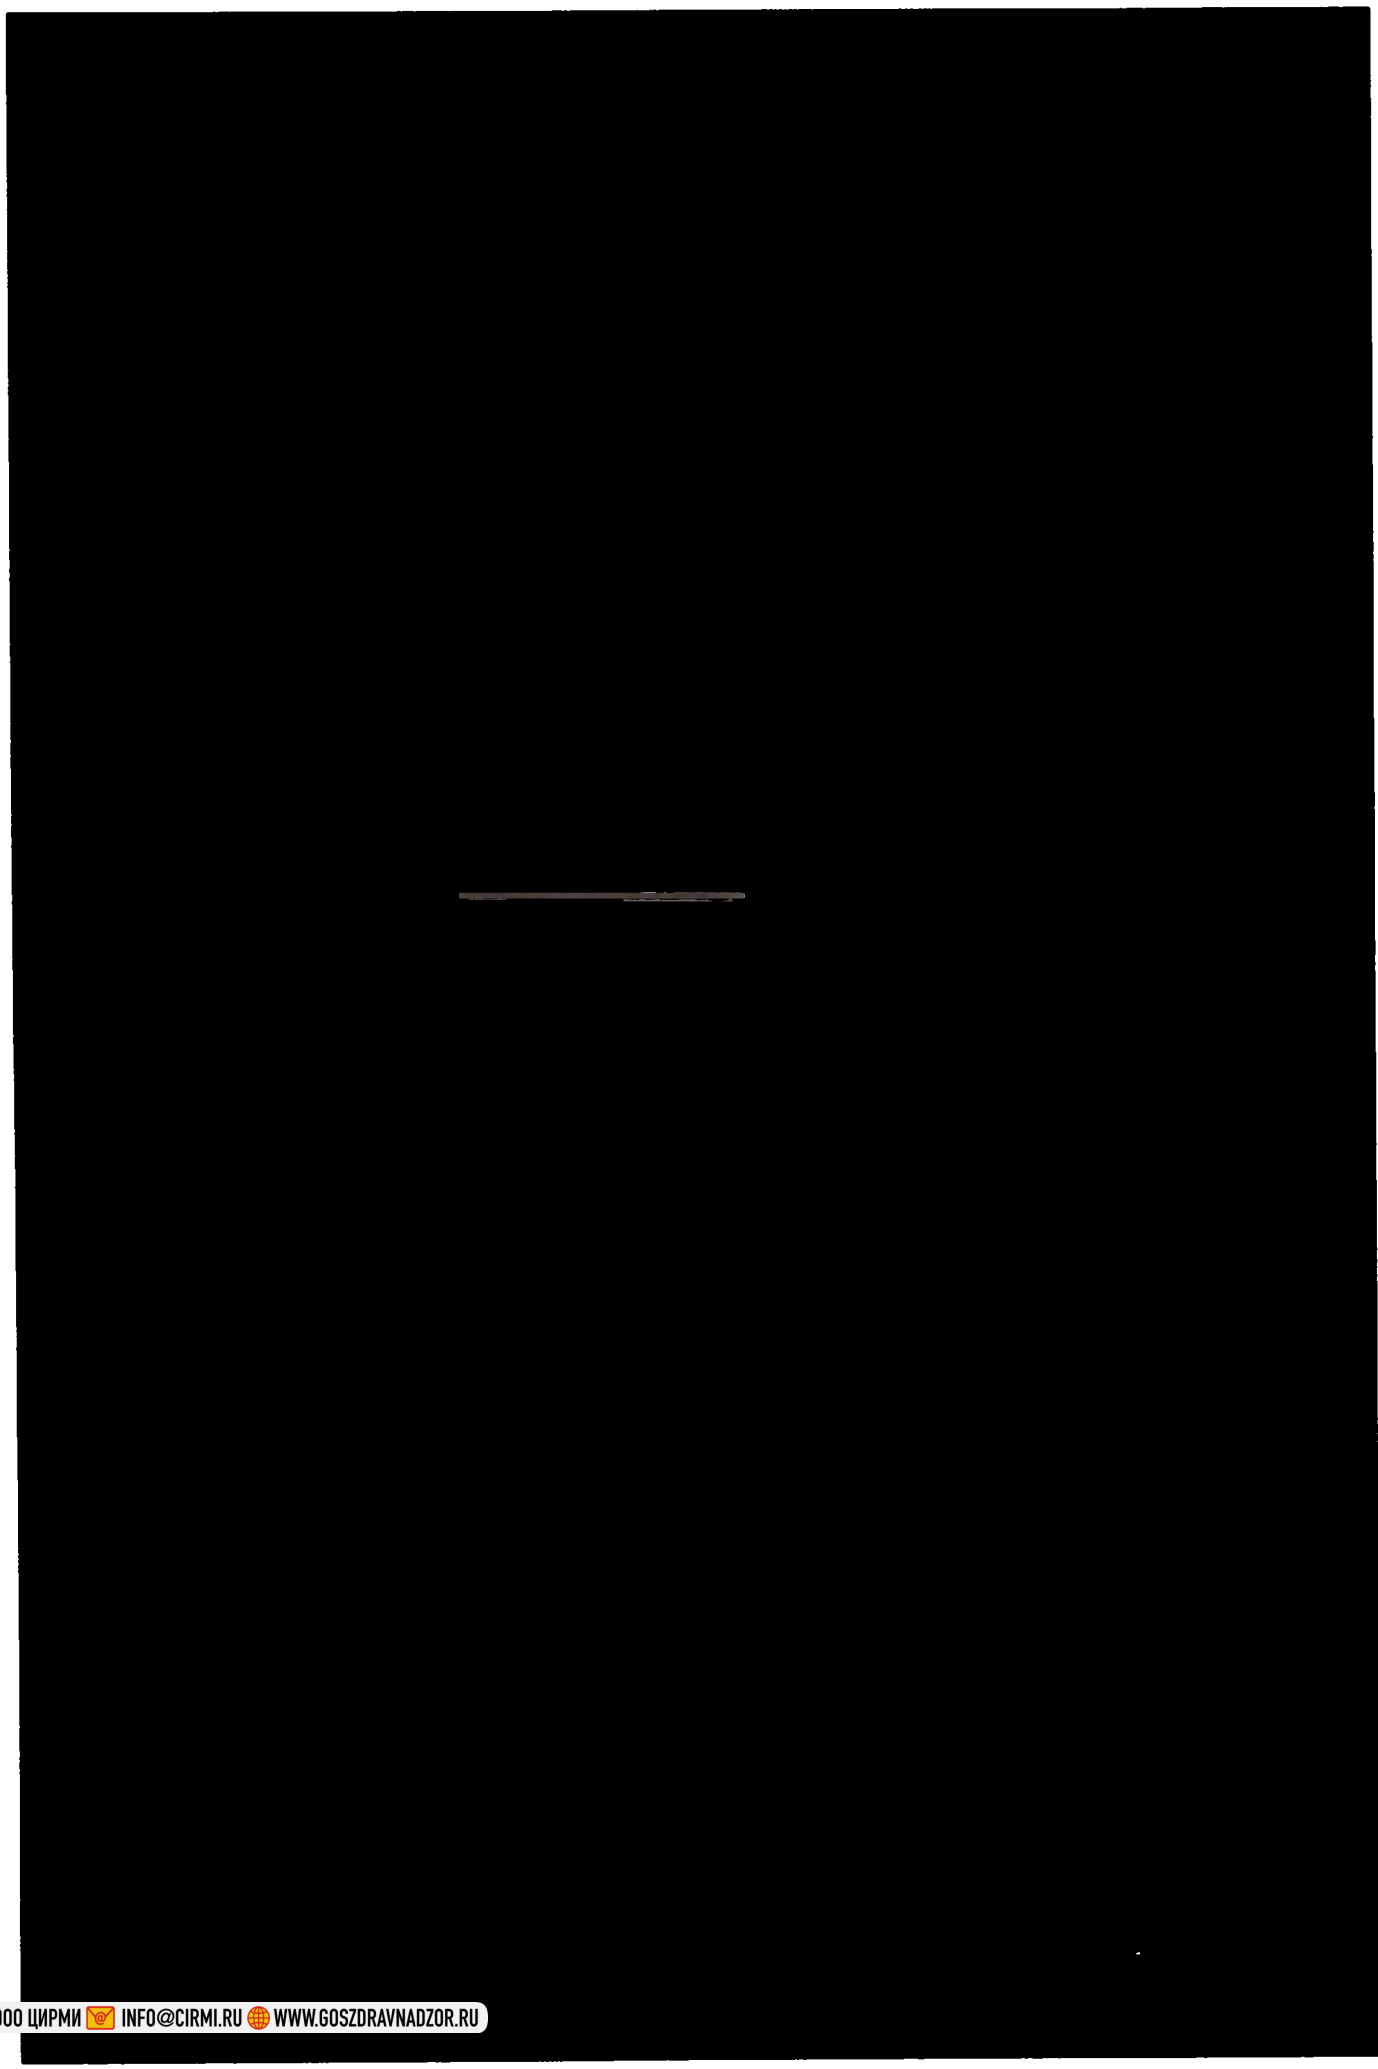

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

Прошито, пронумеровано, скреплено печатью
11 (одиннадцать) лист[ов]
Генеральный директор
ООО «Компания Алкор Био»
_____ Д.Г. Полынцев

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU