



ООО "Эбботт Лэбораториз"  
125171, Москва, Ленинградское шоссе,  
д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80  
Факс: (495) 258 42 81

## Фотографические изображения медицинского изделия

*«Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor»,  
в вариантах исполнения,  
производства Abbott Medical, USA  
(Эбботт Медикал, США)*

177 County Road B East St. Paul, Minnesota 55117, USA

**УТВЕРЖДАЮ**

Менеджер по регуляторным вопросам

ООО «Эбботт Лэбораториз»

по доверенности № 77АД 3225473 от 13.04.2023 г.

**Киселева А.А.**

«23» октября 2024г.





ООО "Эбботт Лаборатория"  
125171, Москва, Ленинградское шоссе,  
д.16А, строение 1, БЦ "Метрополис"

Тел: (495) 258 42 80  
Факс: (495) 258 42 81

В Федеральную службу по надзору  
в сфере здравоохранения  
109074, г. Москва,  
Славянская пл., д. 4, стр.1

ООО «Эбботт Лабораториз» настоящим дает пояснение, относительно регистрируемого медицинского изделия «Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor», в вариантах исполнения.

Производитель - Abbott Medical, успешно прошел первичное инспектирование производства в соответствии с требованиями надзорных органов, что подтверждено Отчетом о результатах первичного инспектирования производства № ИП-24-157 от 12.08.2024г., выданного ФГБУ «ВНИИИМТ» Росздравнадзора.

В ходе инспектирования, также был рассмотрен и признан, соответствующим требованиям стандартов, установленным для медицинских изделий, тип и маркировка транспортной упаковки.

Основные требования к транспортной упаковке включают обеспечение целостности, стерильности (если применимо), а также защиту от внешних воздействий и повреждений во время транспортировки и хранения.

Отсутствие маркировки на русском языке на транспортной упаковке не влияет на выполнение вышеуказанных требований и не снижает уровень безопасности и качества изделий.

Маркировка транспортной упаковки содержит минимальную информацию (манипуляционные символы), необходимую для обеспечения безопасности и эффективности медицинских изделий при их транспортировании и обращении.

Указание наименования медицинского изделия и других идентифицирующих признаков на транспортной упаковке медицинских изделий не является обязательным требованием.

Размер транспортной упаковки может варьироваться в зависимости от объема заказа, что способствует оптимизации логистических процессов и своевременному обеспечению клиник необходимой продукцией.

Также, в соответствии с требованиями, при поставке на территорию РФ в целях обращения рядом с оригинальной маркировкой, но, не перекрывая её, потребительская упаковка каждого элемента, входящего в состав «Системы имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor» и индивидуальная упаковка систем доставки/загрузки дополнительно маркируется локальным стикером.



ООО «Эбботт Лэбораториз»  
125171 Москва Ленинградское шоссе  
д.16А строение 1, БЦ «Метрополис»

Тел: (495) 258 42 80  
Факс: (495) 258 42 81

Транскатетерный аортальный клапан Navitor маркируется локальным стикером до уровня потребительской упаковки во избежание нарушения стерильности и целостности.

При прохождении таможенного досмотра или иных проверочных процедур транспортная упаковка вскрывается и проверяется наличие маркировки на русском языке на потребительской упаковке каждого медицинского изделия.

Следует также отметить, что в одной транспортной упаковке могут находиться различные медицинские изделия, так как заказы формируются индивидуально под каждое медицинское учреждение.

Менеджер по регуляторным вопросам  
ООО «Эбботт Лэбораториз»  
по доверенности № 77АД 3225473 от 13.04.2023 г.  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2024г.

Киселева А.А.

М.П.

\_\_\_\_\_  
(Подпись)



**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм.**





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм.






**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм.**






Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм.

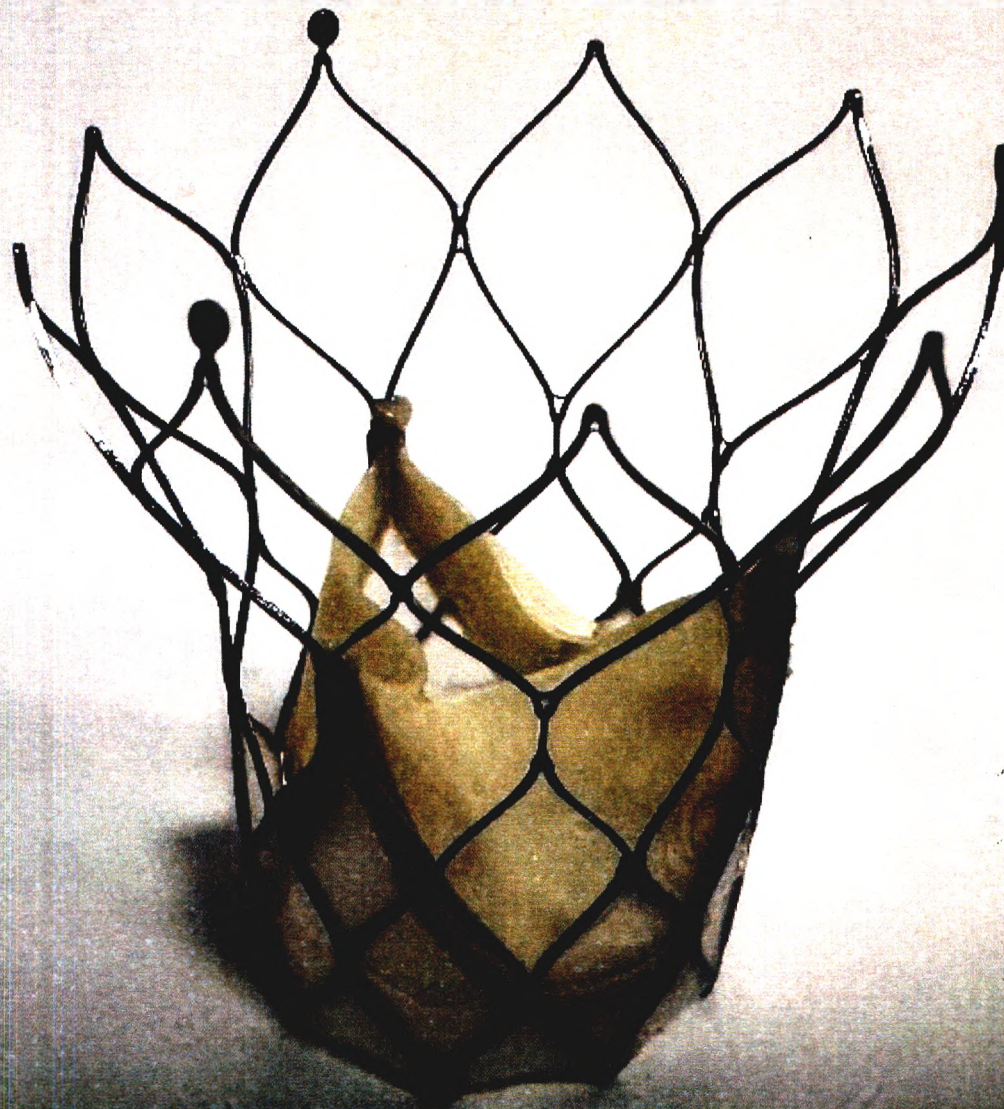



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм. Индивидуальная упаковка.

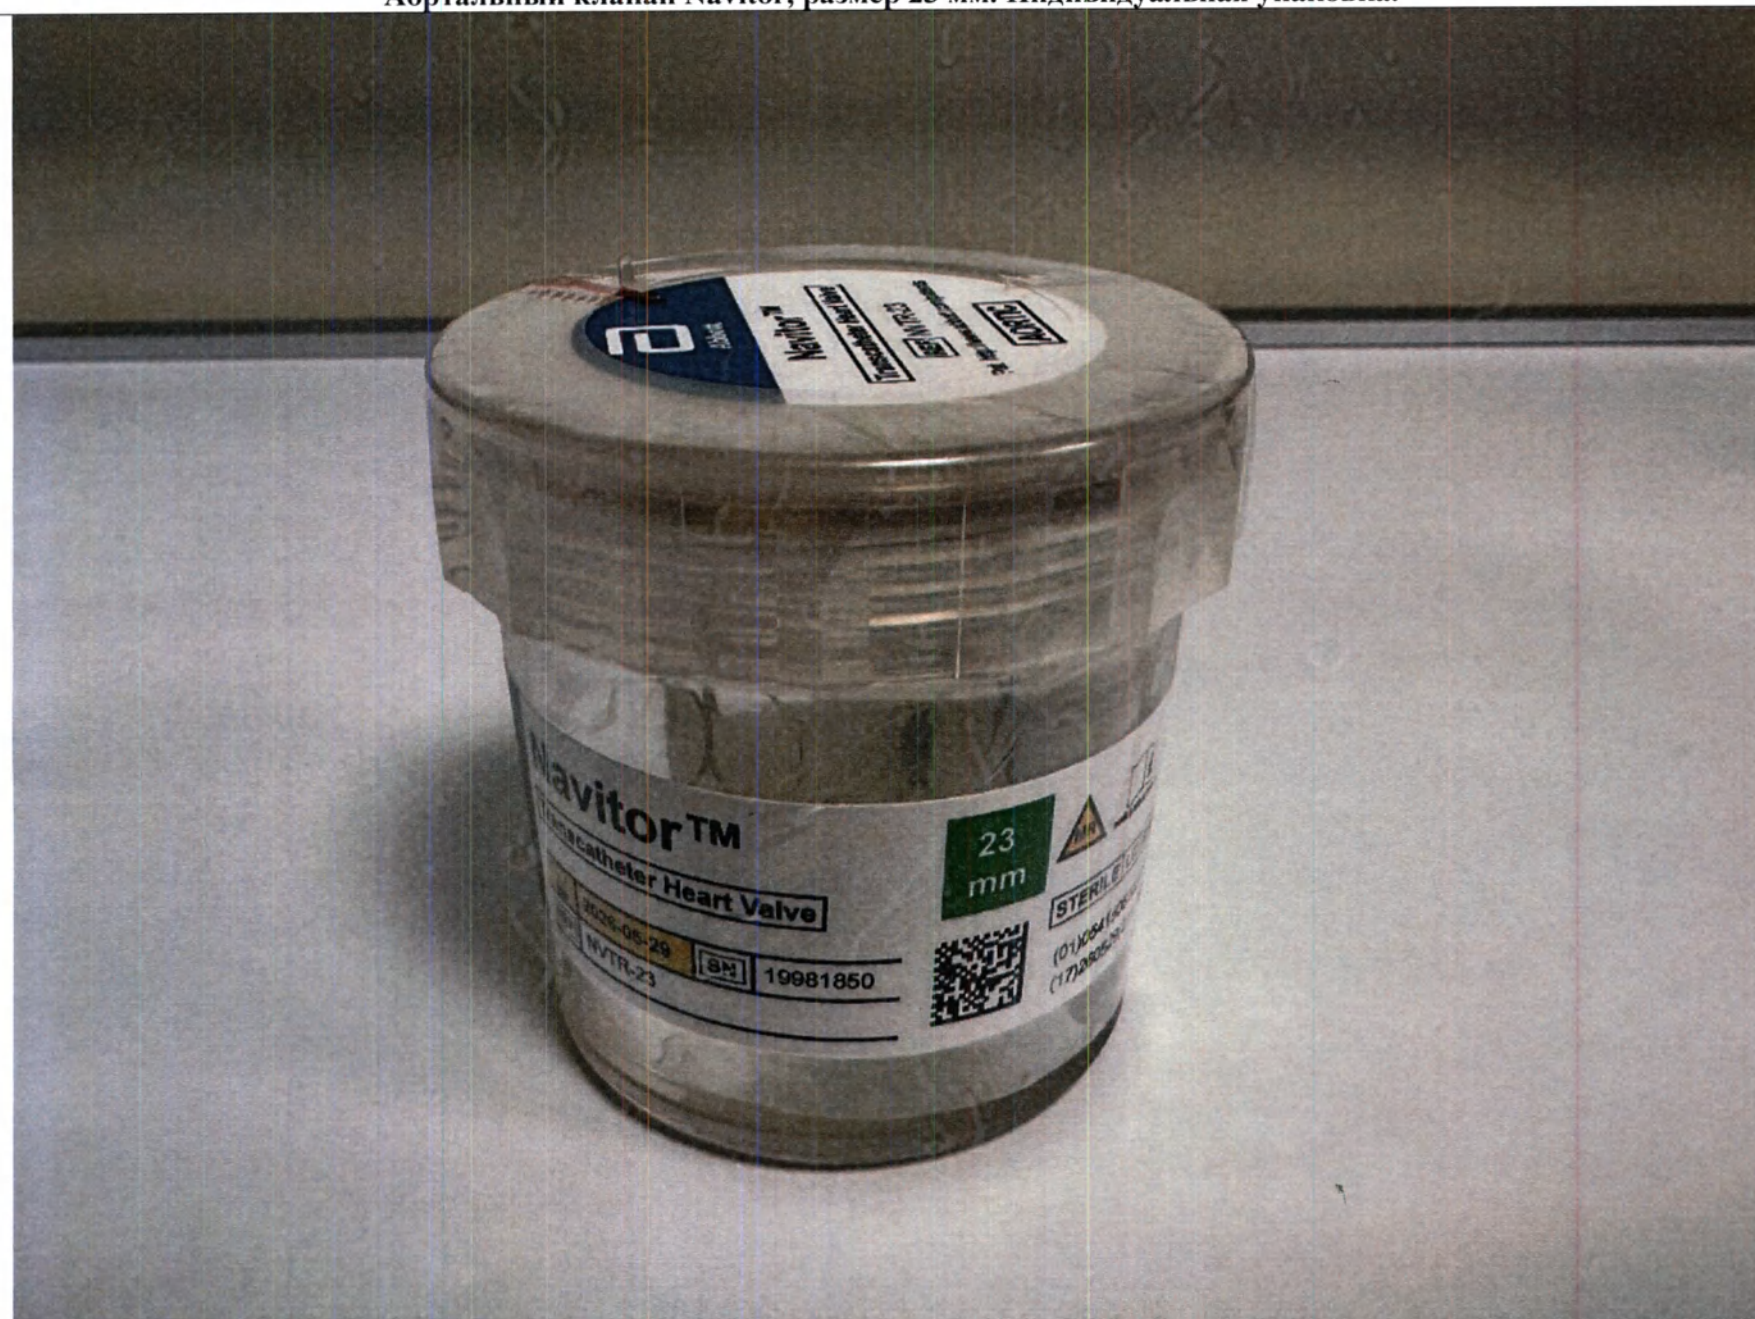




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм. Индивидуальная упаковка.





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм. Индивидуальная упаковка.

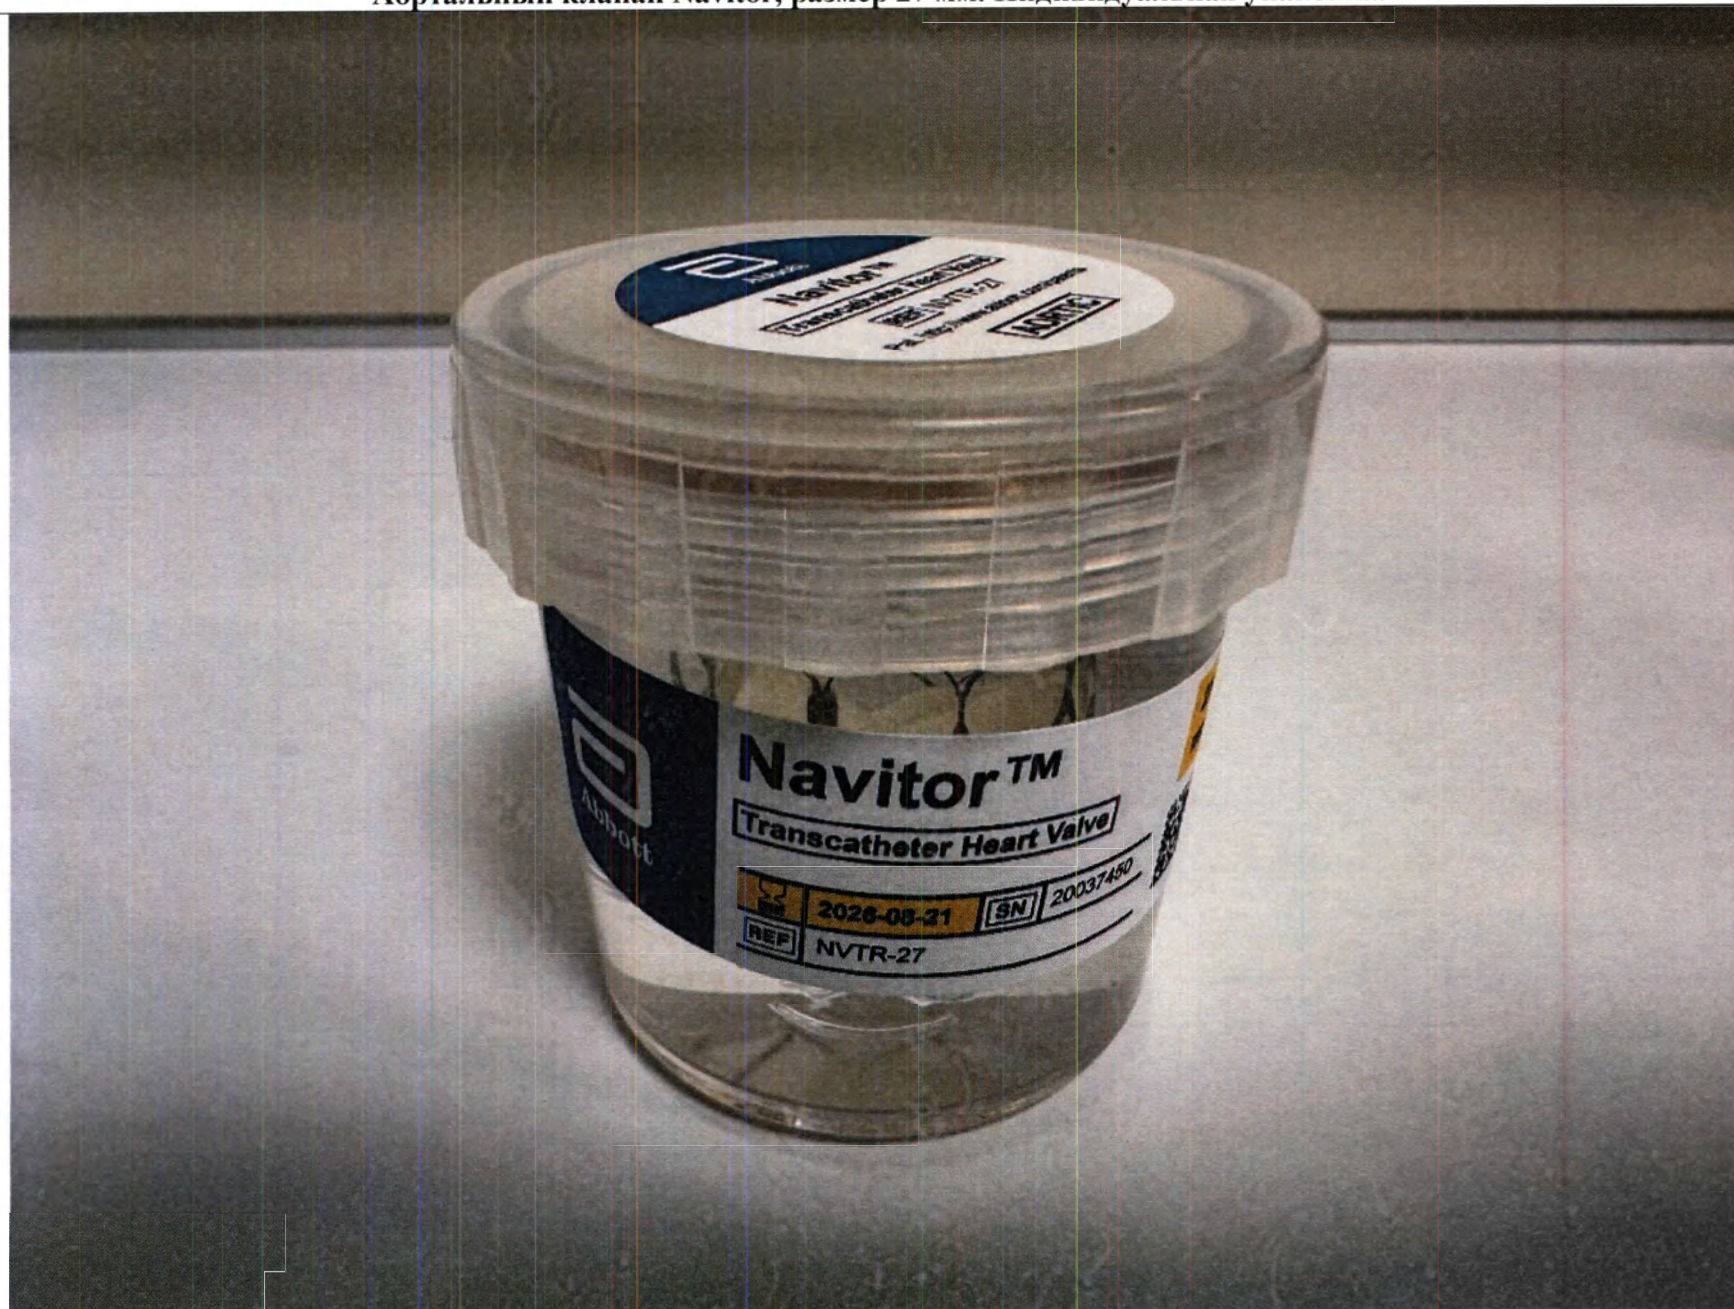




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм. Индивидуальная упаковка.





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.

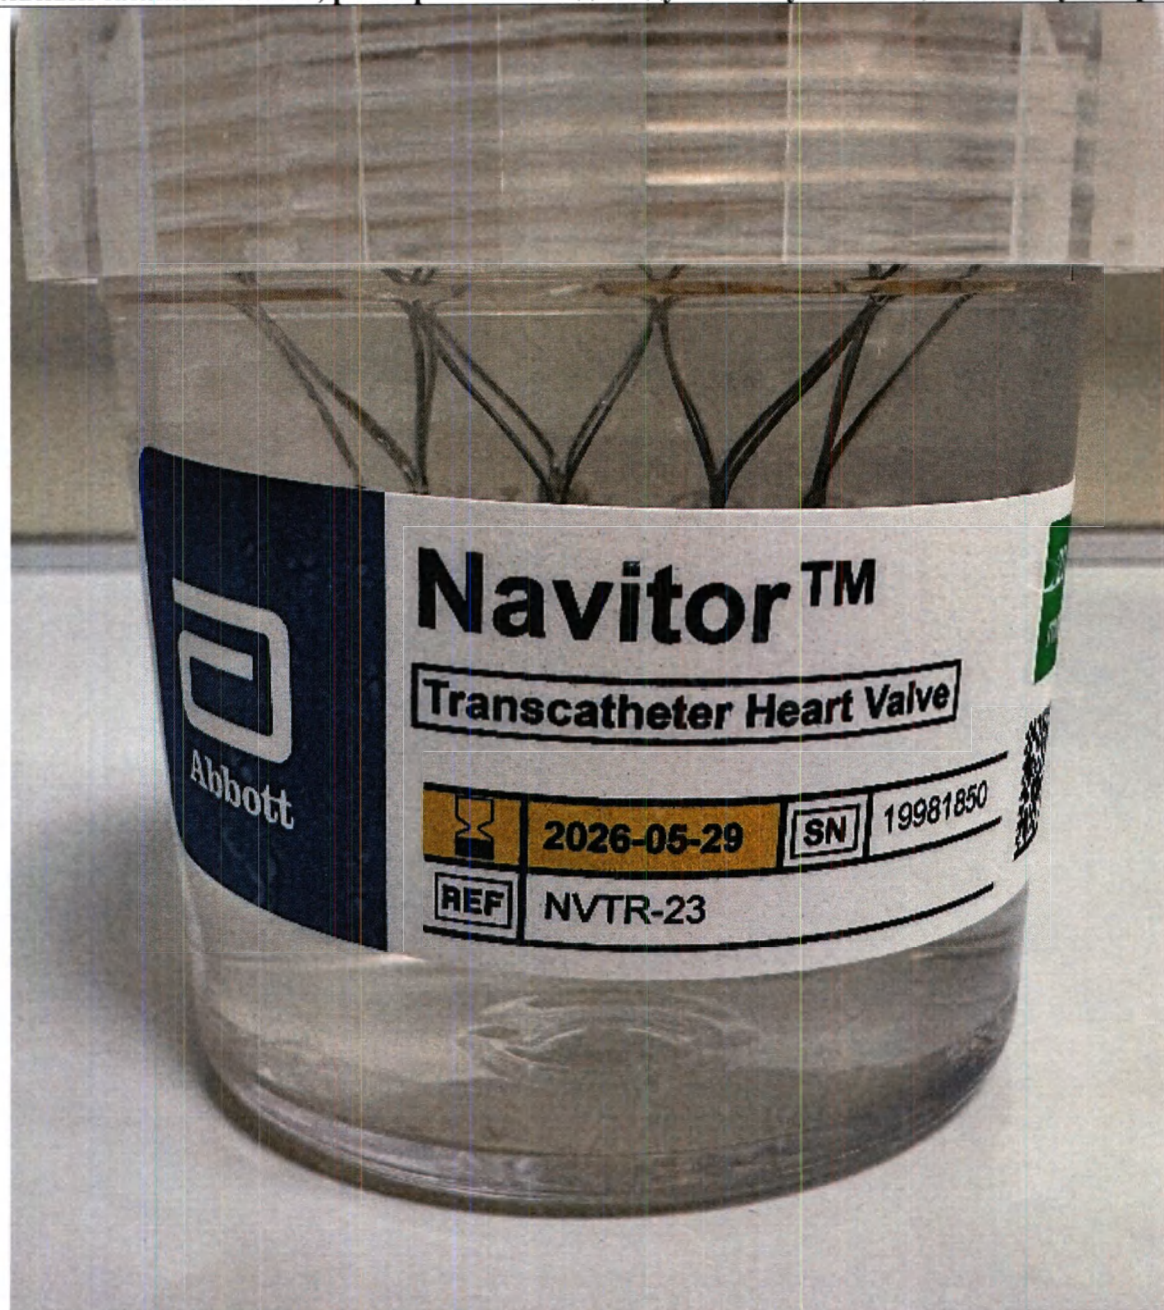



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.






Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.

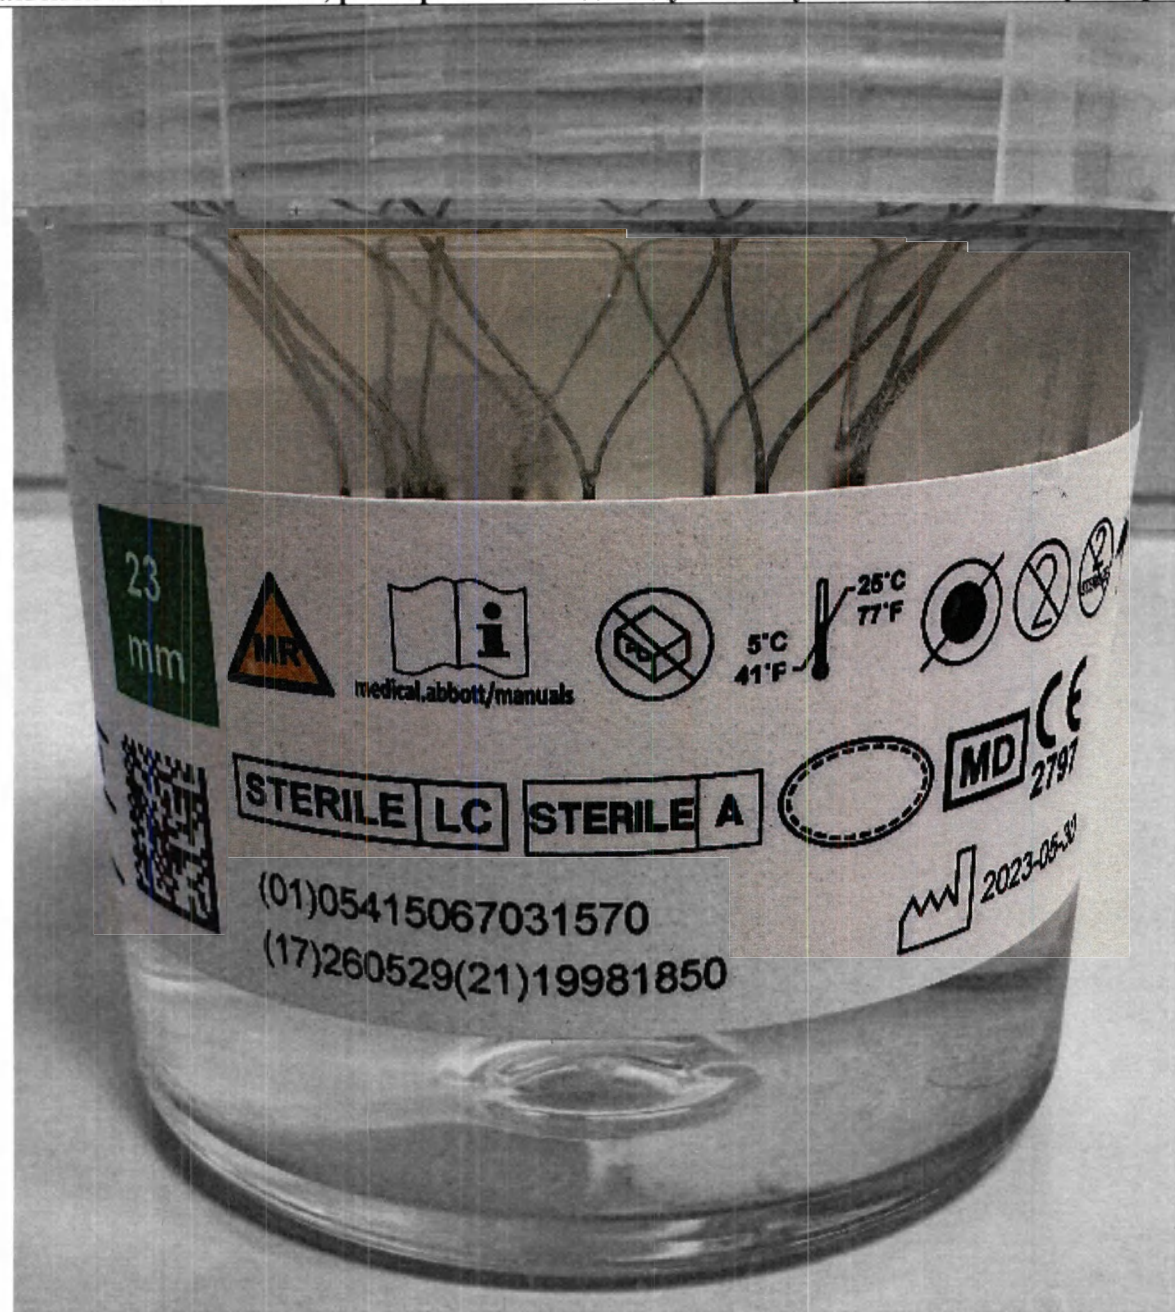



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.





**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.**






**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.**






Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.

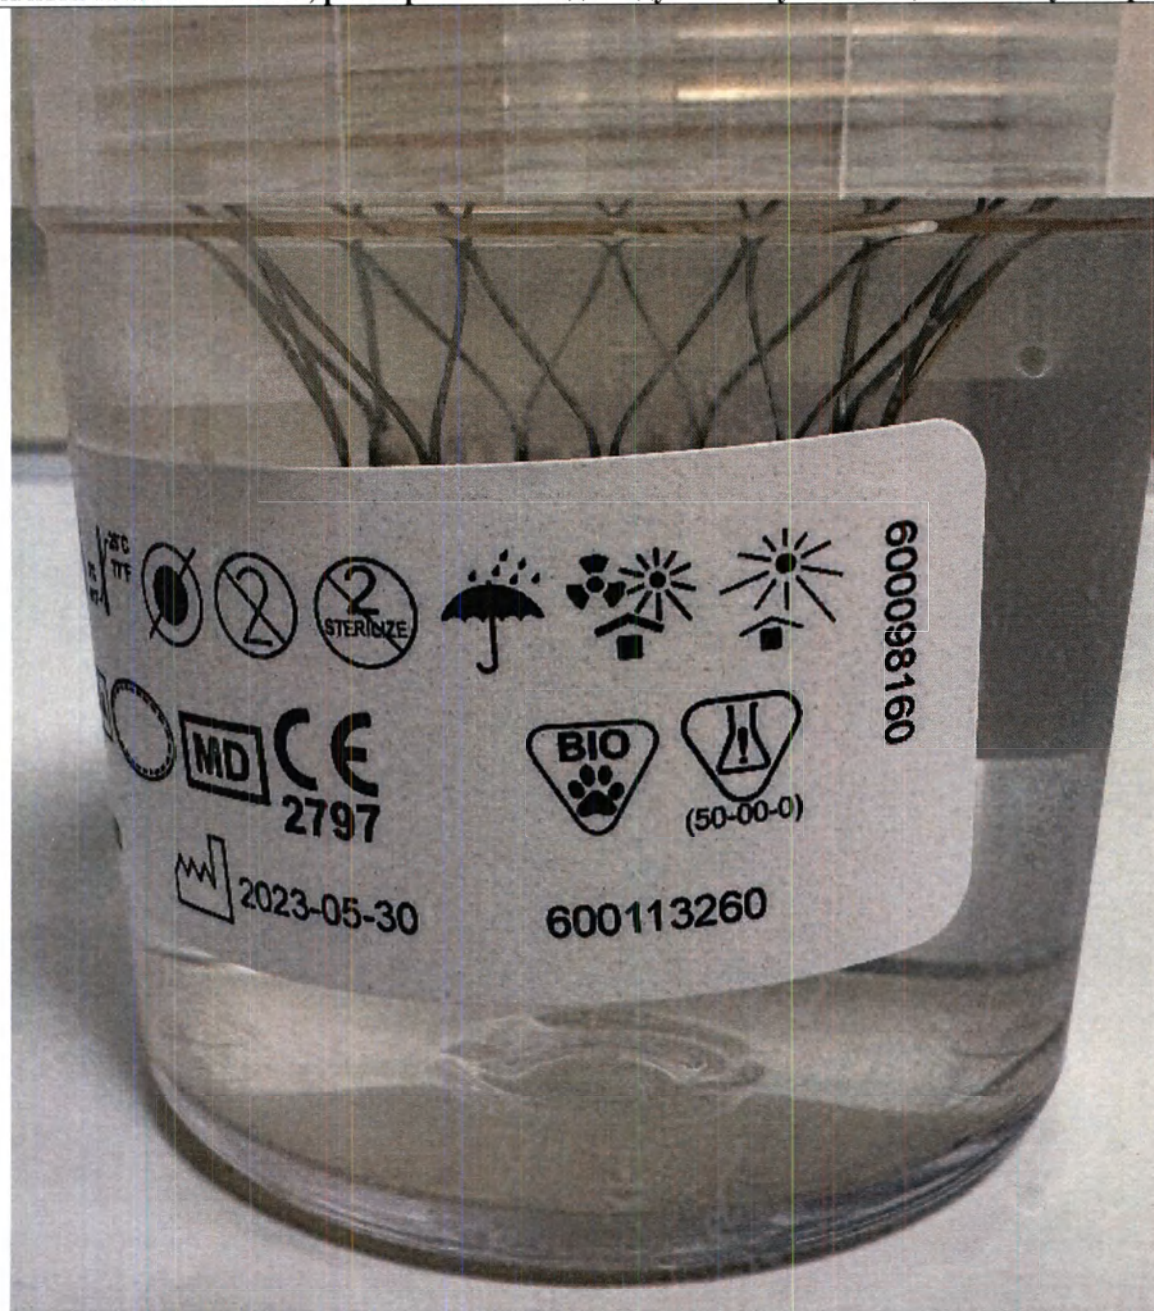




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.

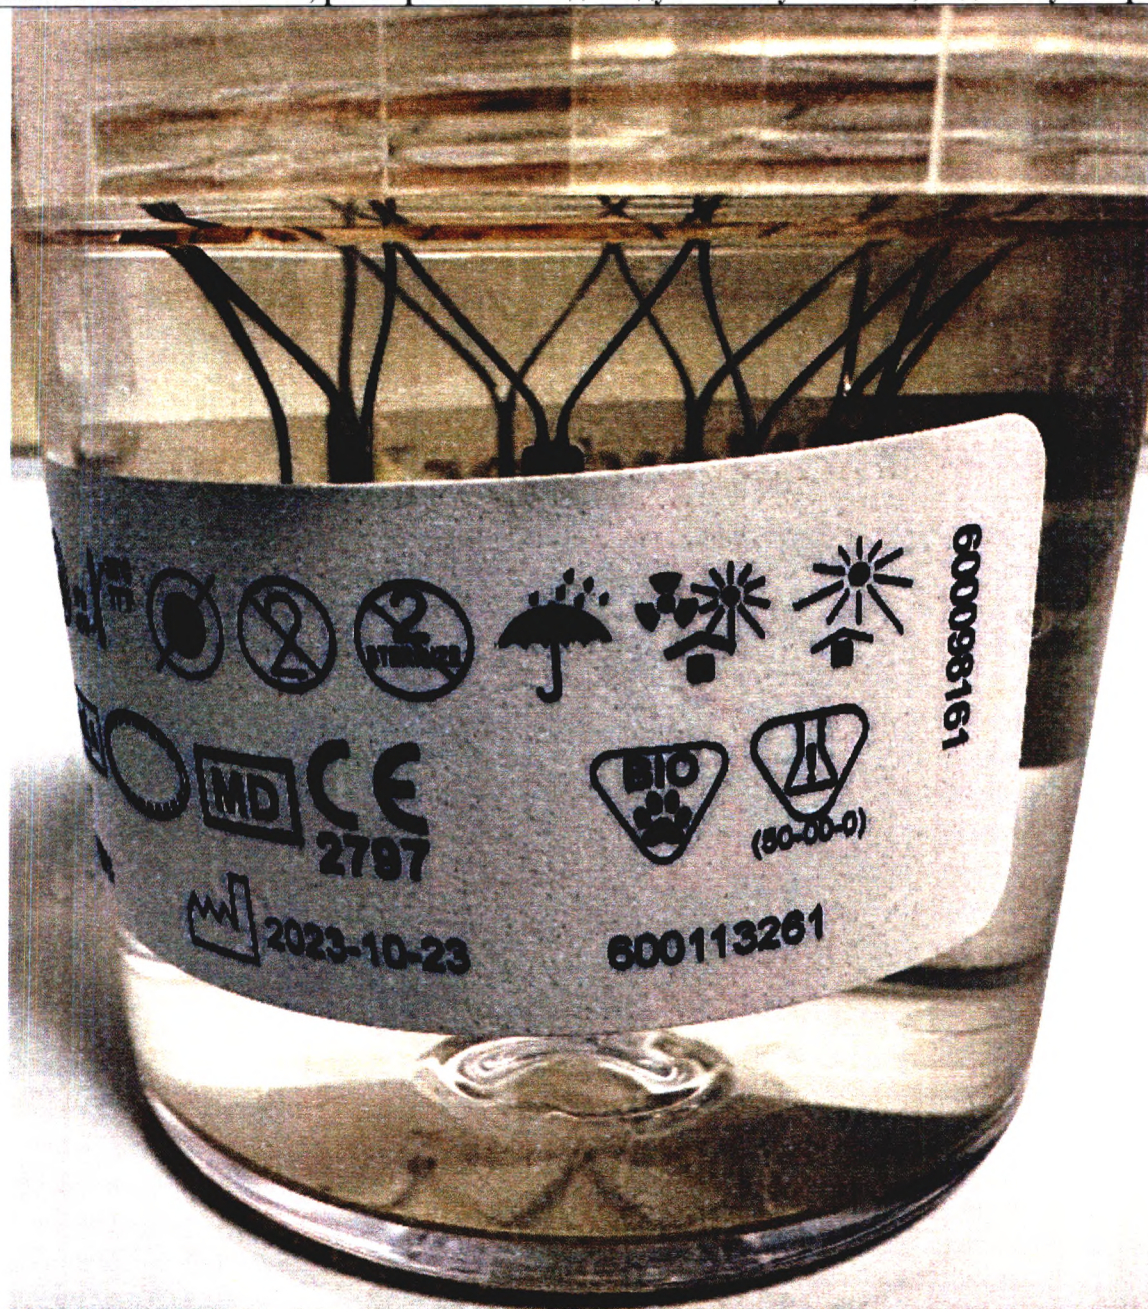




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.

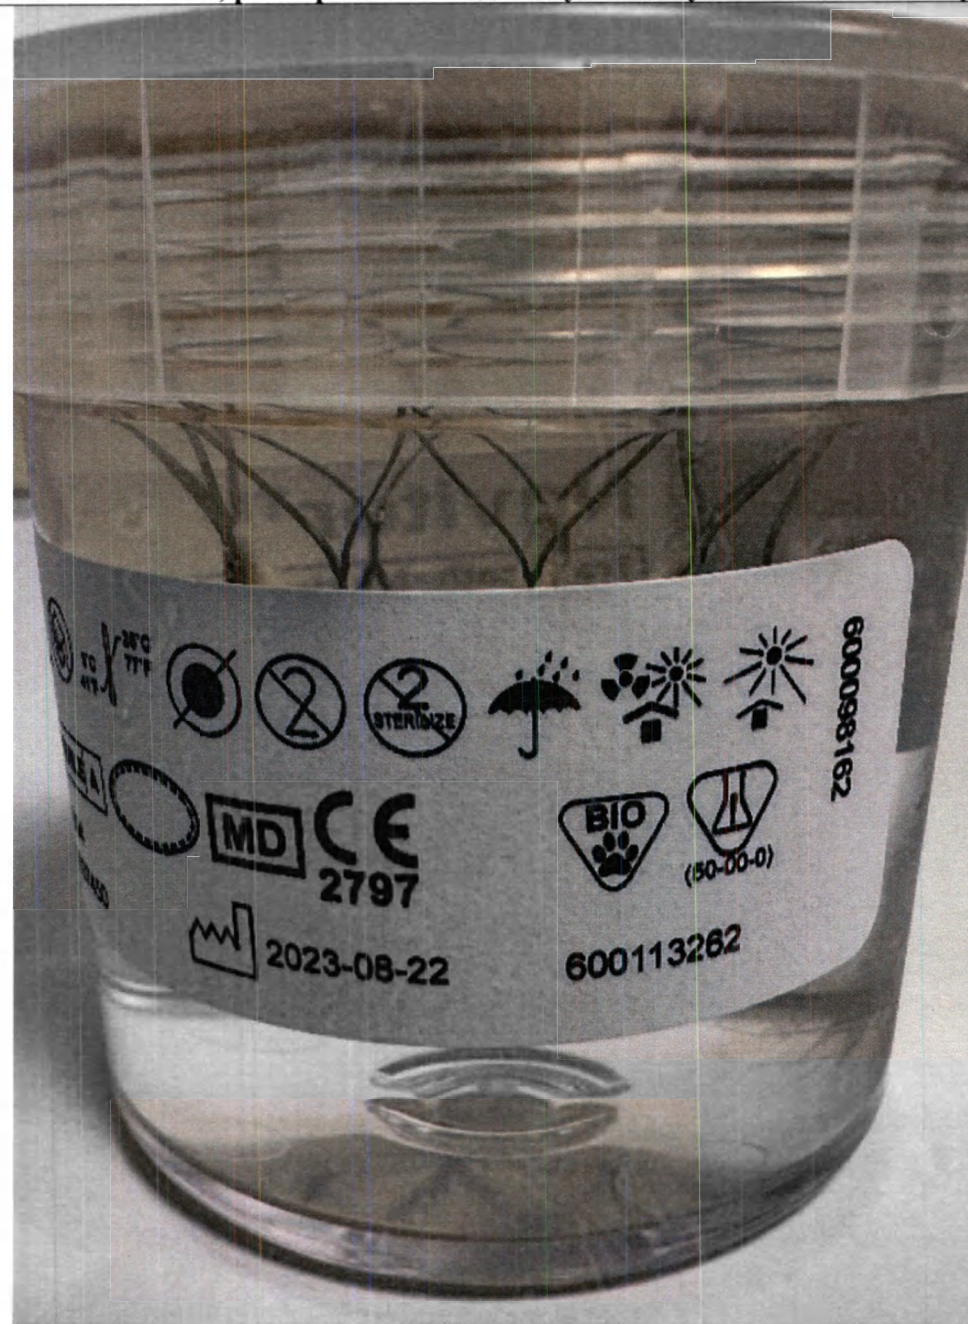




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм. Индивидуальная упаковка, вид сбоку. Маркировка.

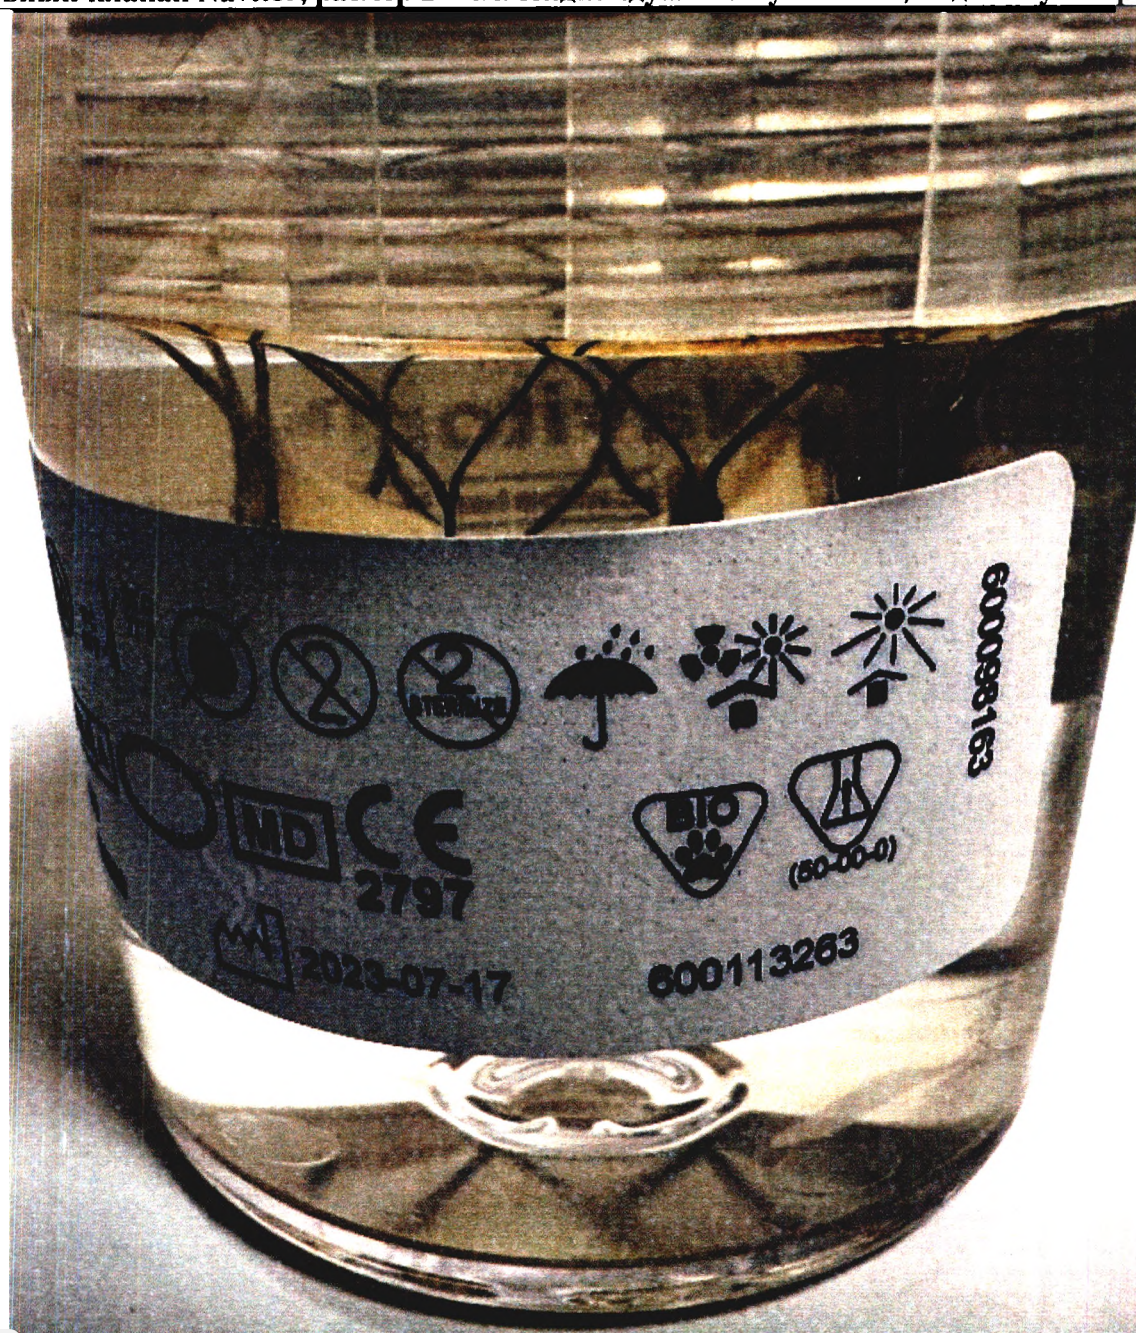



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм. Индивидуальная упаковка, вид сверху. Маркировка.

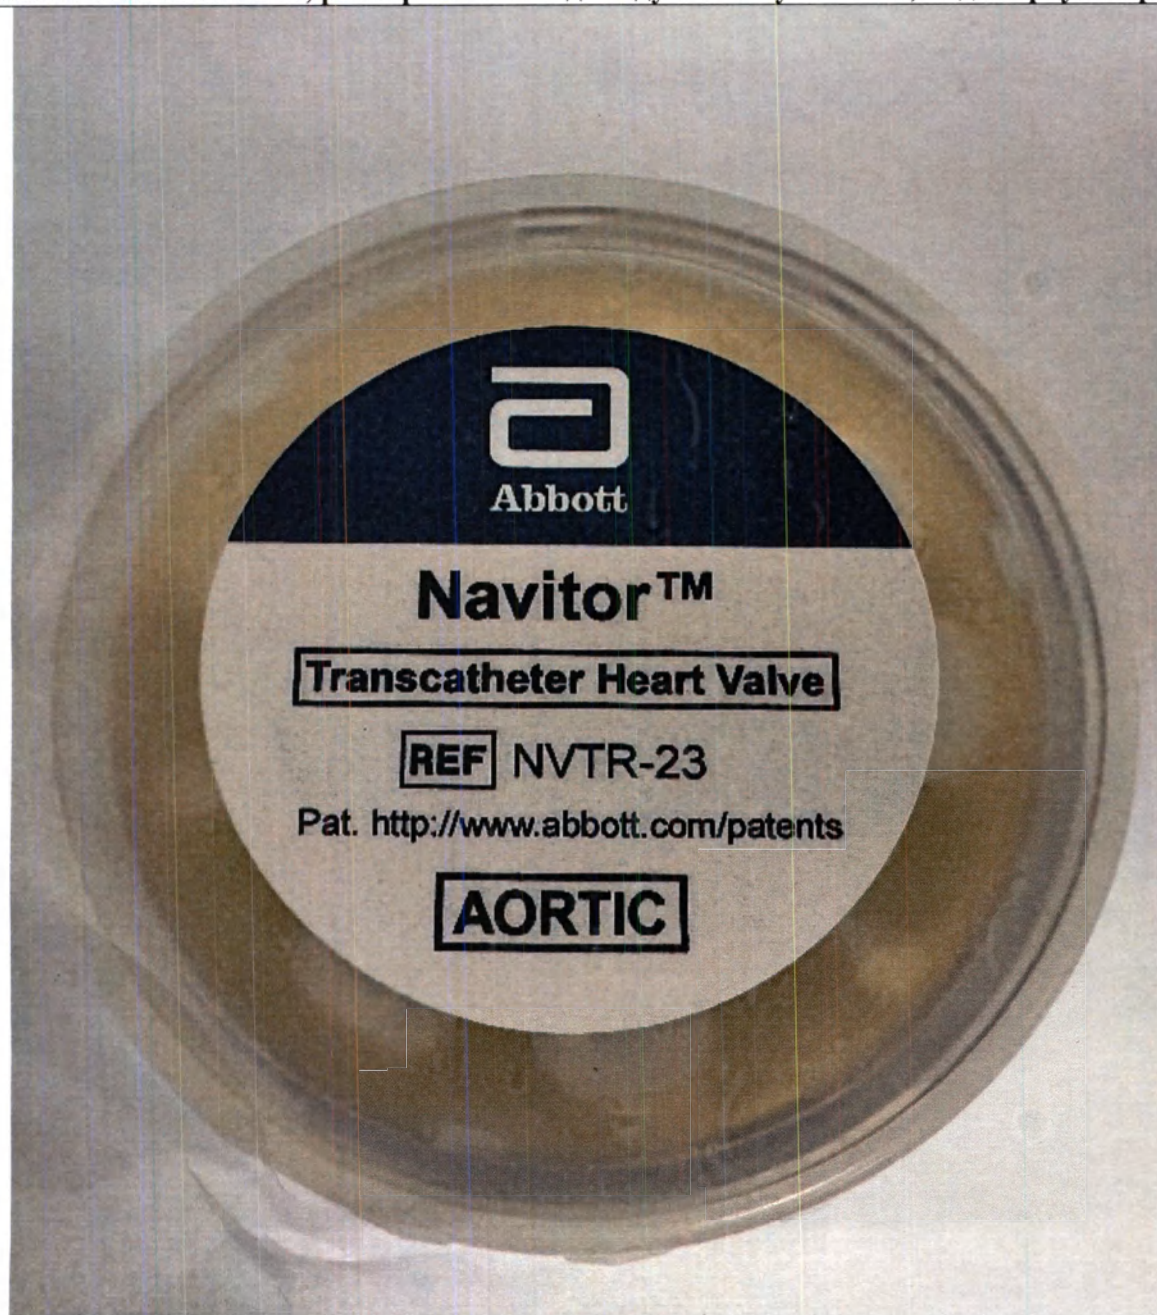



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм. Индивидуальная упаковка, вид сверху. Маркировка.





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм. Индивидуальная упаковка, вид сверху. Маркировка.







Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм. Индивидуальная упаковка, вид сверху. Маркировка.






Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм. Комплектация.

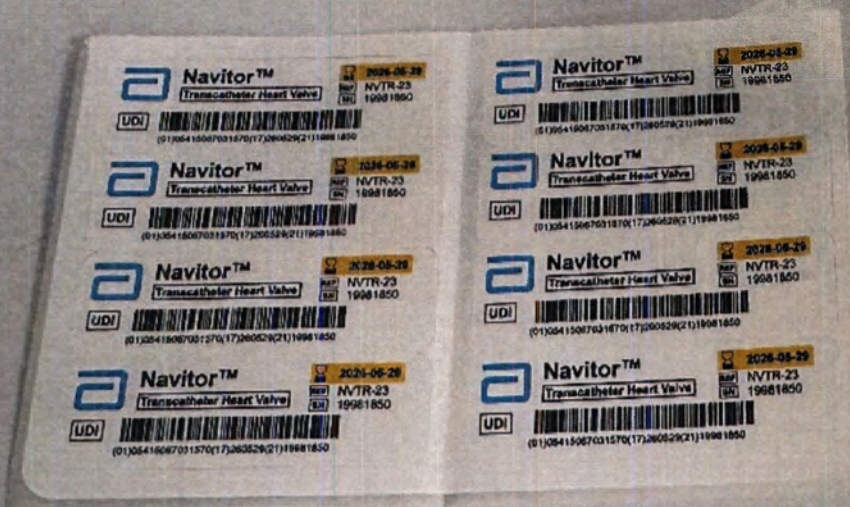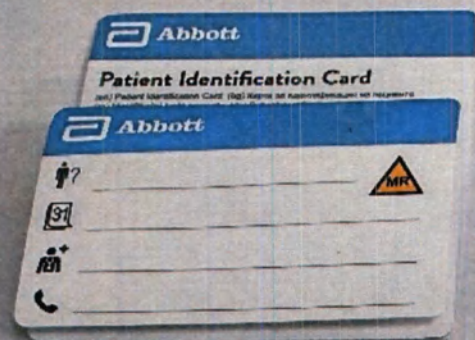




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм. Комплектация.

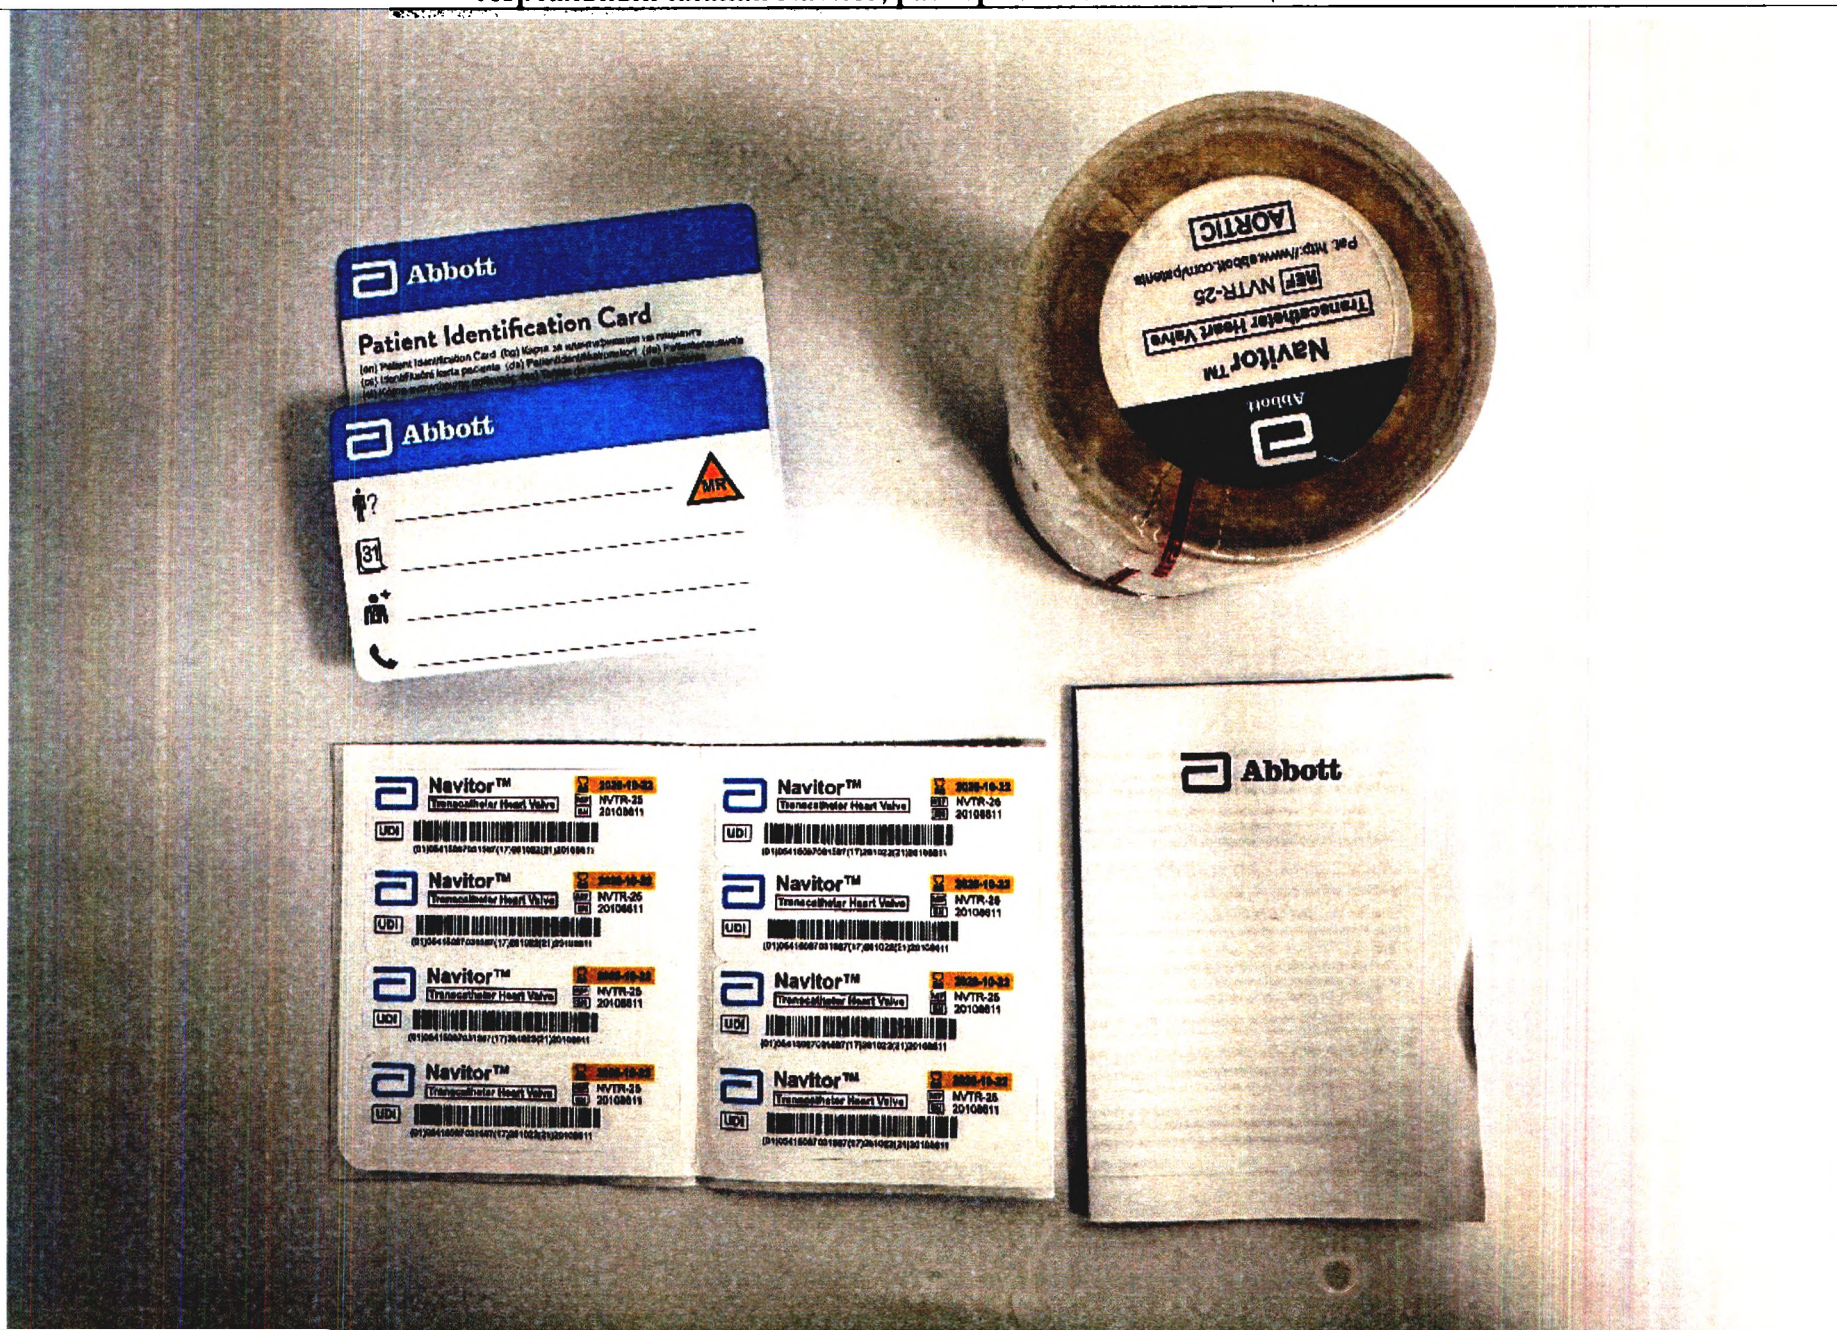



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм. Комплектация.

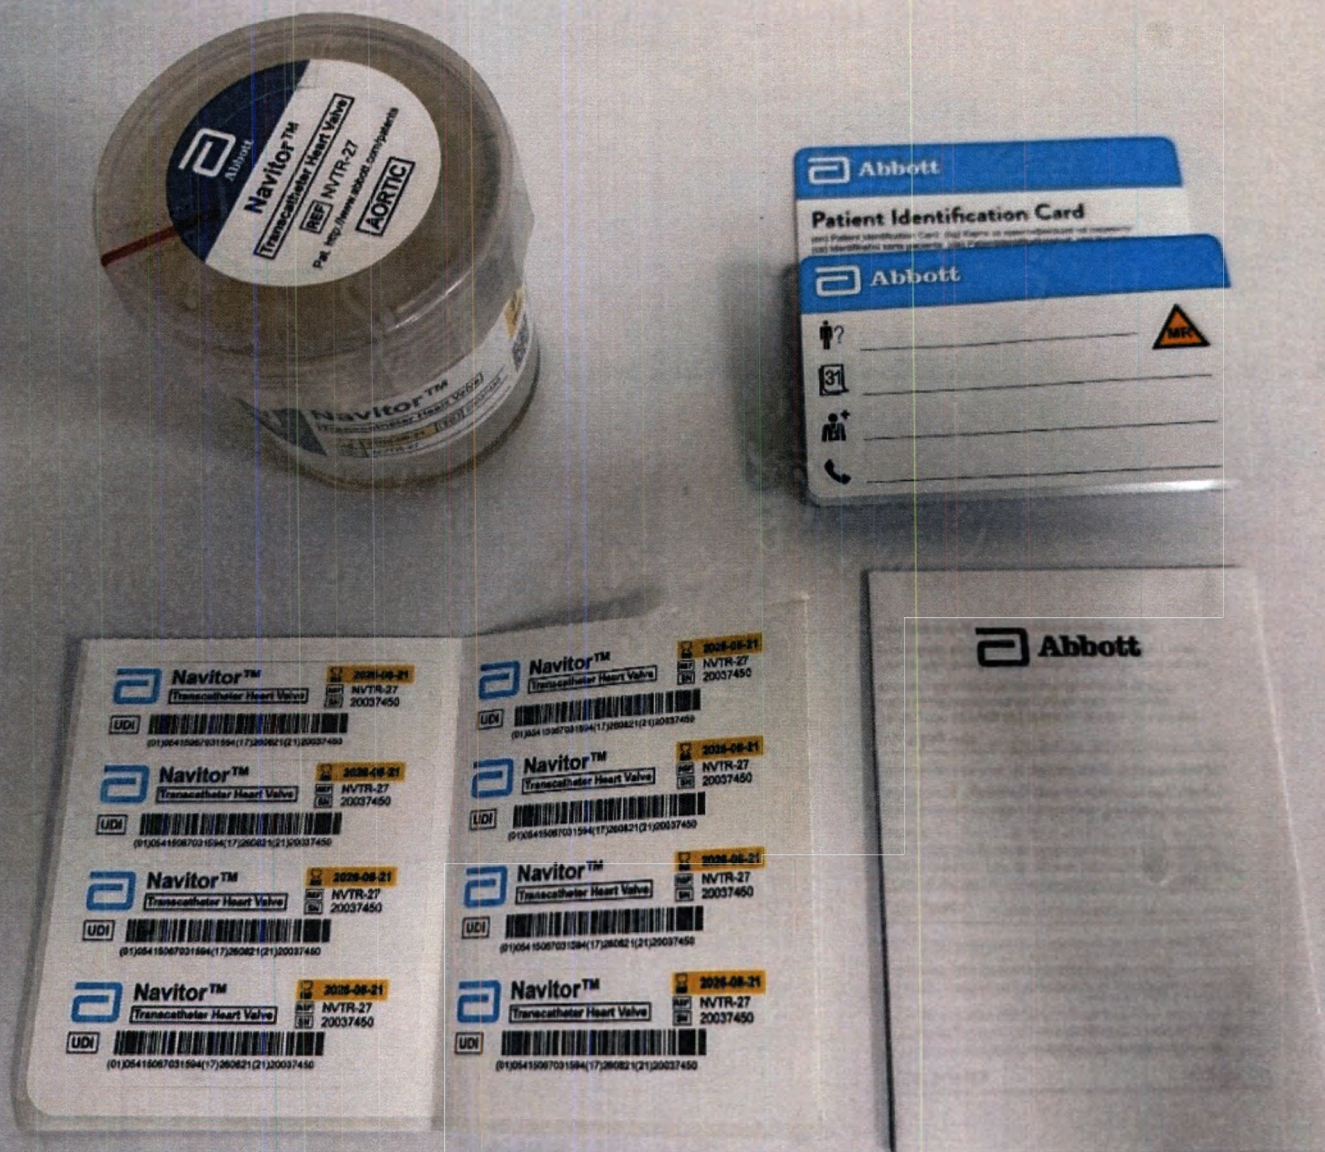




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм. Комплектация.





**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка.**

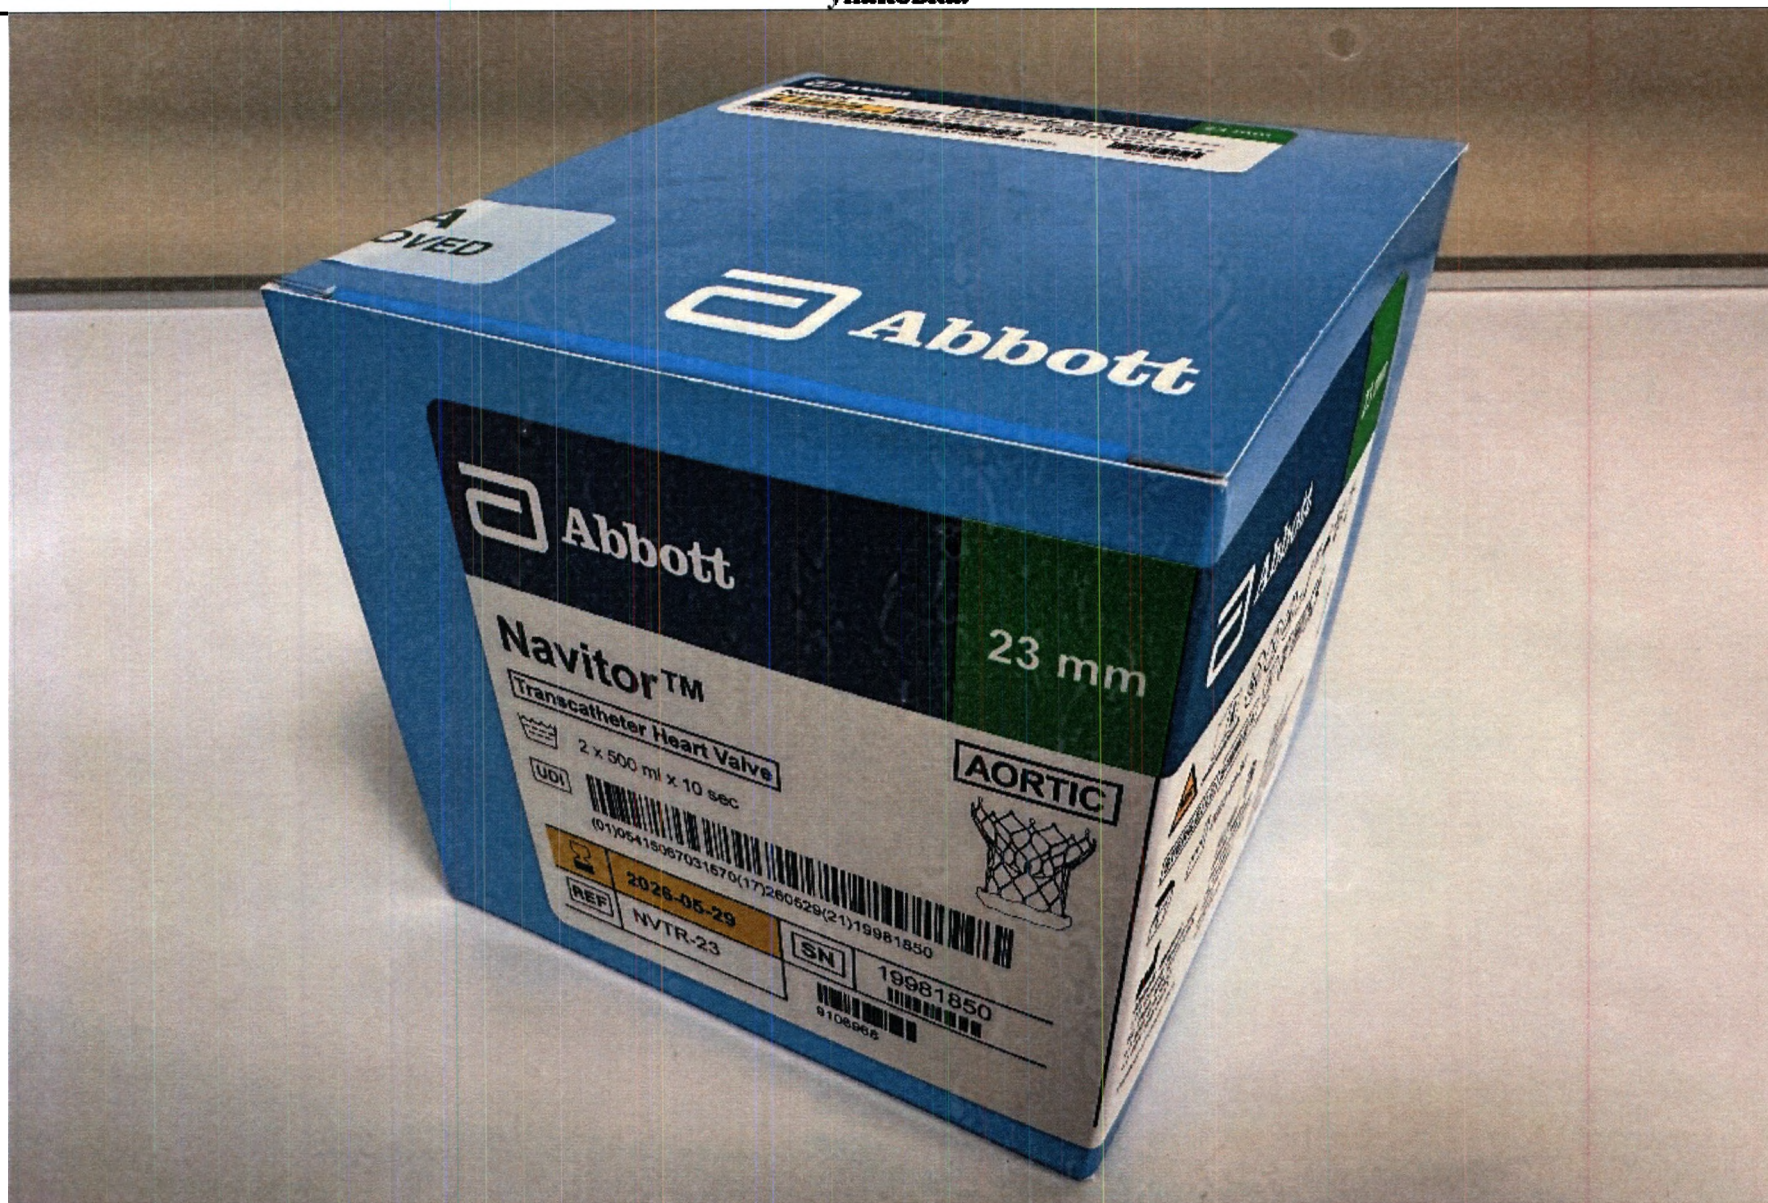



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка.





**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.**  
**Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка.**






Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка.






Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская  
упаковка, вид спереди. Маркировка

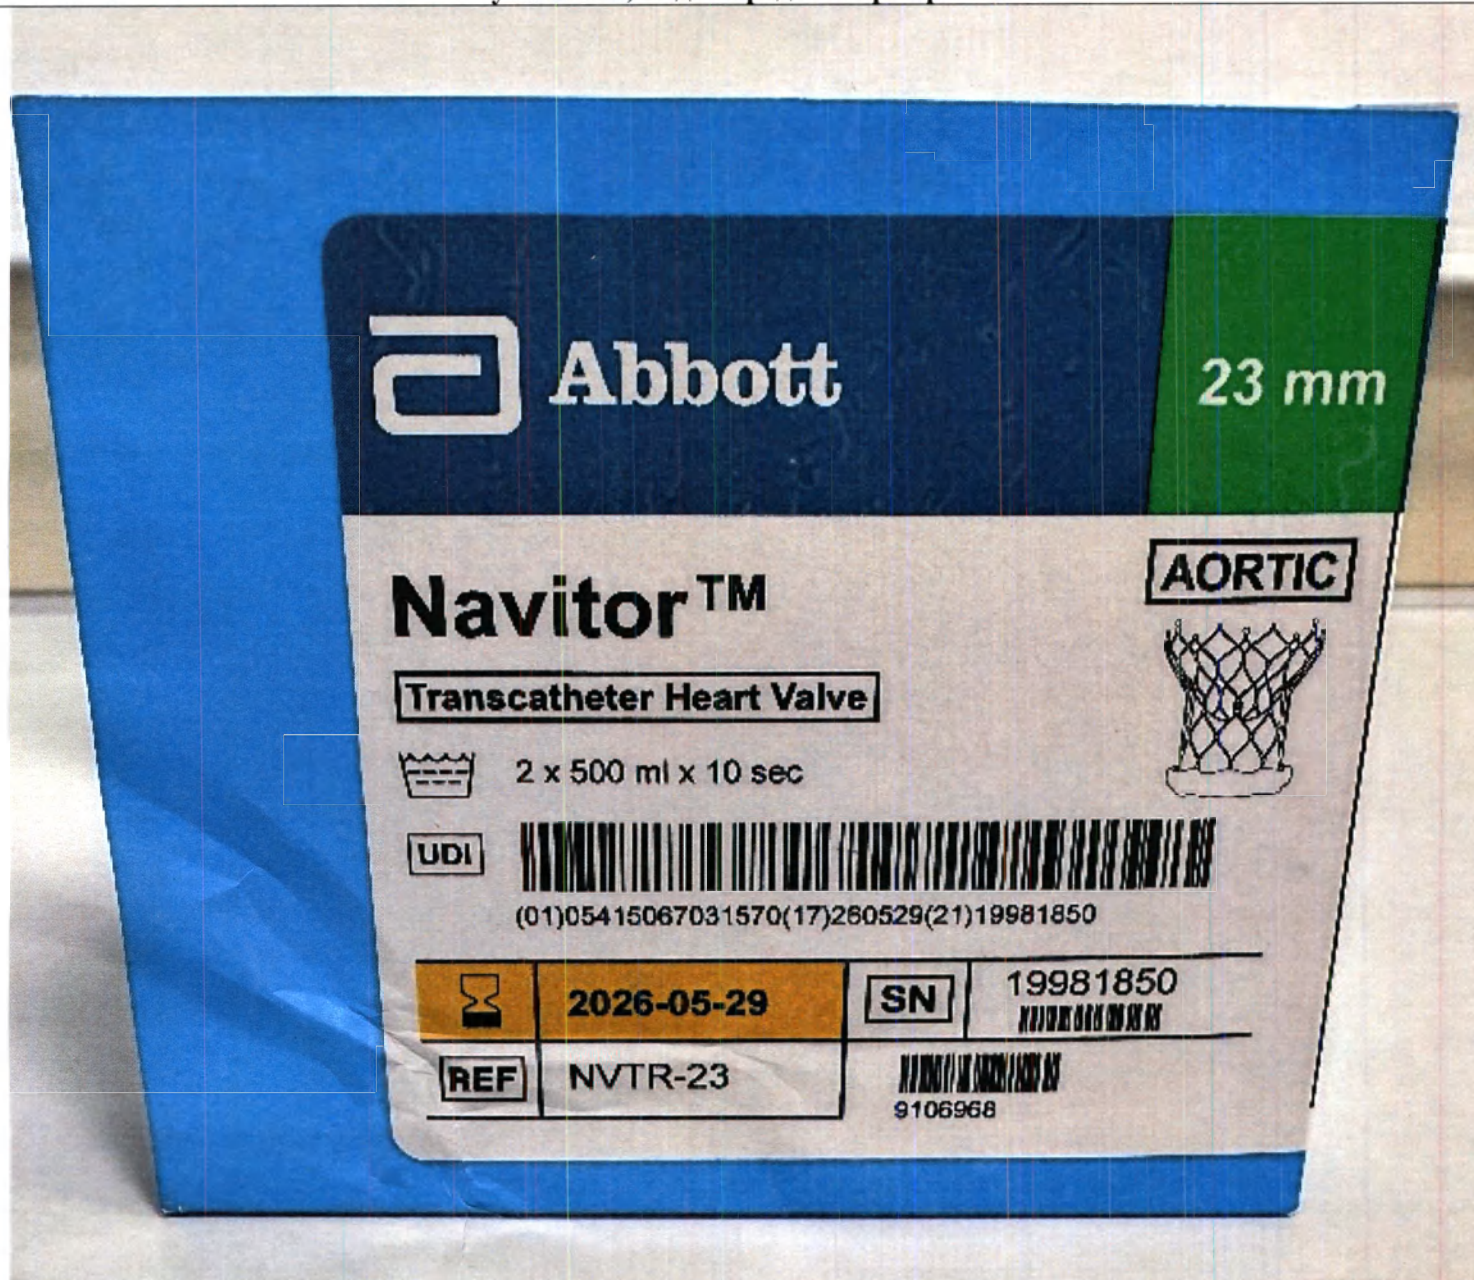




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид спереди. Маркировка

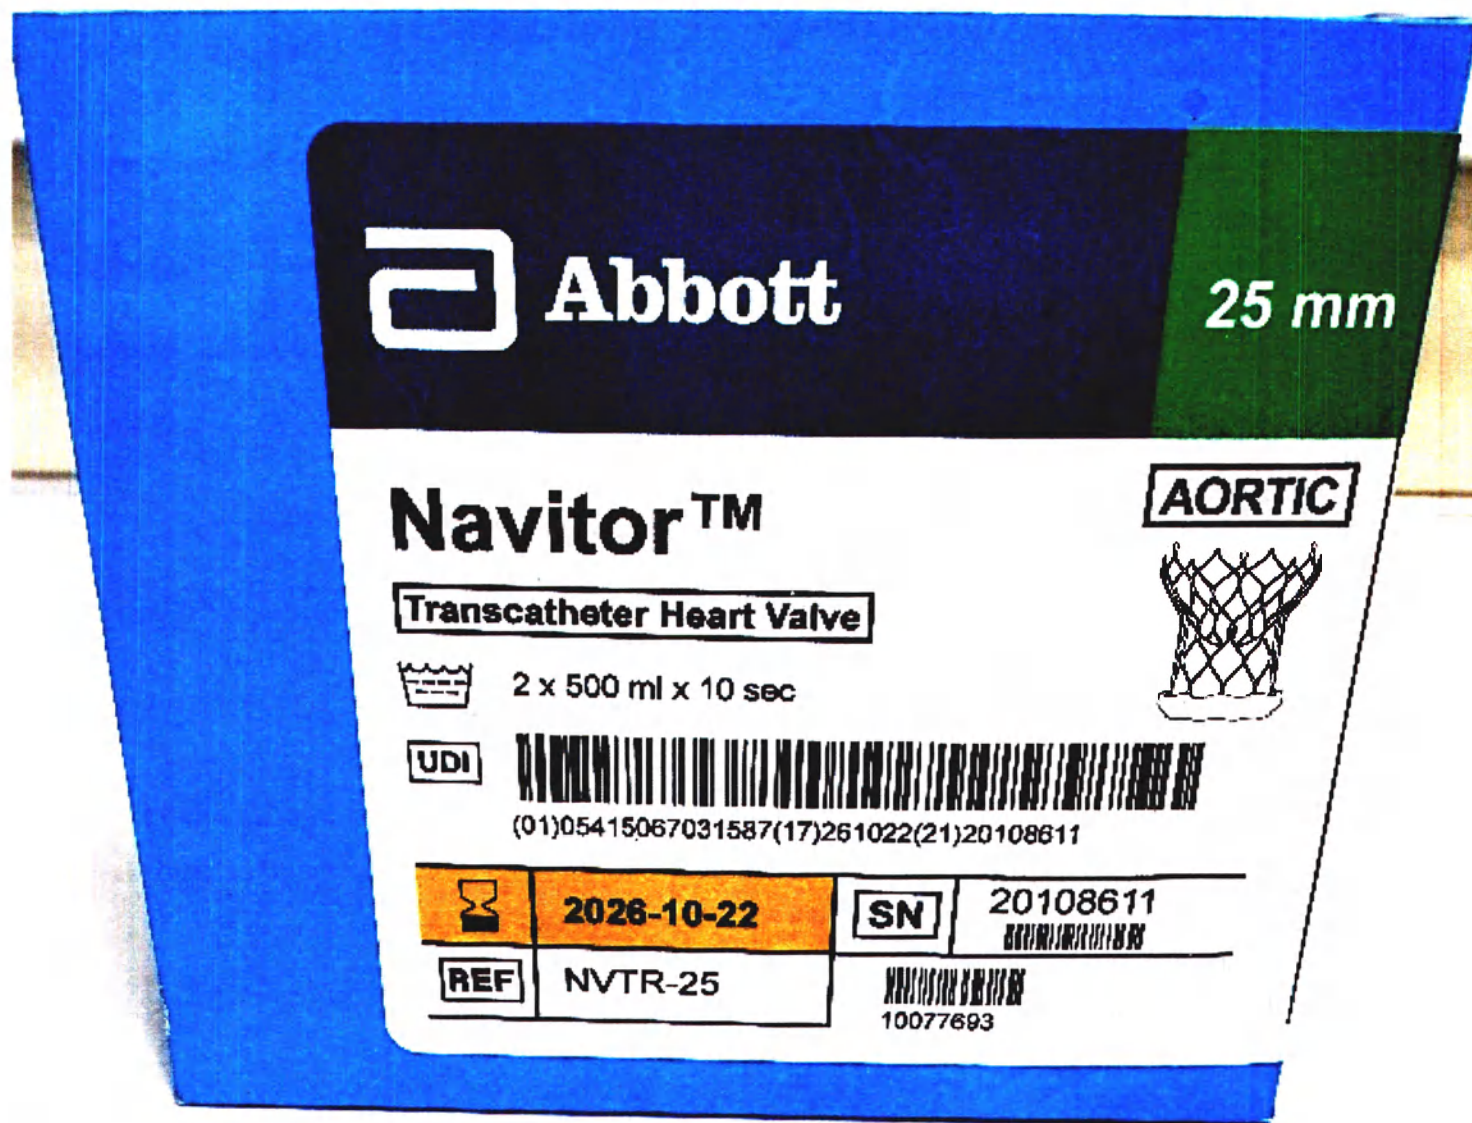




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид спереди. Маркировка

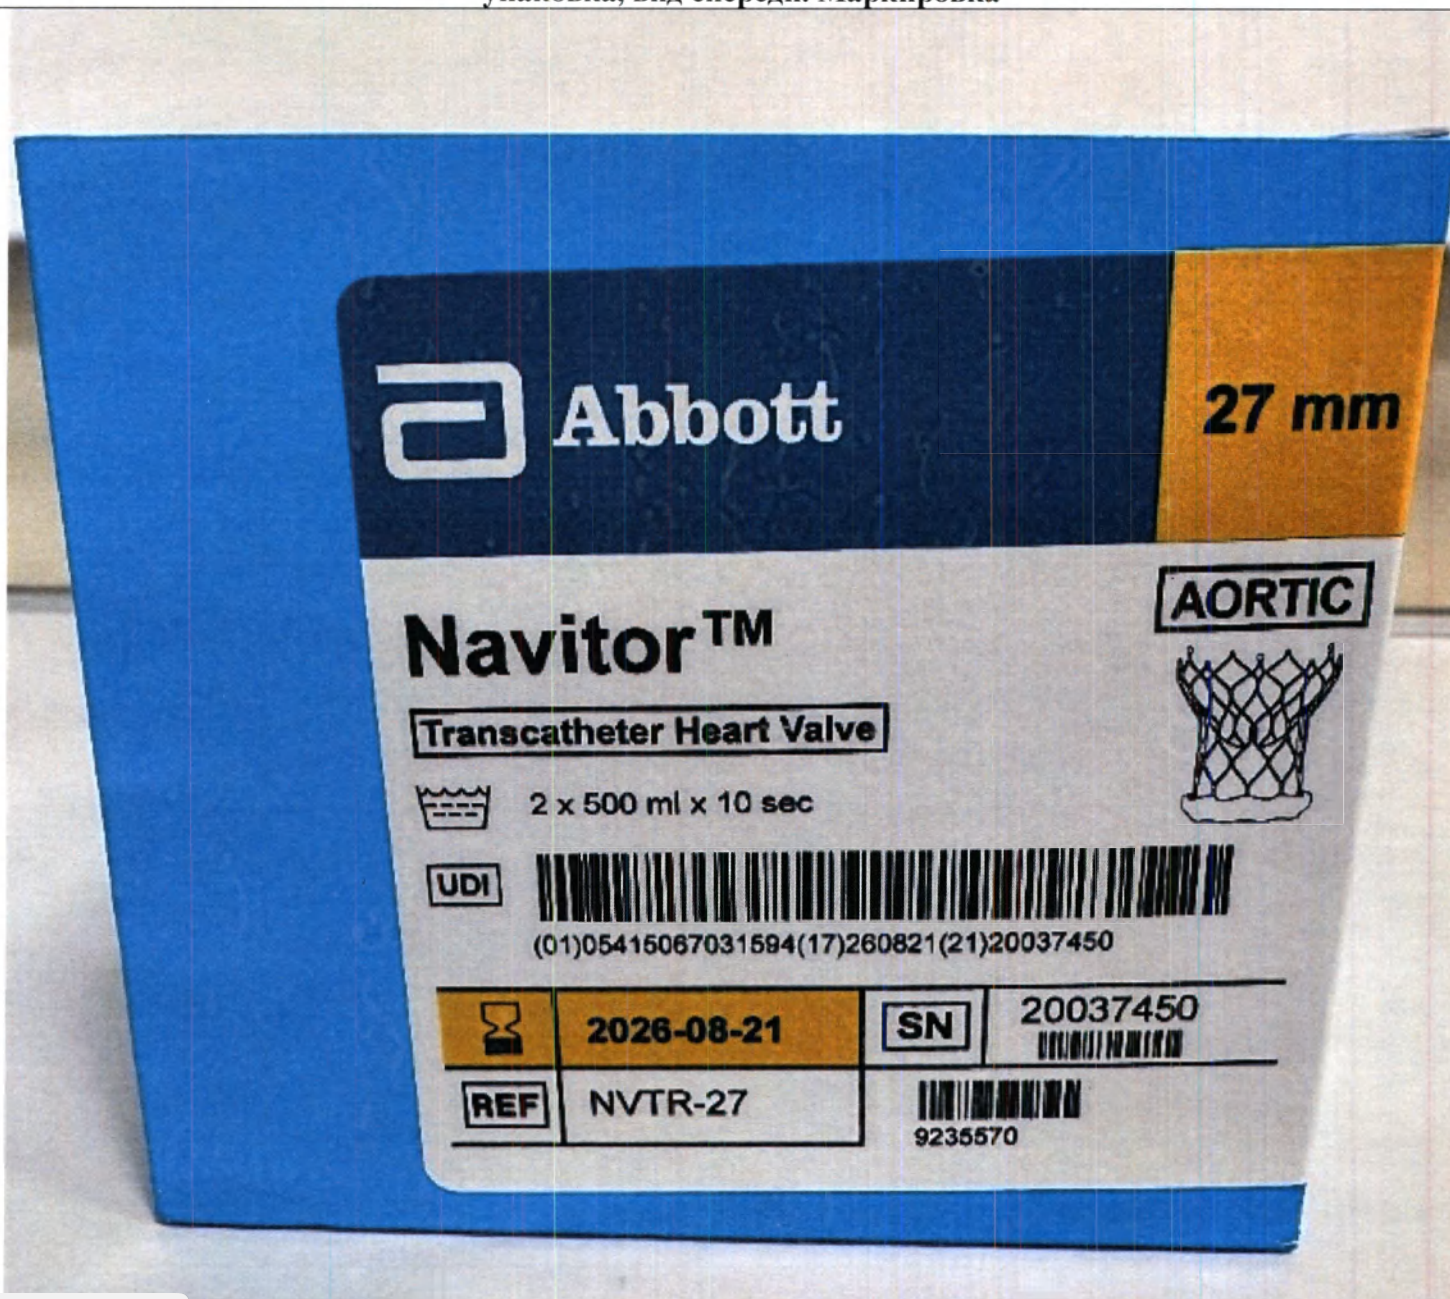



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид спереди. Маркировка

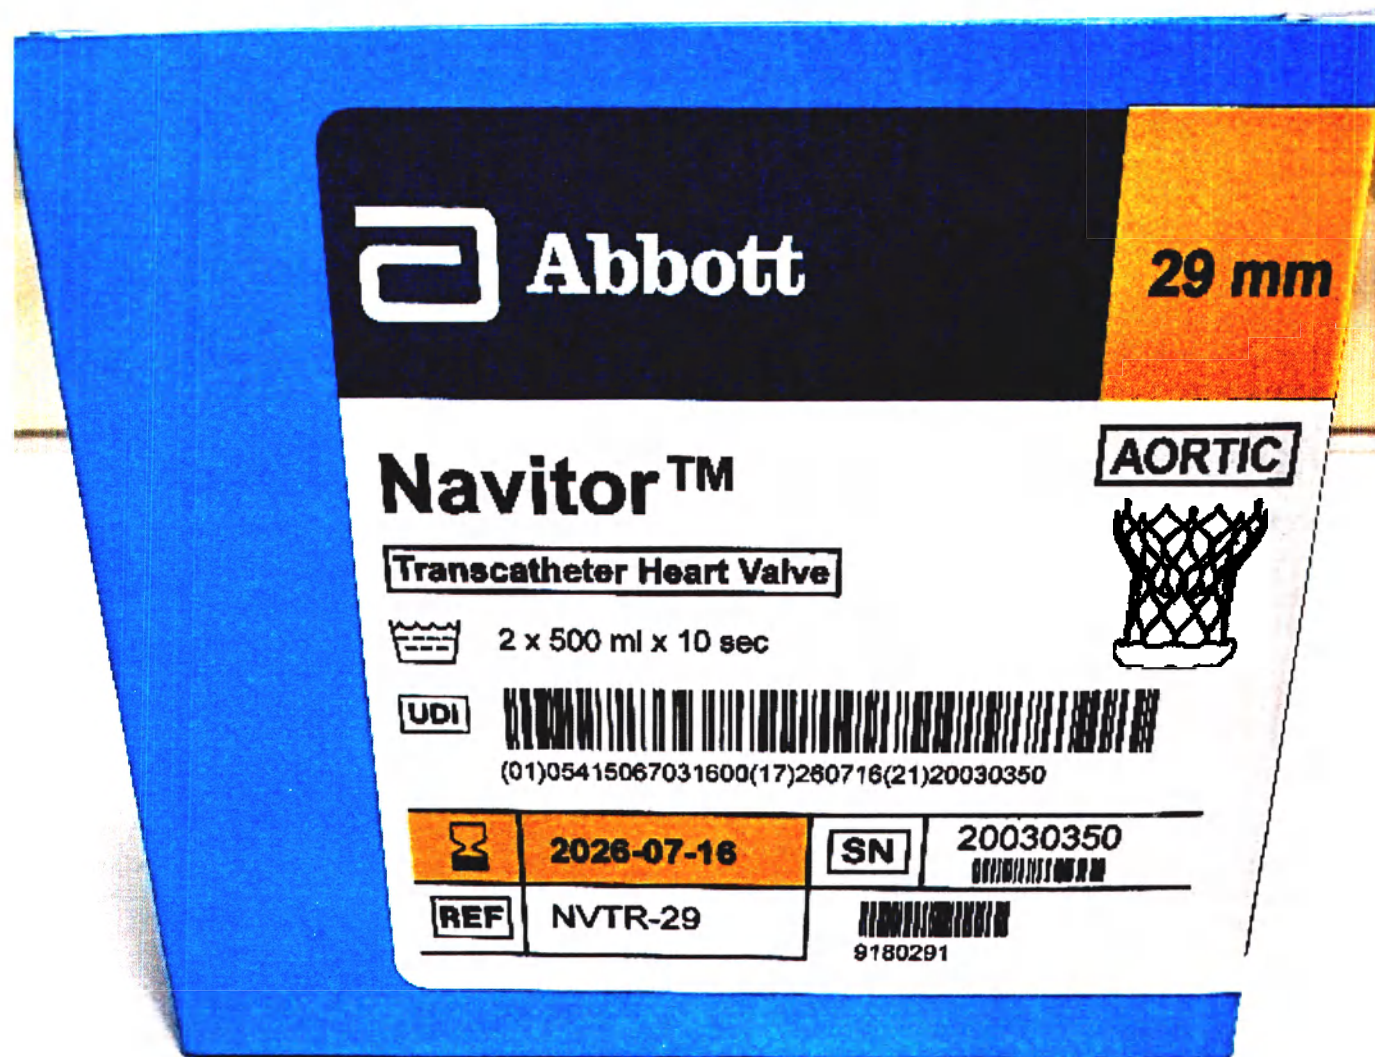




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид справа. Маркировка





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
 Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская  
 упаковка, вид справа. Маркировка

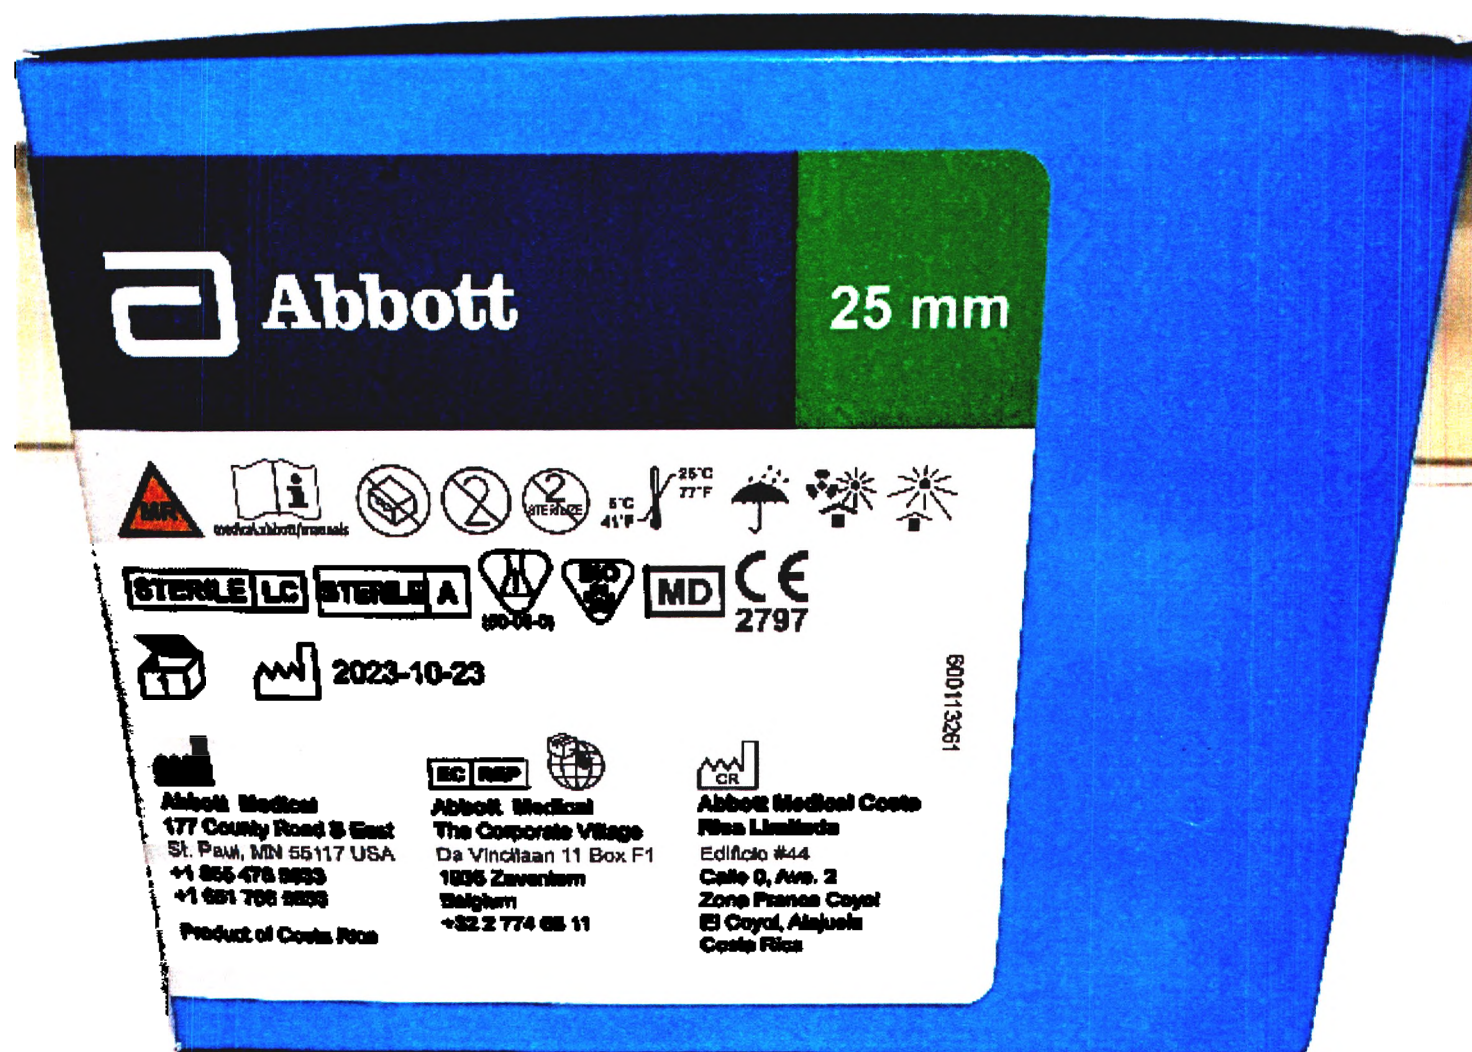



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид справа. Маркировка





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид справа. Маркировка





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид слева. Маркировка, индикаторы температуры.





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид слева. Маркировка, индикаторы температуры.





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид слева. Маркировка, индикаторы температуры.






Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид слева. Маркировка, индикаторы температуры.





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 23 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид сзади. Маркировка

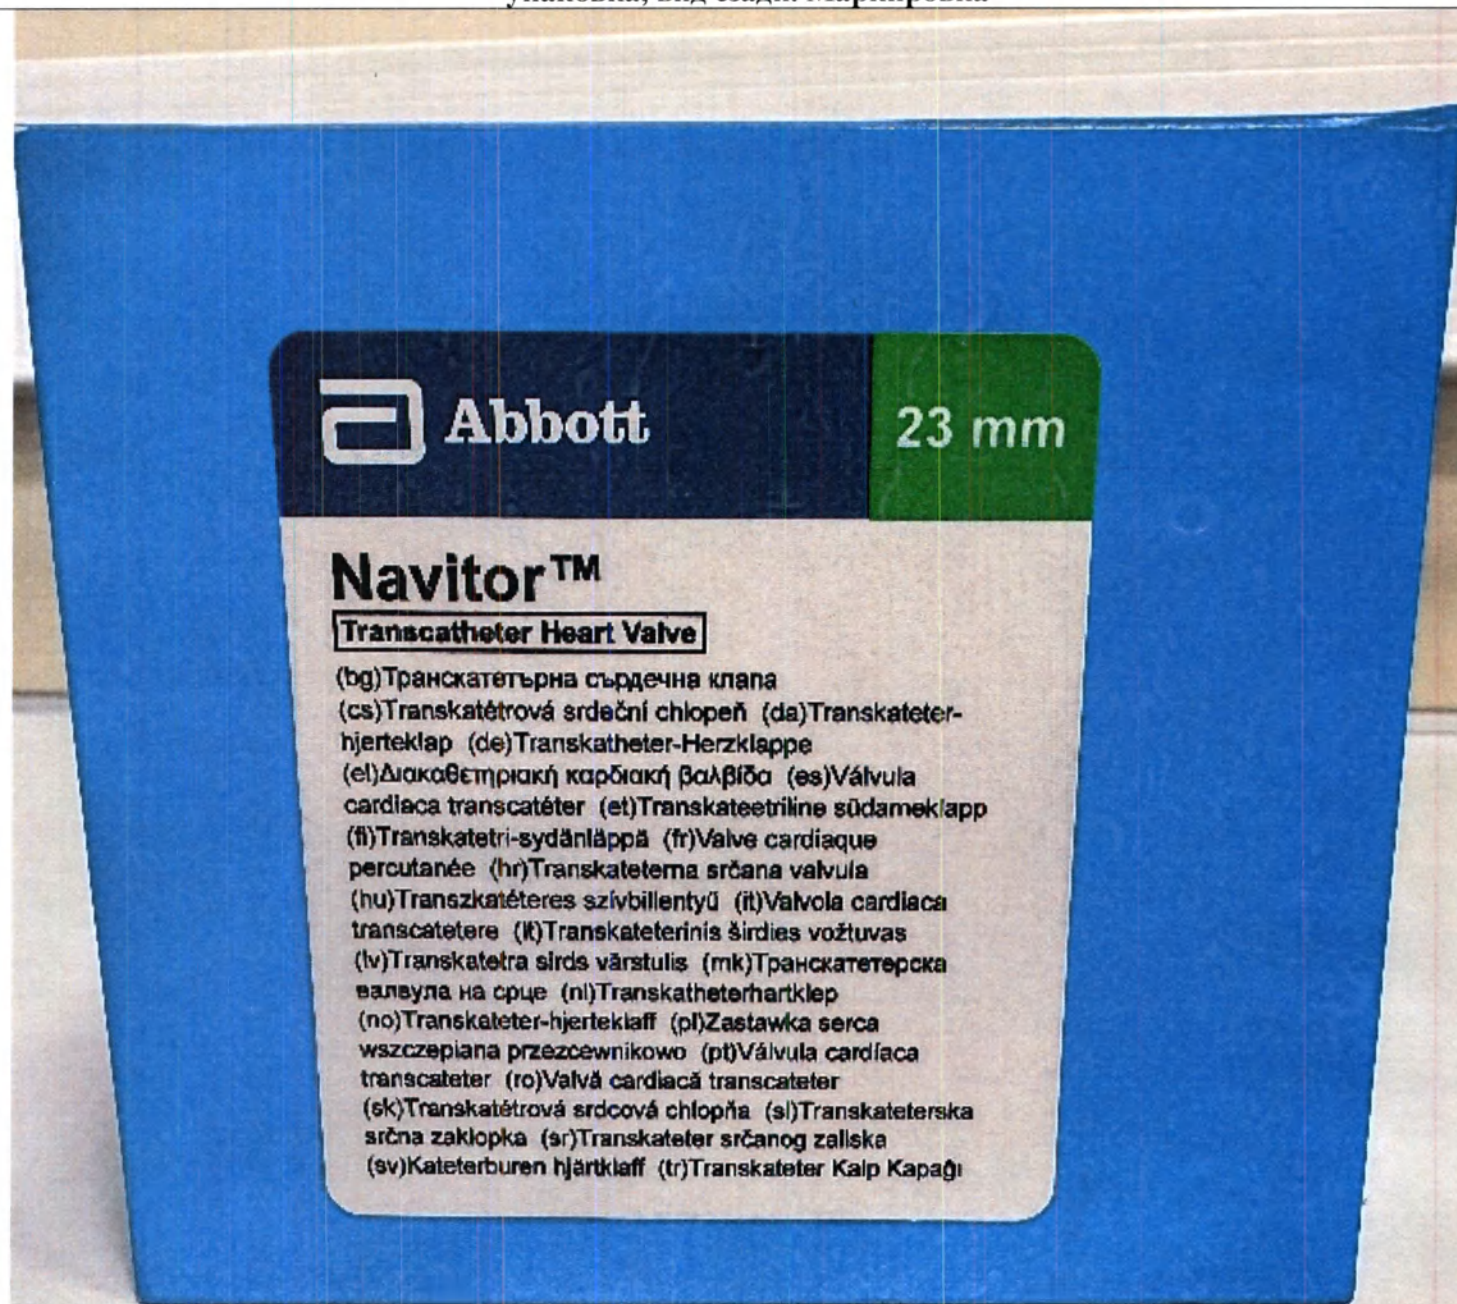



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 25 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская  
упаковка, вид сзади. Маркировка





# Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.

Аортальный клапан Navitor, размер 27 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид сзади. Маркировка






Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, размер 29 мм, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид сзади. Маркировка






Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Аортальный клапан Navitor, все размеры, в упаковке с двумя встроенными индикаторами температуры. Потребительская упаковка, вид сверху. Маркировка, локальный стикер.

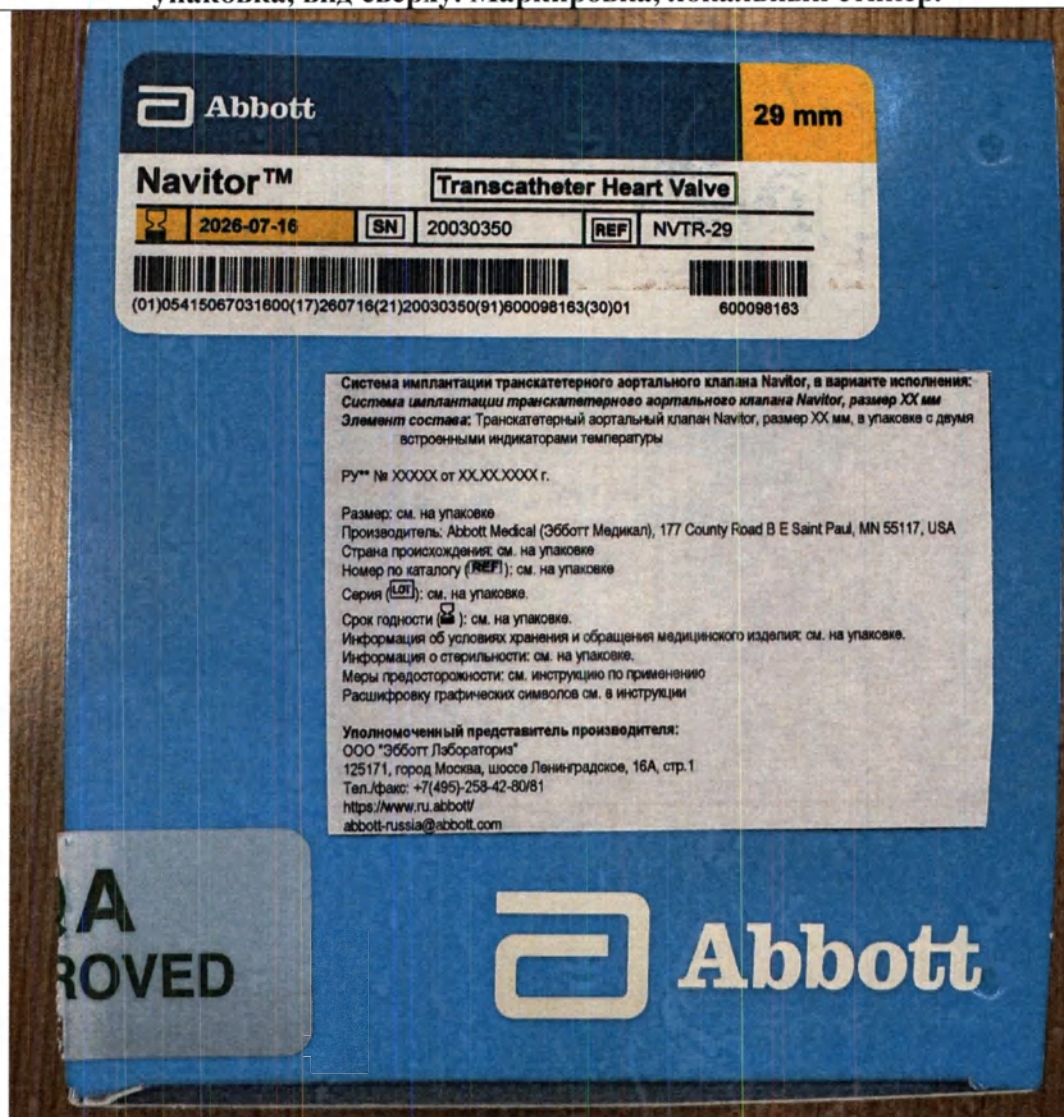




**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 18F.**

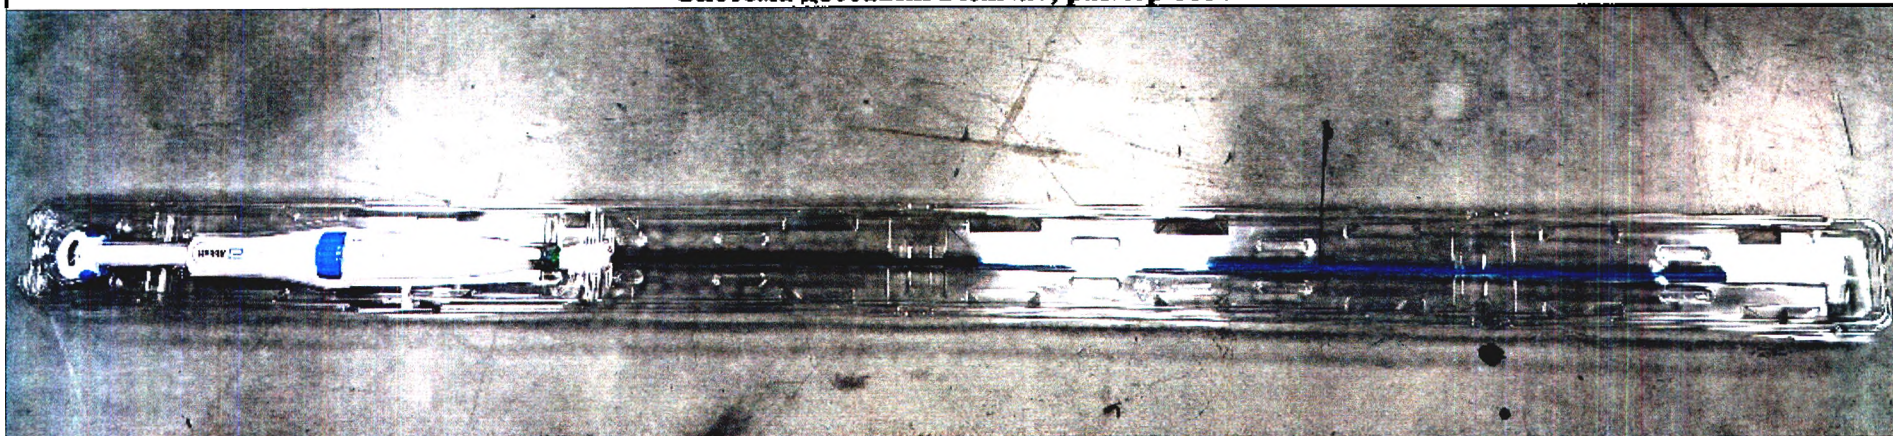




**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 19F.**

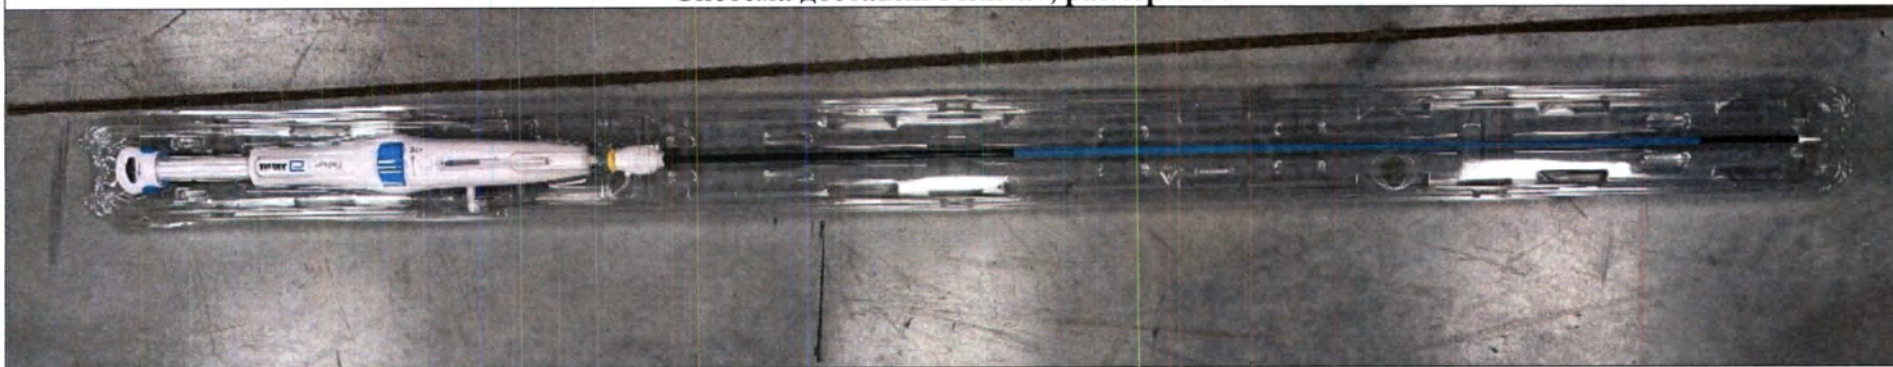




**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 18F. Рукоятка**

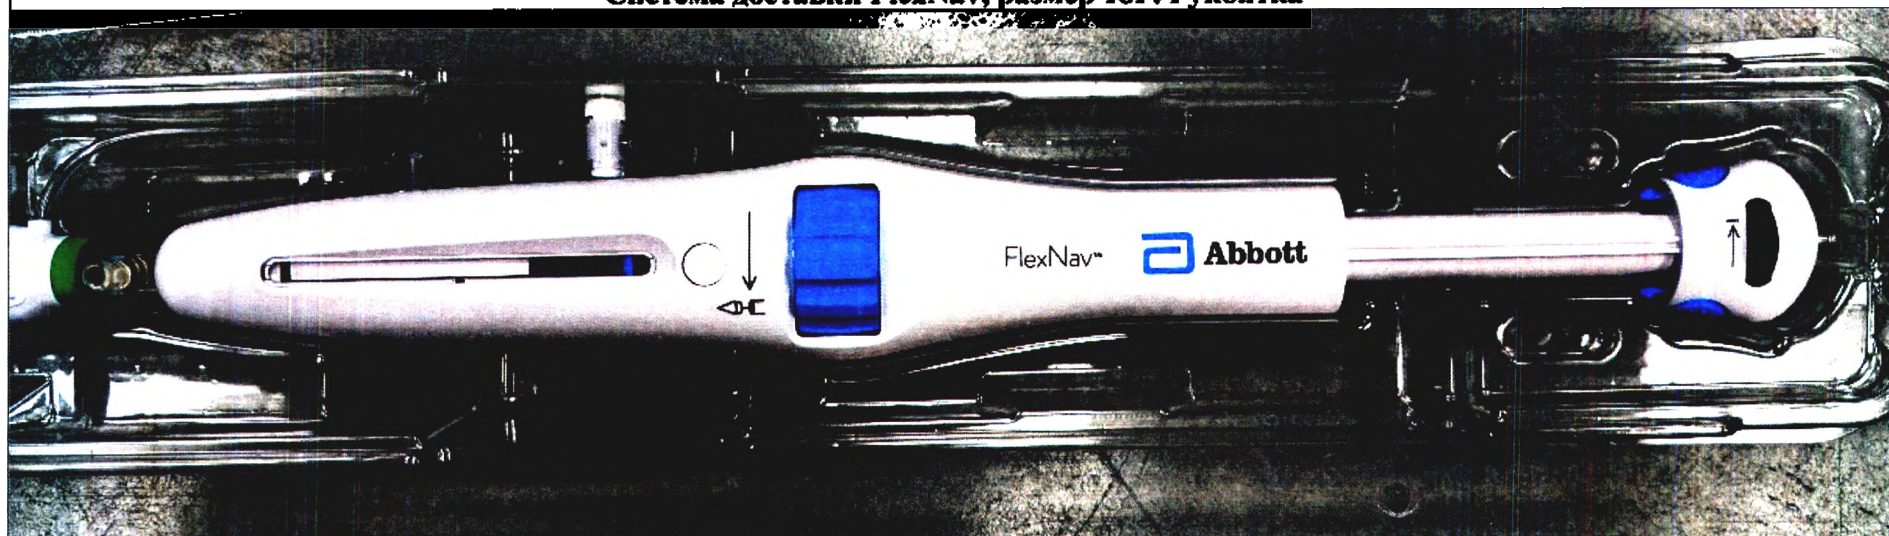



**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 19F. Рукоятка**

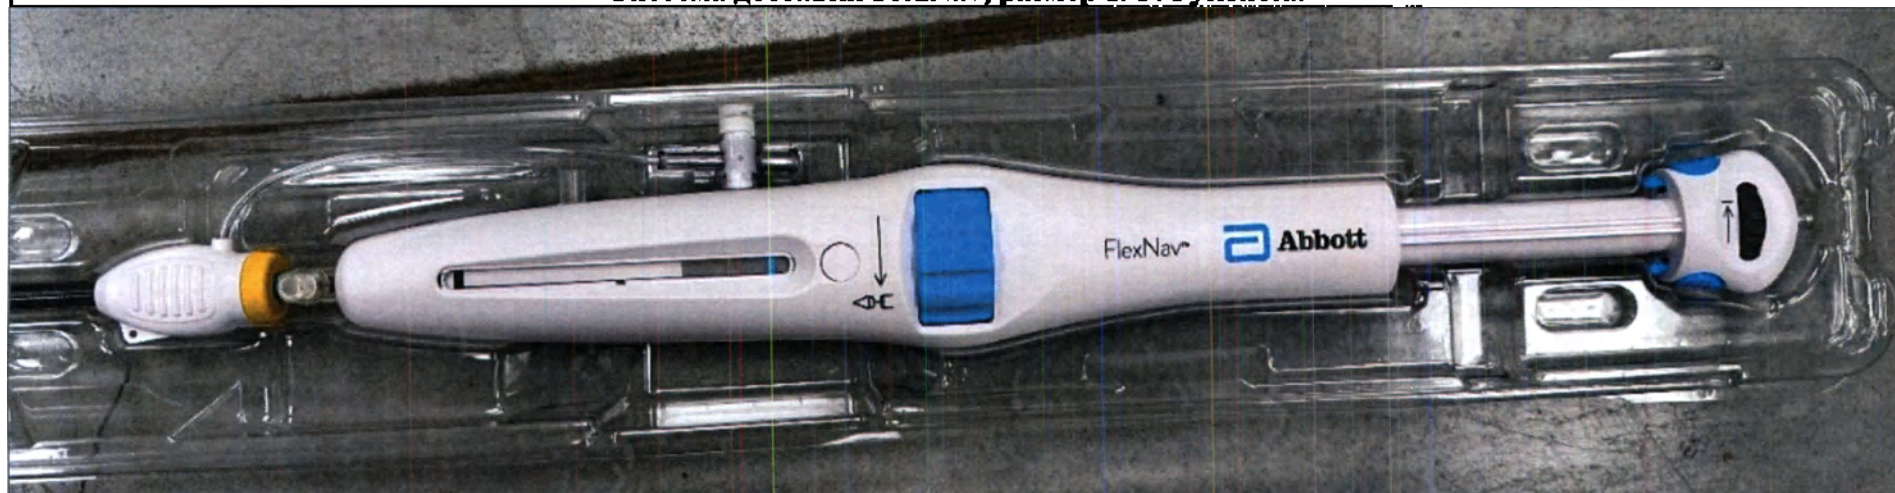




**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 18F. Дистальный конец, рентгерконтрастный кончик размер 18F.**






**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.**  
**Система доставки FlexNav, размер 19F. Дистальный конец, рентгерконтрастный кончик размер 19F.**

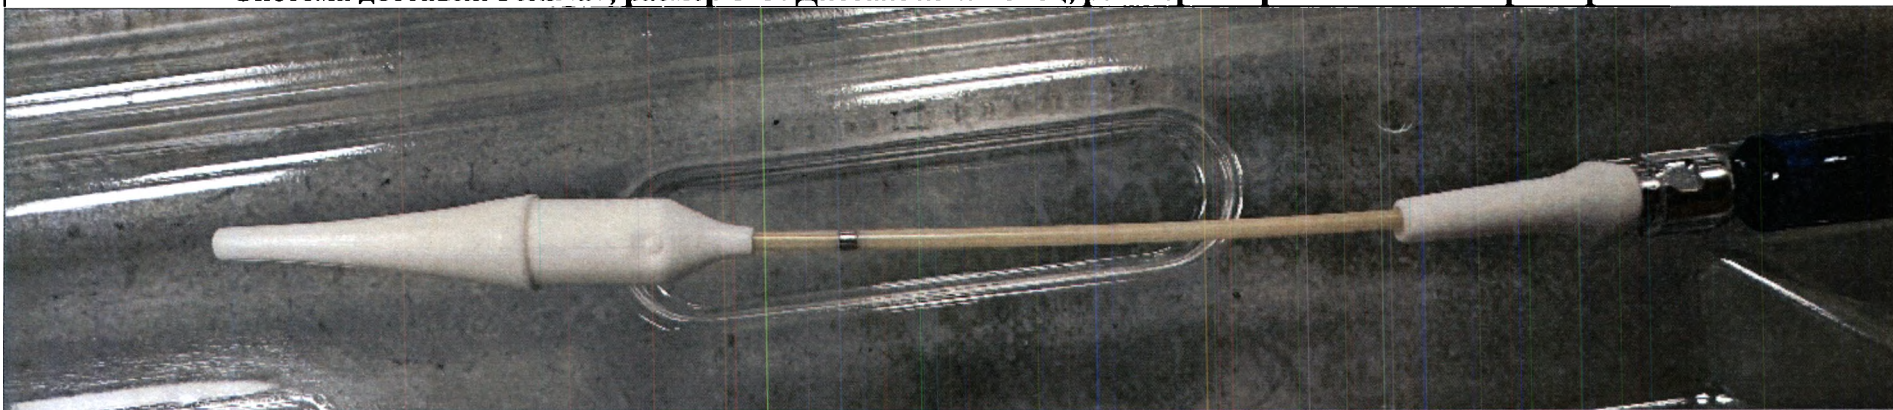




**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 18F. Индивидуальная упаковка.**

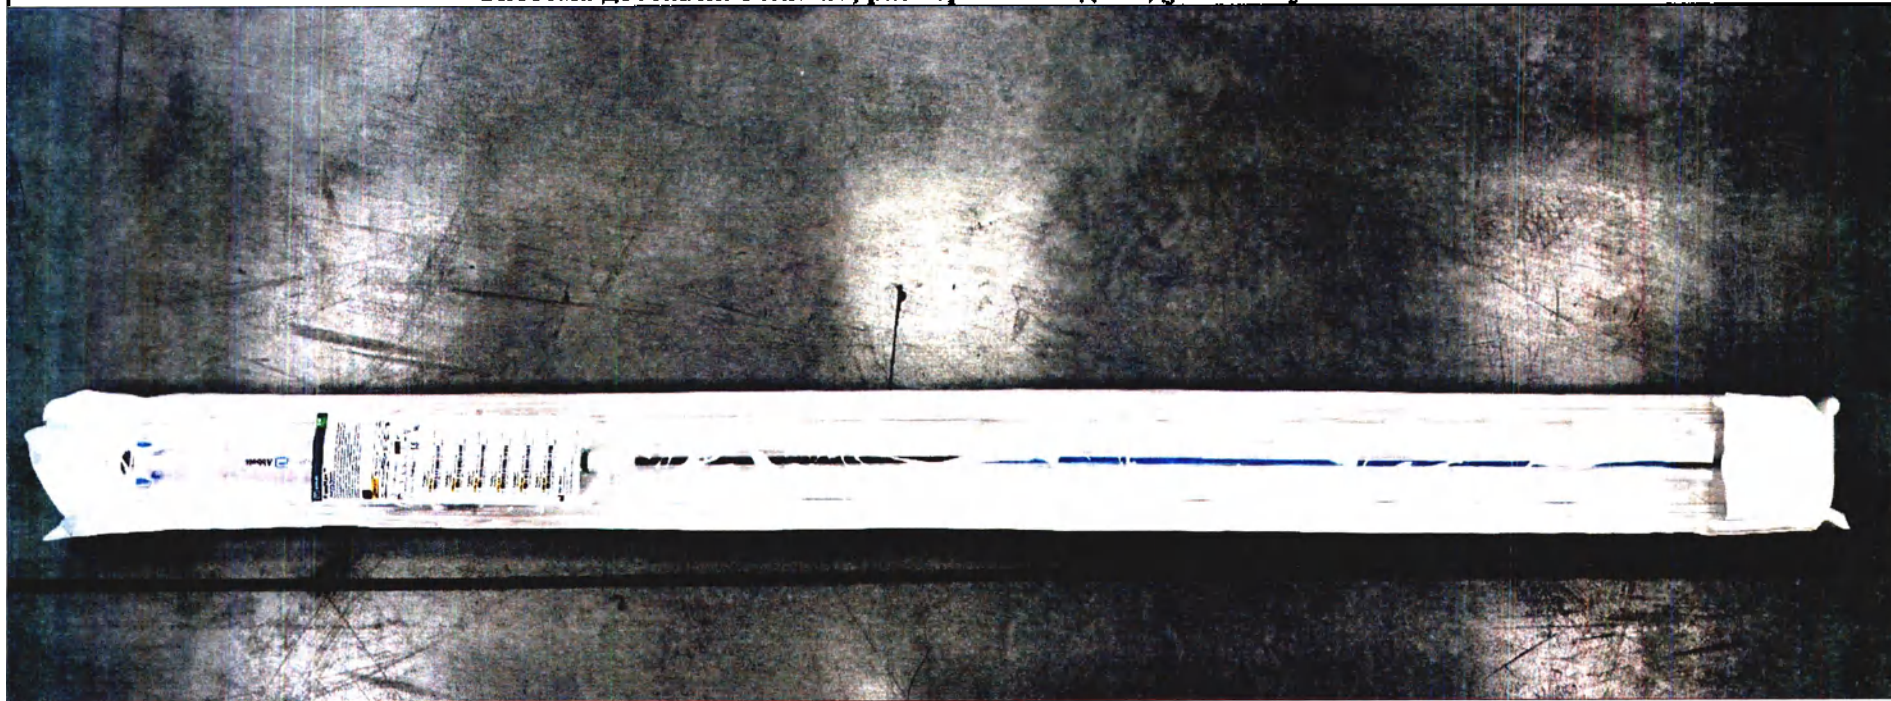




**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 19F. Индивидуальная упаковка.**

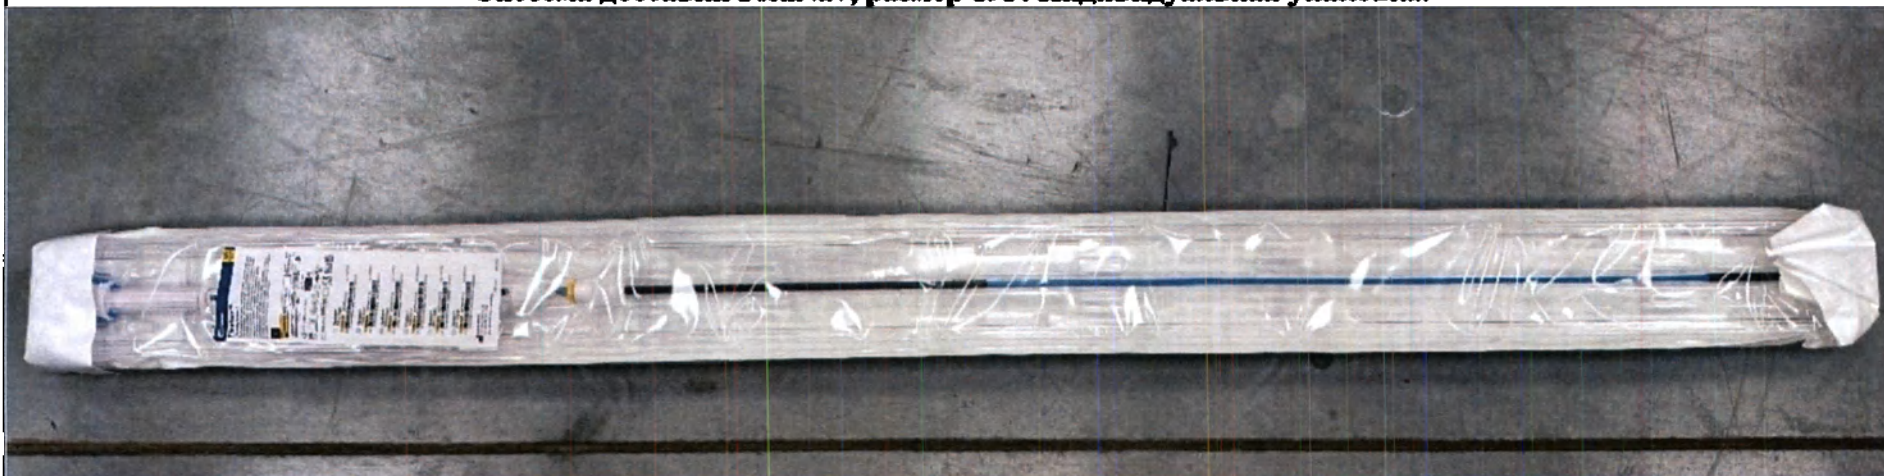




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, все размеры. Маркировка, локальный стикер.

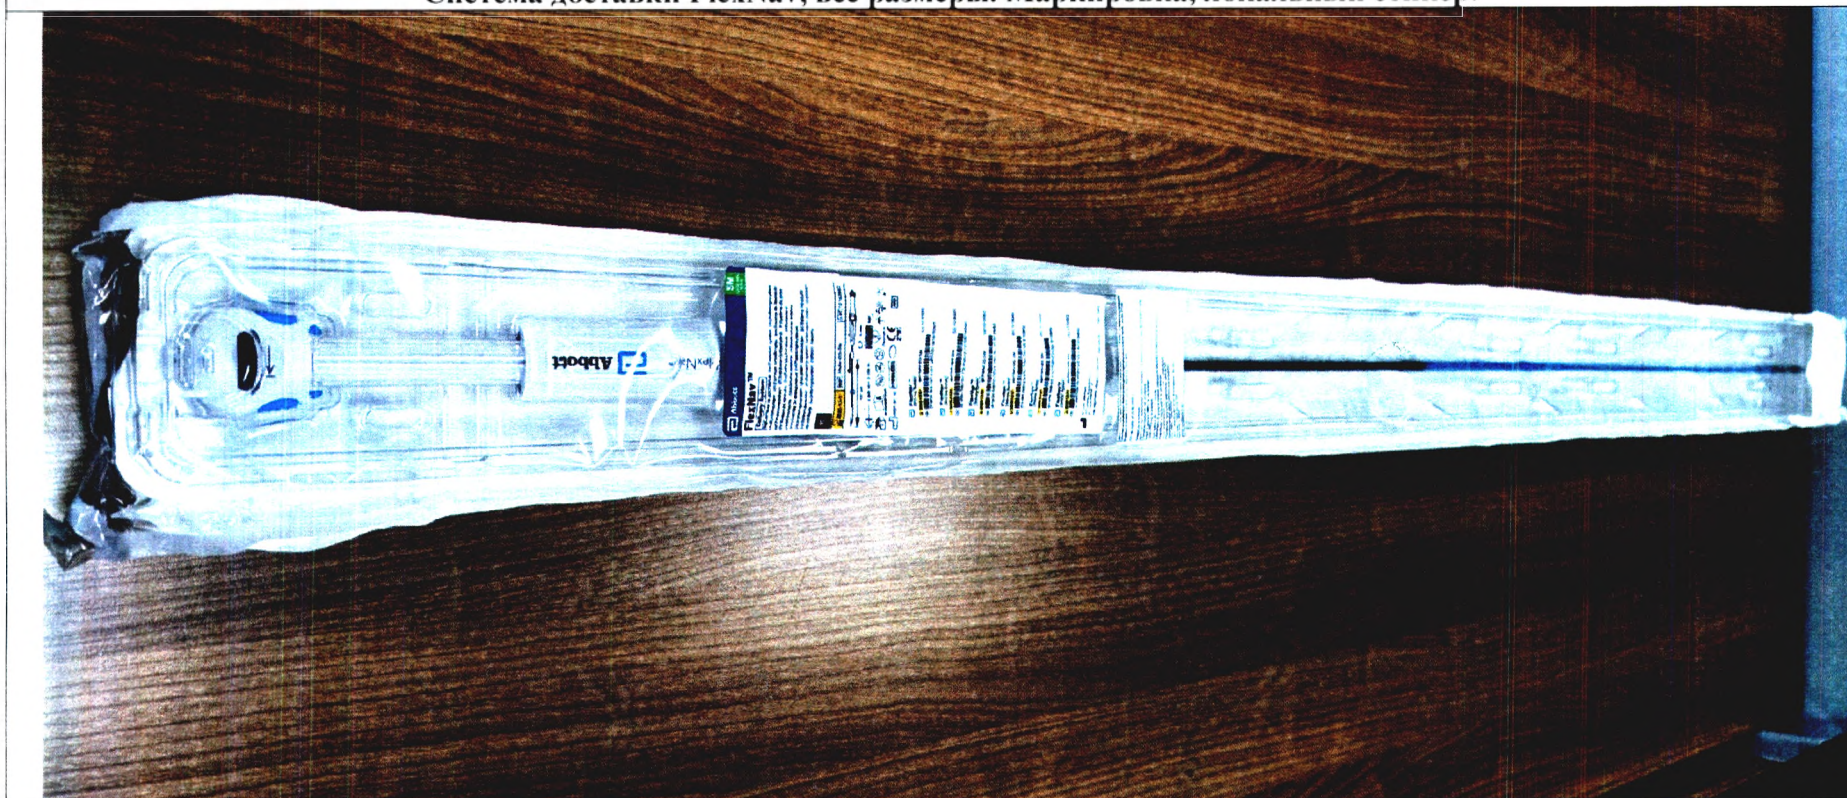



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, все размеры. Маркировка, локальный стикер.

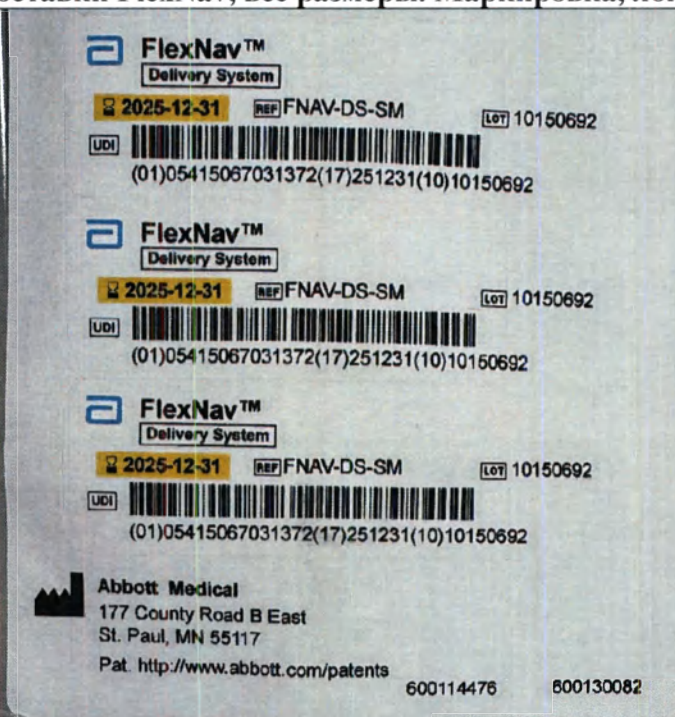

Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor, в варианте исполнения:  
Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor, размер XX мм.  
Элемент состава: Система доставки FlexNav, размер XXF

FY\*\* № XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Размер: см. на упаковке  
Производитель: Abbott Medical (ЗББотт Медиал), 177 County Road B E Saint Paul, MN 55117, USA  
Страна происхождения: см. на упаковке  
Номер по каталогу (REF): см. на упаковке  
Серия (LOT): см. на упаковке.  
Срок годности (SA): см. на упаковке.  
Информация об условиях хранения и обращения медицинского изделия: см. на упаковке.  
Информация о стерильности: см. на упаковке.  
Меры предосторожности: см. инструкцию по применению  
Расшифровку графических символов см. в инструкции  
Уполномоченный представитель производителя:  
ООО "ЗББотт Лэбораториз"  
125171, город Москва, шоссе Ленинградское, 16А, стр.1  
Тел./факс: +7(495)-258 42-80/81  
http://www.ru.abbott/  
abbott-russia@abbott.com



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 18F. Индивидуальная упаковка. Маркировка.

**Abbott**

**SM**  
23/25 mm  
Valve

**FlexNav™**

**Delivery System**

(bg)Система за доставяне (cs)Zaváděcí systém (da)Indføringssystem  
(de)Einführungssystem (el)Σύστημα τοποθέτησης (es)Sistema de liberación  
(et)Paigaldussüsteem (fi)Sisäänvientijärjestelmä (fr)Système de pose  
(hr)Sustav za isporuku (hu)Felhelyezőrendszer (it)Sistema di  
posizionamento (lt)Įstūmimo sistema (lv)Ievietošanas sistēma  
(mk)Систем за воведување (nl)Plaatsingssysteem  
(no)Innføringssystem (pl)System dostarczający (pt)Sistema introdutor  
(ro)Sistem de livrare (sk)Aplikačný systém (sl)Uvajalni sistem (sr)Sistem  
za uvođenje (sv)Införingssystem (tr)İletim Sistemi

**107**  
cm





**2025-12-31**

**REF**

**FNAV-DS-SM**

**LOT**


**10160692**

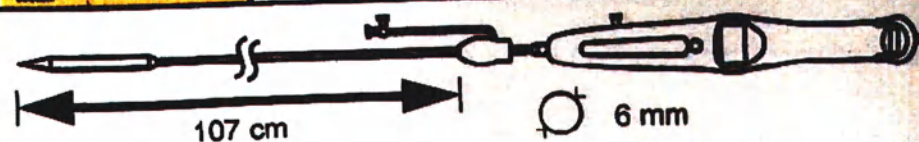

**EQUIV. SHEATH 14F**



medical.abott/manuals



(7440-48-4)



2024-01-10

**STERILE EO**



**CE**  
2797

**MD**




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 19F. Индивидуальная упаковка. Маркировка.






**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 18F. Потребительская упаковка.**

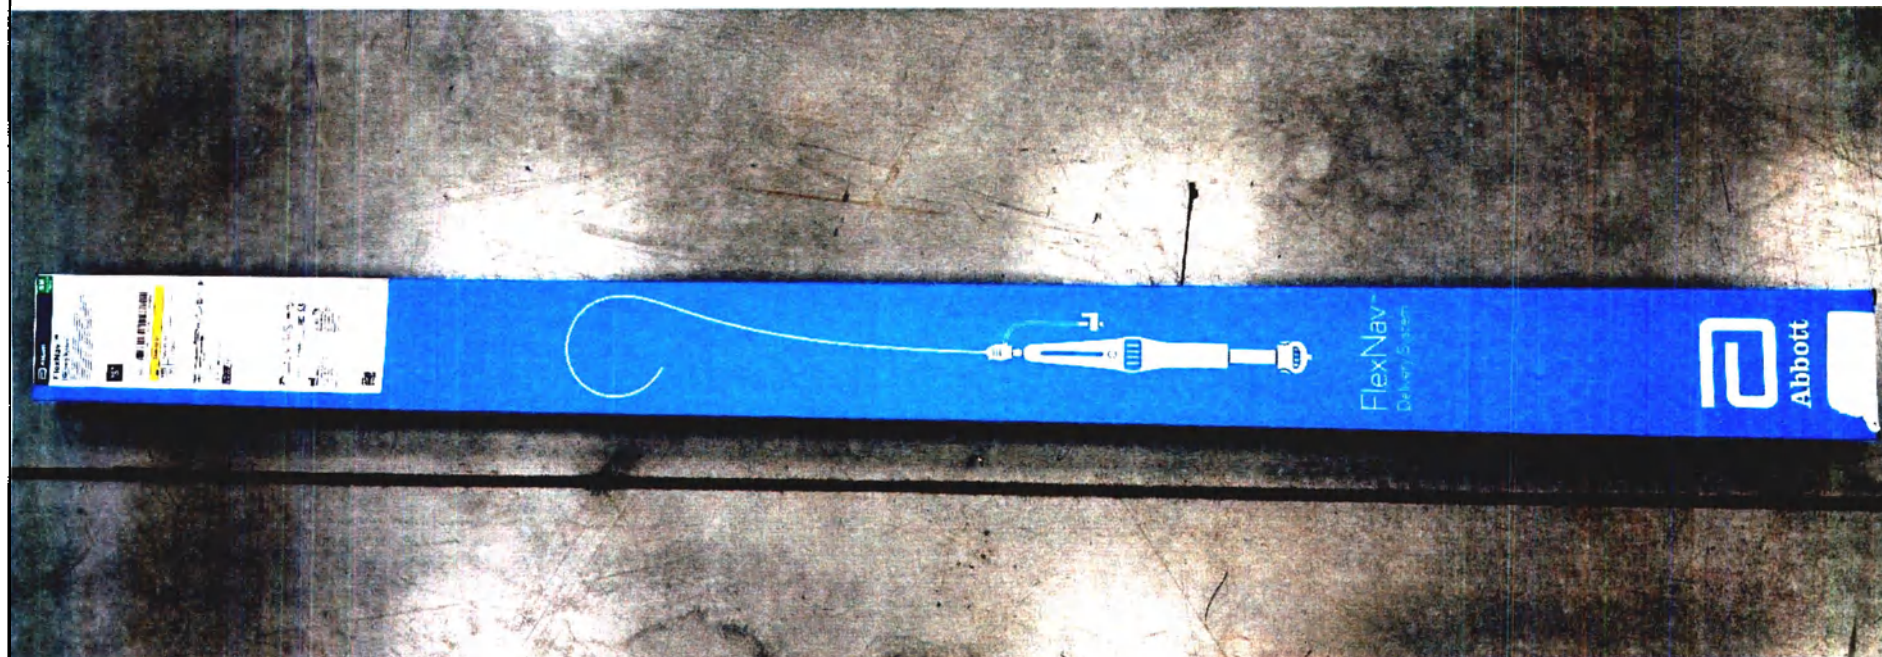



**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 19F. Потребительская упаковка.**

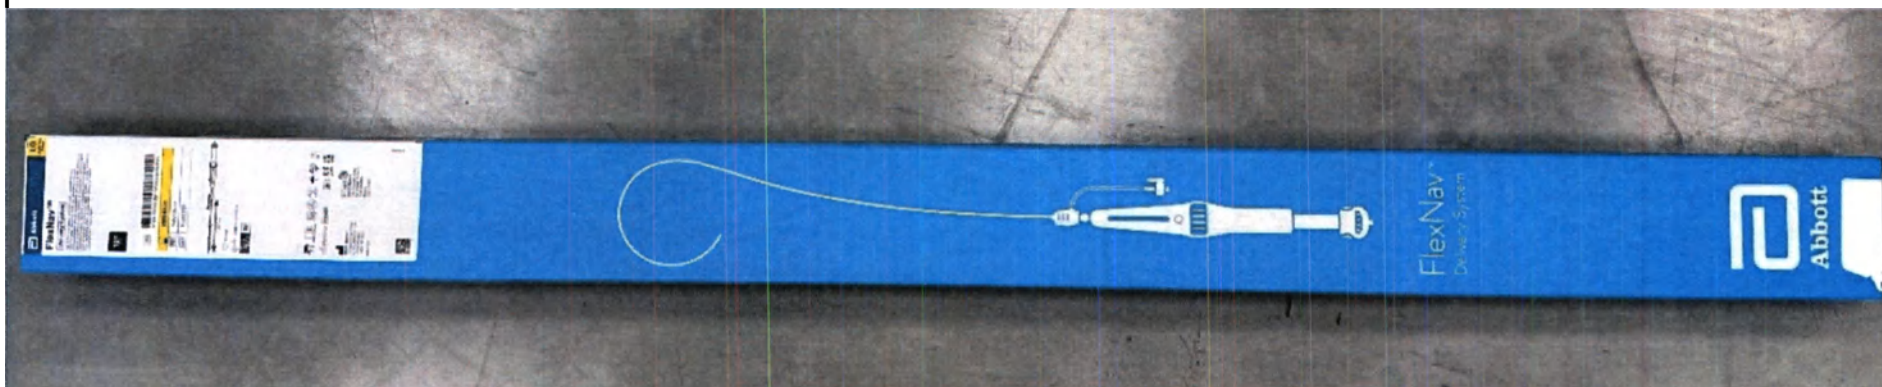



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, все размеры. Потребительская упаковка. Маркировка, локальный стикер





**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, все размеры. Потребительская упаковка. Маркировка, локальный стикер**

Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor, в варианте исполнения:  
Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor, размер XX мм.  
Элемент состава: Система доставки FlexNav, размер XXF

РУ\*\* № XXXXX от XX.XX.XXXX г.

Размер: см. на упаковке

Производитель: Abbott Medical (Эбботт Медикал), 177 County Road B E Saint Paul, MN 55117, USA

Страна происхождения: см. на упаковке

Номер по каталогу (REF): см. на упаковке

Серия (LOT): см. на упаковке.

Срок годности (M): см. на упаковке.

Информация об условиях хранения и обращения медицинского изделия: см. на упаковке.

Информация о стерильности: см. на упаковке.

Меры предосторожности: см. инструкцию по применению

Расшифровку графических символов см. в инструкции

Уполномоченный представитель производителя:

ООО "Эбботт Лабс" (Эбботт Лабс)

125171, город Москва, шоссе Ленинградское, 16А, стр.1

Тел./факс: +7(495)-258-42-80/81

<https://www.ru.abbott/>

[abbott-russia@abbott.com](mailto:abbott-russia@abbott.com)



**2025-12-31**

**REF**




(01)05415067031372(17)251231(10)1015







Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 19F. Индивидуальная упаковка. Маркировка

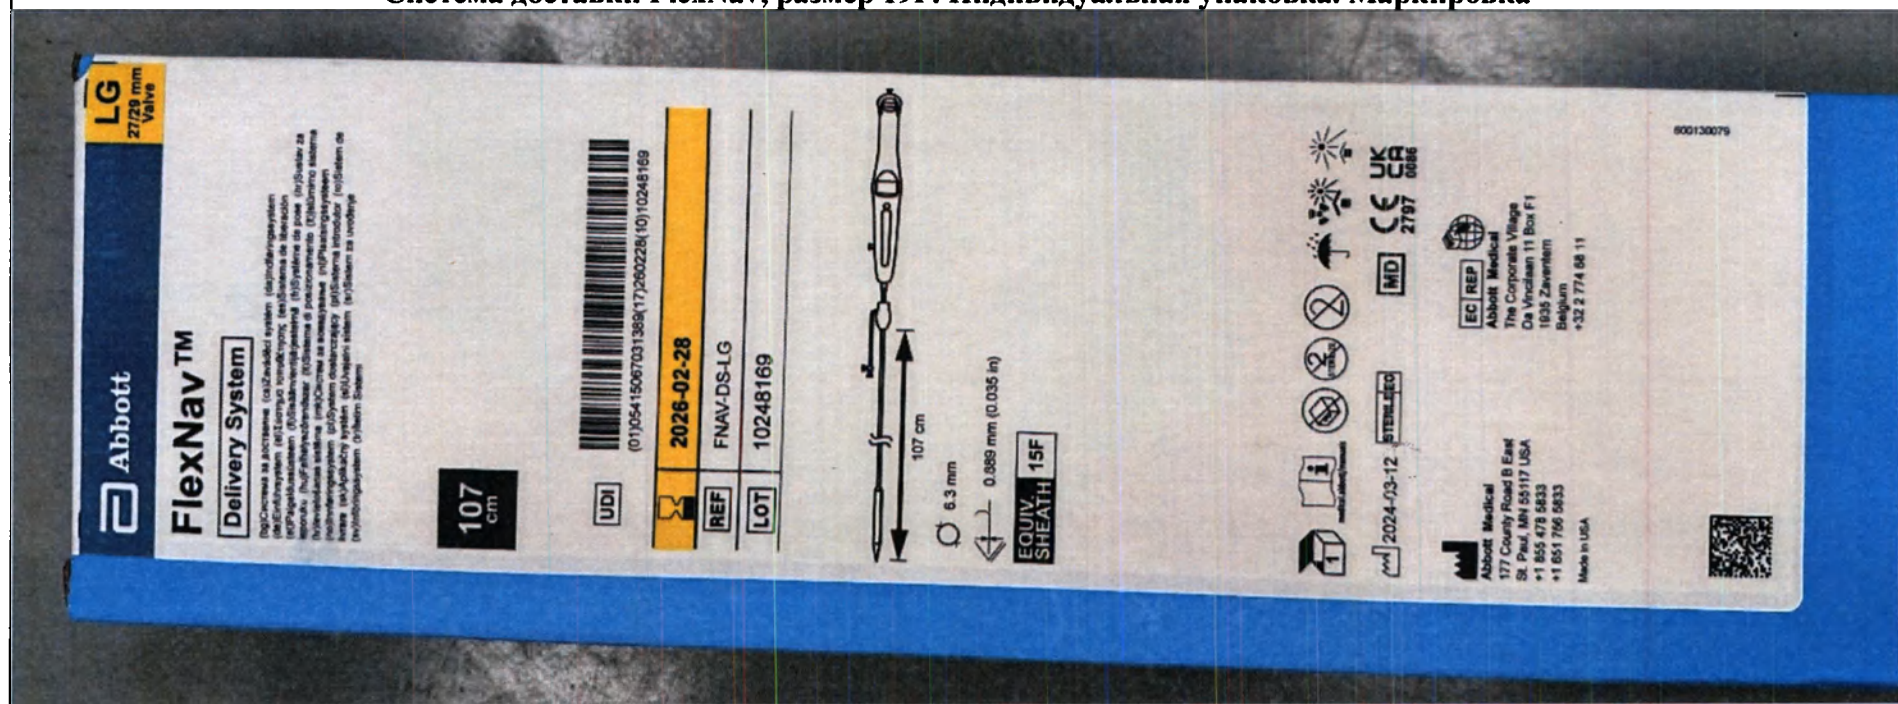



**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 18F. Индивидуальная упаковка. Маркировка**

 **2025-12-31**  **REF** FNAV-DS-SM  **LOT** 10150692



(01)05415067031372(17)251231(10)10150692(91)500114476(30)01


**107**  
cm

**SM**  
23/25 mm  
Valve

**FlexNav™**  
Delivery System




**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 19F. Индивидуальная упаковка. Маркировка**

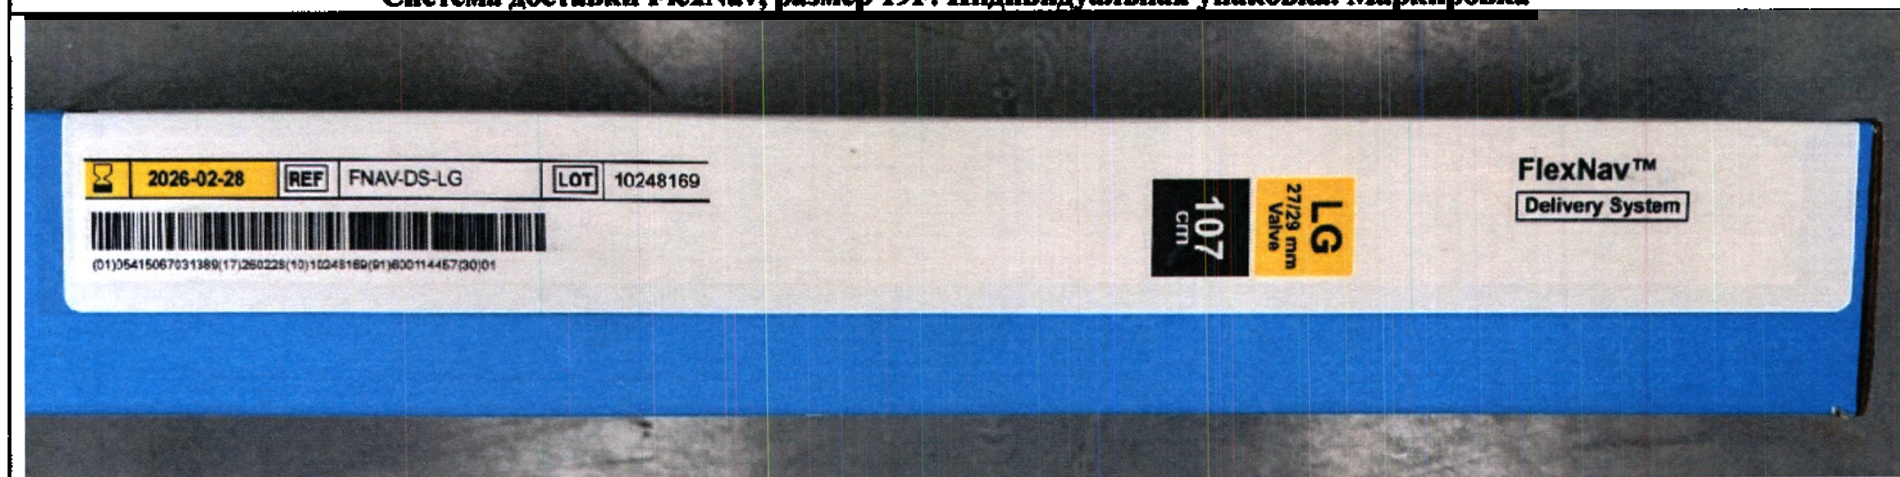




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 18F. Индивидуальная упаковка. Маркировка

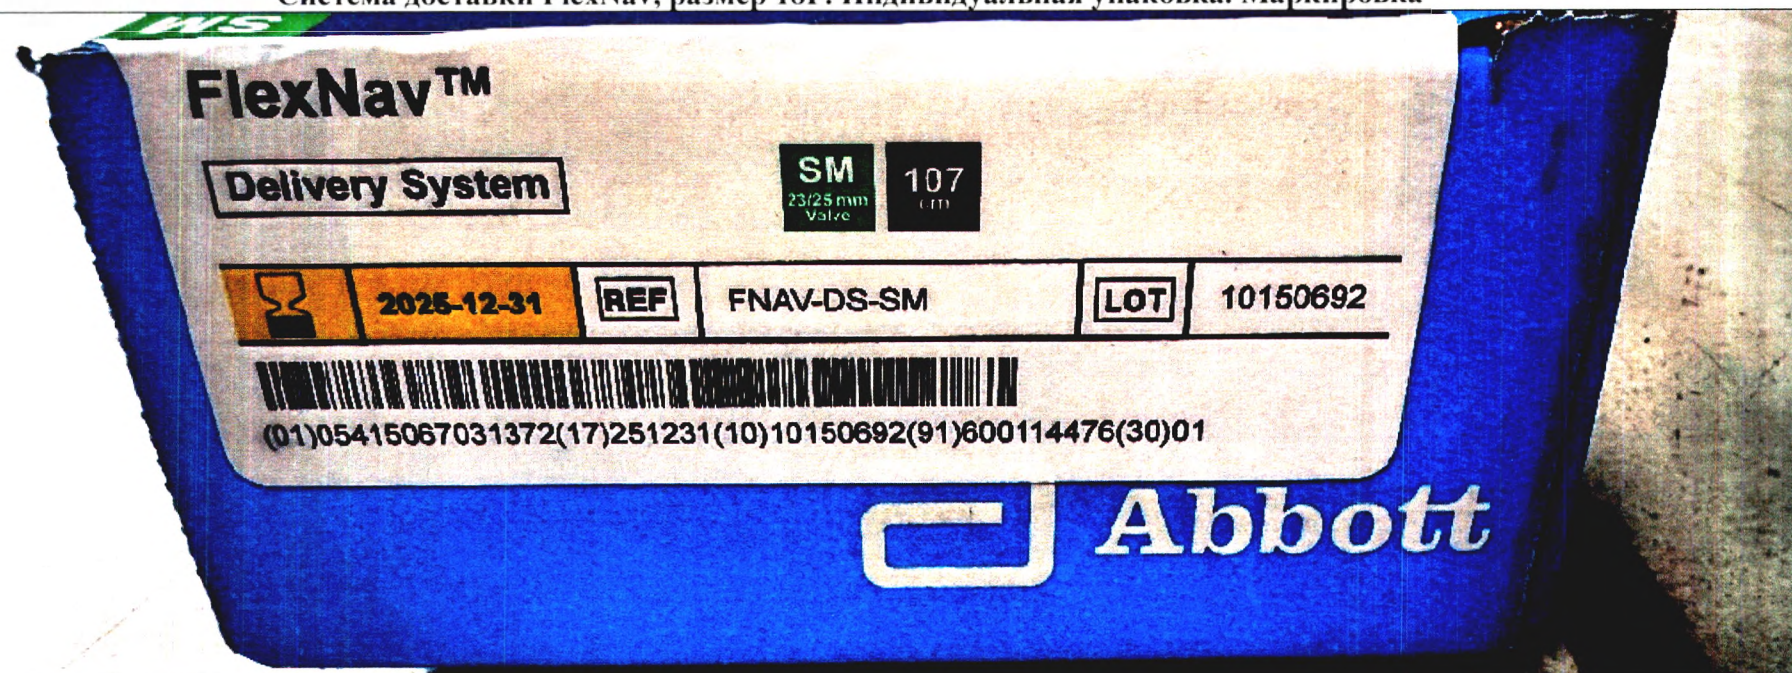



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система доставки FlexNav, размер 19F. Индивидуальная упаковка. Маркировка

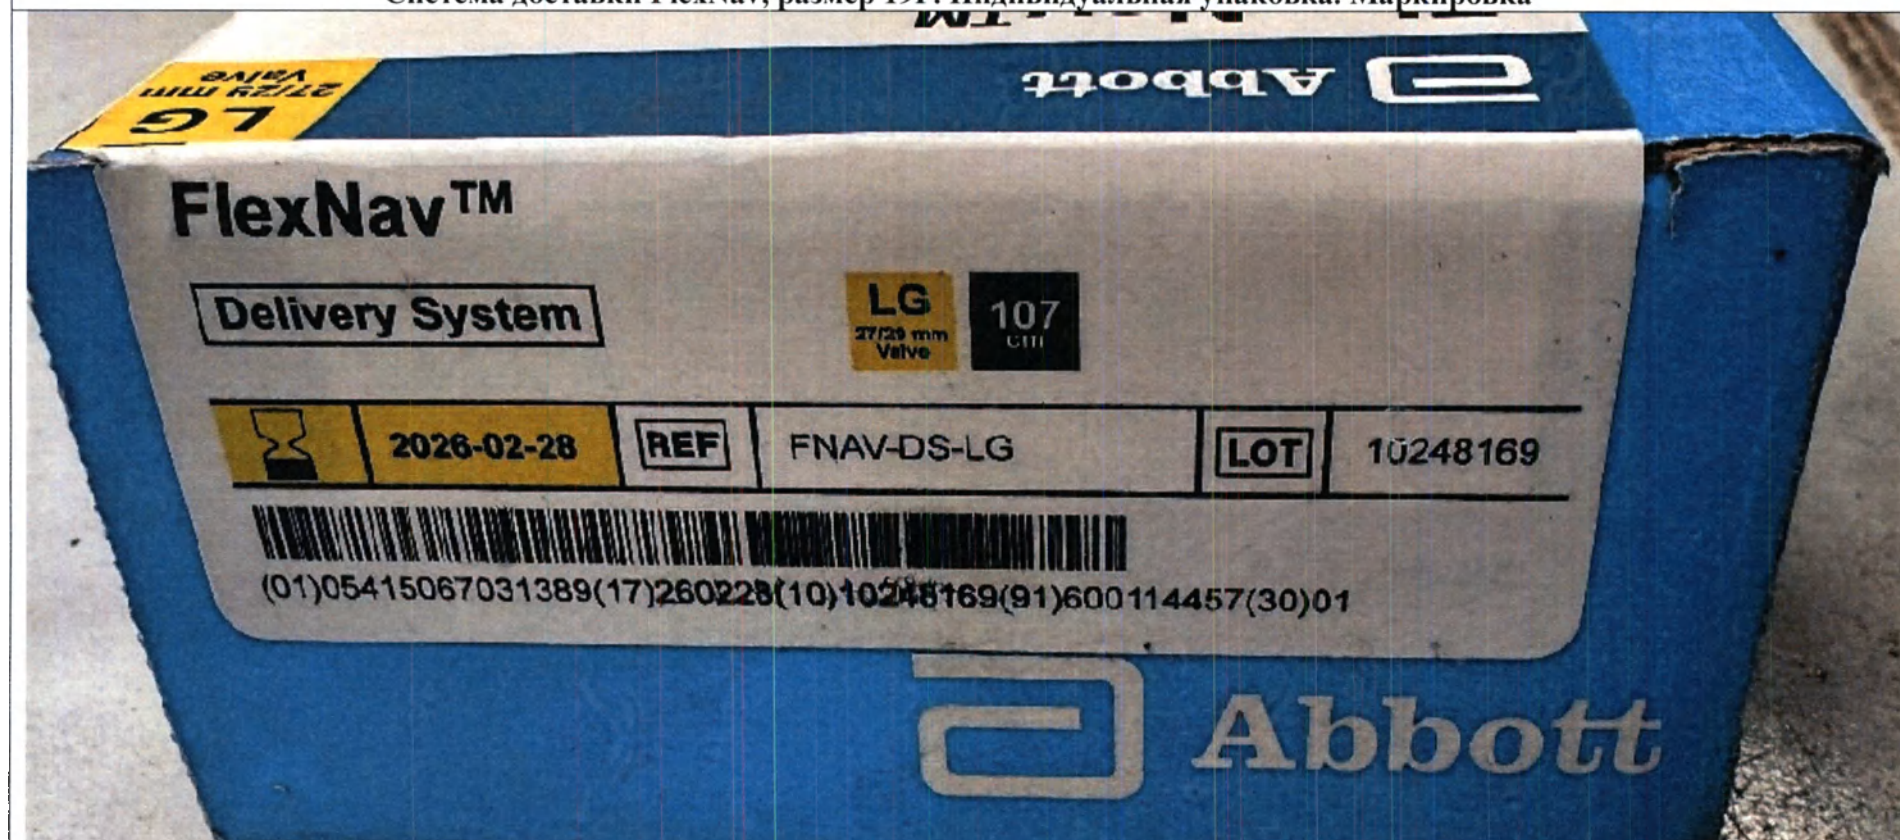




**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 18F.**





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 19F.

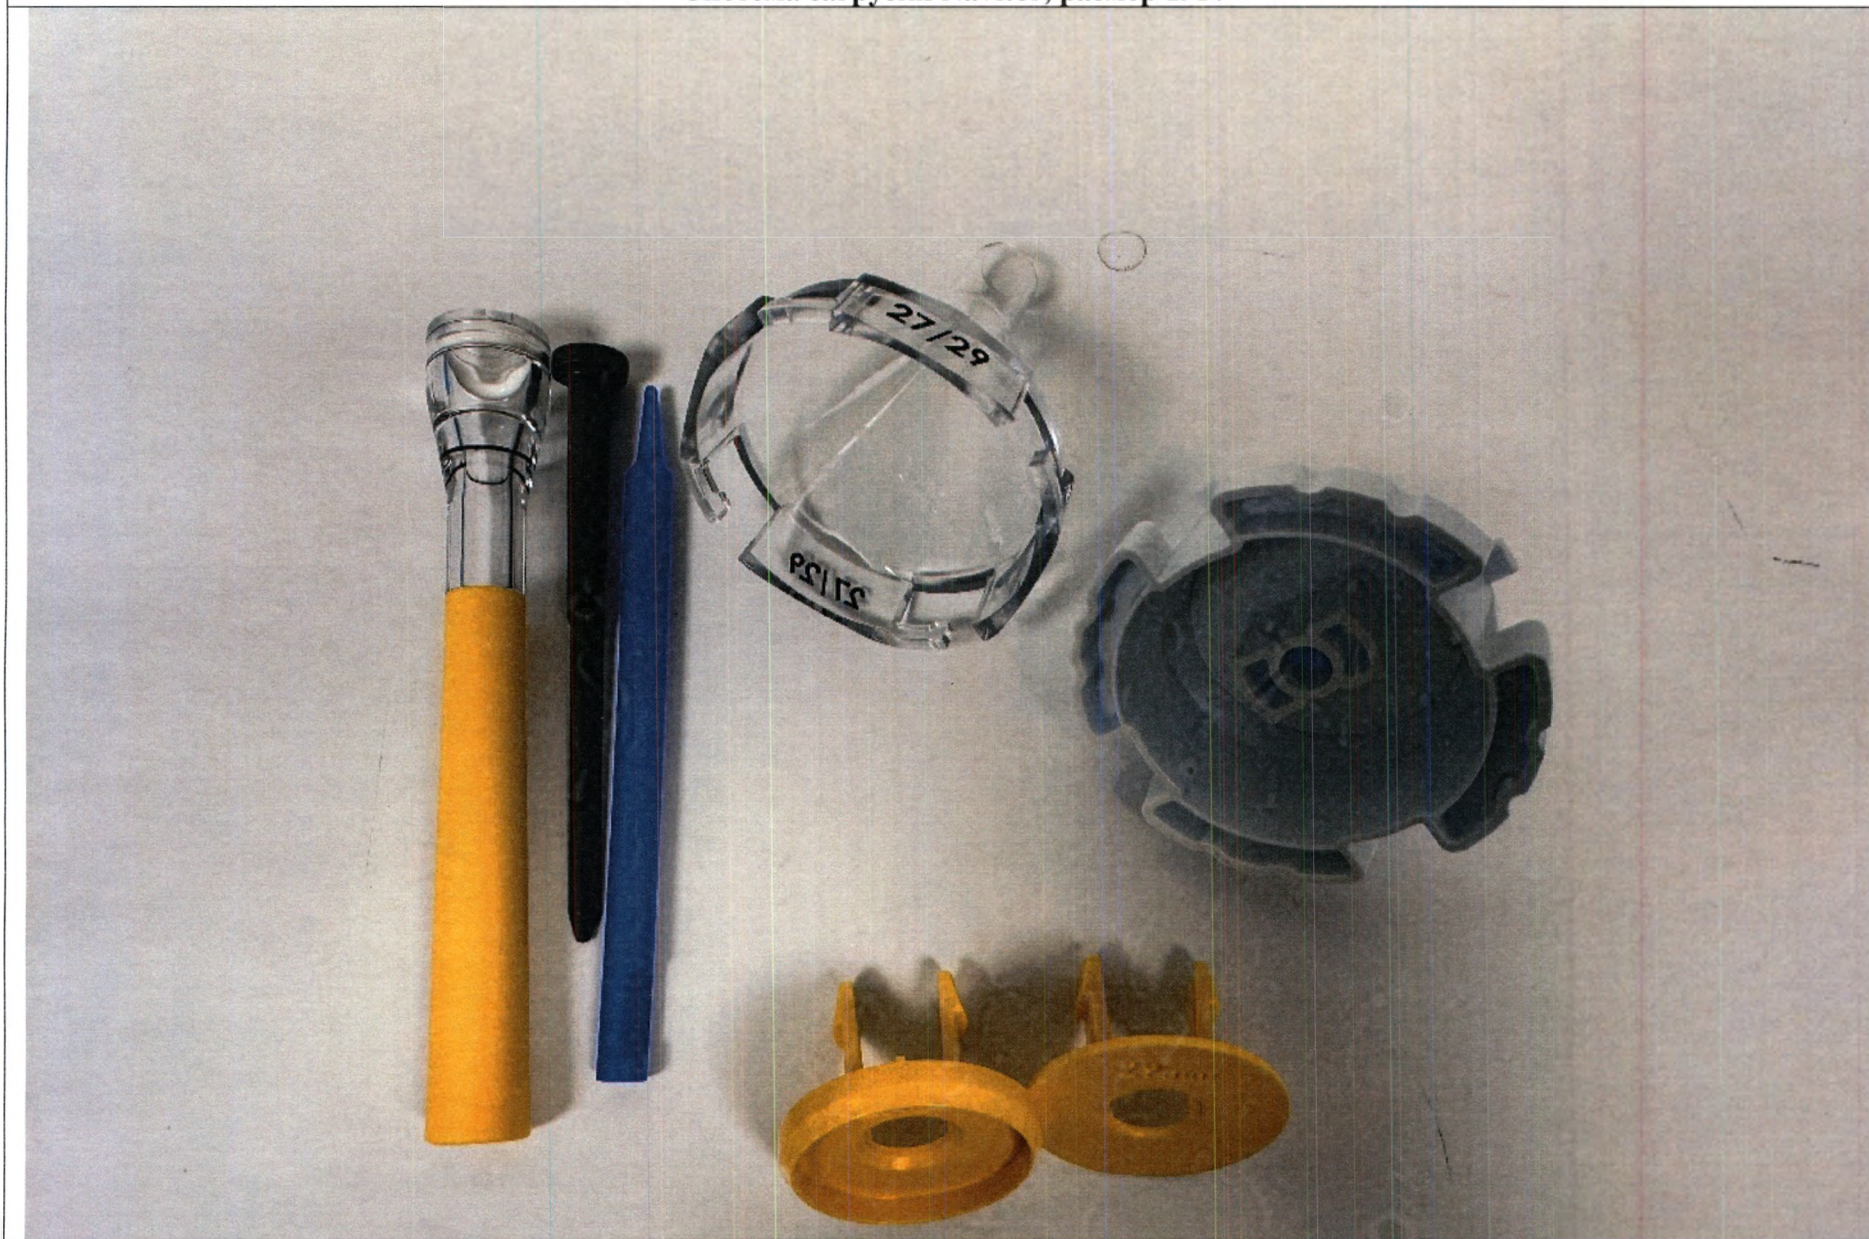




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 18F. Индивидуальная упаковка.






Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 19F. Индивидуальная упаковка.

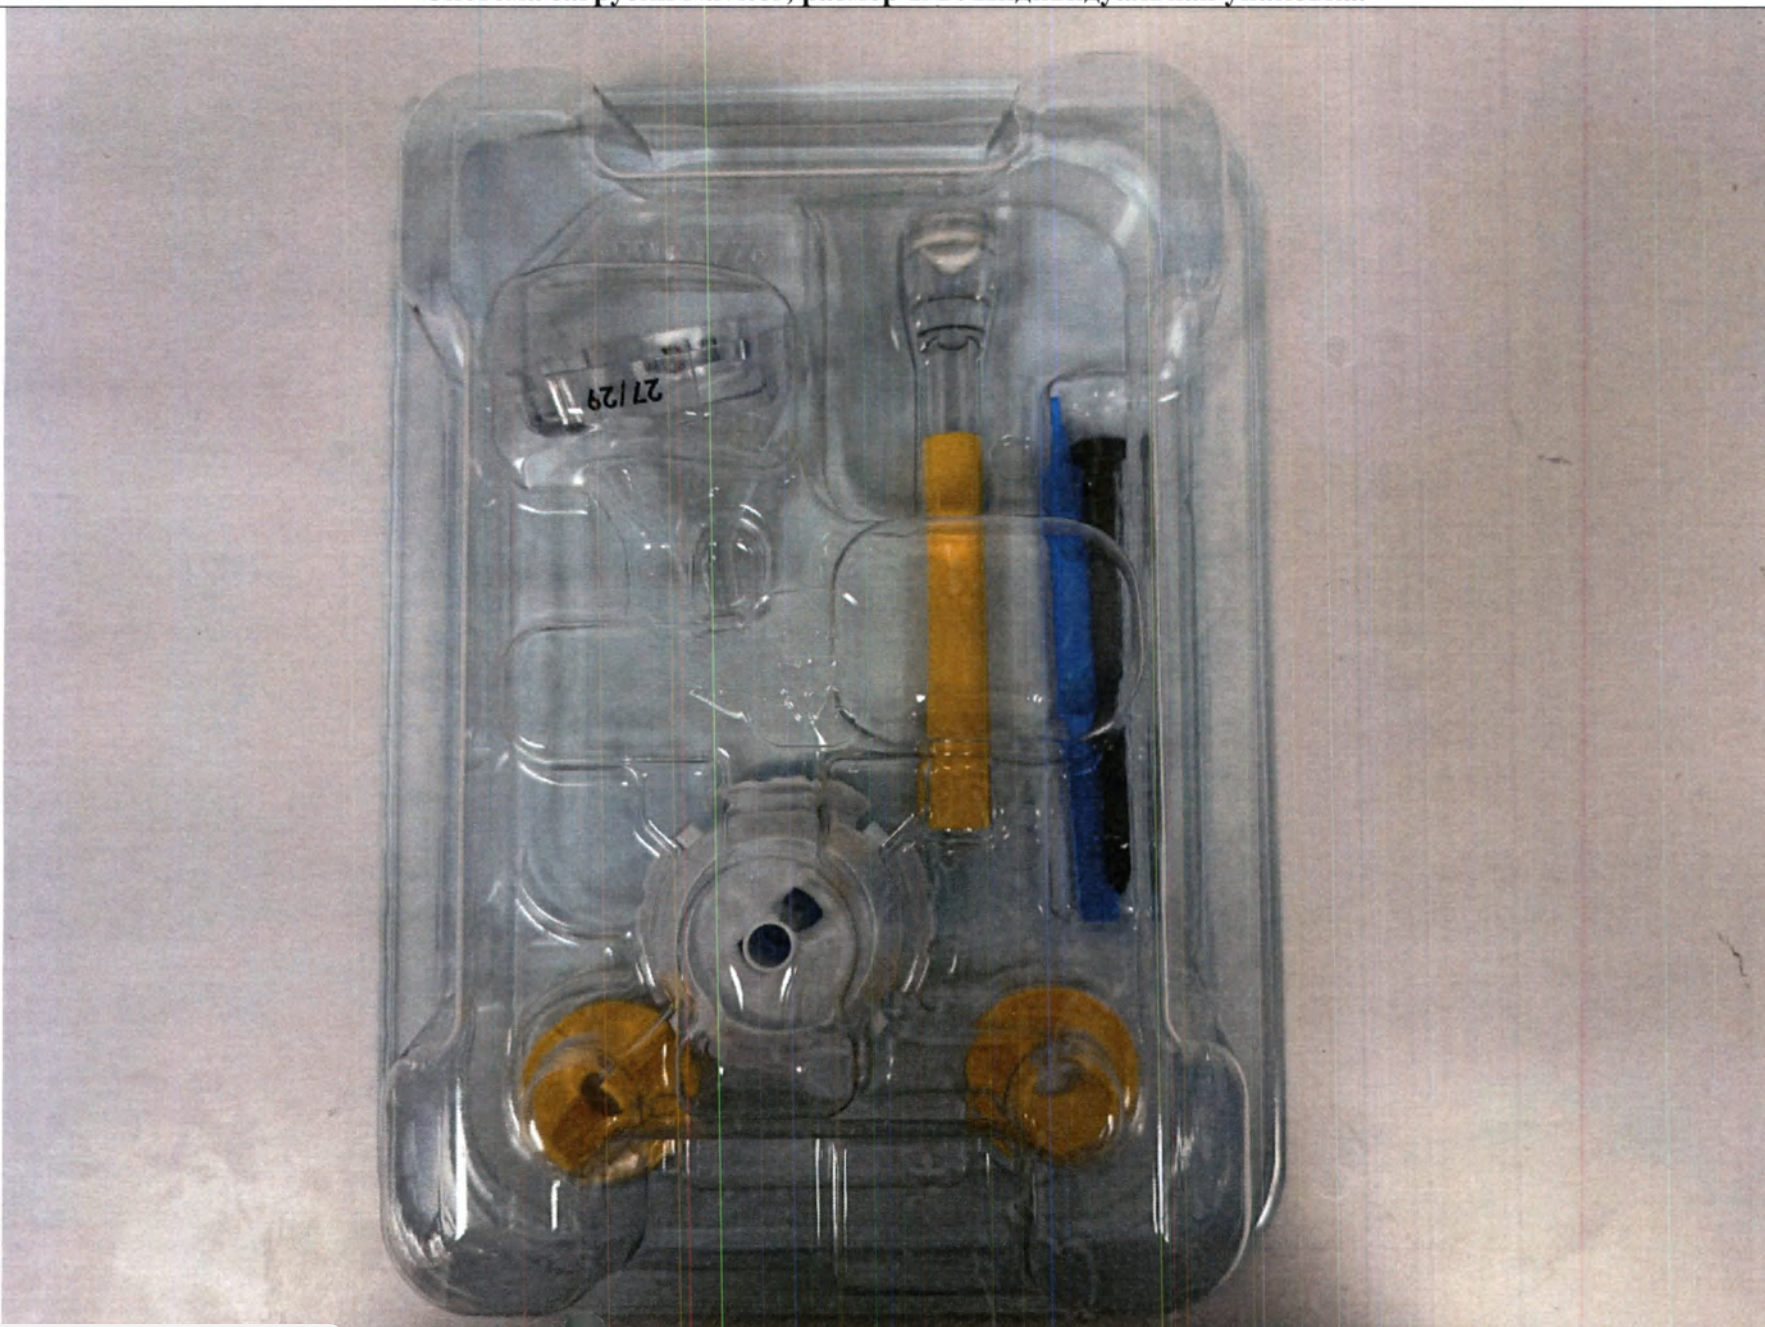




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 18F. Индивидуальная упаковка, вид сзади.

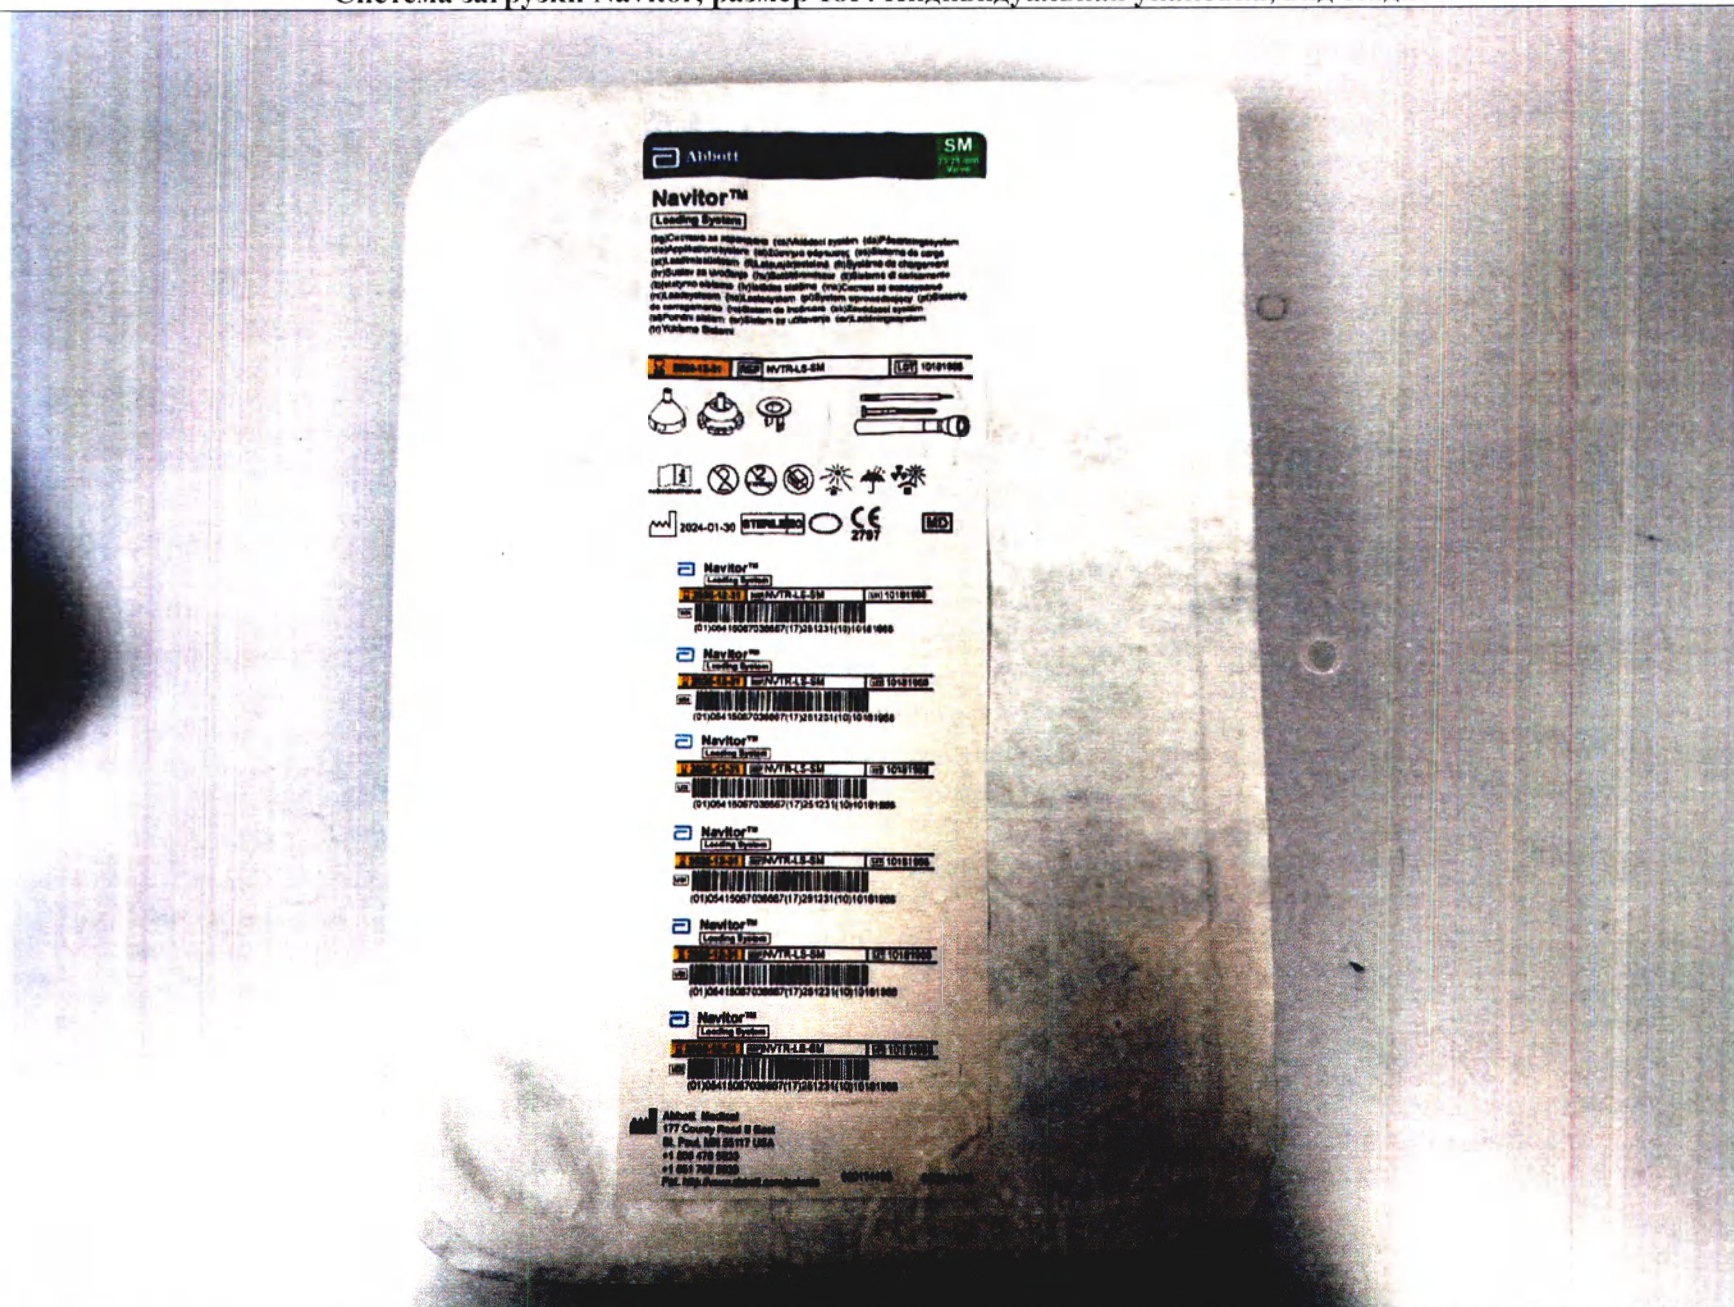




**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.**  
**Система загрузки Navitor, размер 19F. Индивидуальная упаковка, вид сзади.**

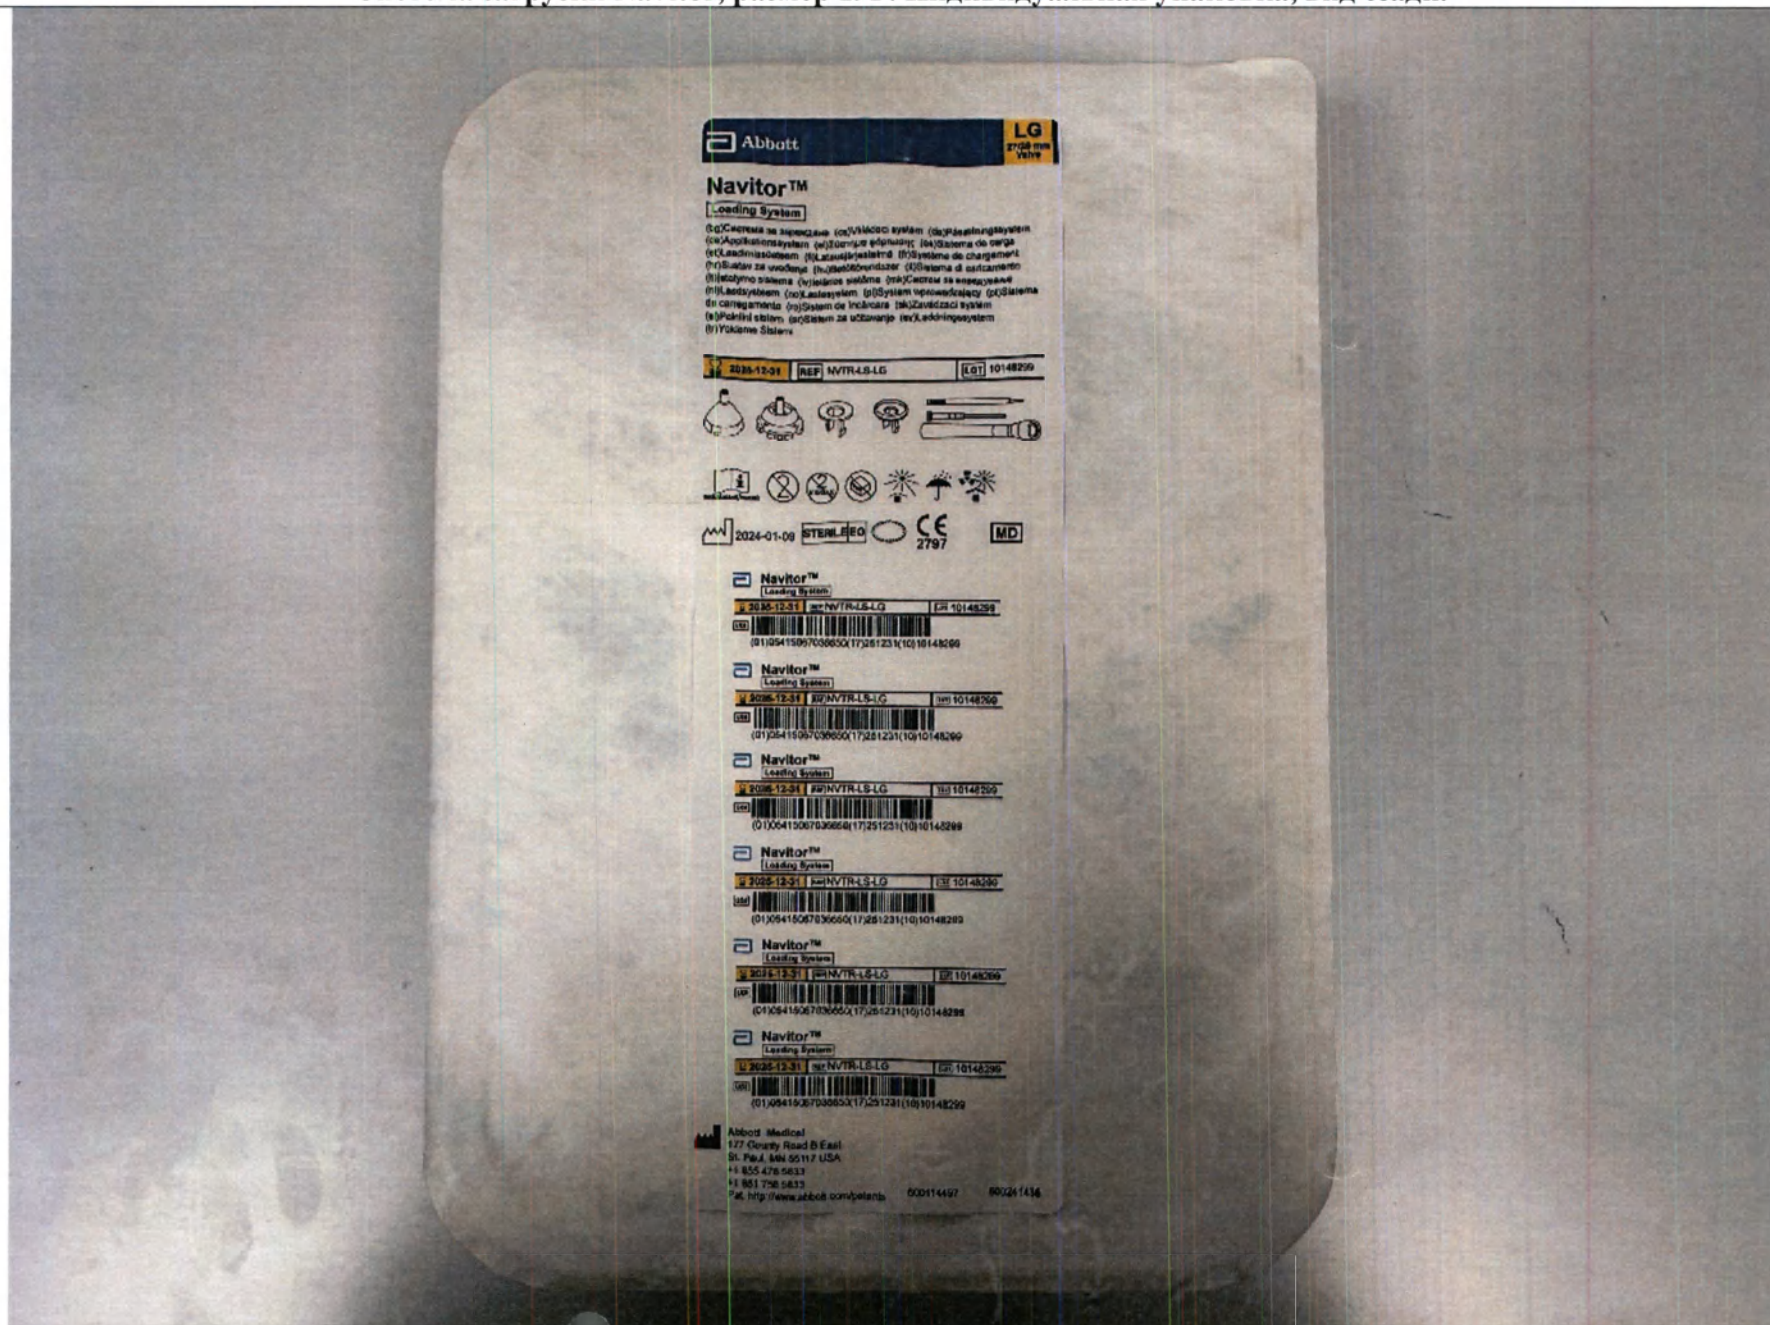




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, все размеры. Индивидуальная упаковка, вид сзади. Локальный стикер.

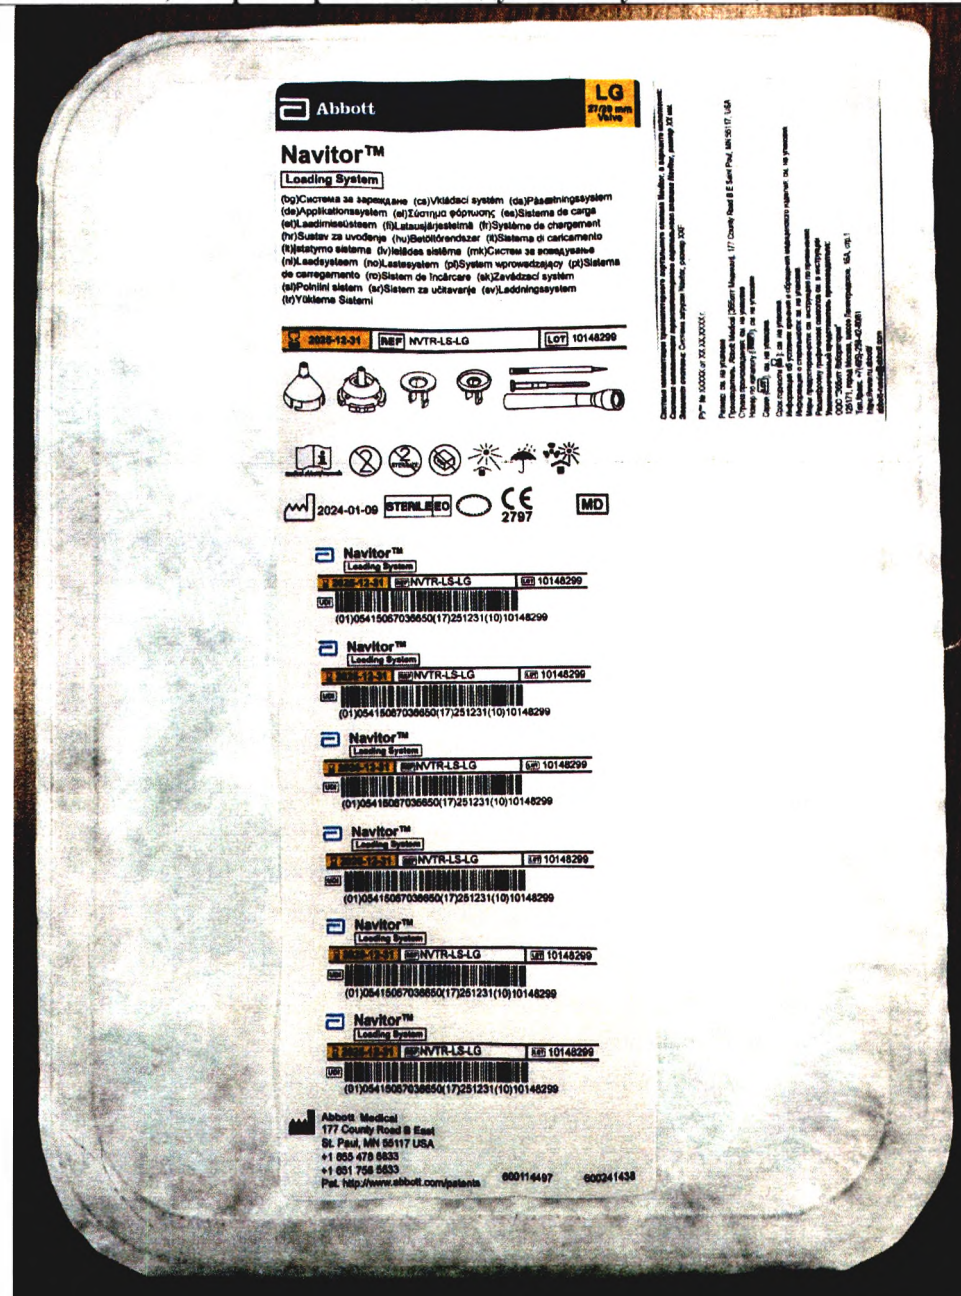



**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, все размеры. Индивидуальная упаковка, вид сзади. Локальный стикер.**

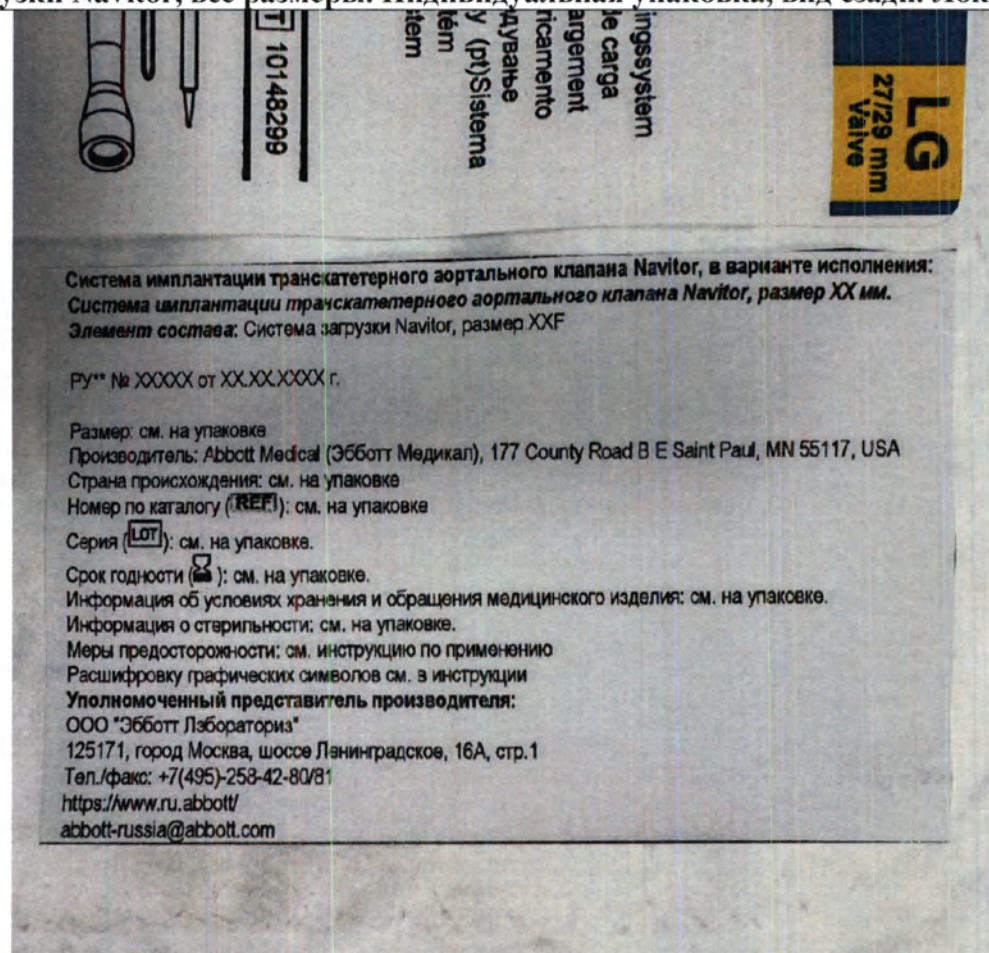



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 18F. Индивидуальная упаковка. Маркировка.

 **Abbott**

**SM**  
23/25 mm  
Valve

## Navitor™

### Loading System

(bg)Система за зареждане (cs)Vkládací systém (da)Påseetningsystem  
(de)Applikationssystem (el)Σύστημα φόρτωσης (es)Sistema de carga  
(et)Laadimisüsteem (fi)Latausjärjestelmä (fr)Système de chargement  
(hr)Sustav za uvođenje (hu)Betöltőrendszer (it)Sistema di caricamento  
(lt)Įstatymo sistema (lv)Ielādes sistēma (mk)Систем за поставување  
(nl)Laadsysteem (no)Lastesystem (pl)System wprowadzający (pt)Sistema  
de carregamento (ro)Sistem de încărcare (sk)Zavádzací systém  
(sl)Polnilni sistem (sr)Sistem za učitavanje (sv)Laddningssystem  
(tr)Yükleme Sistemi

 **2025-12-31** **REF** NVTR-LS-SM **LOT** 10181968



2024-01-30

**STERILE**



**CE**  
2797

**MD**

 **Navitor™**  
Loading System





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 19F. Индивидуальная упаковка. Маркировка.



## Navitor™

### Loading System

(bg)Система за зареждане (cs)Vkládací systém (da)Påsætningssystem  
(de)Applikationssystem (el)Σύστημα φόρτωσης (es)Sistema de carga  
(et)Laadimissüsteem (fi)Latausjärjestelmä (fr)Système de chargement  
(hr)Sustav za uvođenje (hu)Betöltőrendszer (it)Sistema di caricamento  
(lt)statymo sistema (lv)Ielādes sistēma (mk)Систем за воведување  
(nl)Laadsysteem (no)Lastesystem (pl)System wprowadzający (pt)Sistema  
de carregamento (ro)Sistem de încărcare (sk)Zavádzací systém  
(sl)Polnilni sistem (sr)Sistem za učitanje (sv)Laddningssystem  
(tr)Yükleme Sistemi

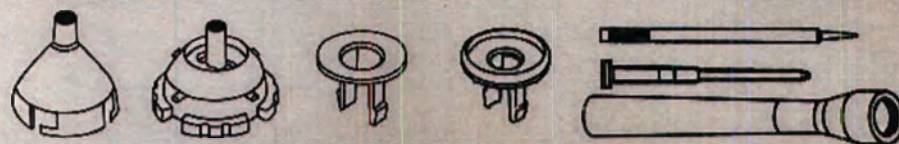

medical.abbott/manuals



2024-01-09

STERILE EO



CE  
2797

MD

Navitor™




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 18F мм. Потребительская упаковка. Маркировка.





Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 19F. Потребительская упаковка. Маркировка.

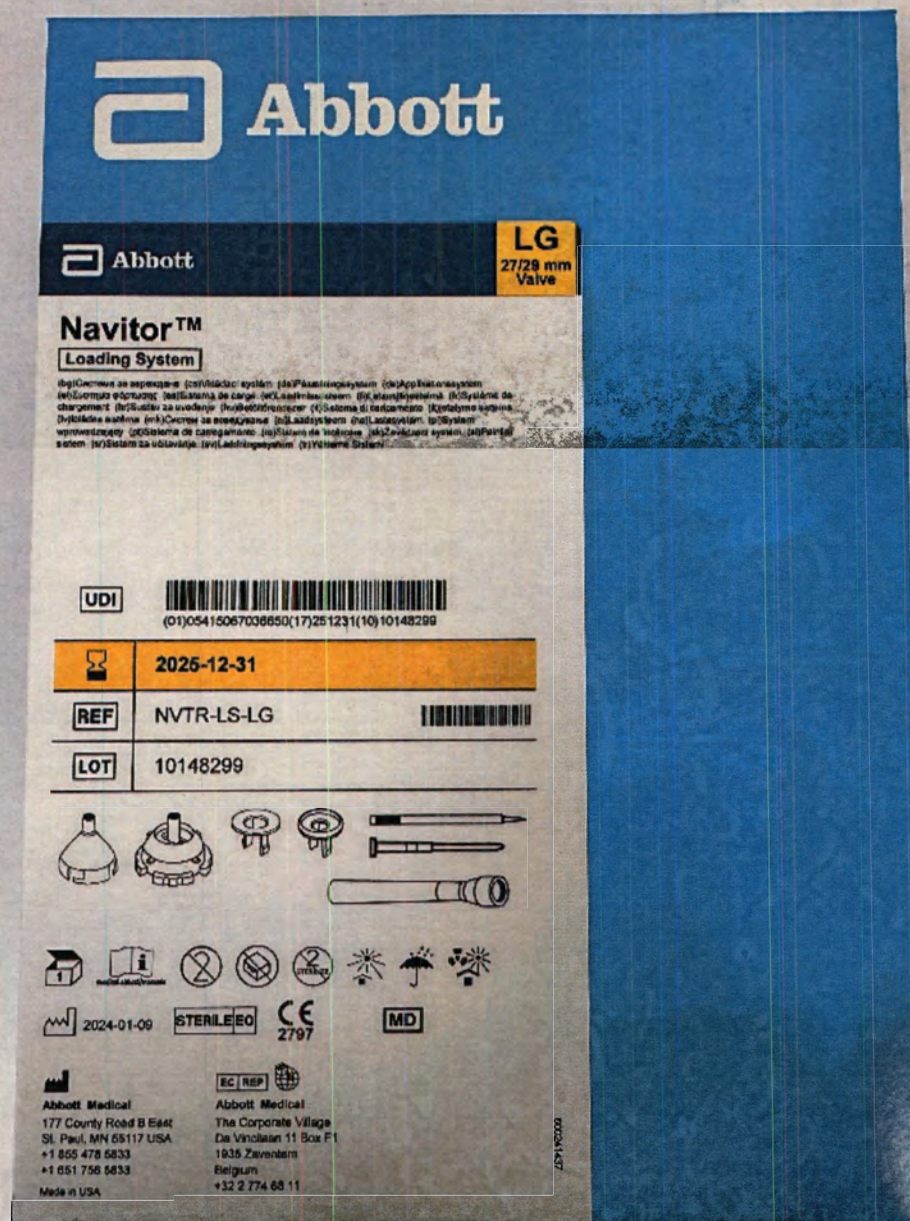





SM  
23/25 mm  
Valve

## Navitor™

### Loading System

(bg)Система за зареждане (ca)Valvulă de sistem (de)Platzierungssystem (de)Applicationsystem (e)Systèmes d'opération (es)Sistema de carga (et)Laadimisüsteem (fi)Latausjärjestelmä (fr)Système de chargement (hr)Sustav za uvođenje (hu)Bevitőrendszer (it)Sistema di caricamento (lt)Įkėlimo sistema (lv)Iekšas sistēma (mk)Система за соопатување (nl)Laadsysteem (no)Lastesystem (pl)System wprowadzający (pt)Sistema de carregamento (ro)Sistem de încărcare (sk)Zavádzací systém (sl)Ponilni sistem (sr)Систем за уčitавање (sv)Laddningssystem (tr)Yükleme Sistemi

UDI



(01)05415067036687(17)251231(10)10181968



2025-12-31



REF

NVTR-LS-SM



LOT

10181968



2024-01-30

STERILE



2797

MD



Abbott Medical

177 County Road B East  
St. Paul, MN 55117 USA  
+1 655 478 5833

Made in USA



EC REP

Abbott Medical  
The Corporate Village  
De Wynden 11 Box F1  
1935 Zaventem  
Belgium  
+32 2 774 66 11

8002451908



**LG**  
**27/29 mm**  
**Valve**

# Navitor™

## Loading System

[illegible]

(01)05415067038850(17)251231(10)10148299


**UDL**

2025-12-31

NVTR-LS-LG



10148299

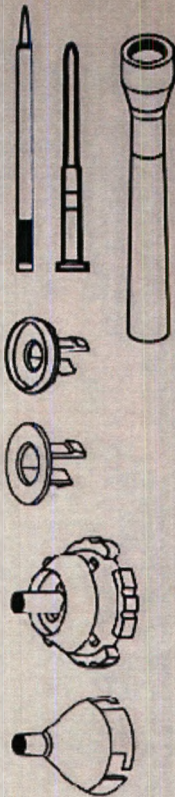

2024-01-09

STERILE

2707

MD



**Abbott Medical**  
177 County Road B East  
St Paul, MN 55117 USA  
+1 855 478 5833  
+1 651 756 5833

Made in USA




Abbott Medical  
The Corporate Village  
Da Vinci 11 Box F1  
1935 Zaventem  
Belgium  
+32 2 774 68 11

+32 2 774 68 11

600241437



**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 18F. Потребительская упаковка, вид сбоку. Маркировка.**

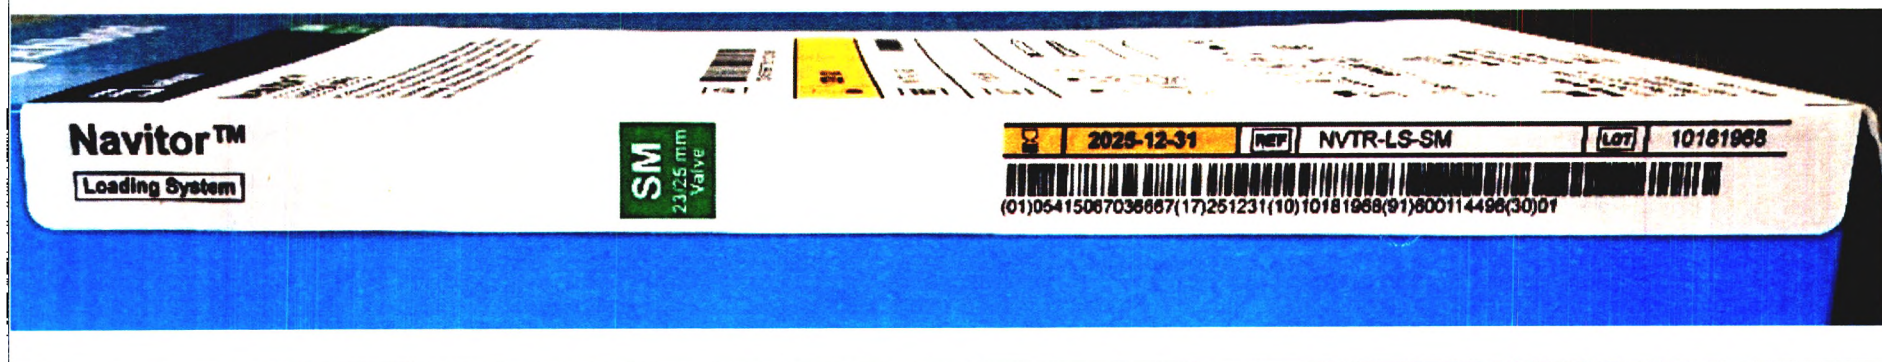









Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 18F. Потребительская упаковка. Маркировка.

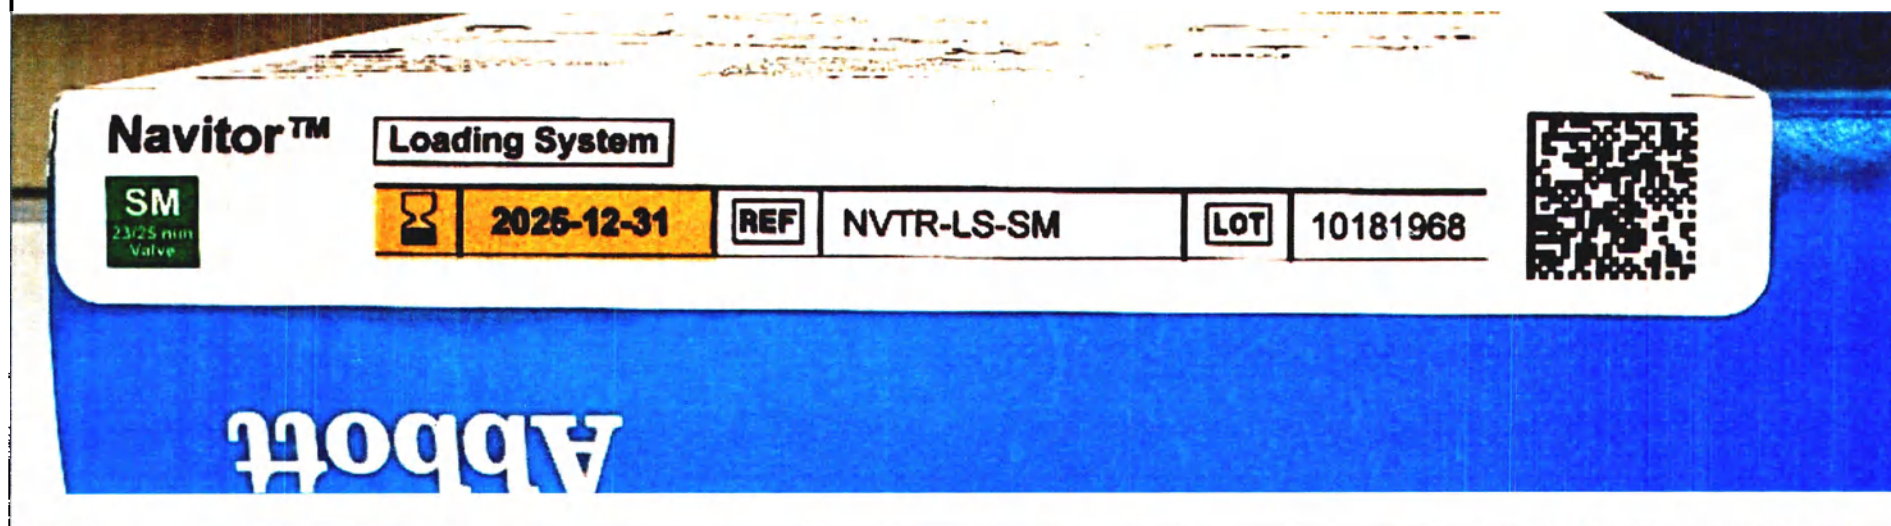




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, размер 19F. Потребительская упаковка. Маркировка.

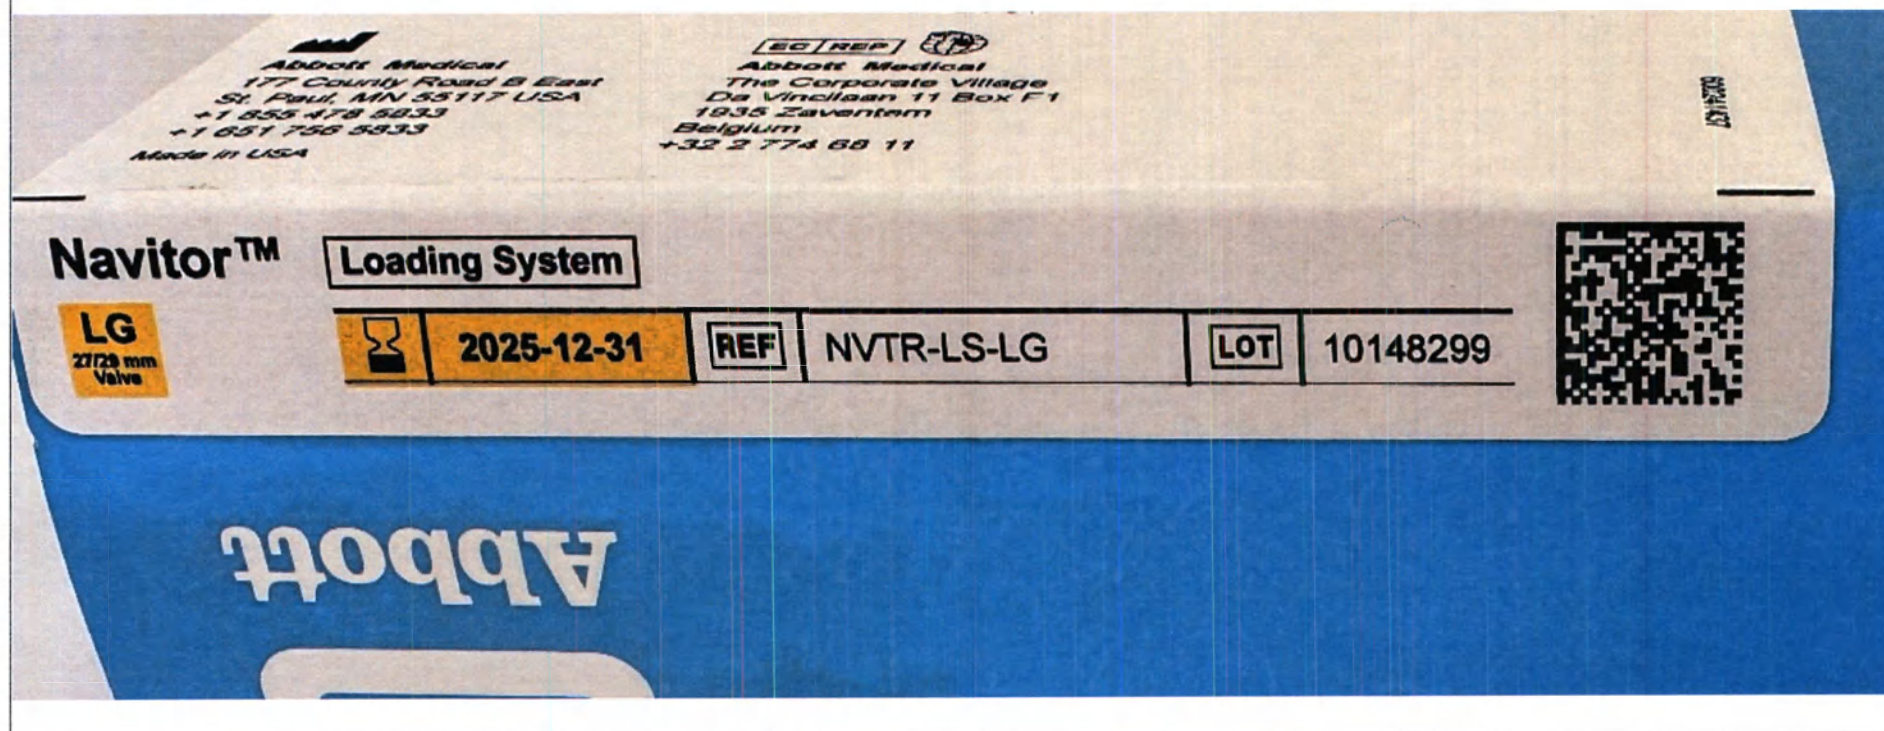



Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, все размеры. Потребительская упаковка. Маркировка, локальный стикер





**LG**  
27/29 mm  
Valve

**Navitor™**  
**Loading System**

(bg)Система за зареждане (ca)Medical system (de)Framingsystem (de)Ankagesystem  
(el)Σύστημα φόρτωσης (es)Sistema de carga (et)Ladimisüsteem (fi)Latausjärjestelmä (fr)Système de chargement (hr)Sustav za uvođenje (hu)Betöltőrendszer (it)Sistema di caricamento (lt)Statyimo sistema (lv)Iekārtas sistēma (mk)Система за носување (nl)Bedringsysteem (no)Lastesystem (pl)System wprowadzający (pt)Sistema de carregamento (ro)Sistem de încărcare (sk)Zavádzací systém (sr)Pomoćni sistem (tr)Sistem za uclavlanje (sv)Laddningssystem (vi)Yükleme Sistemi

UDI




(01)05415067038850(17)251231(10)10148299

|                                                                                   |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>2025-12-31</b>                                                                              |
| <b>REF</b>                                                                        | NVTR-LS-LG  |
| <b>LOT</b>                                                                        | 10148299                                                                                       |













 2024-01-09



 2797



**Abbott Medical**  
177 County Road B East  
St. Paul, MN 55117 USA  
+1 855 478 5833  
+1 651 768 5833  
Made in USA

**BC REP** 

**Abbott Medical**  
The Corporate Village  
De Vinolaan 11 Box F1  
1835 Zaventem  
Belgium  
+32 2 774 68 11

Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor, в комплекте поставки:  
Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor, в комплекте поставки:  
Защитная пленка: Система загрузки Navitor, размер LG

РП № 00006 от 00.00.00000

Резерв: см. на упаковке

Примечание: Abbott Medical (DSB) Medical, 177 County Road B E Saint Paul, MN 55117, USA

Наименование: Система загрузки Navitor, размер LG

Номер по каталогу (P/N): 00006

Срок годности (Sh): см. на упаковке

Срок годности (Ex): см. на упаковке

Информация об упаковке: упаковка в блистер из непрозрачного пластика, см. на упаковке

Материал: поликарбонат, см. на упаковке

Резерв: информация о резервном запасе см. в инструкции

1000 "Система загрузки Navitor" (P/N) 00006

100171, завод Navitor, завод Navitor, USA, стр. 1


Тип: АБС - 47449-238-42-001

Идентификационный номер

Идентификационный номер




Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Система загрузки Navitor, все размеры. Потребительская упаковка. Маркировка, локальный стикер

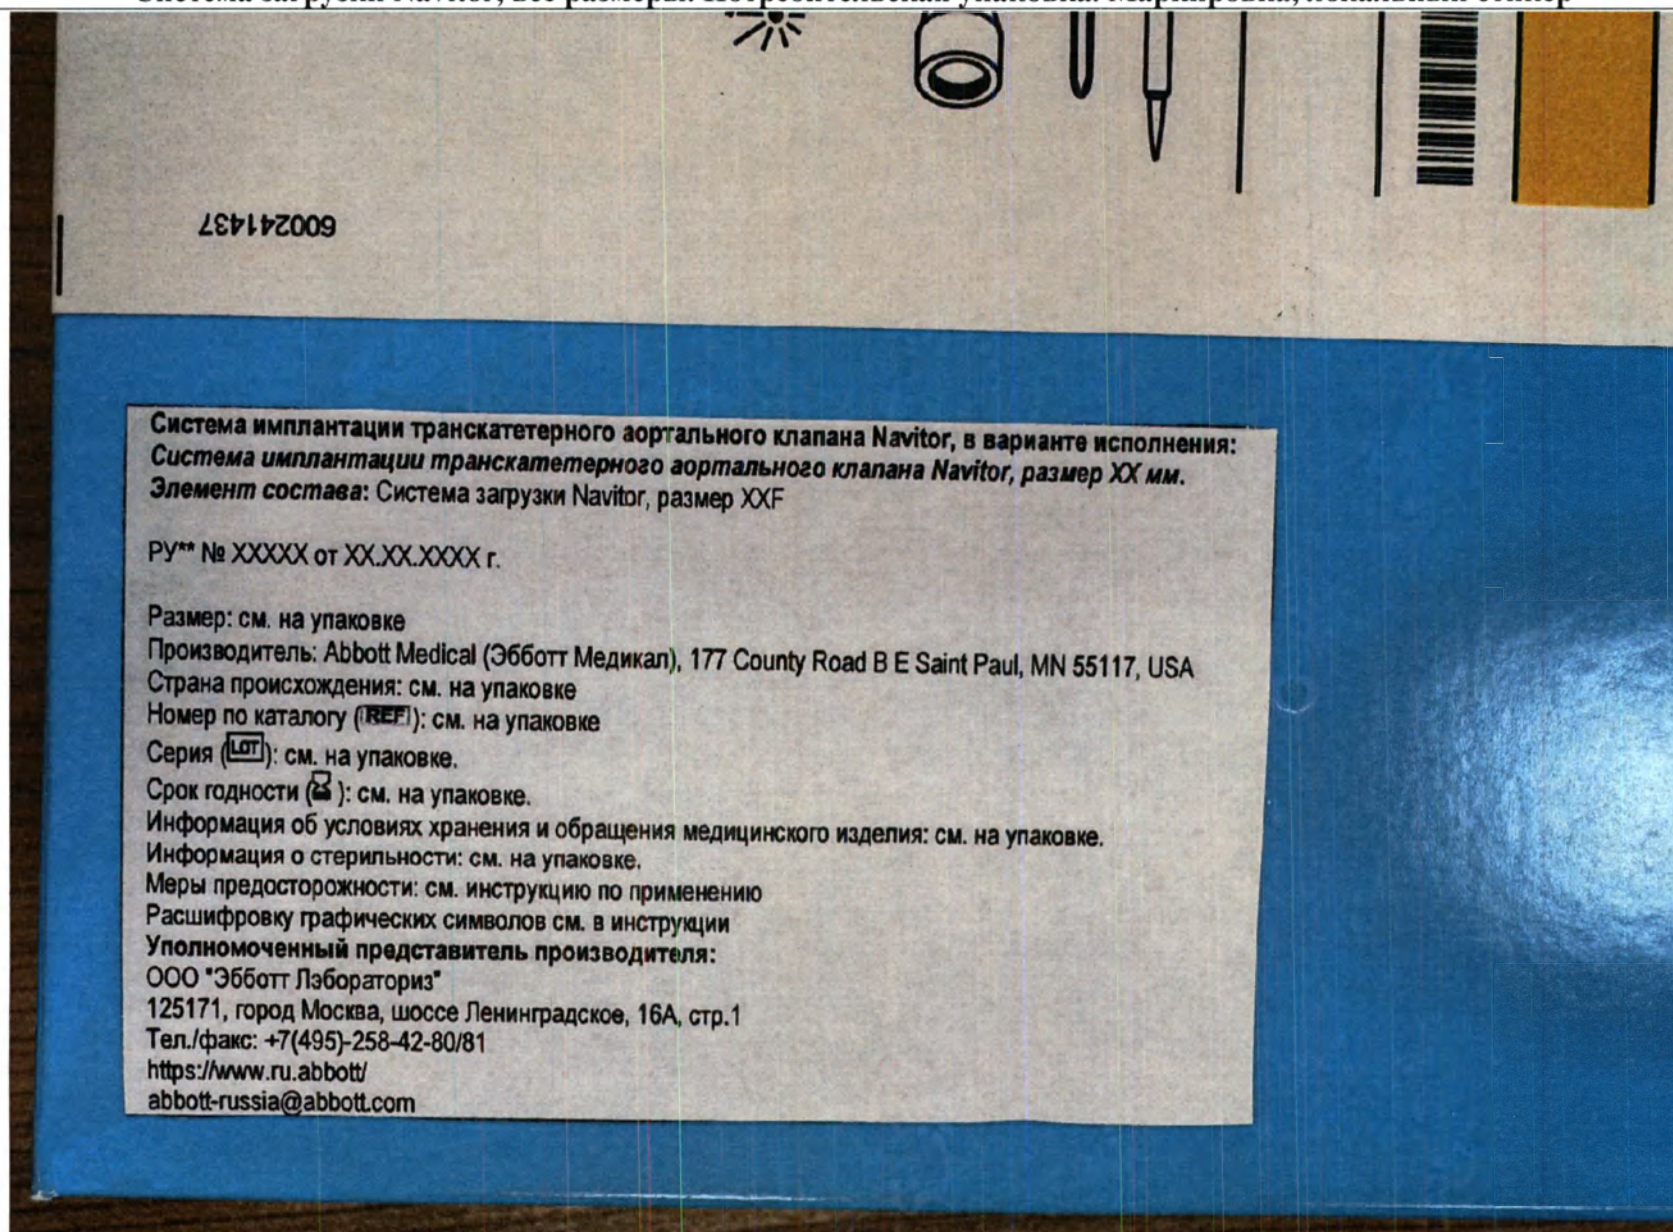



**Система имплантации транскатетерного аортального клапана Navitor.  
Транспортная упаковка. Маркировка.**

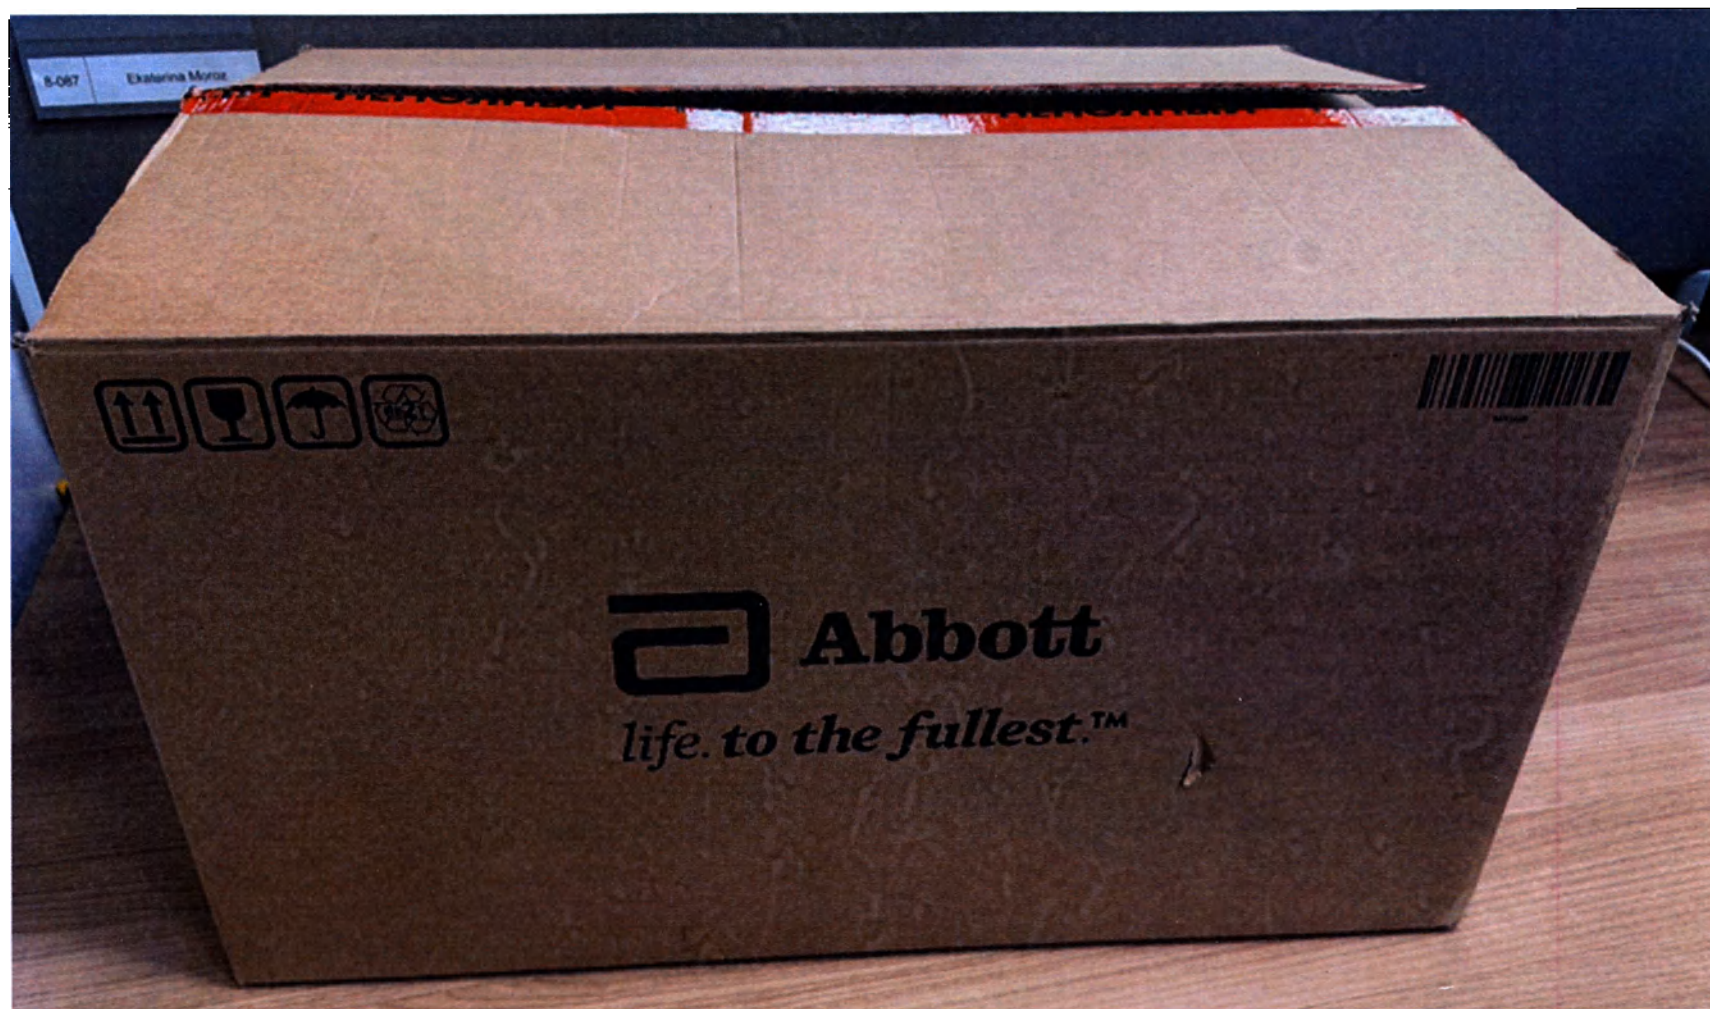





Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

48  
листов

Общество с ограниченной ответственностью  
«Эбботт Лэбораториз»

Менеджер по регуляторным вопросам  
Киселева А.А.