



Директор

ООО «Медика Продакт»

Е.М. Михалева

2024 г.

**Фотографические изображения медицинского изделия
«Сенсорные картриджи для полуавтоматического анализатора газов
крови и электролитов GASTAT-Pro, в различных вариантах
исполнения»**

производства «Техно Медика Ко., ЛТД.», Япония
(«Techno Medica Co., Ltd.», 5-5-1 Nakamachidai Tsuzuki-ku, Yokohama,
Kanagawa, JAPAN; Тел.: +81-45-948-1967.


Факс: +81-45-948-1962, E-mail: overseas@technomedica.co.jp).



Сенсорные картриджи GASTAT-Pro Sensor Card P1



Сенсорные картриджи GASTAT-Pro Sensor Card P2

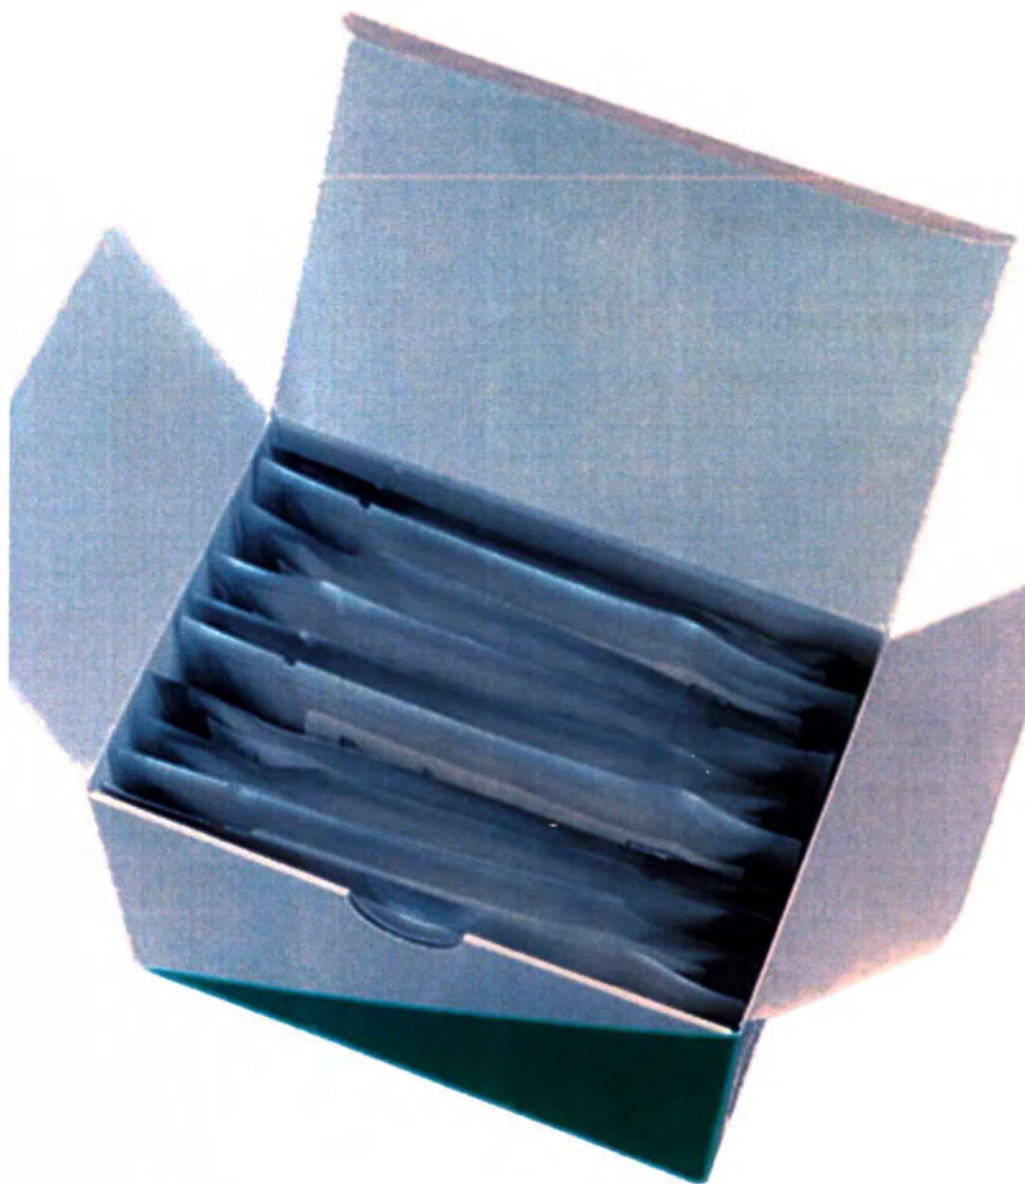

Сенсорные картриджи GASTAT-Pro Sensor Card P3

	Инструкция по применению	GASTAT-Pro Sensor Card	Стр. 1
---	--------------------------	---------------------------	--------

УТВЕРЖДАЮ / APPROVED

CEO

(designation/position)

Masatomo Saneyoshi

(Name)

«Techno Medica Co., Ltd.»

(signature)

М.П./Stamp

_____.20__

Инструкция по применению

(User manual)

Сенсорные картриджи для полуавтоматического анализатора газов крови и электролитов GASTAT-Pro, в различных вариантах исполнения



 **Techno Medica**

Techno Medica Co., Ltd.

5-5-1 Nakamachidai Tsuzuki-ku,
Yokohama, Kanagawa, JAPAN

Инструкция по применению



Маркировка сенсорных картриджей GASTAT-Pro Sensor Card P1




Маркировка сенсорных картриджей GASTAT-Pro Sensor Card P2



Маркировка сенсорных картриджей GASTAT-Pro Sensor Card P3

Сенсорные картриджи GASTAT-Pro Sensor Card P1 для полуавтоматического анализатора газов крови и электролитов GASTAT-Pro		QR
REF	LOT	
Состав: Сенсорные картриджи GASTAT-Pro Sensor Card P1 – 10 шт. уп. Инструкция по применению – 1 шт.		
 Techno Medica Co., Ltd. 5-5-1 Nakamachidai Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan		
Официальный представитель в России: ООО «Медика Продакт» 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.27 +7 342 270-08-02 moscow@westmedica.com , perm@westmedica.com		
МАССА НЕТТО ____ г	IVD CE	 RU №
МАССА БРУТТО ____ г		

Шаблон маркировки упаковки сенсорных картриджей GASTAT-Pro Sensor Card P 1

Сенсорные картриджи GASTAT-Pro Sensor Card P2 для полуавтоматического анализатора газов крови и электролитов GASTAT-Pro		
REF	LOT	Состав: Сенсорные картриджи GASTAT-Pro Sensor Card P2 – 10 шт. уп. Инструкция по применению – 1 шт.
 Techno Medica Co., Ltd. 5-5-1 Nakamachidai Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan Официальный представитель в России: ООО «Медика Продакт» 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.27 +7 342 270-08-02 moscow@westmedica.com, perm@westmedica.com		
МАССА НЕТТО ____ г      10  		
МАССА БРУТТО ____ г     10  		
		

Шаблон маркировки упаковки сенсорных картриджей GASTAT-Pro Sensor Card P 2

Сенсорные картриджи GASTAT-Pro Sensor Card P3 для полуавтоматического анализатора газов крови и электролитов GASTAT-Pro		
REF	LOT	Состав: Сенсорные картриджи GASTAT-Pro Sensor Card P3 – 10 шт. уп. Инструкция по применению – 1 шт.
 Techno Medica Co., Ltd. 5-5-1 Nakamachidai Tsuzuki-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan Официальный представитель в России: ООО «Медика Продакт» 614000, Пермский край, г. Пермь, ул. Газеты Звезда, д.27 +7 342 270-08-02 moscow@westmedica.com, perm@westmedica.com		
МАССА НЕТТО ____ г      10  		
МАССА БРУТТО ____ г     10  		
		

Шаблон маркировки упаковки сенсорных картриджей GASTAT-Pro Sensor Card P 3



Шаблон маркировки первичной упаковки сенсорных картриджей GASTAT-Pro Sensor Card

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью
лист(-ах/-е) бумаги

Михалева Е. М., Директор

