

Фотографические изображения медицинского изделия  
***Система автоматическая микробиологическая серии ВС для in vitro диагностики, в вариантах исполнения***

УТВЕРЖДАЮ


Руководитель департамента регистрации ООО «ИЛС»

Стариковская И.А.


«15»  2024 г.




Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики  
(Основной блок системы автоматической микробиологической ВС60 – 1 шт: Вид спереди)

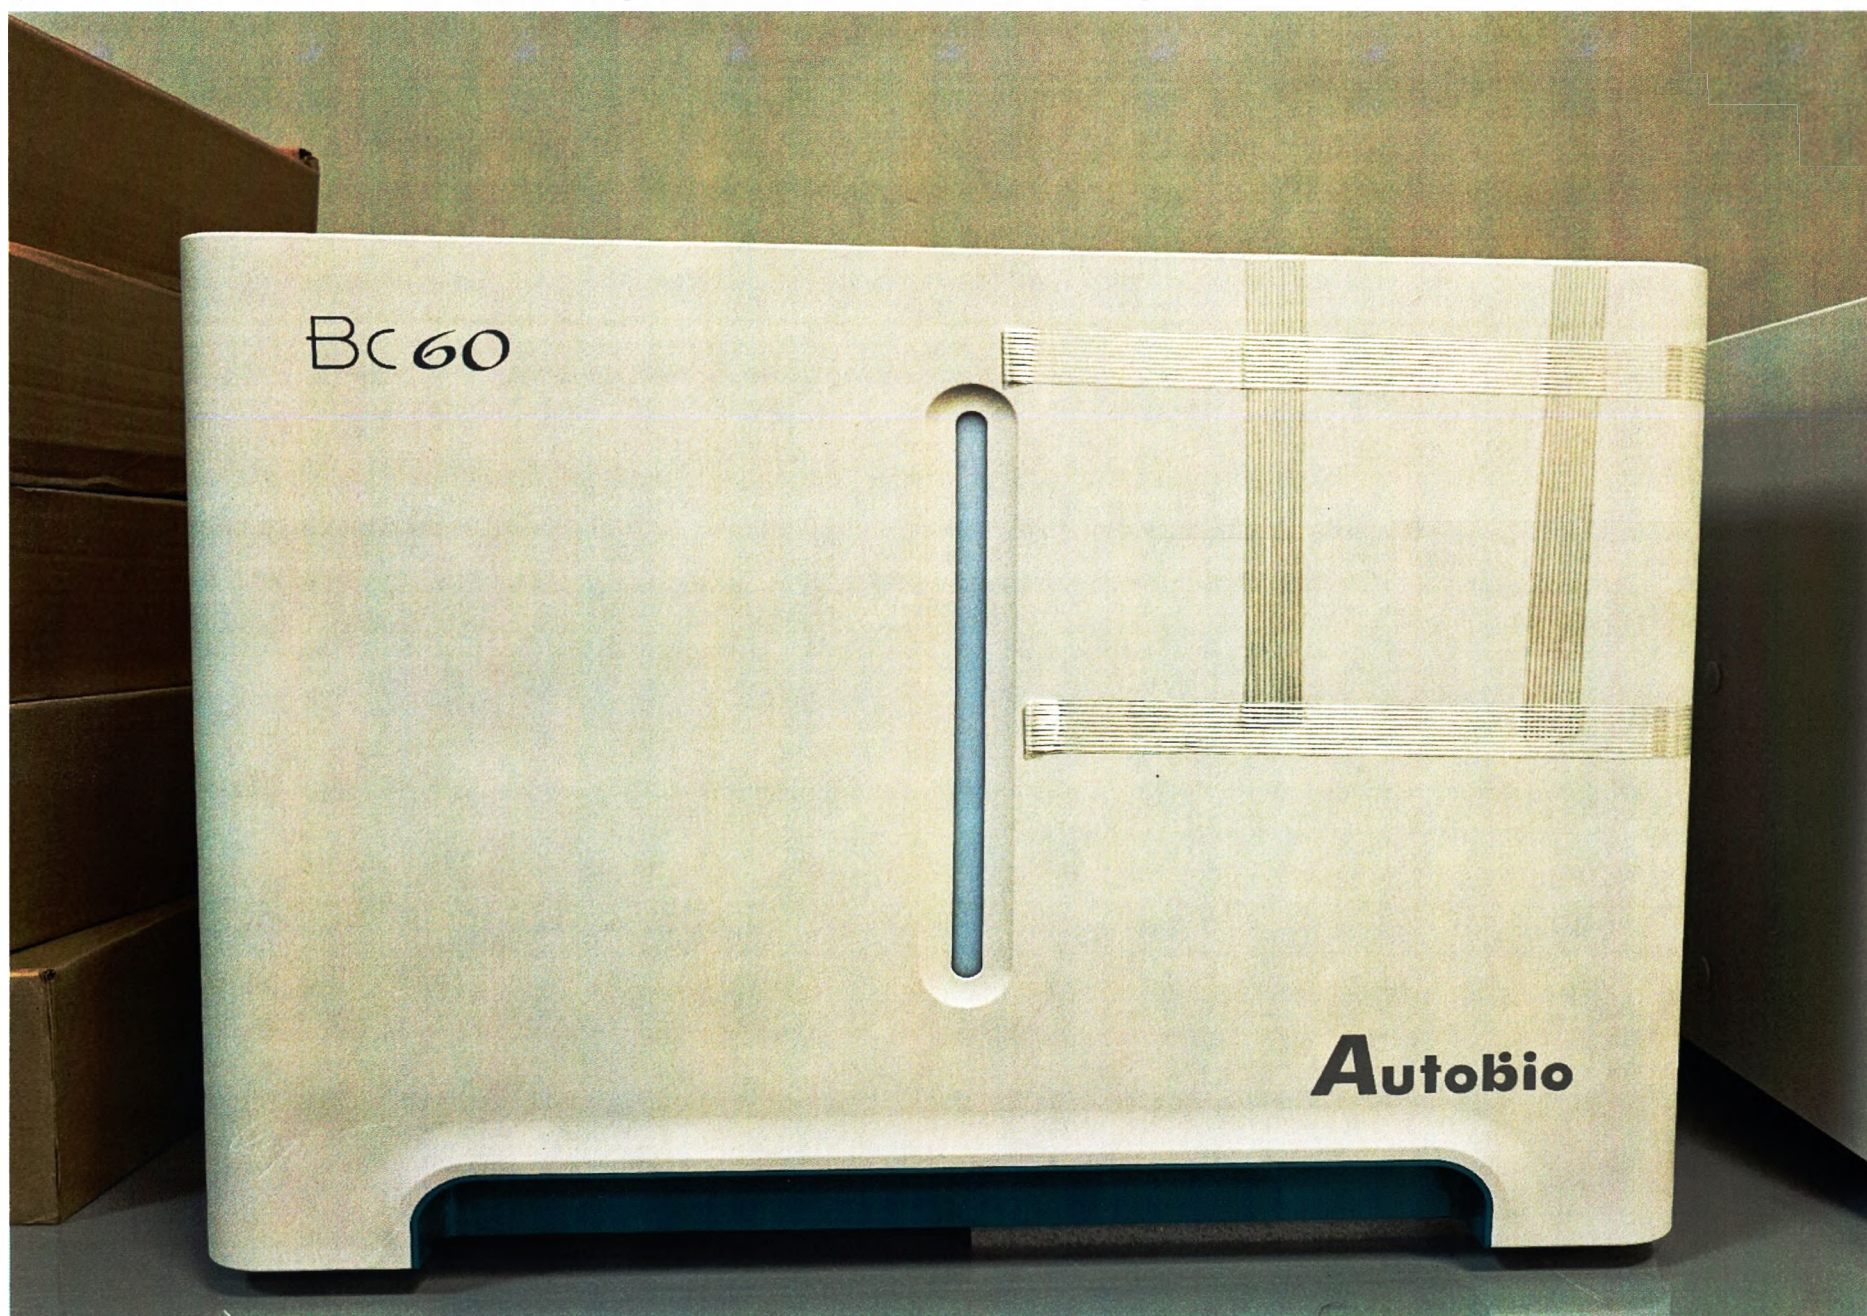


**Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики  
(Основной блок системы автоматической микробиологической ВС60 – 1 шт: Вид сбоку)**

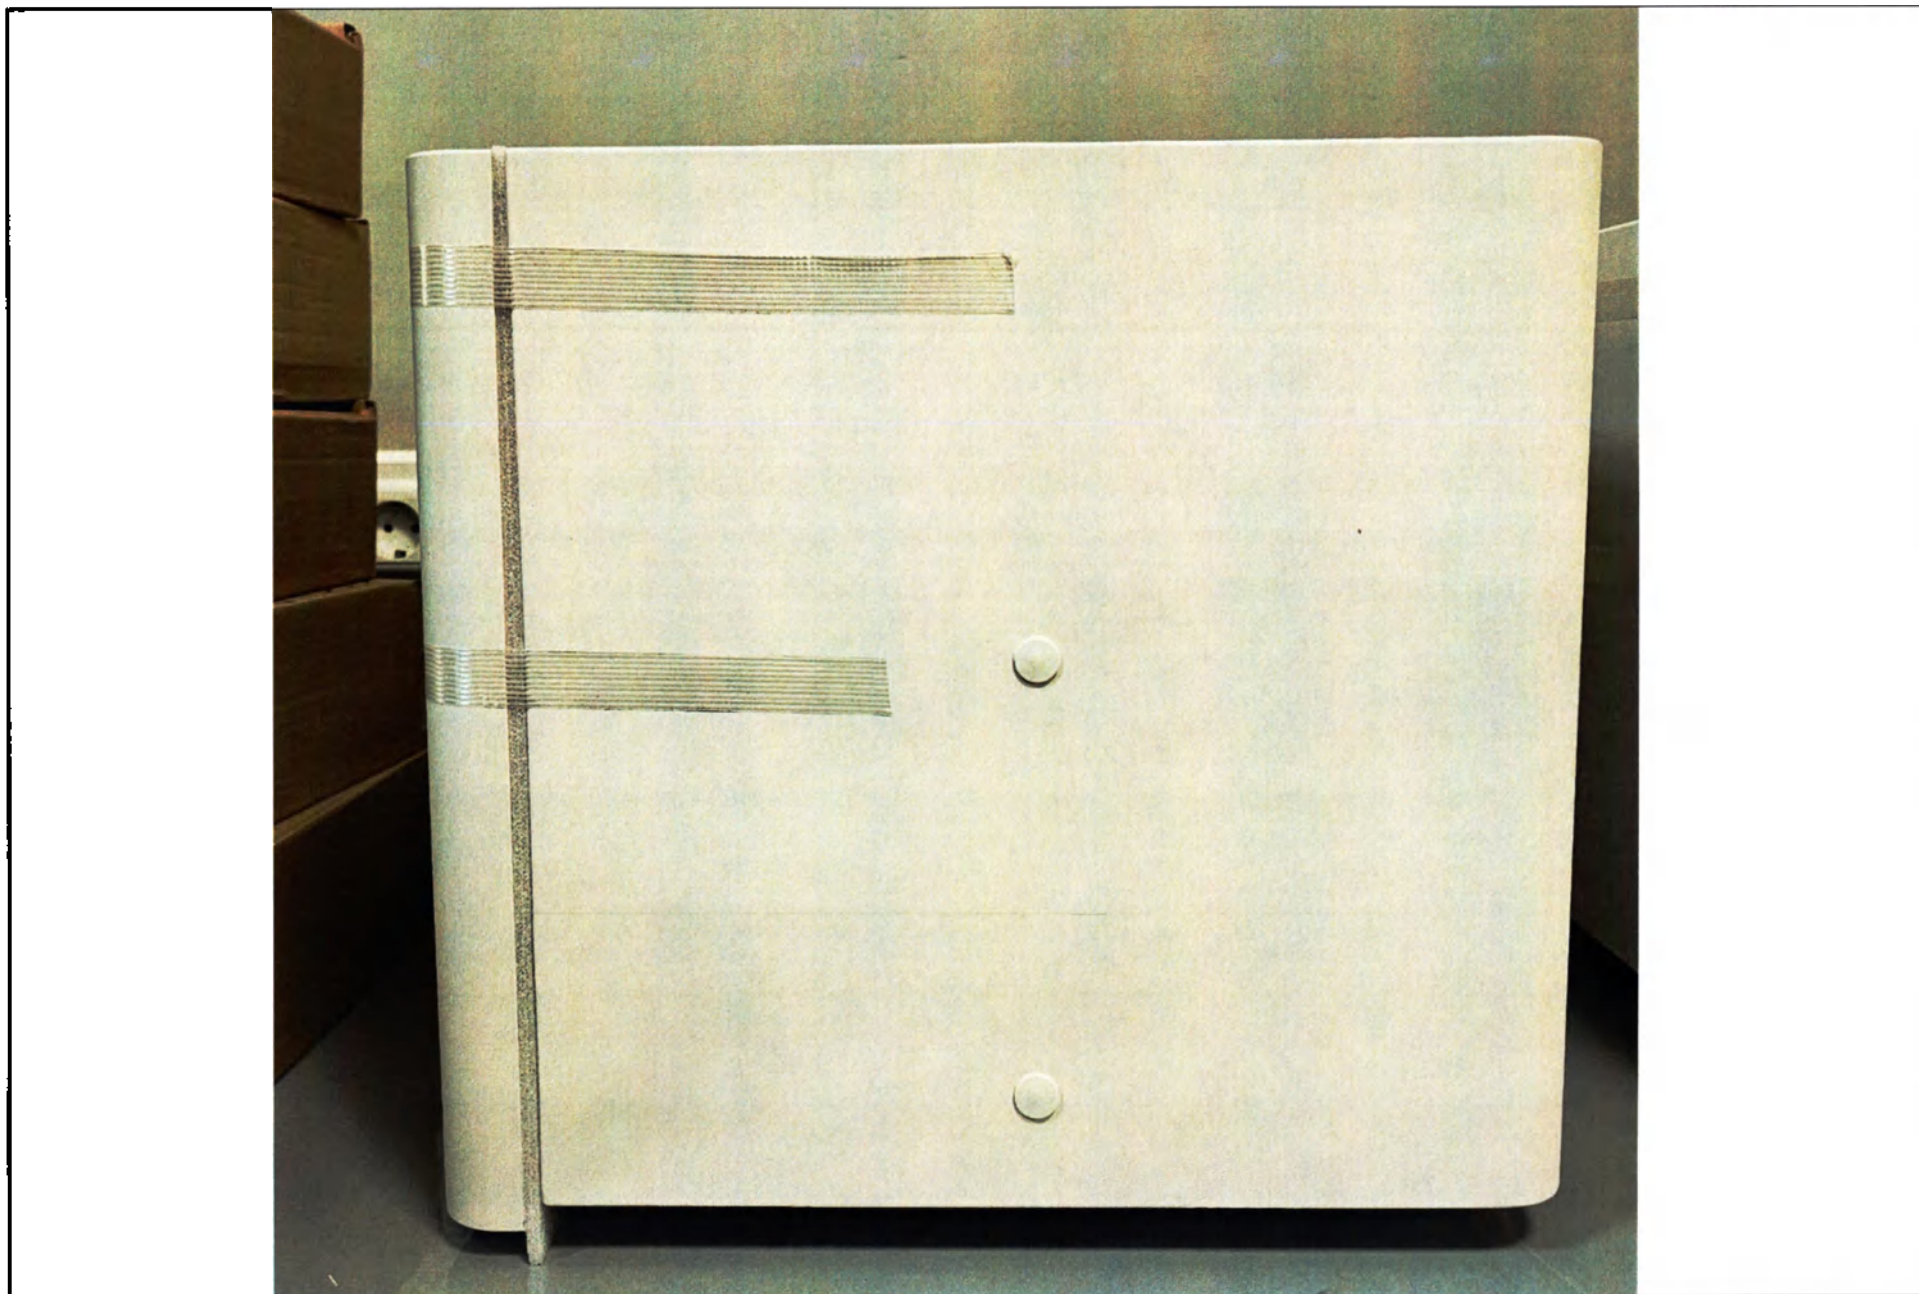

Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики  
(Основной блок системы автоматической микробиологической ВС60 – 1 шт: Вид сзади)

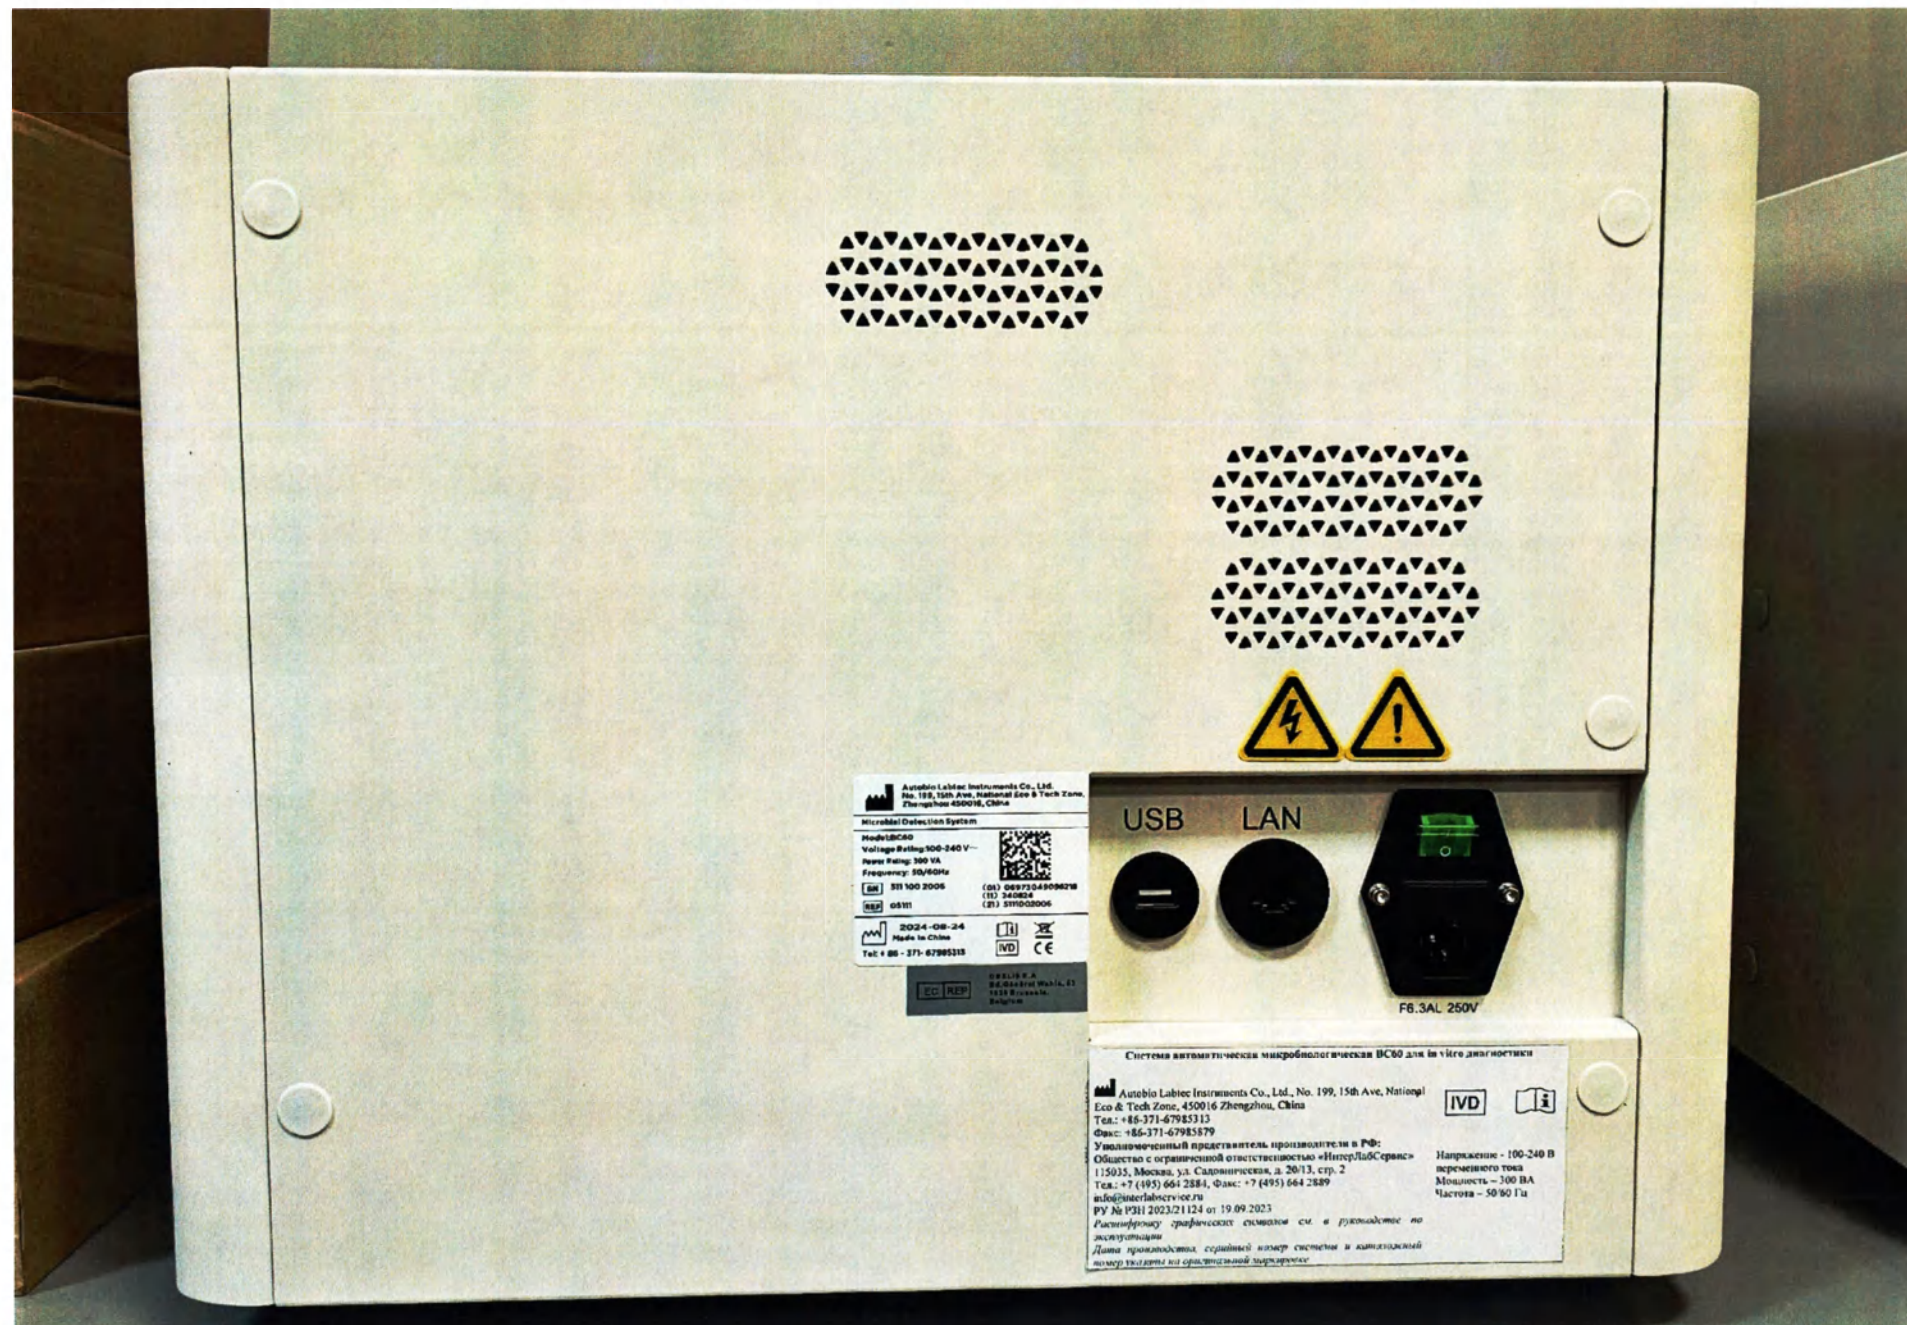

Пример оригинальной маркировки и дополнительной маркировки на русском языке системы автоматической микробиологической BC60 для in vitro диагностики

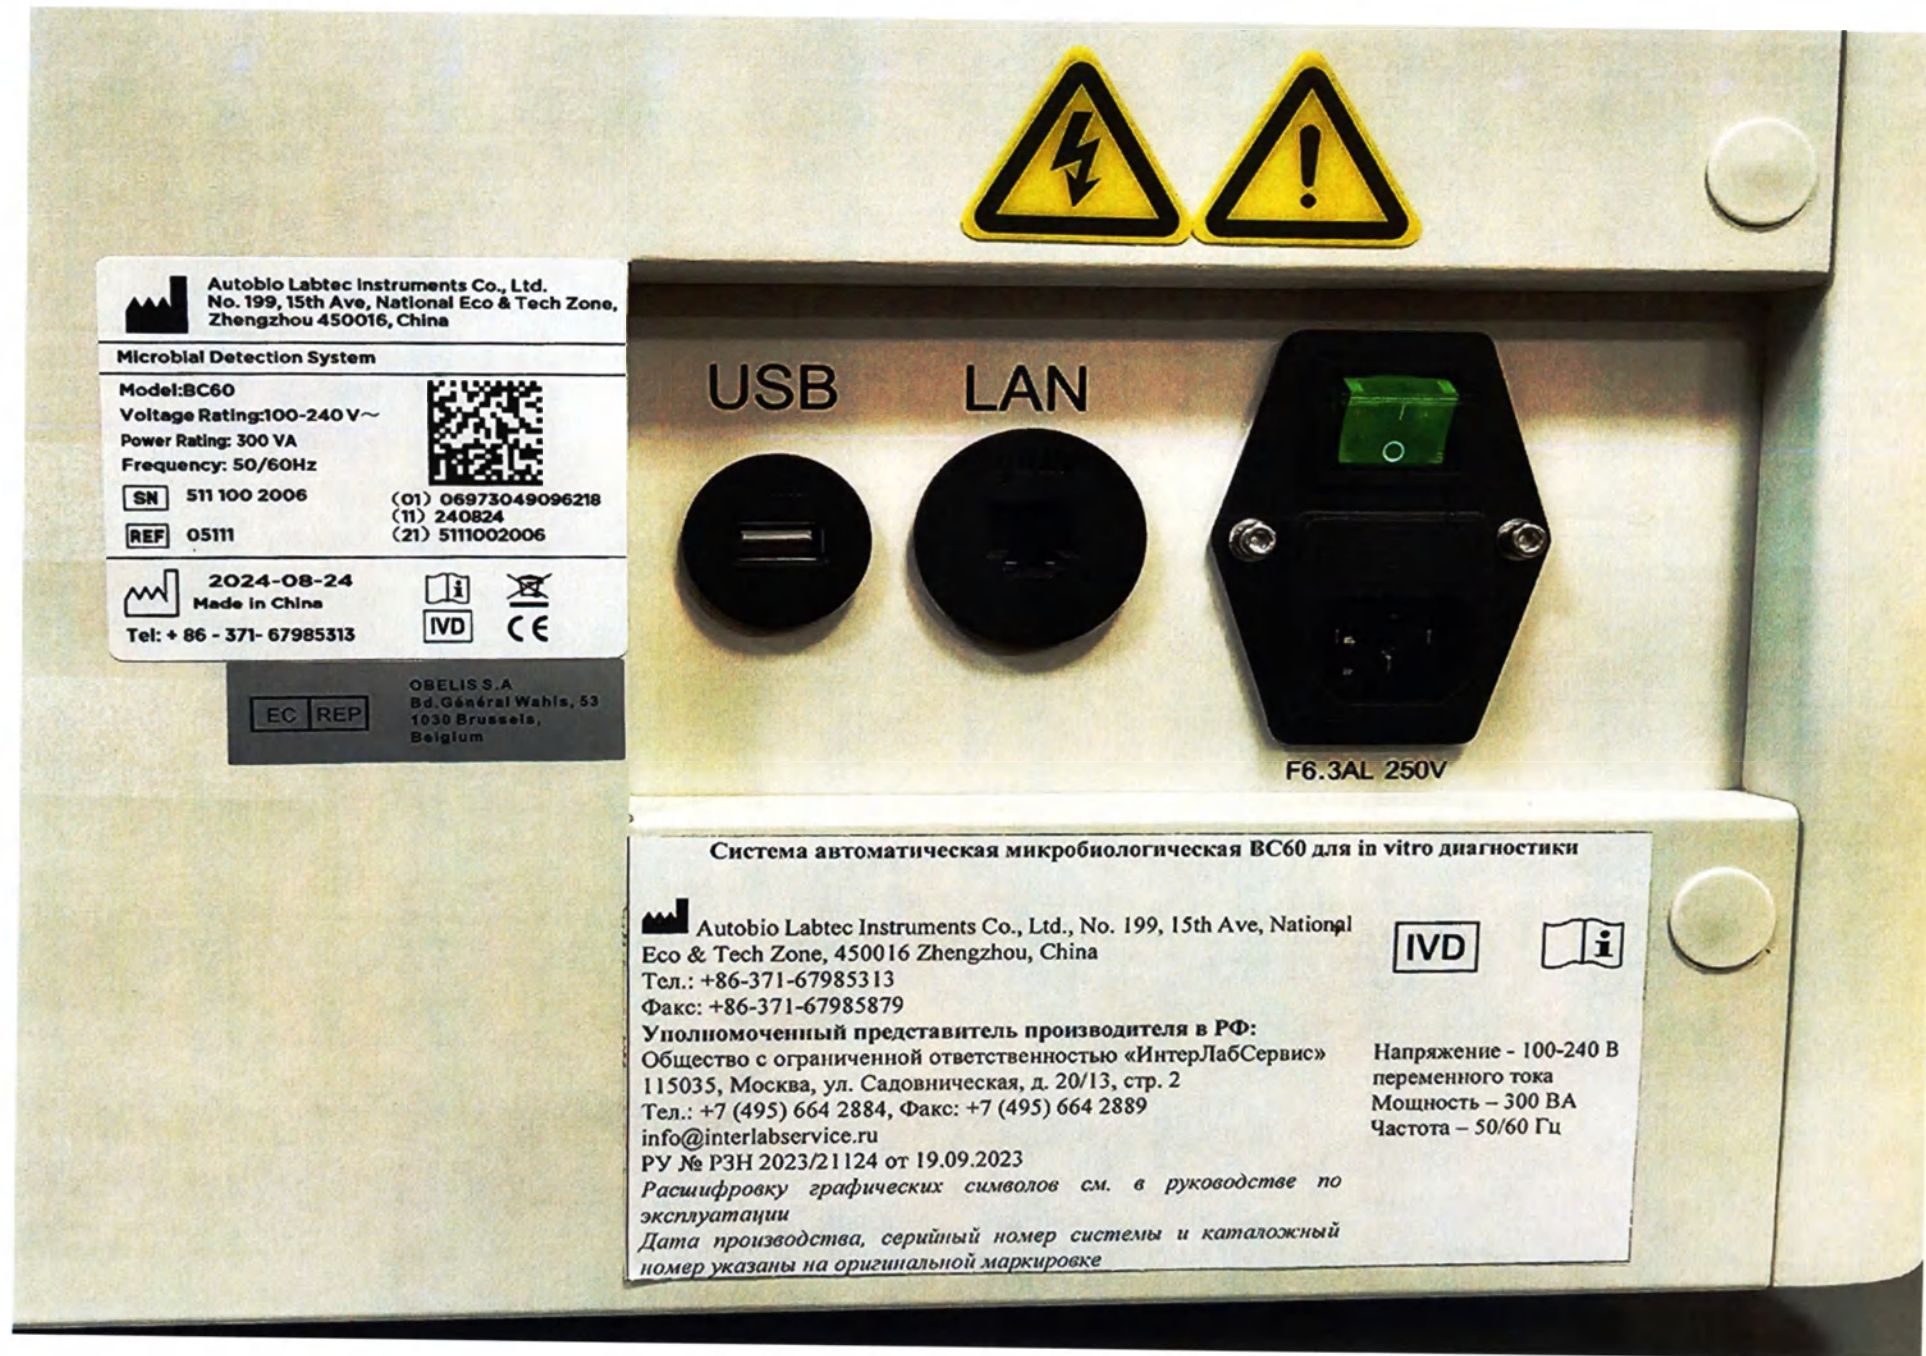

Пример оригинальной маркировки системы автоматической микробиологической BC60 для in vitro диагностики



**Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.**  
No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone,  
Zhengzhou 450016, China

**Microbial Detection System**

**Model:BC60**

**Voltage Rating:100-240 V~**

**Power Rating: 300 VA**

**Frequency: 50/60Hz**



**SN** 511 100 2006

(01) 06973049096218

(11) 240824

**REF** 05111



(21) 5111002006



**2024-08-24**

**Made in China**

**Tel: + 86 - 371- 67985313**



**EC**

**REP**

**OBELIS S.A**  
Bd. Général Wahls, 53  
1030 Brussels,  
Belgium

Система автоматическая микробиологическая ВС60 для *in vitro* диагностики



Autobio Labtec Instruments Co., Ltd., No. 199, 15th Ave, National  
Eco & Tech Zone, 450016 Zhengzhou, China

Тел.: +86-371-67985313

Факс: +86-371-67985879



Уполномоченный представитель производителя в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЛабСервис»

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2

Тел.: +7 (495) 664 2884, Факс: +7 (495) 664 2889

info@interlabservice.ru

РУ № РЗН XXXX/XXXXX от \_\_\_\_\_.

*Расшифровку графических символов см. в руководстве по эксплуатации*

*Дата производства, серийный номер системы и каталожный номер указаны на оригинальной маркировке*

Напряжение - 100-240 В

переменного тока

Мощность – 300 ВА

Частота – 50/60 Гц

Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики. Транспортная упаковка.



Система автоматическая микробиологическая BC60 для in vitro диагностики. Маркировка транспортной упаковки.

Система автоматическая микробиологическая BC60 для in vitro диагностики

REF

05111

IVD



SN

511 100 2006



2024-08-24



Autobio Labtec Instruments Co., Ltd., No. 199, 15th Ave,  
National Eco & Tech Zone, Zhengzhou 450016, China

Тел.: +86-371-67985313

Факс: +86-371-67985879

www.autobio.com.cn

Адрес производства:

Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.,  
No. 199, 15th Ave, National Eco &  
Tech Zone, 450016 Zhengzhou,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Уполномоченный представитель производителя Масса нетто 43 кг  
в РФ:

Общество с ограниченной ответственностью Масса брутто 56 кг  
«ИнтерЛабСервис»

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2

Тел.: +7 (495) 664 2884, Факс: +7 (495) 664 2889

info@interlabservice.ru

РУ № РЗН 2023/21124 от 19.09.2023 г.

Расшифровку графических символов см. в  
инструкции



Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Кабель питания – 1 шт.)





Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.  
No. 199, 15<sup>th</sup> Ave, National Eco & Tech Development Area  
Zhengzhou, China, 450016  
Tel.: +86-371-67985313 e-mail: info@autobio-diagnostics.com  
website: en.autobio.com.cn

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /  
OPERATING MANUAL

Система автоматическая микробиологическая BC60 для in vitro диагностики /  
Automatic microbiological system BC60 for in vitro diagnostics

Производитель / Manufacturer  
«Аутобио Лабтек Инструментс Ко., Лтд.» /  
Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.


Версия для Российской Федерации 1.3  
Version for Russian Federation 1.3

Система автоматическая микробиологическая BC60 для in vitro диагностики (Руководство по эксплуатации — 1 шт.)

Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (LAN кабель (сетевой шнур) – 1 шт.)




Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Калибровочный стержень – не более 10 шт.)

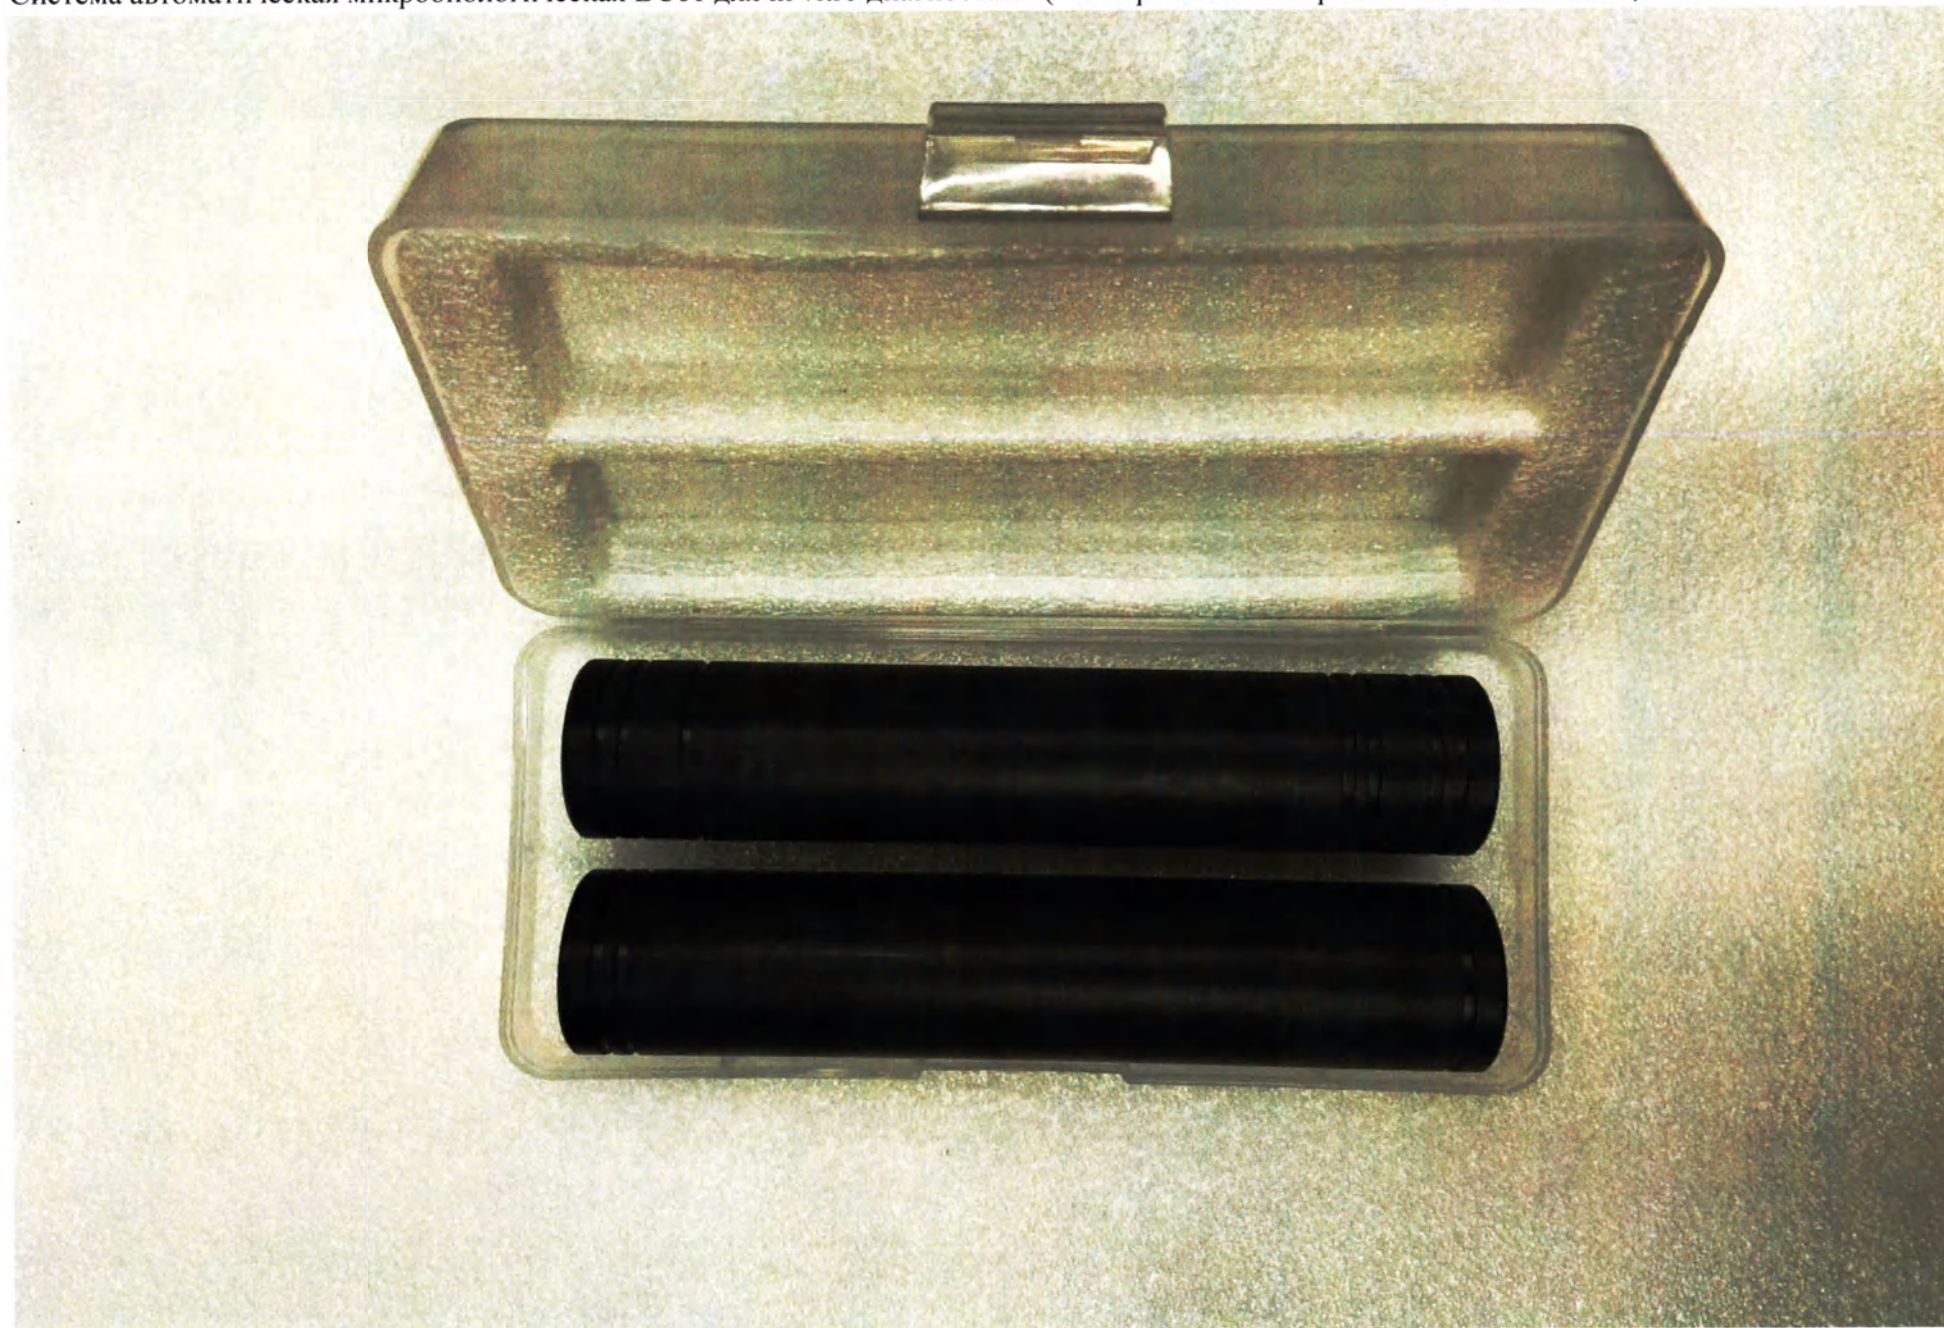

**Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Предохранитель – 2 шт.)**



Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Планшетный ПК – 1 шт.)

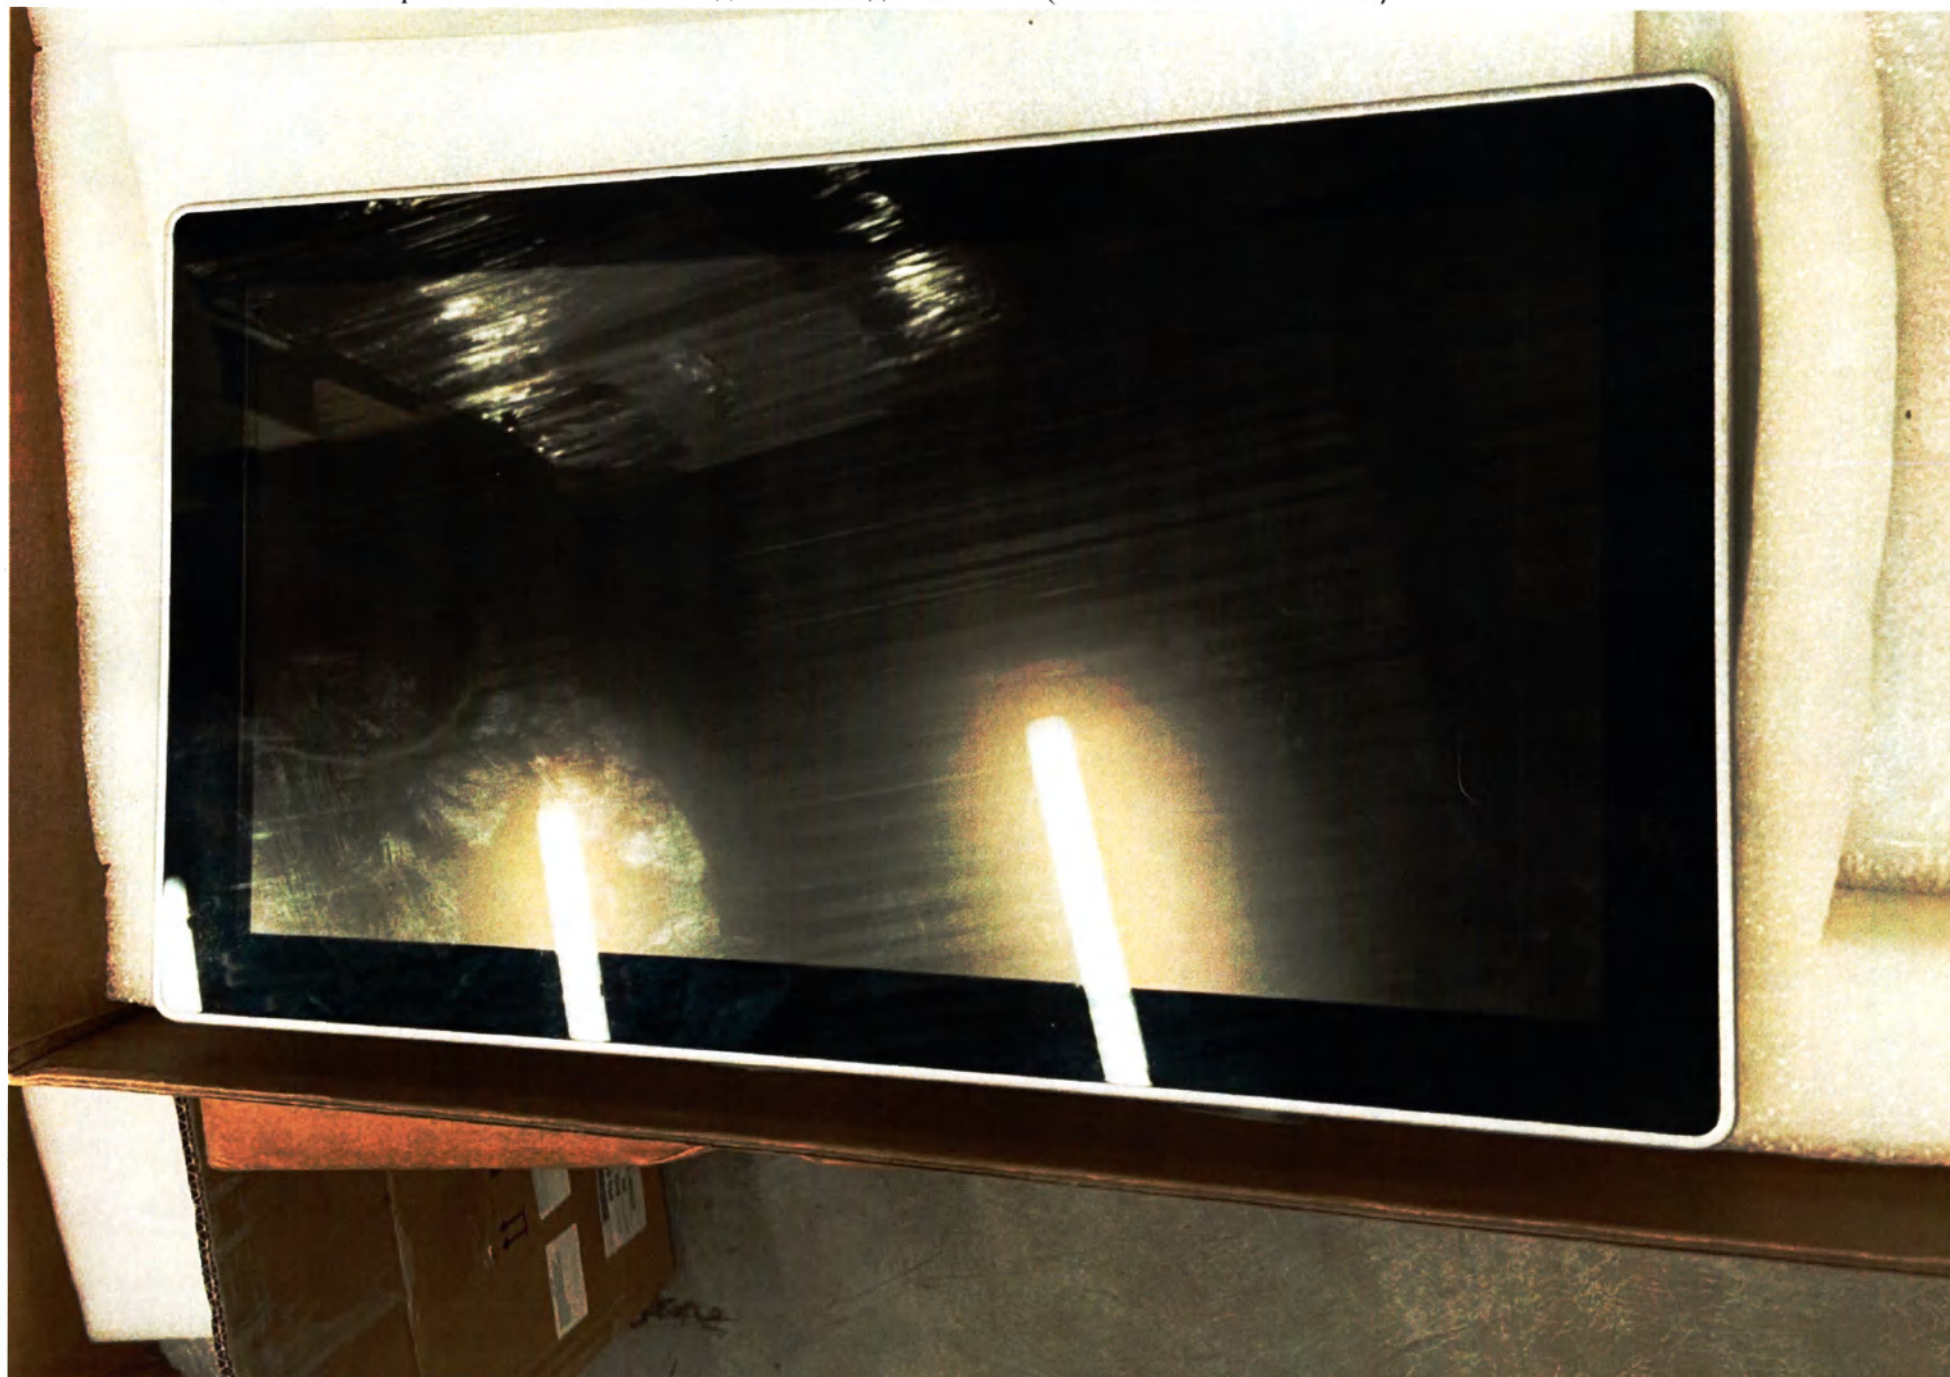


Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Блок питания планшетного ПК – 1 шт.)



Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Кабель питания блока питания планшетного ПК– 1 шт.)



Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Клеммная колодка - 1 шт.)

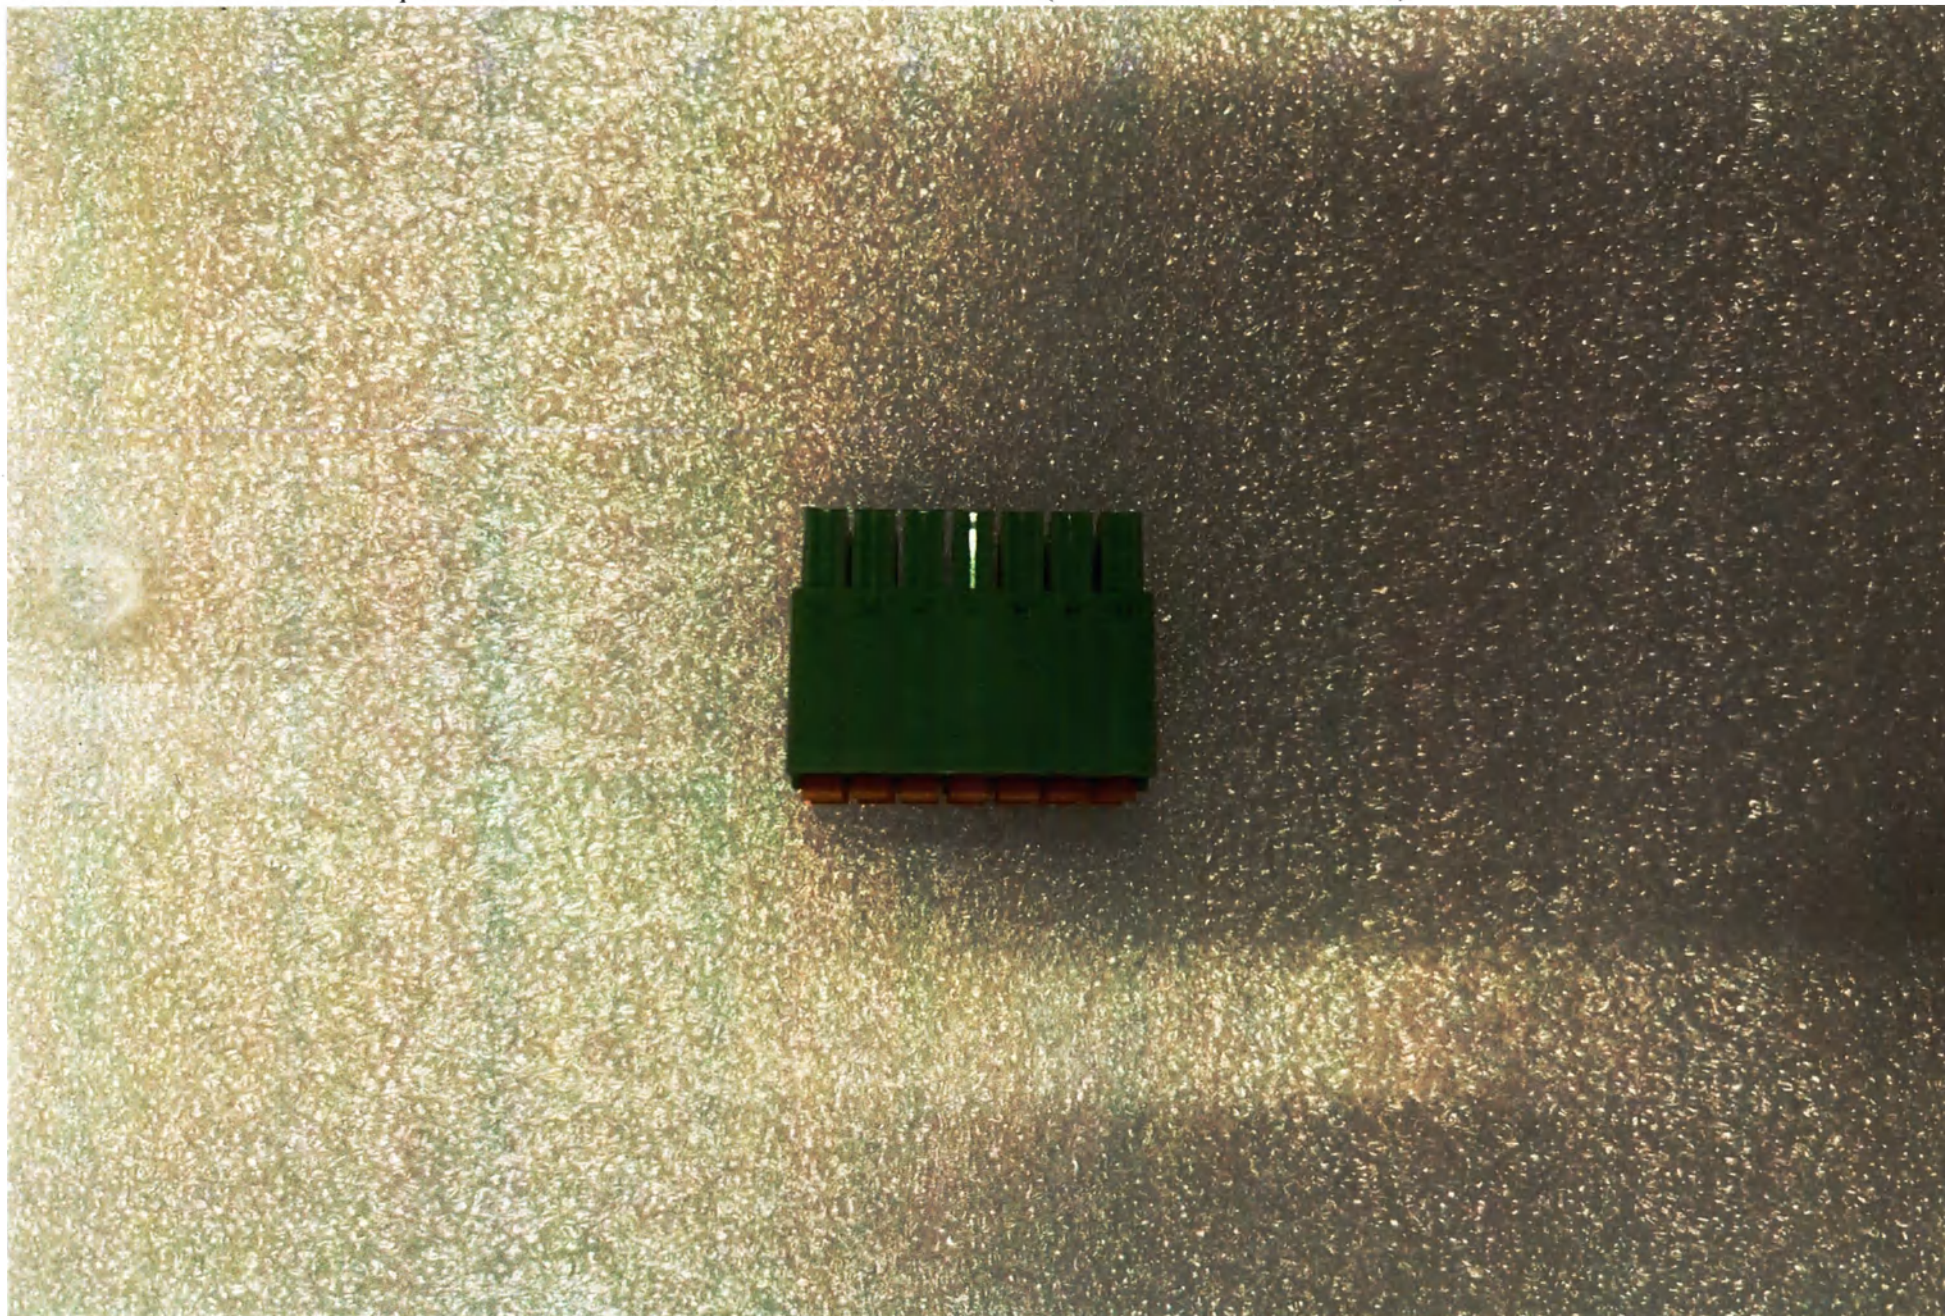


Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Кронштейн для планшетного ПК – 1 шт.)



Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Шестигранный ключ с поперечной рукояткой – 1 шт.)



Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Г-образный шестигранный ключ с поперечной рукояткой – 1 шт.)

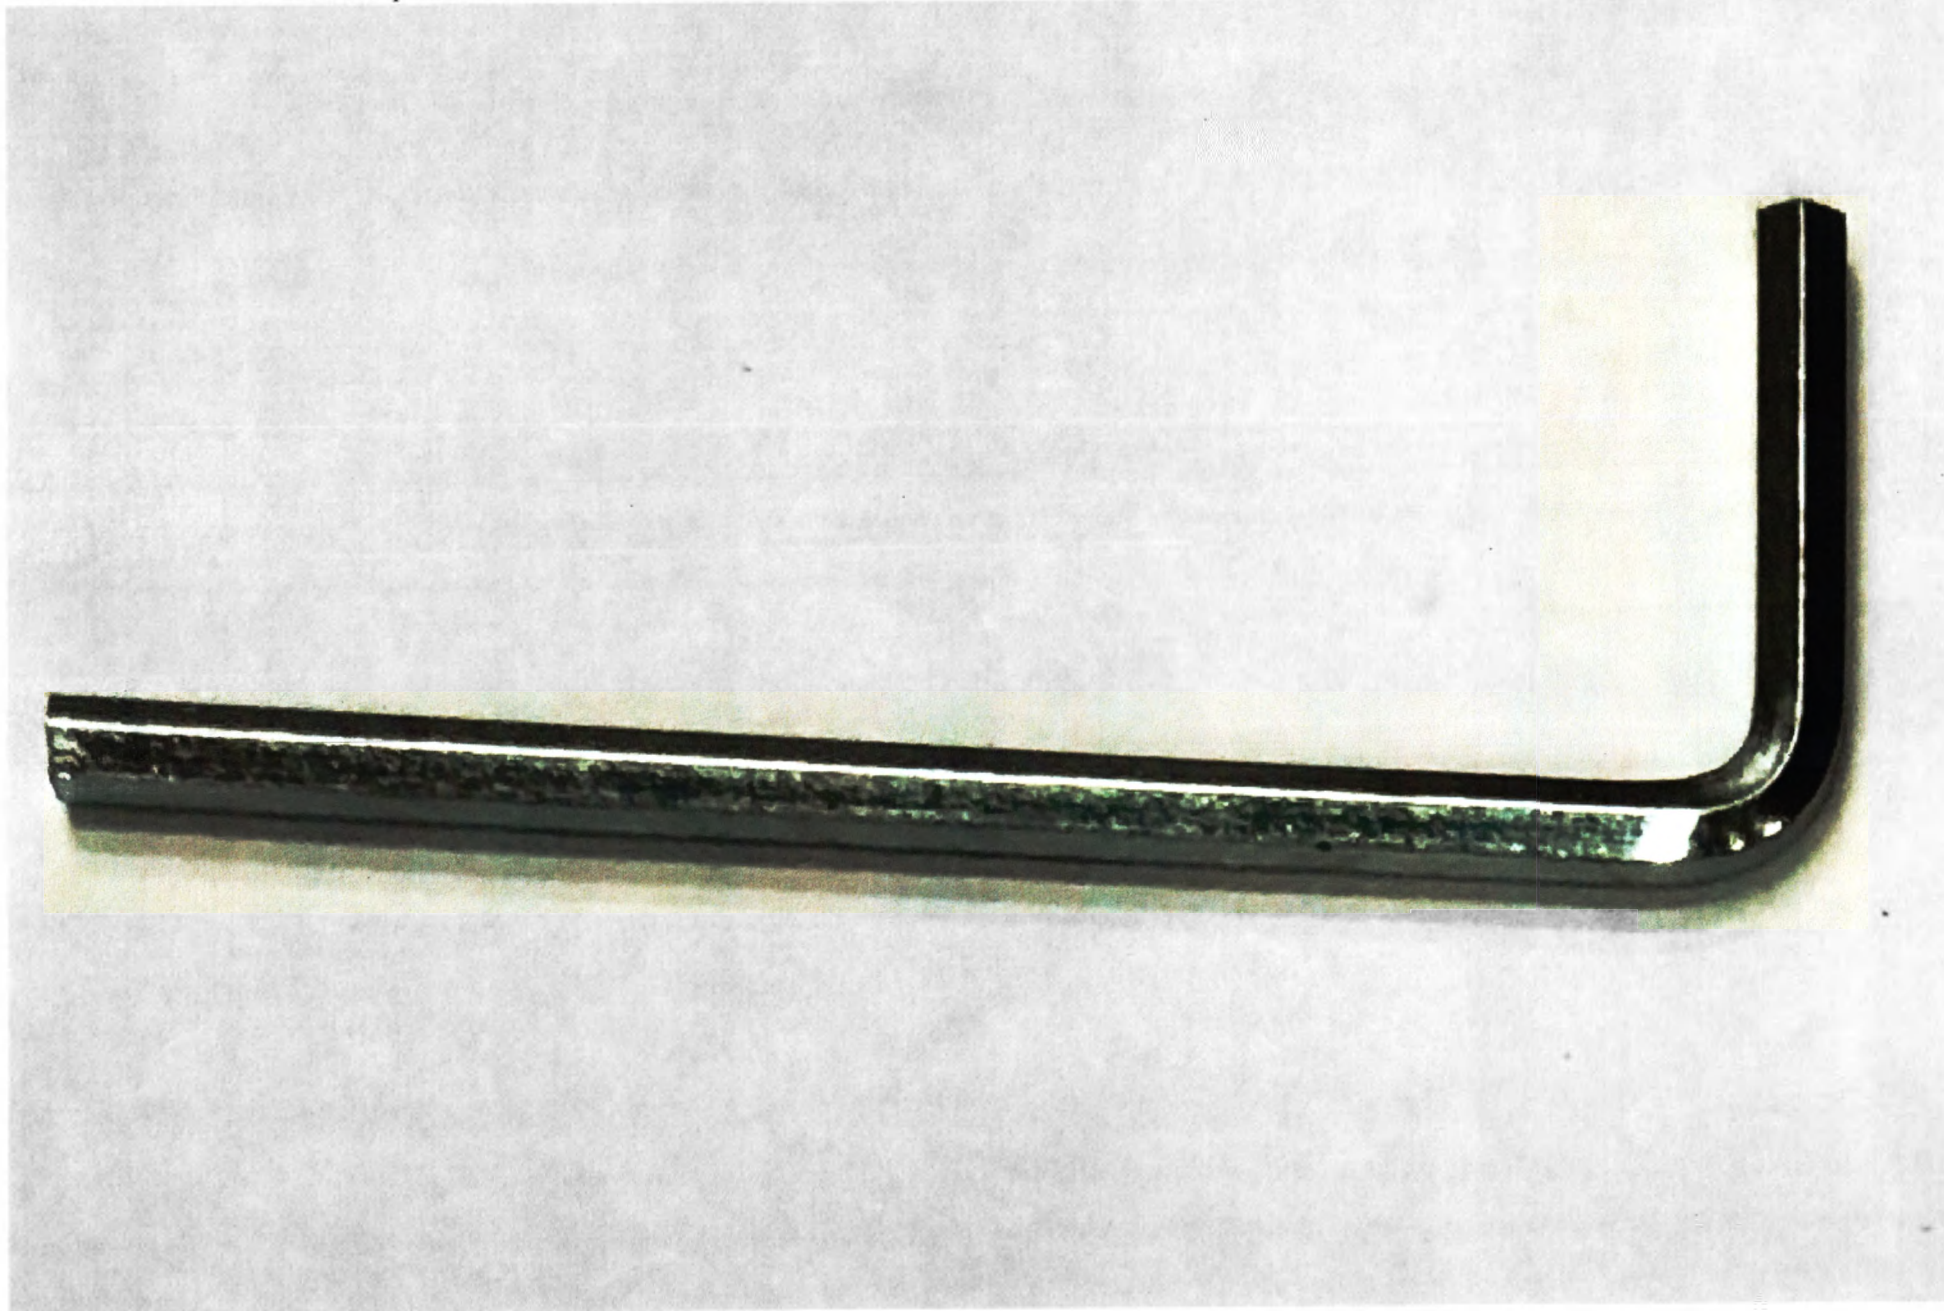

Система автоматическая микробиологическая ВС60 для *in vitro* диагностики (Набор для установки кронштейна планшетного ПК на стену, в составе: Дюбель – 2 шт.; Крепежный шуруп – 2 шт.; Крепежный винт – 4 шт.; Винт с металлической шайбой – 4 шт.; Винт – 2 шт.; Резиновая прокладка округлой формы – 2 шт.; Пластиковые заглушки кронштейна для планшетного ПК – 2 шт.; Металлическая шайба – 2 шт.)




Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Сканер штрих-кодов – 1 шт.)




Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Подставка для сканера - 1 шт.)



Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (USB-шнур – 1 шт )

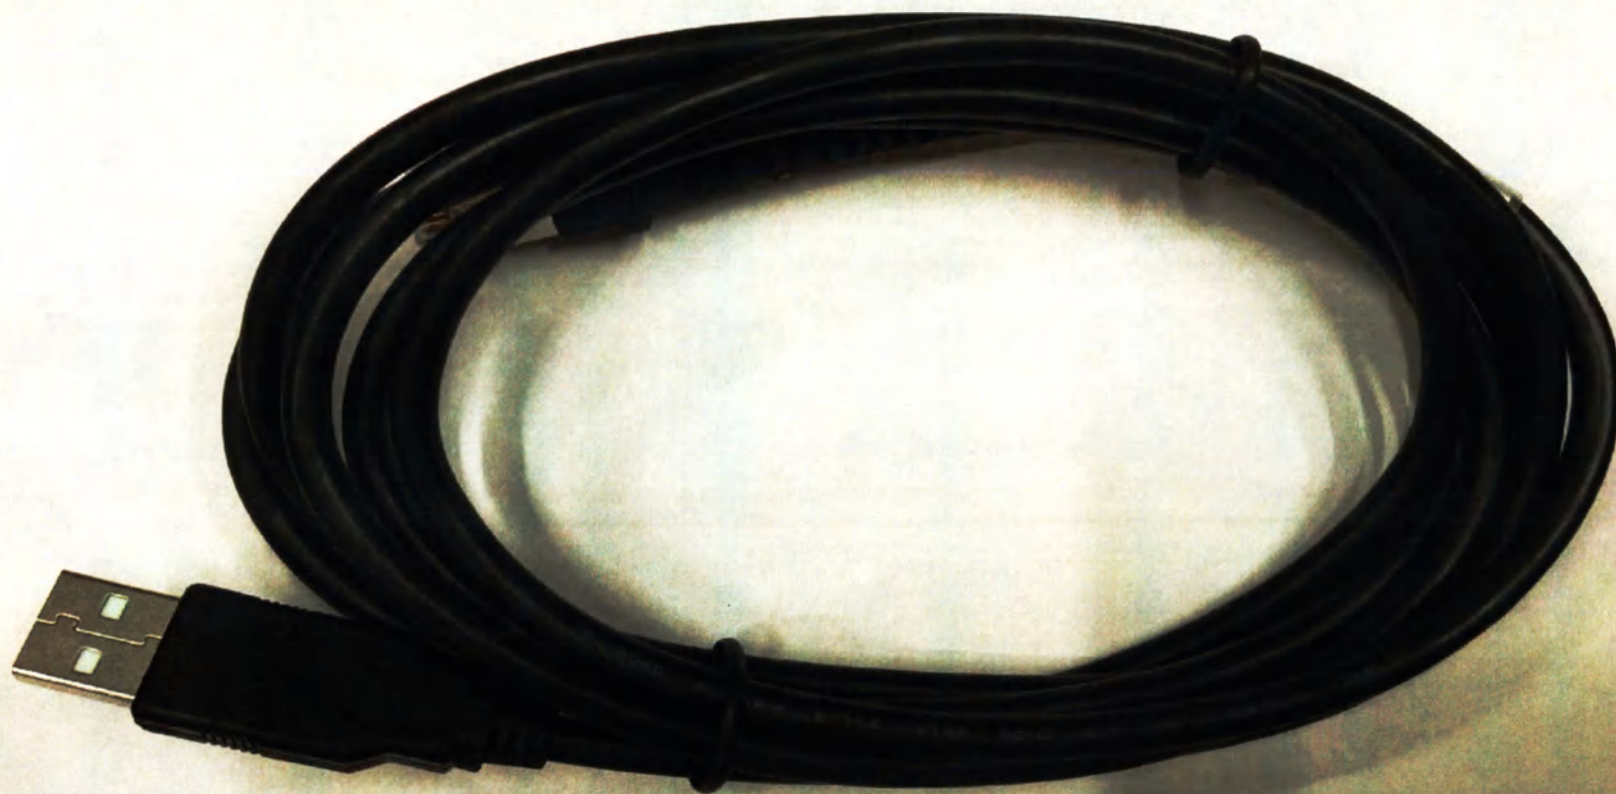

Система автоматическая микробиологическая ВС60 для in vitro диагностики (Фиксирующая рейка – 1 шт )

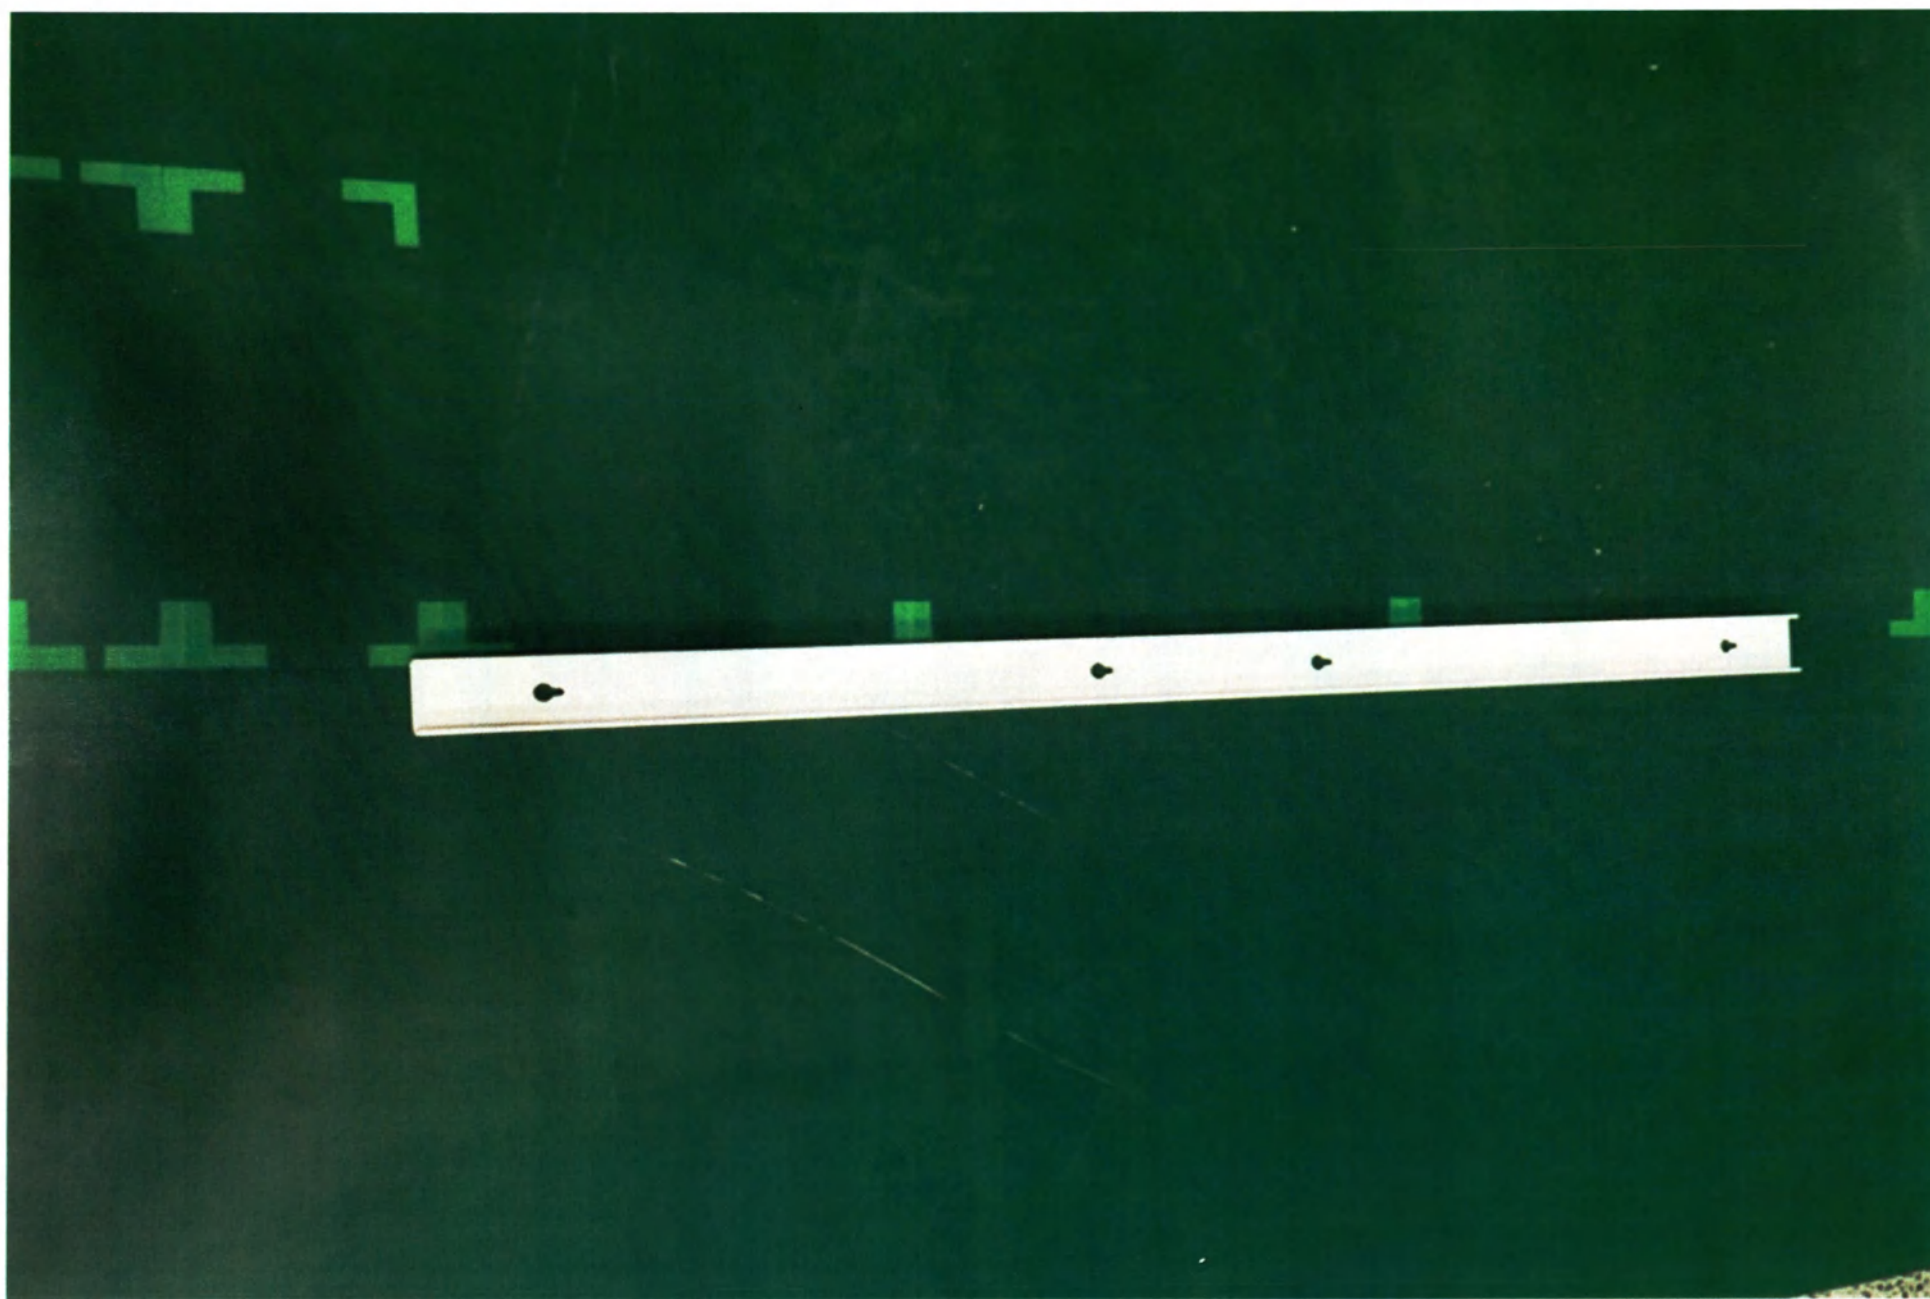


Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики  
(Основной блок системы автоматической микробиологической BC120 – 1 шт.: Общий вид)




Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики (Основной блок системы автоматической микробиологической BC120 – 1 шт.: Вид спереди)




**Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики  
(Основной блок системы автоматической микробиологической BC120 – 1 шт.: Вид сбоку)**

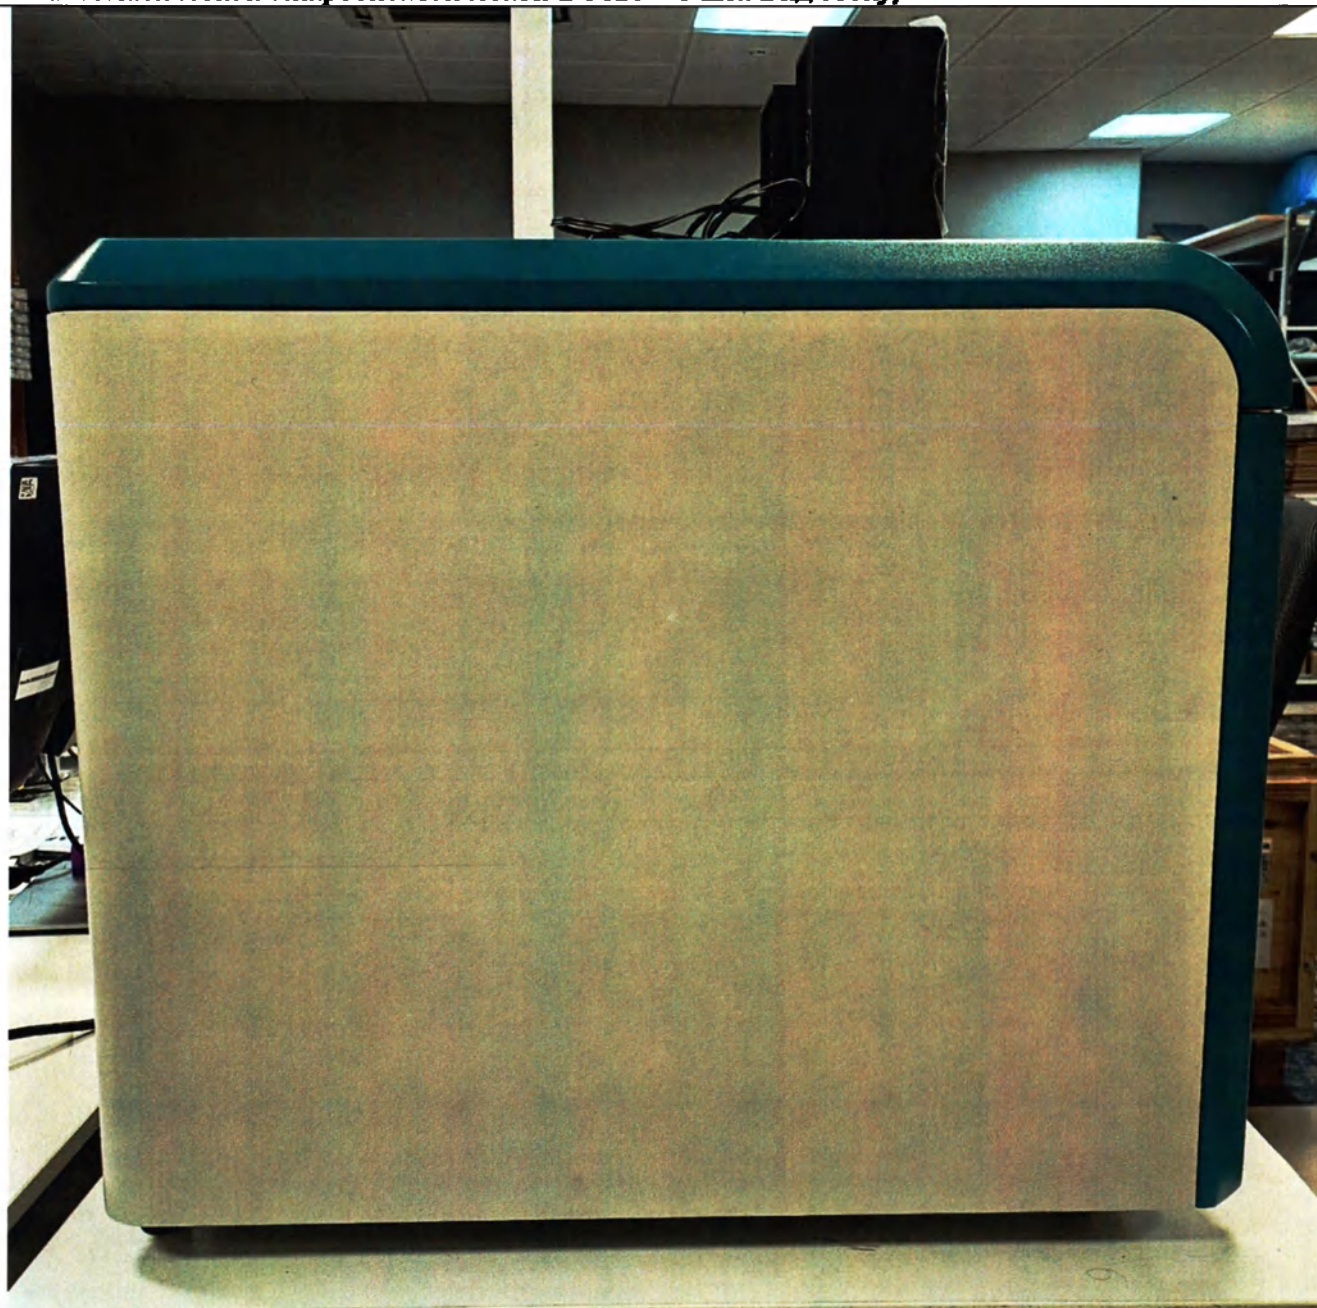

Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики (Основной блок системы автоматической микробиологической BC120 – 1 шт.: Вид сзади)

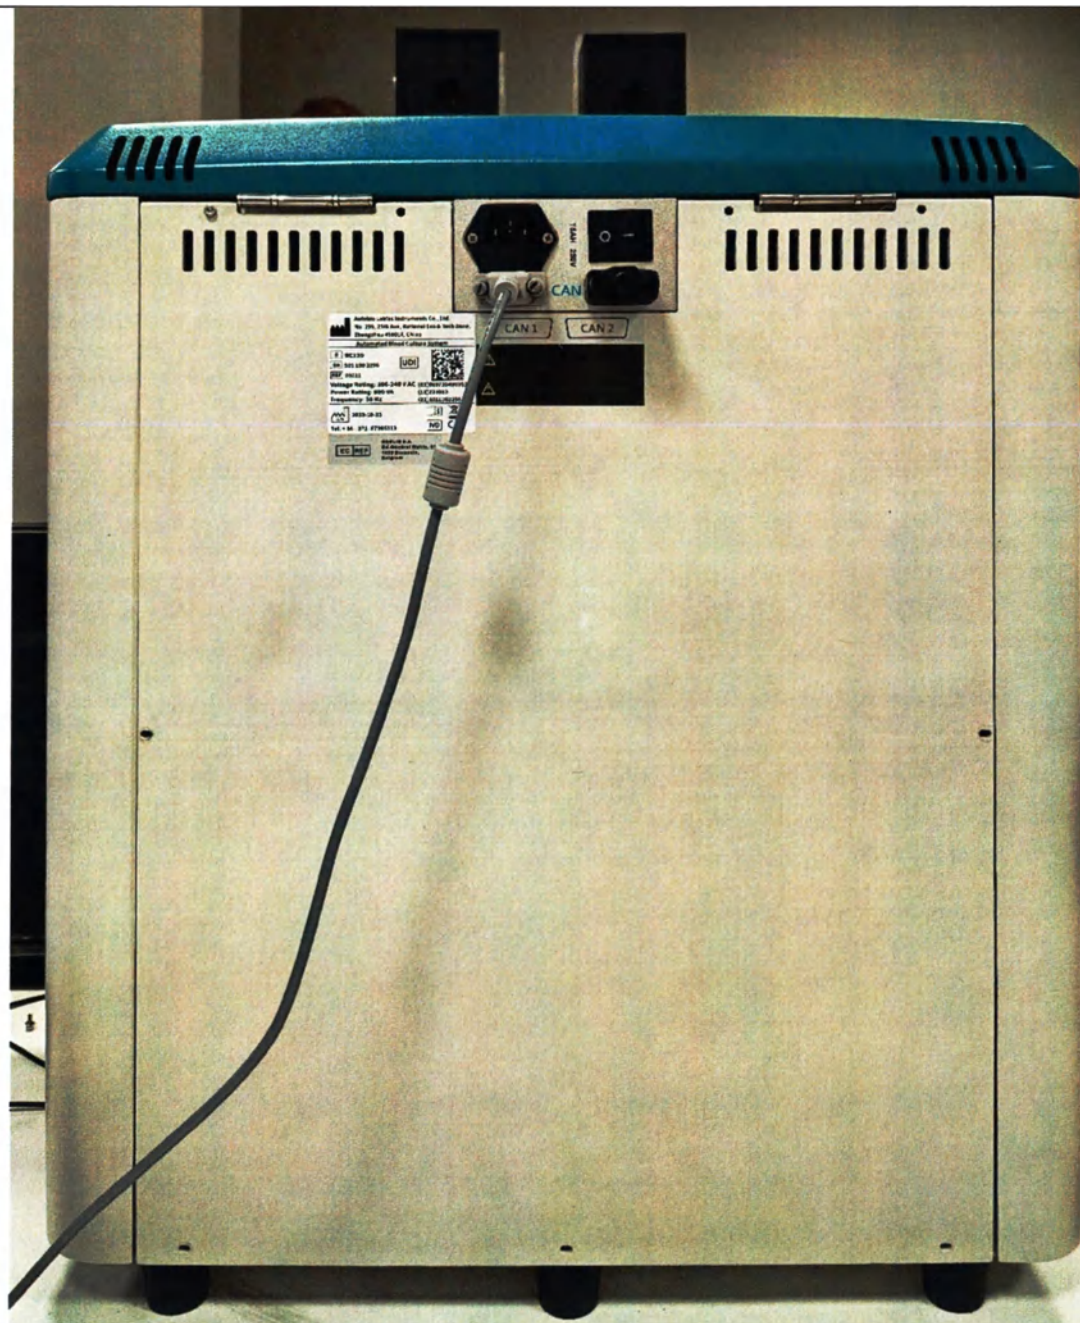

Пример оригинальной маркировки и дополнительной маркировки на русском языке системы автоматической микробиологической BC120 для in vitro диагностики

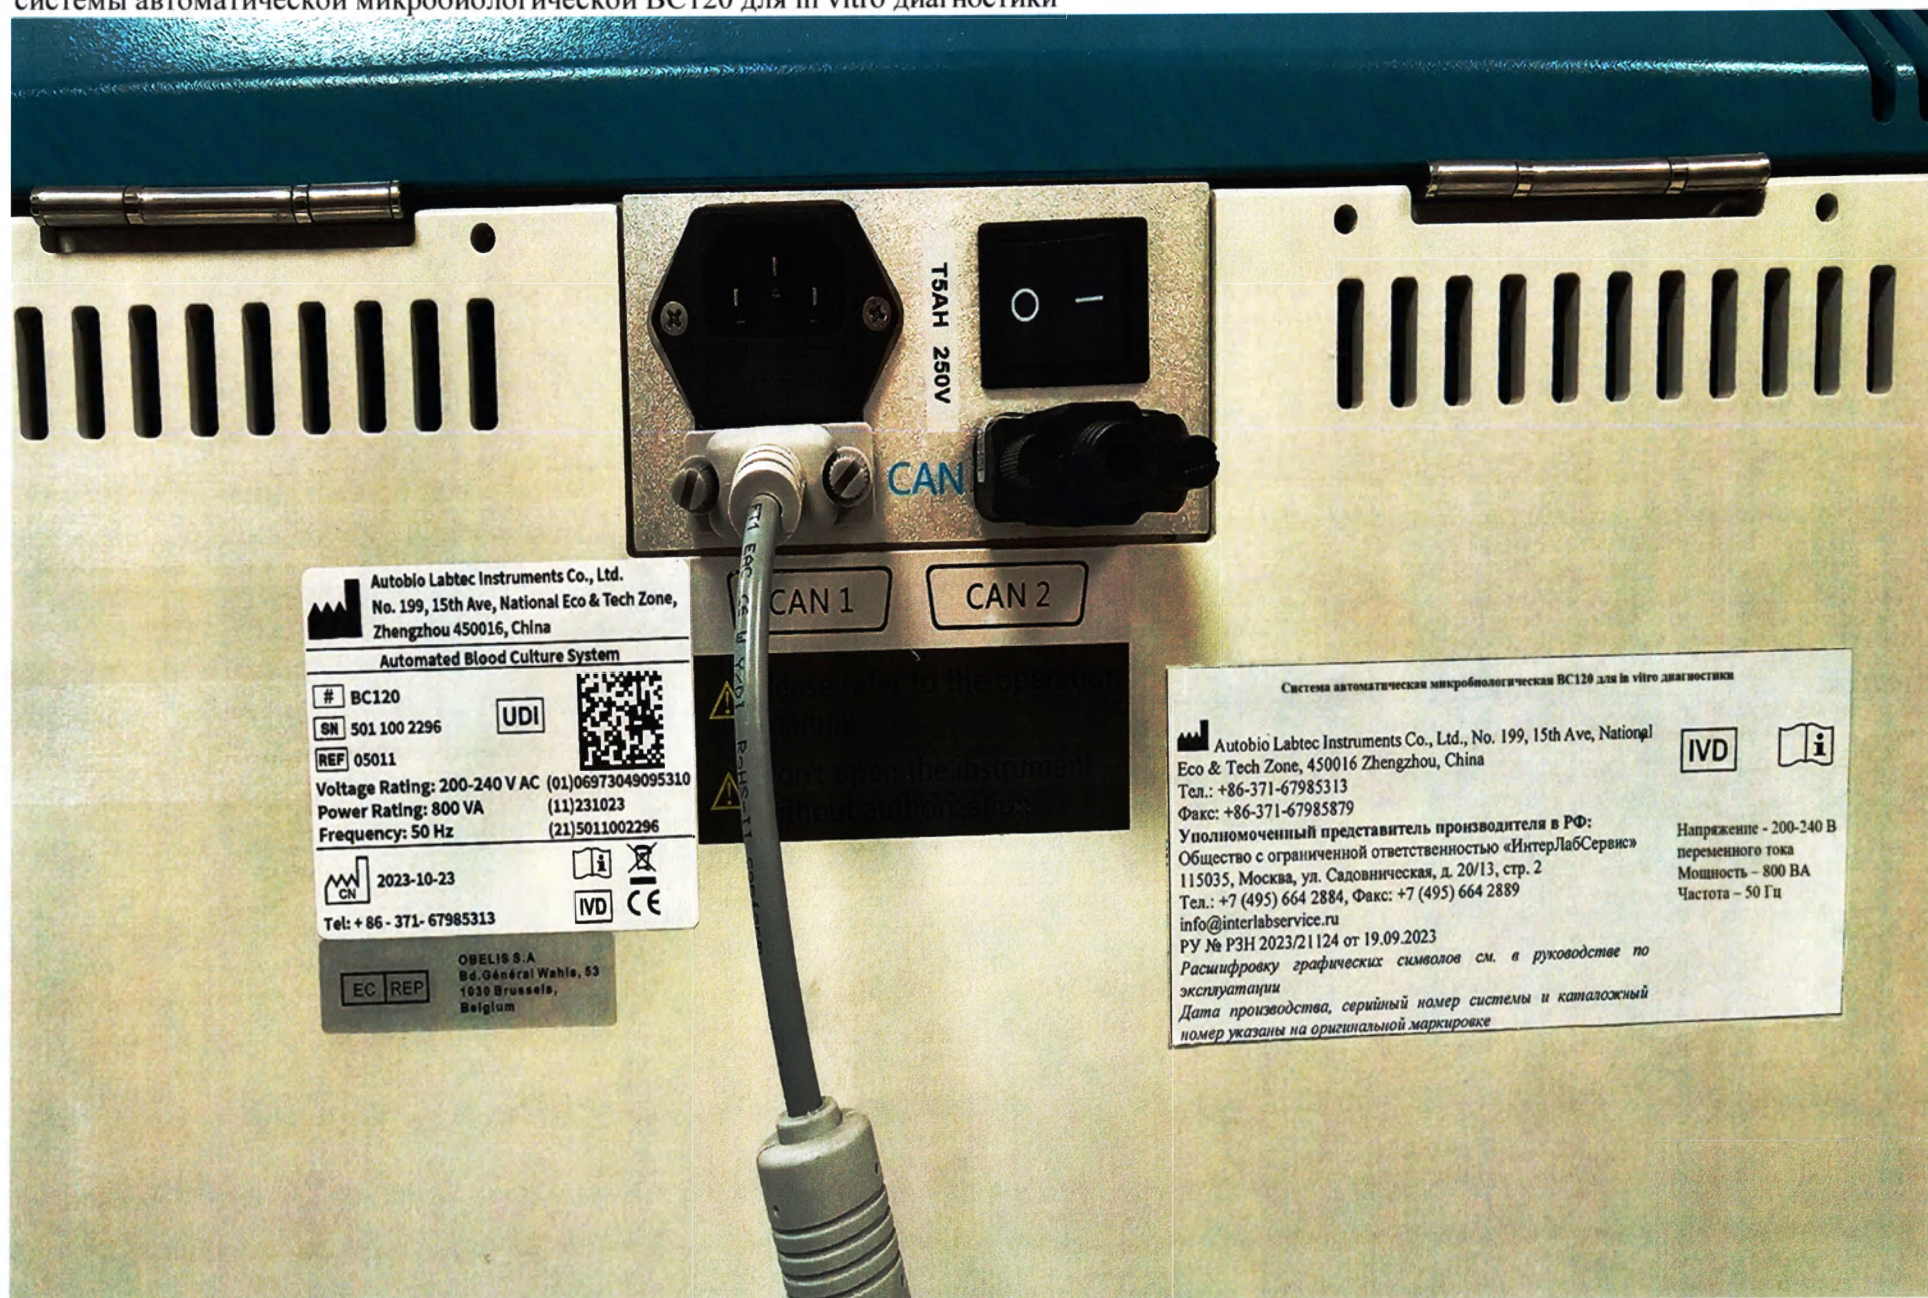

Пример оригинальной маркировки системы автоматической микробиологической BC120 для in vitro диагностики



**Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.**  
No. 199, 15th Ave, National Eco & Tech Zone,  
Zhengzhou 450016, China

**Automated Blood Culture System**

# BC120

SN 501 100 2296

REF 05011

UDI



**Voltage Rating: 200-240 V AC** (01)06973049095310

**Power Rating: 800 VA** (11)231023

**Frequency: 50 Hz** (21)5011002296



2023-10-23

Tel: + 86 - 371- 67985313



**OBELIS S.A**  
Bd.Général Wahis, 53  
1030 Brussels,  
Belgium

**Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики**



**Autobio Labtec Instruments Co., Ltd., No. 199, 15th Ave, National Eco  
& Tech Zone, 450016 Zhengzhou, China**

**Тел.: +86-371-67985313**

**Факс: +86-371-67985879**



**Уполномоченный представитель производителя в РФ:**

**Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерЛабСервис»**

**115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2**

**Тел.: +7 (495) 664 2884, Факс: +7 (495) 664 2889**

**info@interlabservice.ru**

**РУ № РЗН XXXX/XXXXX от \_\_\_\_\_.**

*Расшифровку графических символов см. в руководстве по эксплуатации*

*Дата производства, серийный номер системы и каталожный номер  
указаны на оригинальной маркировке*

**Напряжение - 200-240 В**

**переменного тока**

**Мощность – 800 ВА**

**Частота – 50 Гц**

Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики. Транспортная упаковка

Новый Мехор 96, 2825521031

- Собрать, протестировать




**Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики**

**REF** 05011

**IVD**



**SN** 501 100 1922

 2023-10-23



 Autobio Labtec Instruments Co., Ltd., No. 199, 15th Ave,  
National Eco & Tech Zone, Zhengzhou 450016, China  
Тел.: +86-371-67985313  
Факс: +86-371-67985879  
www.autobio.com.cn

**Адрес производства:**

Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.,  
No. 199, 15th Ave, National Eco &  
Tech Zone, 450016 Zhengzhou,  
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

**Уполномоченный представитель производителя  
в РФ:**

Масса нетто: 90 кг

Общество с ограниченной ответственностью  
«ИнтерЛабСервис»

Масса брутто 115 кг

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 20/13, стр. 2

Тел.: +7 (495) 664 2884, Факс: +7 (495) 664 2889

info@interlabservice.ru

ПУ № РЗН 2023/21124 от 19.09.2023 г.


Расшифровку графических символов см. в  
инструкции



Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Кабель питания (европейский тип вилки) – 3 шт.)




Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики (Адаптер согласования мощности – 1 шт.)

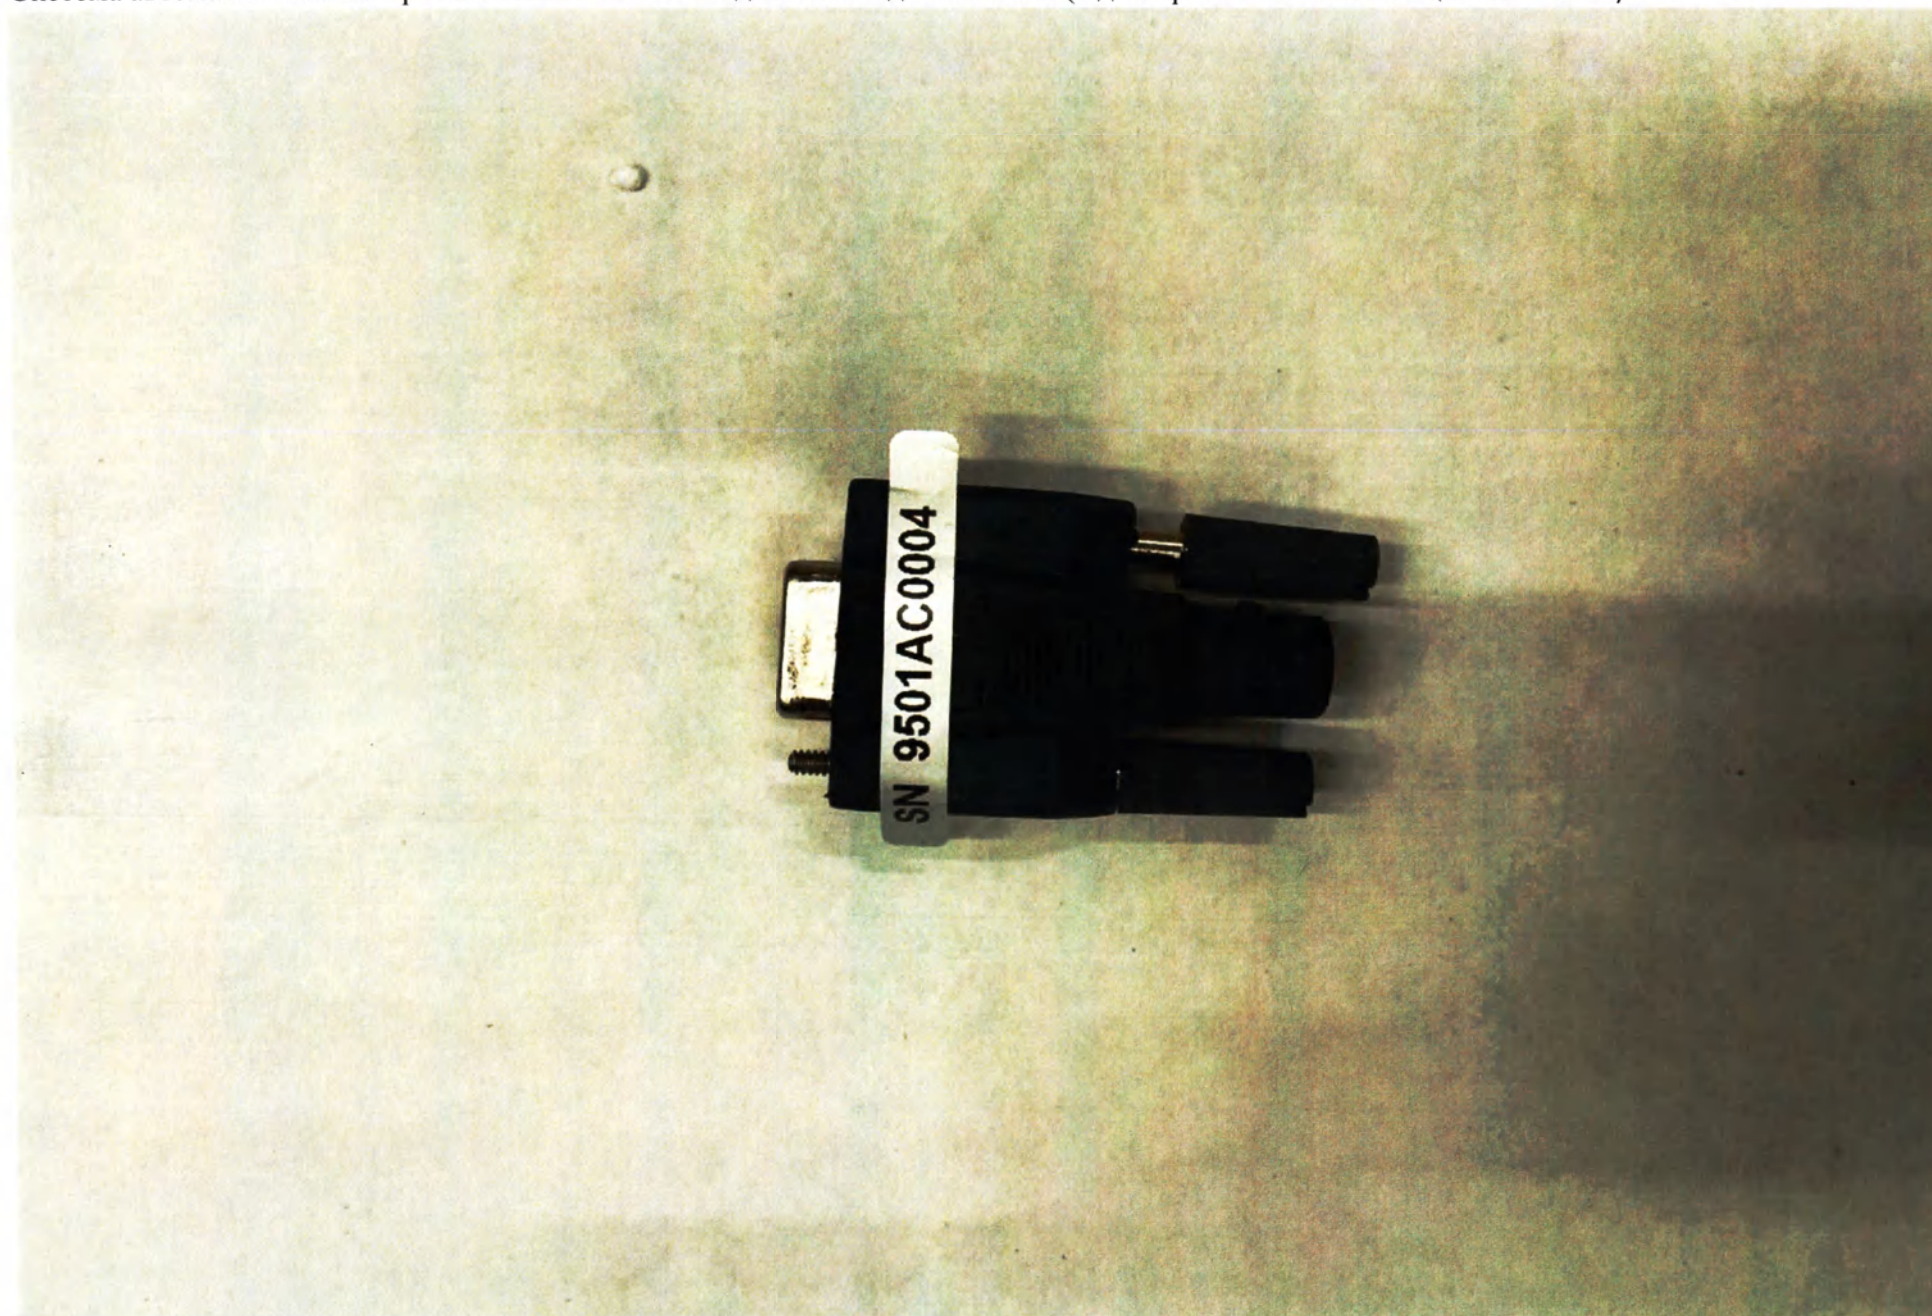


Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Монитор – 1 шт. (вид спереди))



Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики (Монитор – 1 шт. (вид сзади))

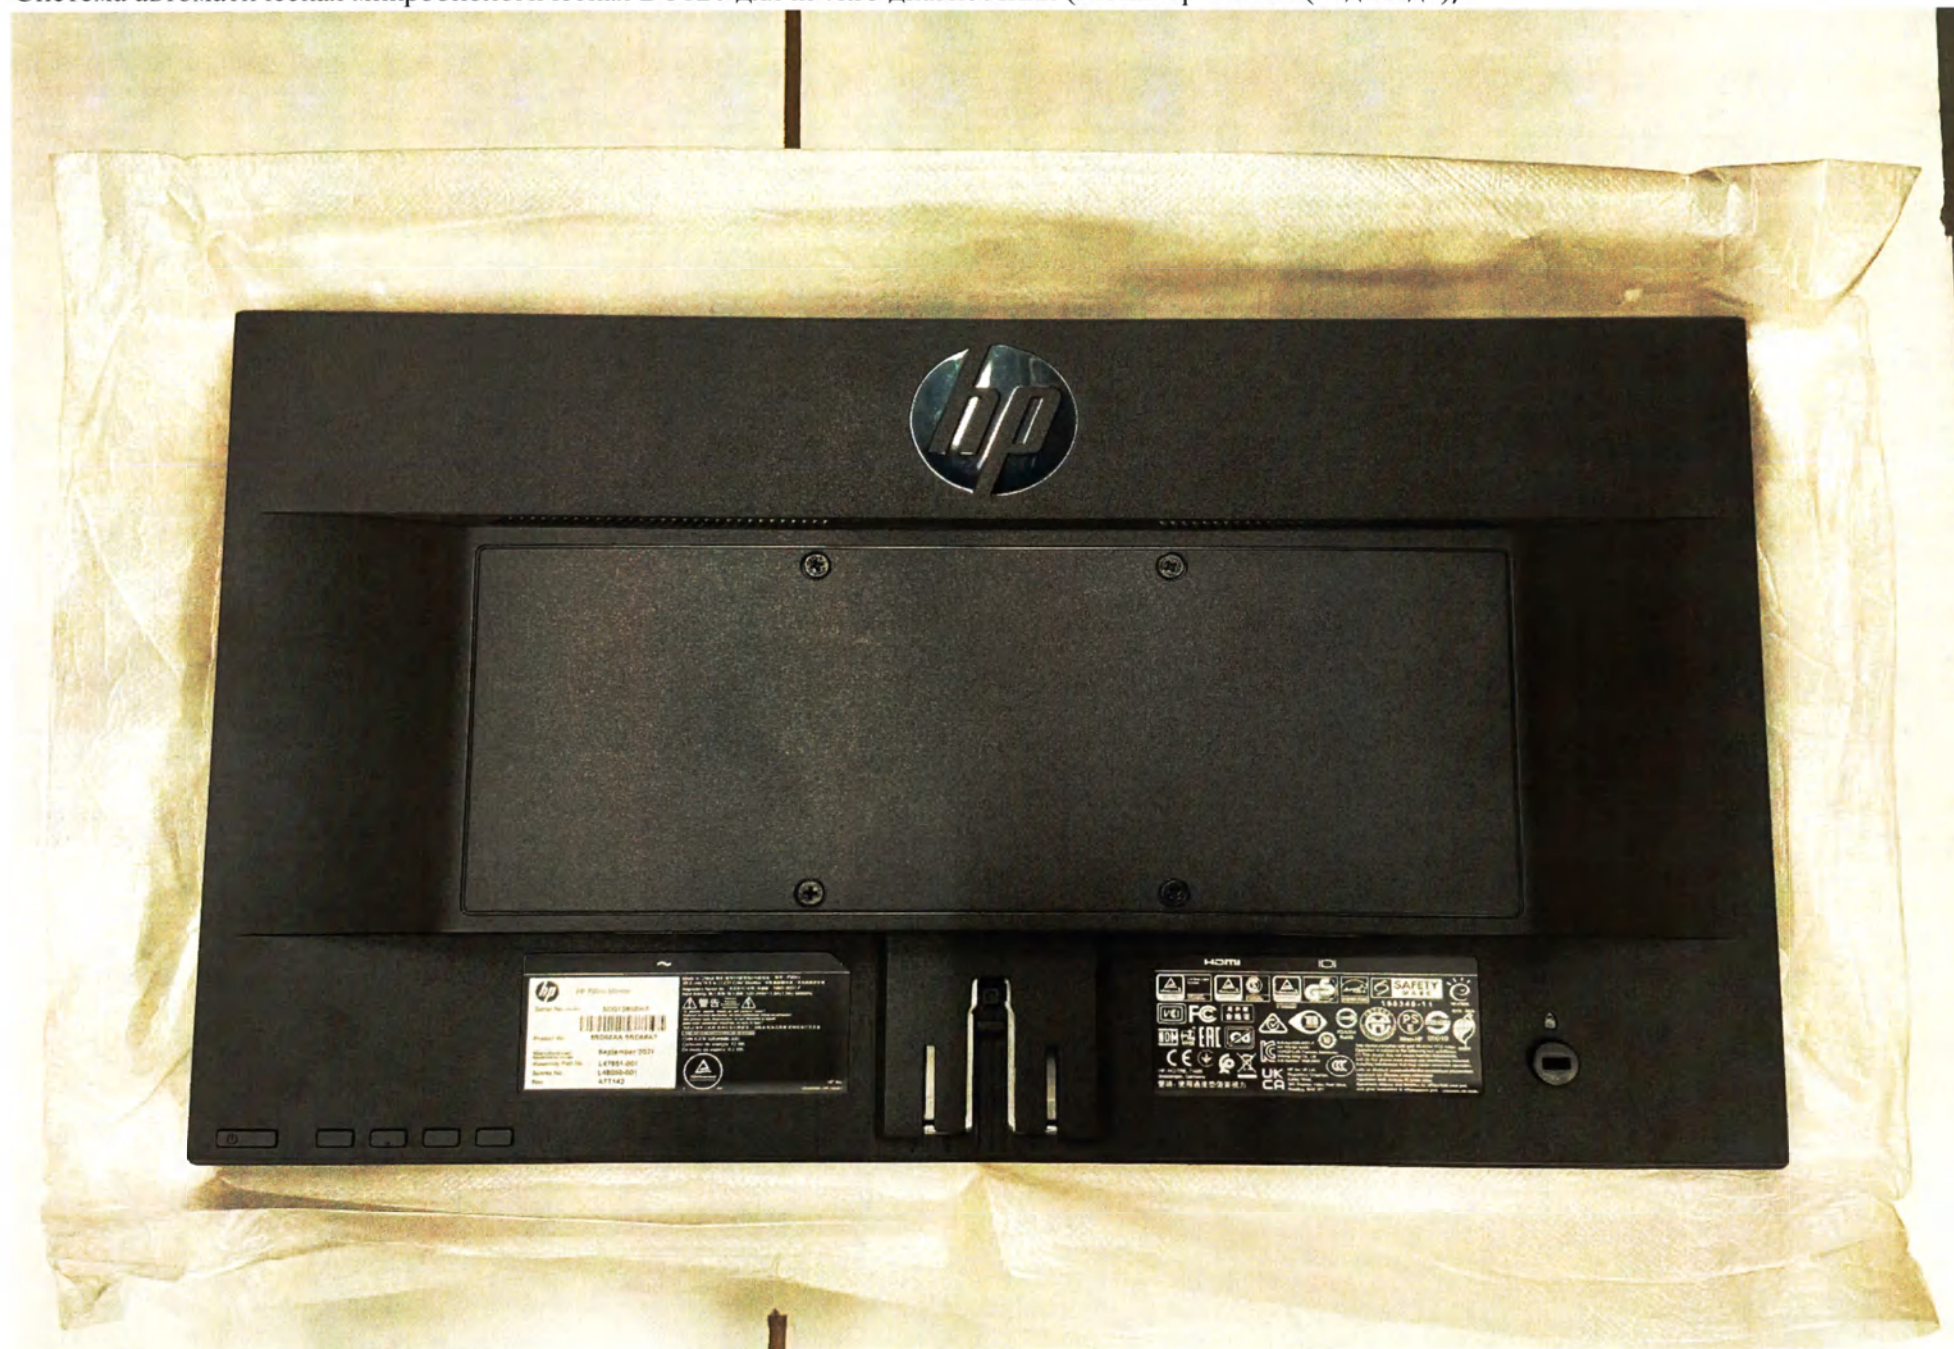


Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Кабель подключения монитора – 1 шт.)

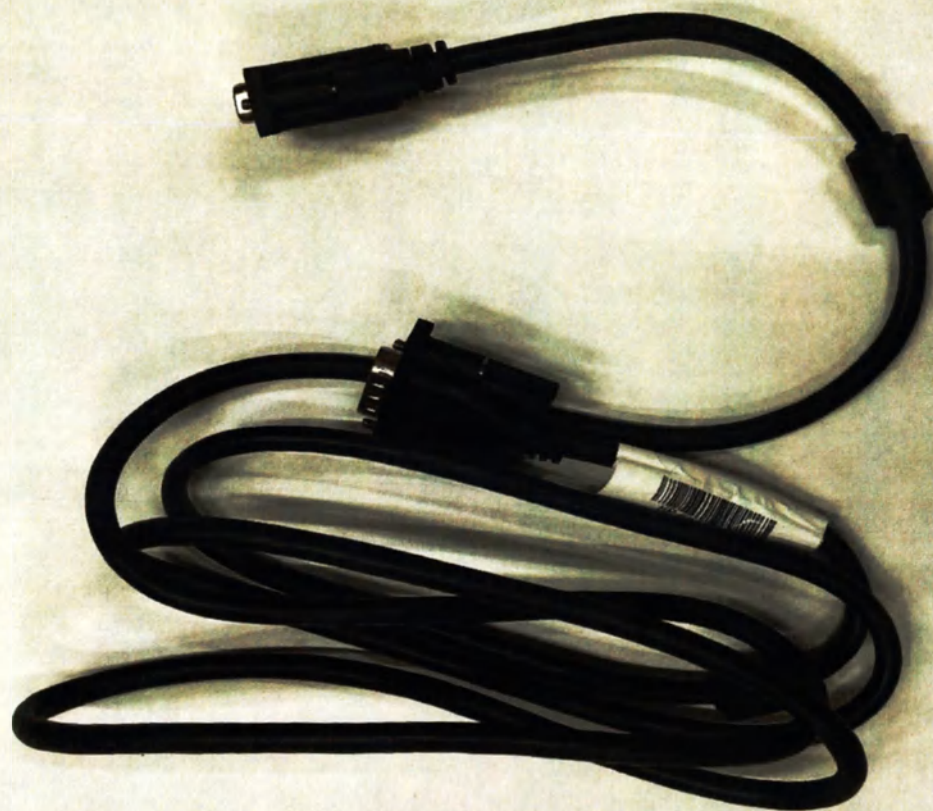


Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (возможен вариант поставки с кабелем HDMI– 1 шт.)



Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Подставка под монитор – 1 шт.)

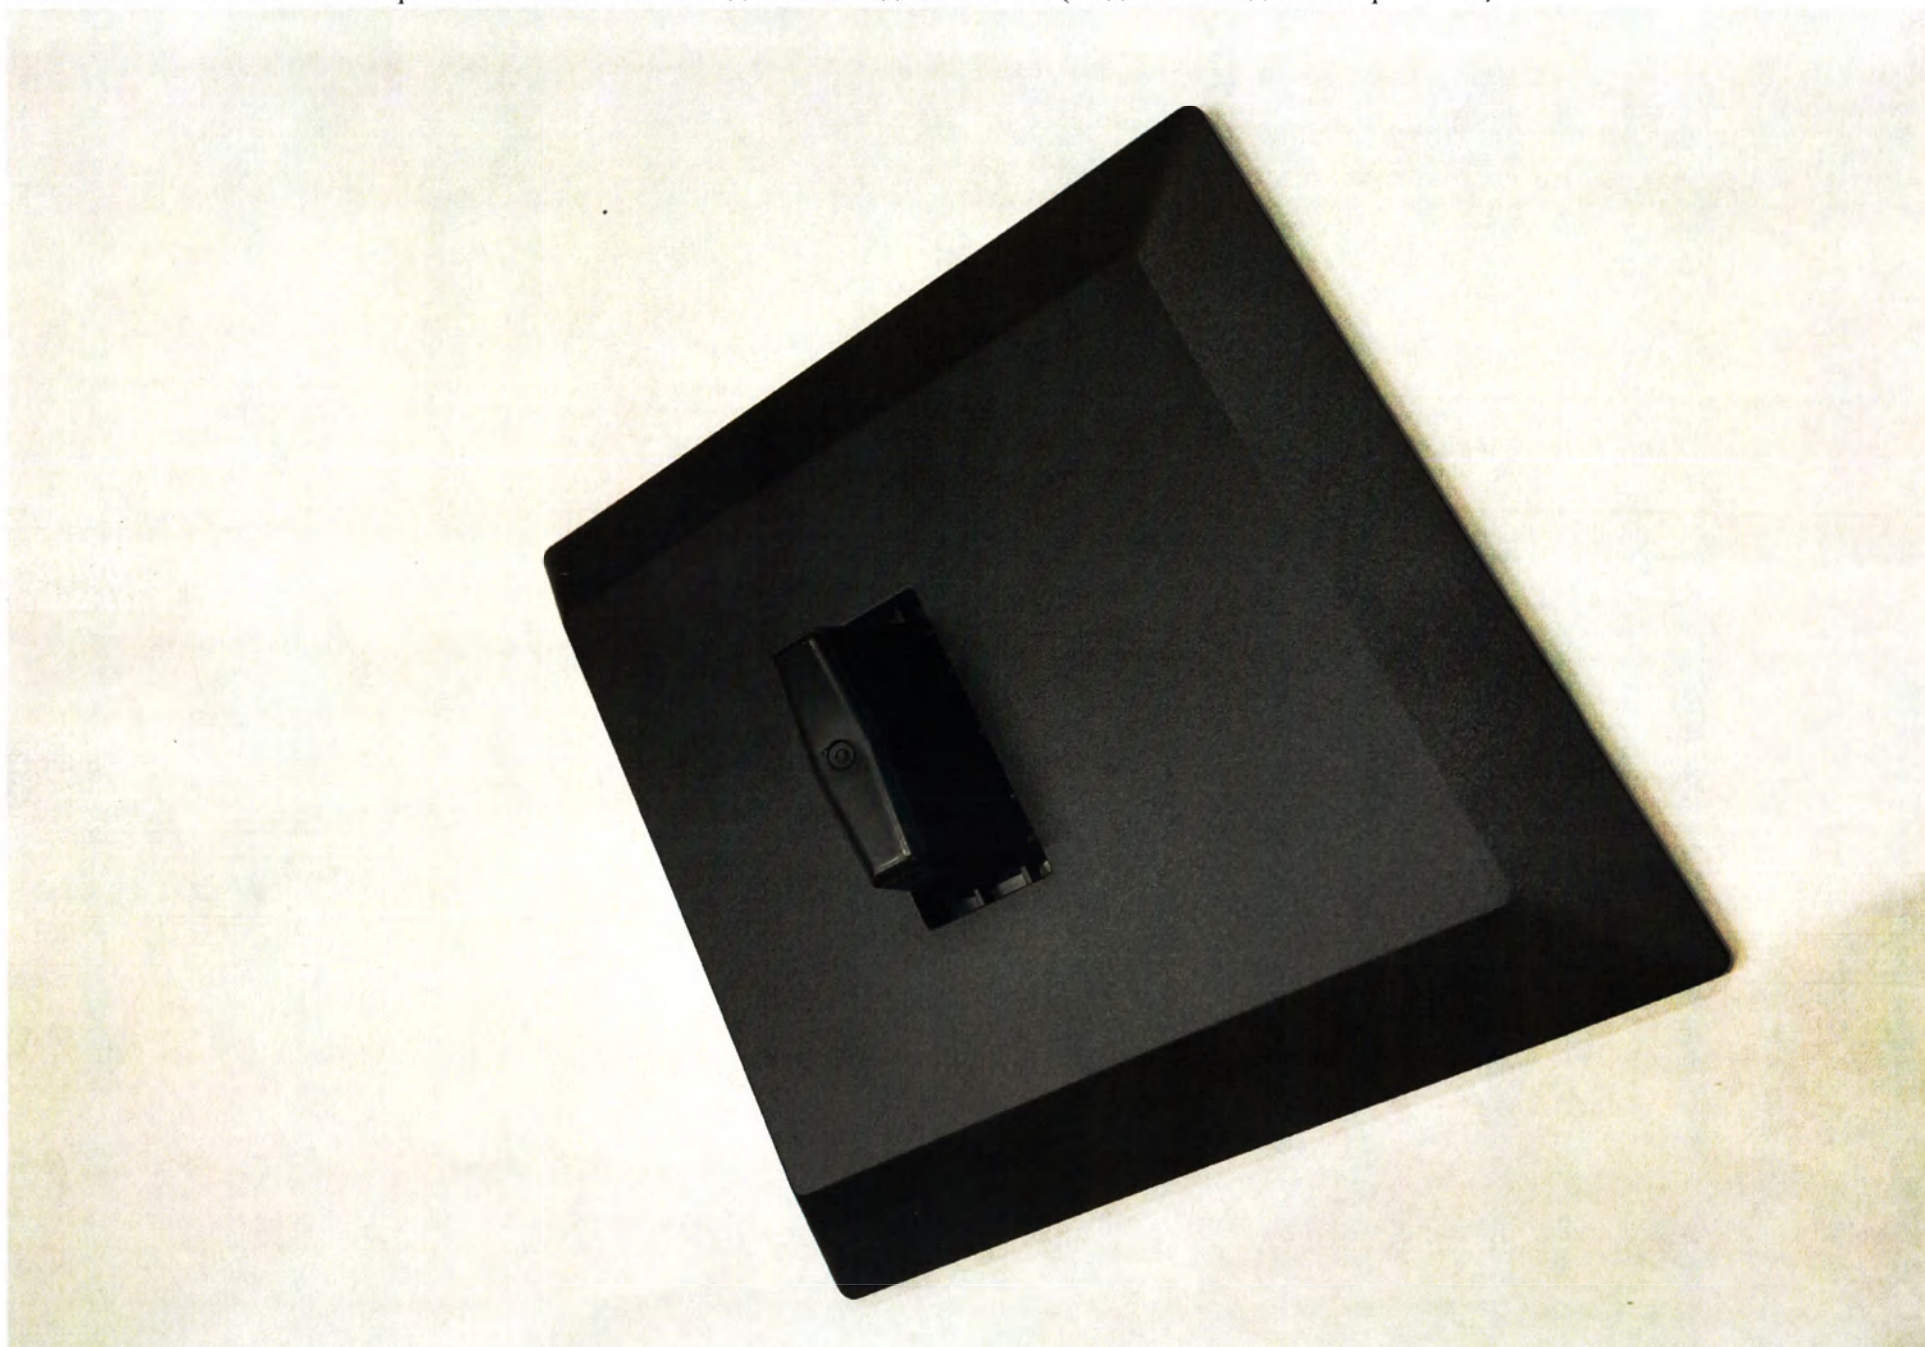

Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Подставка под монитор – 1 шт.)

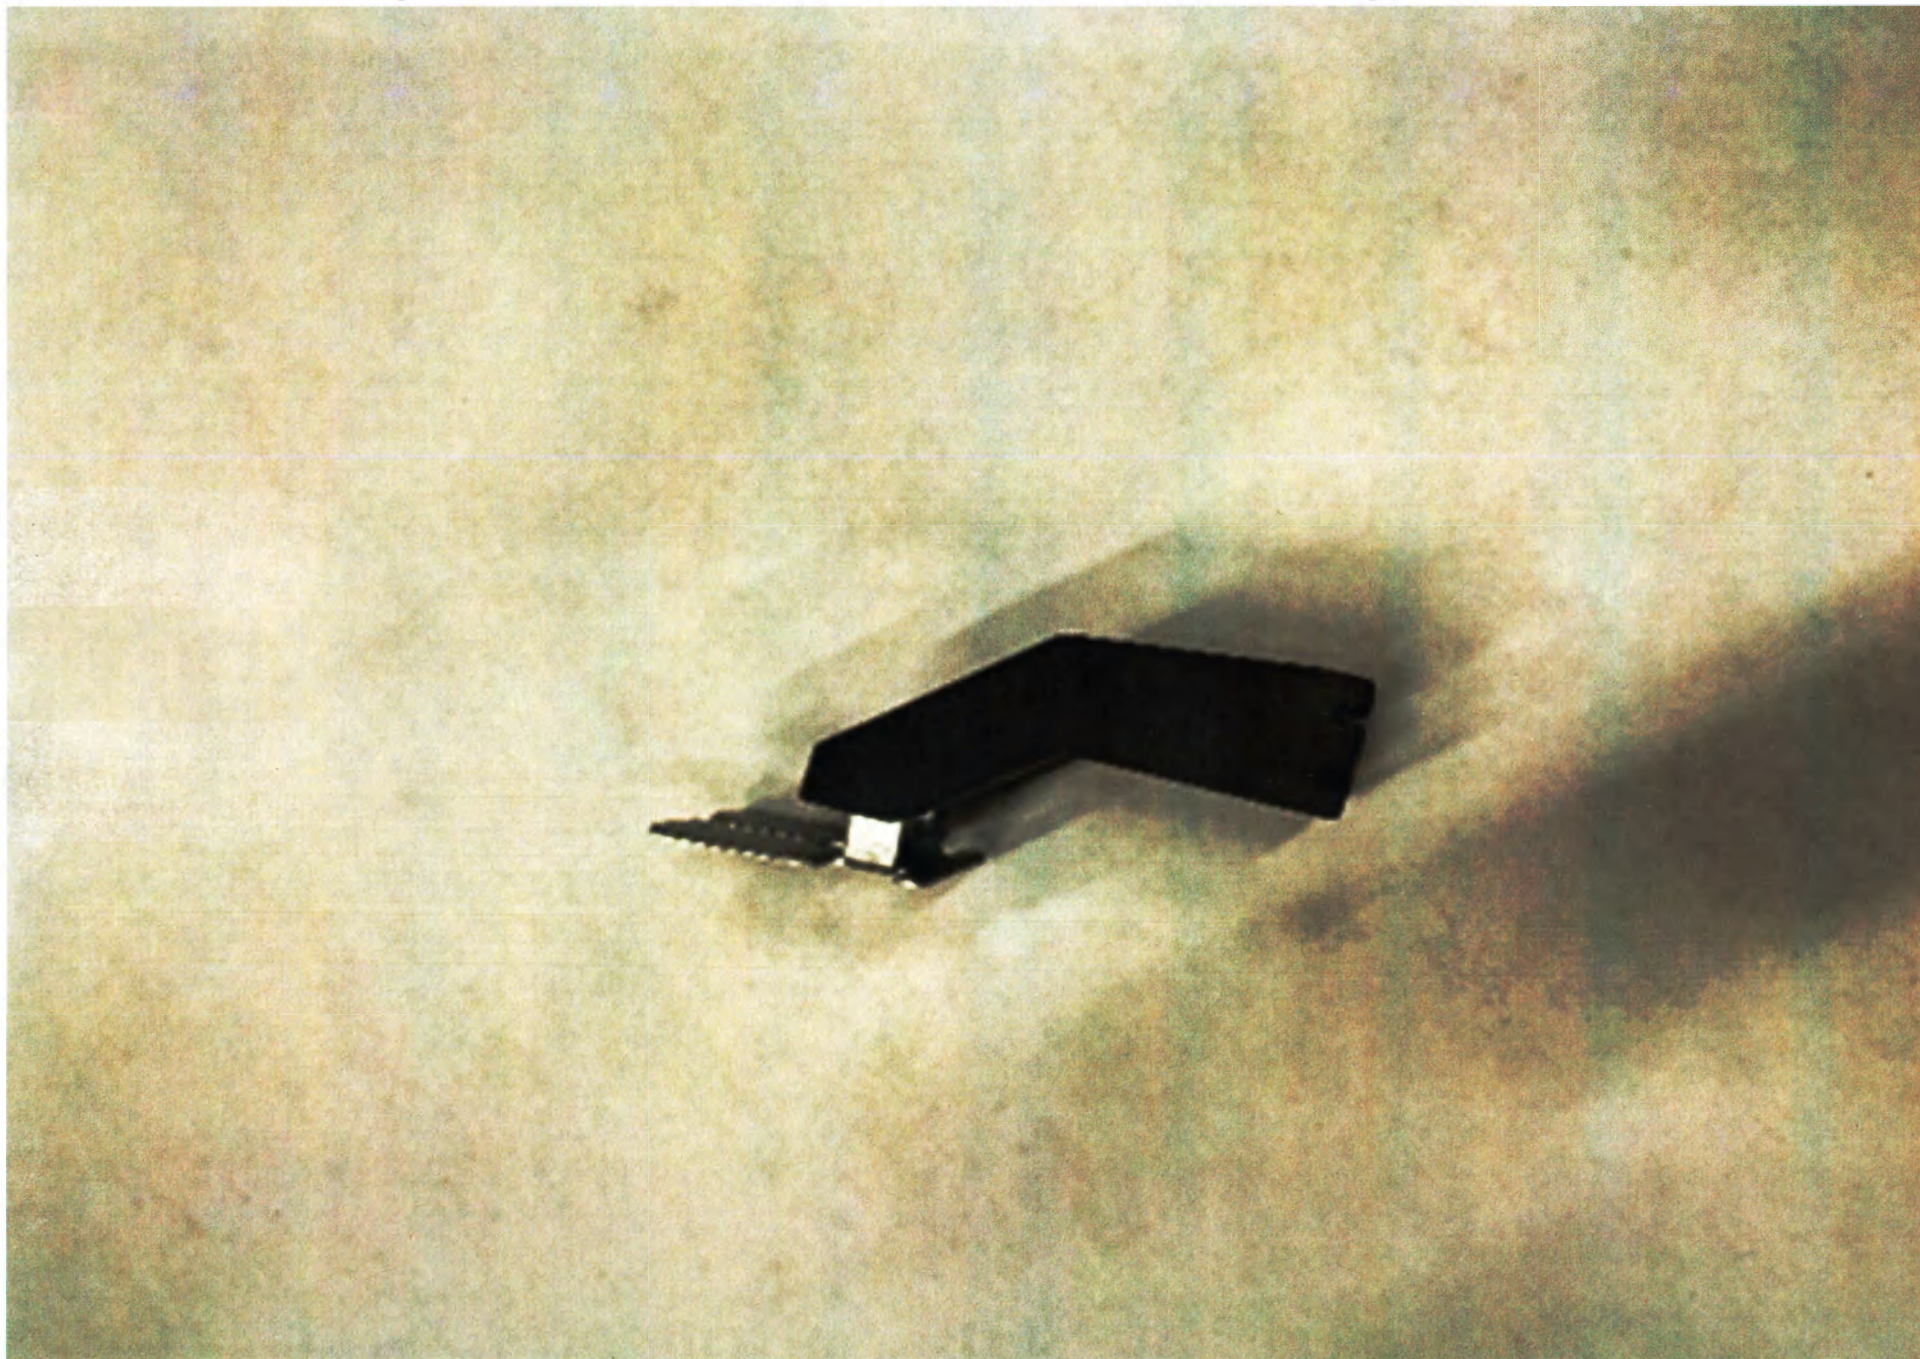

Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Персональный компьютер – 1 шт.)



Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Мышка – 1 шт.)




Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики (Клавиатура – 1 шт.)



Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Коврик для мышки - 1 шт.)



Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики  
(Кабель для подключения основного блока системы – 1 шт.)

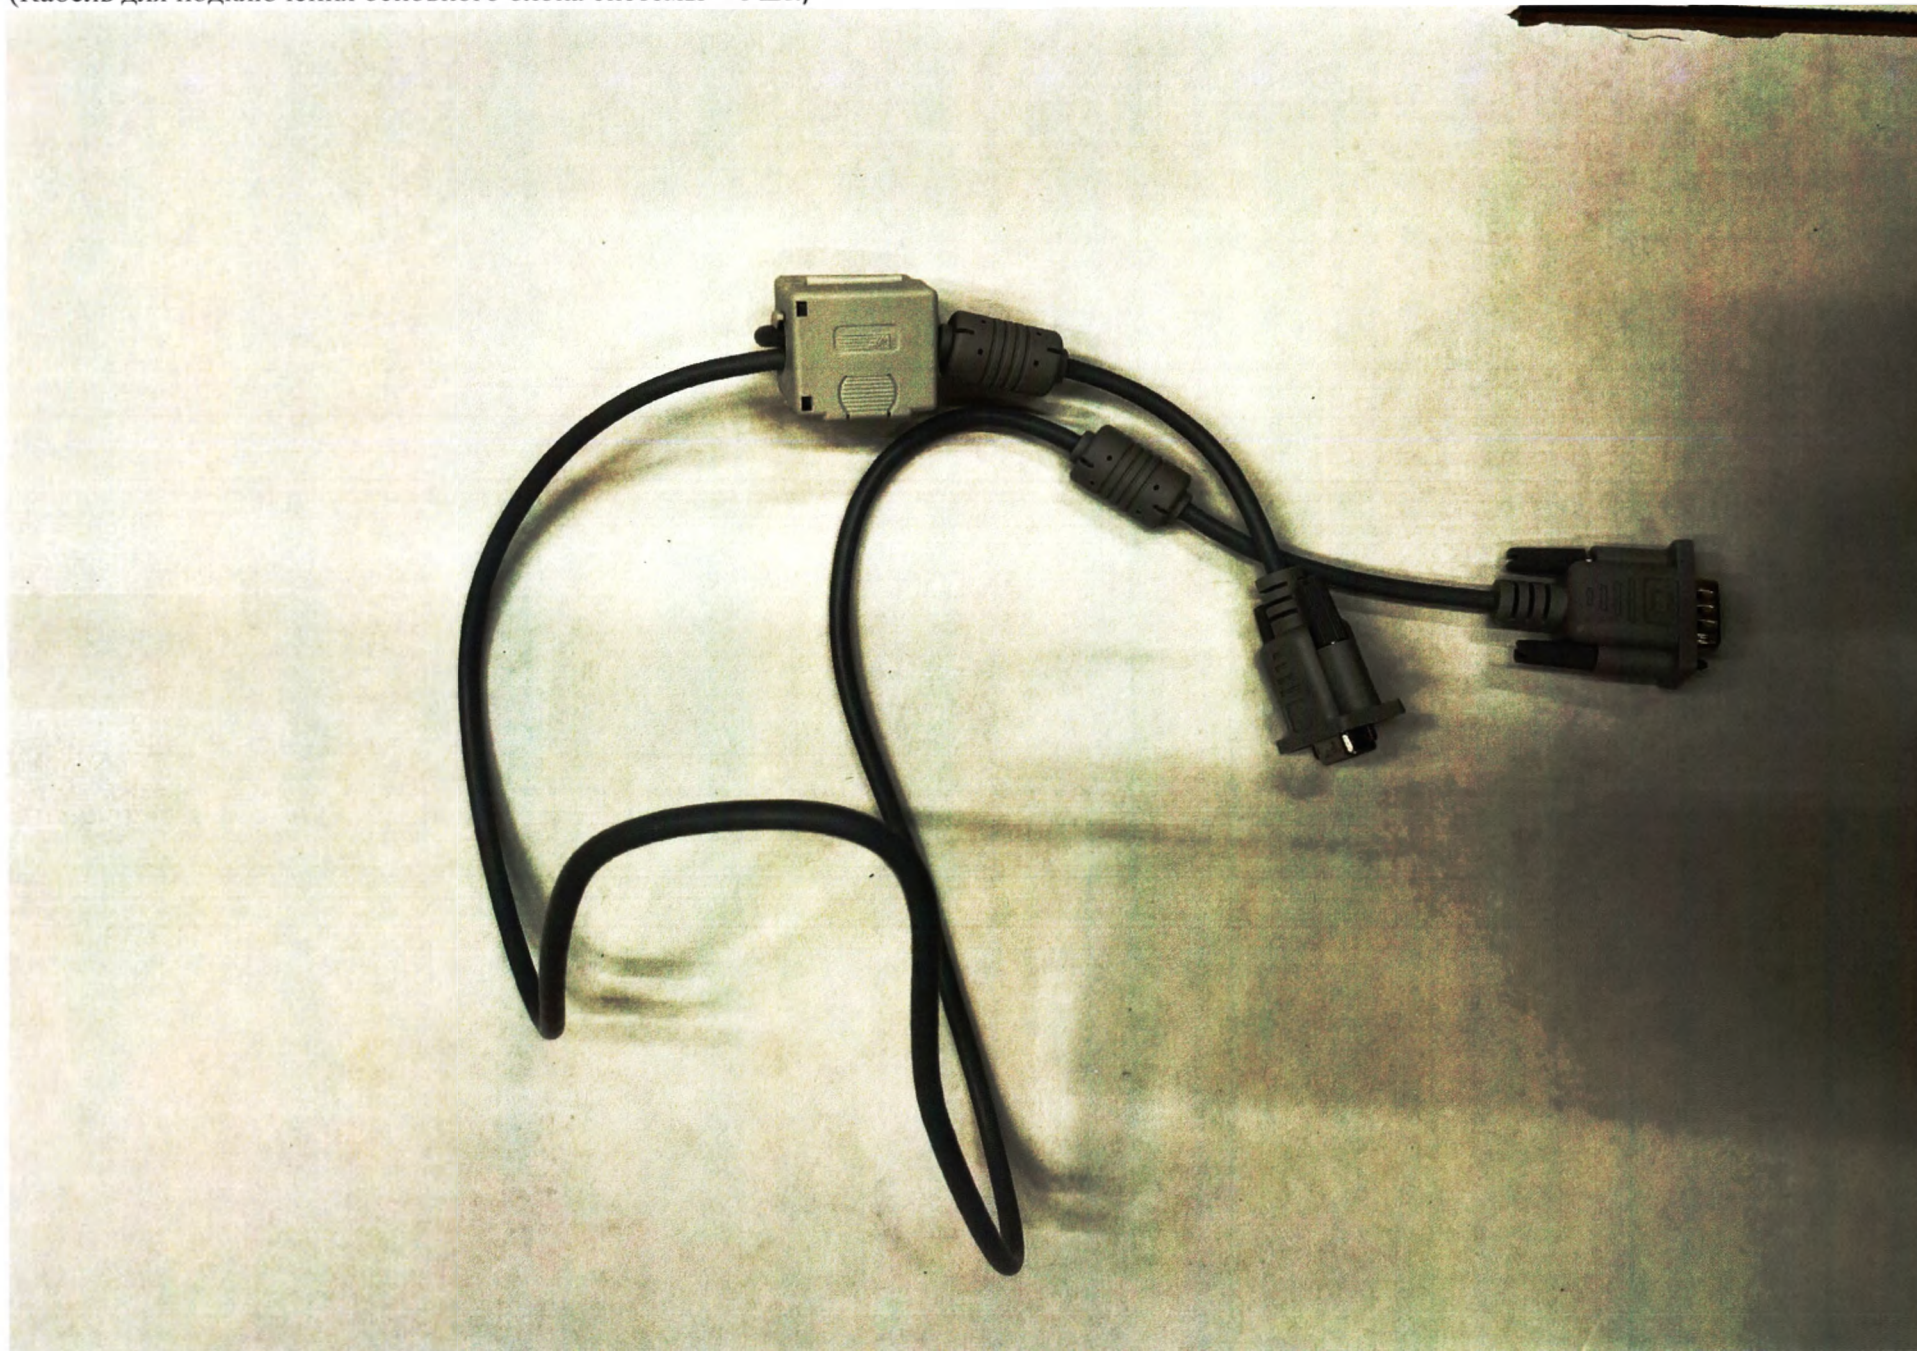


Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики (Калибровочный стержень – не более 10 шт.)



Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики (Программное обеспечение на диске – 1 шт.)



Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Предохранитель – 2 шт.)

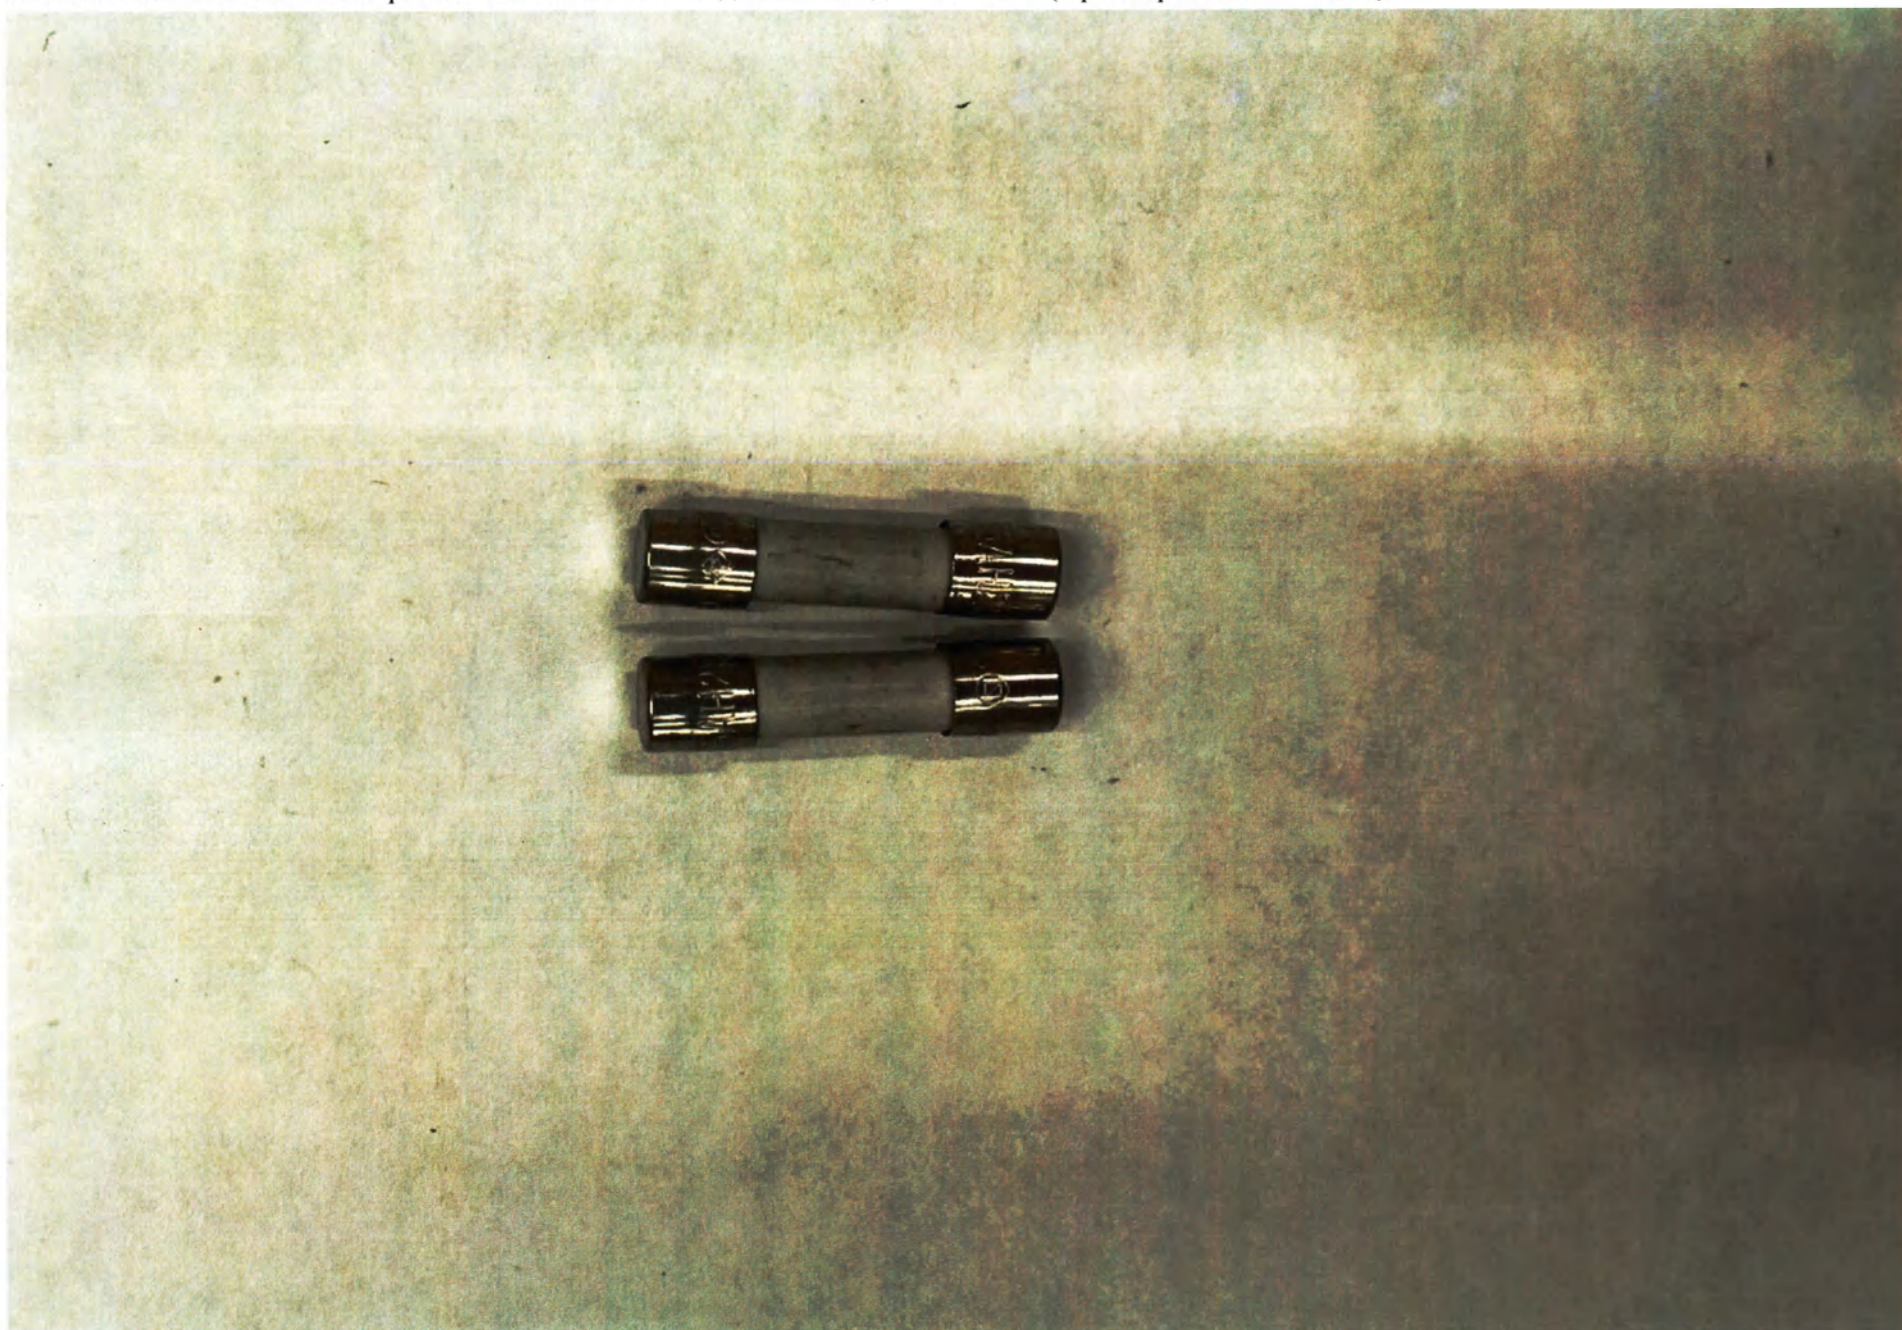



Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.  
No. 199, 15<sup>th</sup> Ave, National Eco & Tech Development Area  
Zhengzhou, China, 450016  
Tel.: +86-371-67985313 e-mail: info@autobio-diagnostics.com  
website: en.autobio.com.cn

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ /  
OPERATING MANUAL


Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики /  
Automatic microbiological system BC120 for in vitro diagnostics

Производитель / Manufacturer  
«Аутобио Лабтек Инструментс Ко., Лтд.» /  
Autobio Labtec Instruments Co., Ltd.


Версия для Российской Федерации 1.3  
Version for Russian Federation 1.3

Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики (Руководство по эксплуатации – 1 шт.)

Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Ключ – 2 шт.)

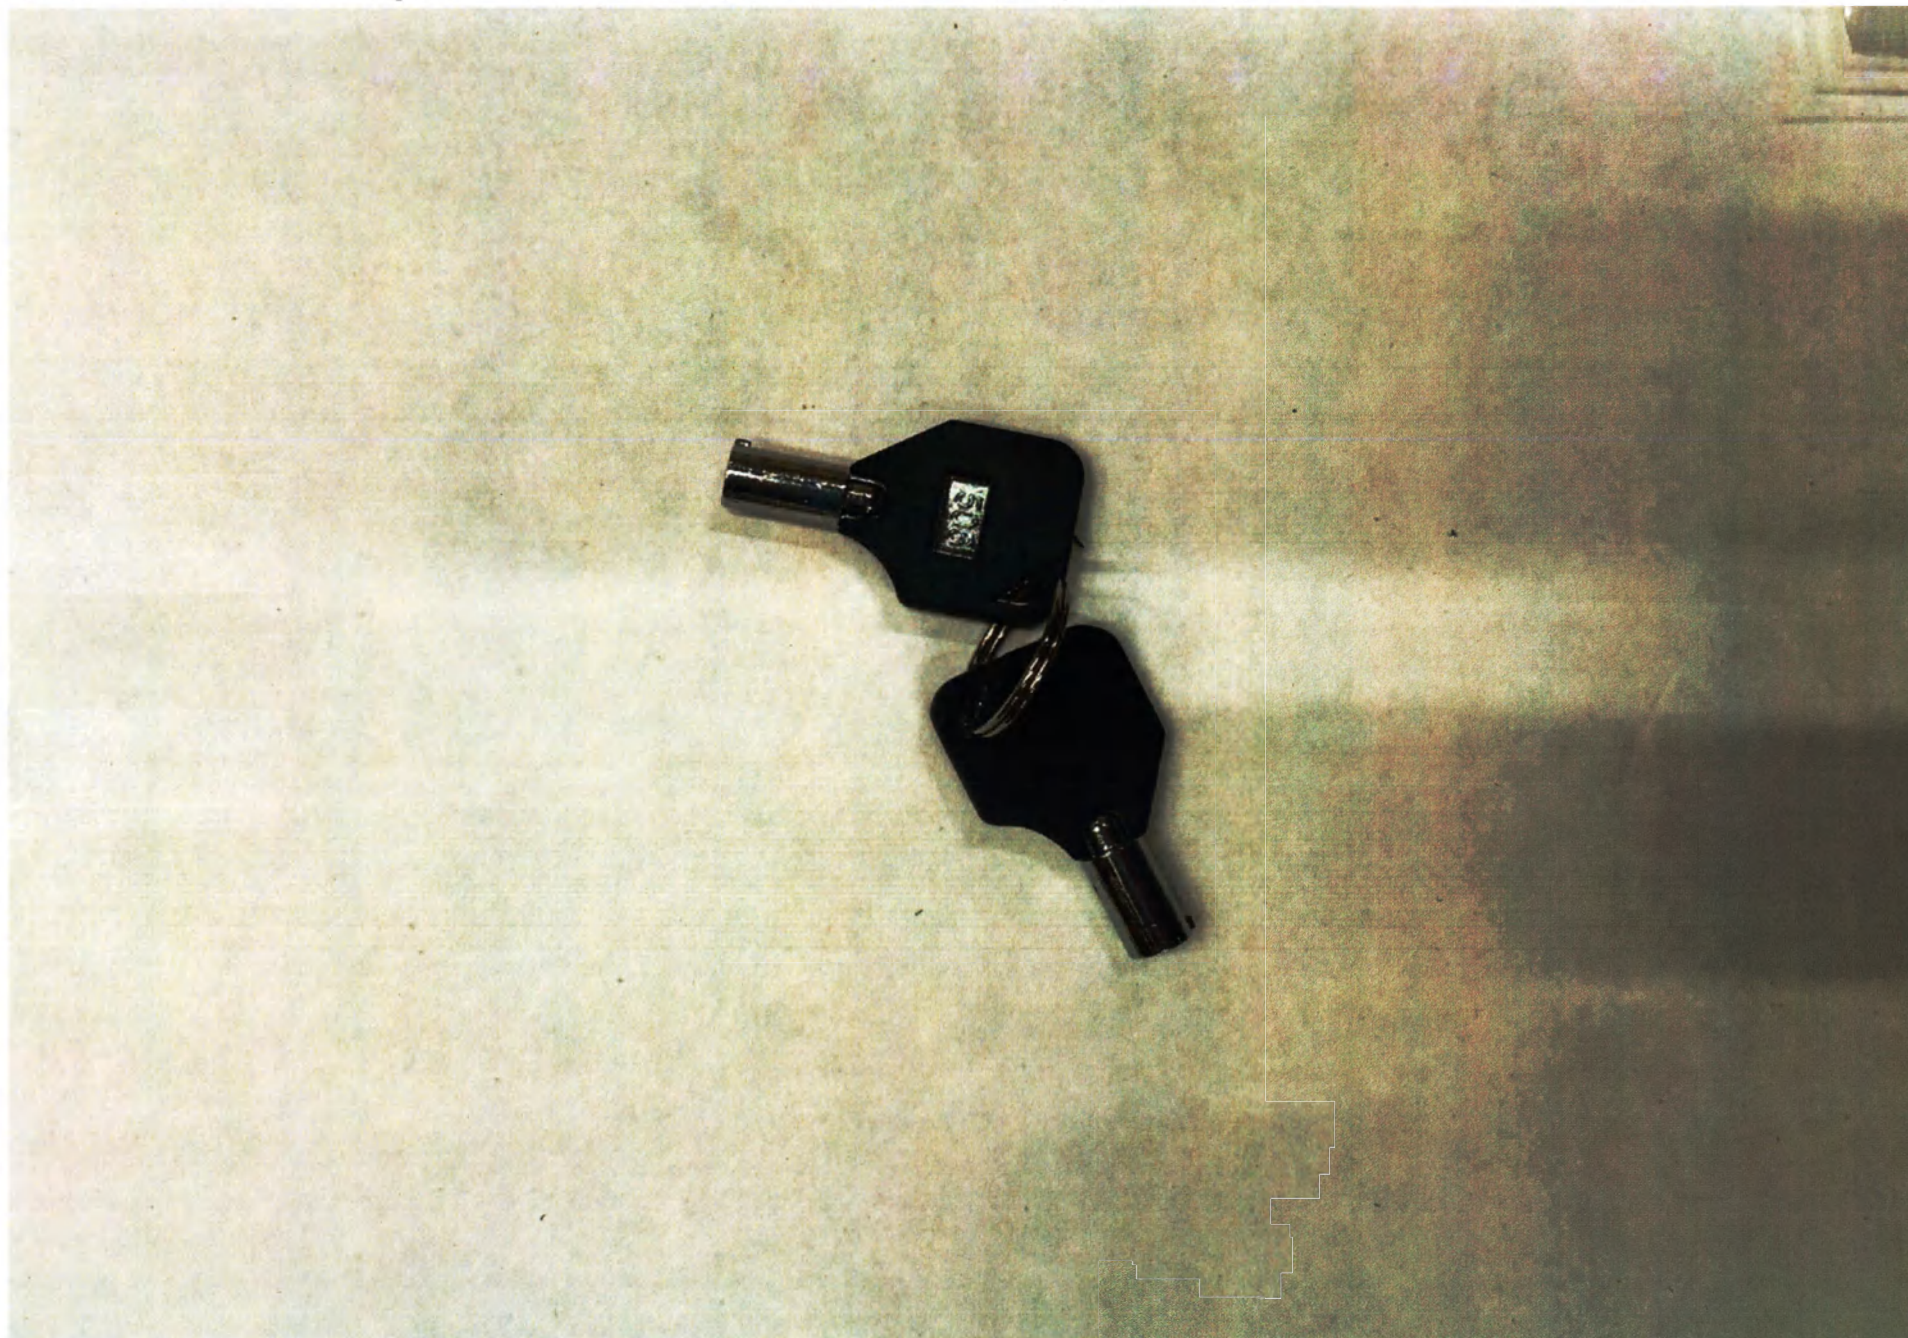


Система автоматическая микробиологическая BC120 для in vitro диагностики (Колонка – 2 шт.)

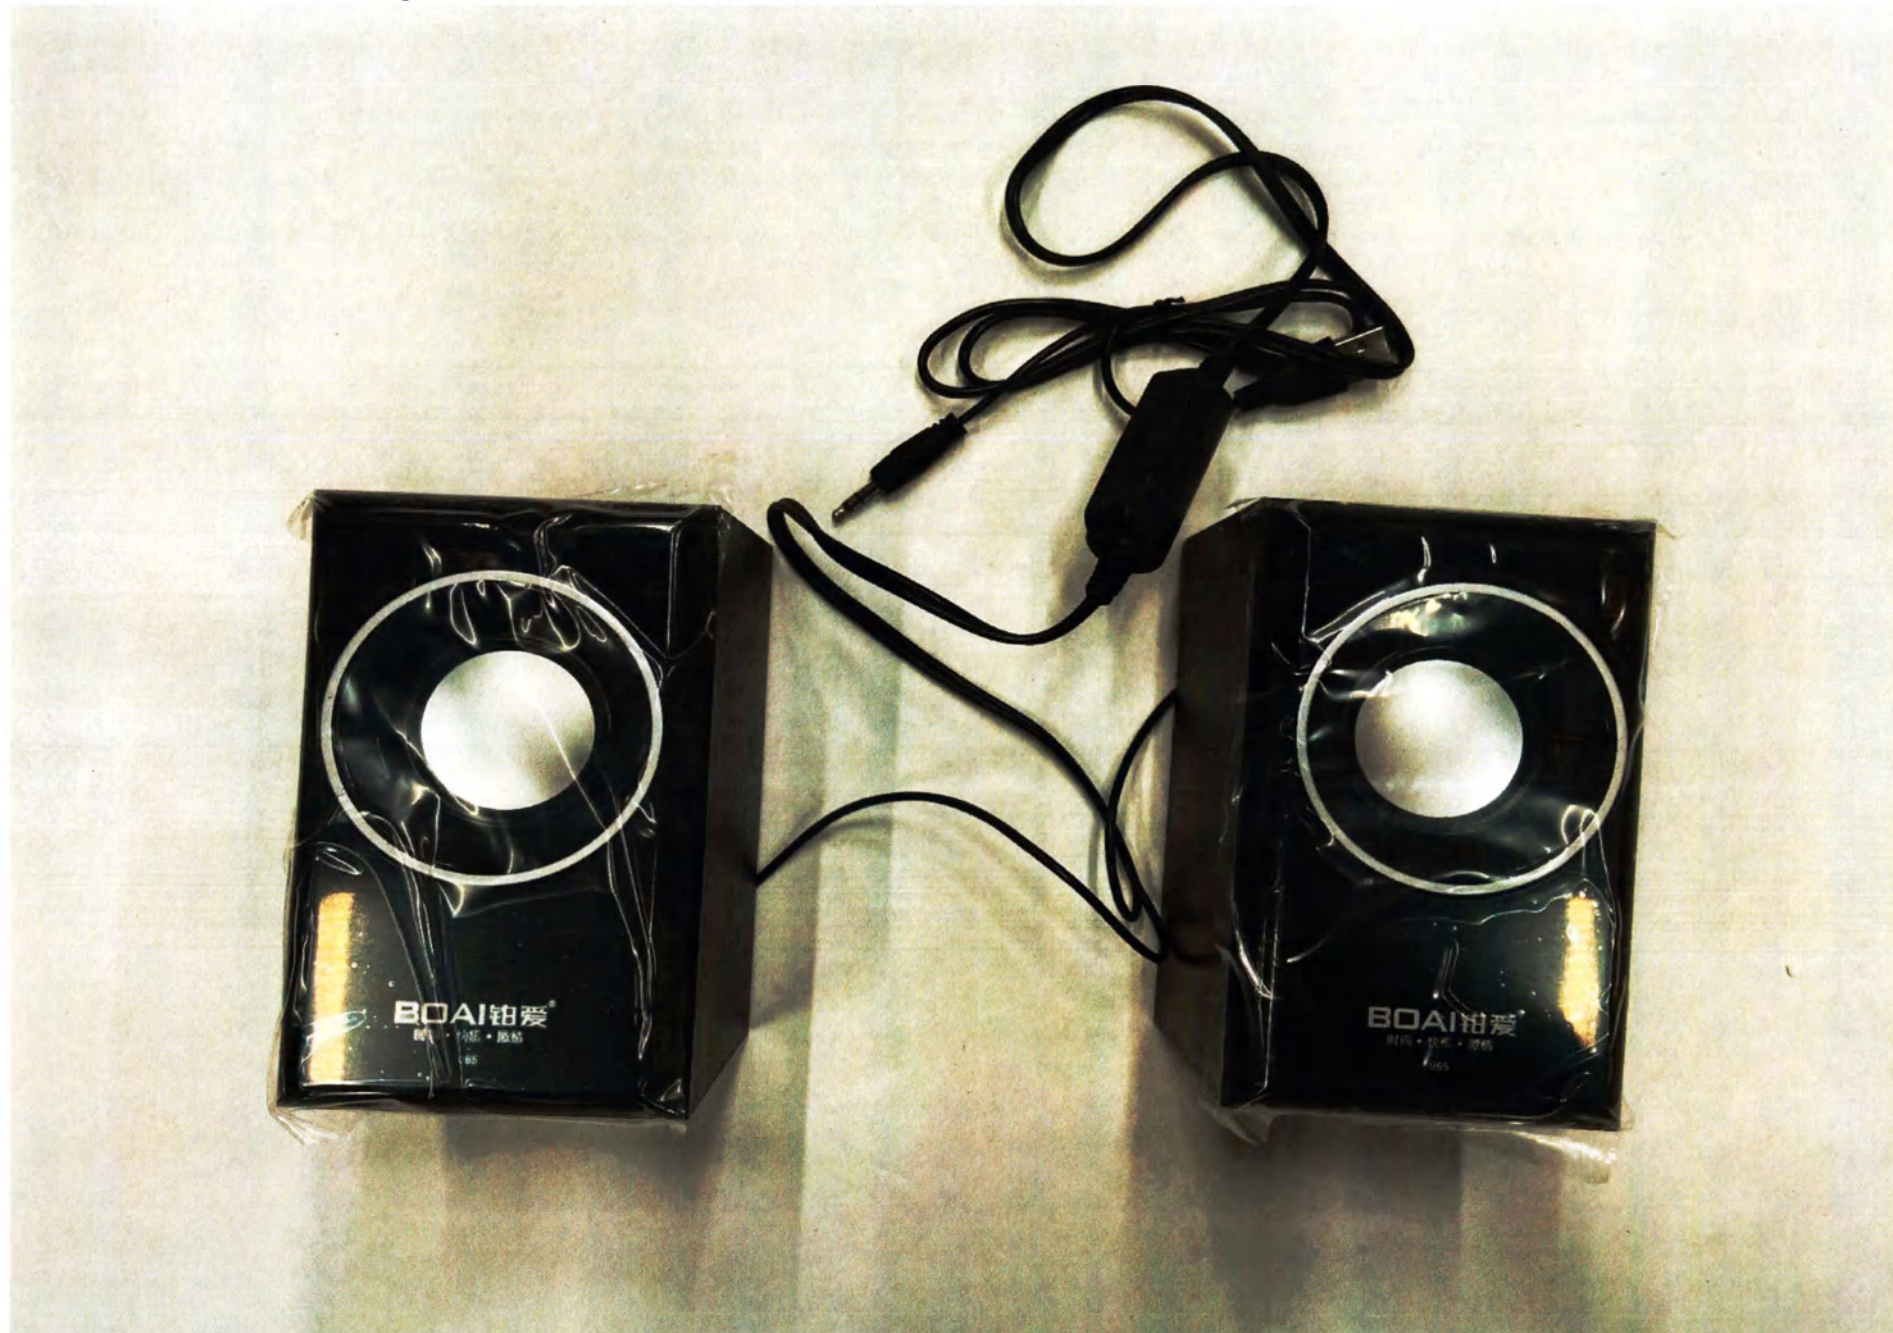

Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Сканер штрих-кодов – 1 шт.)



Система автоматическая микробиологическая ВС120 для in vitro диагностики (Подставка для сканера – 1 шт.)

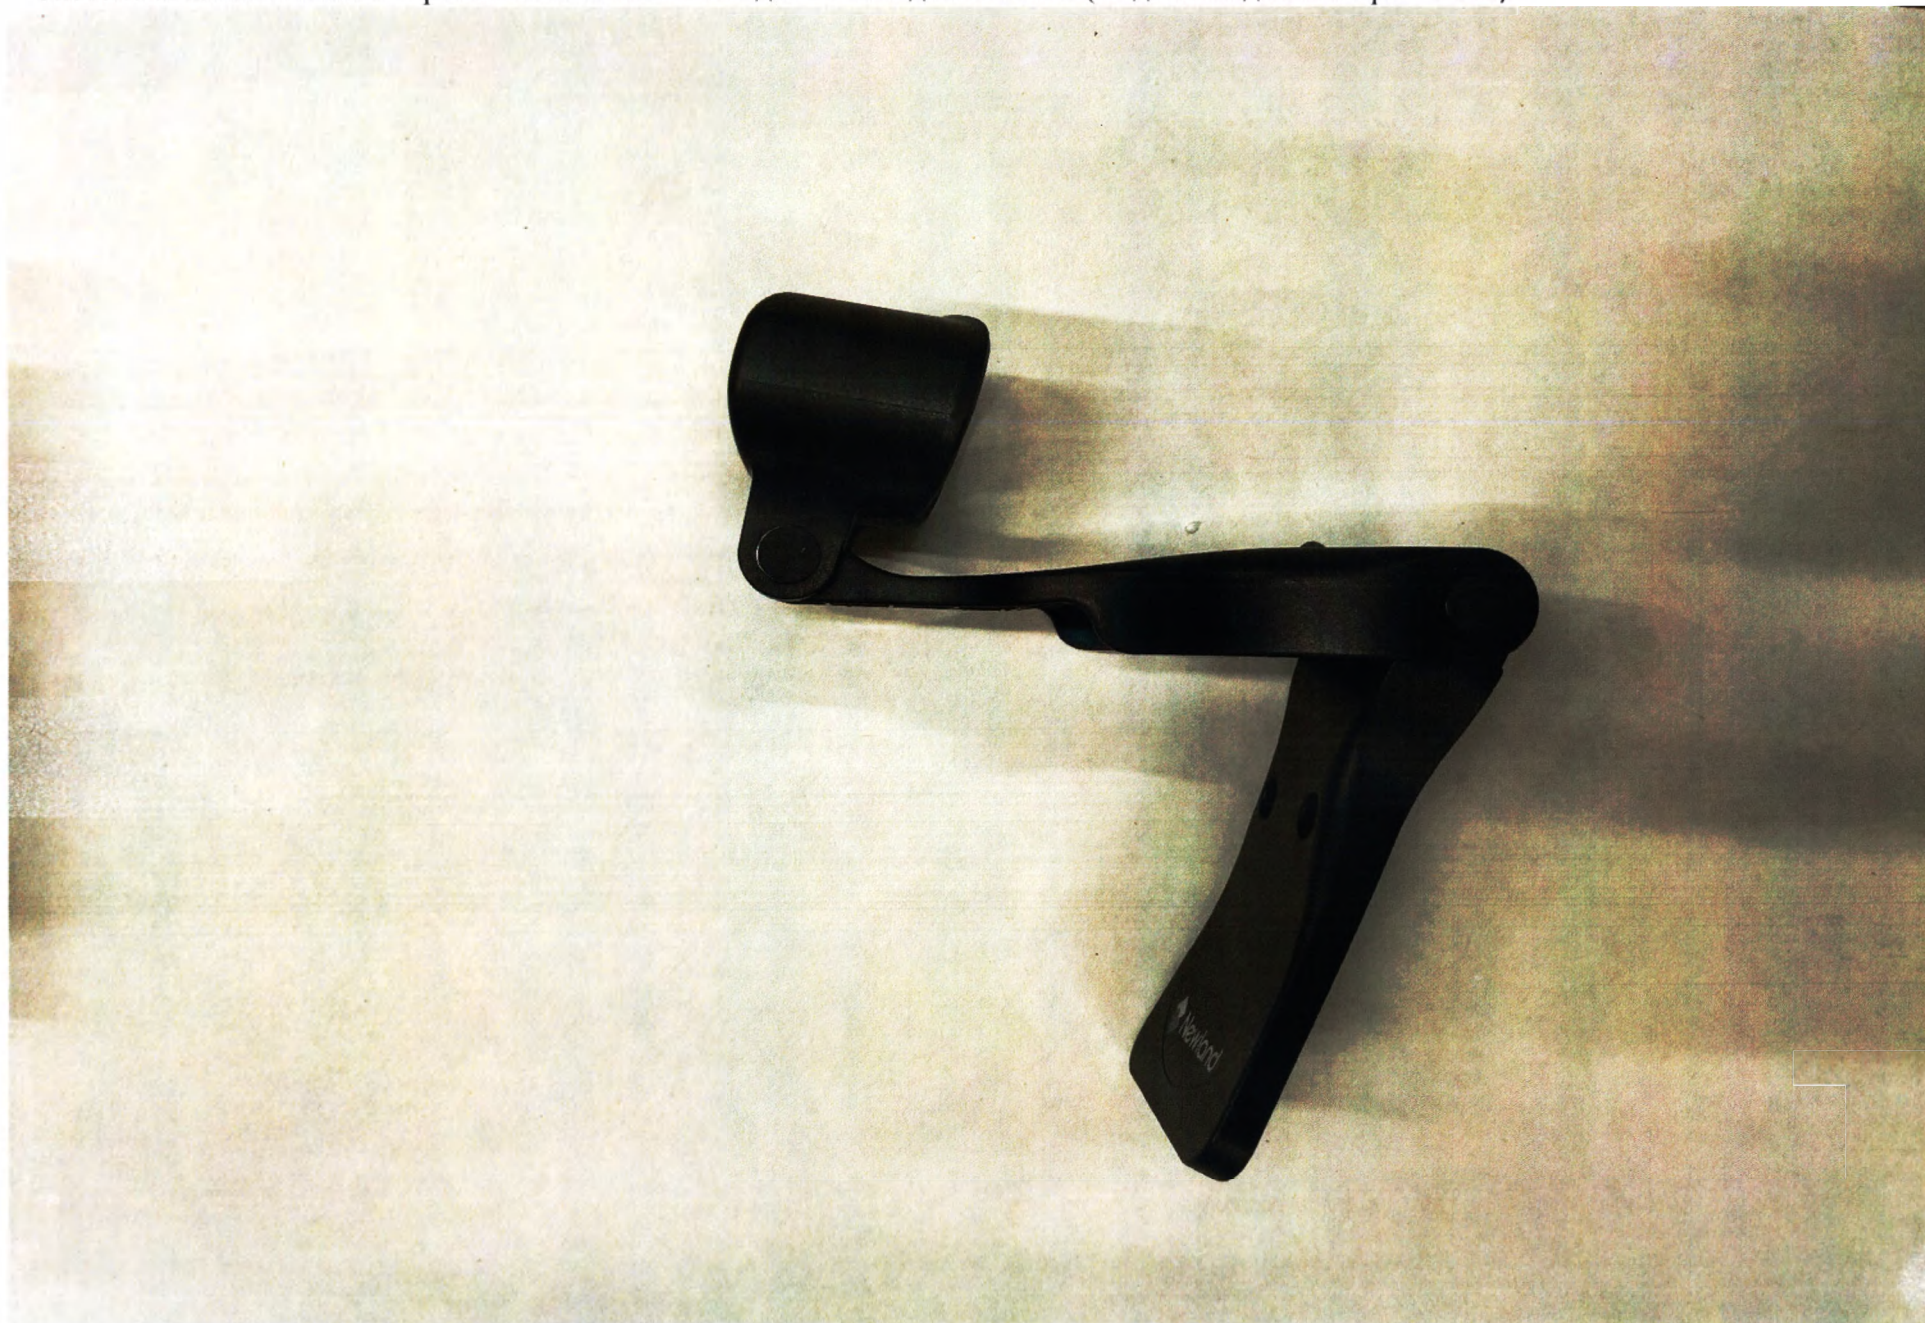

Пронумеровано, прошито и скреплено  
печатью 56 лист (а/ов)  
Руководитель департамента регистрации  
ООО «ИЛС»



И.А. Стариковская