



ООО «Лабораторный проект»
115088, г. Москва, Внутригородская территория
муниципальный округ Таганский, ул. Крутицкая,
дом 17, строение 6, этаж 3, офис 324

тел./факс: +7 495 995 15 83
e-mail: info@lab-project.ru
lab-project.ru

Генеральный директор ООО «Лабораторный проект»
Ипатов С.Б.

"10" августа 2024 г.



Фотографические изображения медицинского изделия:

Анализатор автоматический газов крови, электролитов, метаболитов в образцах цельной крови методами потенциометрии, амперометрии, кондуктометрии для диагностики in vitro PT1000


Анализатор автоматический газов крови, электролитов, метаболитов в образцах цельной крови методами потенциометрии, амперометрии, кондуктометрии для диагностики in vitro PT1000, в составе:

1. Анализатор PT1000 – 1 шт.







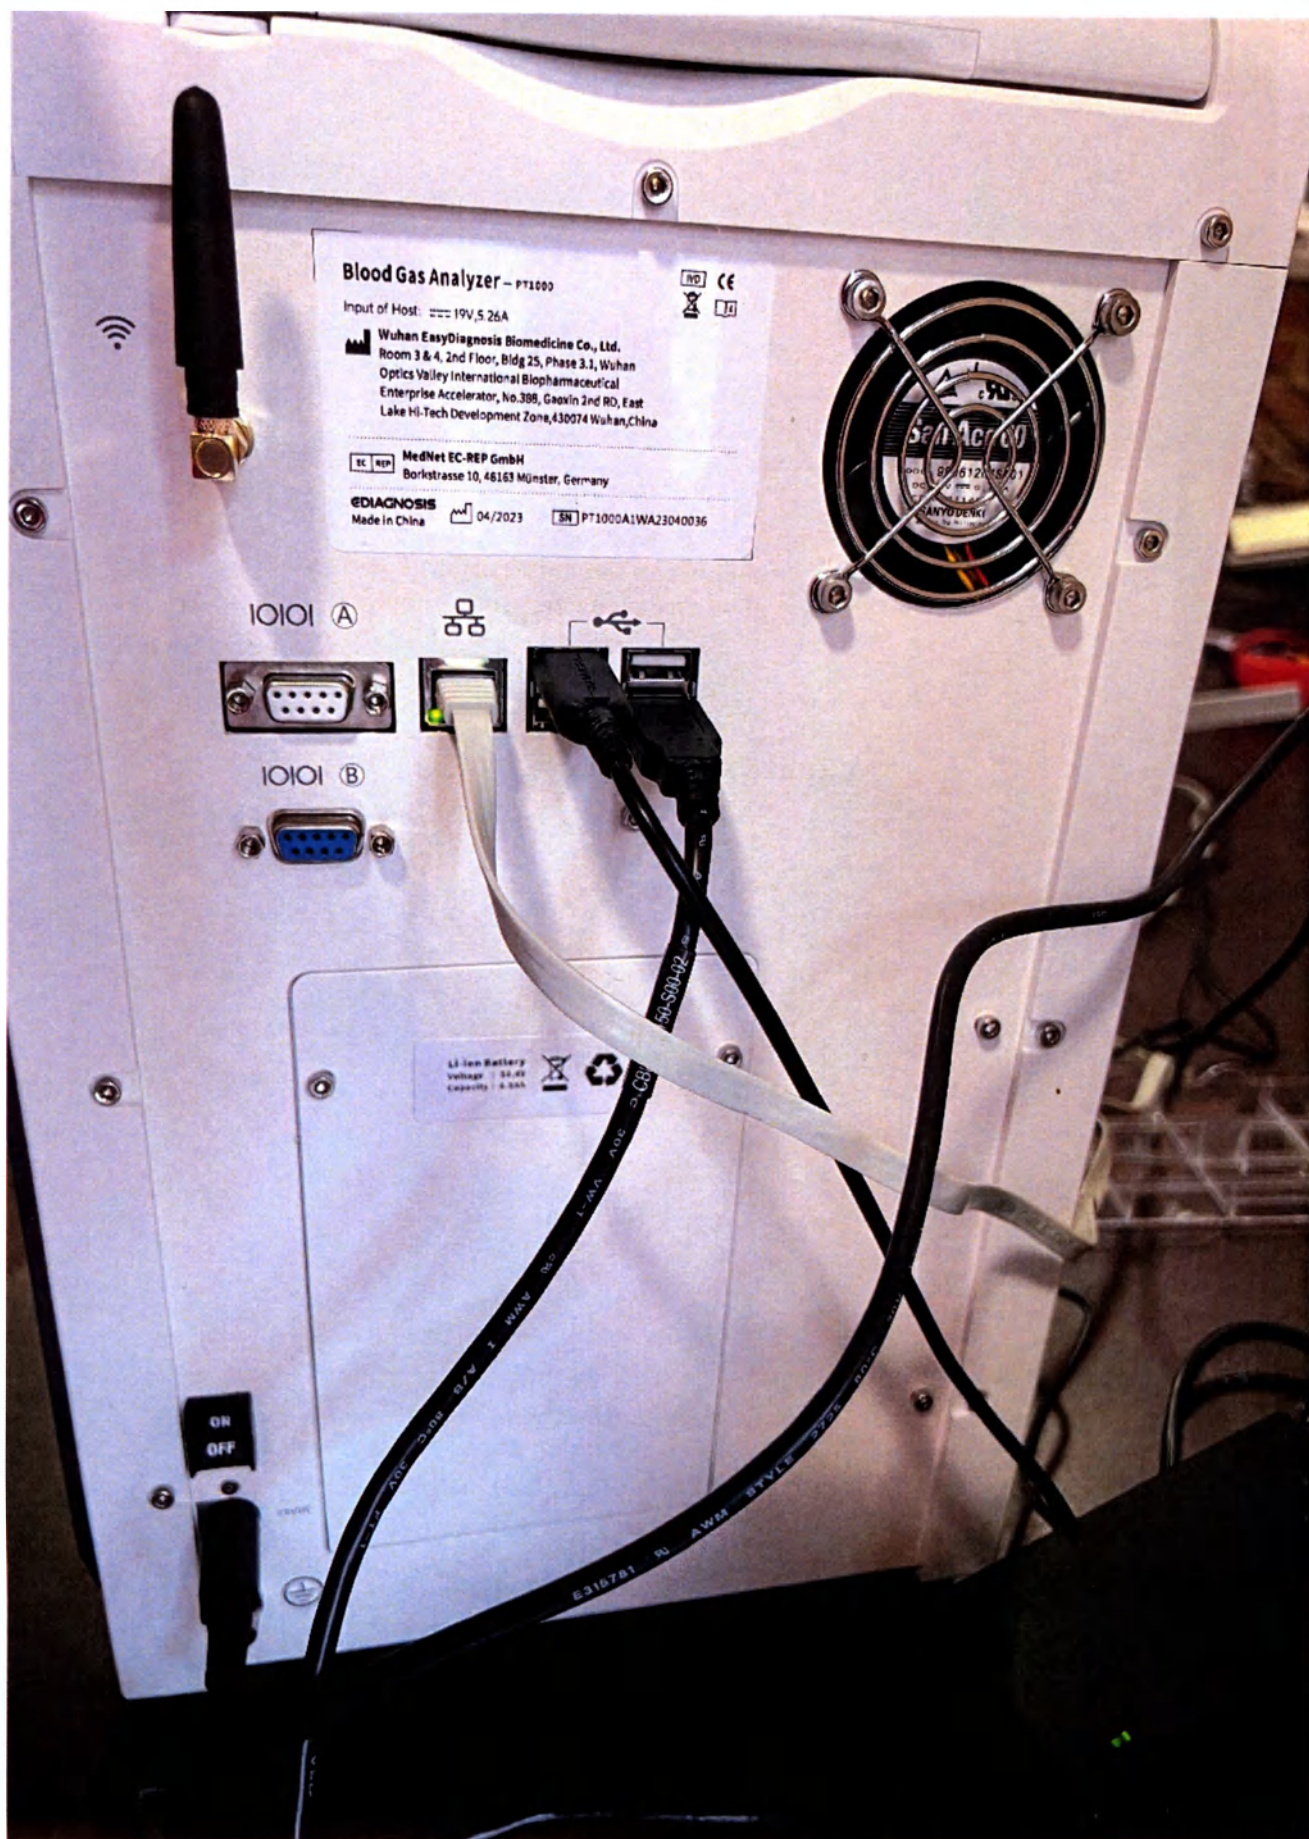

Анализатор автоматический газов крови, электролитов, метаболитов в образцах цельной крови методами потенциометрии, амперометрии, кондуктометрии для диагностики in vitro PT1000

Руководство по эксплуатации

Wuhan EasyDiagnosis Biomedicine Co., Ltd.

Версия: V1.4
Дата выпуска: 1 февраля 2024 г.

3. Блок питания (XP POWER, MODEL NO: AHM100PS19) – 1 шт.



4. Кабель питания – 1 шт.



5. Аккумуляторная батарея (SHENZHEN HENGYU ENRGY TECHNOLOGY CO.,LTD, model: HYLB-2155 (4INR19/66-2)) – 1 шт.



可充电锂离子电池 Rechargeable Li-ion Battery

型号Model: HYLB-2155 (41NR19/66-2)

标称电压Nominal Voltage : 14.4V

额定容量Nominal Capacity : 6500mAh / 93.6Wh

充电限制电压Limited Charge Voltage: 16.8V

工作温度范围Temp Range: -10°C ~ 60°C

制造日期Date of Manufacture : 2023-02

⚠ 警告CAUTION

- 只能使用配套专用充电器
Charge only with specified charger
- 不要将电池加热或投入火中
Don't heat or dispose of in fire
- 不要将电池拆开
Don't disassemble the battery
- 不要将电池正负极短路
Don't short circuit "+" "-"



Li-ion



SN: HY230200099

制造商




中国制造MADE IN CHINA
深圳市恒宇电能科技有限公司
SHEN ZHEN HENG YU ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD

6. Сканер штрих-кодов (Honeywell, model: HH450) – 1 шт.





7. Бумага для термопечати – 2 шт.

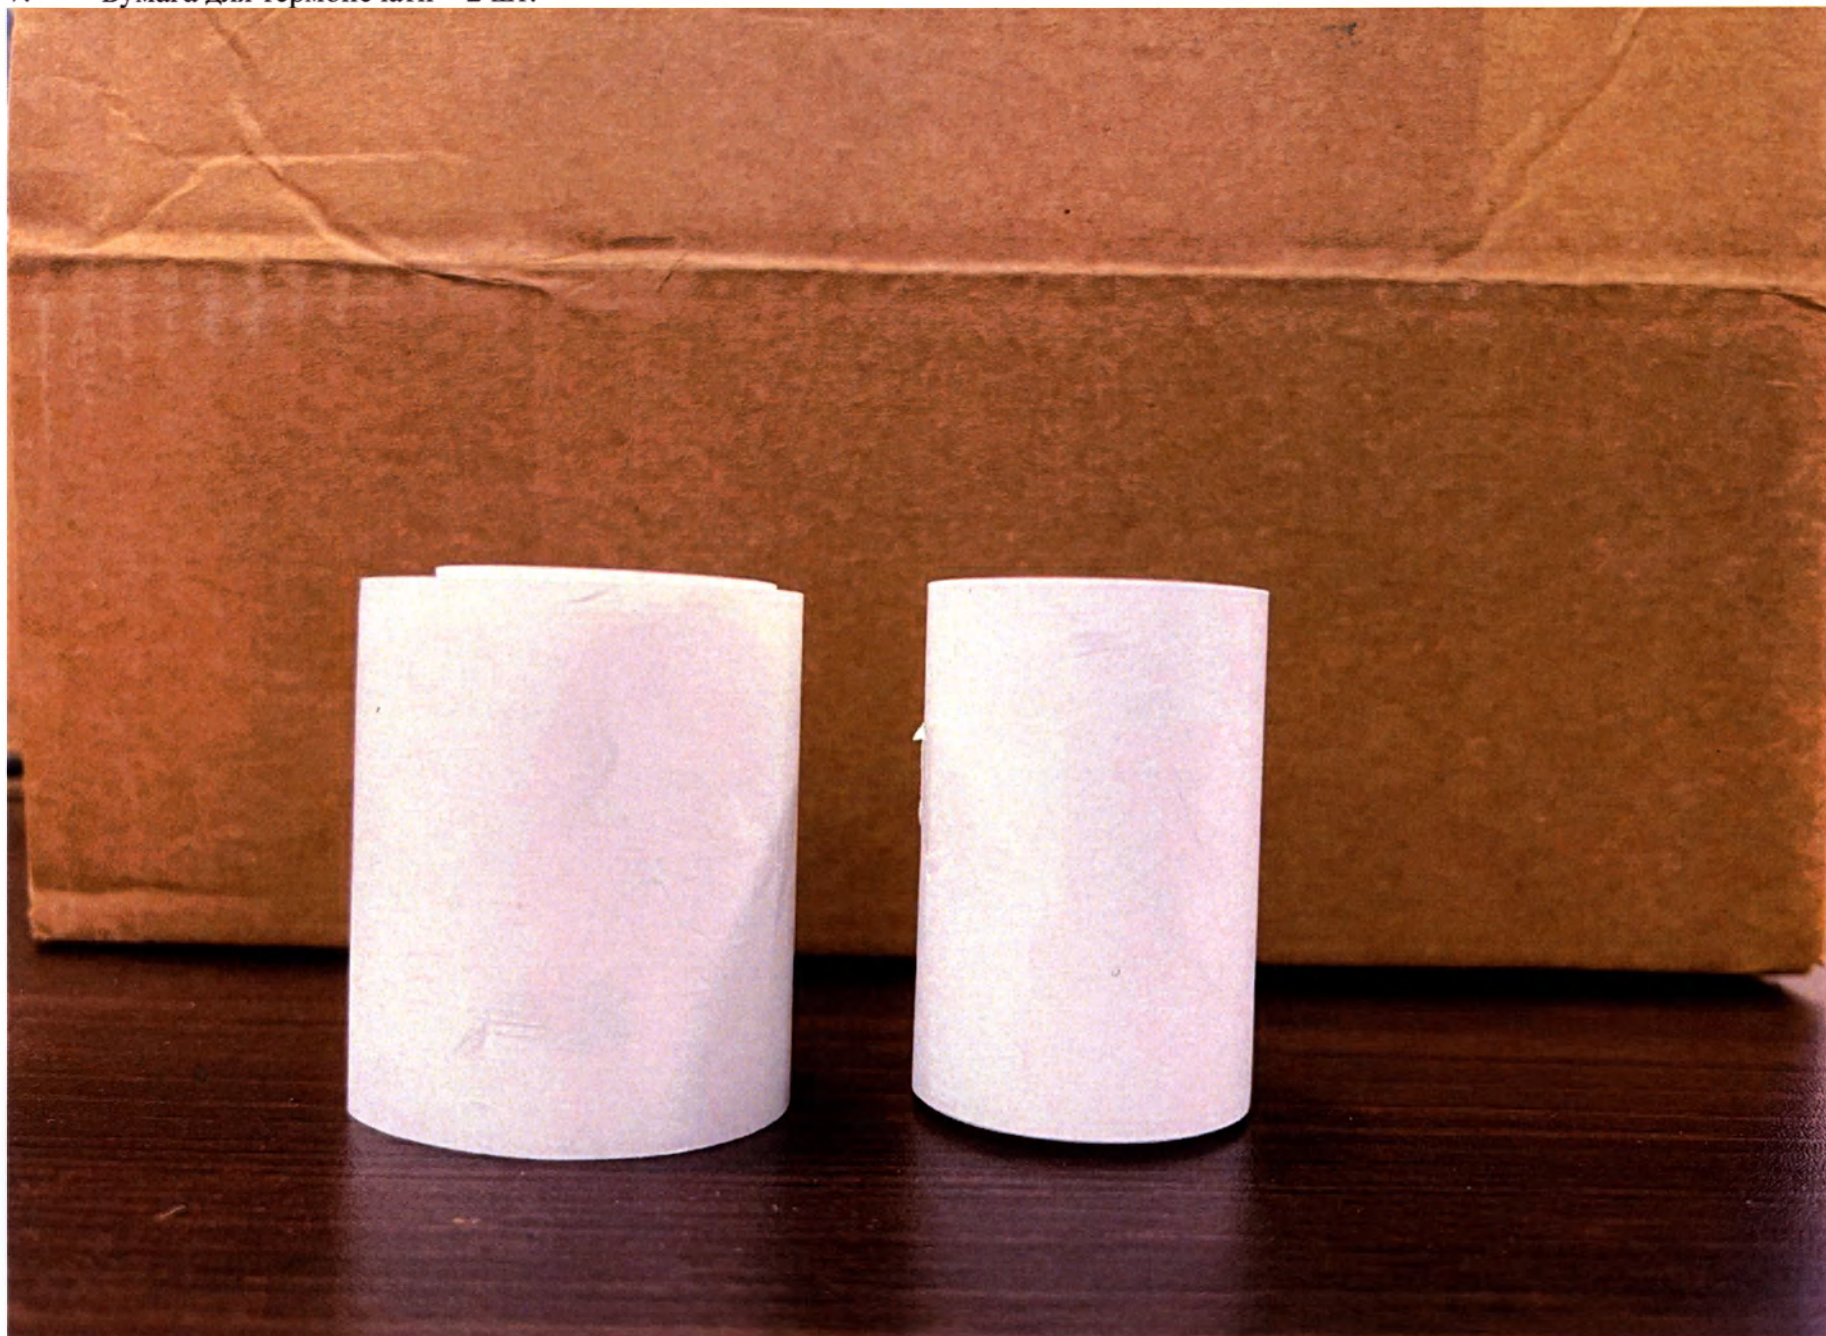

8. Программное обеспечение на USB-носителе – 1 шт.



Потребительская упаковка Анализатора автоматического газов крови, электролитов, метаболитов в образцах цельной крови методами потенциометрии, амперометрии, кондуктометрии для диагностики in vitro PT1000







Blood Gas Analyzer

— PT1000

Wuhan EasyDiagnos Biomedicine Co., Ltd.

Room 3 & 4, 2nd Floor, Bldg 2/3, Phase 3.1, Wuhan Optics Valley International
Biopharmaceutical Enterprise Accelerator, No. 388, Gaolin 2nd Rd, East Lake
Hi-Tech Development Zone, 430074 Wuhan, China

Tel: +86(0)27-8780855 Fax: +86(0)27-8780805

URL: www.mideaasydiagnosis.com
Email: info@ediagnosis.cn

EDIAGNOSIS

EC REP MedNet EC-REP GmbH
Borkstrasse 10, 48163 Münster, Germany

30°C


35°C

25%

93%

40kPa

108.6kPa



FVD   04/2023

SN PT1000A1WA23040042

Генеральный директор
Ипатов С.В.
Лабораторный проект
Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
18/05/2019