



Шуринов Д.В.

Фотографические изображения
медицинского изделия

***Система ультразвуковая диагностическая
медицинская – «Кларити Уро» («Clarity Uro»)
по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022***


Производства

Общество с ограниченной ответственностью
«ОРХИМЕД» (ООО «ОРХИМЕД»)

117246, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Черемушки, Научный пр-д, д. 10, офис 101(36)

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022


Транспортная упаковка

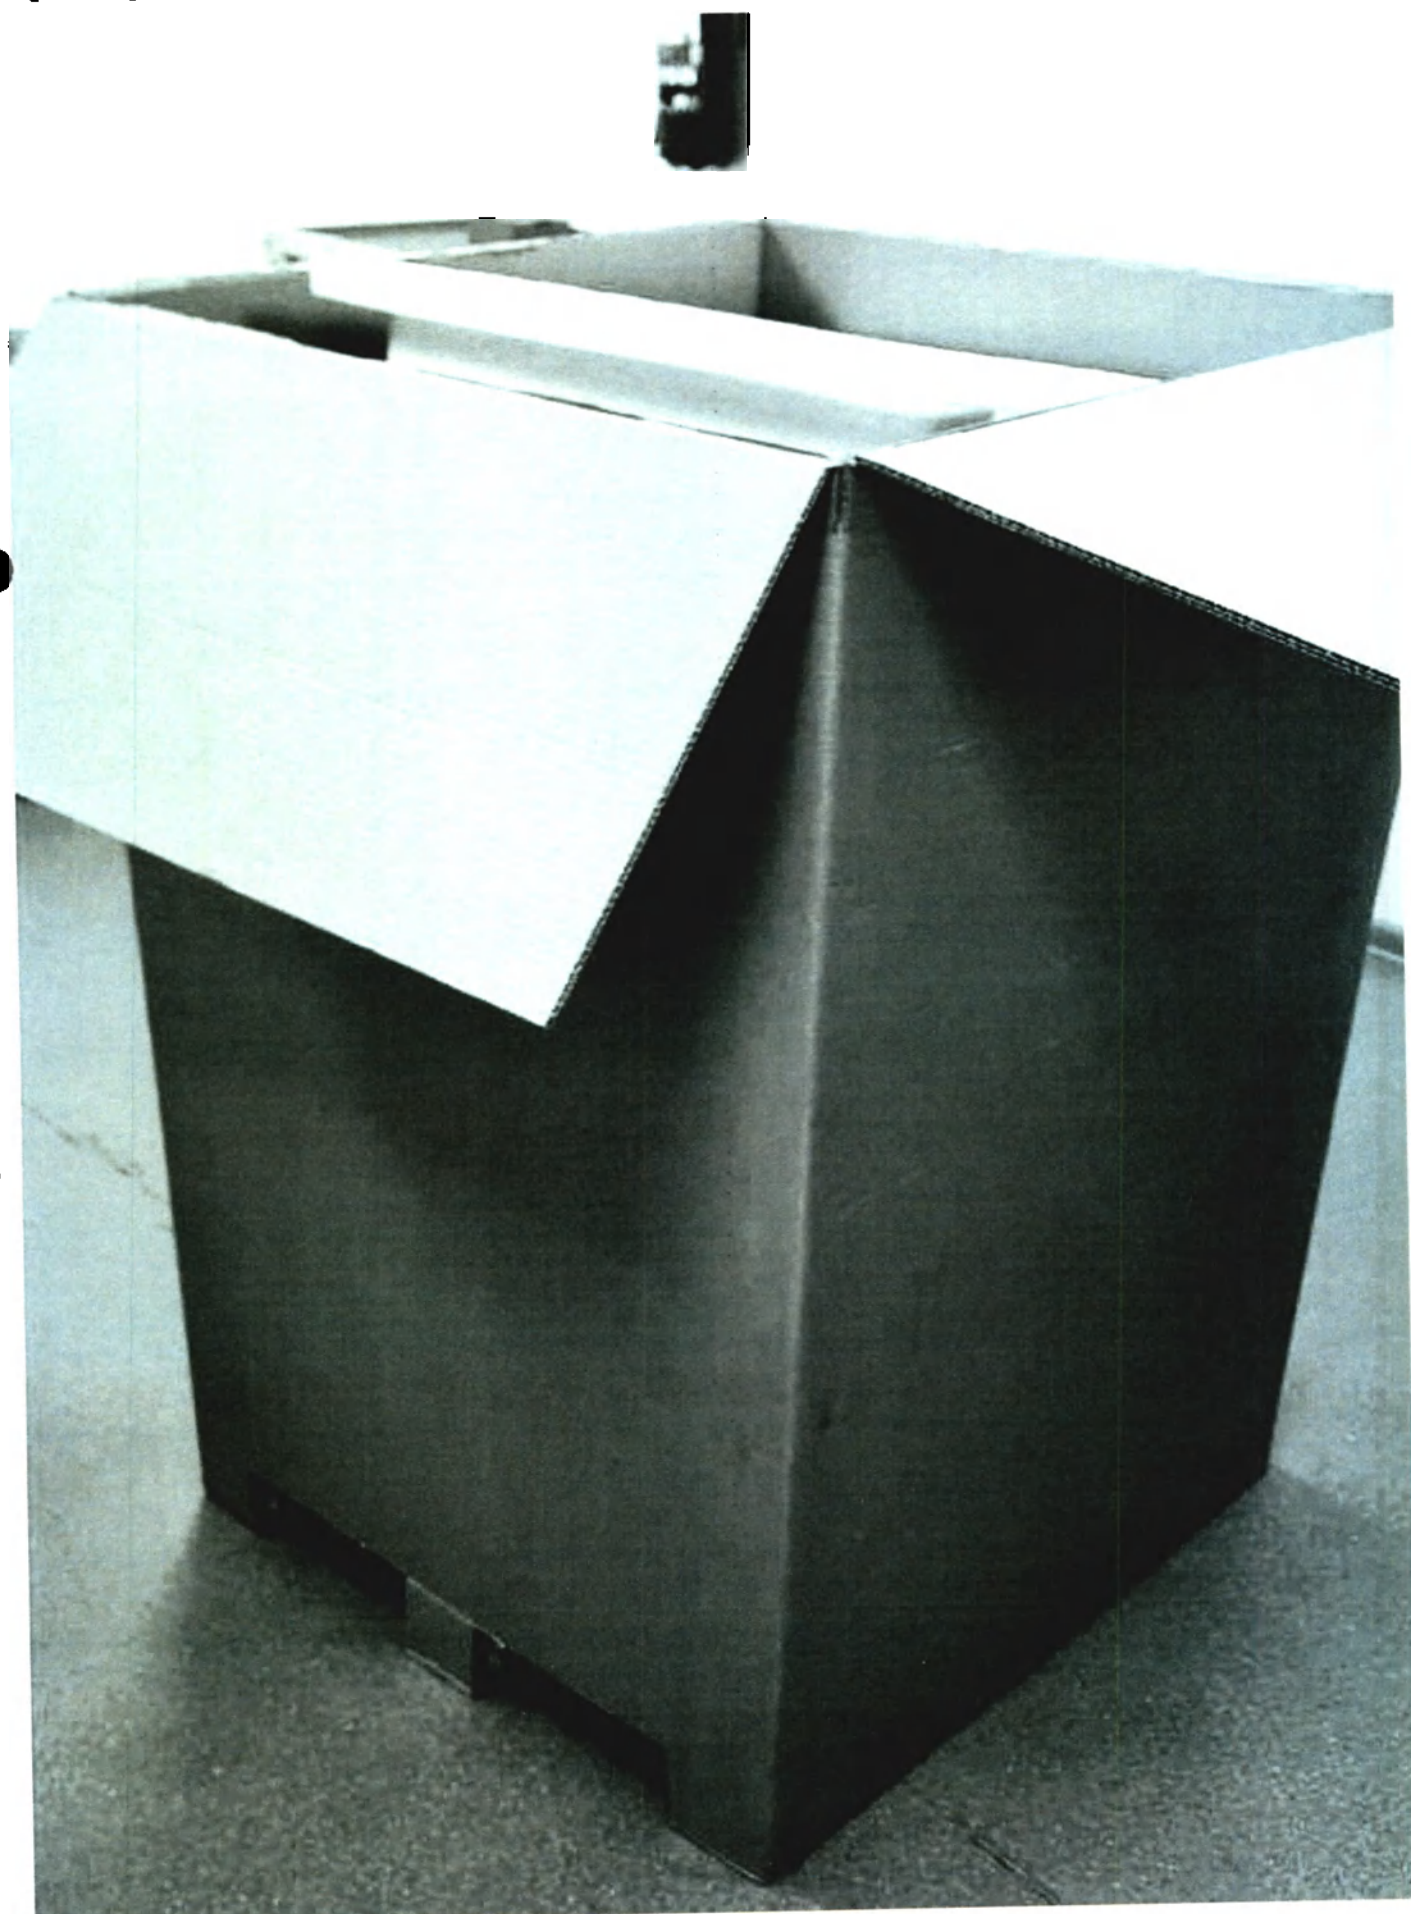

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Маркировка транспортной упаковки



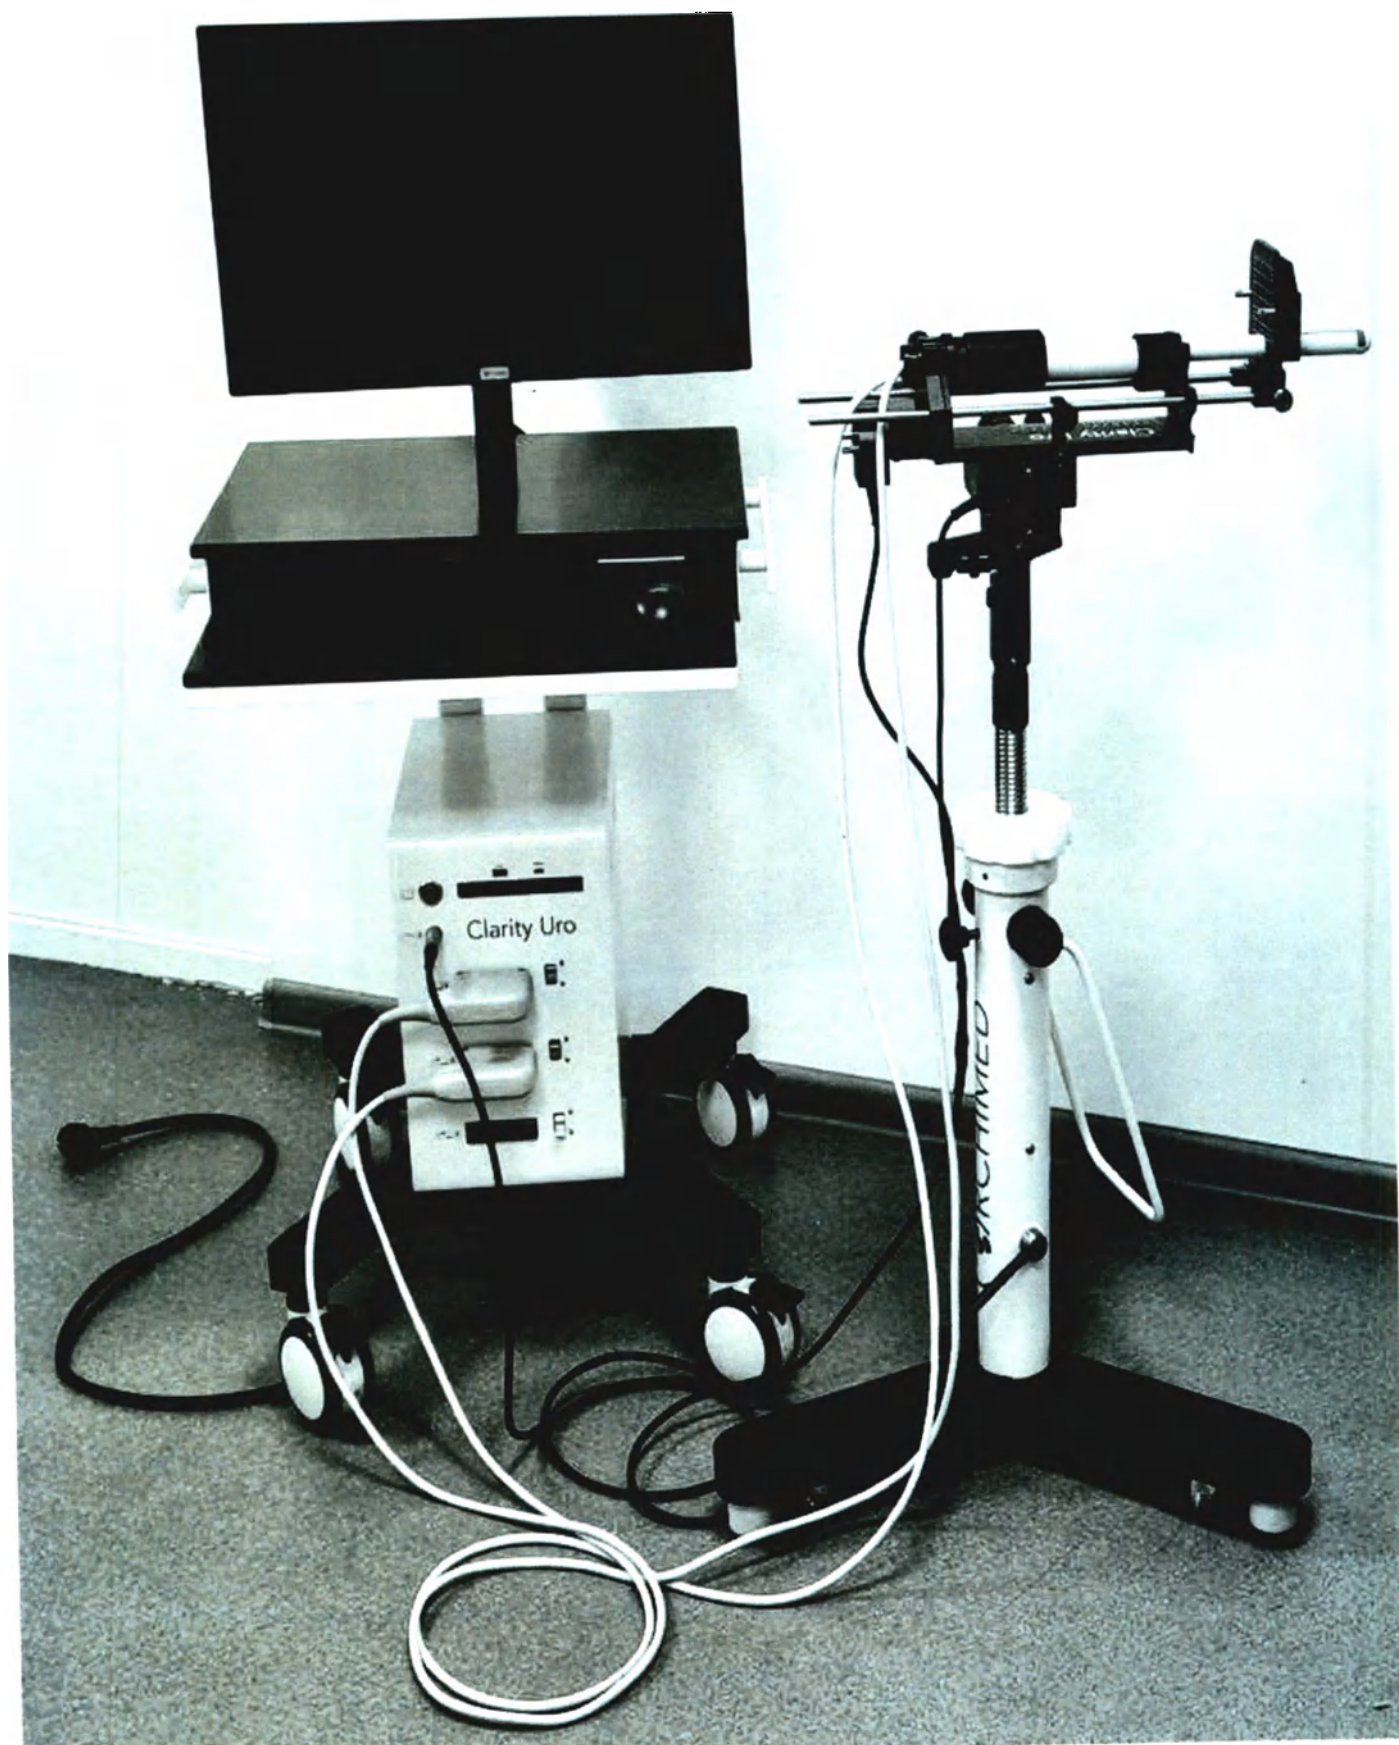

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Консоль



по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022


Маркировка консоли



Система ультразвуковая диагностическая медицинская – «Кларити Уро» («Clarity Uro») 7

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Биплановый ректальный УЗ-датчик (упаковка)

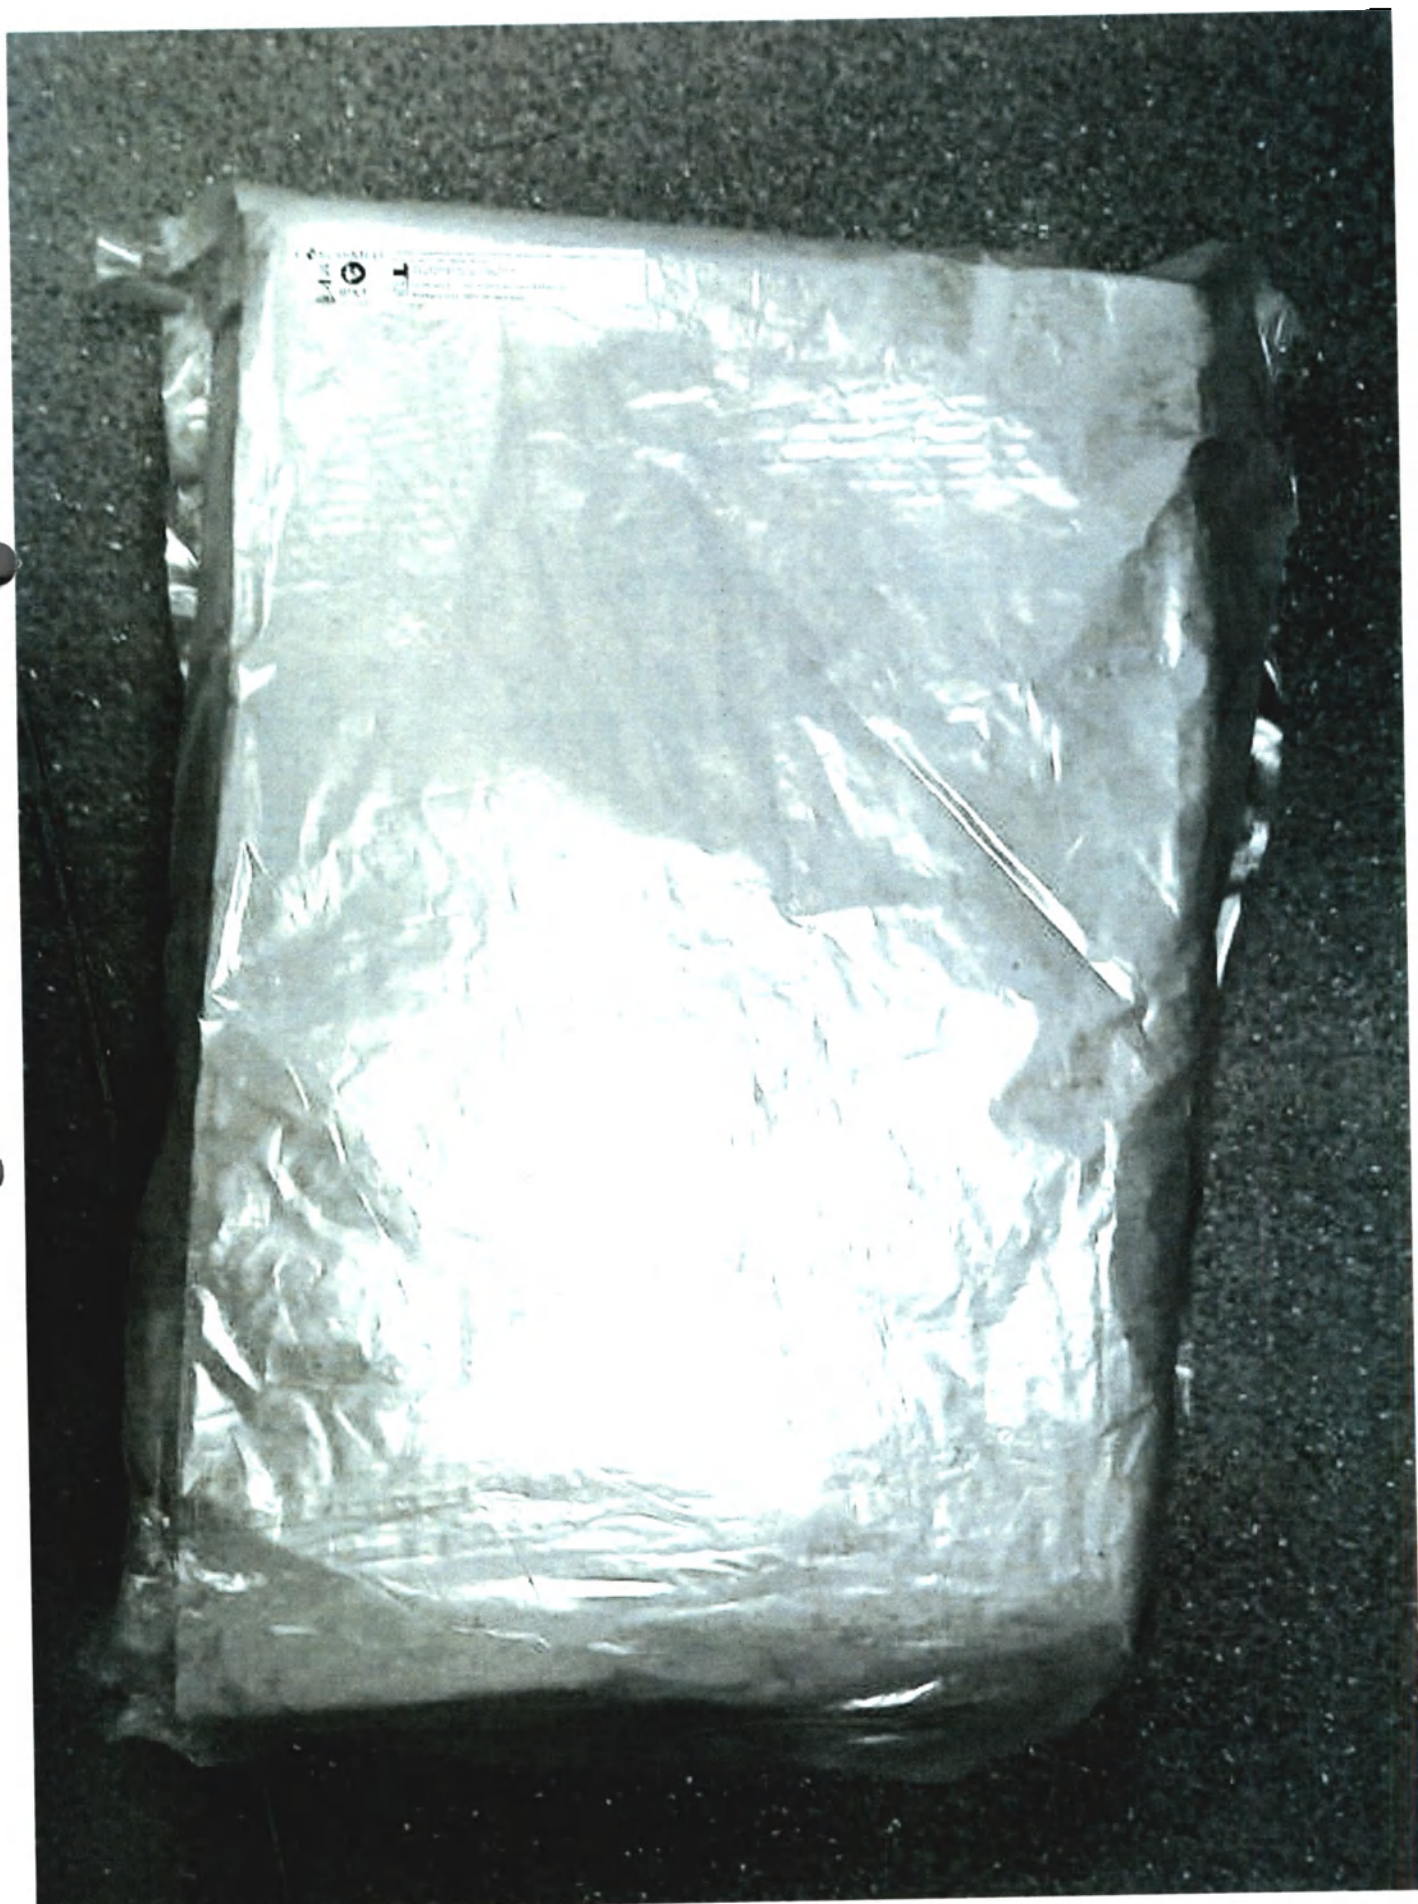

Система ультразвуковая диагностическая медицинская – «Кларити Уро» («Clarity Uro»)

8


по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Биплановый ректальный УЗ-датчик (маркировка упаковки)



по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Биплановый ректальный УЗ-датчик

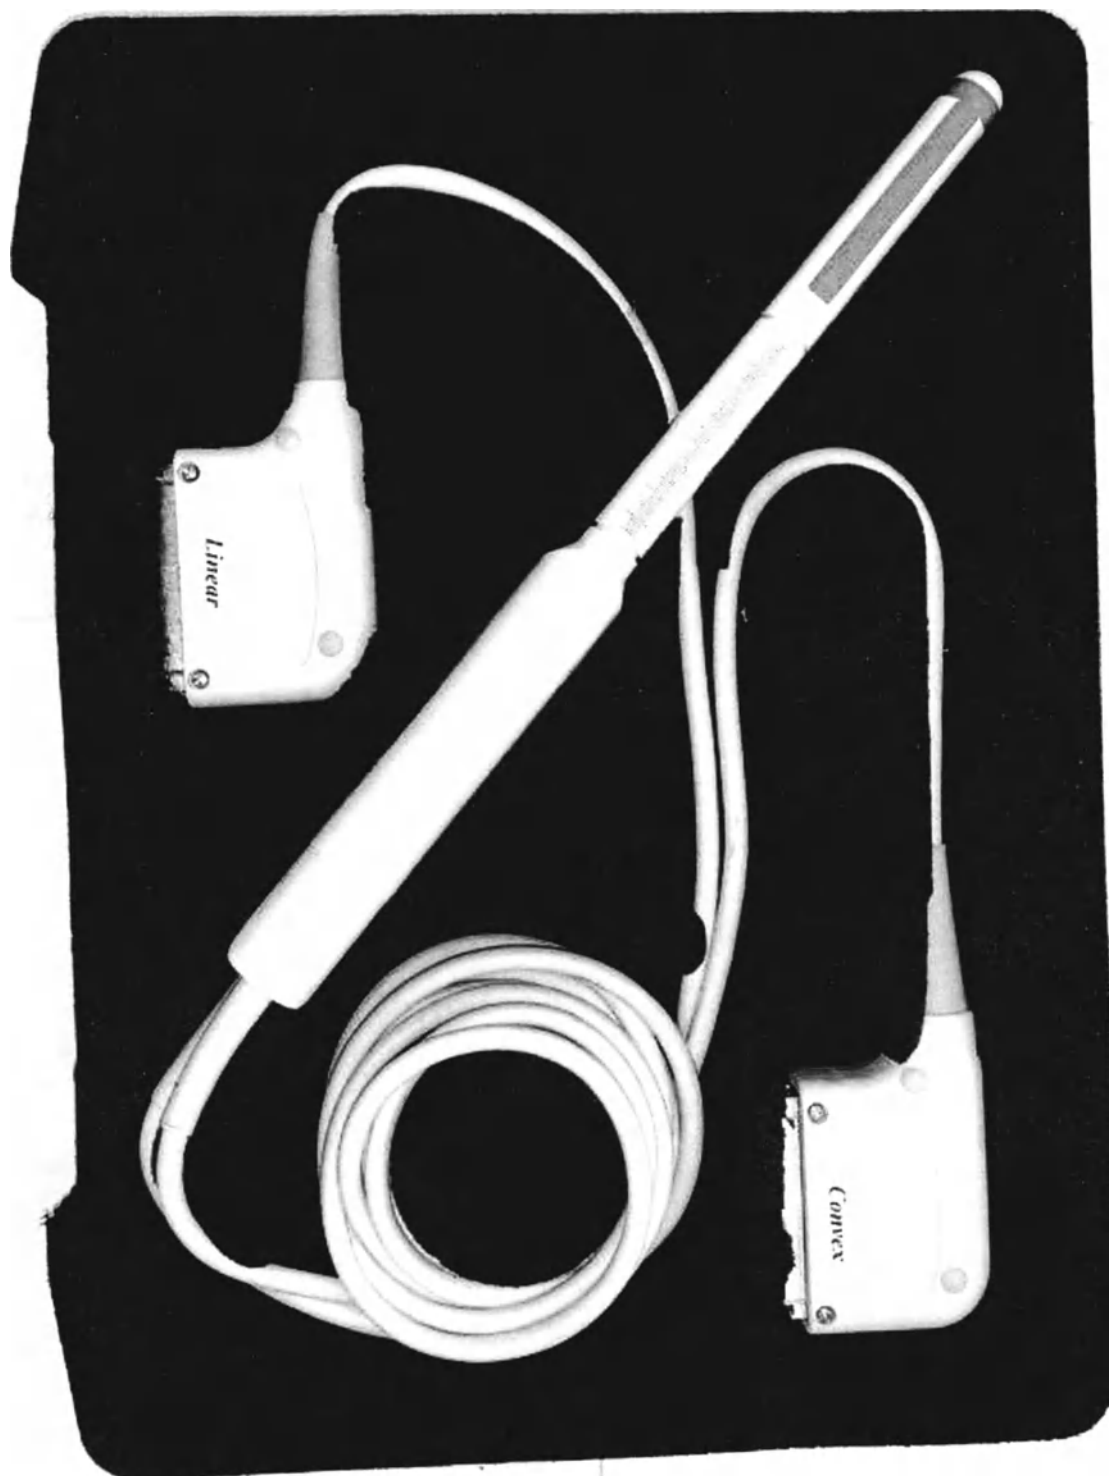

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Блок позиционирования УЗ-датчика (упаковка)



по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Блок позиционирования УЗ-датчика (маркировка упаковки)



Система ультразвуковая диагностическая медицинская – «Кларити Уро» («Clarity Uro»)
по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

 ООО «ОРХИМЕД», Россия, 117246, г. Москва,
проезд Научный, д. 10, офис 101(36)



12.09.2022

Блок позиционирования УЗ-датчика



SN344012005



SACU003903


по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Блок позиционирования УЗ-датчика



по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Адаптер для УЗ-датчика (упаковка)

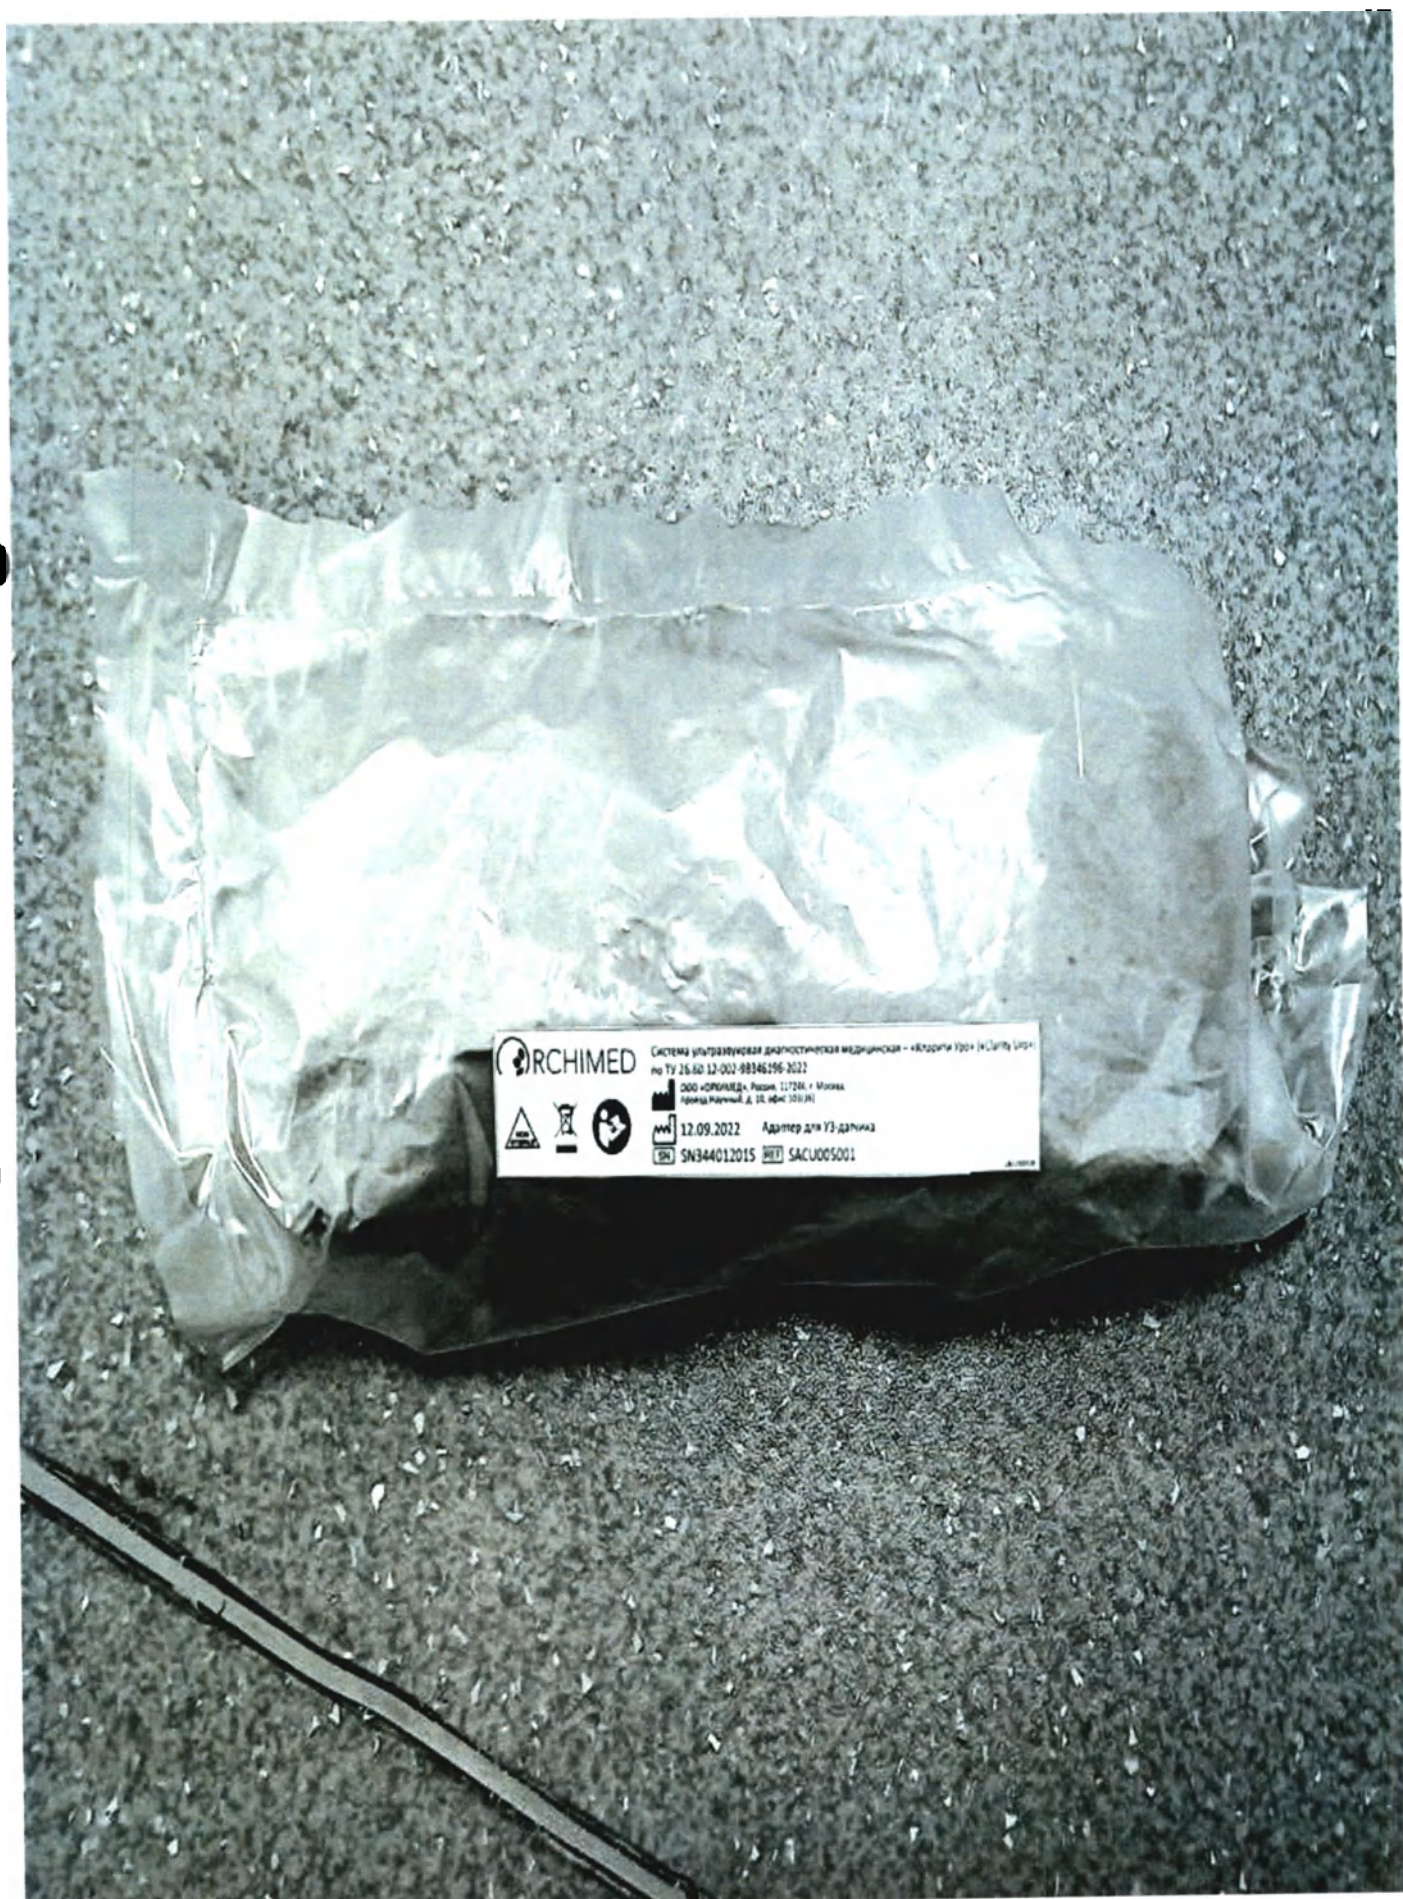

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Адаптер для УЗ-датчика (маркировка упаковки)

 ORCHIMED

Система ультразвуковая диагностическая медицинская – «Кларити Уро» («Clarity Uro»)
по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022



ООО «ОРХИМЕД», Россия, 117246, г. Москва,
проезд Научный, д. 10, офис 101(36)



12.09.2022 Адаптер для УЗ-датчика



SN344012015




SACU005001

LBCU000500


по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Адаптер для УЗ-датчика

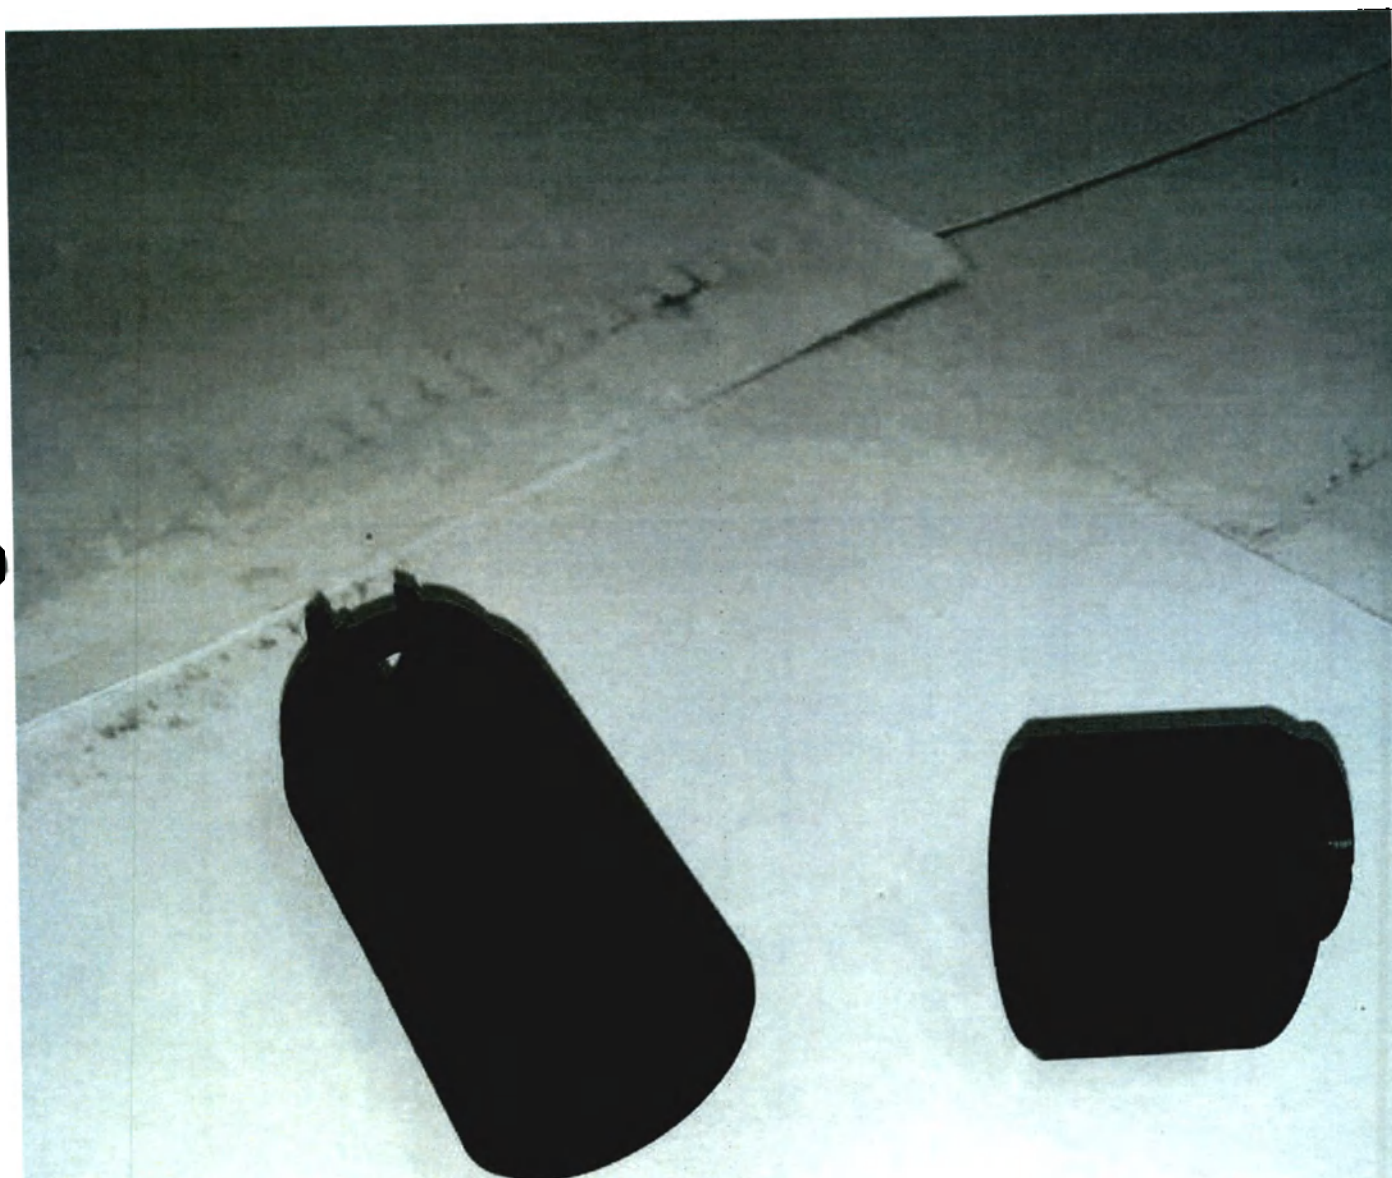


по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Тройная промежуточная решетка (упаковка и маркировка упаковки)

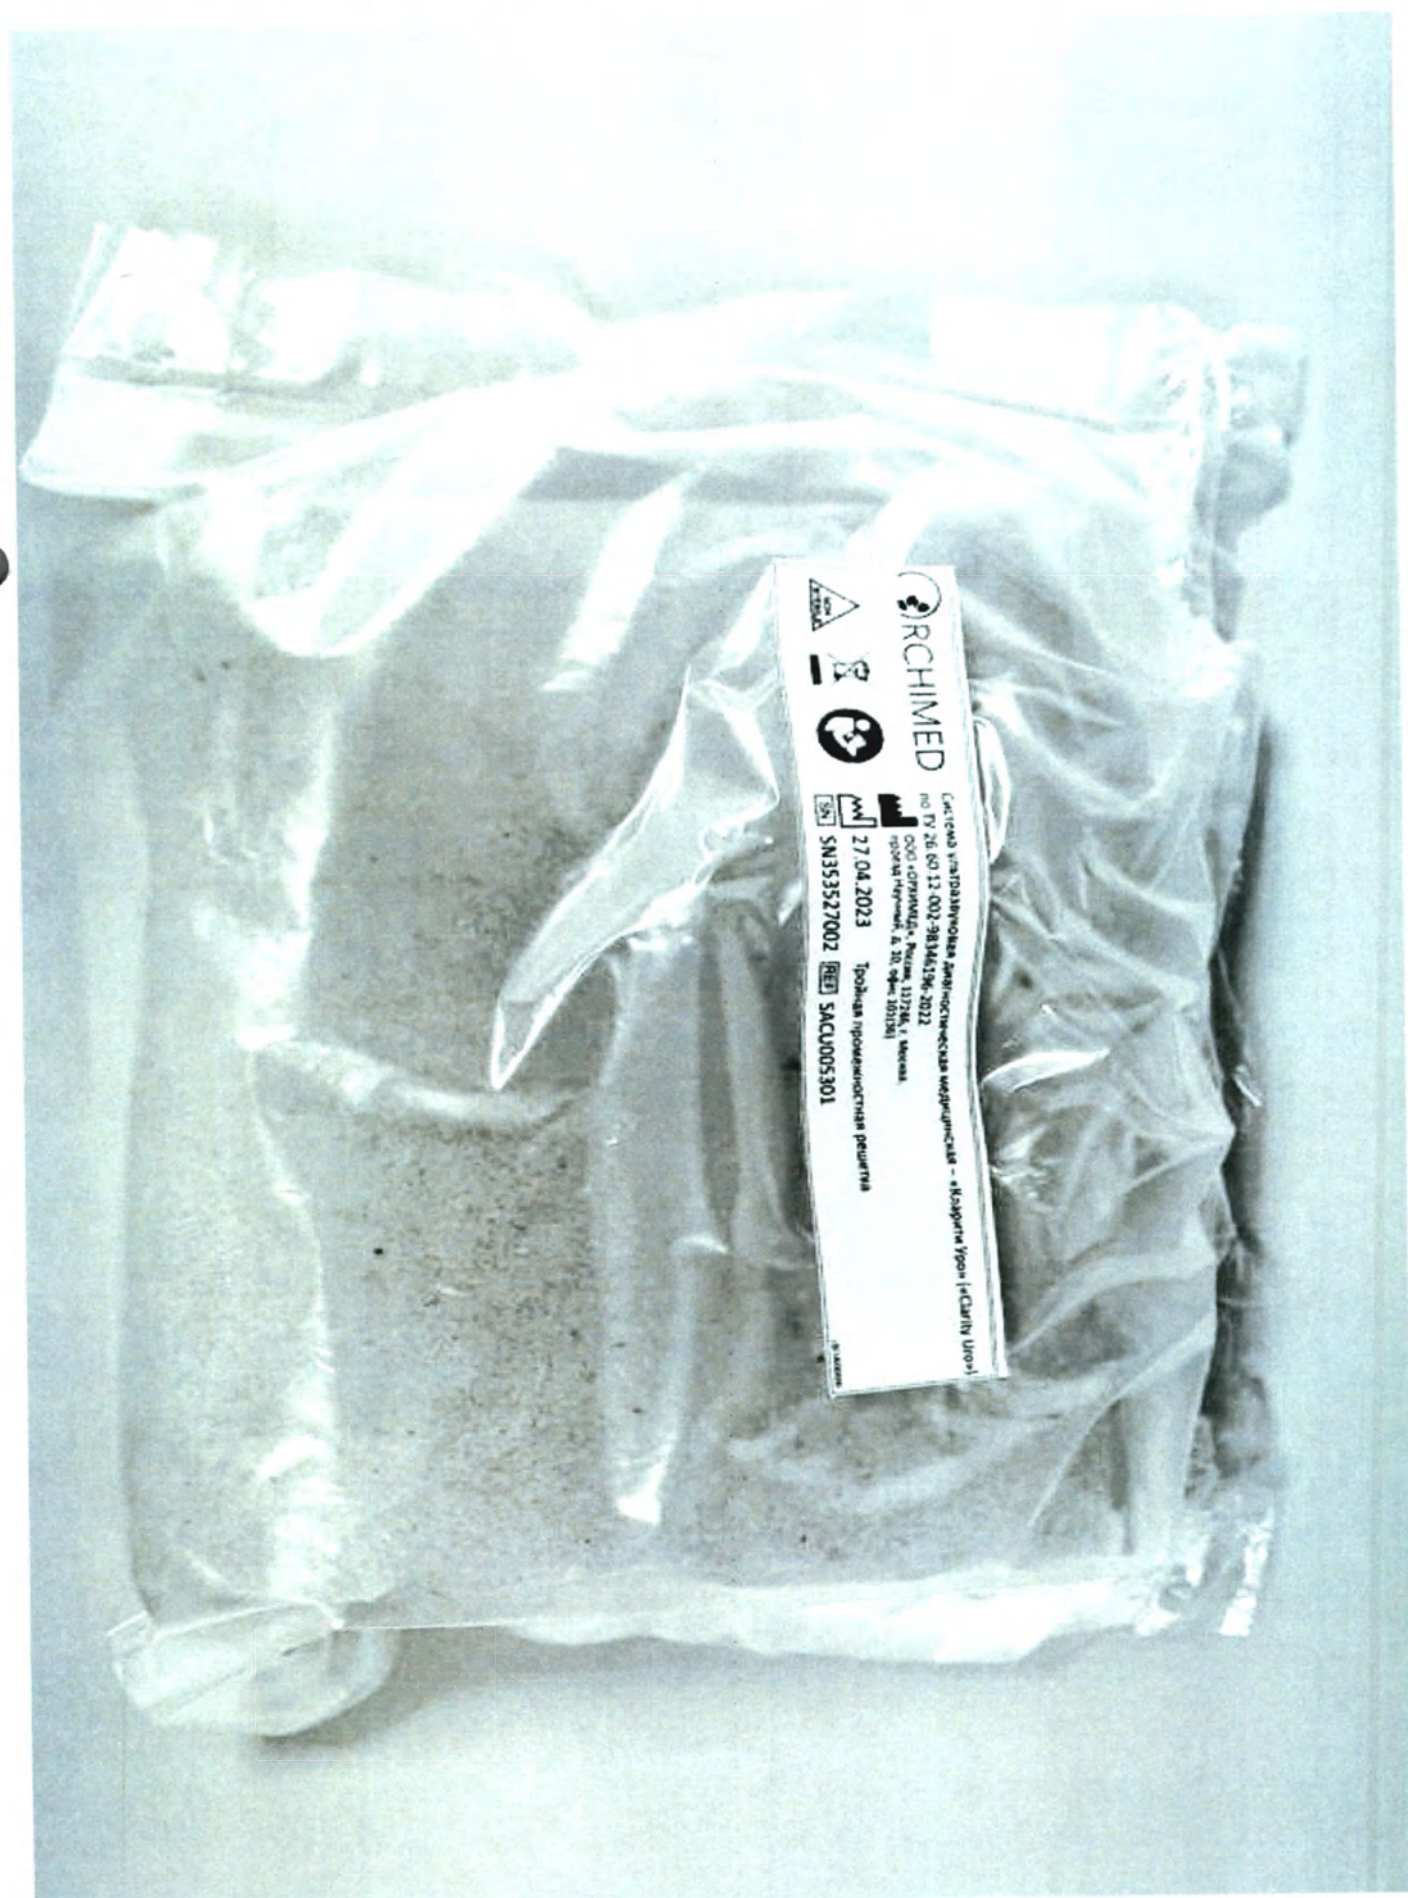

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Тройная промежуточная решетка

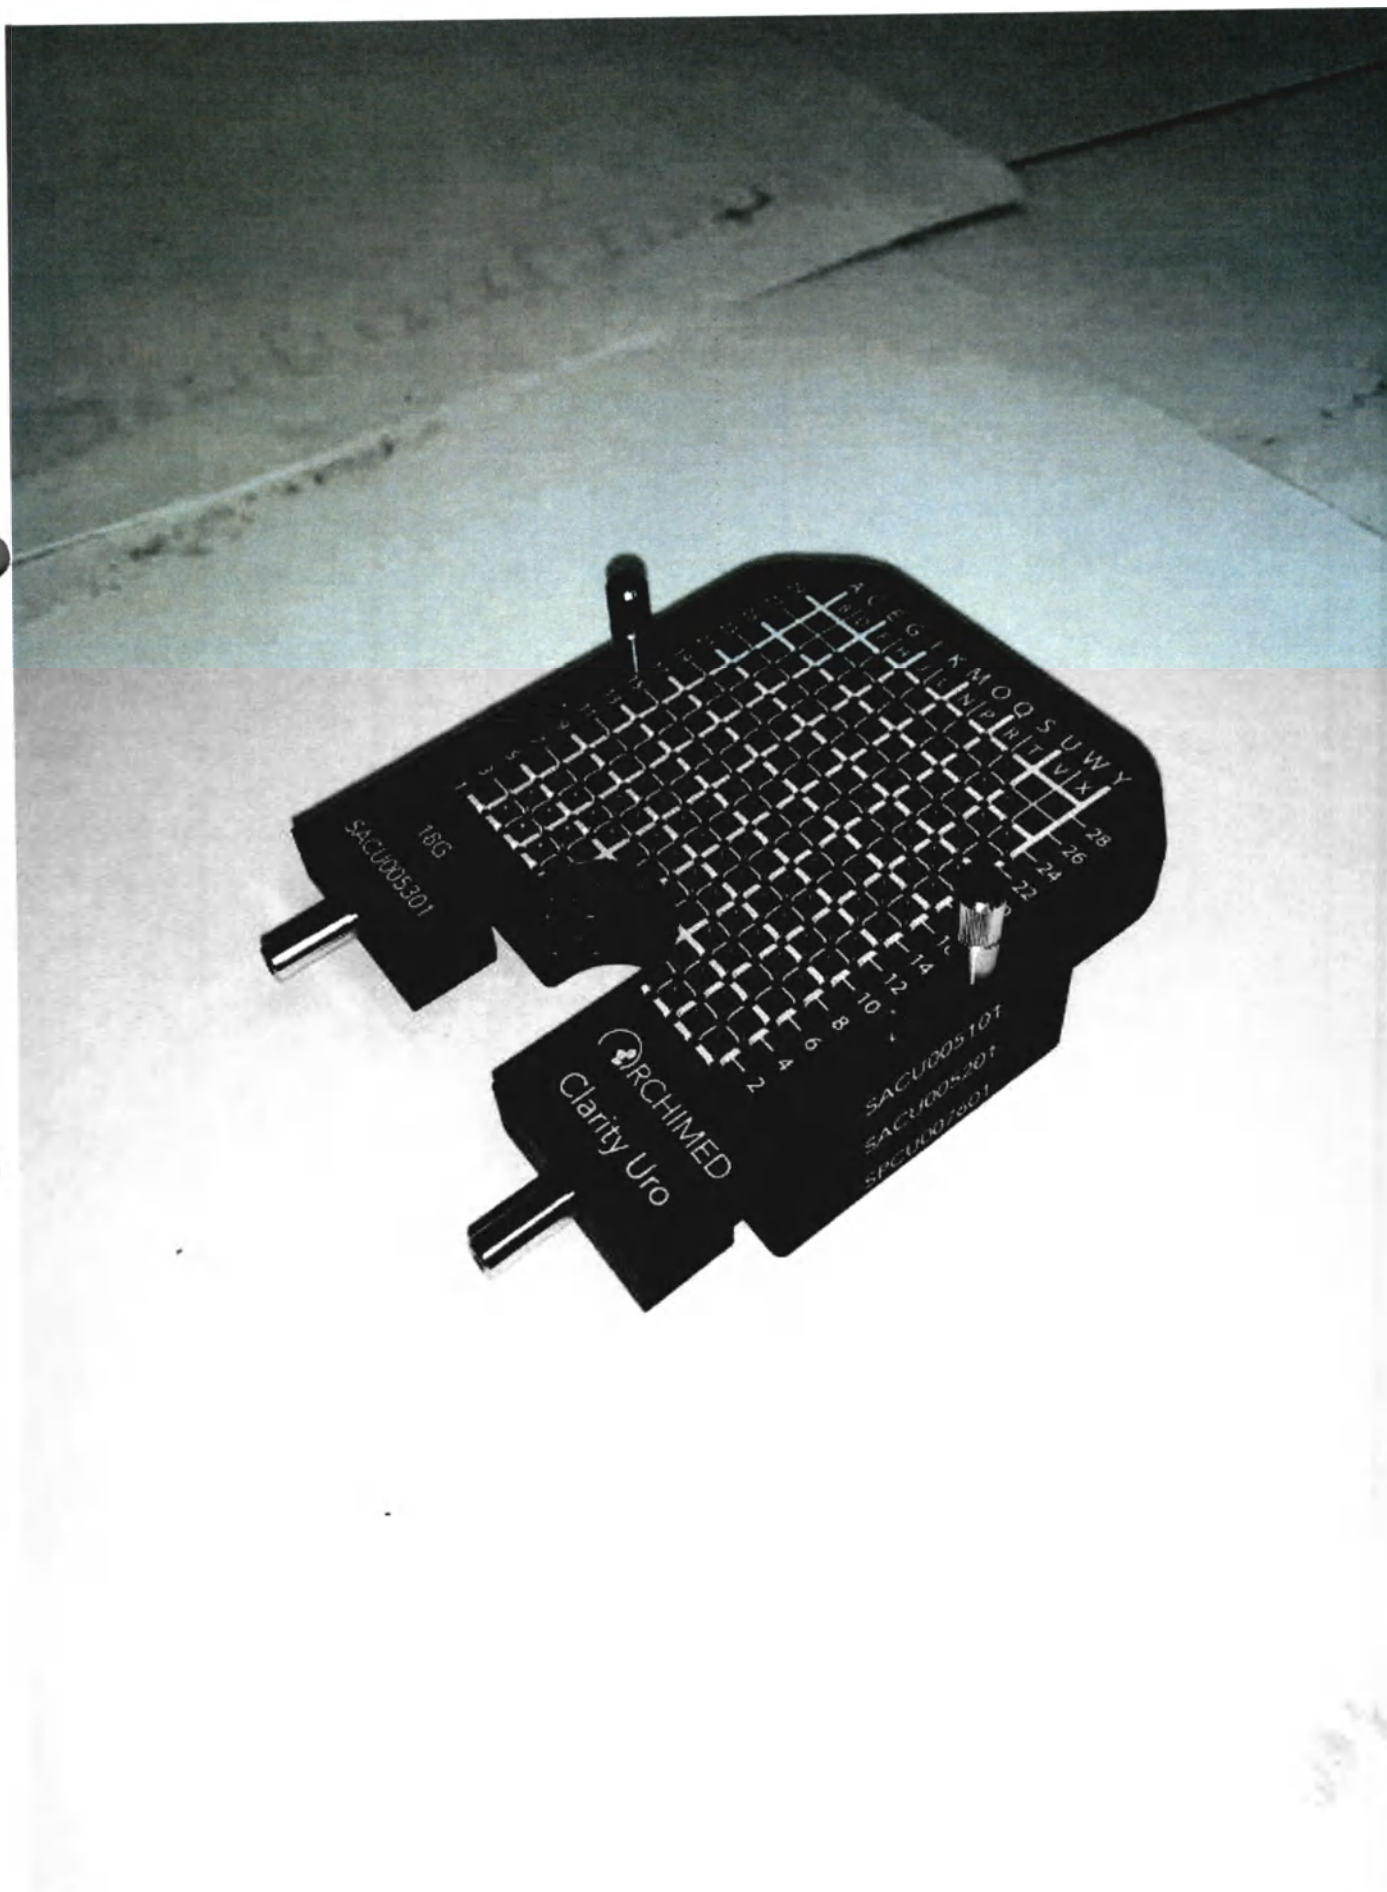

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Держатель промежуточной решетки (упаковка)



по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Держатель промежуточной решетки (маркировка упаковки)

 ORCHIMED

Система ультразвуковая диагностическая медицинская – «Кларити Уро» («Clarity Uro»)
по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

 ООО «ОРХИМЕД», Россия, 117246, г. Москва,
проезд Научный, д. 10, офис 101(36)



28.04.2023

Держатель промежуточной решетки



SN353528006




SACU005403

LACU000700

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Держатель промежуточной решетки

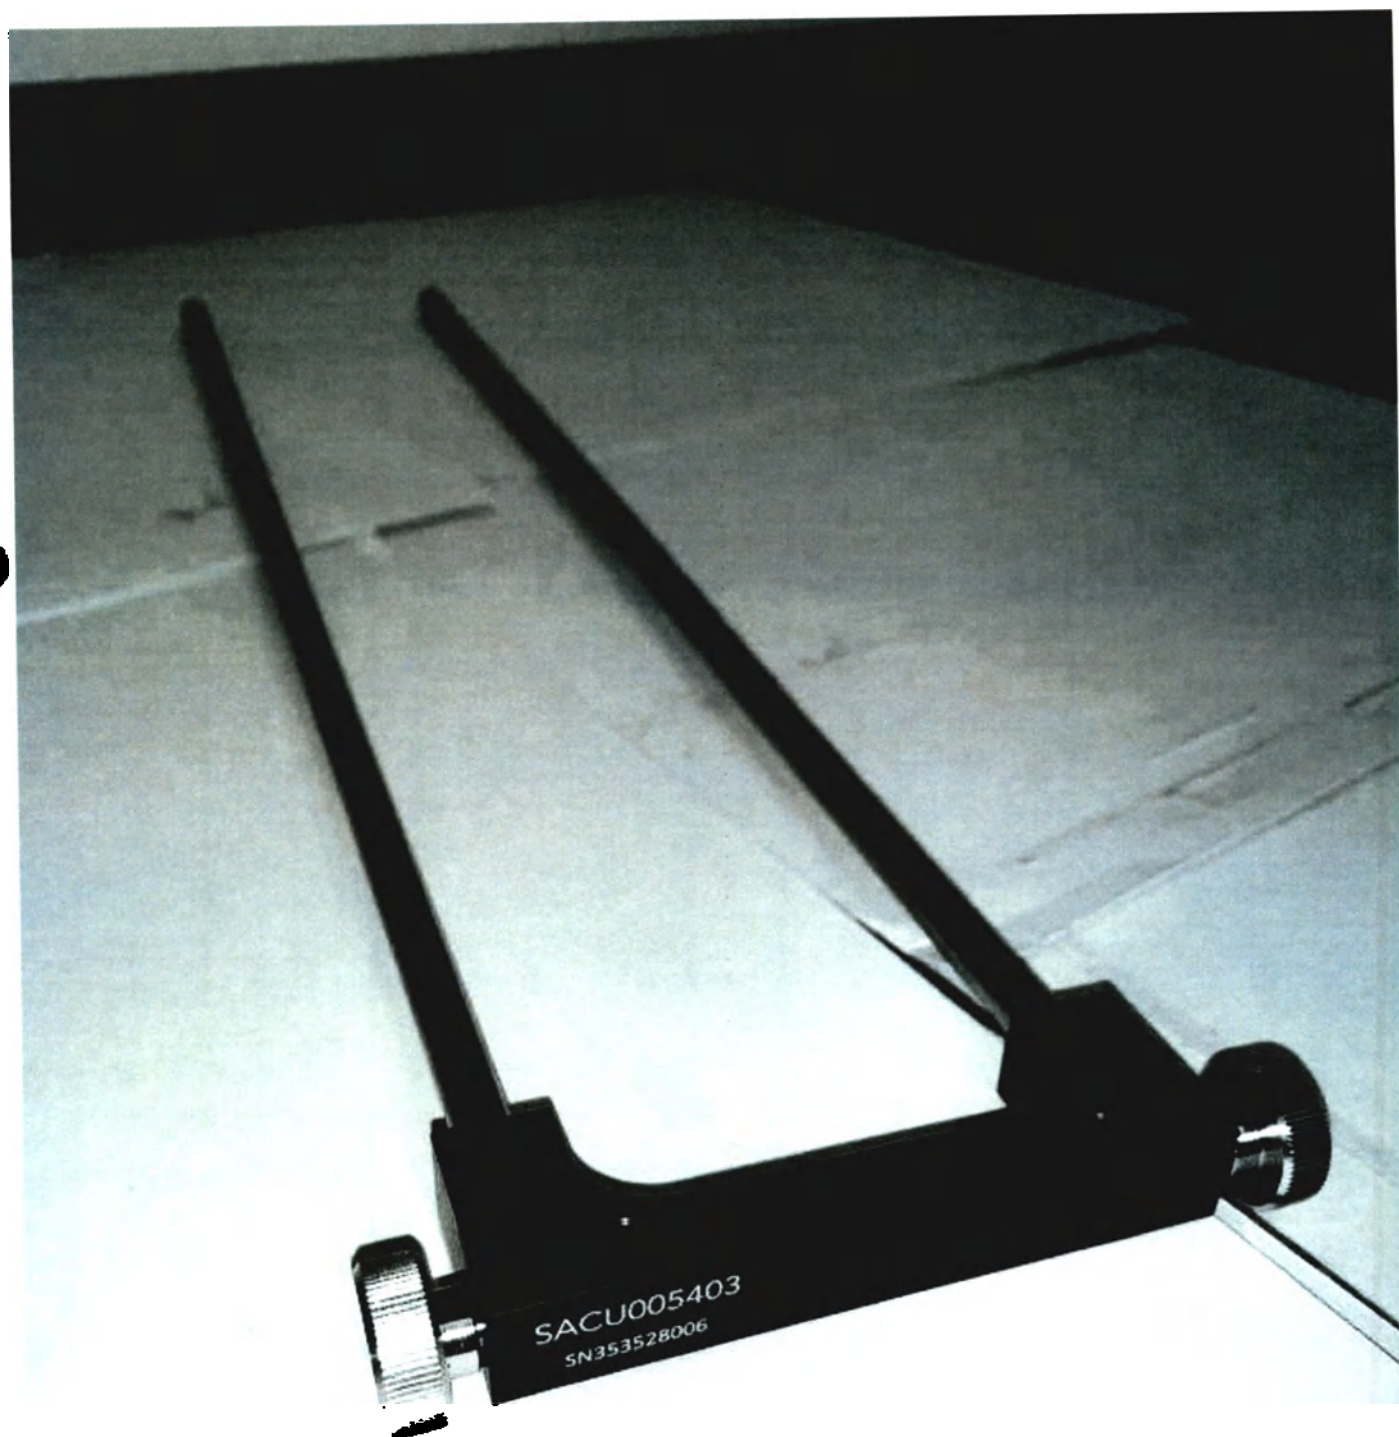

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Держатель блока позиционирования (упаковка)




по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Держатель блока позиционирования (маркировка упаковки)




по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Держатель блока позиционирования

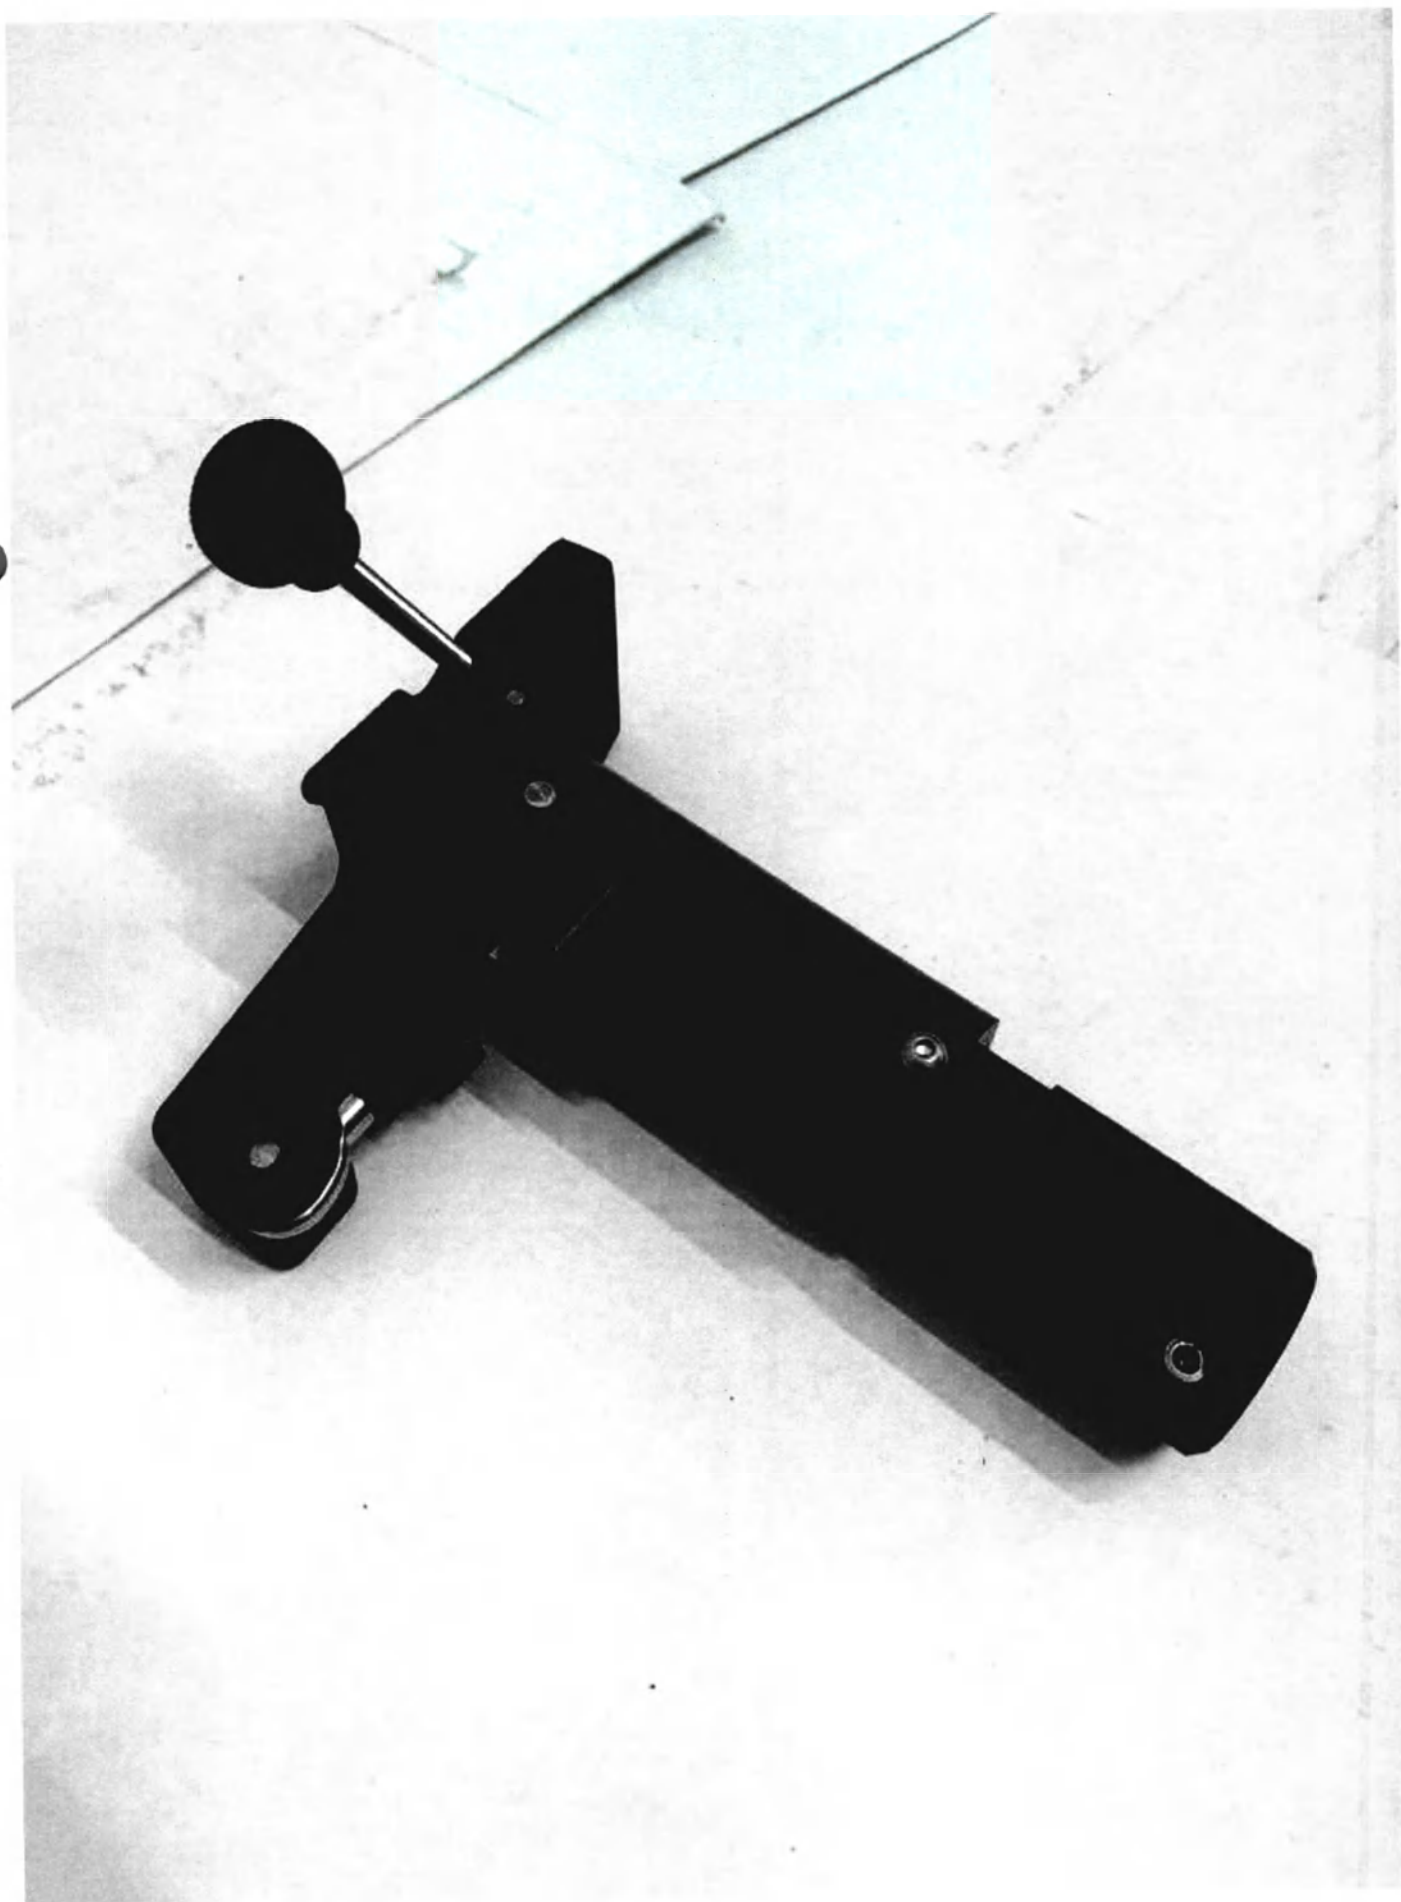


по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Детектор ротационного и продольного смещений (упаковка)

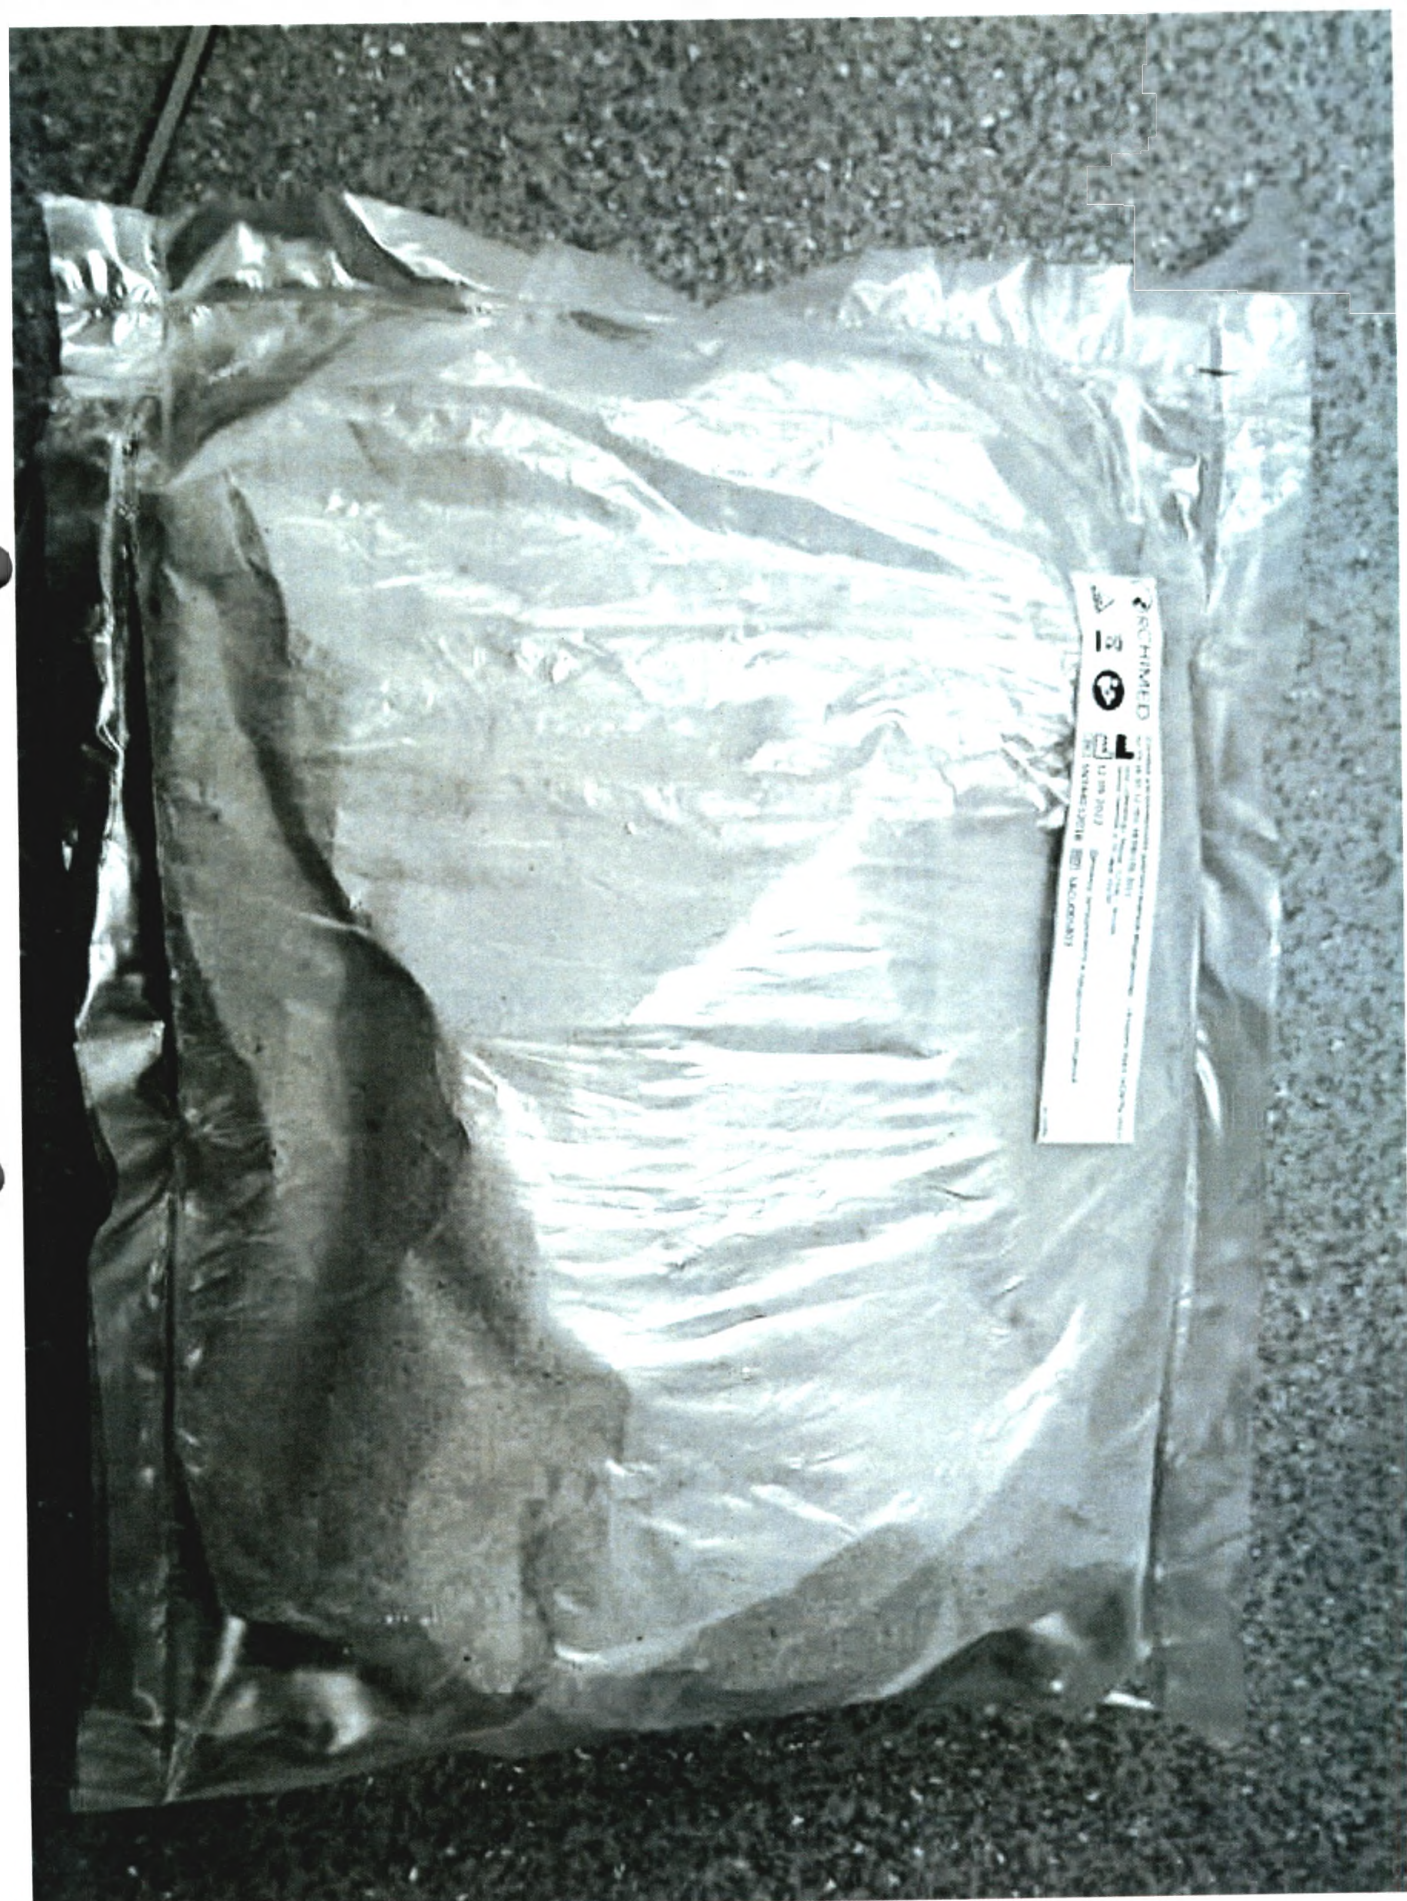

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Детектор ротационного и продольного смещений (маркировка упаковки)

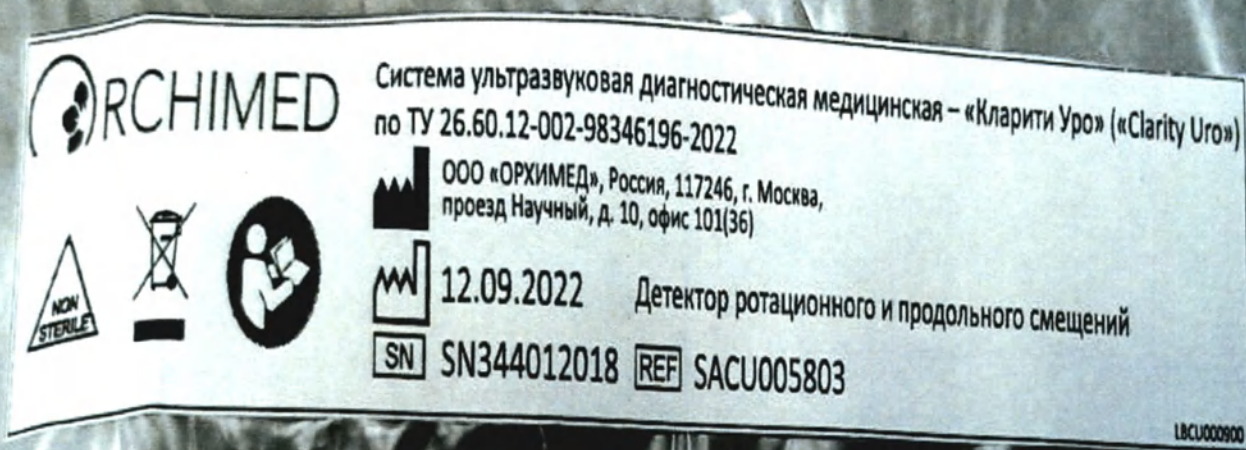


по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Детектор ротационного и продольного смещений



по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Степпер в сборе

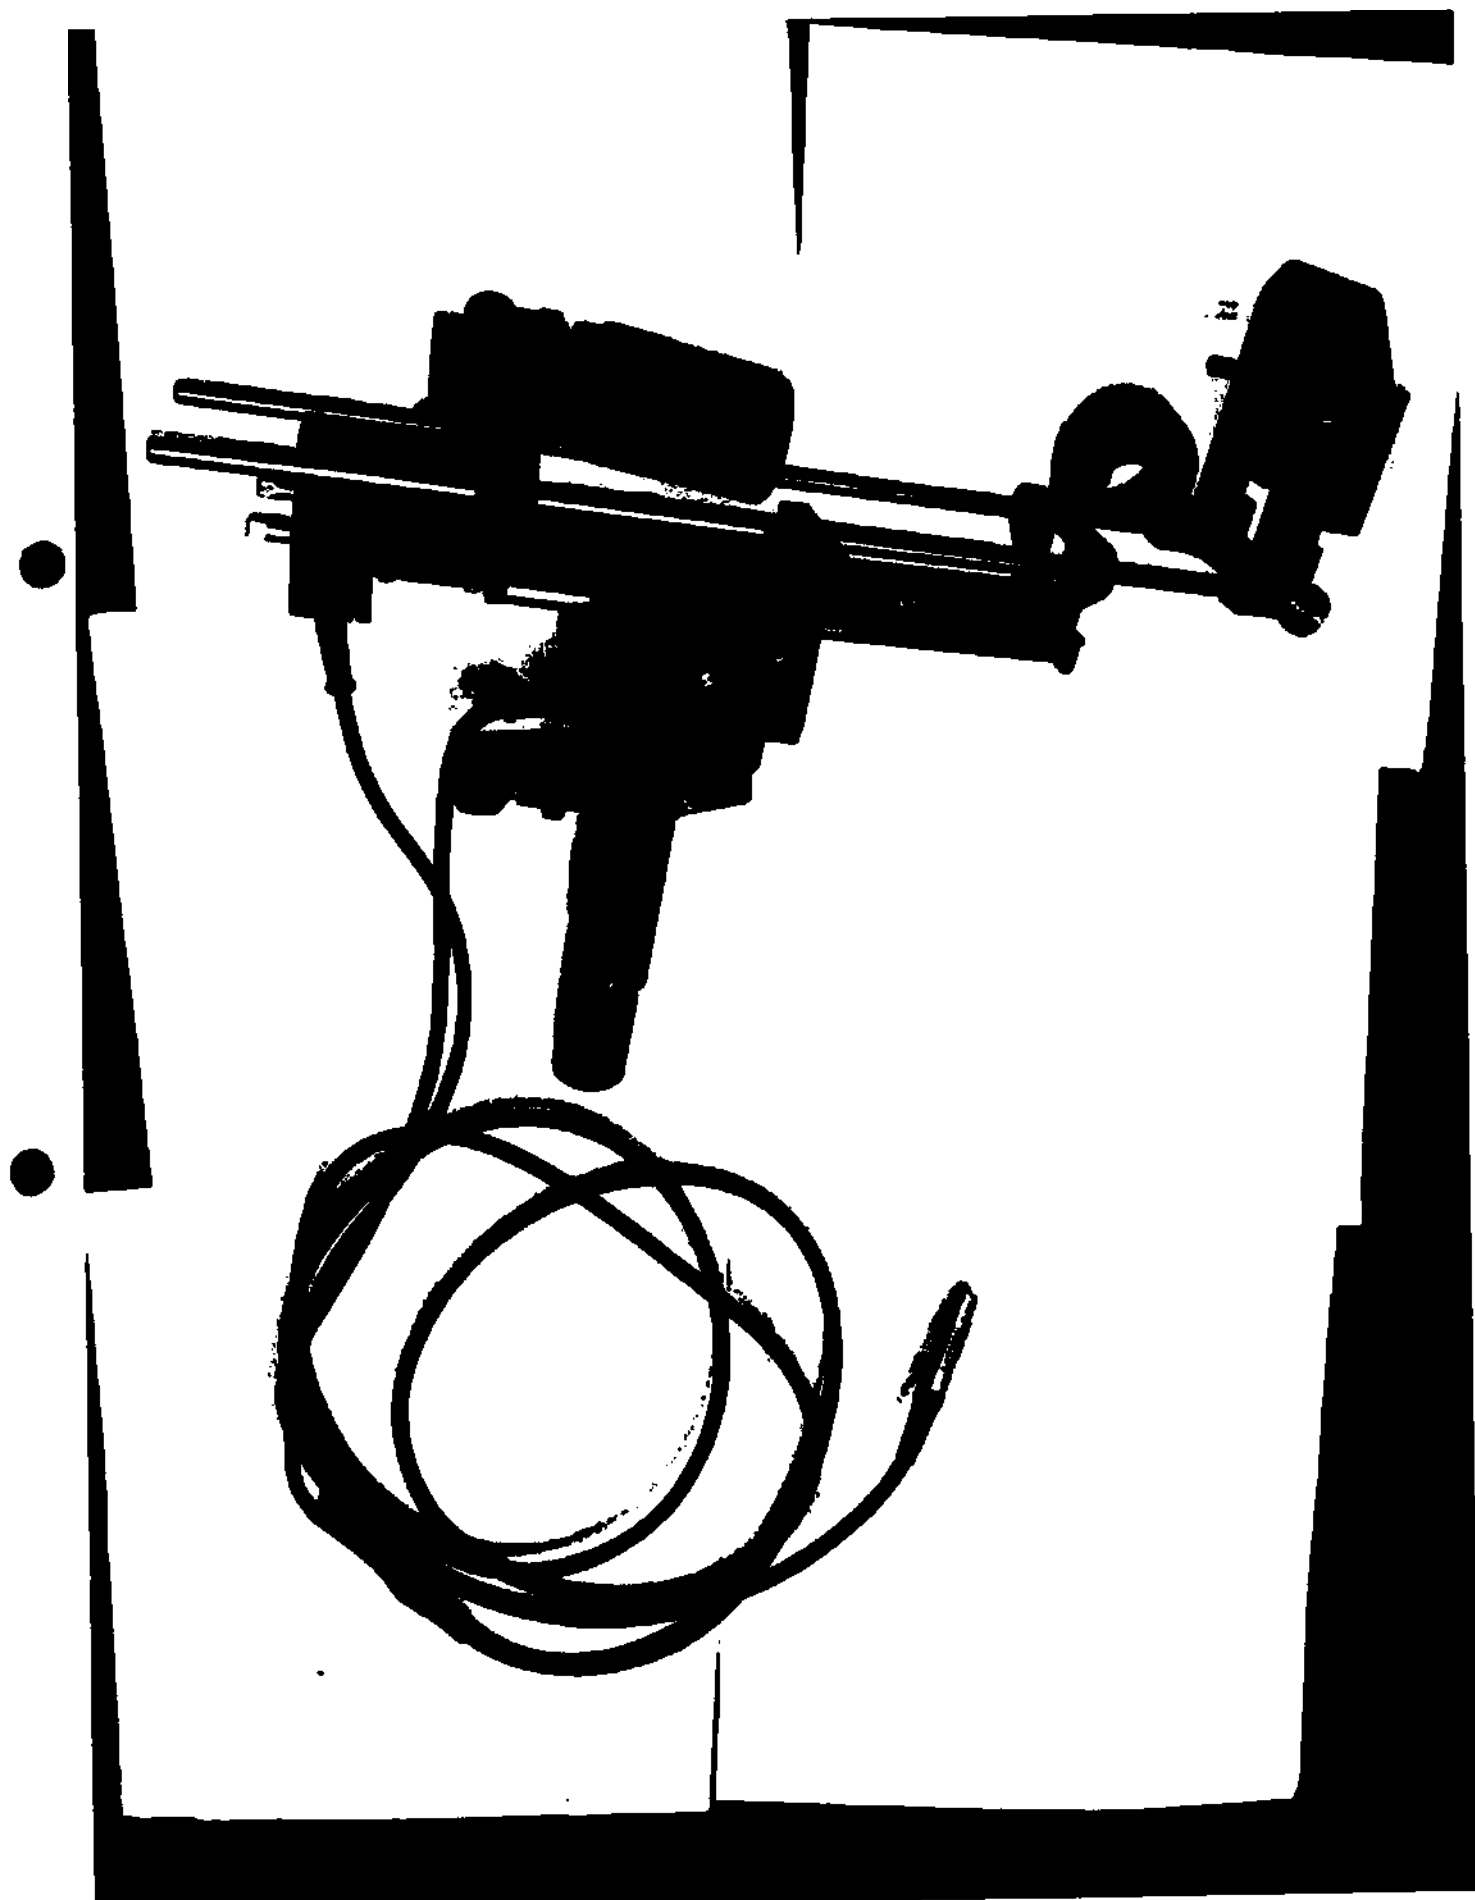


по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Степпер (компоненты степпера в картонной коробке)




по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Стойка для степпера (упаковка)

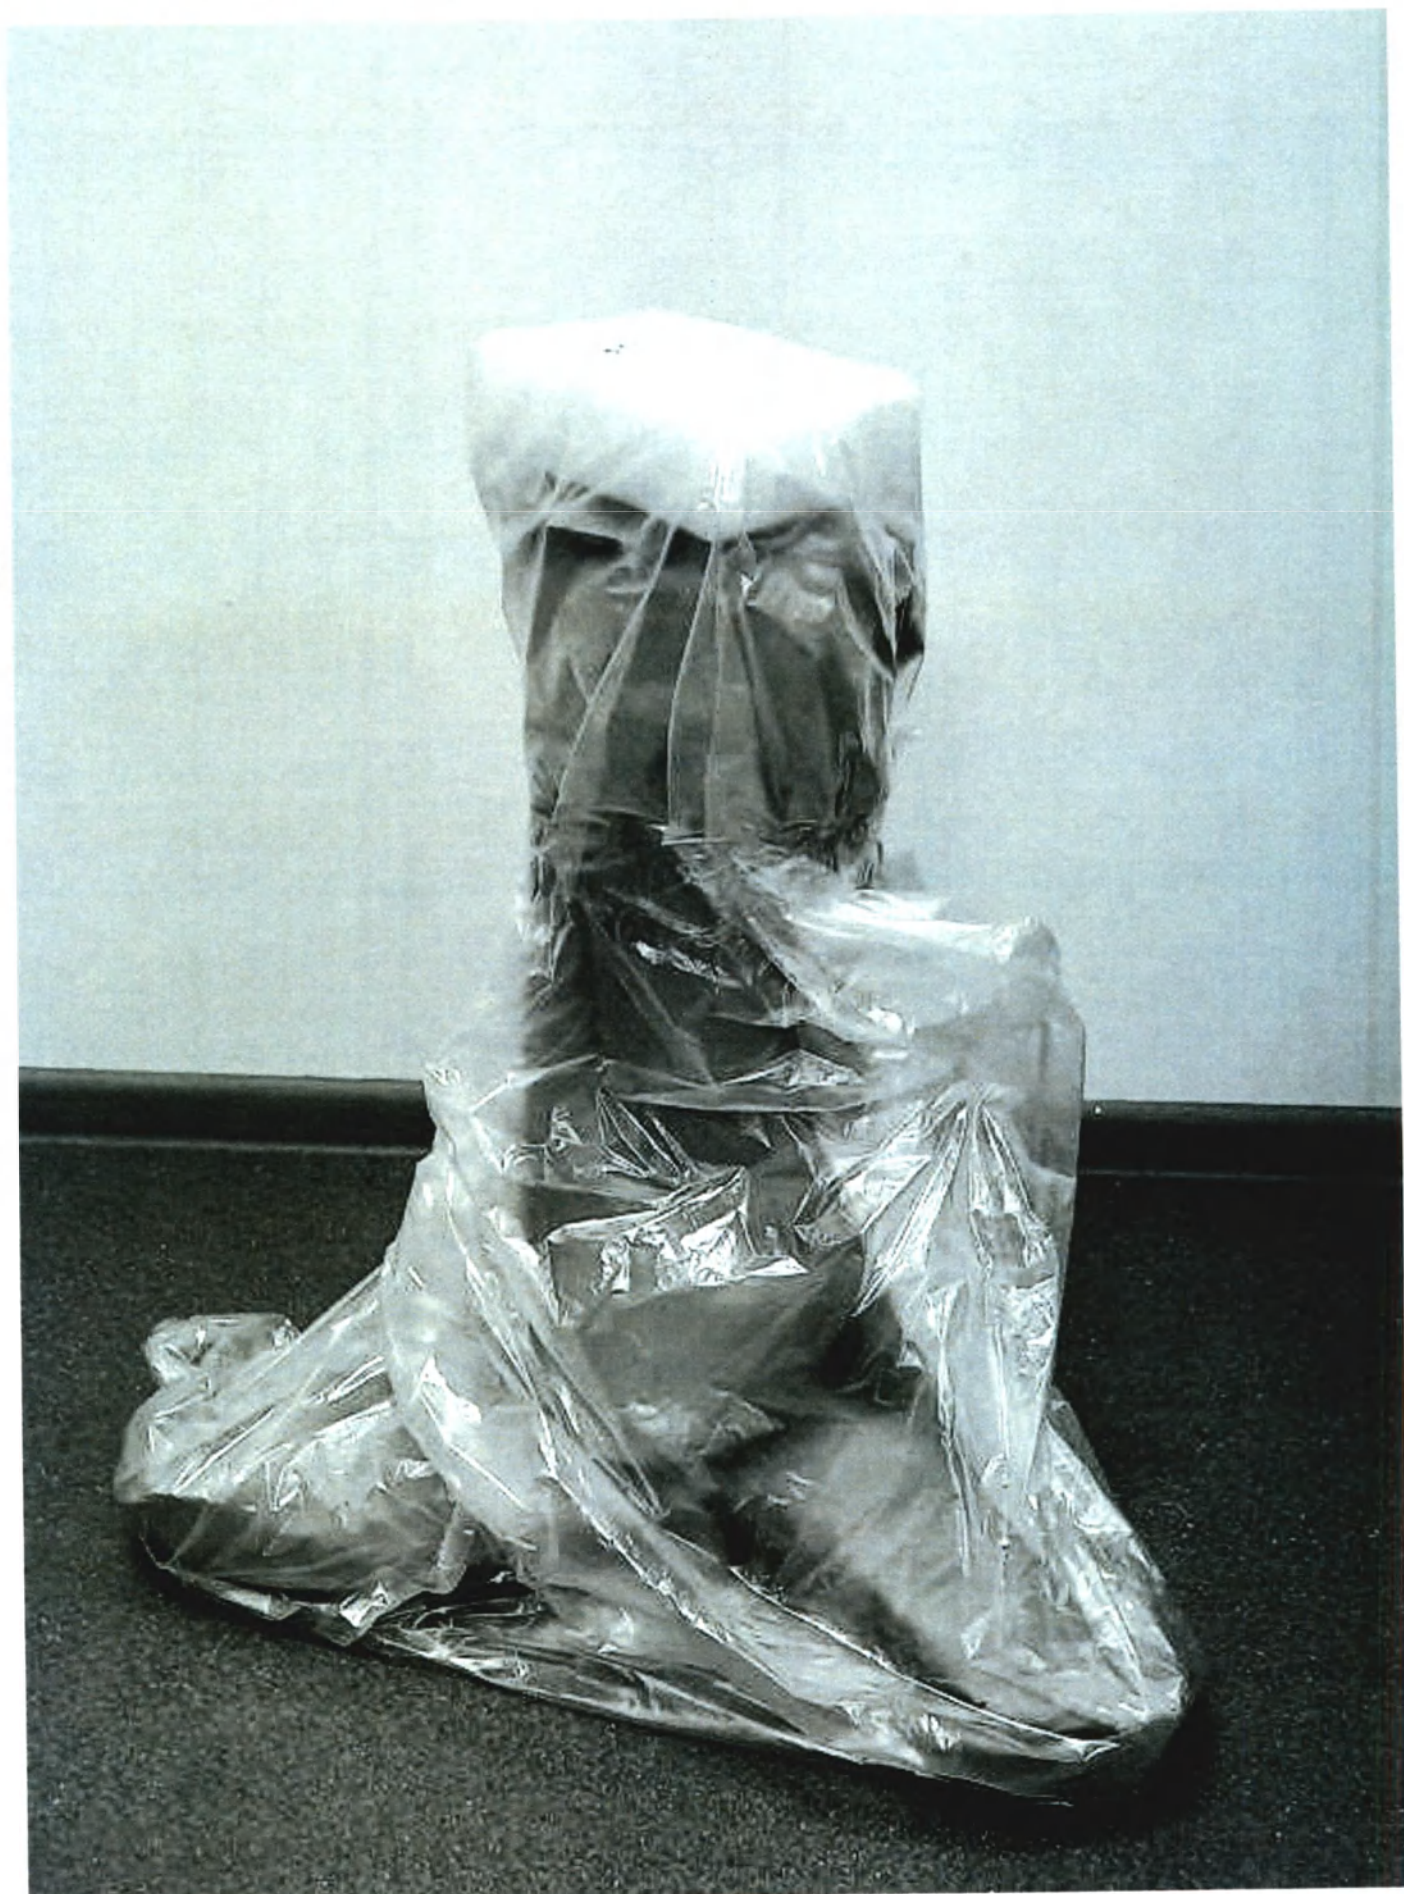


по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Стойка для степпера (маркировка упаковки)

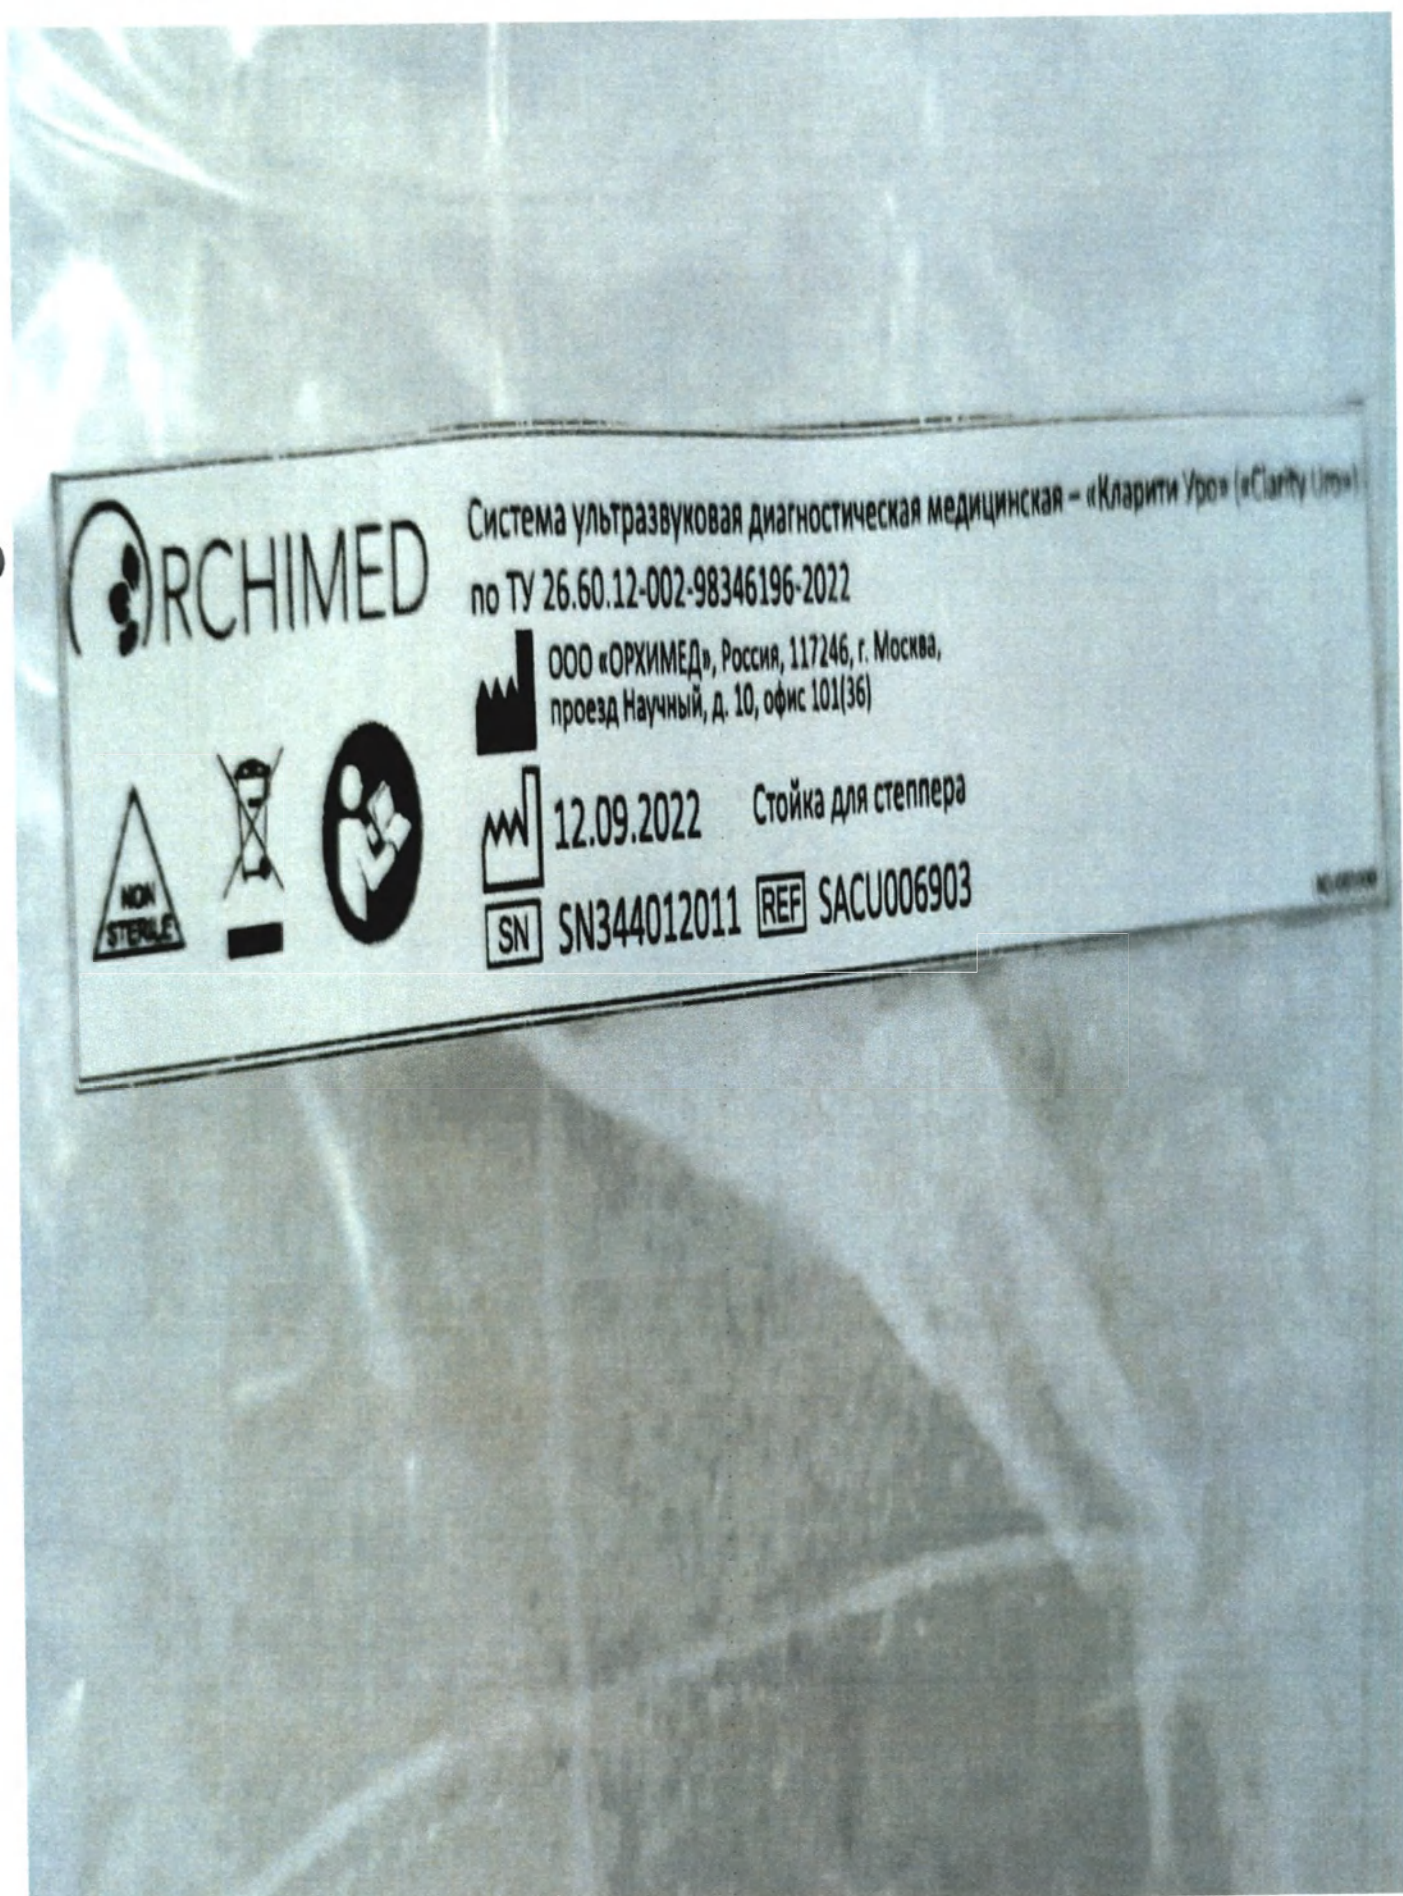


по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Стойка для степпера

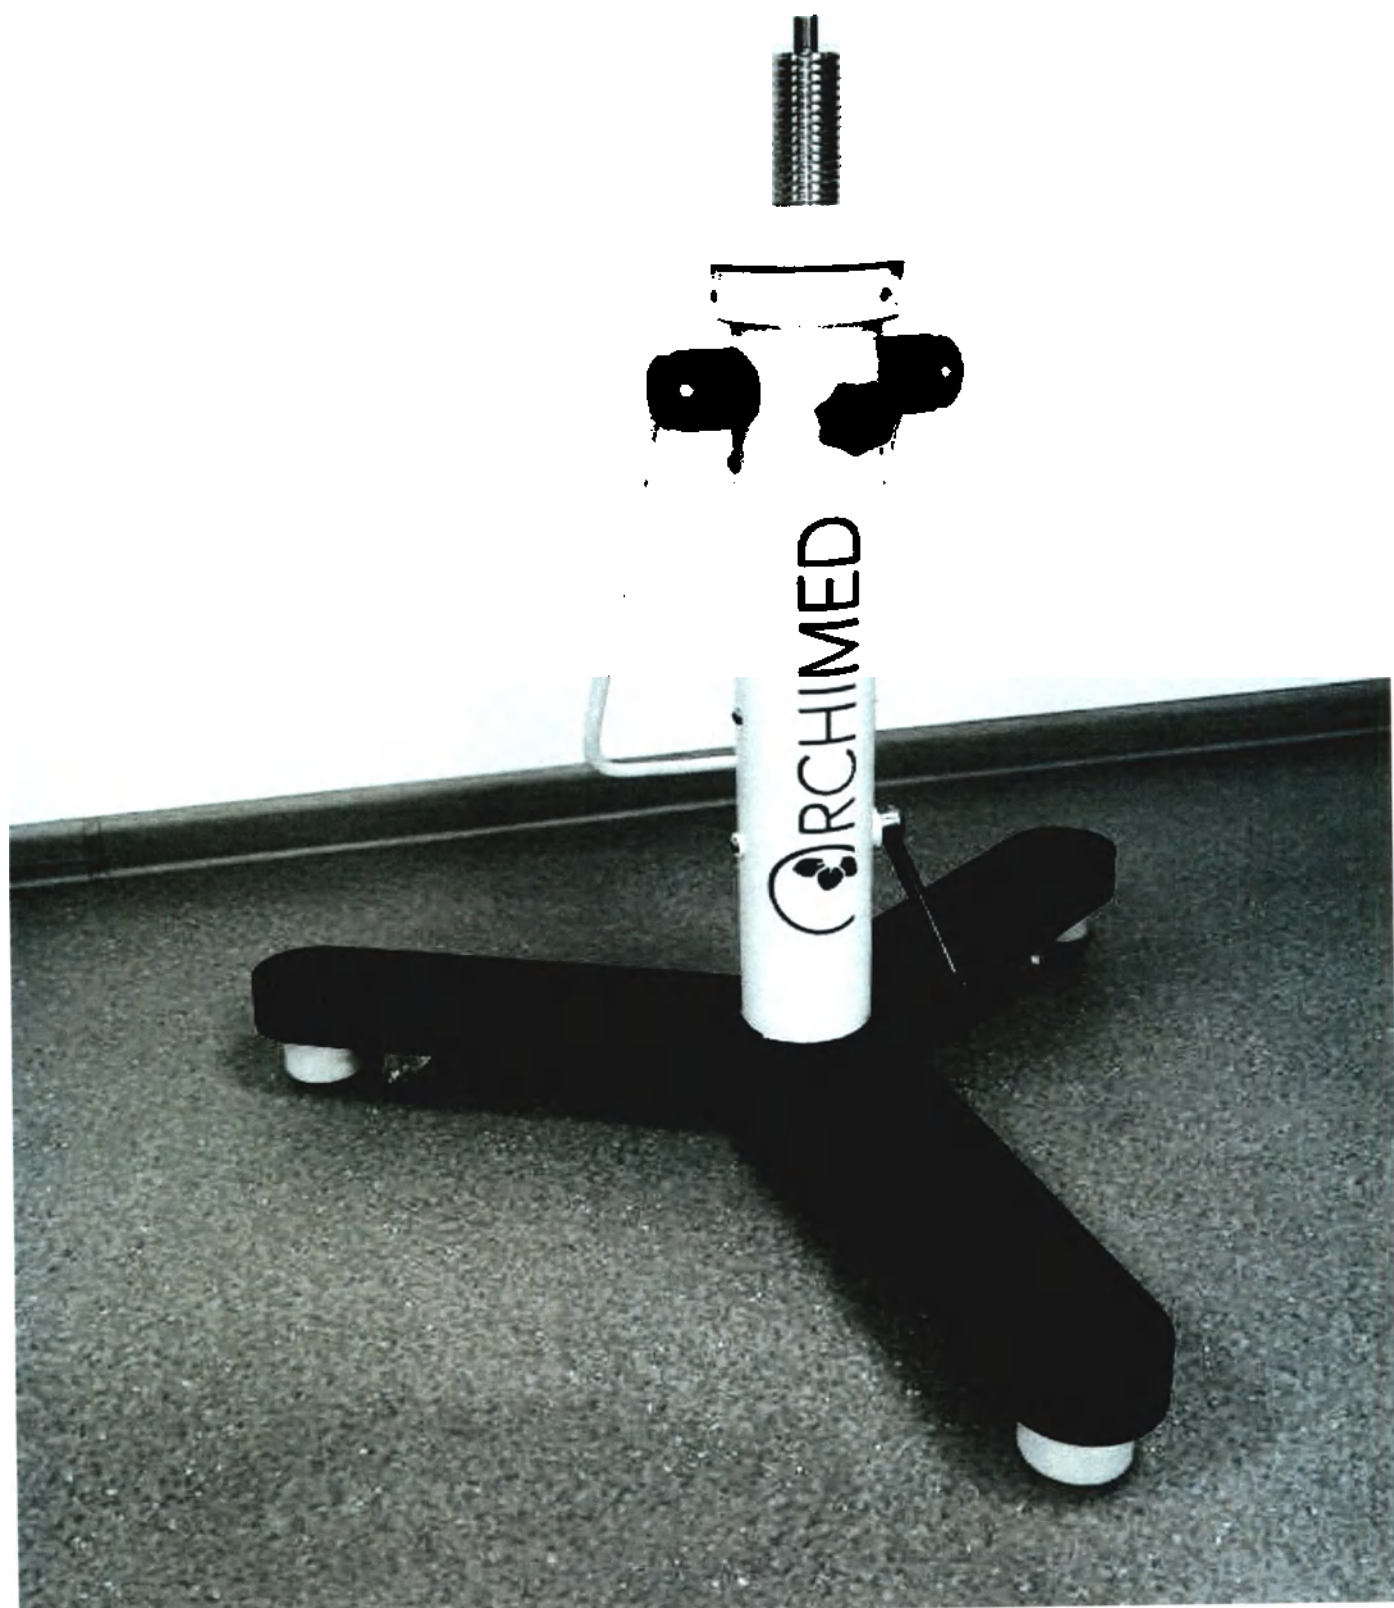

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Кабель питания (упаковка)

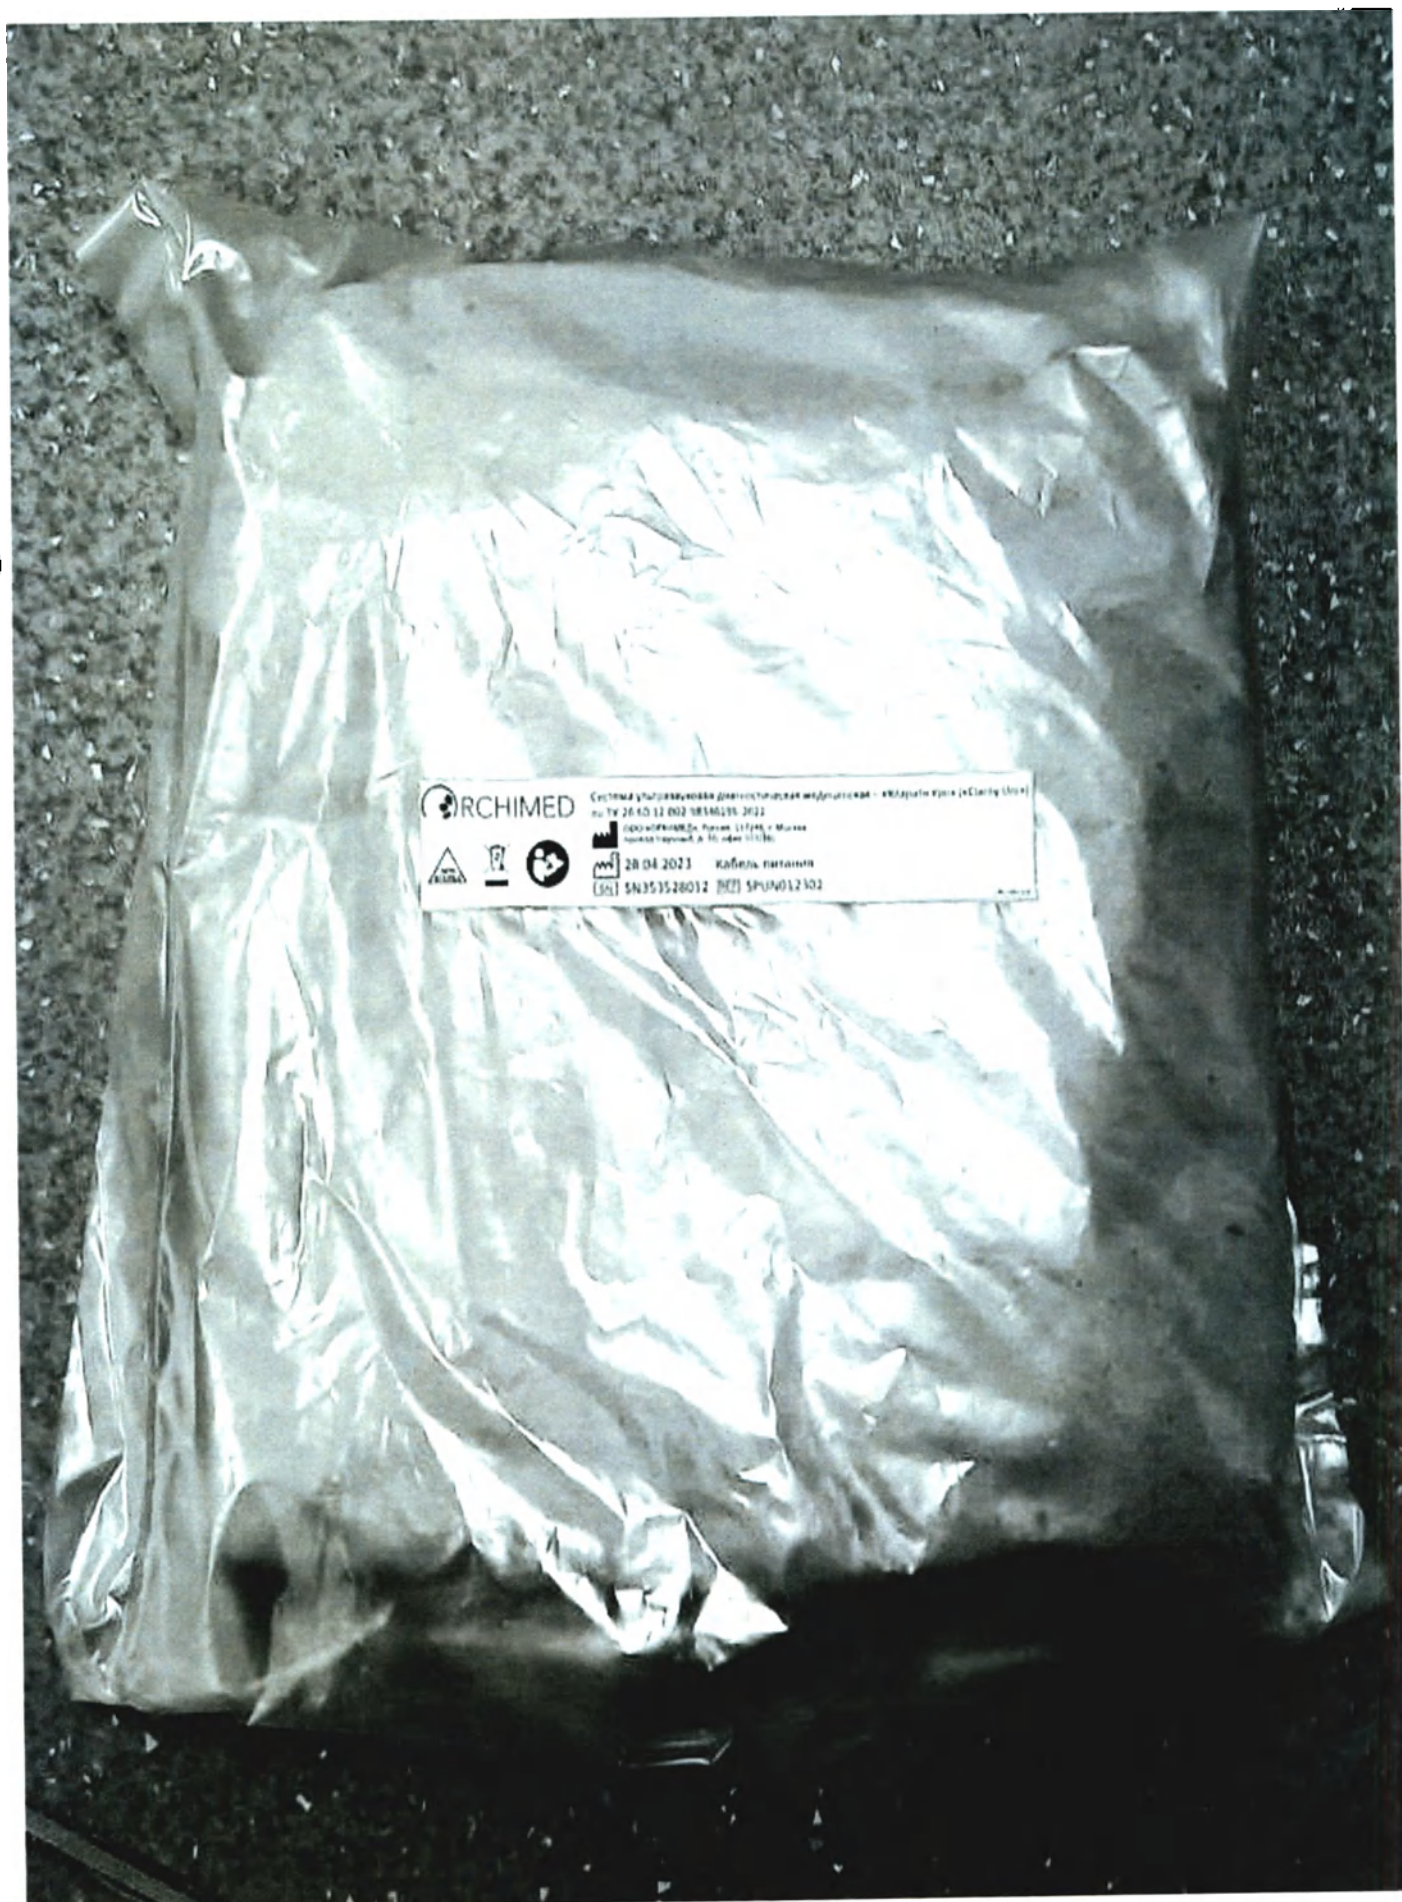

по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Кабель питания (маркировка упаковки)



по ТУ 26.60.12-002-98346196-2022

Кабель питания



Всего в настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью:

34 ЛИСТОВ.

Генеральный директор ООО «ОРХИМЕД»

Шумило Д. В.

