

**Фотографические изображения медицинского изделия.
Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.**



ис. 1 – Общий вид.

Лейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



ис. 2 – Блок управления, SN344220001.

Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



рис. 3 – Блок управления, SN344220001. В упаковке.

Рейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



CIRCHIMED Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut»)
по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022
ООО «ОРИМЕД», Россия, 117246, г. Москва,
проезд Научный, д. 10, офис 101(36)
11.10.2022 LOT 110111022
SN344220002 REF ACSC002301
насадка режущая ФастКат 400 (FastCut 400)
18SC0000300

ис. 4 – Насадка режущая ФастКат 400 (FastCut 400), SN344220002.

Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.


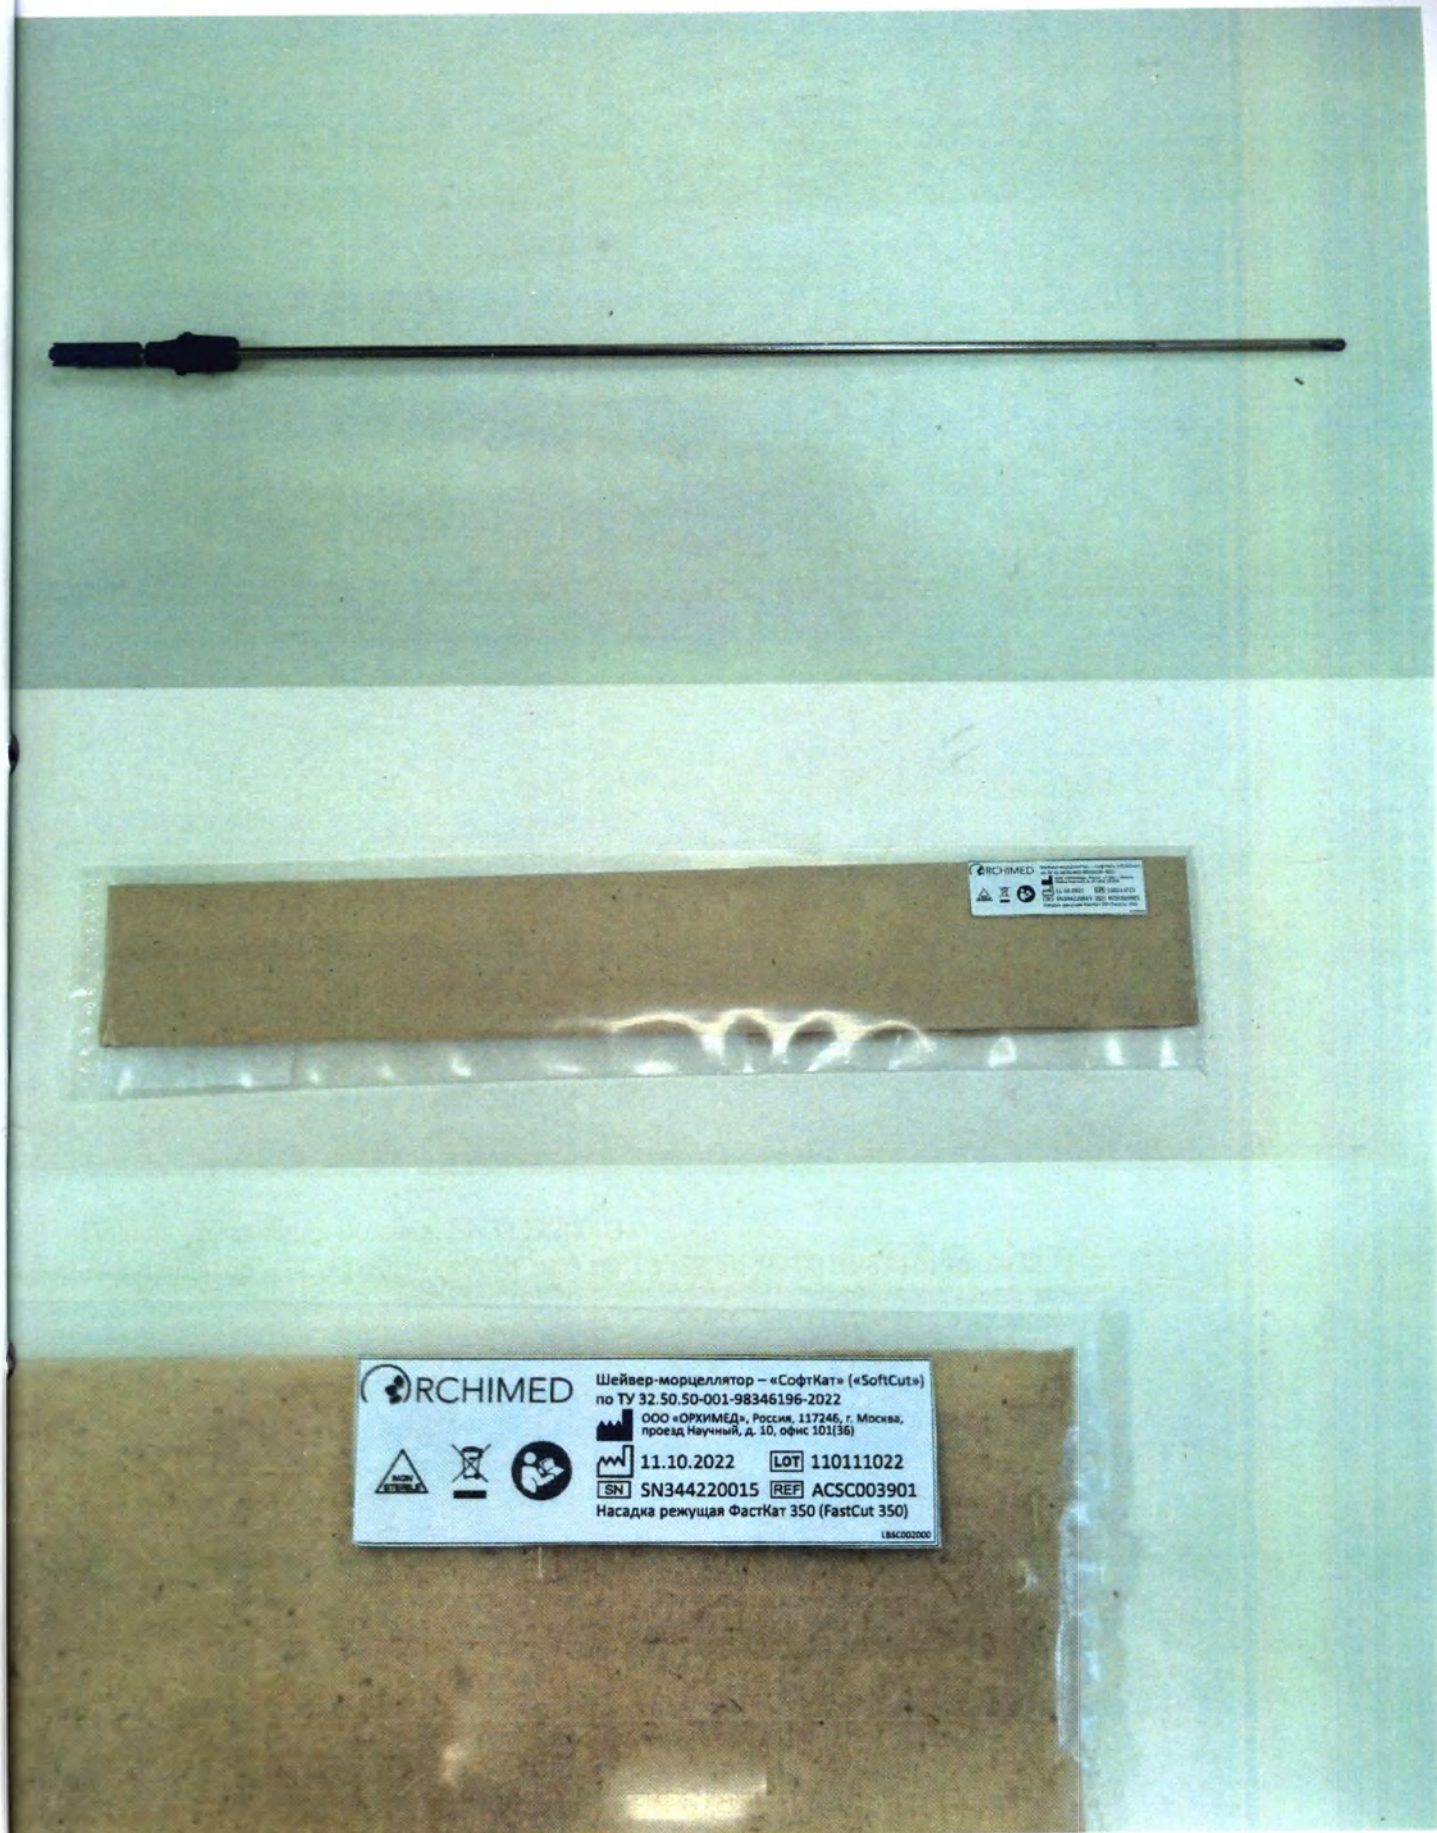


рис. 5 – Насадка режущая ФастКат 350 (FastCut 350), SN344220015.
Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

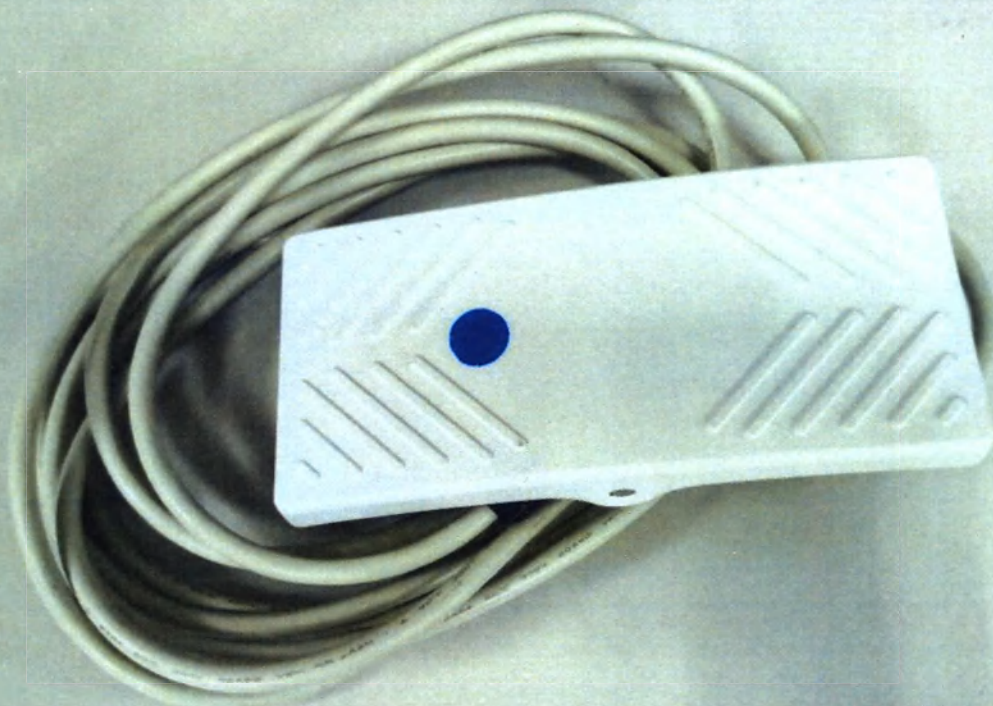

ис. 6 – Педаль управления ножная, SN344220003.

Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

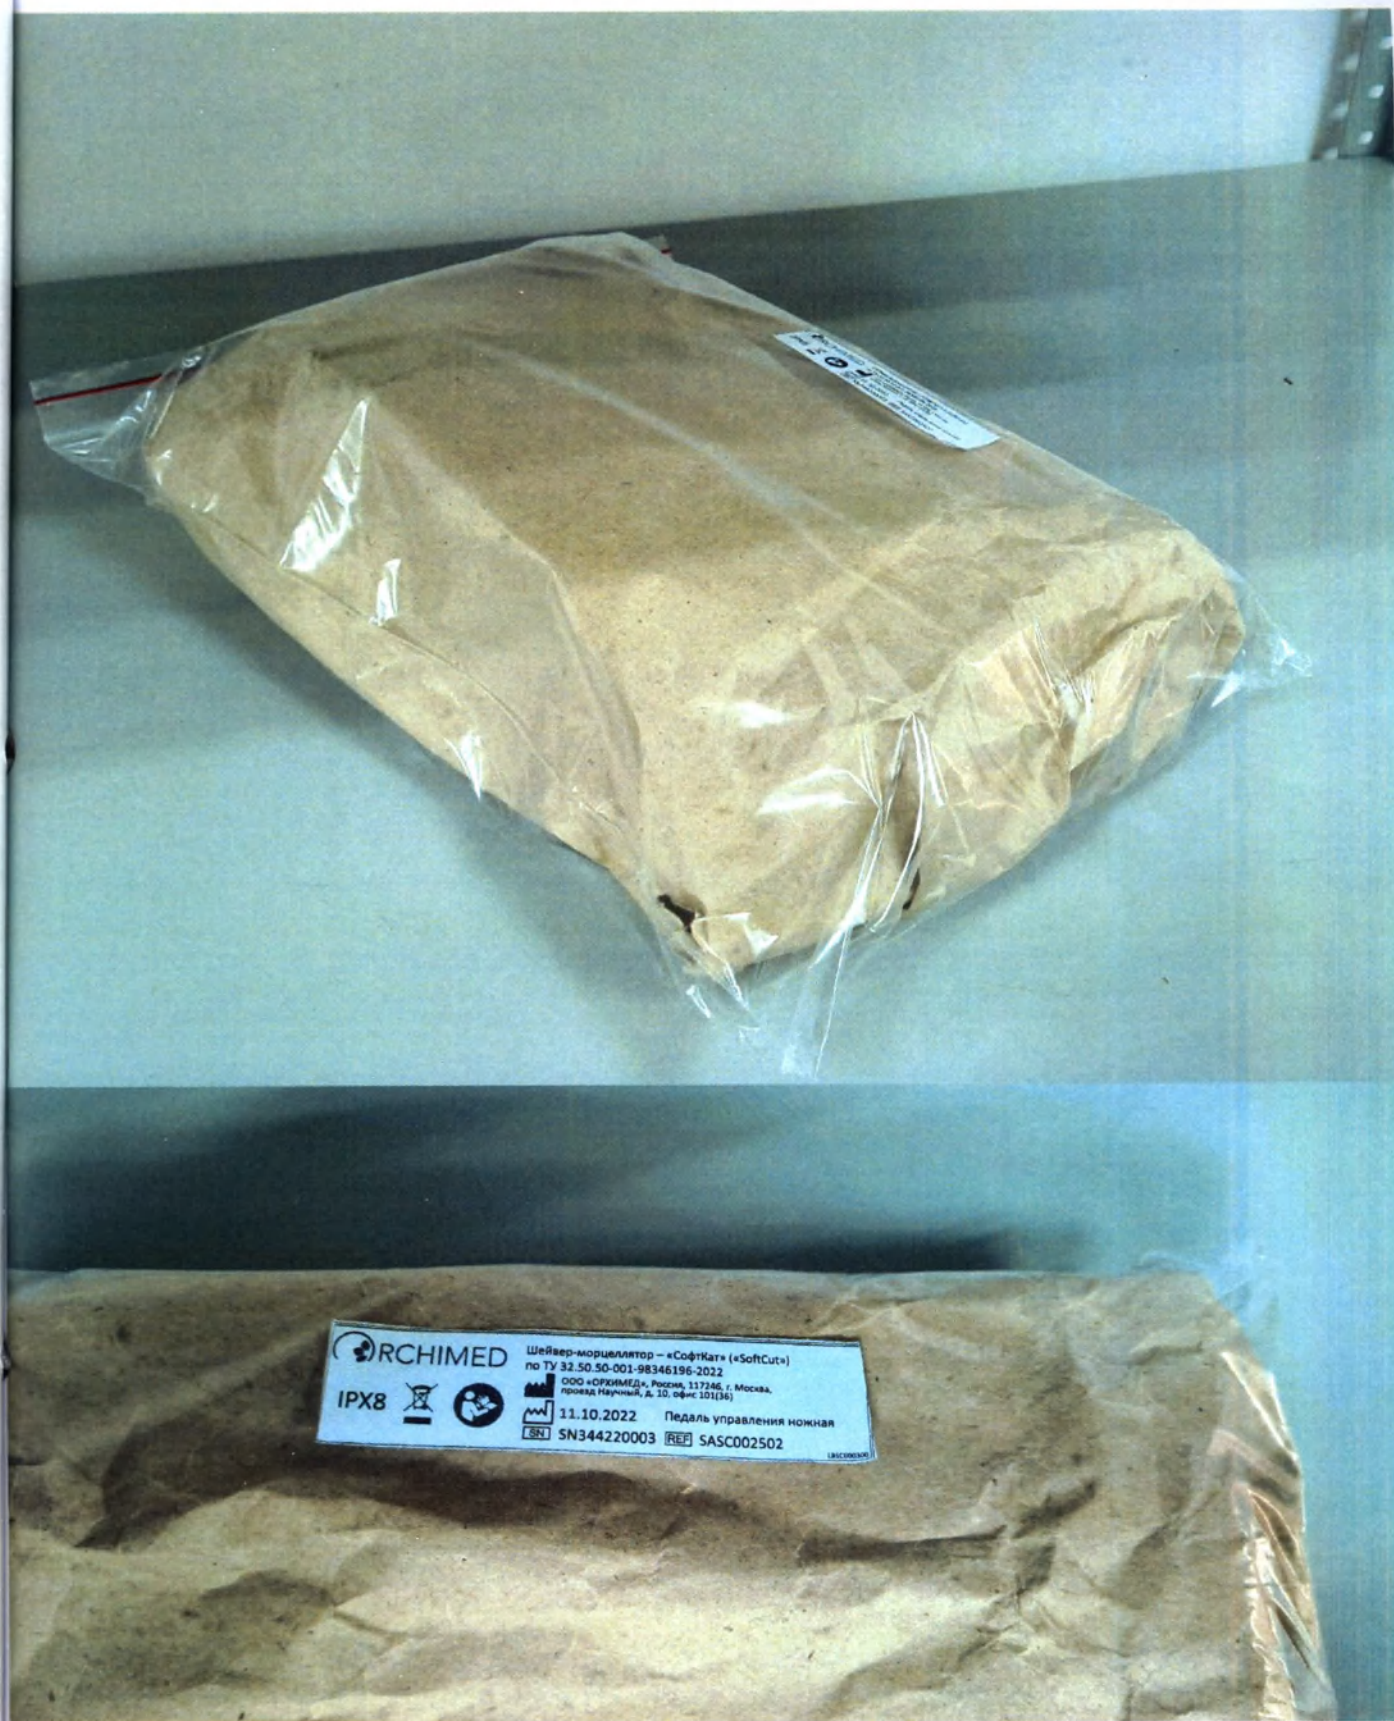



Рис. 7 – Педаль управления ножная, SN344220003. В упаковке.
Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



с. 8 – Банка аспирационная малая (2,5 л), SN344220004.
Рейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



Рис. 9 – Банка аспирационная большая (4 л), SN344220005.
Вибро-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

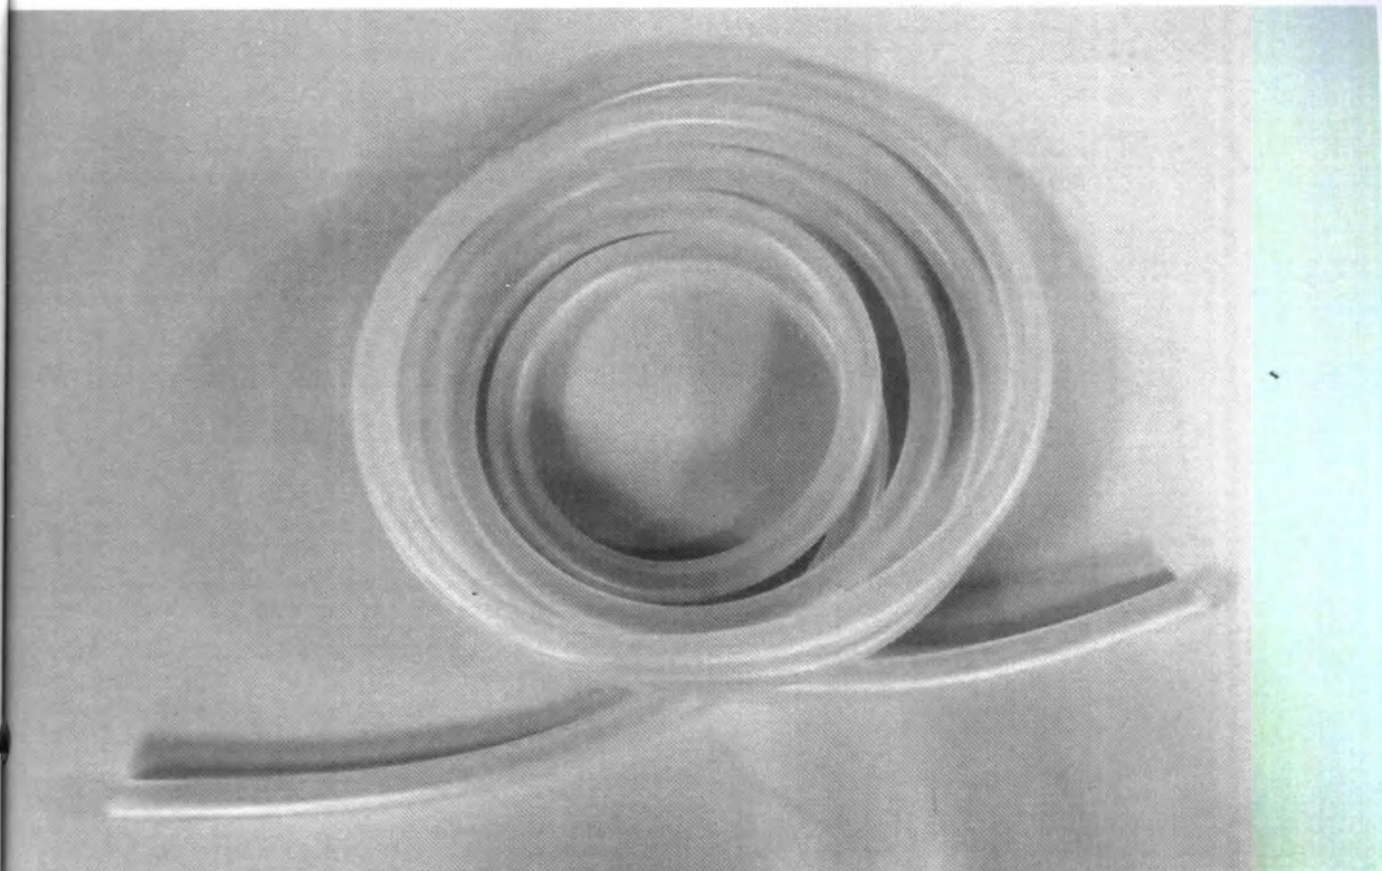

р. 10 – Трубка аспирационная рукоятки морцеллятора (3,5 м), SN344220006.
ейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.


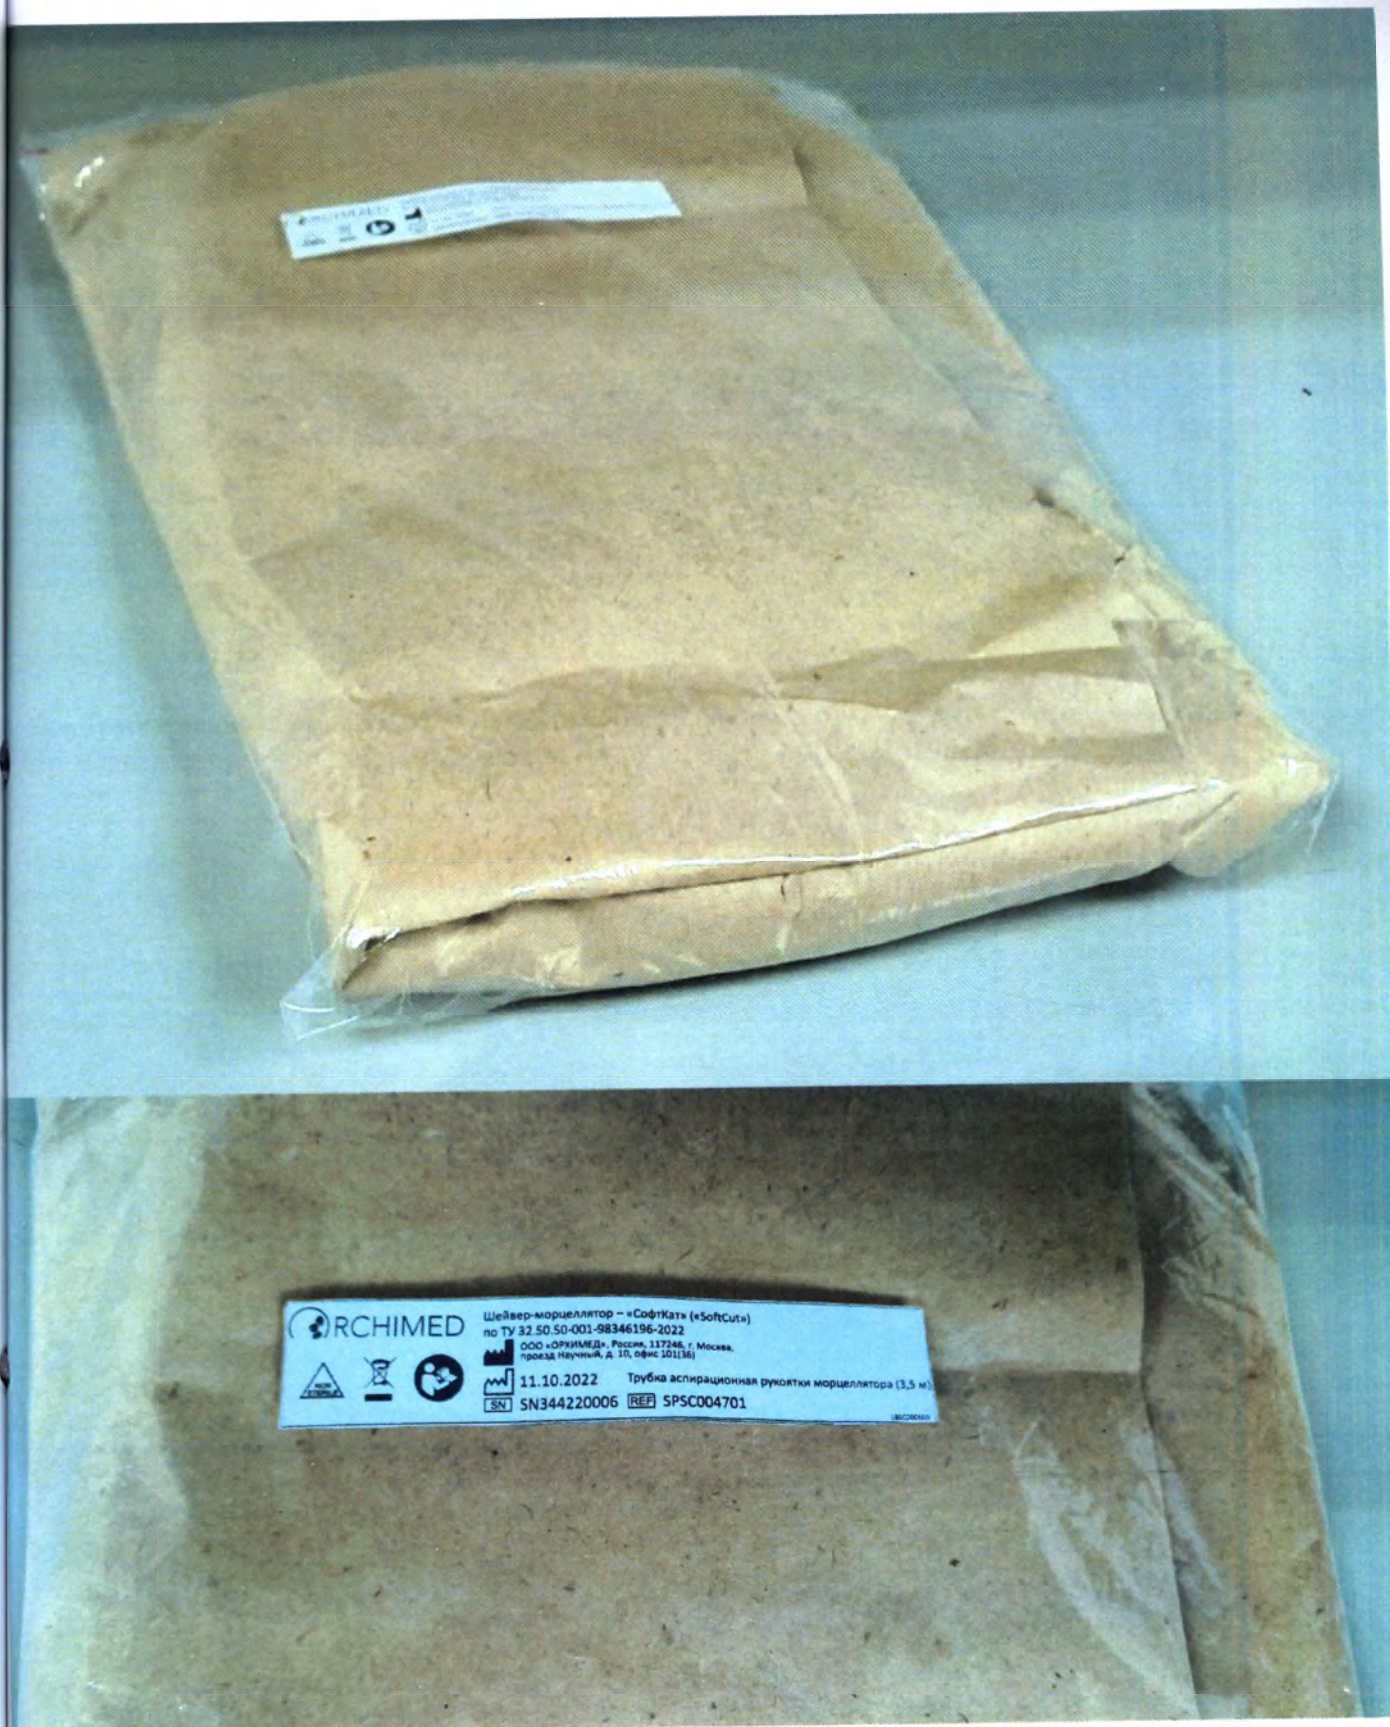


рис. 11 – Трубка аспирационная рукоятки морцеллятора (3,5 м), SN344220006. В упаковке.
Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

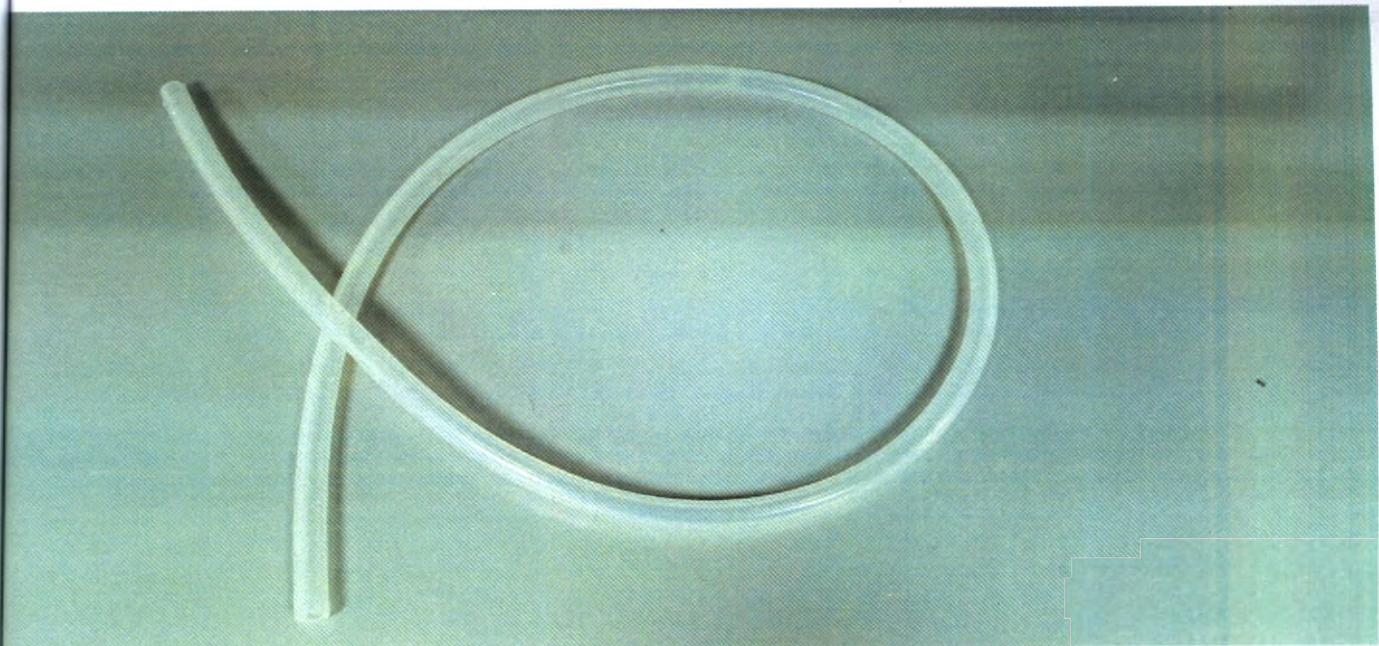

12 – Трубка аспирационная вакуумная (1 м), SN353506006.

Файбер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



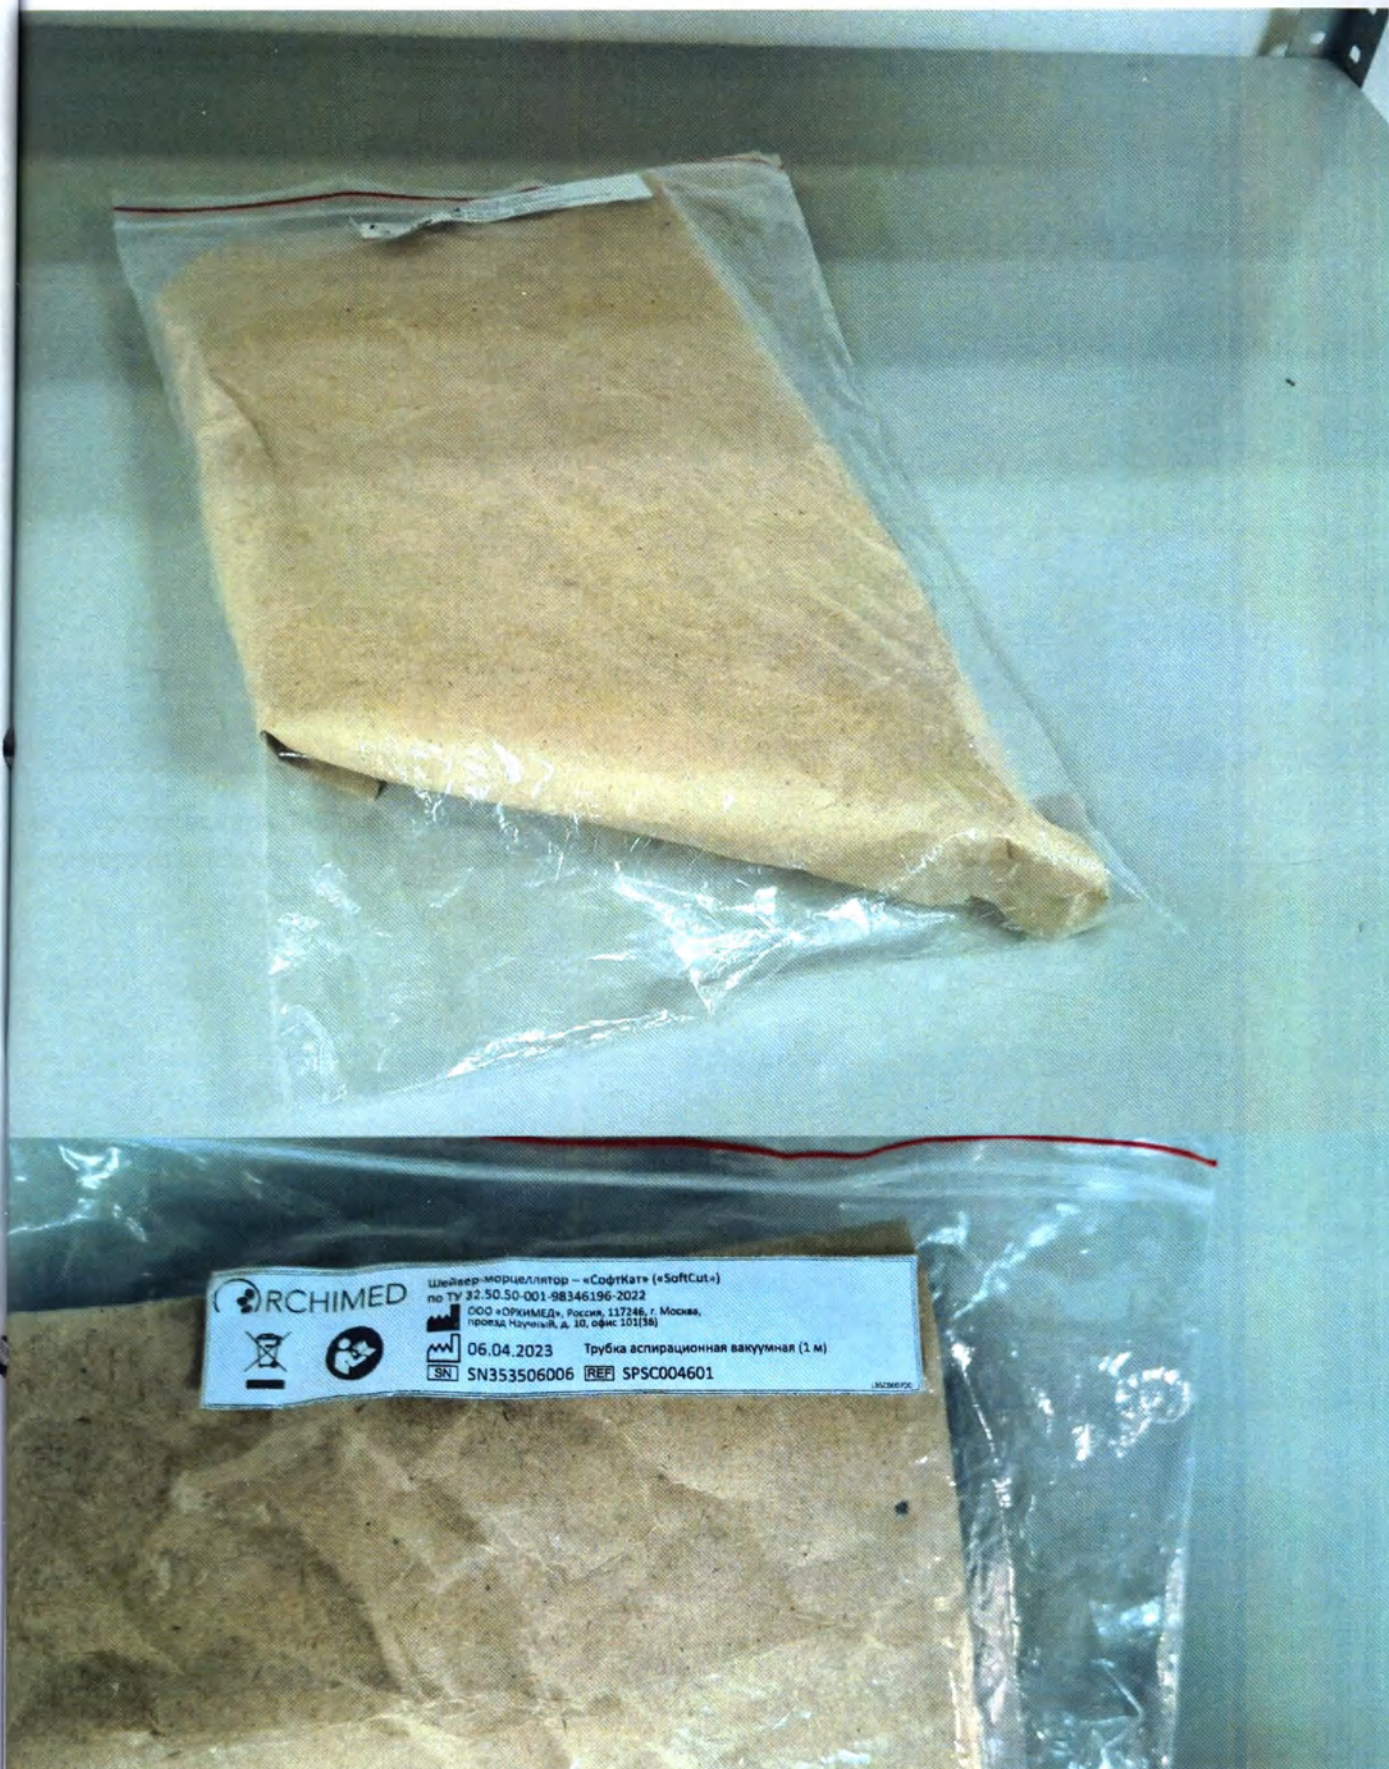



рис. 13 – Трубка аспирационная вакуумная (1 м), SN353506006. В упаковке.
Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

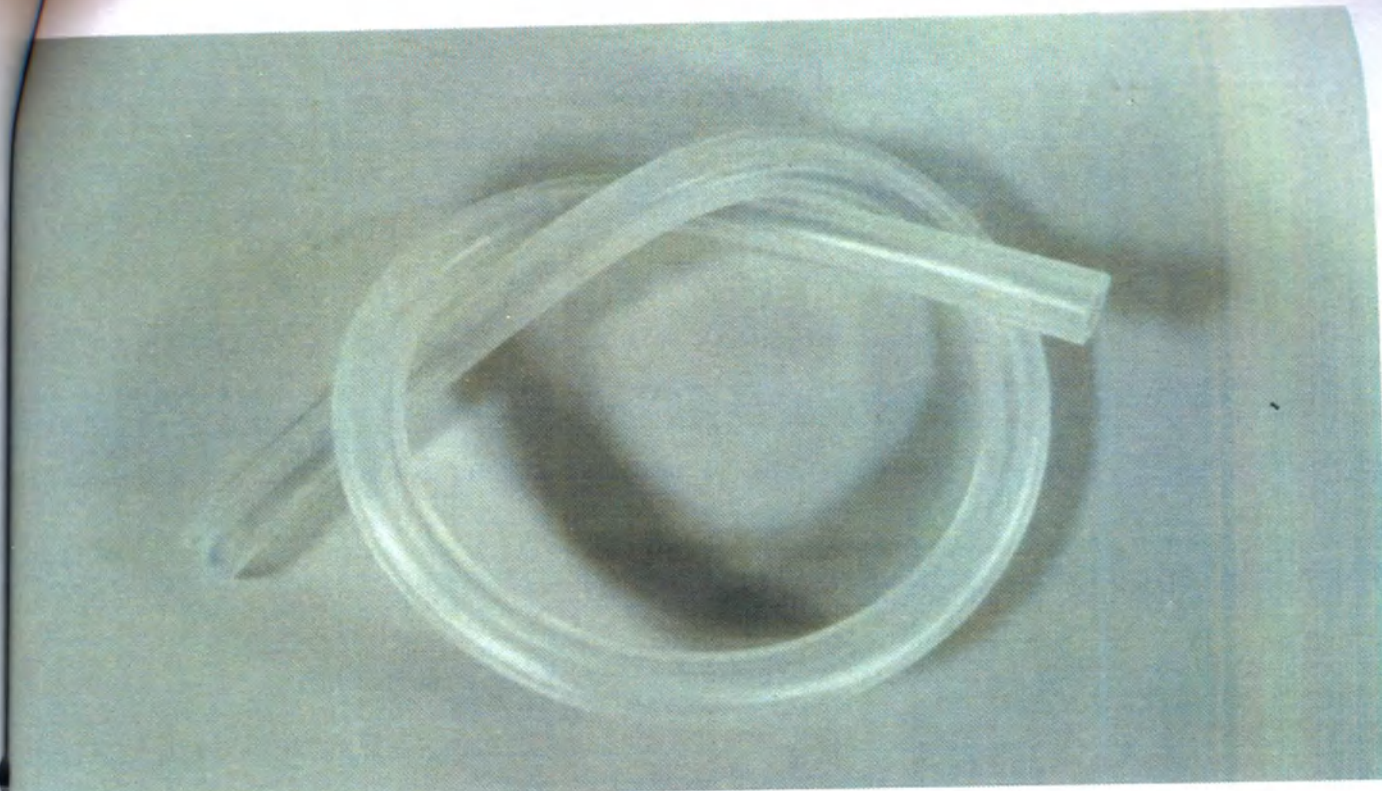


с. 14 – Трубка аспирационная переливная (0,5 м), SN344220008.
Файбер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

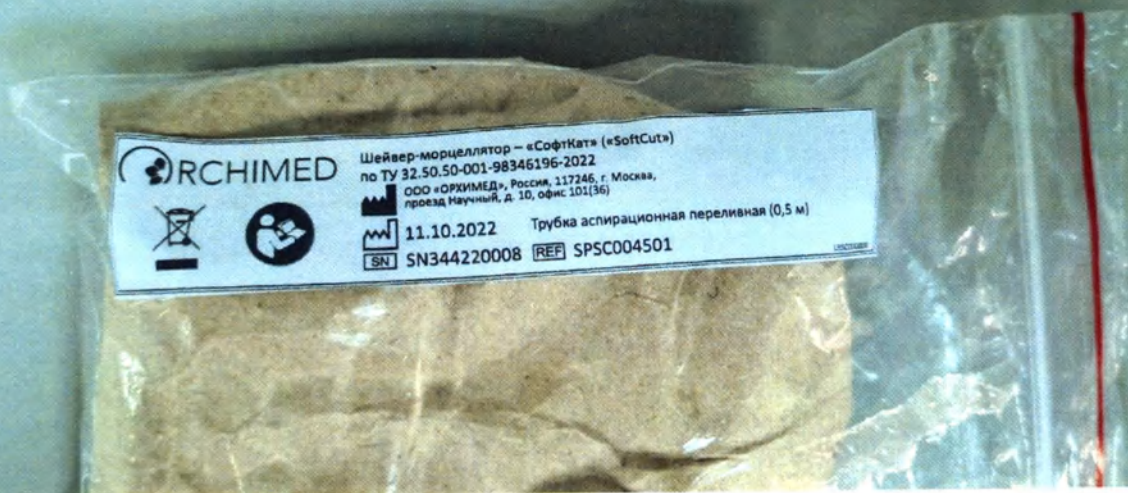

с. 15 – Трубка аспирационная переливная (0,5 м), SN344220008. В упаковке.
 шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

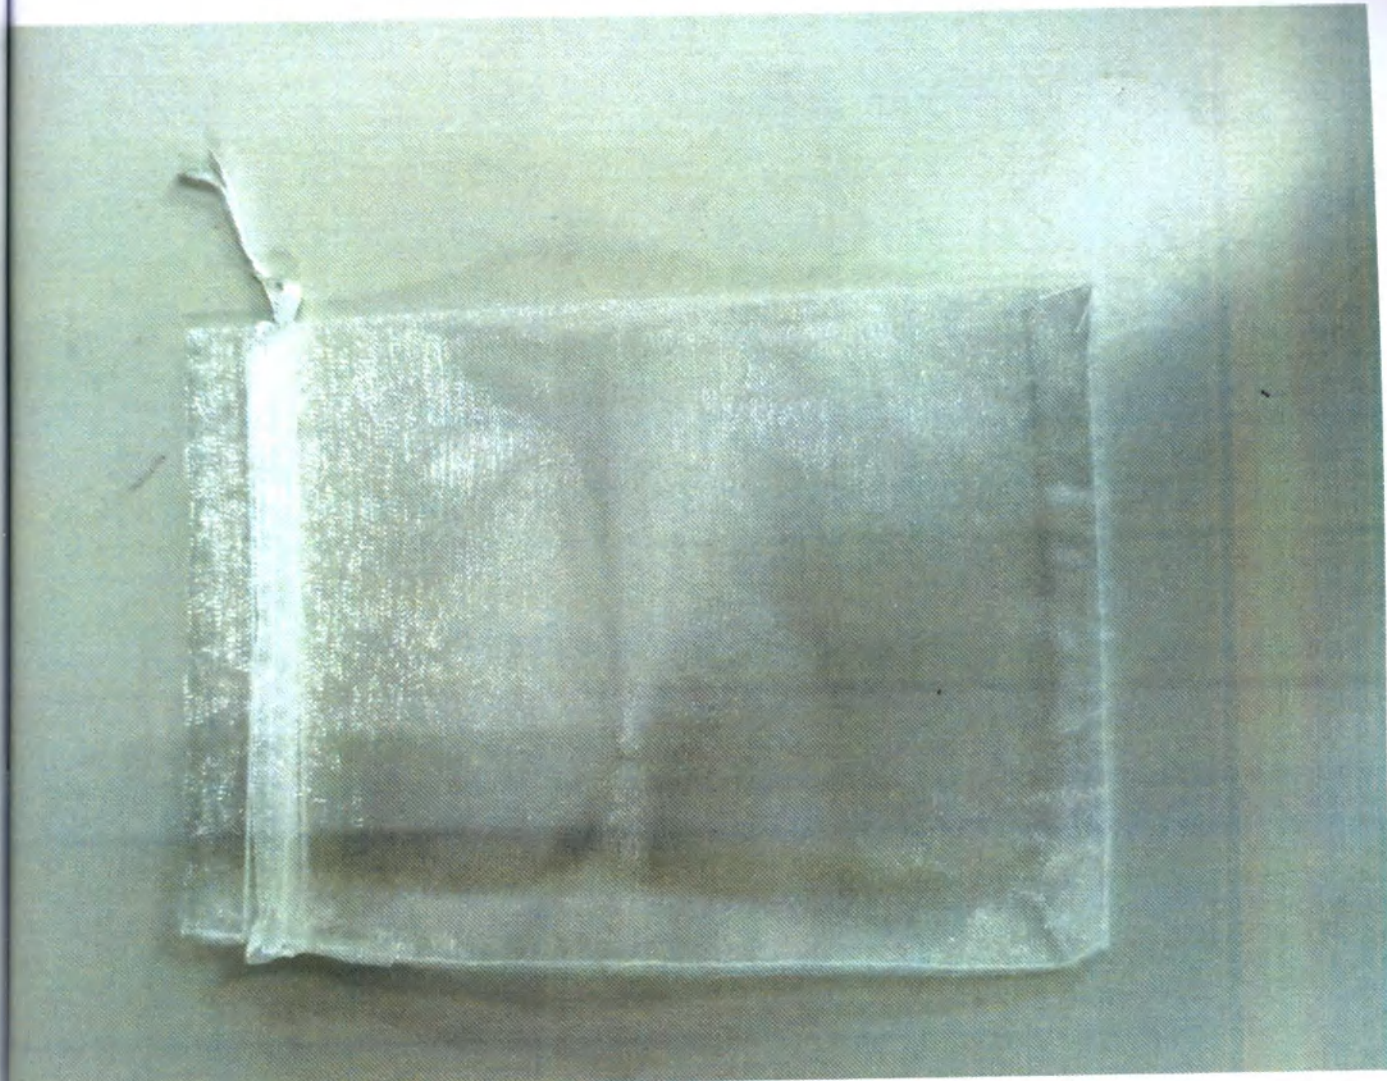

с. 16 – Мешок для сбора биологической ткани, SN344220009.
рейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

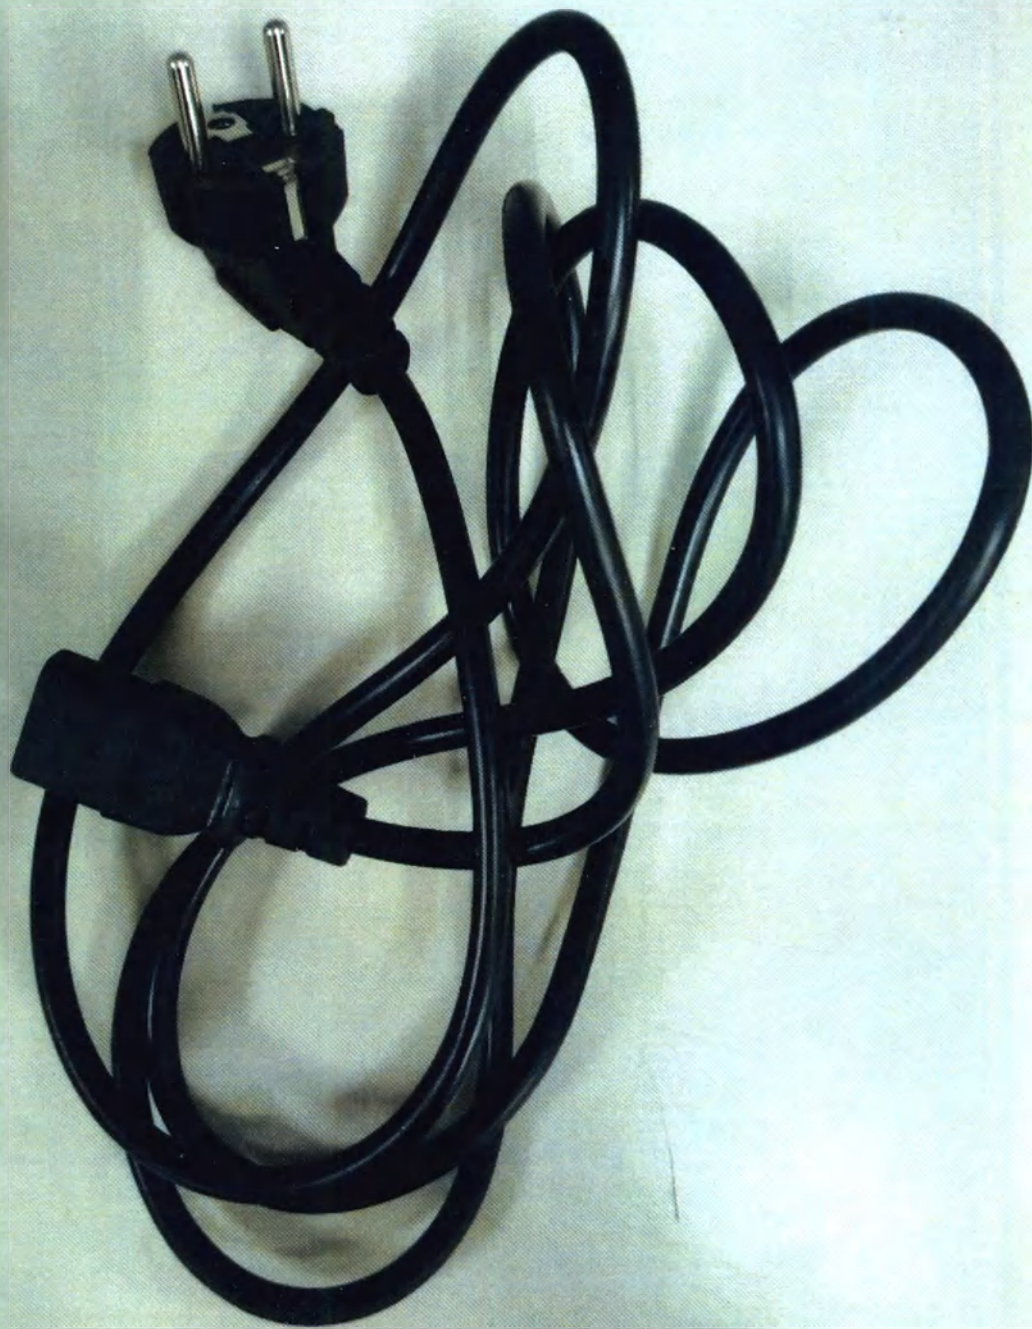

с. 17 – Кабель питания, SN344220010.
ейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

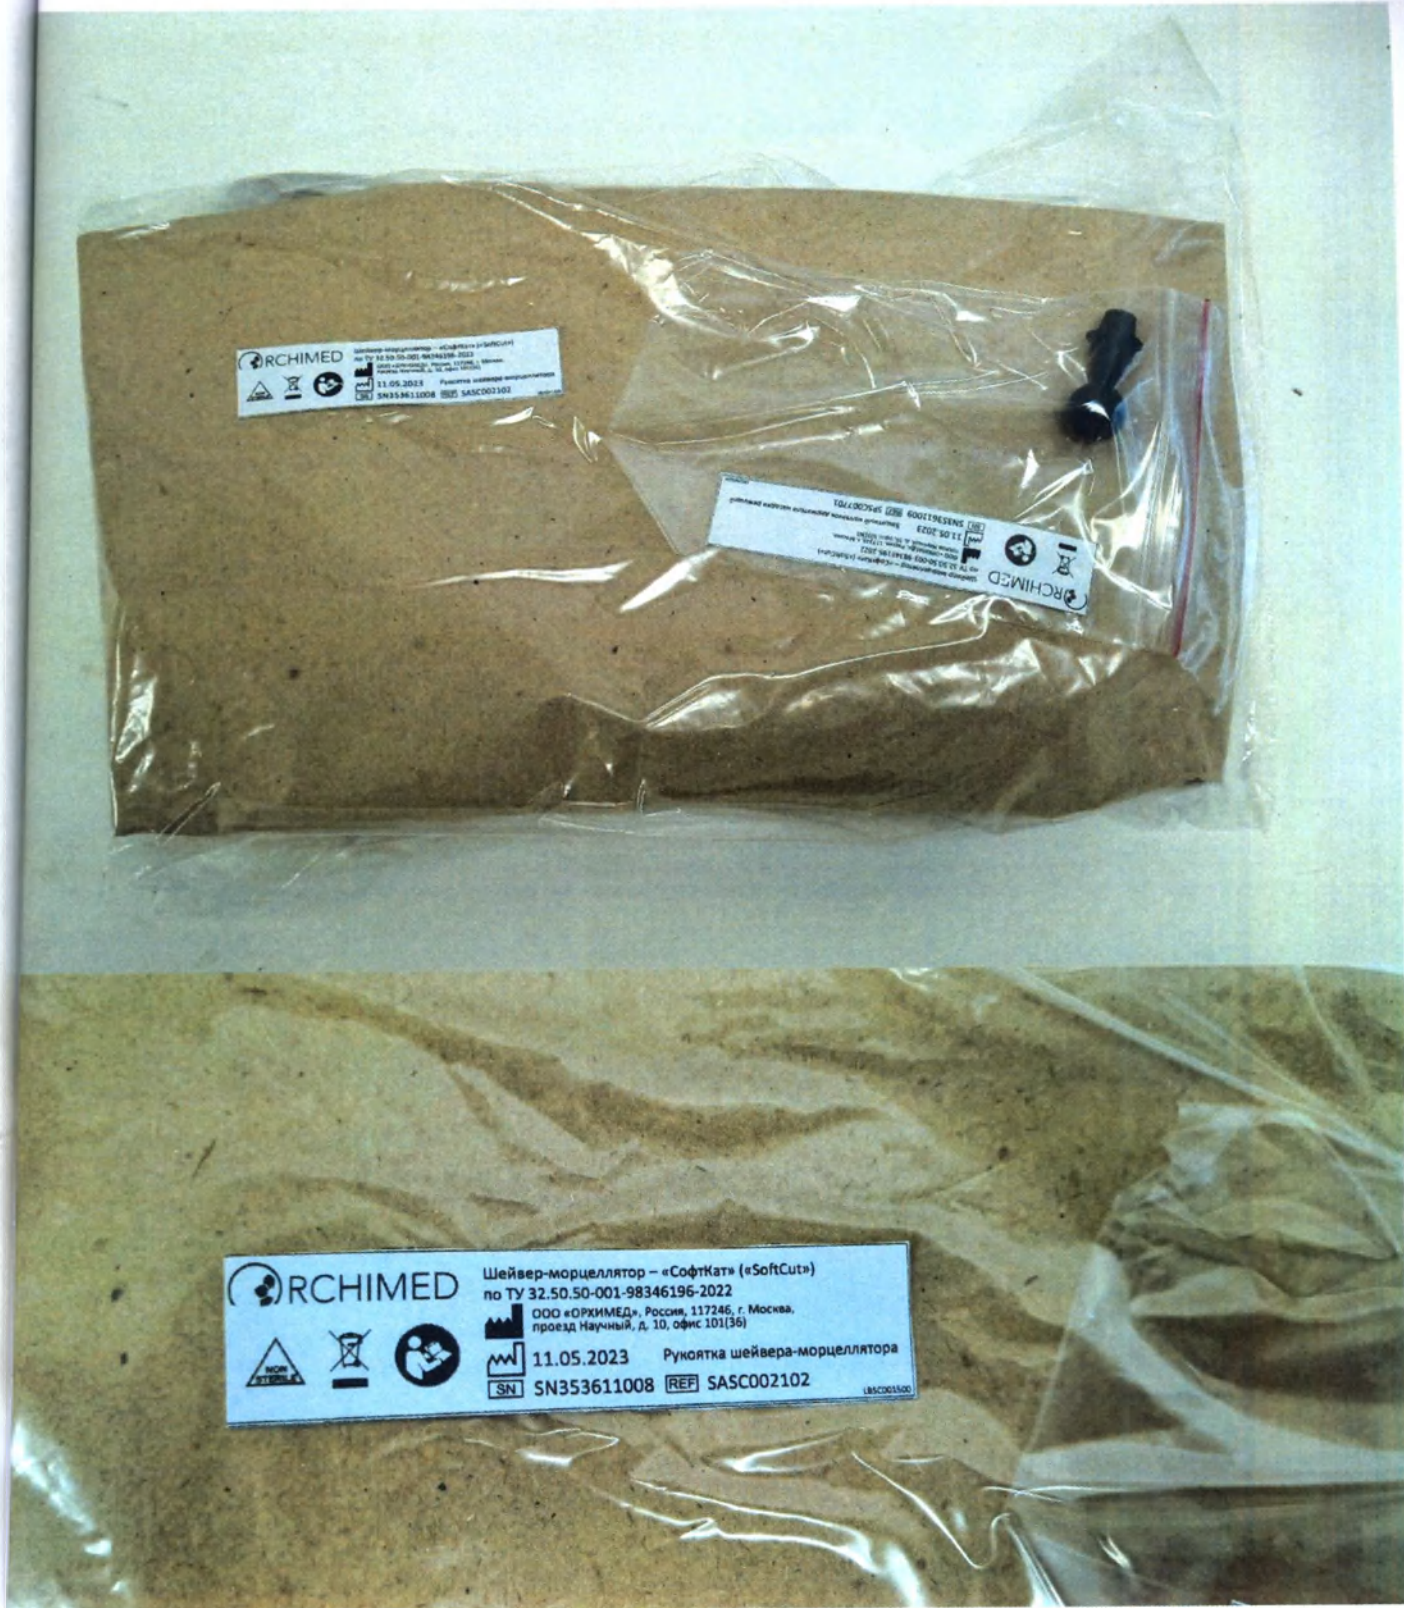


рис. 18 – Кабель питания, SN344220010. В упаковке.


Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



с. 19 – Рукоятка шейвера-морцеллятора, SN344220011.
шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



ис. 20 – Рукоятка шейвера-морцеллятора, SN353611008. В упаковке.
Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

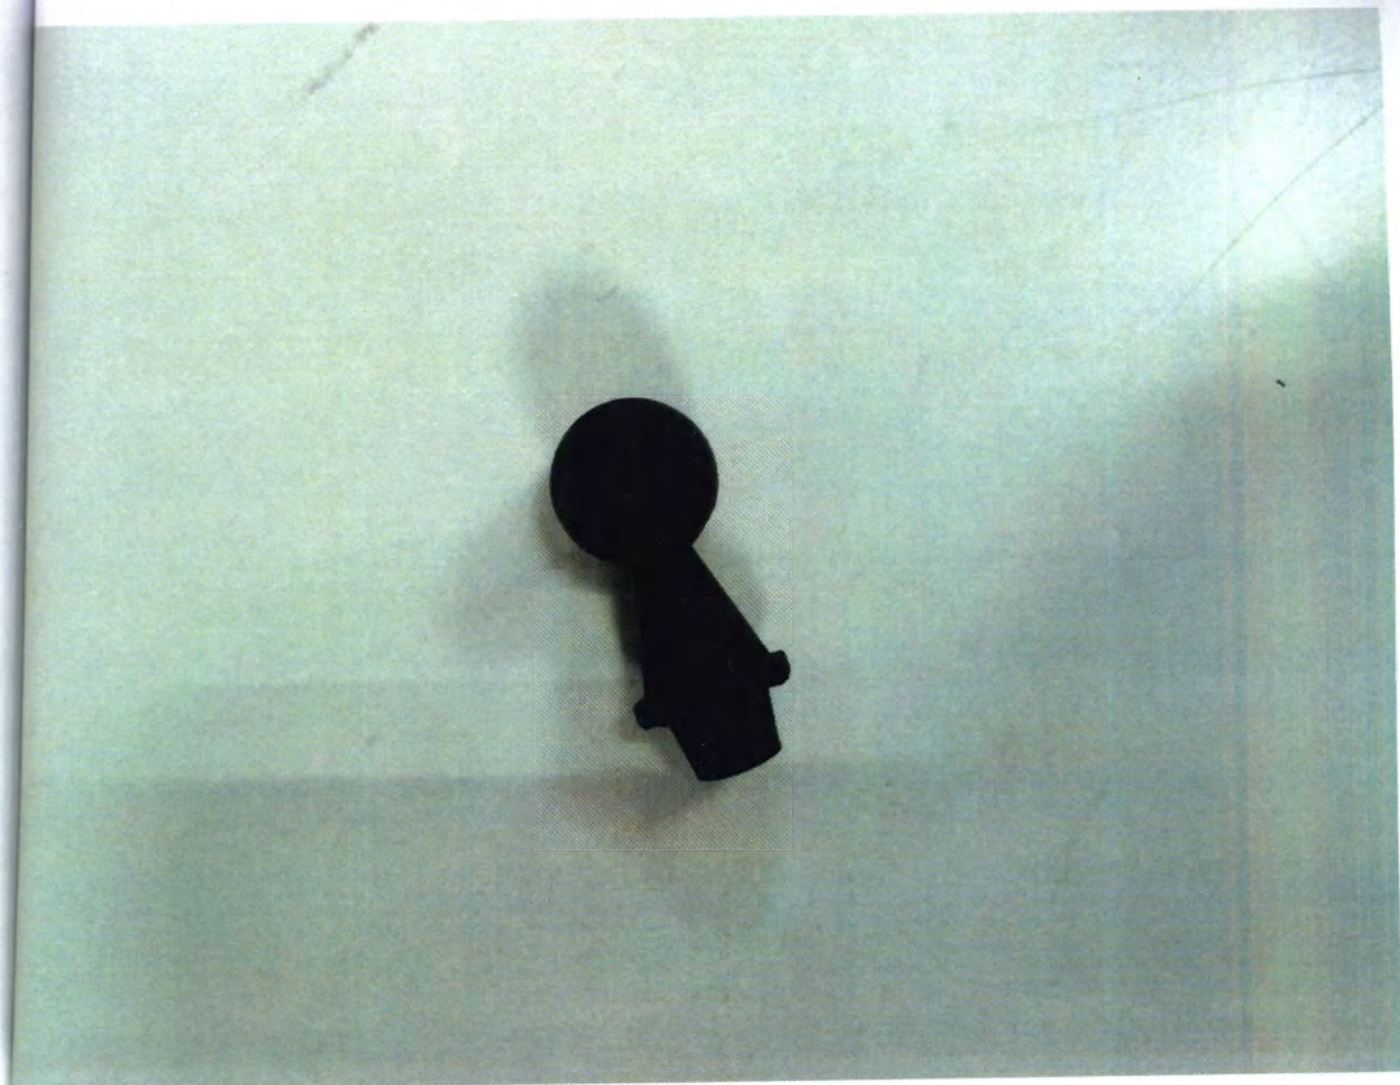

с. 21 – Защитный колпачок держателя насадки режущей, SN344220012.
ейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



с. 22 – Защитный колпачок разъема кабеля рукоятки, SN344220013.
рейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



с. 24 – Тележка для шейвера-морцеллятора, SN344220015.
шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



ис. 25 – Винт-фиксатор блока управления, SN344220016.

Фейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРХИМЕД»

ОКПД2 32.50.50.190

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ОРХИМЕД»



Д.В. Шумило

19.09.2022 г.

Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022
Паспорт
Введен впервые

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Имя, № дубл.	Подп. и дата

РАЗРАБОТАЛ

Инженер-конструктор
(должность)

С. 19.09.2022
(подпись, дата)

П.В. Ширококов
(инициалы, фамилия)

2022 г.

Рис. 26 – Паспорт SoftCut.

Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОРХИМЕД»

ОКПД2 32.50.50.190

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ООО «ОРХИМЕД»



Д.В. Шумило

2022 г.

Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022
Руководство пользователя
Введено впервые

Име. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Име. № дубл.	Подп. и дата

РАЗРАБОТАЛ

Инженер-конструктор
(должность)

g 19.08 2022
(подпись, дата)

П.В. Ширококов
(инициалы, фамилия)

2022 г.



рис. 28 – Комплект поставки основной. Транспортная тара.
Лейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.



с. 29 – Комплект поставки основной. Транспортная тара, маркировка.
Шейвер-морцеллятор – «СофтКат» («SoftCut») по ТУ 32.50.50-001-98346196-2022.

Всего в настоящем документе прошито,
пронумеровано и скреплено печатью:

30 ЛИСТОВ.

Генеральный директор ООО «САЙНСМЕД»

 Шумило Д. В.

«14» июля 2023 г.

