

**УТВЕРЖДАЮ**

**Директор**

**ООО «Инфомед-Нейро»**

**В.А. Шаповал**



**МАКЕТ МАРКИРОВКИ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

**Стимулятор электромагнитный транскраниальный, модель: ALTMS**

# REMED



**РЕМЕД Ко., Лтд (REMED Co., Ltd)**

301-303, Мигун Техно Ворлд II, 187, Техно 2-ро, Ясенг-гу,  
Даеджеон, 34025 Республика Корея / 301-303, Migun Techno World  
187, Techno 2-ro, Yeseong-Gu, Daejeon-Si, 34025, Republic of Korea

EC REP

Obelis s.a  
Boulevard General Wahls  
53,  
1030 Brussels, BELGIUM

## Модель: ALTMS

Номинальное напряжение: 230В ~, 50Гц,

Максимальная потребляемая мощность: 3000ВА


Масса: 64 кг.



Чтобы убедиться в понимании всех функций и обеспечить эффективное  
использование этого оборудования, пожалуйста, внимательно  
прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием.



2797



2301001



16.01.2023



# REMED



**РЕМЕД Ко., Лтд (REMED Co., Ltd)**

84, Осонгсаенгъеонг 2-ро,  
Осонг-еп, Хеунгдеок-гу Чонгджу-си Чонгченгбук-до  
Республика Корея / 84, Osongsaengmyeong 2-ro,  
Osong-eup, Heungdeok-gu Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea

EC REP

Obelis s.a  
Boulevard General Wahls  
53,  
1030 Brussels, BELGIUM

## Модель: ALTMS


Номинальное напряжение: 230В ~, 50Гц,  
Максимальная потребляемая мощность: 3000ВА  
Масса: 64 кг.



Чтобы убедиться в понимании всех функций и обеспечить эффективное использование этого оборудования, пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации перед использованием.



2797



2301001



16.01.2023



Прошнуровано и  
пронумеровано

3

страниц



**УТВЕРЖДАЮ**

Директор  
ООО «Инфомед-Нейро»  
В.А.Шаповал



**«19» ноября 2024г.**

**Фотографические изображения  
Медицинского изделия**

Стимулятор электромагнитный транскраниальный, модель: ALTMS



Рисунок 1. Вид спереди



Рисунок 2. Вид сзади



Рисунок 3. Вид сверху

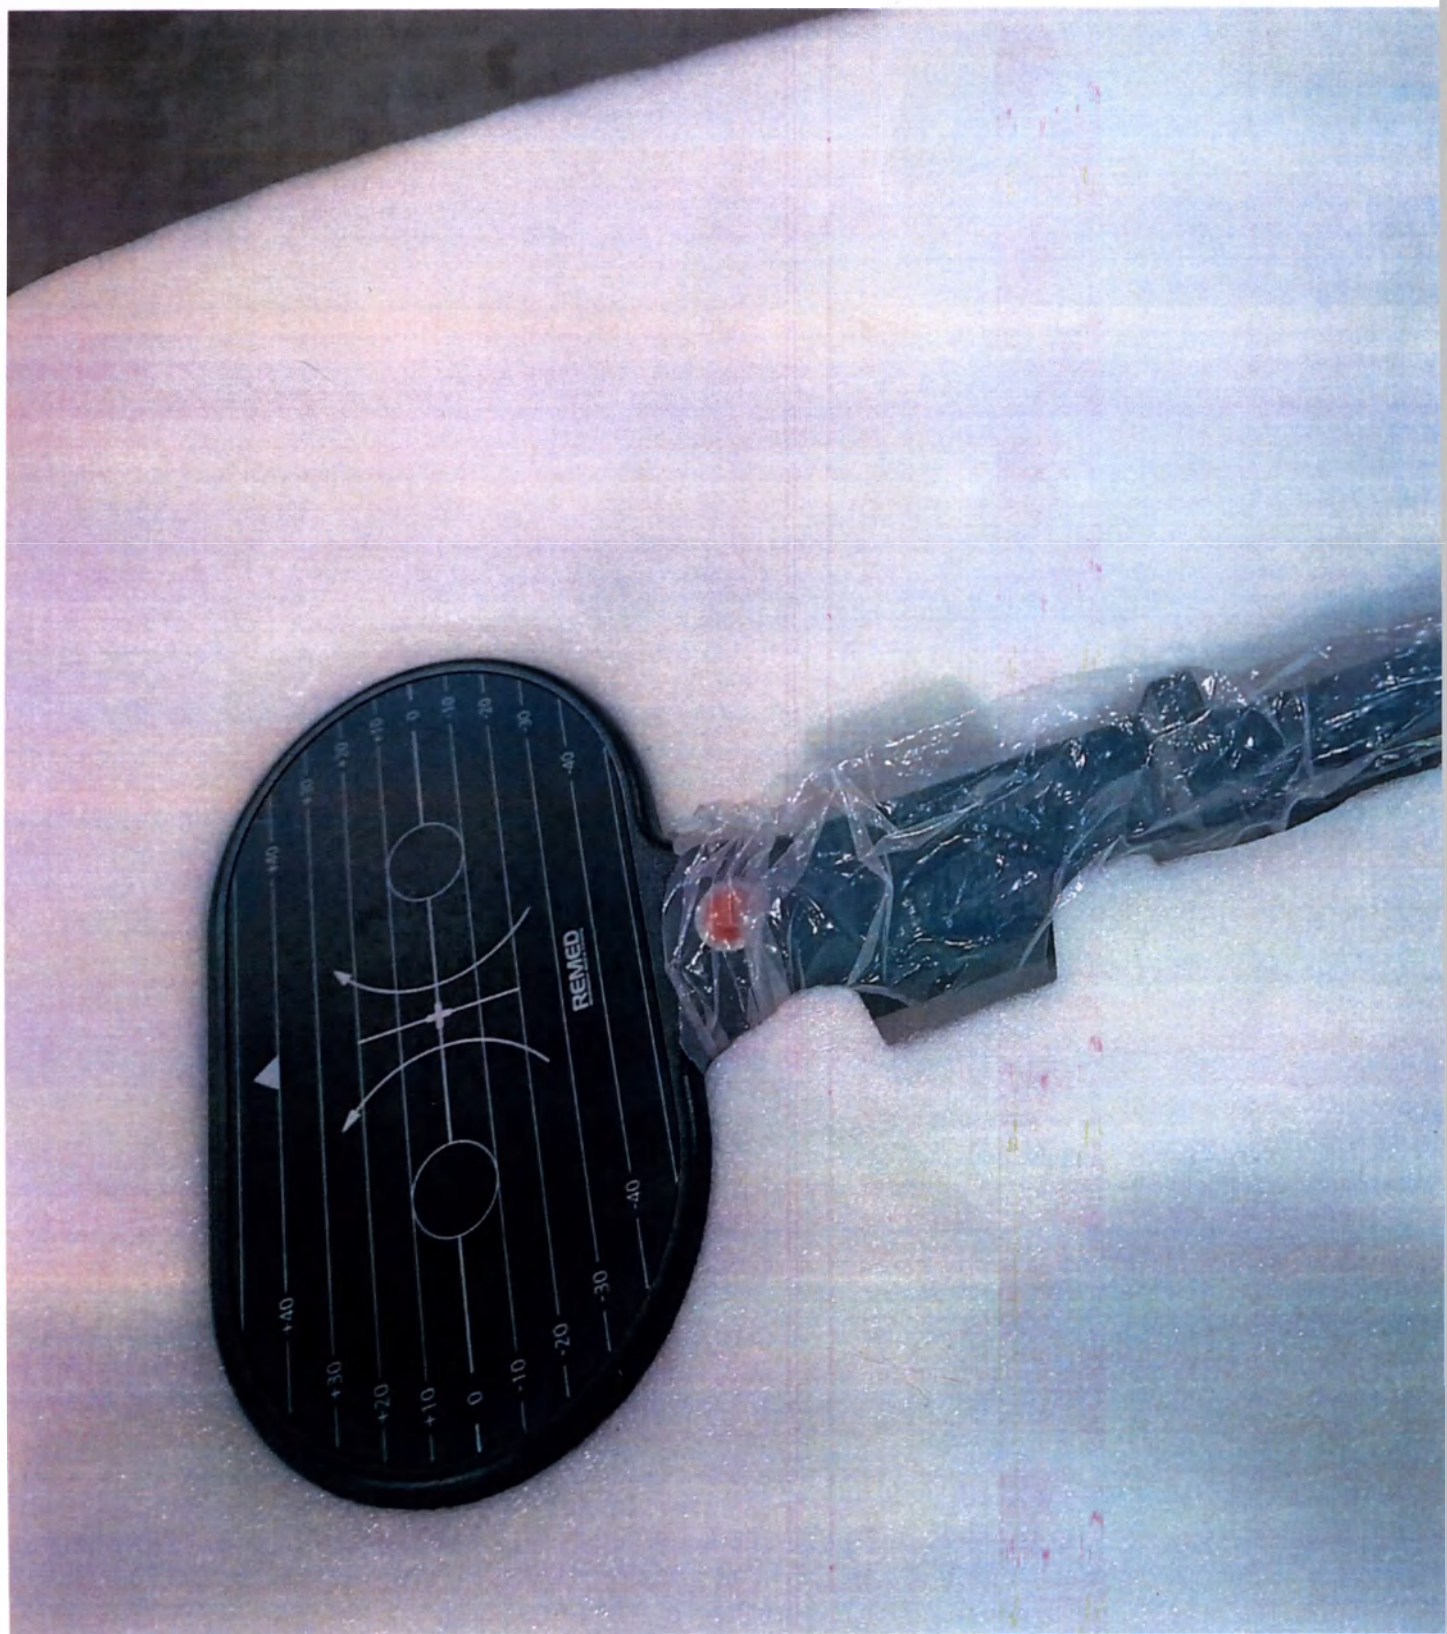


Рисунок 4. Индуктор



Рисунок 5. Кресло функциональное



Рисунок 6. Кресло функциональное с маркировкой безопасной рабочей нагрузки



Рисунок 7. Стойка для держателя индуктора



Рисунок 8. Держатель индуктора

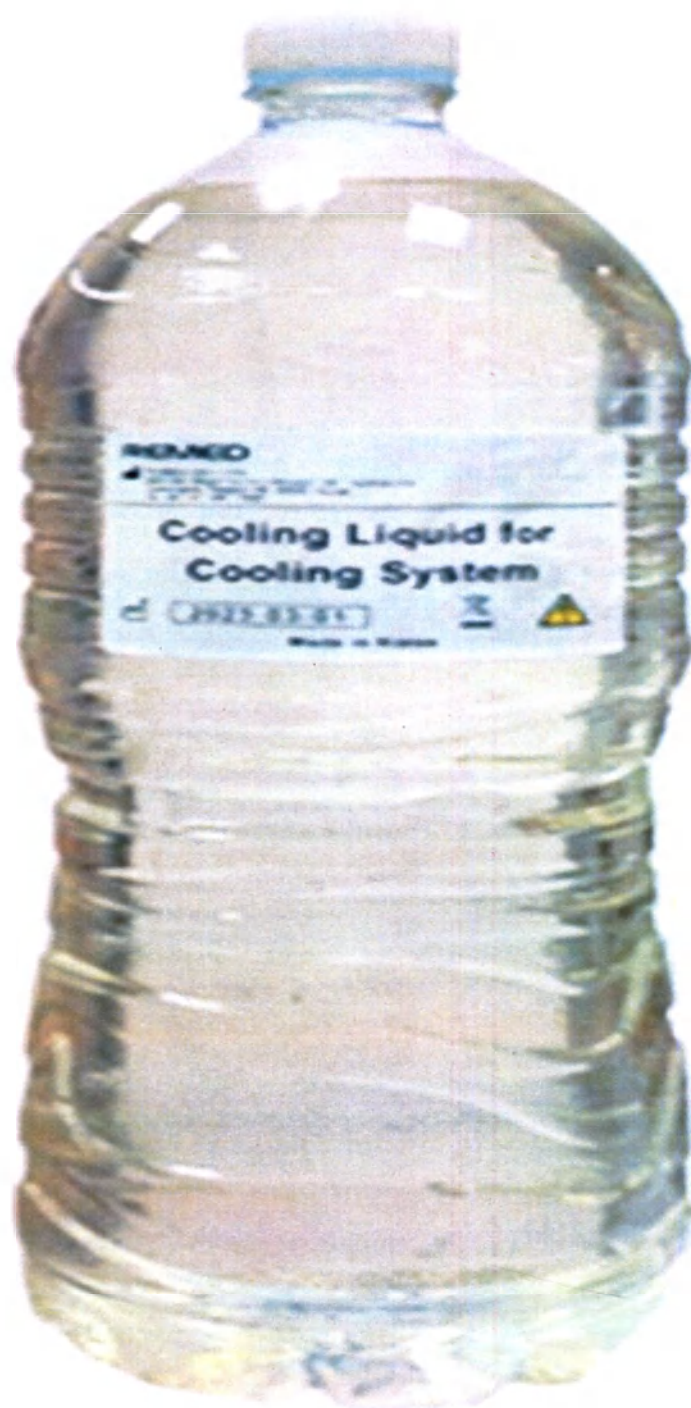


Рисунок 9. Жидкость охлаждающая, для системы охлаждения



Рисунок 10. Шапка функциональная

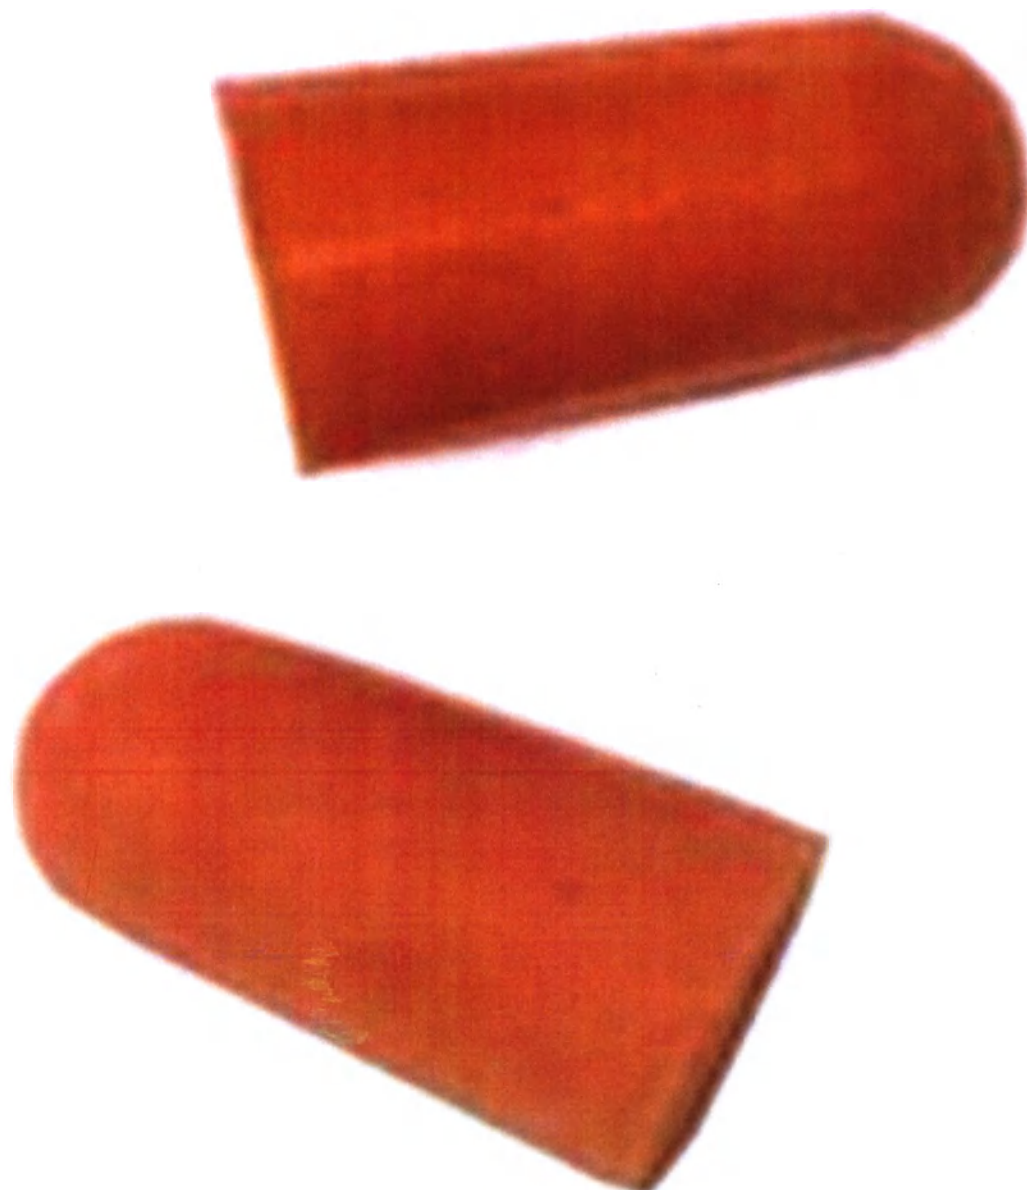


Рисунок 11. Беруши



Рисунок 12. Линейка



Рисунок 13. Ключ шестигранный

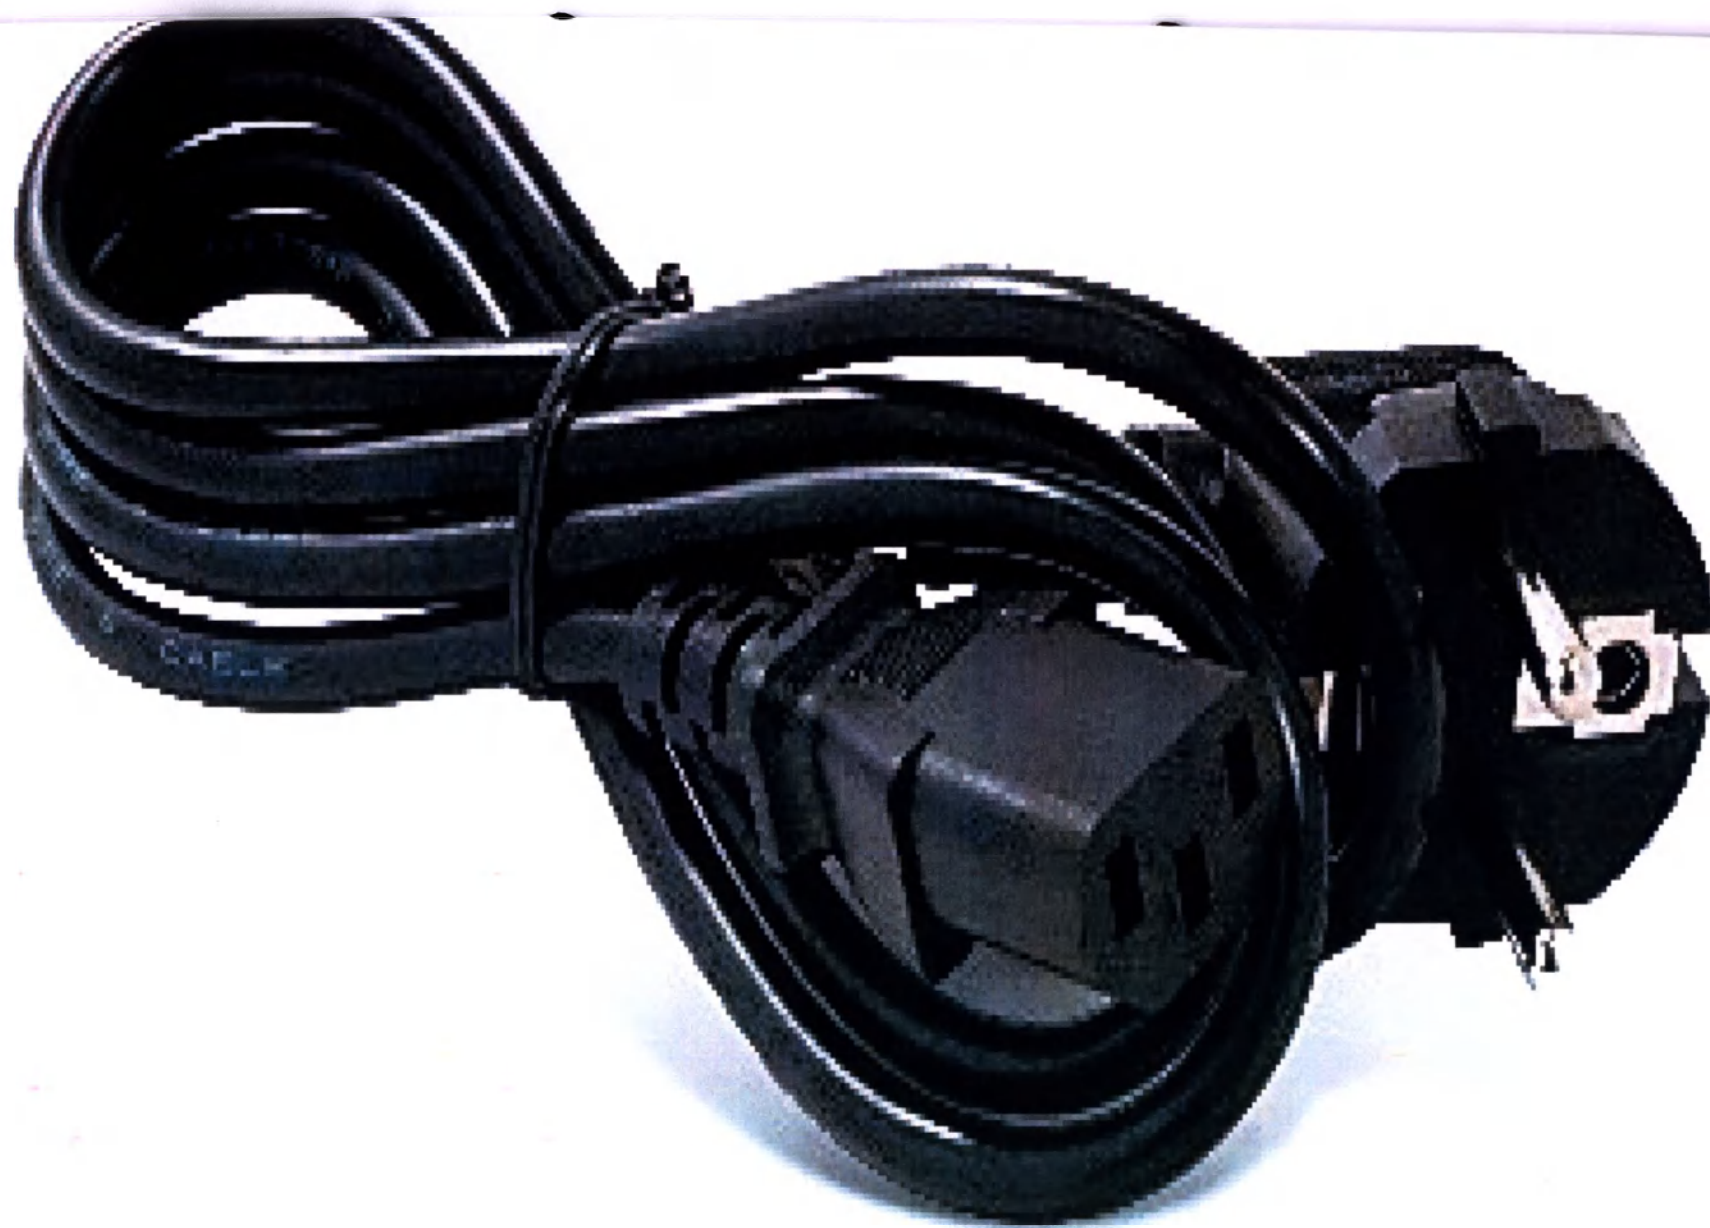


Рисунок 14. Кабель питания

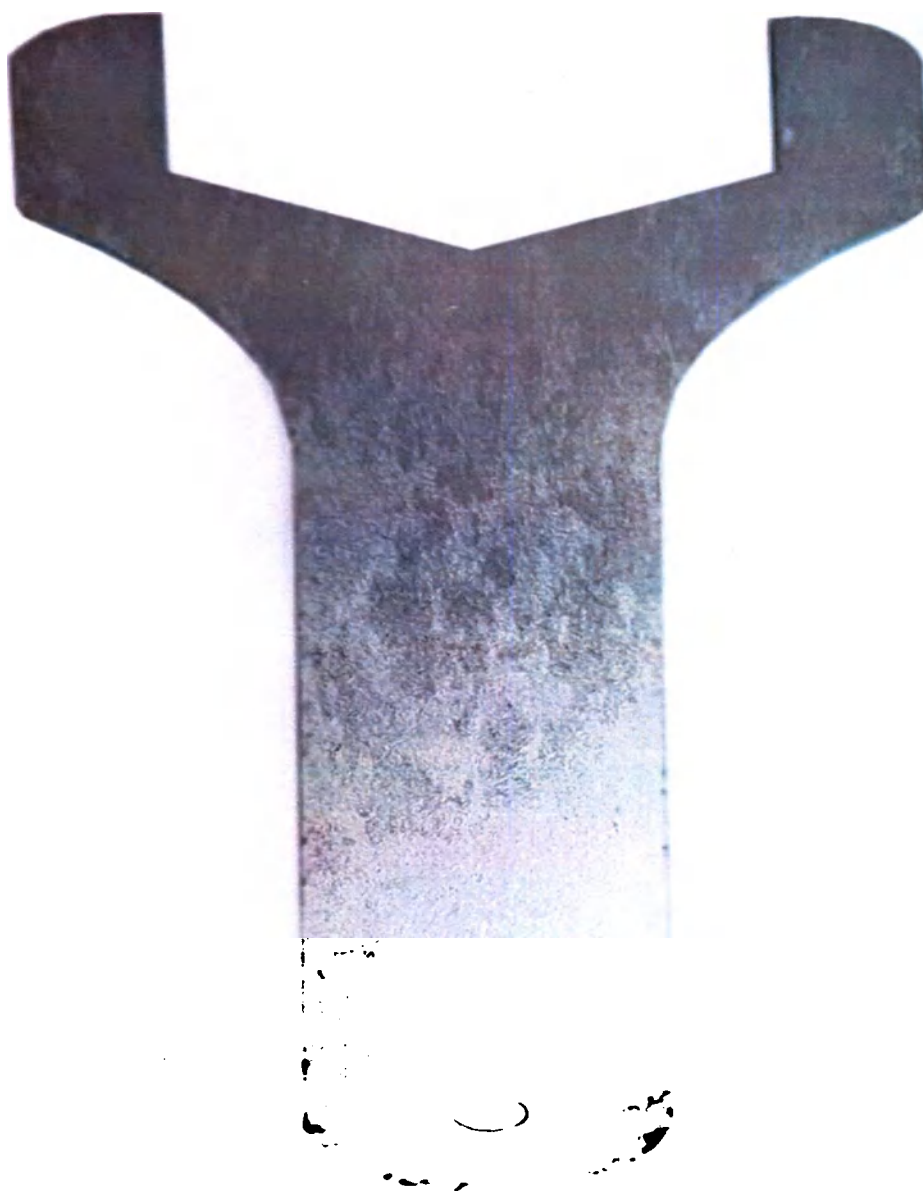


Рисунок 15. Накидной ключ

Прошнуровано и  
пронумеровано

16

страниц

