

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «МЕДТЕХ-РМ»



Кокотов О.Б.

«25» декабря 2023 г.

СВЕДЕНИЯ О МАРКИРОВКЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Микротом криостатический СТ520 (Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

1. Маркировка Микротомы криостатического CT520 (Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

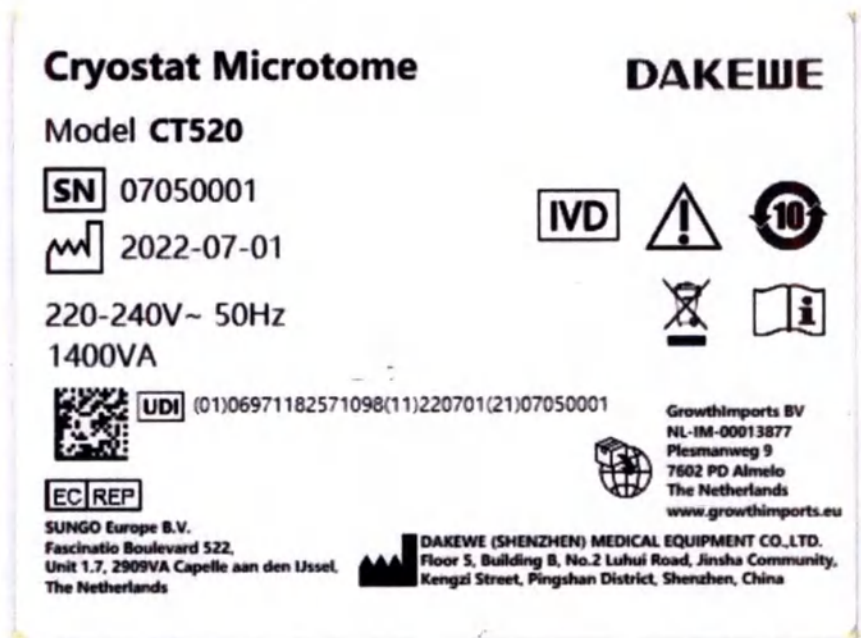


Рисунок 1. Образец маркировки Микротомы криостатического CT520, расположенной на корпусе микротомы

Размер этикетки 85x65 мм ±5 мм

Таблица 1. Перевод маркировки аппарата для гистологической проводки тканей HP300 Плюс на русский язык

Английский язык	Русский язык
Cryostat microtome	Микротом криостатический
Model	Модель
CT520	CT520
SUNGO Europe B.V.	СУНГО Юроп Б.В.
Fascinatia Boulevard 522, Unit 1.7. 2909VA Capelle aan den Ussel, The Netherlands	Бульвар Фасцинатио 522, Блок 1.7. 2909VA Капелле-ан-ден-Эйссел, Нидерланды
Growthimports BV	Гросимпортс BV
NL-IM-00013877 Plesmanweg 9 7602 PD Almeo The Netherlands www.growthimpots.es	NL-IM-00013877 Плесманверг 9 7602 PD Алмео Нидерланды www.growthimpots.es
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.	Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China.	5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай

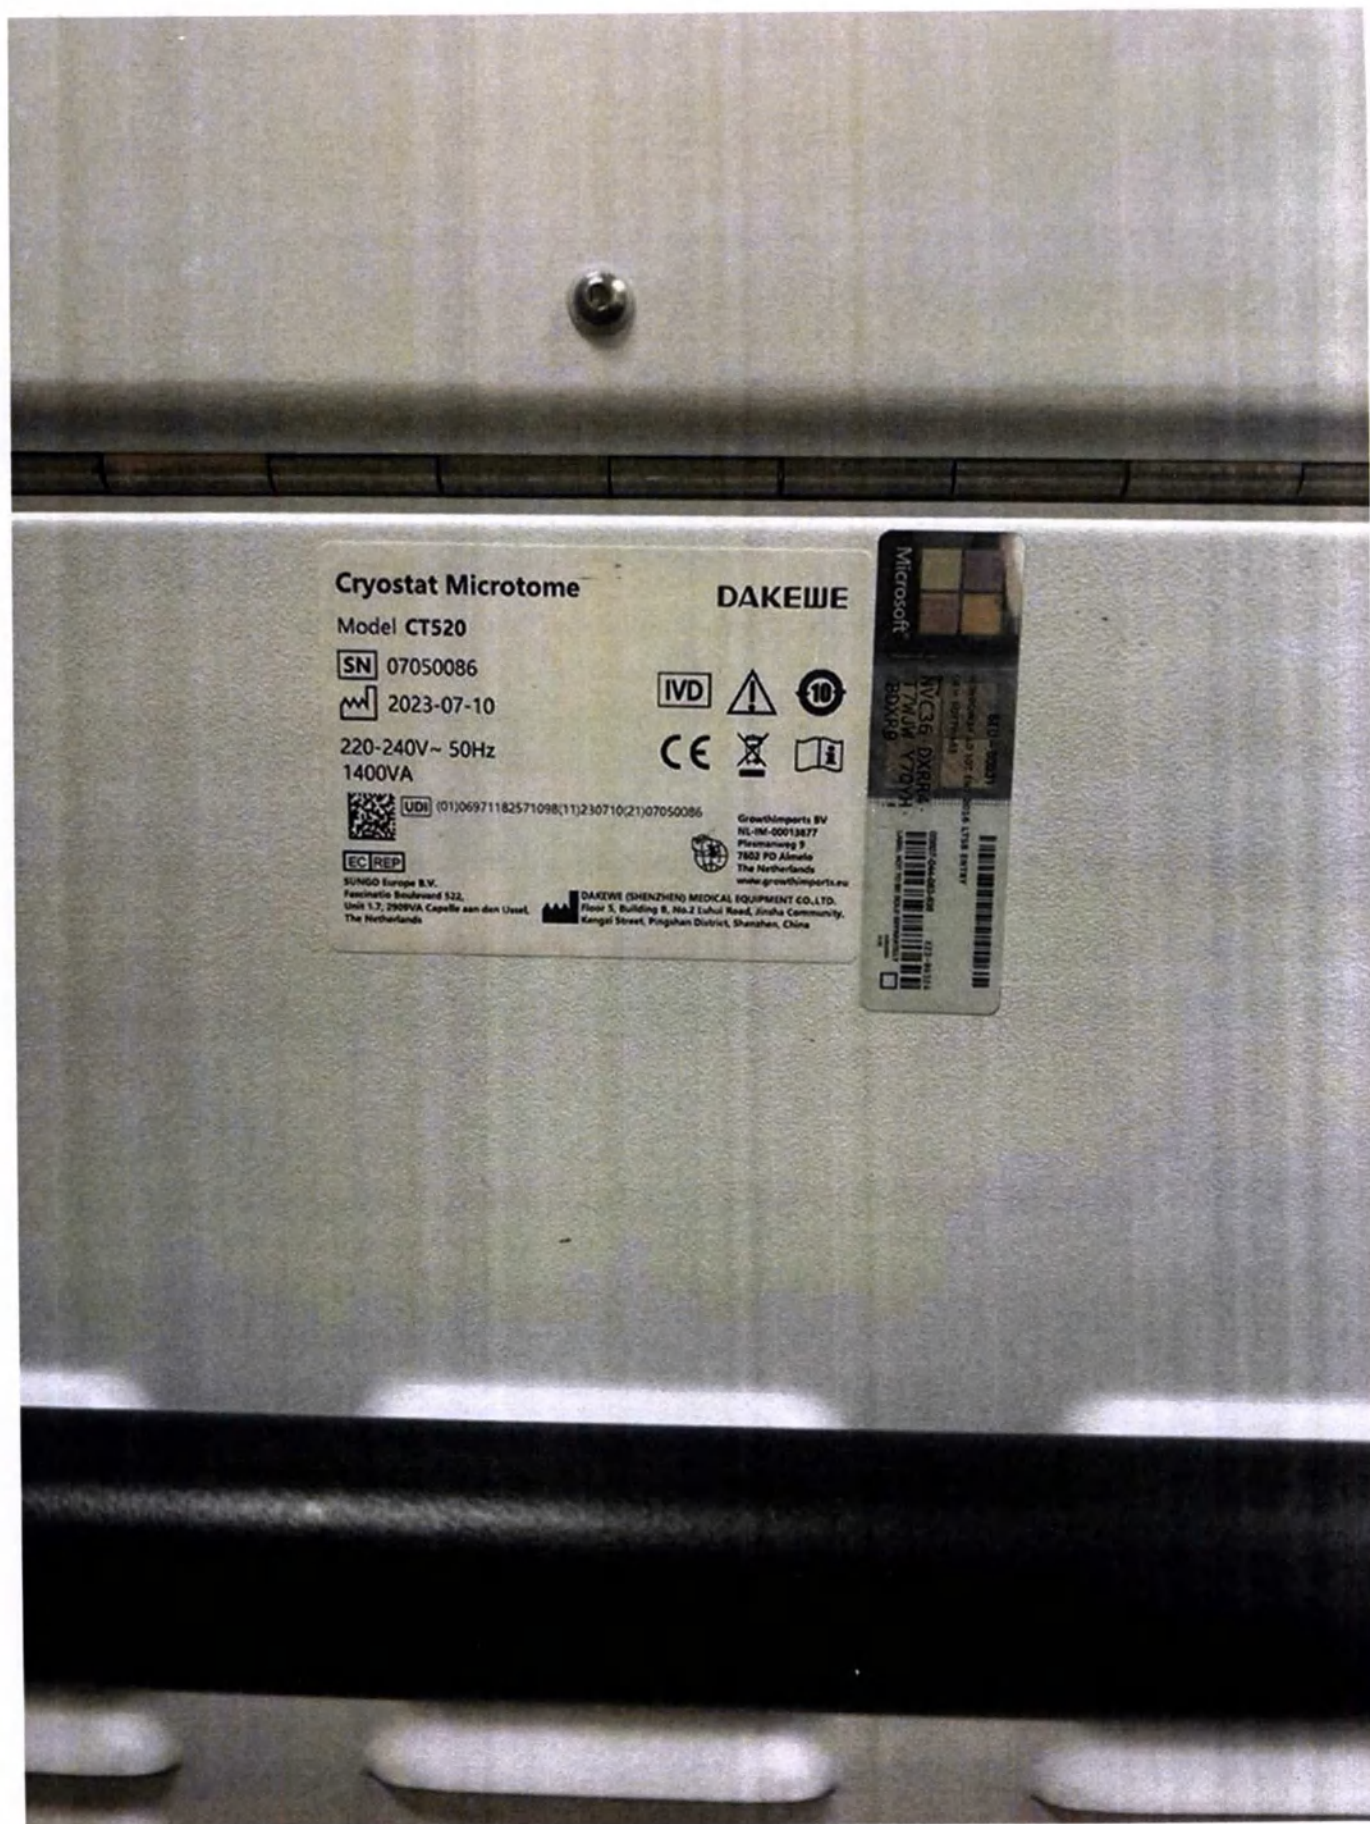


Рисунок 2. Изображение маркировки, расположенной на задней панели прибора

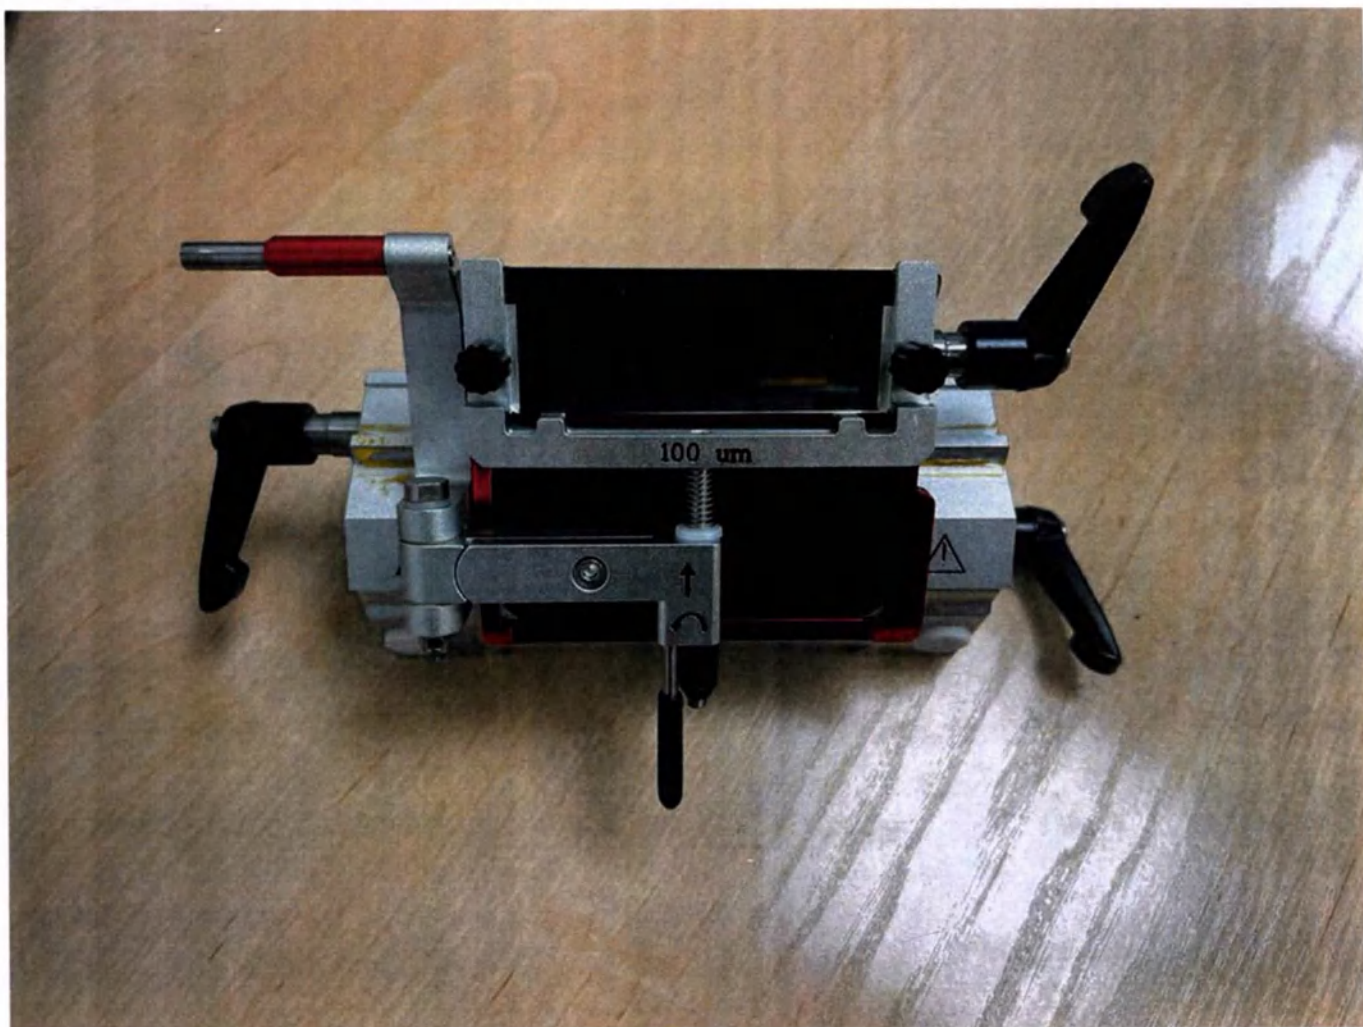


Рисунок 3. Изображение маркировки, расположенной на держателе лезвия



Рисунок 4. Изображение маркировки, расположенной на стеклянной дверце криокамеры

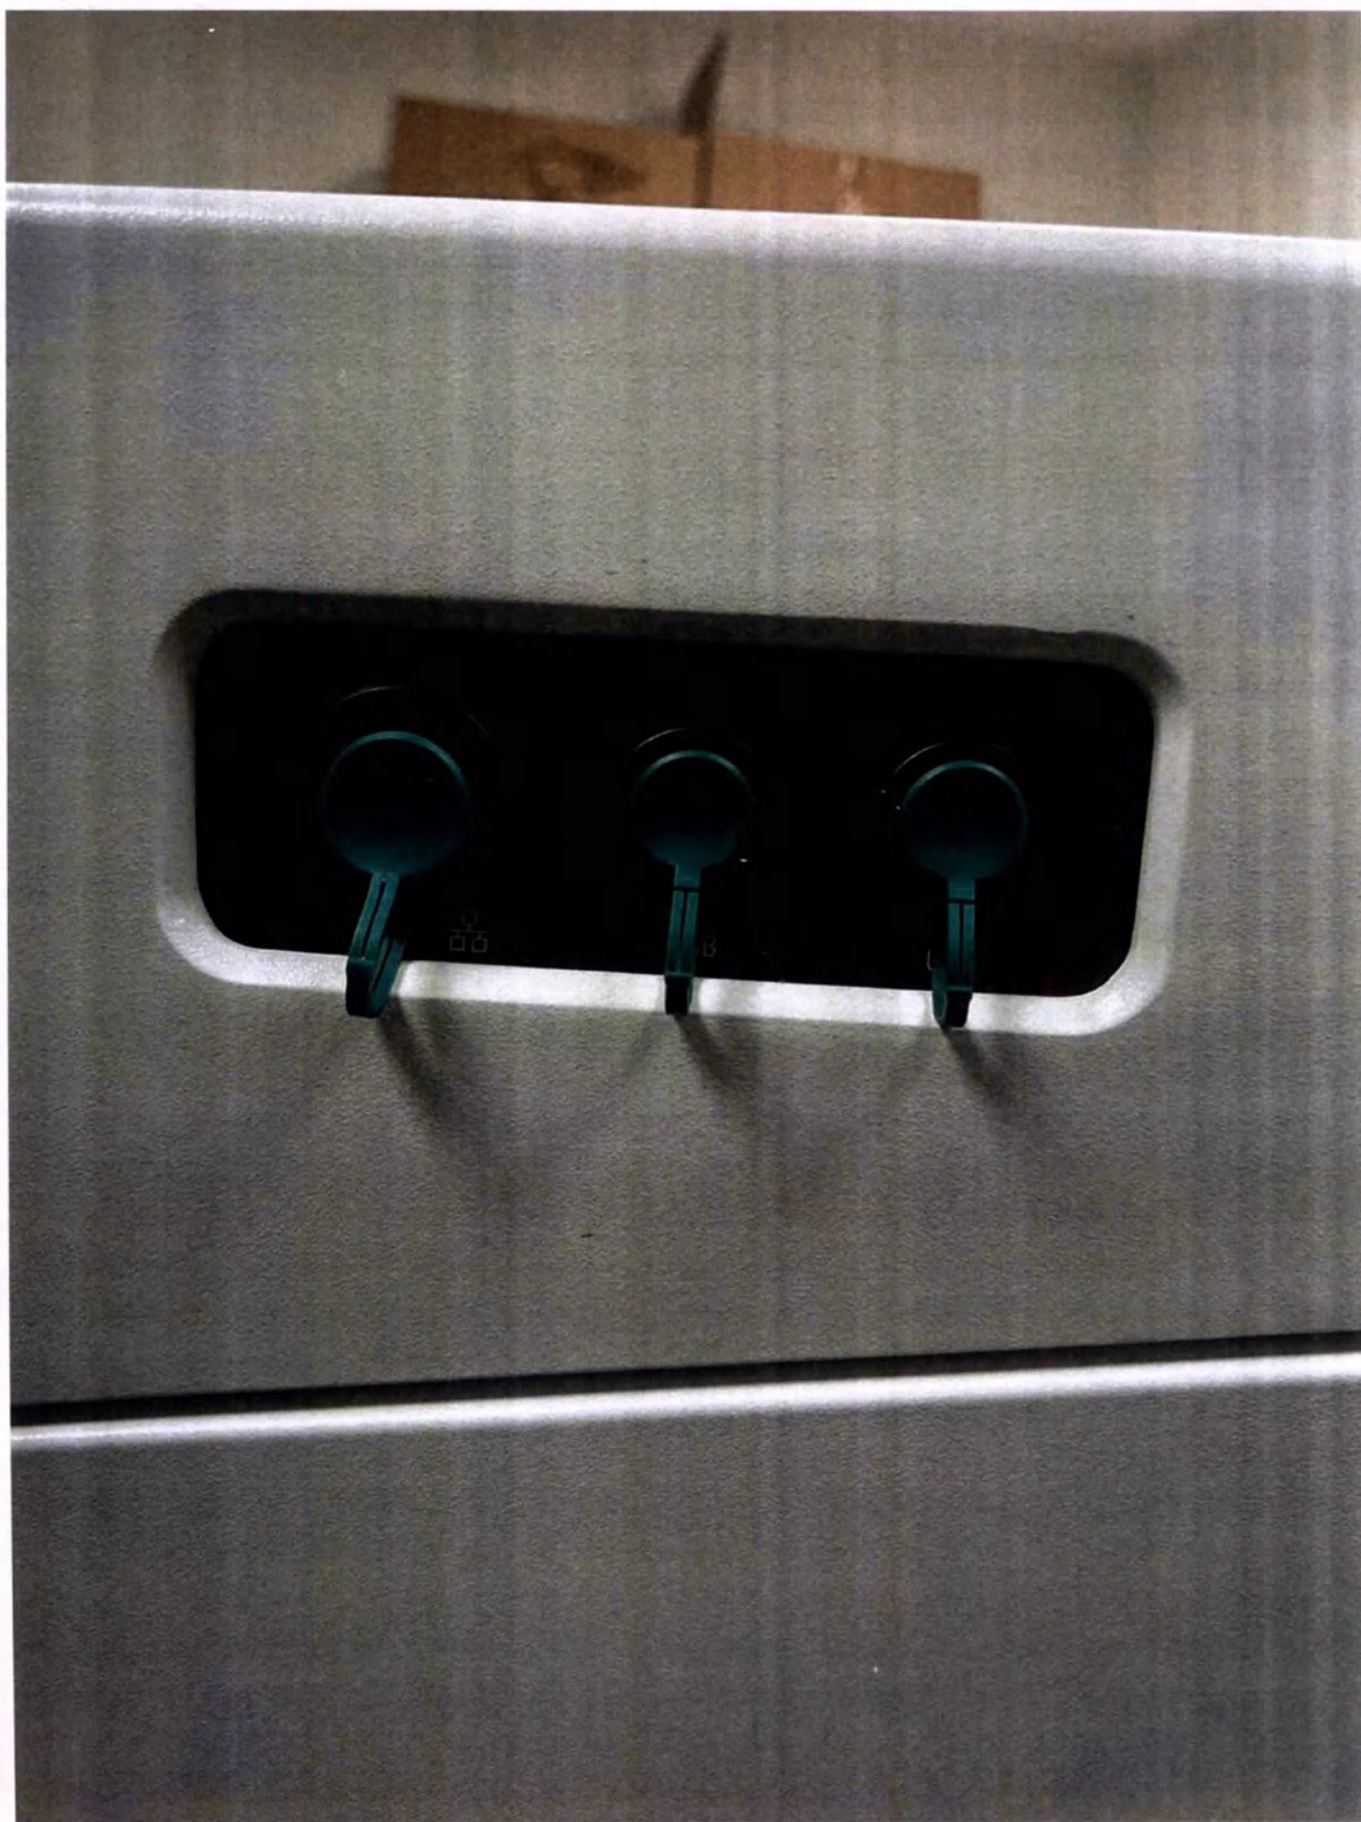


Рисунок 5. Изображение маркировки сетевого интерфейса, расположенной на боковой панели прибора

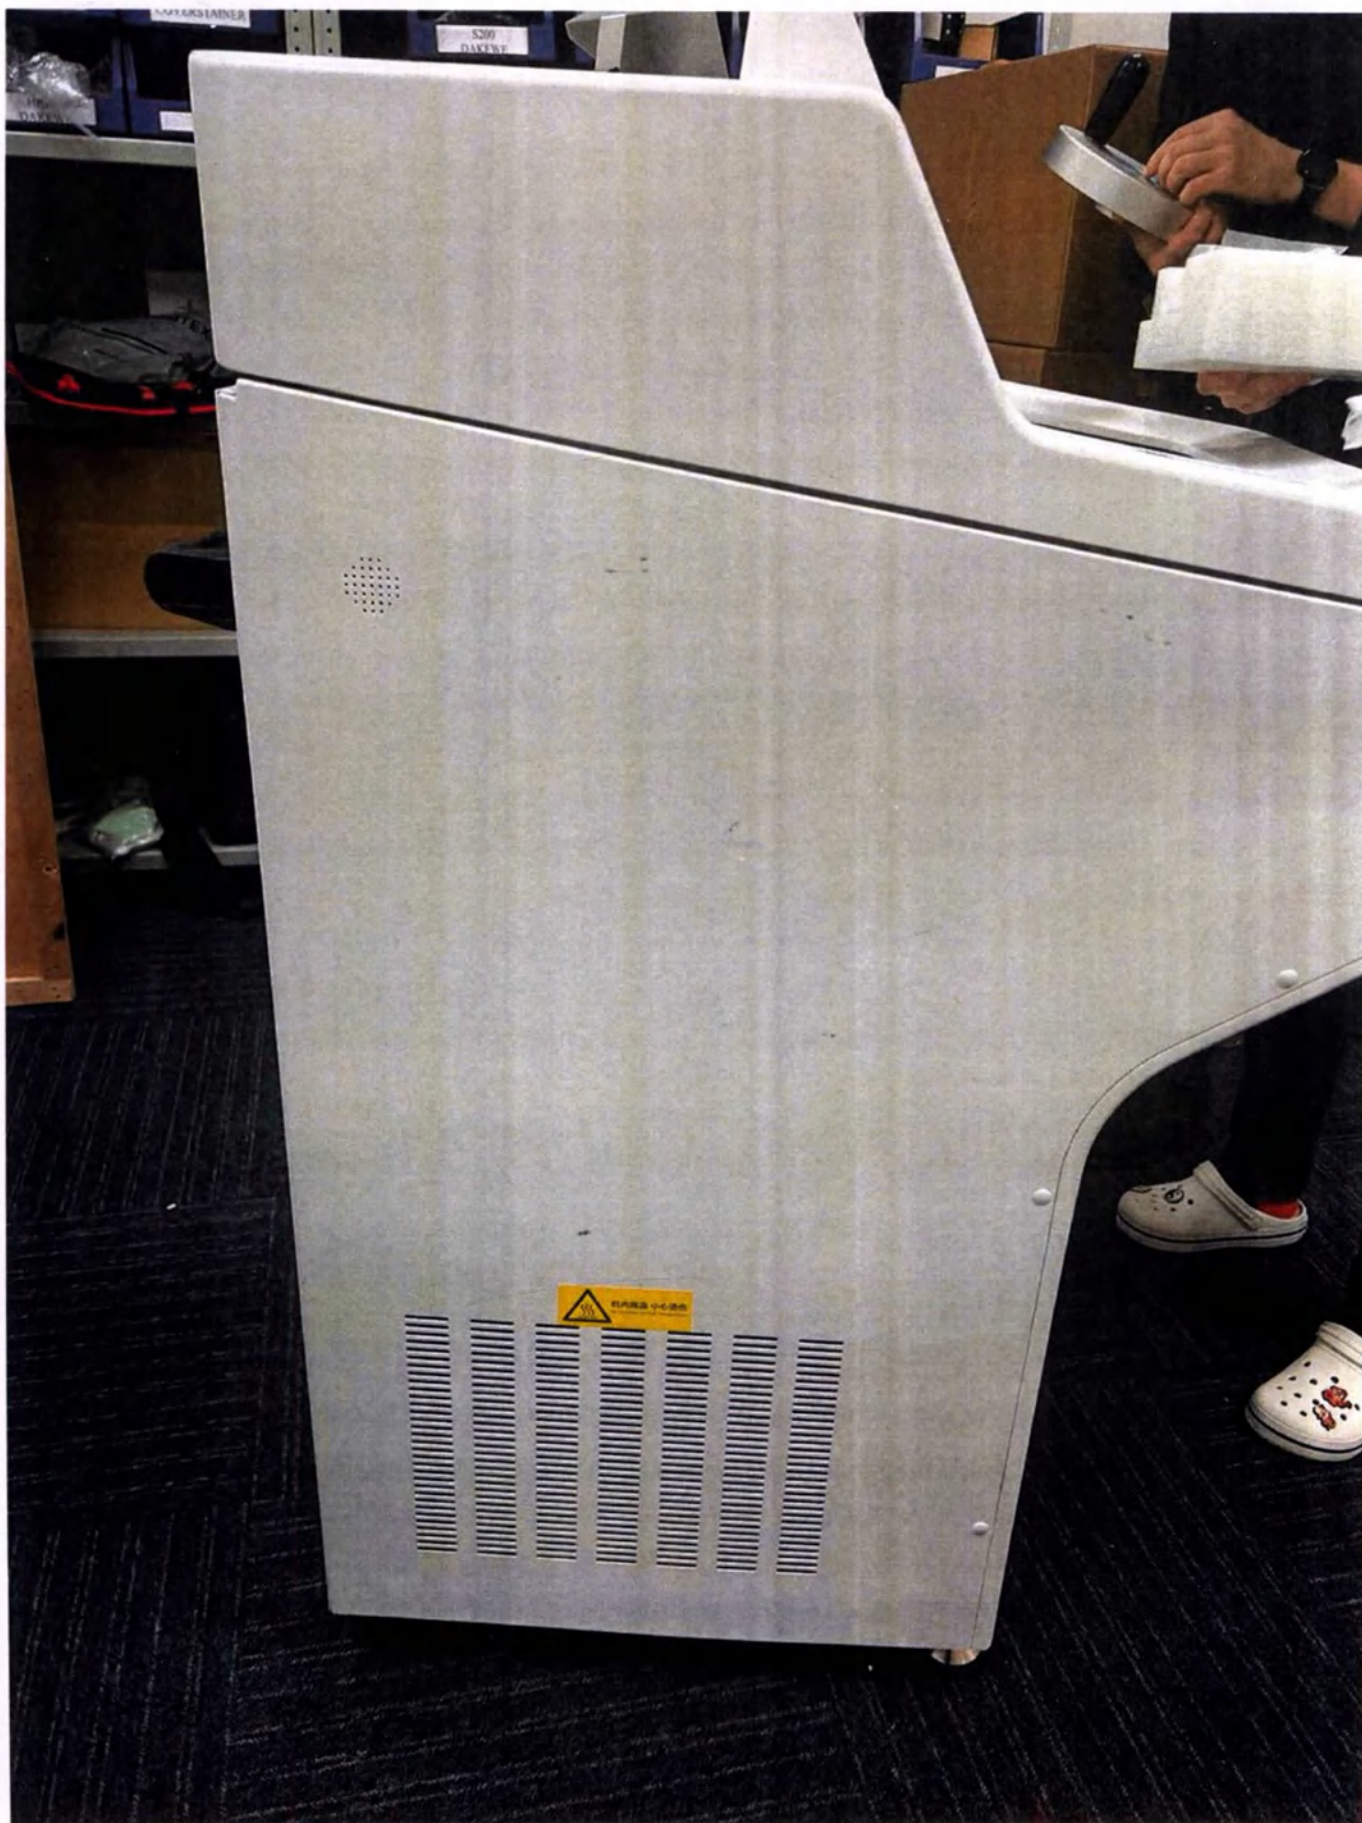


Рисунок 6-1. Изображение маркировки на боковой панели прибора



Рисунок 6-2. Изображение маркировки на боковой панели прибора
Be Cautious of High Temperature Осторожно, высокая температура!



Рисунок 7. Изображение маркировки у бутылки для конденсата

**Макет маркировки Микротома криостатического CT520 (Cryostat microtome CT520)
с принадлежностями на русском языке**

**Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями**

ПУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Срок службы – 7 лет

 XXXXXXXXXXXX

 XX.XX.XXXX

 (01)06971182570978(11)220228(21)15010001



ДАКЕШЕ

Напряжение 220-240 В

Частота ~50 Гц

Мощность 1200 ВА

Эксплуатация от +5 °С до +35 °С

Хранение от +5 °С до +55 °С

Транспортировка от +5 °С до +55 °С

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



**Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
(Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.)**


Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай (Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China)
тел.: +86 755 2640 5921

Место производства:

Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. / Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай (Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China)

Таблица 2. Описание символов, применяемых на маркировке

Символ	Описание
	Серийный номер
	Уникальный идентификатор изделия
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Импортёр
	Осторожно Указание на важную предупреждающую информацию, с которой пользователи должны ознакомиться в Руководстве пользователя.
	Знак защиты окружающей среды Директивы RoHS. Цифра в символе указывает на количество лет экологически чистого использования (EFUP) прибора. Обратите внимание на этот символ, если период использования вещества ограниченного применения превышает максимально допустимый предел.
	Указывает на отдельный сбор электрического и электронного оборудования, подлежащего утилизации
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Биологические риски
	Осторожно! Поверхность нагревается! Знак, указывающий поверхность прибора, которая становится горячей во время работы. Избегайте прямого контакта для предотвращения ожогов.
	Осторожно! Ультрафиолетовое излучение!
	Осторожно! Низкая температура!
	Идентификатор сетевого интерфейса

2. Макет маркировки транспортной упаковки (Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

DAKEWE	
Product	
Cryostat Microtome	
Model	
CT520	
Part No.	 2022-07-01 Date of Manufacture
	
P/N: 130.019.001-00	
Serial No.	
	
S/N: 07050001	
Dakewe Sales Order	
	
Customer P.O.	
	
L*W*H(MM)	
1038×854×1517	
G.W. (KG)	
280	
N.W. (KG)	
185	
 UDI 101306973182571099611323070112187050001	
 55°C	
 60% non-condensing	
 DAKEWE (SHENZHEN) MEDICAL EQUIPMENT CO., LTD Floor 5, Building B, No 1 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China	
Made in China	

Рисунок 8. Транспортная маркировка Микротома криостатического CT520.
Размер этикетки 210 x 320 мм ±5мм.

Таблица 3. Перевод маркировки транспортной упаковки на русский язык

Английский язык	Русский язык
Product	Наименование изделия
Automatic Tissue Processor	Микротом криостатический CT520 (Cryostat microtome CT520) с принадлежностями
Model	
CT520	
Part No.	Номер по каталогу (внутренний производственный номер)
Serial No.	Серийный номер
Dakewe Sales Order	Номер заказа Дакеве
Customer P.O.	Заказчик РО
LxWxH(mm)	ДхШхВ(мм)
G.W. (KG)	Вес брутто (кг)

Английский язык	Русский язык
N.W. (KG) 38	Вес нетто (кг)
	QR код
UDI	Уникальный идентификатор изделия
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.	Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China	5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай
Made in China	Сделано в Китае
Date of manufacture	Дата производства





Рисунок 9. Изображение маркировки, расположенной на транспортном контейнере прибора

Таблица 4. Перевод маркировки, расположенной на транспортном контейнере прибора

Английский язык	Русский язык
Over Pack	Негабаритный груз
Product	Наименование изделия
Automatic Tissue Processor	Микротом криостатический CT520 (Cryostat microtome CT520) с принадлежностями
Model	
CT520	
Part No.	Номер по каталогу (внутренний производственный номер)
Serial No.	Серийный номер
Dakewe Sales Order	Номер заказа Дакеве
Customer P.O.	Заказчик РО
LxWxH(mm)	ДхШхВ(мм)
G.W. (KG)	Вес брутто (кг)
N.W. (KG) 38	Вес нетто (кг)
	QR код
UDI	Уникальный идентификатор изделия
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.	Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China	5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай
Made in China	Сделано в Китае
Date of manufacture	Дата производства
PO#29/33/34	Заказ № 29/33/34
LiFan	Компания «ЛиФан»
Package:21/21	Место 21 из 21

Таблица 5. Описание символов, применяемых на транспортной маркировке

Символ	Описание
	Этикетка для контроля наклона прибора во время транспортировки и хранения. Если угол наклона превысит 60°, синий кварцевый песок попадет в индикаторное окошко в форме стрелки и навсегда останется в нем. Таким образом проверка сразу покажет, что имело место ненадлежащее обращение с прибором при транспортировке или хранении.
	Система Shockwatch с индикатором ударов, который становится красным, если упаковка подвергалась ударам или толчкам, сила которых превышает спецификацию. В случае превышения установленного значения ускорения (величина g) цвет трубки индикатора меняется.
	Уникальный идентификатор изделия

Символ	Описание
	Изготовитель
	Температурный диапазон Требования к температуре при транспортировке: минимум 5 °С, максимум 55 °С
	Диапазон влажности Допустимый диапазон относительной влажности при хранении и транспортировке: максимум 60 %, без конденсации
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Обозначение правильного вертикального положения упаковочного контейнера
	Не допускать воздействия влаги
	Штабелировать запрещается.
	Не вращать и не переворачивать транспортную упаковку.
	В приборе присутствуют литий-металлические батареи

Макет маркировки транспортной упаковки (Cryostat microtome CT520) с принадлежностями на русском языке

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX
Серийный номер XXXXXXXXXXXX

 **Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.**
(Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.)
5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, провинция Гуаньдун, Китай (Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China).
Страна происхождения: CHINA (Китай)

Масса нетто 185 кг
Масса брутто 280 кг

Дата изготовления XX.XX.XXXX
Дата упаковывания XX.XX.XXXX

Условия транспортирования:
допустимая температура от +5 до +55 °C;
допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации.

Условия хранения:
допустимая температура от +5 до +55 °C;
допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации.

Грузополучатель _____

Пункт назначения _____

Уполномоченный представитель производителя в России:
Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХ-РМ», (ООО «МЕДТЕХ-РМ»)
Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81
e-mail: info@medteh-mo.ru



Таблица 6. Описание символов, применяемых на транспортной маркировке

Символ	Описание
	Изготовитель
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Обозначение правильного вертикального положения упаковочного контейнера
	Не допускать воздействия влаги
	Штабелировать запрещается.
	Не вращать и не переворачивать транспортную упаковку.
 60% без конденсации	Диапазон влажности Допустимый диапазон относительной влажности при хранении и транспортировке: максимум 60 %, без конденсации

5. Маркировка компонентов состава Микротома криостатического CT520 (Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Состав:

2. Держатель лезвия – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Состав:

3. Диски для образцов, 30 мм – 1 набор

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Состав:

4. Диски для образцов, 40 мм – 1 набор

Эксплуатация от +5°C до +35 °C
Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C
Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Состав:

5. Диск для образца, 55 мм – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C
Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C
Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

ПУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Состав:

6. Подставка для дисков – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C
Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C
Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакеш (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кан Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

ПУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Состав:

7. Маховик – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C
Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C
Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакеш (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кан Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Состав:

8. Молоточек для отвода тепла – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Состав:

9. Кабель питания – 1 шт.

(производитель: KING-CORE ELECTRONICS (SHEN ZHEN)
CO., LTD., модель: KC-015+KC-003, H05VV-F 3G*1.0MM2, 2M)

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Принадлежности:

1. Заглушка на винт для маховика – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэве (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Принадлежности:

2. Кисть № 30 – 1 шт.

(

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэве (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXX00X от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Принадлежности:

3. Кисть № 4 – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Давидов, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лулуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXX00X от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Принадлежности:

4. Кисть № 5 – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Давидов, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лулуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Принадлежности:

5. Комплект торцевых ключей – 1 компл.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Принадлежности:

6. Гаечный ключ – 1 шт.

(производитель: KING-CORE ELECTRONICS (SHEN ZHEN)
CO., LTD., модель: KC-015+KC-003, H05VV-F 3G*1.0MM2, 2M)

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Принадлежности:

7. Лоток для кистей – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакеш (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Принадлежности:

8. Лоток для отходов – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакеш (Шэньчжэнь) медицинский экипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

26 (двадцать шесть) листов

генеральный директор

Кокотов О.Б.

«31» июля 2024 г.



УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Кокотов О.Б.

«25» декабря 2023 г.

Фотографические изображения медицинского изделия для диагностики in vitro

Микротом криостатический СТ520 (Cryostat microtome СТ520) с
принадлежностями



Рисунок 1. Транспортная упаковка



Рисунок 2. Маркировка транспортной упаковки




Рисунок 3. Основной блок

Cryostat Microtome

DAKEWE

Model CT520

SN 07050086

 2023-07-10

220-240V~ 50Hz
1400VA



UDI (01)06971182571098(11)230710(21)07050086

EC REP

SUNGO Europe B.V.
Fascinatio Boulevard 522,
Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel,
The Netherlands



GrowthImports BV
NL-IM-00013877
Plesmanweg 9
7602 PD Almelo
The Netherlands
www.growthimports.eu



DAKEWE (SHENZHEN) MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.
Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community,
Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China

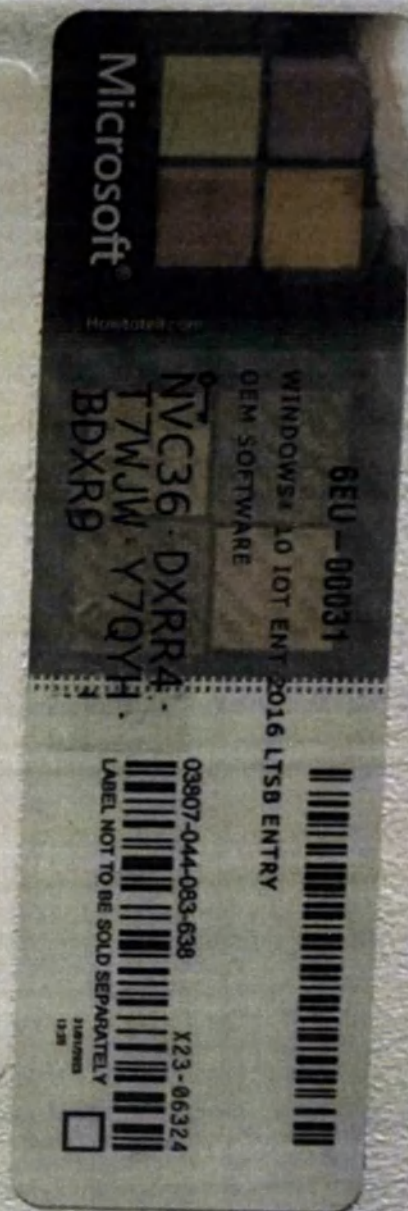


Рисунок 4. Маркировка Микротомы криостатического CT520 (Cryostat microtome CT520) с принадлежностями


证明书

CERTIFICATE



中国国际贸易促进委员会暨中国国际商会
China Council for the Promotion of International Trade is China Chamber of International Commerce

Рисунок 5. Руководство пользователя

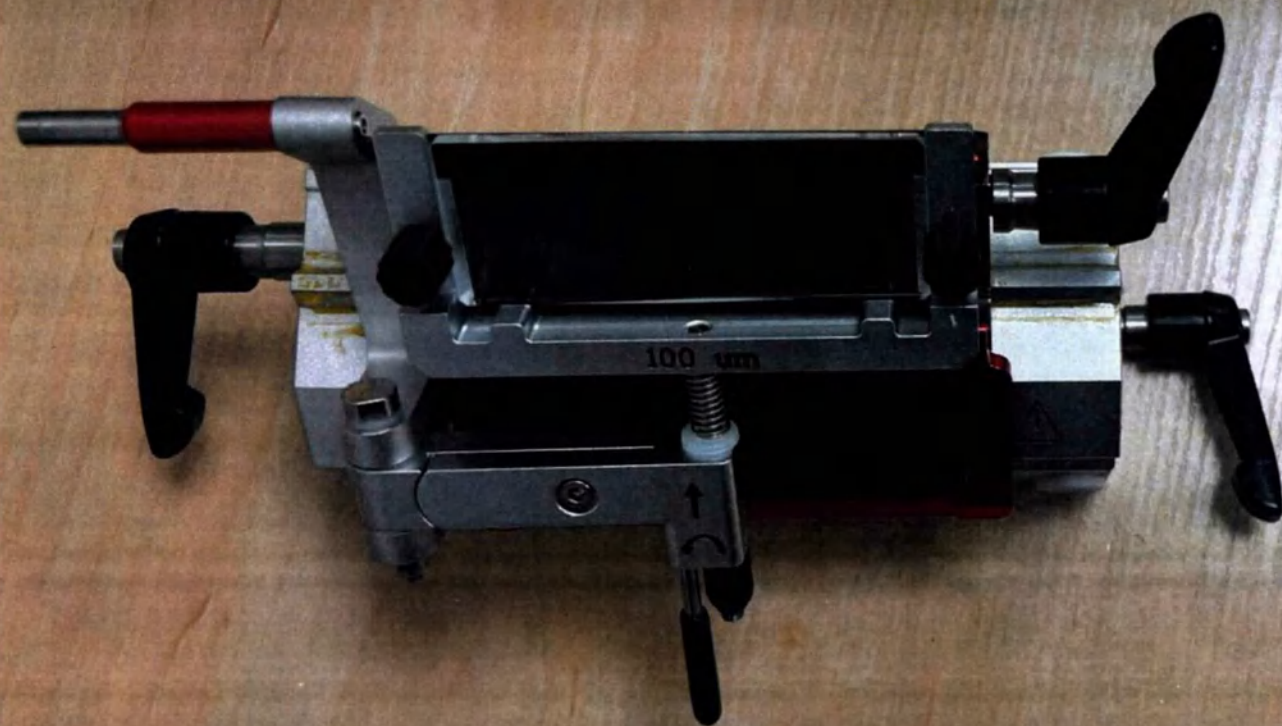

DAKESHE

Р/У № XXXXXXXX от XXX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Состав:

2. Держатель лезвия – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127015, г. Москва, вн.тер.г. муницип. округ Марьино Рошд.

ул. Давыдов, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакеш (Шэньчжэнь) медицинск. оборудован. Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус 6, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Линьшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 6. Держатель лезвия



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Состав:

3. Диски для образцов, 30 мм – 1 набор

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 7. Диски для образцов, 30 мм



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Состав:

4. Диски для образцов, 40 мм – 1 набор

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5°C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 8. Диски для образцов, 40 мм



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Состав:

5. Диск для образца, 55 мм – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35°C

Хранение/транспортировка от +5°C до +55°C

Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru




Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 9. Диск для образцов, 55 мм

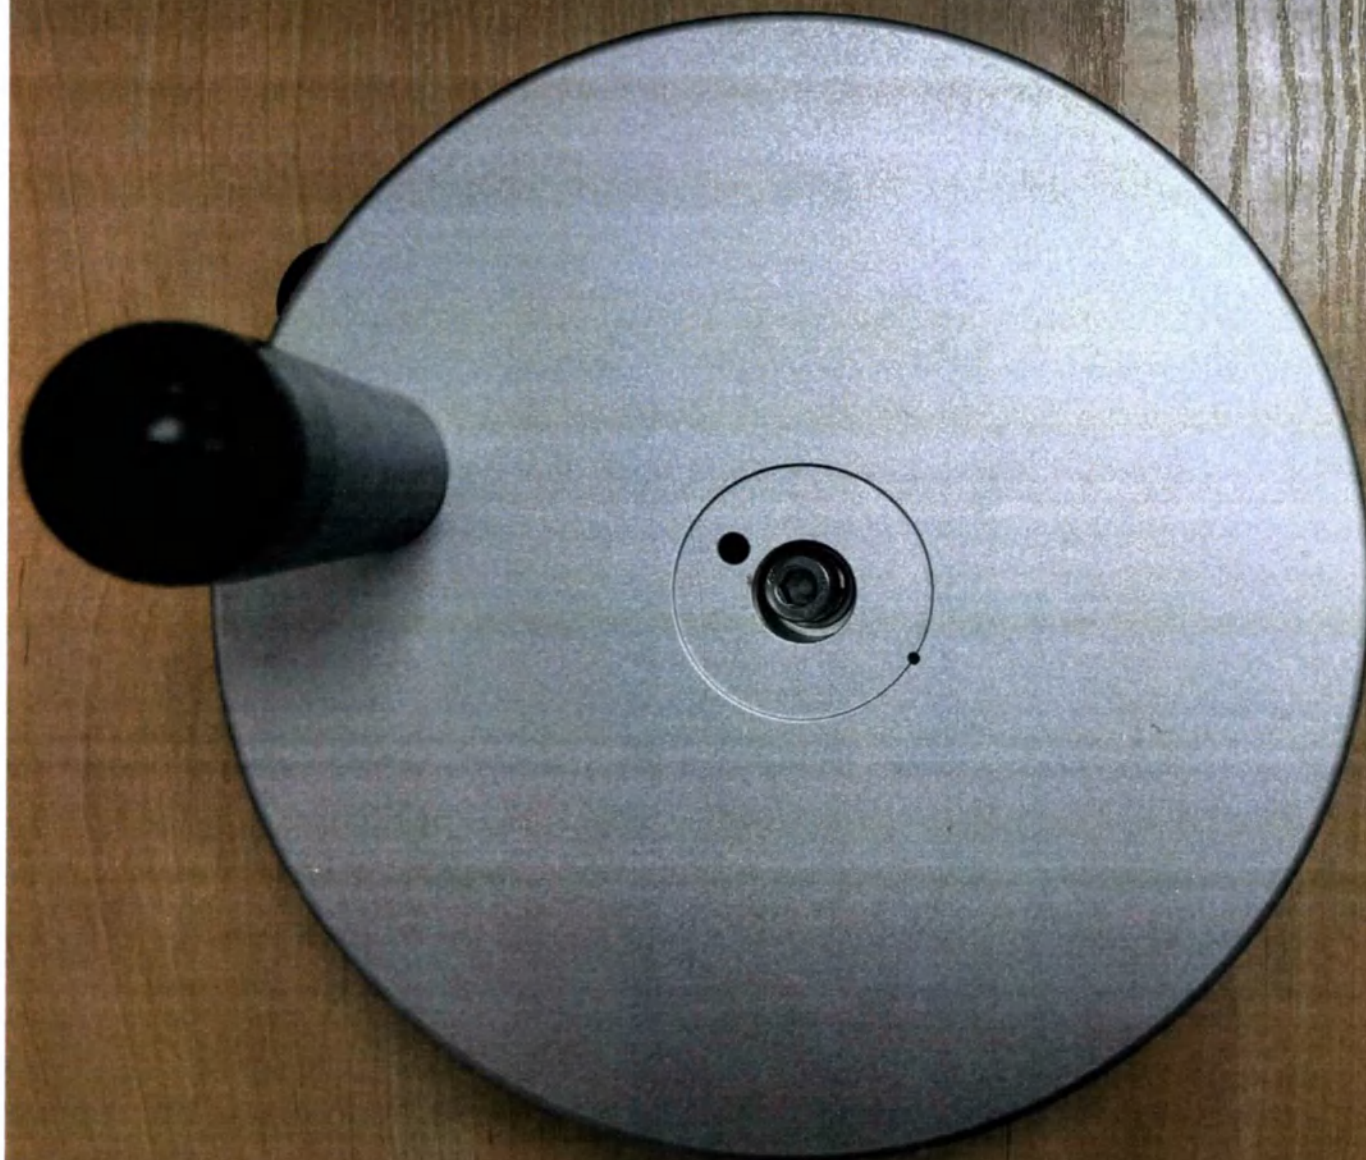

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Состав:

7. Маховик – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Давидов, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дажэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кан Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 10. Маховик



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Состав:

8. Молоточек для отвода тепла – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роца,

ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 11. Молоточек для отвода тепла



DAKEWE

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Состав:

9. Кабель питания – 1 шт.

(производитель: KING-CORE ELECTRONICS (SHEN ZHEN)
CO., LTD., модель: KC-015+KC-003, H05VV-F 3G*1.0MM2, 2M)

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 12. Кабель питания



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Принадлежности:

1. Заглушка на винт для маховика – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 13. Заглушка на винт для маховика



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Принадлежности:

2. Кисть № 30 – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,

ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 14. Кисть № 30

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome СТ520) с принадлежностями

Принадлежности:

3. Кисть № 4 – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 15. Кисть № 4



DAKEWE

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Принадлежности:

4. Кисть № 5 – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,

ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 16. Кисть № 5



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Принадлежности:

5. Комплект торцевых ключей – 1 компл.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша,

ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 17. Комплект торцевых ключей



ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Принадлежности:

6. Гаечный ключ – 1 шт.

(производитель: KING-CORE ELECTRONICS (SHEN ZHEN)
CO., LTD., модель: KC-015+KC-003, H05VV-F 3G*1.0MM2, 2M)

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China

тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 18. Гаечный ключ

DAKEWE

DAKEWE

Р/У № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический СТ520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Принадлежности:

7. Лоток для кистей – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5 °C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %, без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медицинал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 19. Лоток для кистей



DAKEWE

РУ № XXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями

Принадлежности:

8. Лоток для отходов – 1 шт.

Эксплуатация от +5°C до +35 °C

Хранение/транспортировка от +5°C до +55 °C

Допустимая относительная влажность до 60 %,
без конденсации

Уполномоченный представитель производителя в России:
ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роша,
ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1
тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакева (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. /
Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша,
Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай / Floor 5, Building
B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District,
Shenzhen, China
тел.: +86 755 2640 5921

Рисунок 20. Лоток для отходов

Макет маркировки Микротом криостатического CT520 (Cryostat microtome CT520) с принадлежностями на русском языке

**Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями**

РУ № XXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Срок службы – 7 лет



XXXXXXXXXXXX



XX.XX.XXXX



(01)06971182570978(11)220228(21)15010001

ДАКЕШЕ

Напряжение 220-240 В

Частота ~50 Гц

Мощность 1200 ВА

Эксплуатация от +5 °С до +35 °С

Хранение от +5 °С до +55 °С

Транспортировка от +5 °С до +55 °С

Уполномоченный представитель производителя в России:

ООО «МЕДТЕХ-РМ»

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12, к. 1, помещ. 1/1

тел: 7 (495) 180 40 81 / e-mail: info@medteh-mo.ru



Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.

(Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.)

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, Китай (Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China)


тел.: +86 755 2640 5921

Место производства:

Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд. / Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.

Адрес: 5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район Пиньшань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай (Floor 5, Building B, No.2 Luhui Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen City, Guangdong Province, China)

Таблица 1. Описание символов, применяемых на маркировке

Символ	Описание
	Серийный номер
	Уникальный идентификатор изделия
	Уполномоченный представитель в Европейском сообществе
	Медицинское изделие для диагностики <i>in vitro</i>
	Дата изготовления
	Изготовитель
	Импортёр
	Осторожно Указание на важную предупреждающую информацию, с которой пользователи должны ознакомиться в Руководстве пользователя.
	Знак защиты окружающей среды Директивы RoHS. Цифра в символе указывает на количество лет экологически чистого использования (EFUP) прибора. Обратите внимание на этот символ, если период использования вещества ограниченного применения превышает максимально допустимый предел.
	Указывает на отдельный сбор электрического и электронного оборудования, подлежащего утилизации
	Обратитесь к инструкции по применению или к инструкции по применению в электронном виде
	Биологические риски
	Осторожно! Поверхность нагревается! Знак, указывающий поверхность прибора, которая становится горячей во время работы. Избегайте прямого контакта для предотвращения ожогов.
	Осторожно! Ультрафиолетовое излучение!
	Осторожно! Низкая температура!
	Идентификатор сетевого интерфейса

Макет маркировки транспортной упаковки (Cryostat microtome CT520) с принадлежностями на русском языке

**Микротом криостатический CT520
(Cryostat microtome CT520) с принадлежностями**

ДАКЕШЕ

РУ № XXXXXXXXXXXX от XX.XX.XXXX

Серийный номер XXXXXXXXXXXX



**Дакэвэ (Шэньчжэнь) медикал эквипмент Ко., Лтд.
(Dakewe (Shenzhen) medical equipment Co., Ltd.)**

5-й этаж, корпус Б, №2 Лухуэй Роуд, микрорайон Цзиньша, Кэн Цзы Стрит, район
Пиньшань, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай (Floor 5, Building B, No.2 Luhui
Road, Jinsha Community, Kengzi Street, Pingshan District, Shenzhen, China).

Страна происхождения: CHINA (Китай)

**Масса нетто 185 кг
Масса брутто 280 кг**

**Дата изготовления XX.XX.XXXX
Дата упаковывания XX.XX.XXXX**

Условия транспортирования:
допустимая температура от +5 до +55 °С;
допустимая относительная влажность до
60 %, без конденсации.

Условия хранения:
допустимая температура от +5 до +55 °С;
допустимая относительная влажность до
60 %, без конденсации.

Грузополучатель

Пункт назначения

Уполномоченный представитель производителя в России:

Общество с ограниченной ответственностью «МЕДТЕХ-РМ», (ООО «МЕДТЕХ-РМ»)

Адрес: 127018, г. Москва, вн.тер.г. мун. округ Марьино Роща, ул. Двинцев, д. 12, к. 1,
помещ. 1/1


тел: 7 (495) 180 40 81

e-mail: info@medteh-mo.ru



60% без конденсации

Таблица 2. Описание символов, применяемых на транспортной маркировке

Символ	Описание
	Изготовитель
	Хрупкое, обращаться осторожно
	Обозначение правильного вертикального положения упаковочного контейнера
	Не допускать воздействия влаги
	Штабелировать запрещается.
	Не вращать и не переворачивать транспортную упаковку.
	Диапазон влажности Допустимый диапазон относительной влажности при хранении и транспортировке: максимум 60 %, без конденсации

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

25 (двадцать пять) листов

генеральный директор

Кокотов О.Б.

июль 2024 г.

