

Фотографические изображения



Компоненты абатмента Toplan,

производства «Топлан Ко., Лтд.» (Toplan Co., Ltd.)

9





Слепочный модуль для оттиска на уровне абатмента (T01 Abutment Level Impression Coping),
T01ALIC45, White / Ø4.5 (без упаковки и в упаковке)

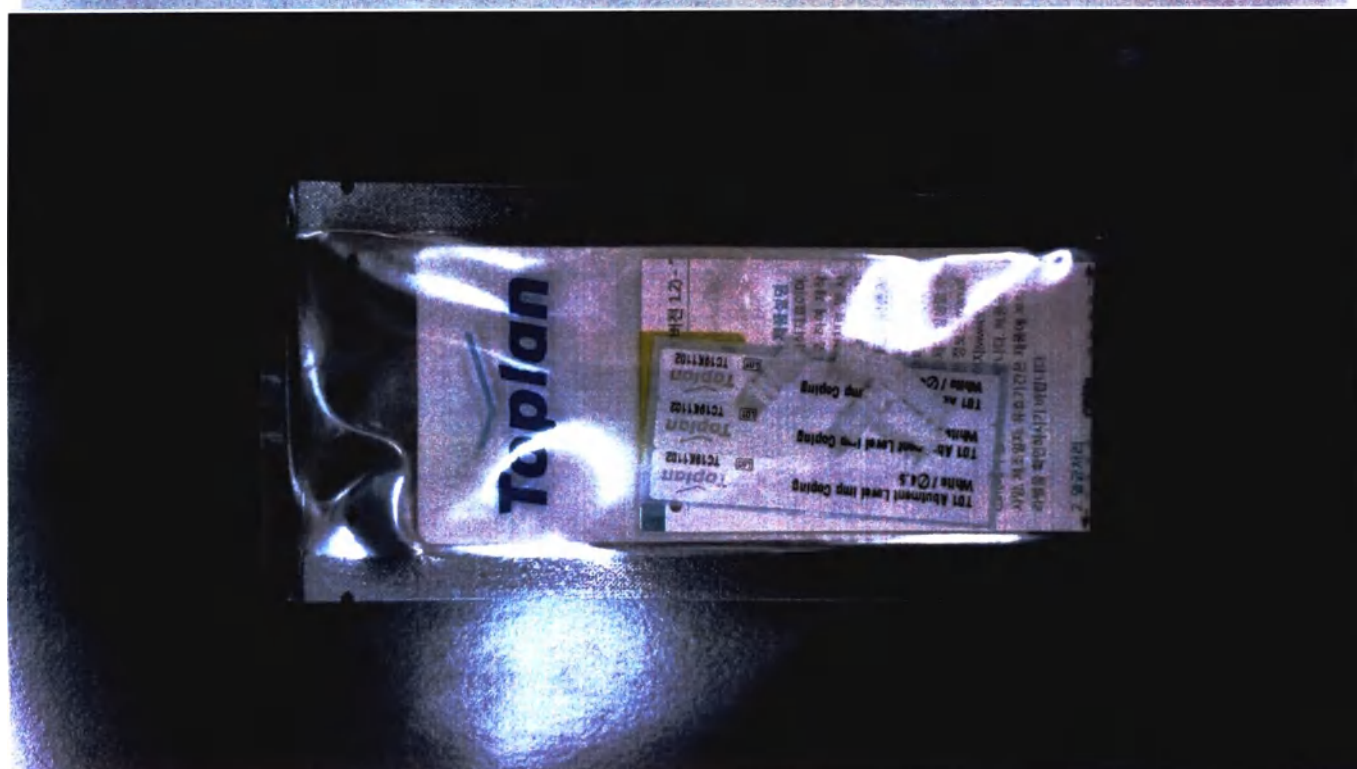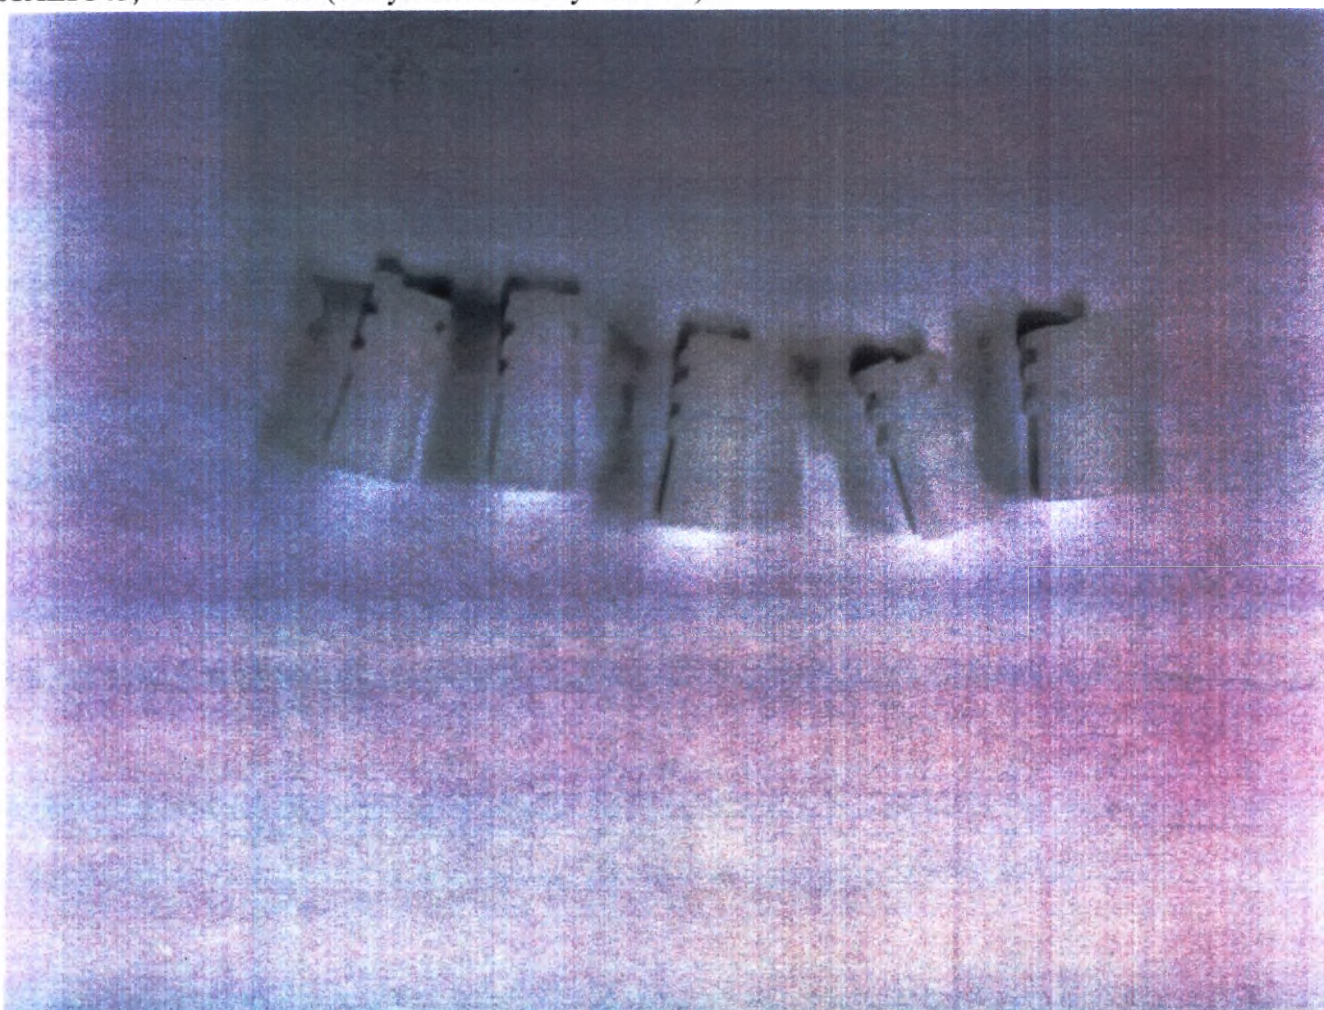



Примечание: Слепочные модули для оттиска на уровне абатмента (T01ALIC40, T01ALIC55, T01ALIC65) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T01 (T01 Pick up Impression Coping Guide Pin), T01PICGS, Short / 11.0мм (L) (без упаковки и в первичной упаковке)

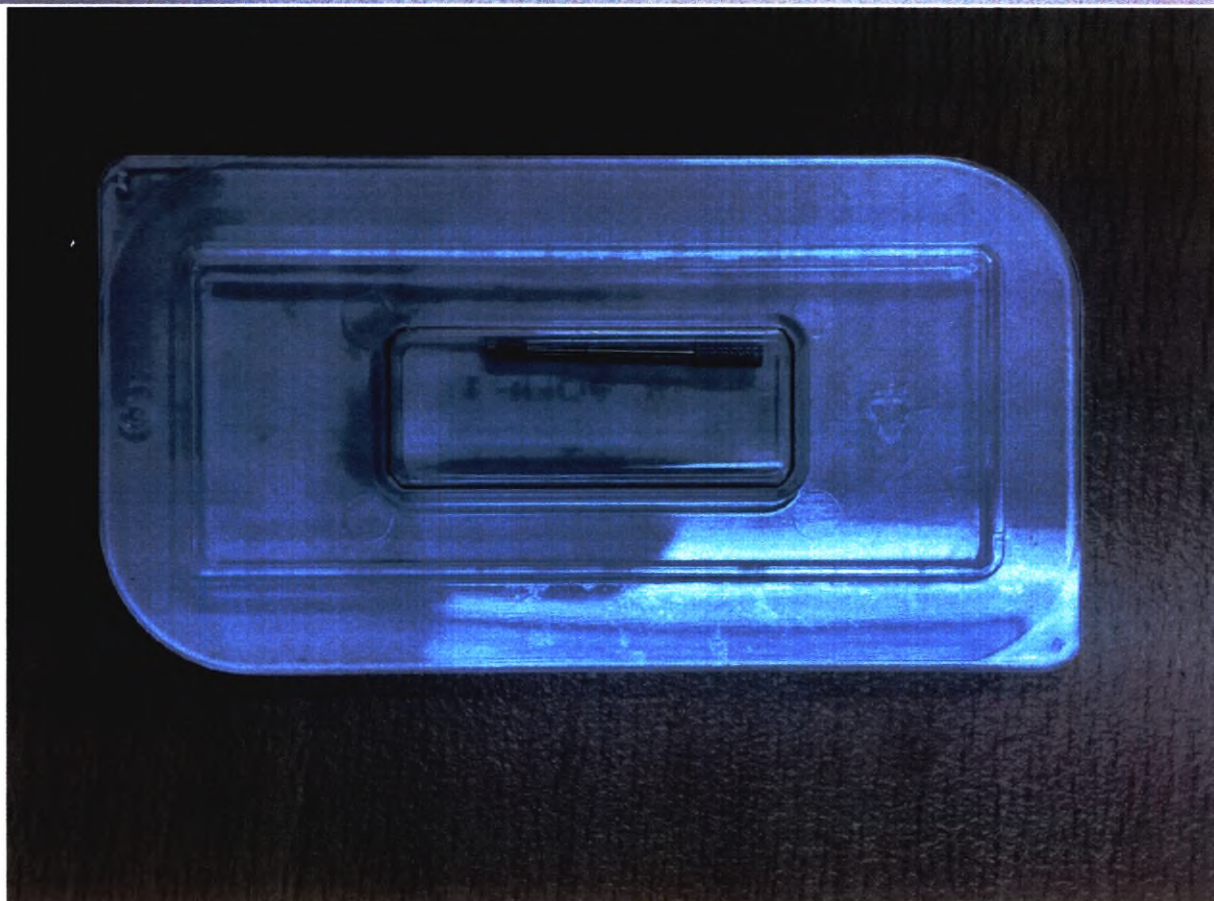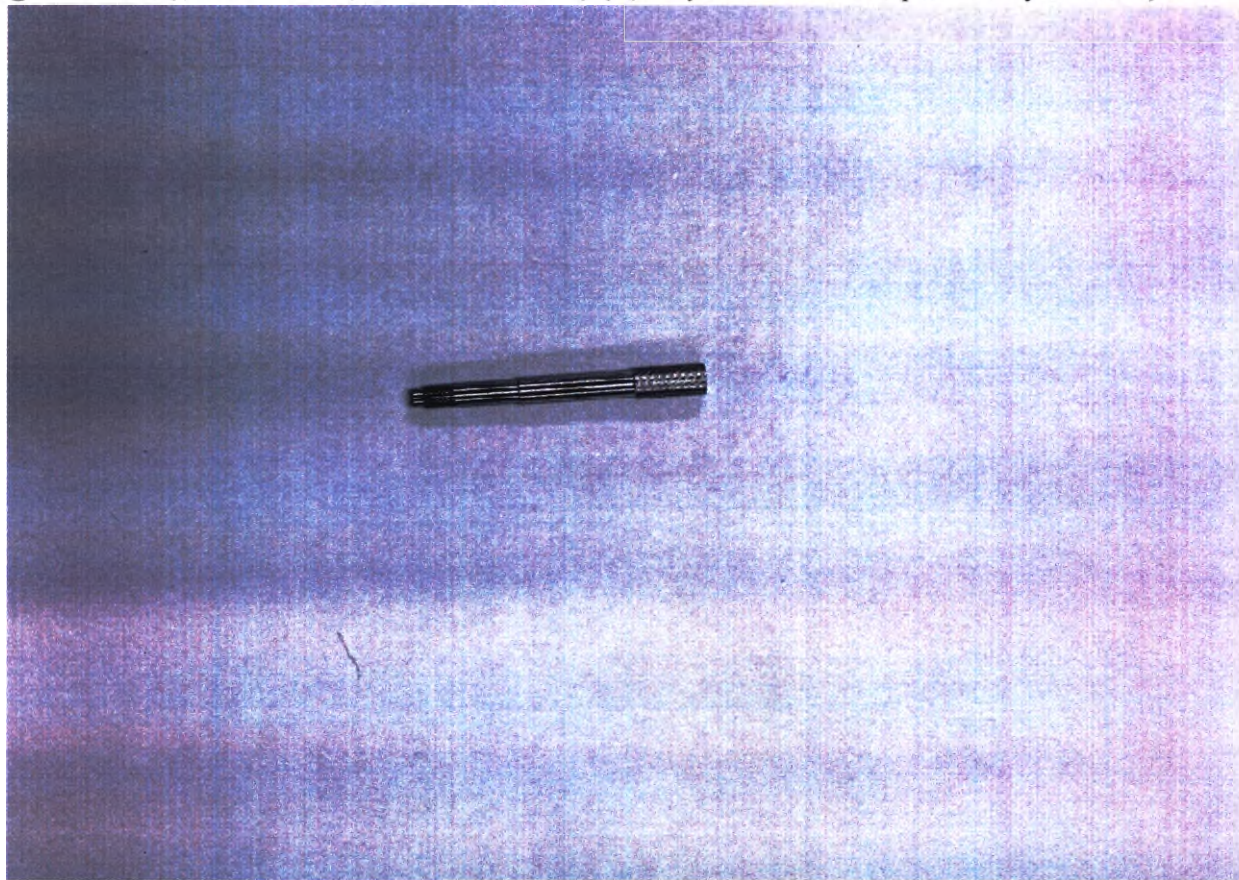



Примечание: Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T01 (T01PICMGS) имеет похожий внешний вид, отличие в размерах.

Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T01 (T01 Pick up Impression Coping Guide Pin), T01PICGL, Long / 15.0мм (L) (без упаковки и в первичной упаковке)

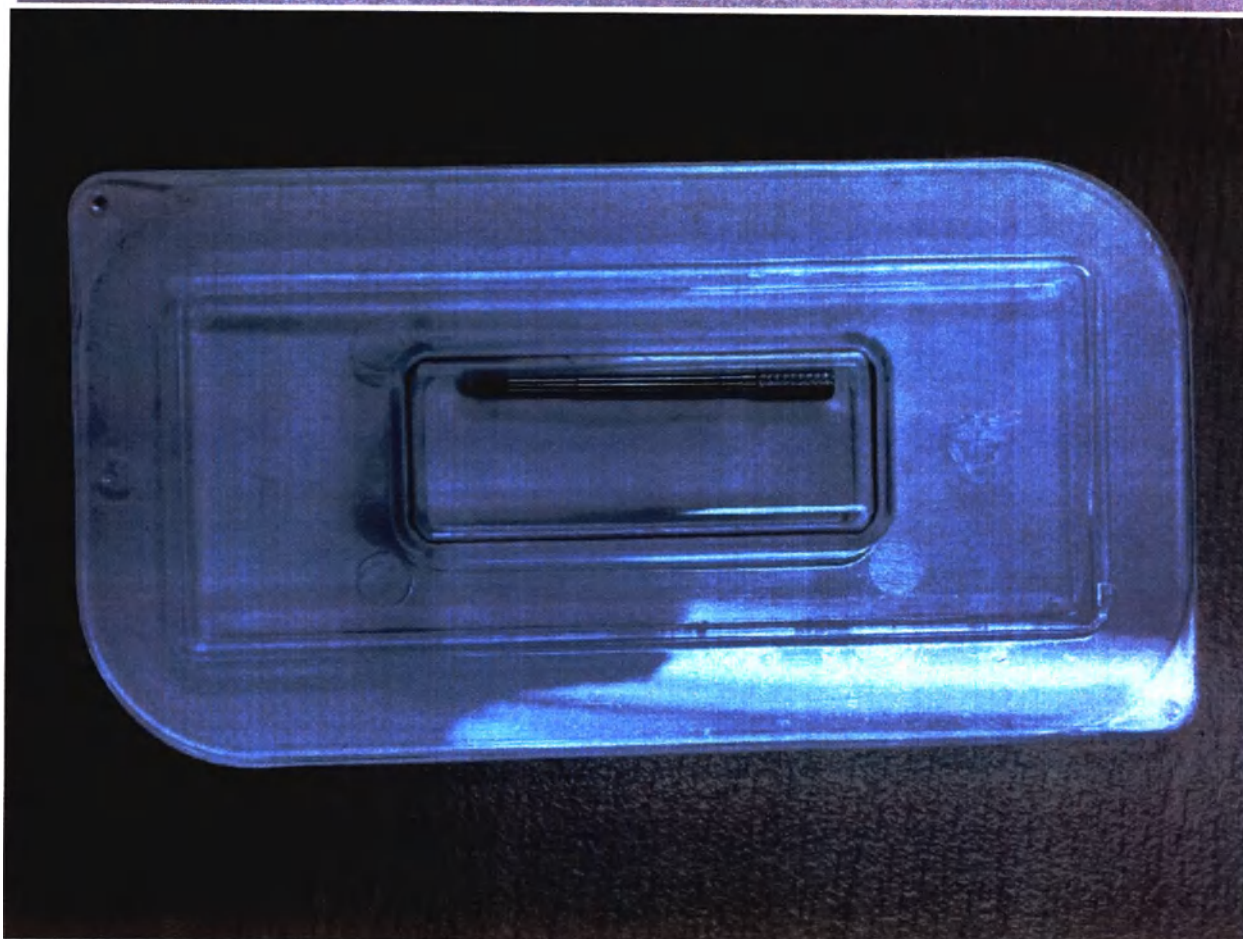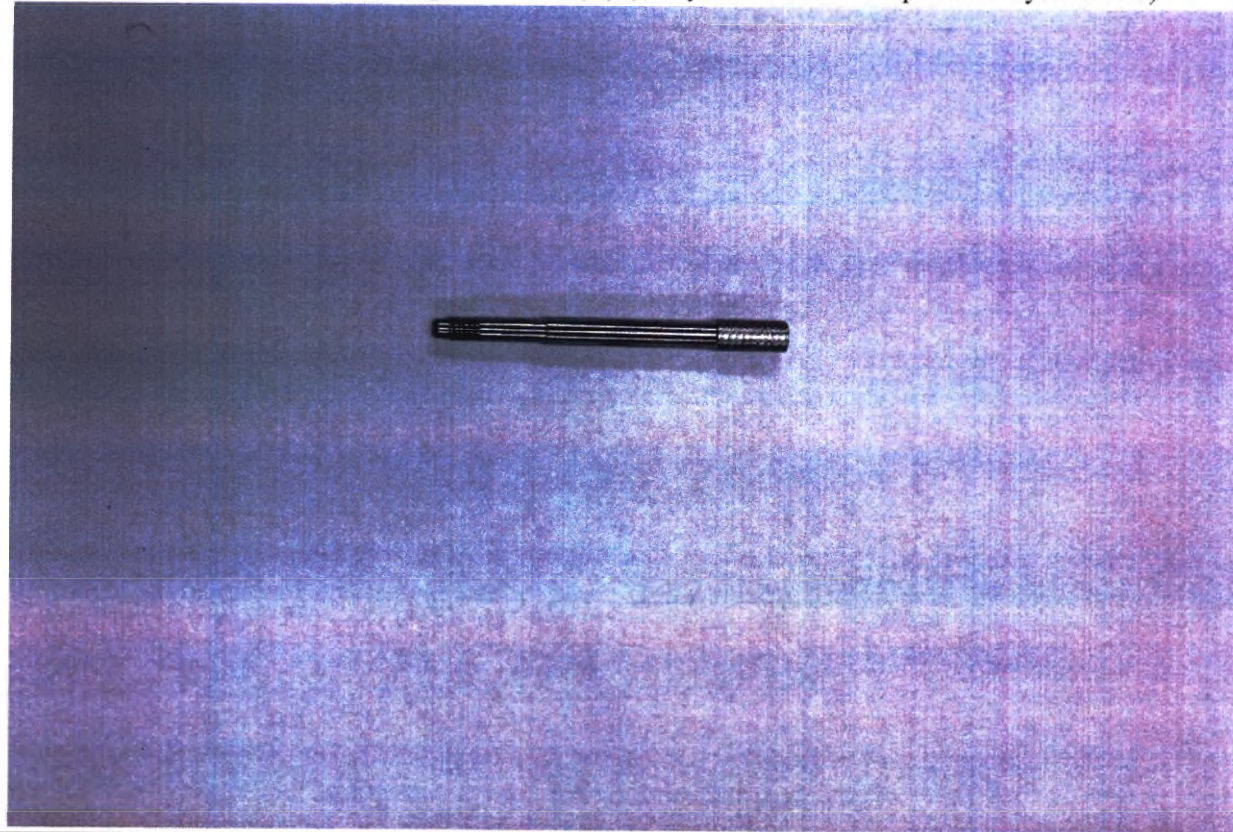


Примечание: Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T01 (T01PICMGL) имеет похожий внешний вид, отличие в размерах.

Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T02 (T02 Pick up Impression Coping Guide Pin), T02PICGS12, Short / 1.2Hex / 11.0мм (L) (без упаковки и в первичной упаковке)

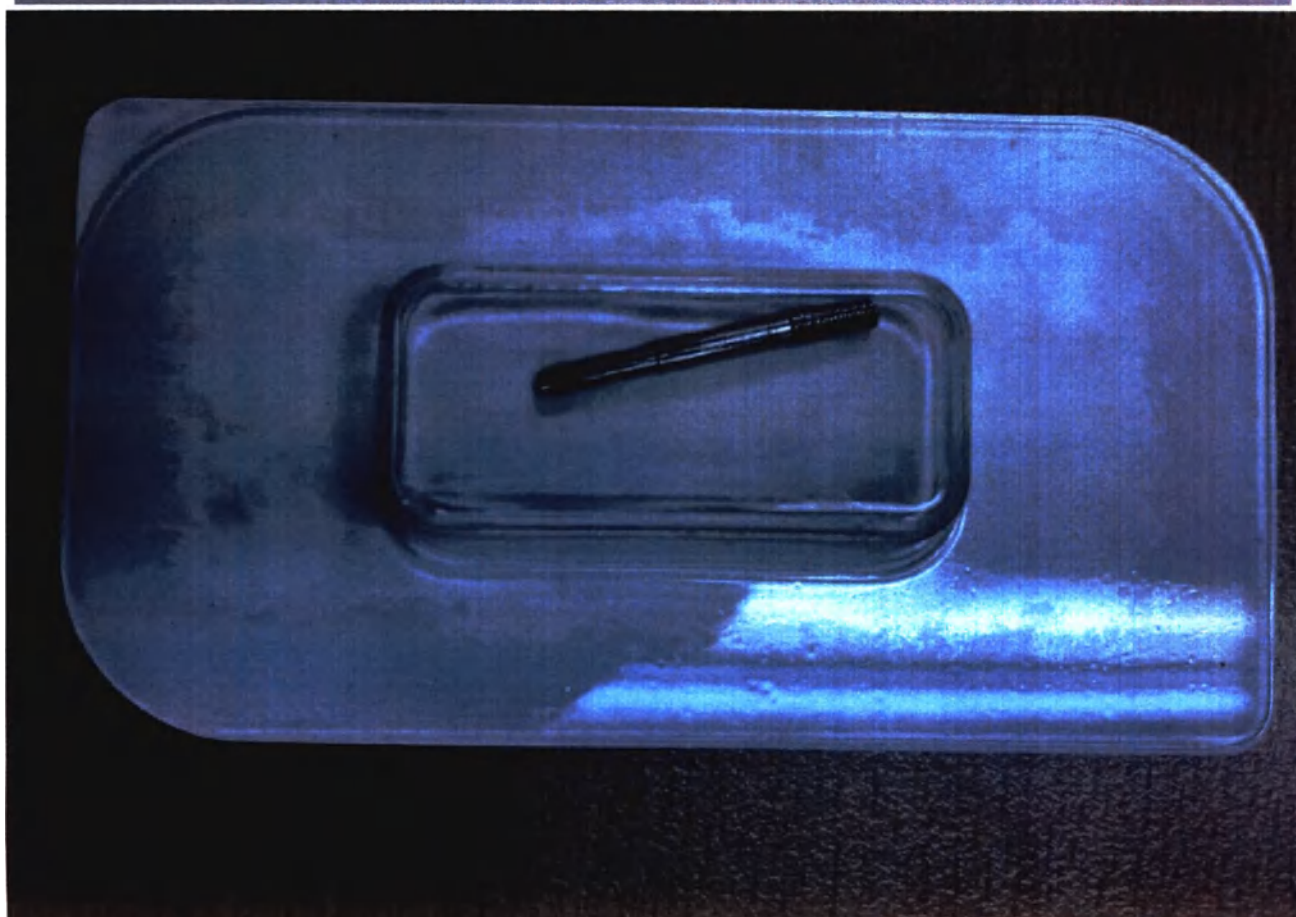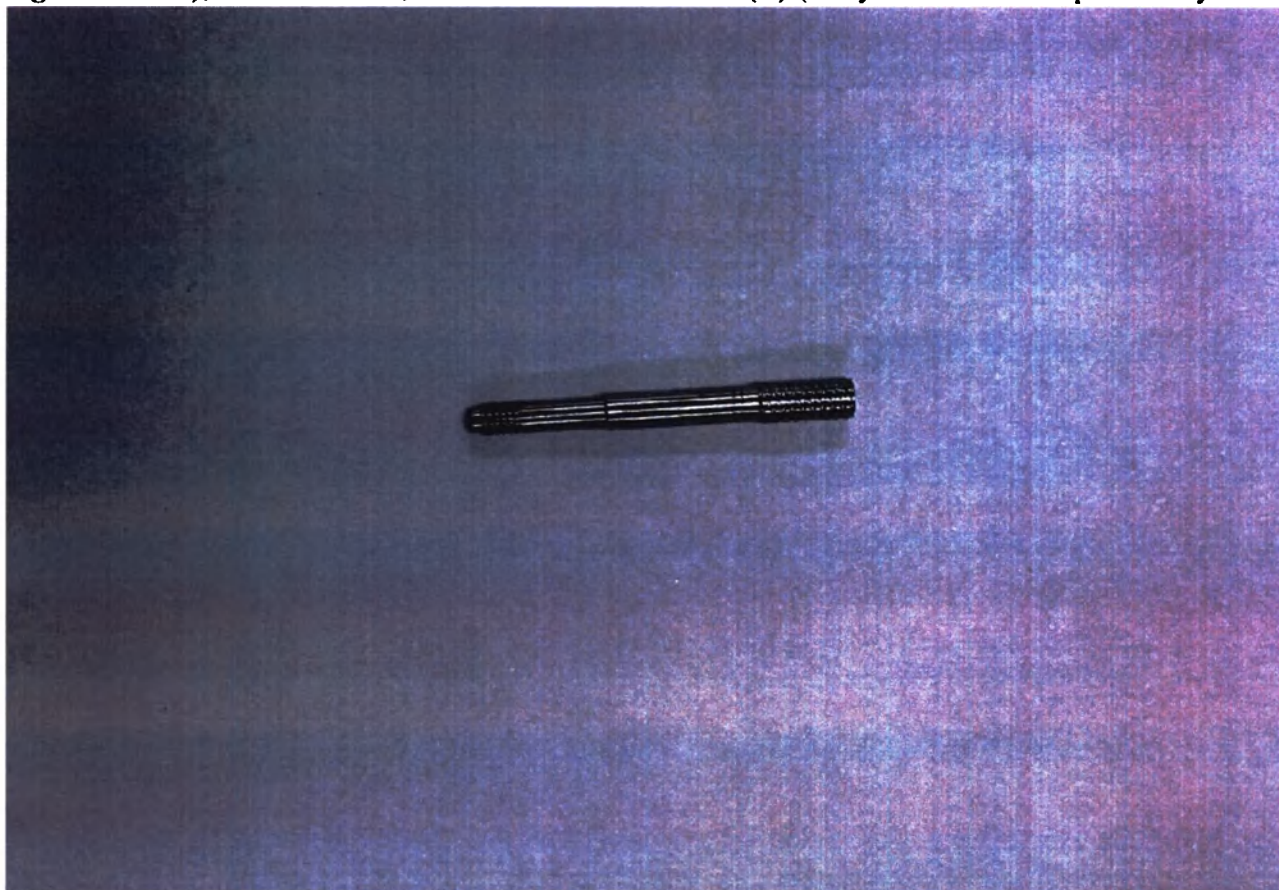


Примечание: Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T02 (T02 Pick up Impression Coping Guide Pin) (T02PICMGS12) имеет похожий внешний вид, отличие в размерах.

Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T02 (T02 Pick up Impression Coping Guide Pin), T02PICGL12, Long / 1.2Hex / 15.0мм (L) (без упаковки и в первичной упаковке)

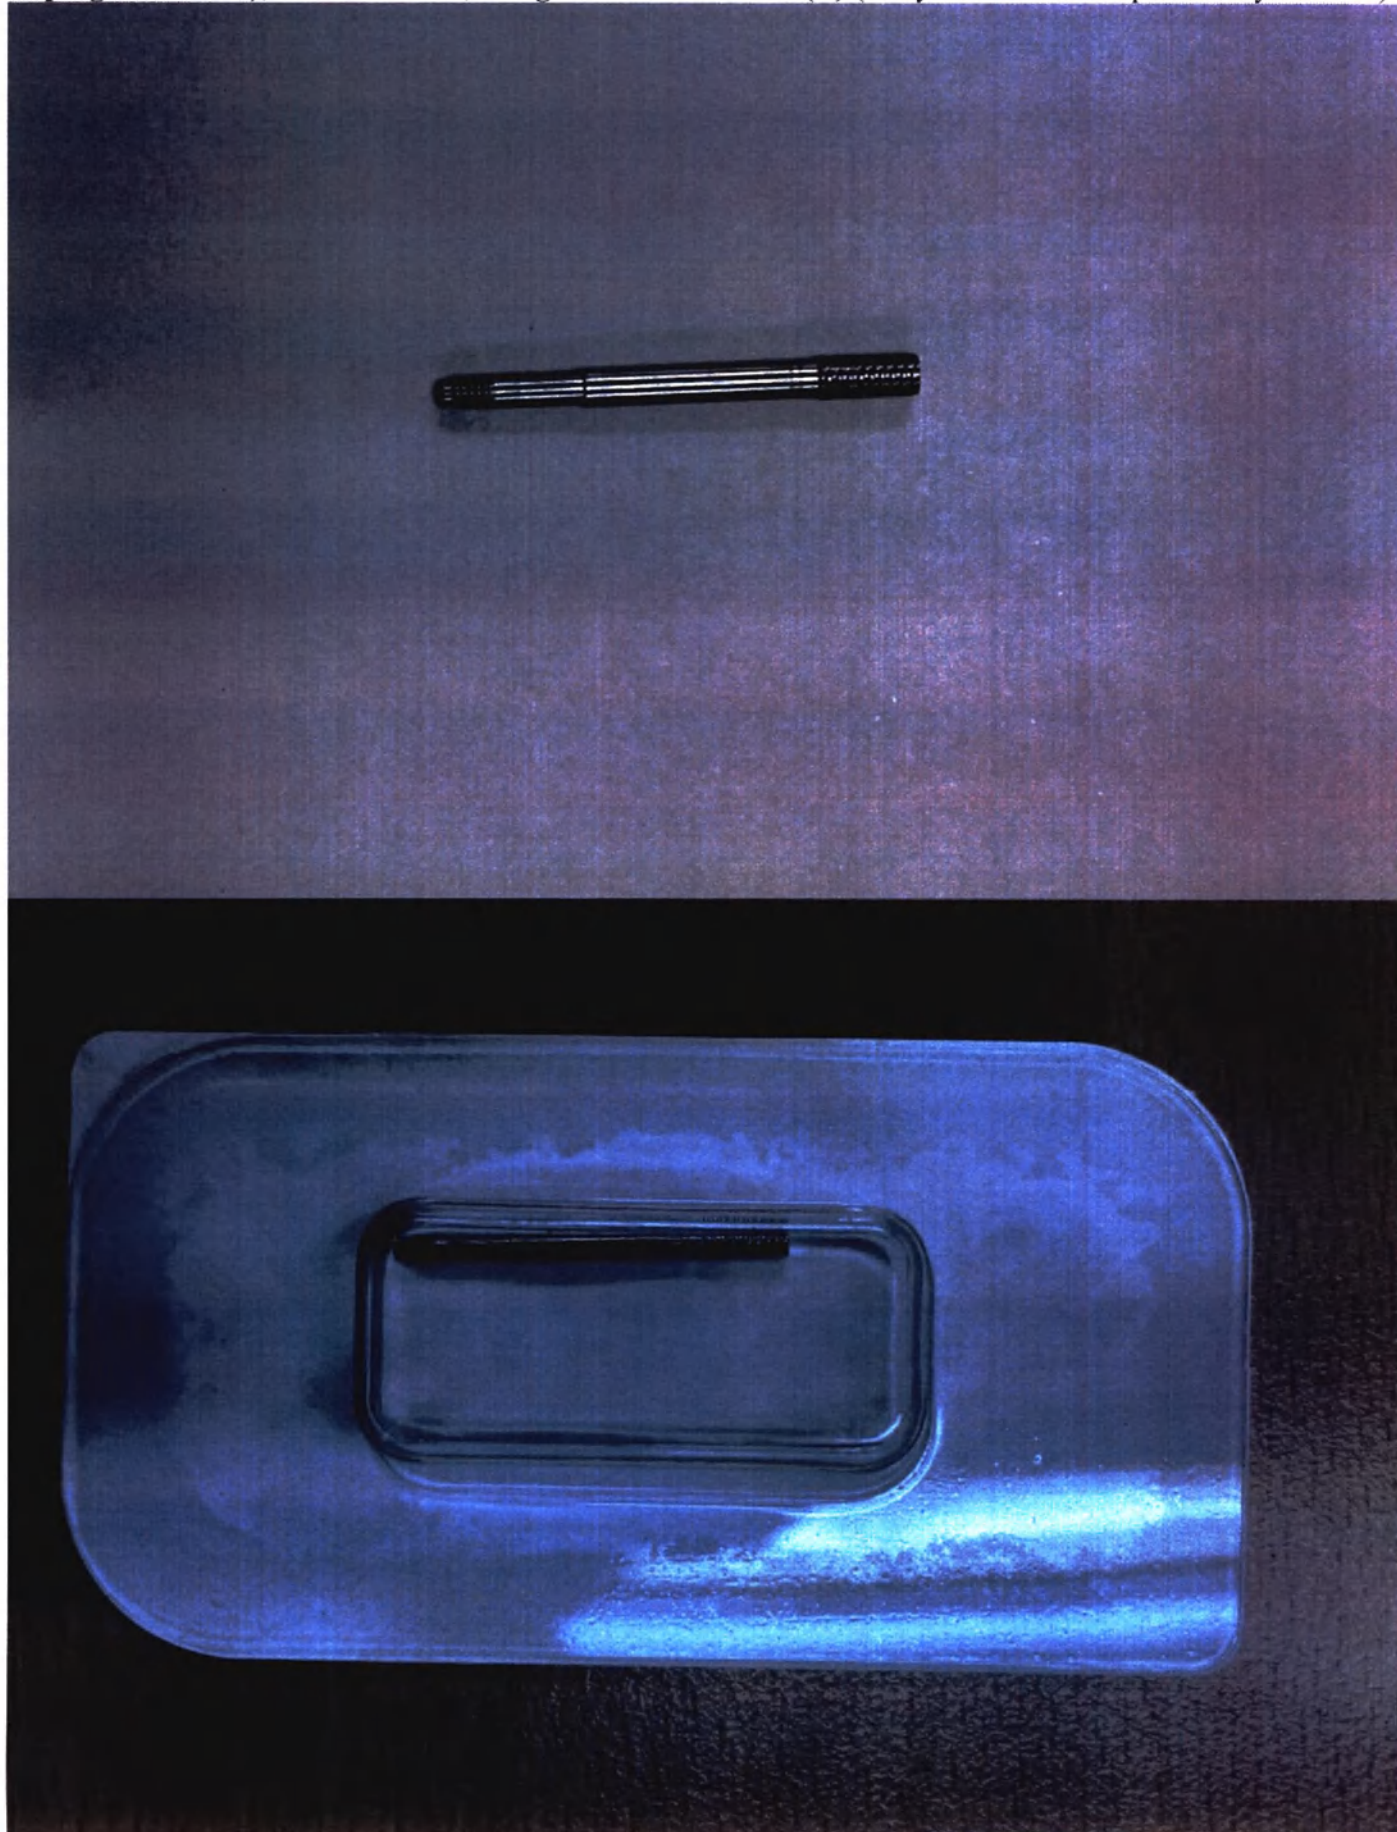


Примечание: Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T02 (T02 Pick up Impression Coping Guide Pin) (T02PICMGL12) имеет похожий внешний вид, отличие в размерах.

Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T01 (T01 Transfer Impression Coping Guide Pin), T01TICGS, Short / 11.0мм (L) (без упаковки и в первичной упаковке)

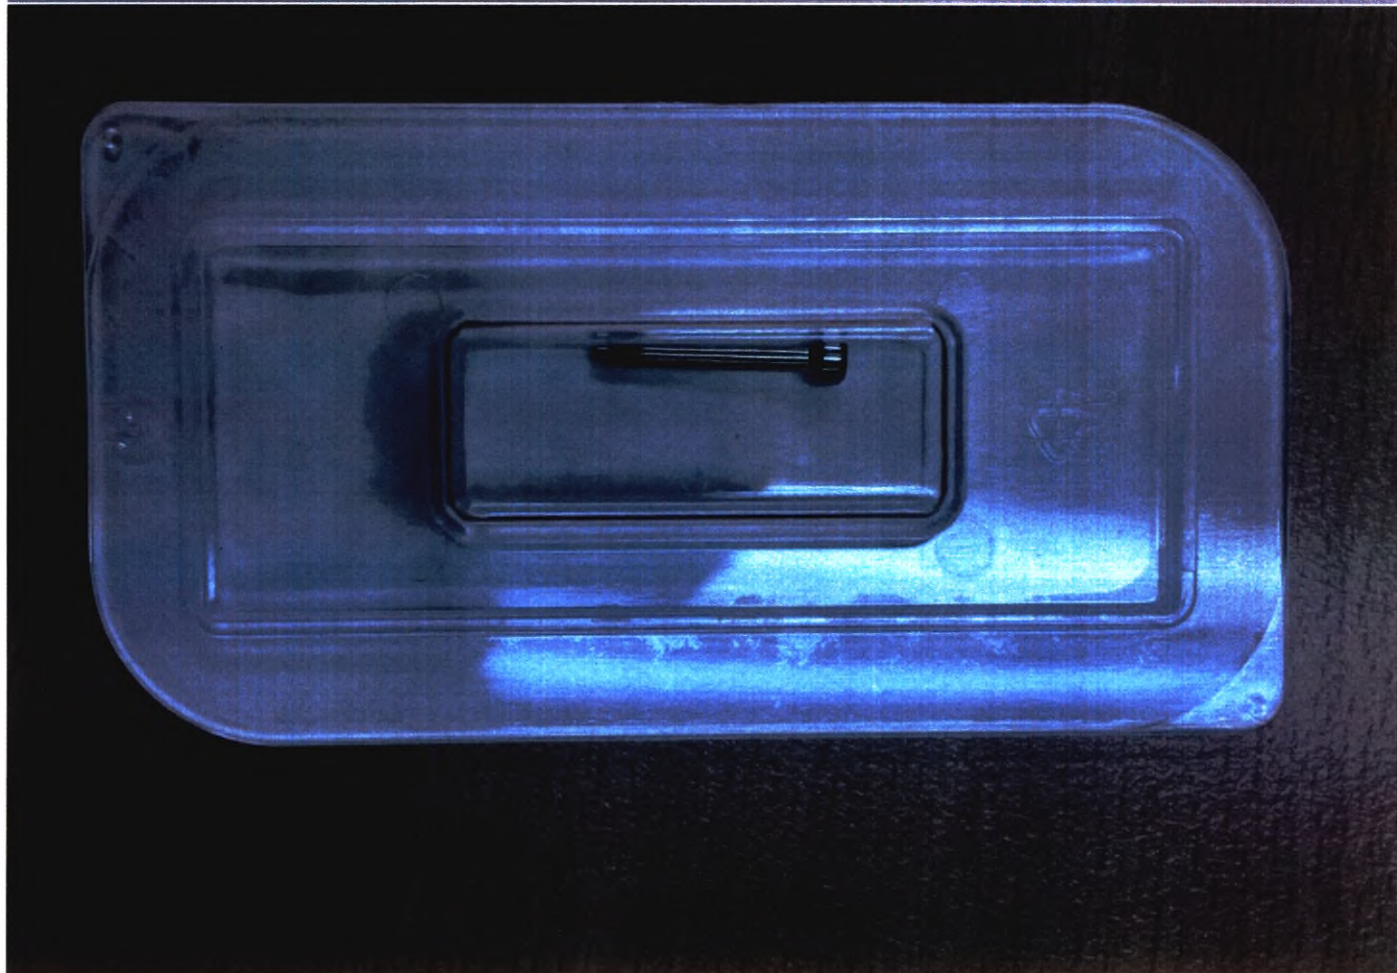



Примечание: Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T01 (T01 Transfer Impression Coping Guide Pin) (T01TICMGS) имеет похожий внешний вид, отличие в размерах.

Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T01 (T01 Transfer Impression Coping Guide Pin), T01TICGL, Long / 15.0мм (L) (без упаковки и в первичной упаковке)

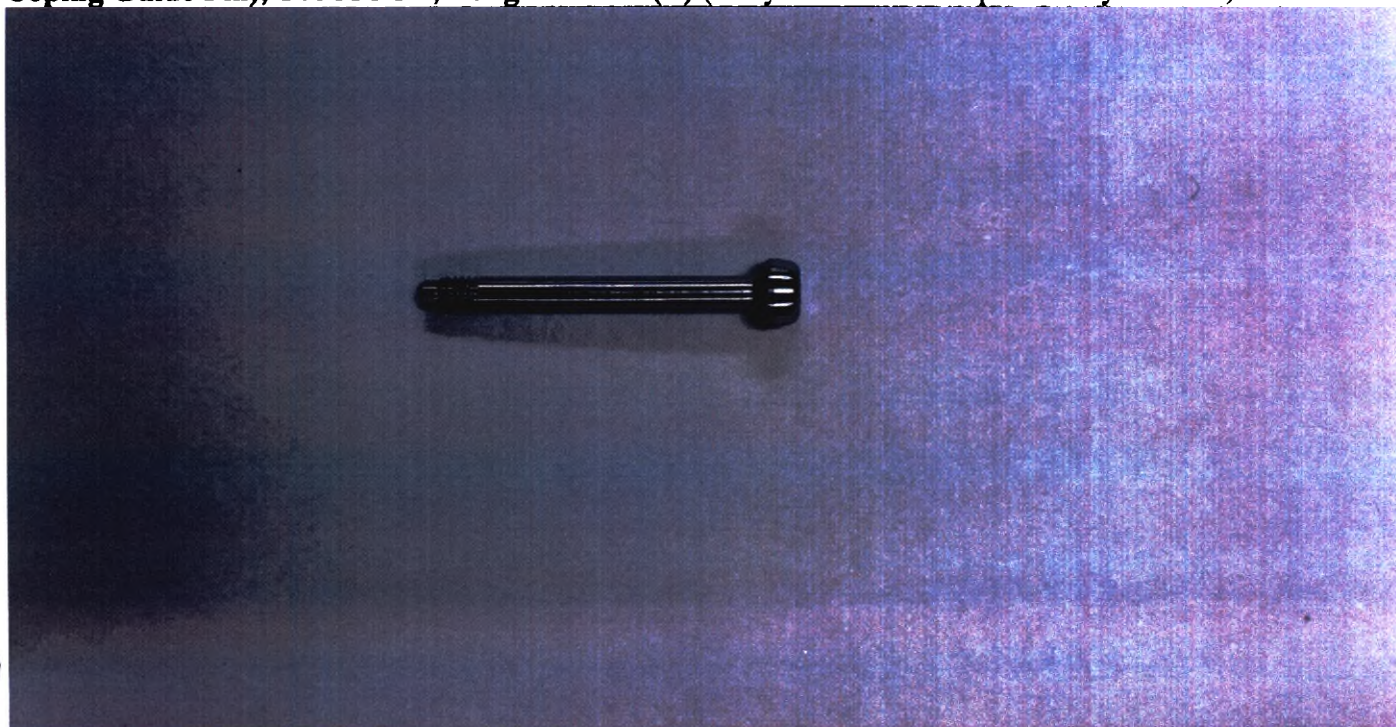

Примечание: Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T01 (T01 Transfer Impression Coping Guide Pin) (T01TICMGL) имеет похожий внешний вид, отличие в размерах.


Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T02 (T02 Transfer Impression Coping Guide Pin), T02TICGS12, Short / 1.2Hex / 11.0мм (L) (без упаковки и в первичной упаковке)

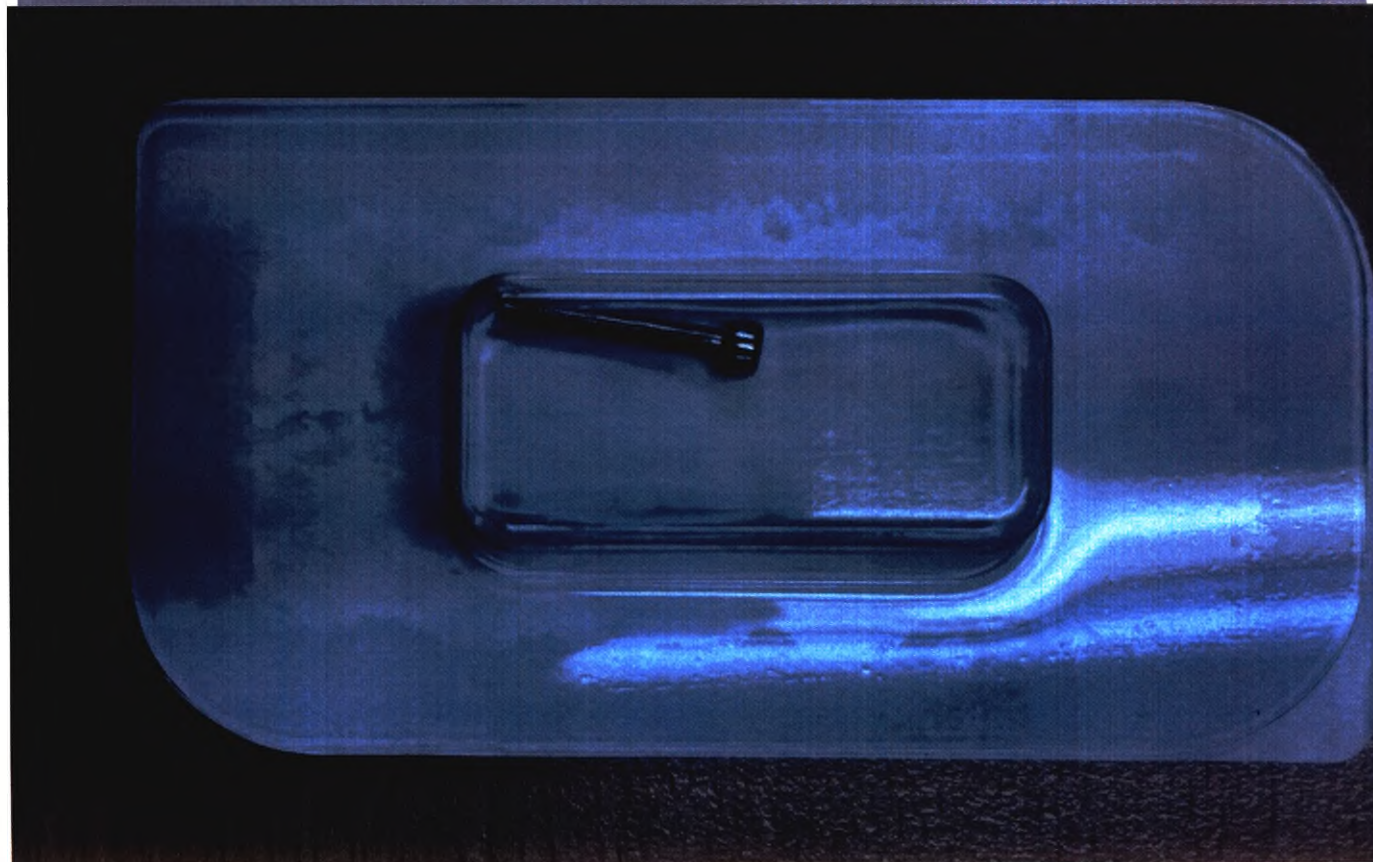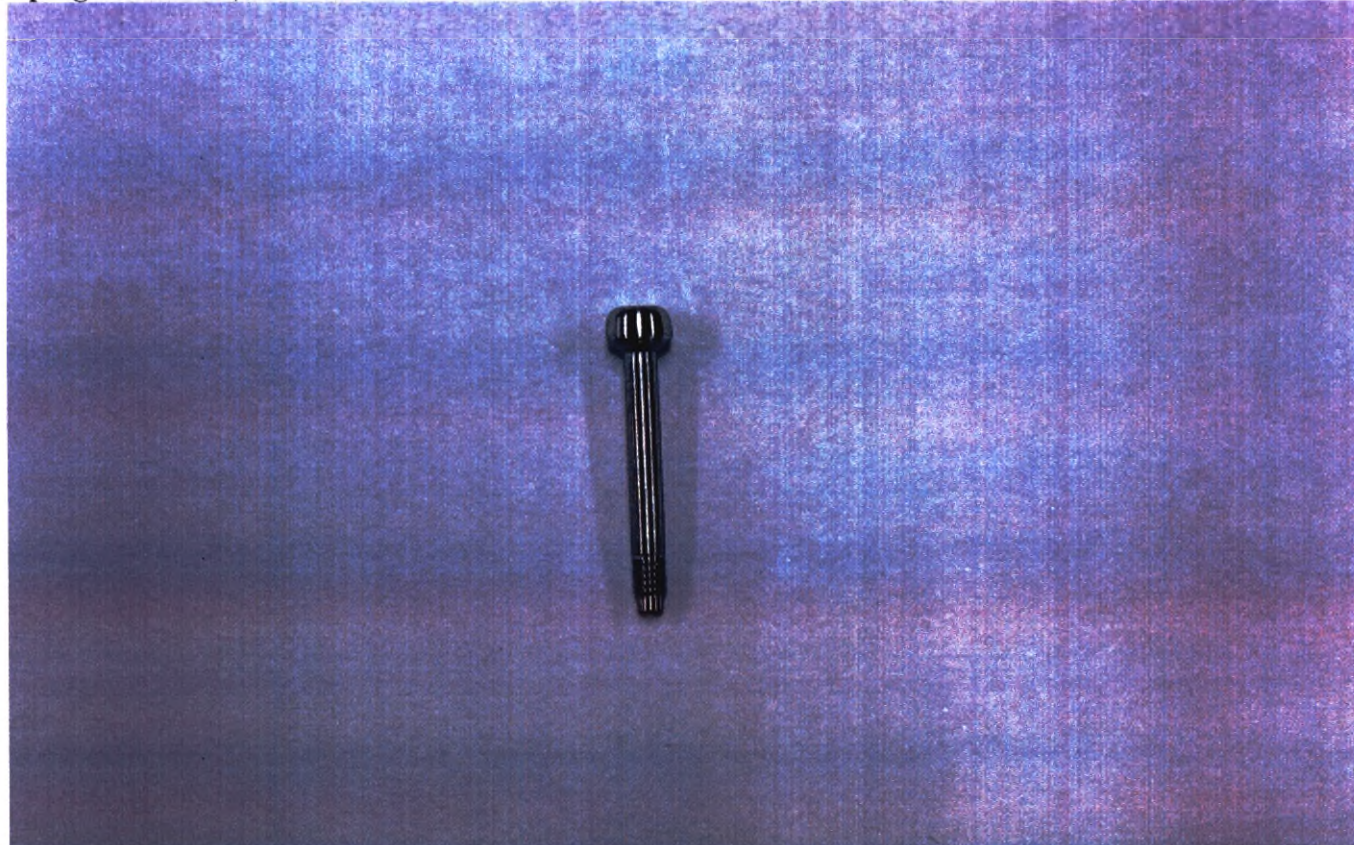

Примечание:

Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T02 (T02 Transfer Impression Coping Guide Pin) (T02TICMGS12) имеет похожий внешний вид, отличие в размерах.


Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T02 (T02 Transfer Impression Coping Guide Pin), T02TICGL12, Long / 1.2Hex / 15.0мм (L) (без упаковки и в первичной упаковке)

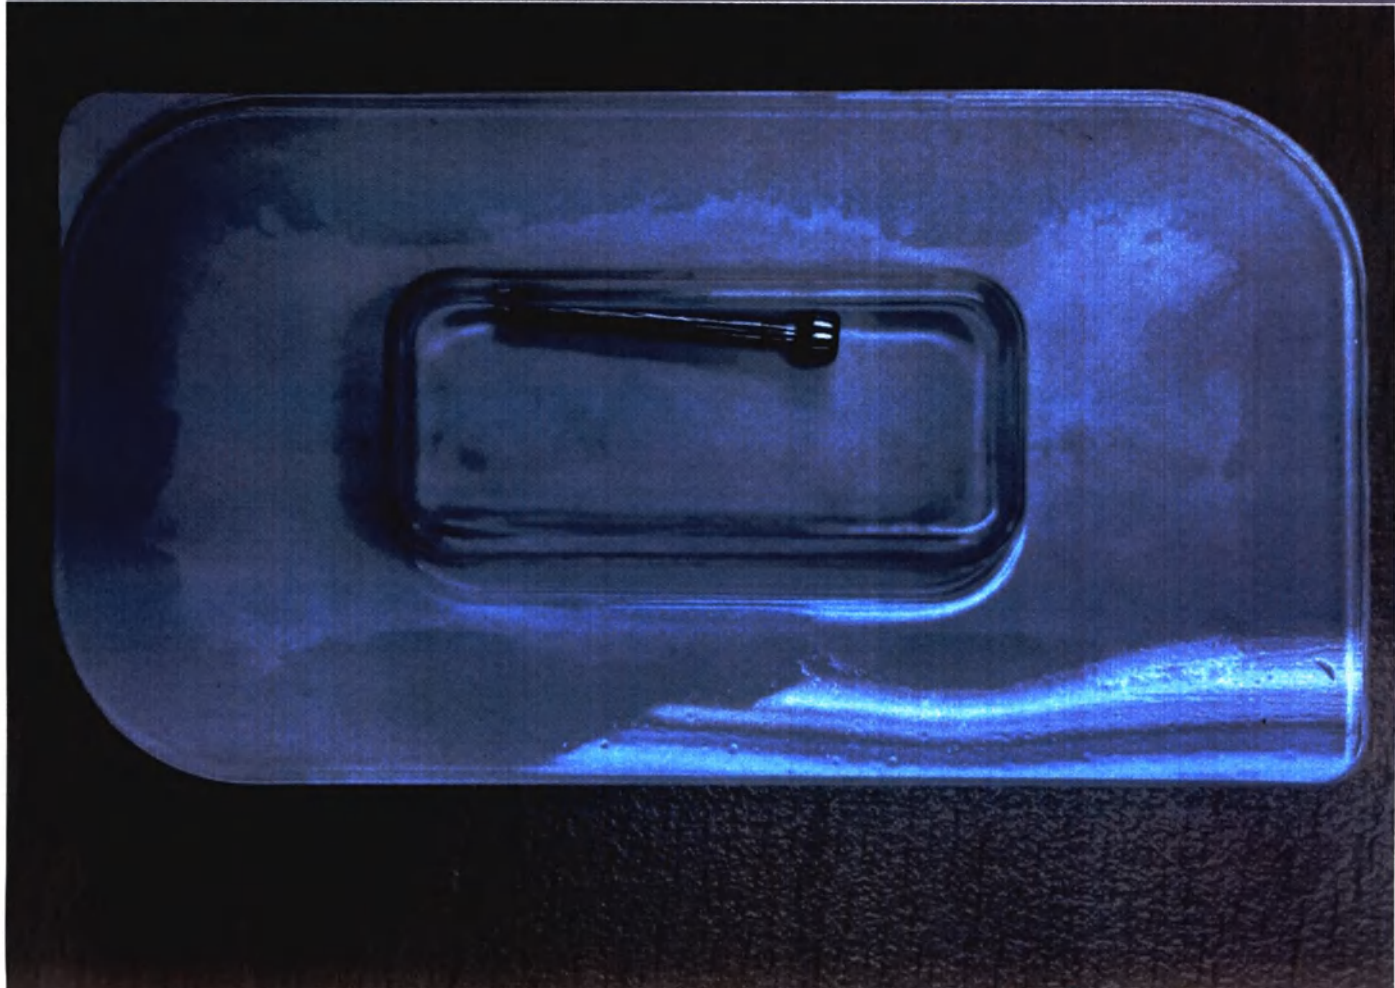

Примечание:

Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T02 (T02 Transfer Impression Coping Guide Pin) (T02TICMGL12) имеет похожий внешний вид, отличие в размерах.


Слепочный модуль для открытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Pick up Impression Coping Set), T01PIC4515TH, Hex / Ø4.5 / 15.0мм (H) (без упаковки и в первичной упаковке)

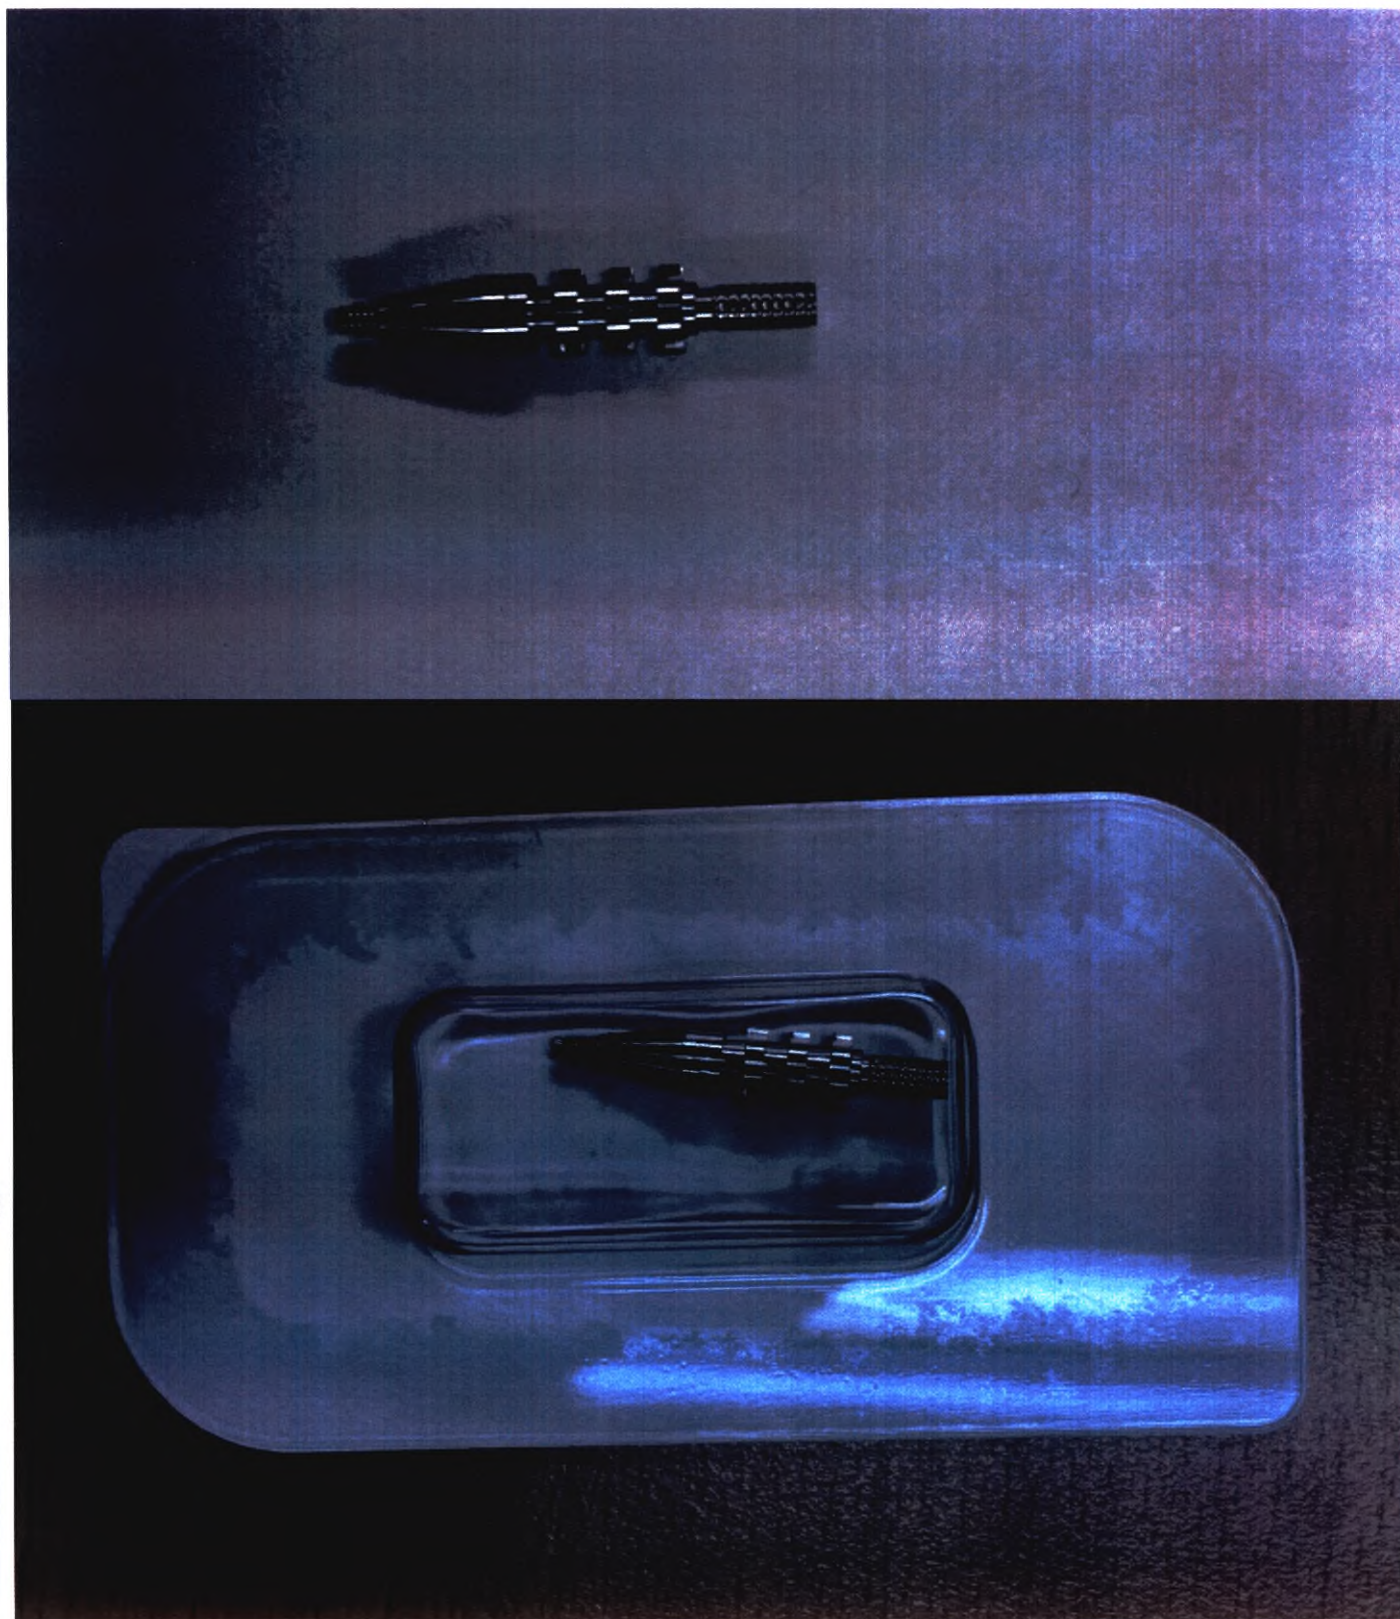

Примечание:

Слепочные модули для открытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Pick up Impression Coping Set) (T01PIC4011TH, T01PIC4015TH, T01PIC4511TH, T01PIC5511TH, T01PIC5515TH, T01PIC6511TH, T01PIC6515TH, T01PICM4011TH, T01PICM4015TH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.


Слепочный модуль для открытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Pick up Impression Coping Set), T01PIC4515NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 15.0мм (H) (без упаковки и в первичной упаковке)

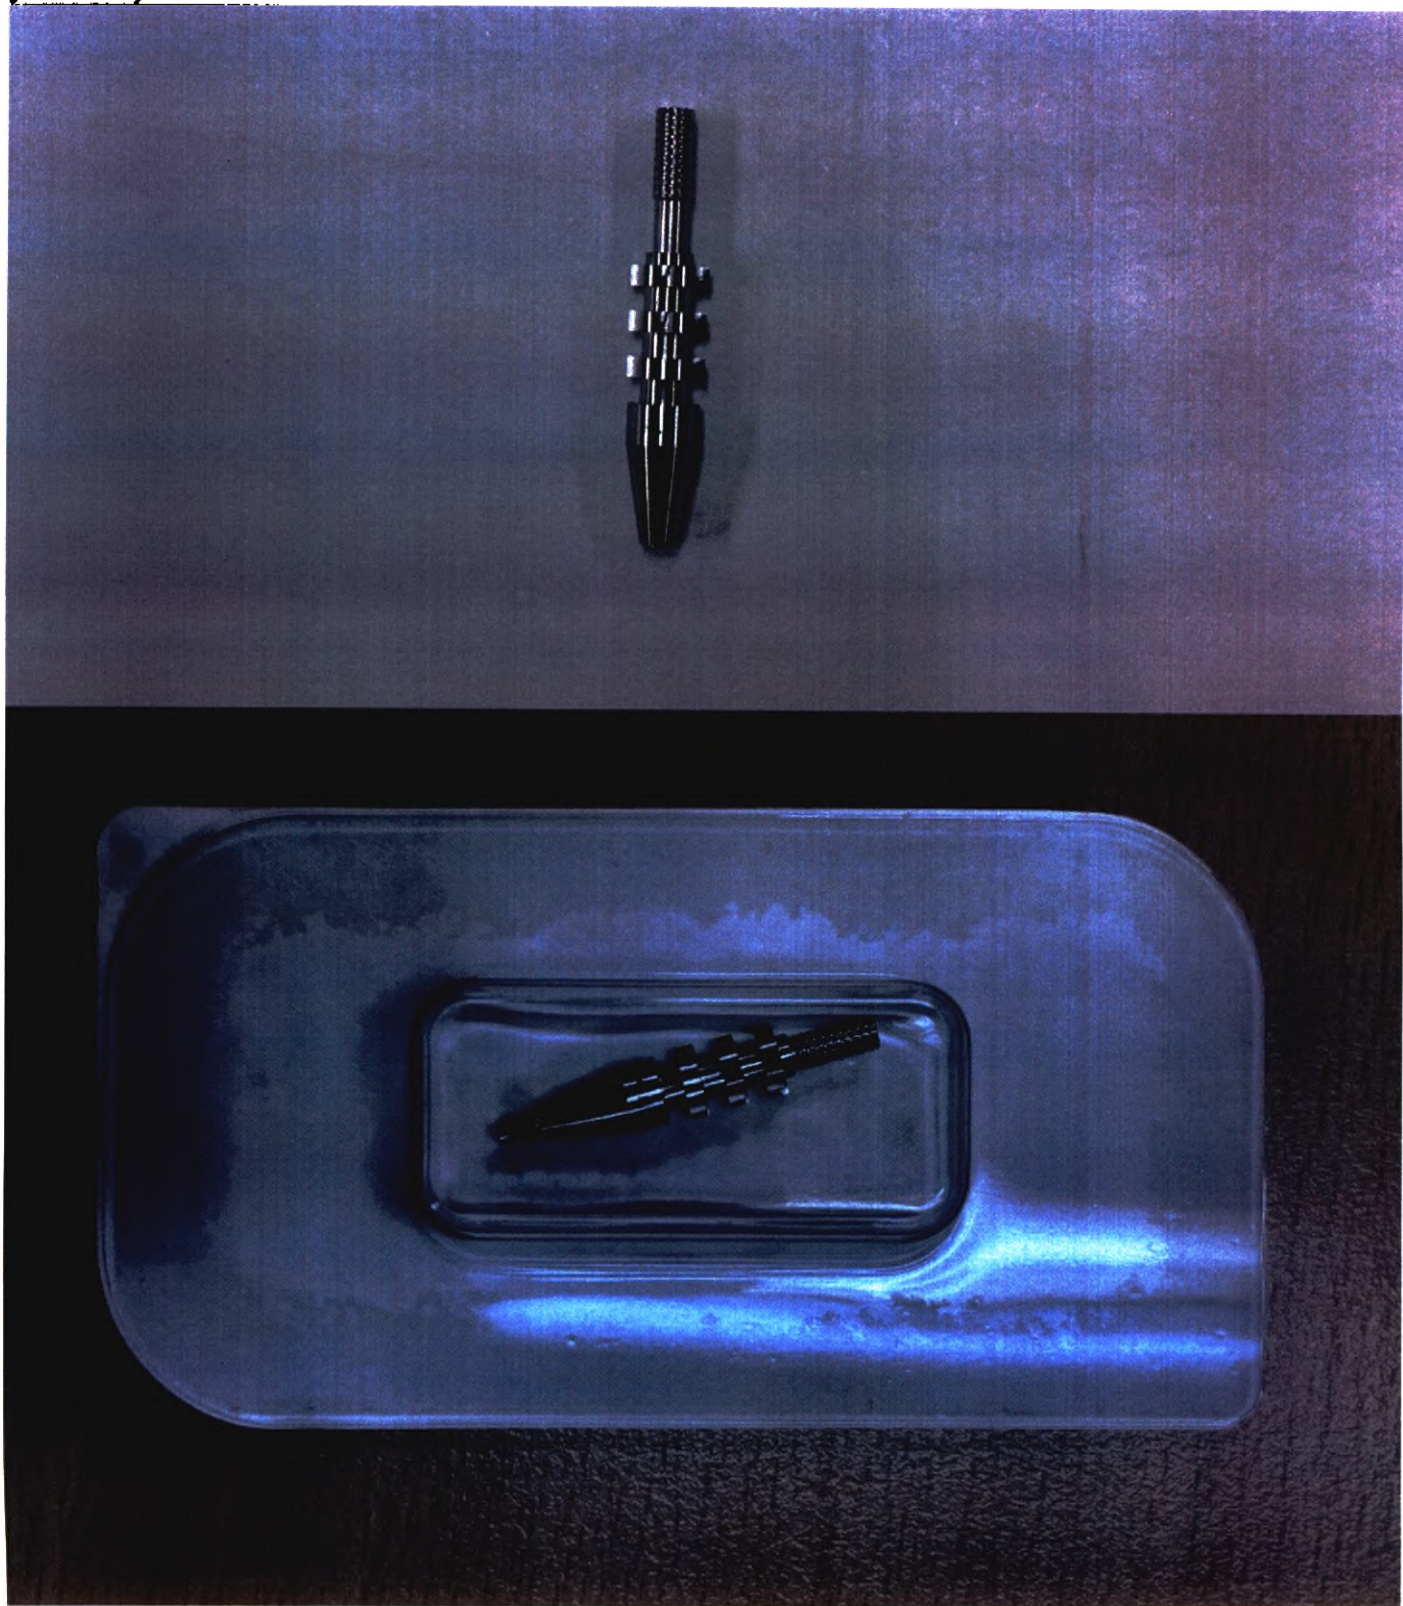

Примечание:

Слепочные модули для открытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Pick up Impression Coping Set) (T01PIC4011NTH, T01PIC4015NTH, T01PIC4511NTH, T01PIC5511NTH, T01PIC5515NTH, T01PIC6511NTH, T01PIC6515NTH, T01PICM4011NTH, T01PICM4015NTH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.


Слепочный модуль для открытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Pick up Impression Coping Set), T02PIC4515TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 15.0мм (H) (без упаковки и в первичной упаковке)

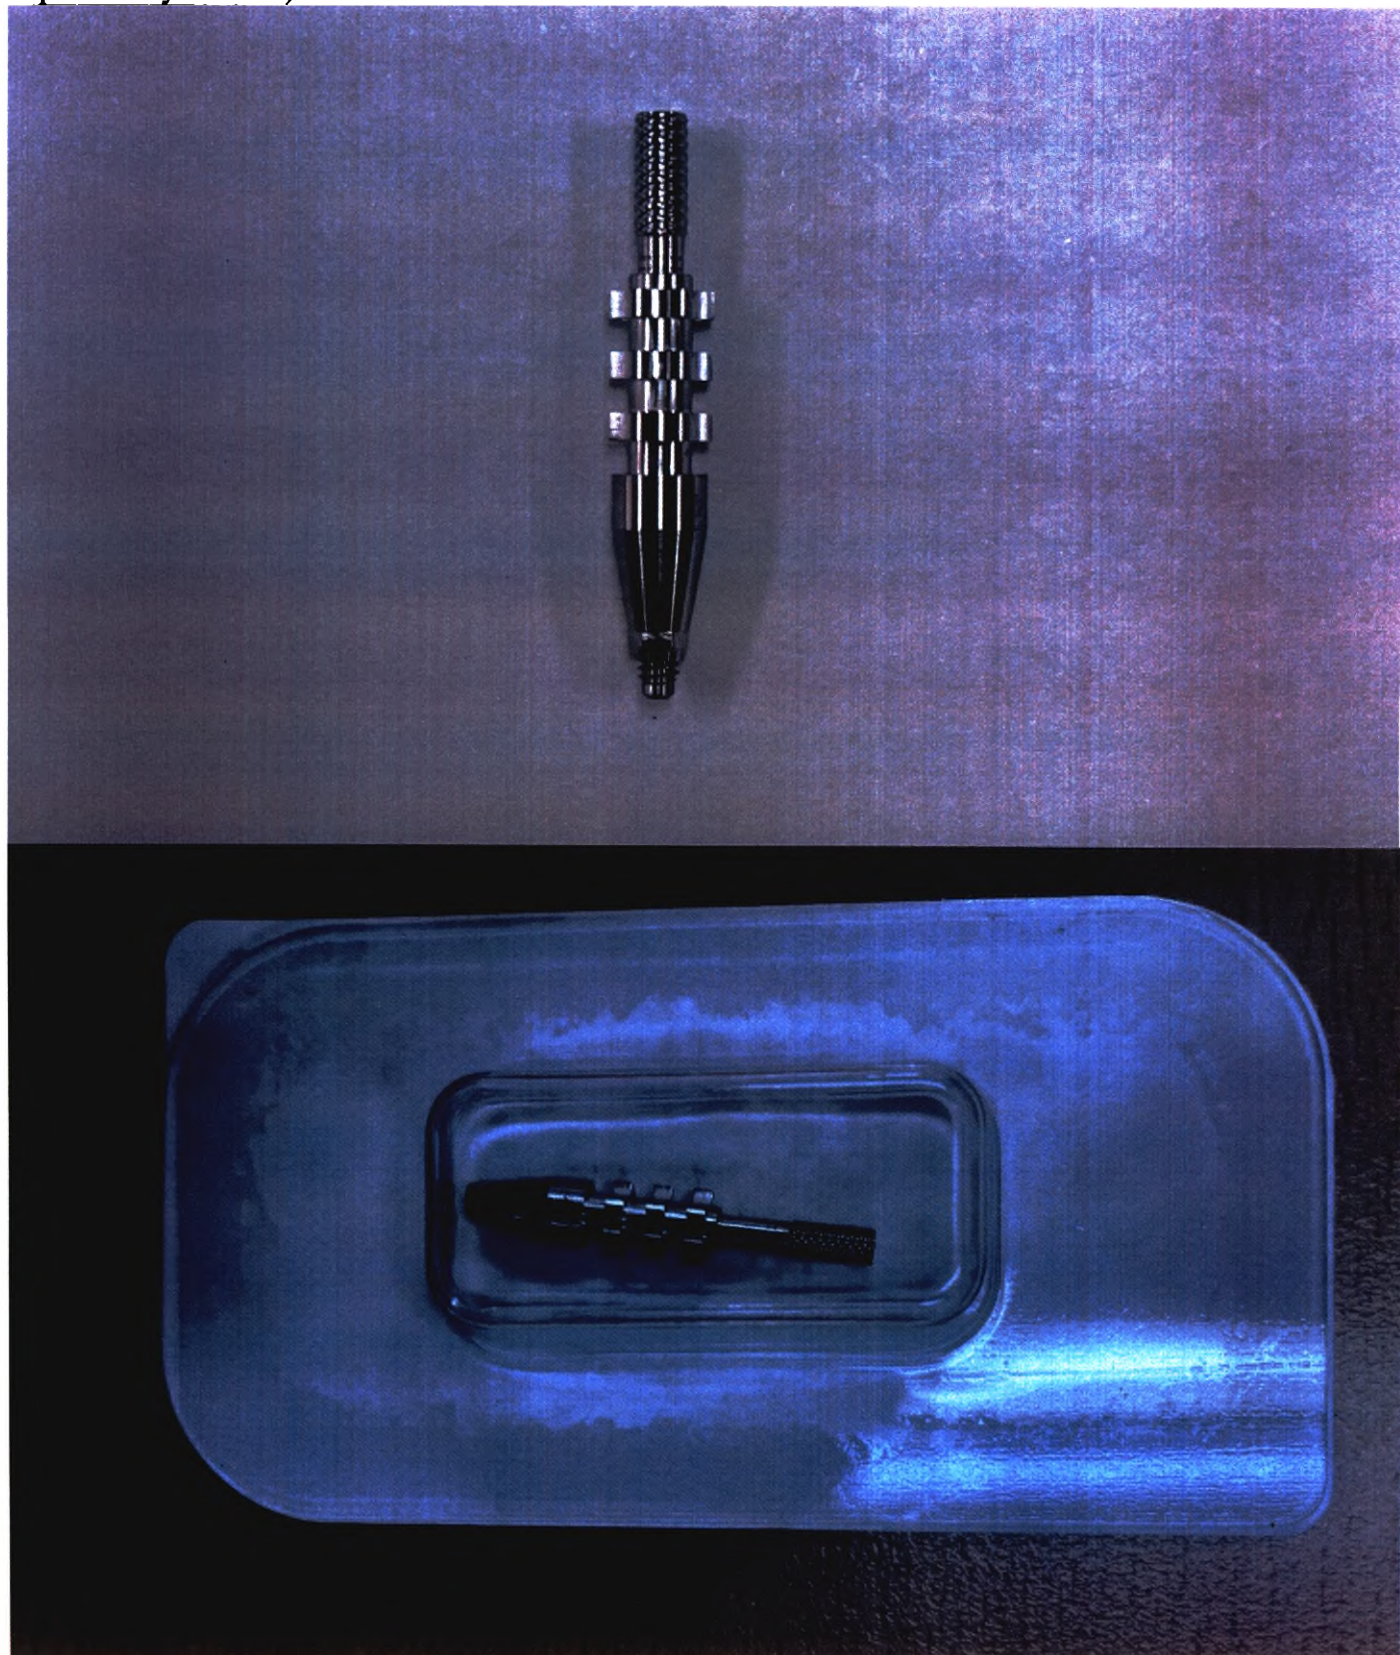

Примечание:


Слепочные модули для открытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Pick up Impression Coping Set) (T02PIC4011TH, T02PIC4015TH, T02PIC4511TH, T02PIC5511TH, T02PIC5515TH, T02PIC6511TH, T02PIC6515TH, T02PICM4011TH, T02PICM4015TH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.

Слепочный модуль для открытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Pick up Impression Coping Set), T02PIC4515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 15.0мм (H) (без упаковки и в первичной упаковке)

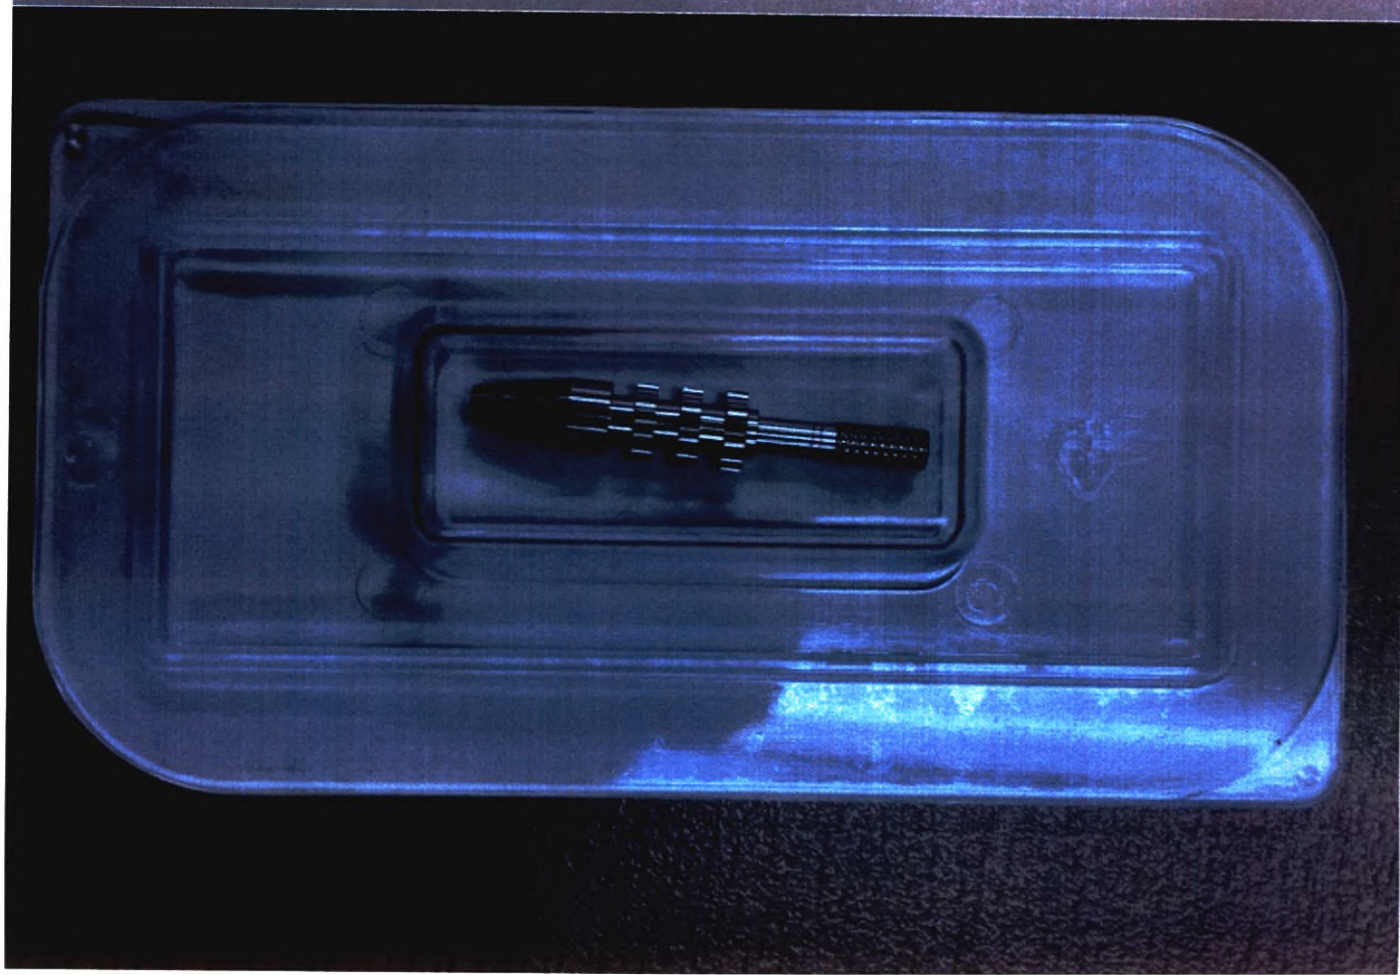

Примечание: Слепочные модули для открытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Pick up Impression Coping Set) (T02PIC4011NTH, T02PIC4015NTH, T02PIC4511NTH, T02PIC5511NTH, T02PIC5515NTH, T02PIC6511NTH, T02PIC6515NTH, T02PICM4011NTH, T02PICM4015NTH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.



Слепочный модуль для закрытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Transfer Impression Coping Set), T01TIC4515TH, Hex / Ø4.5 / 15.0мм (H) (без упаковки и в первичной упаковке)

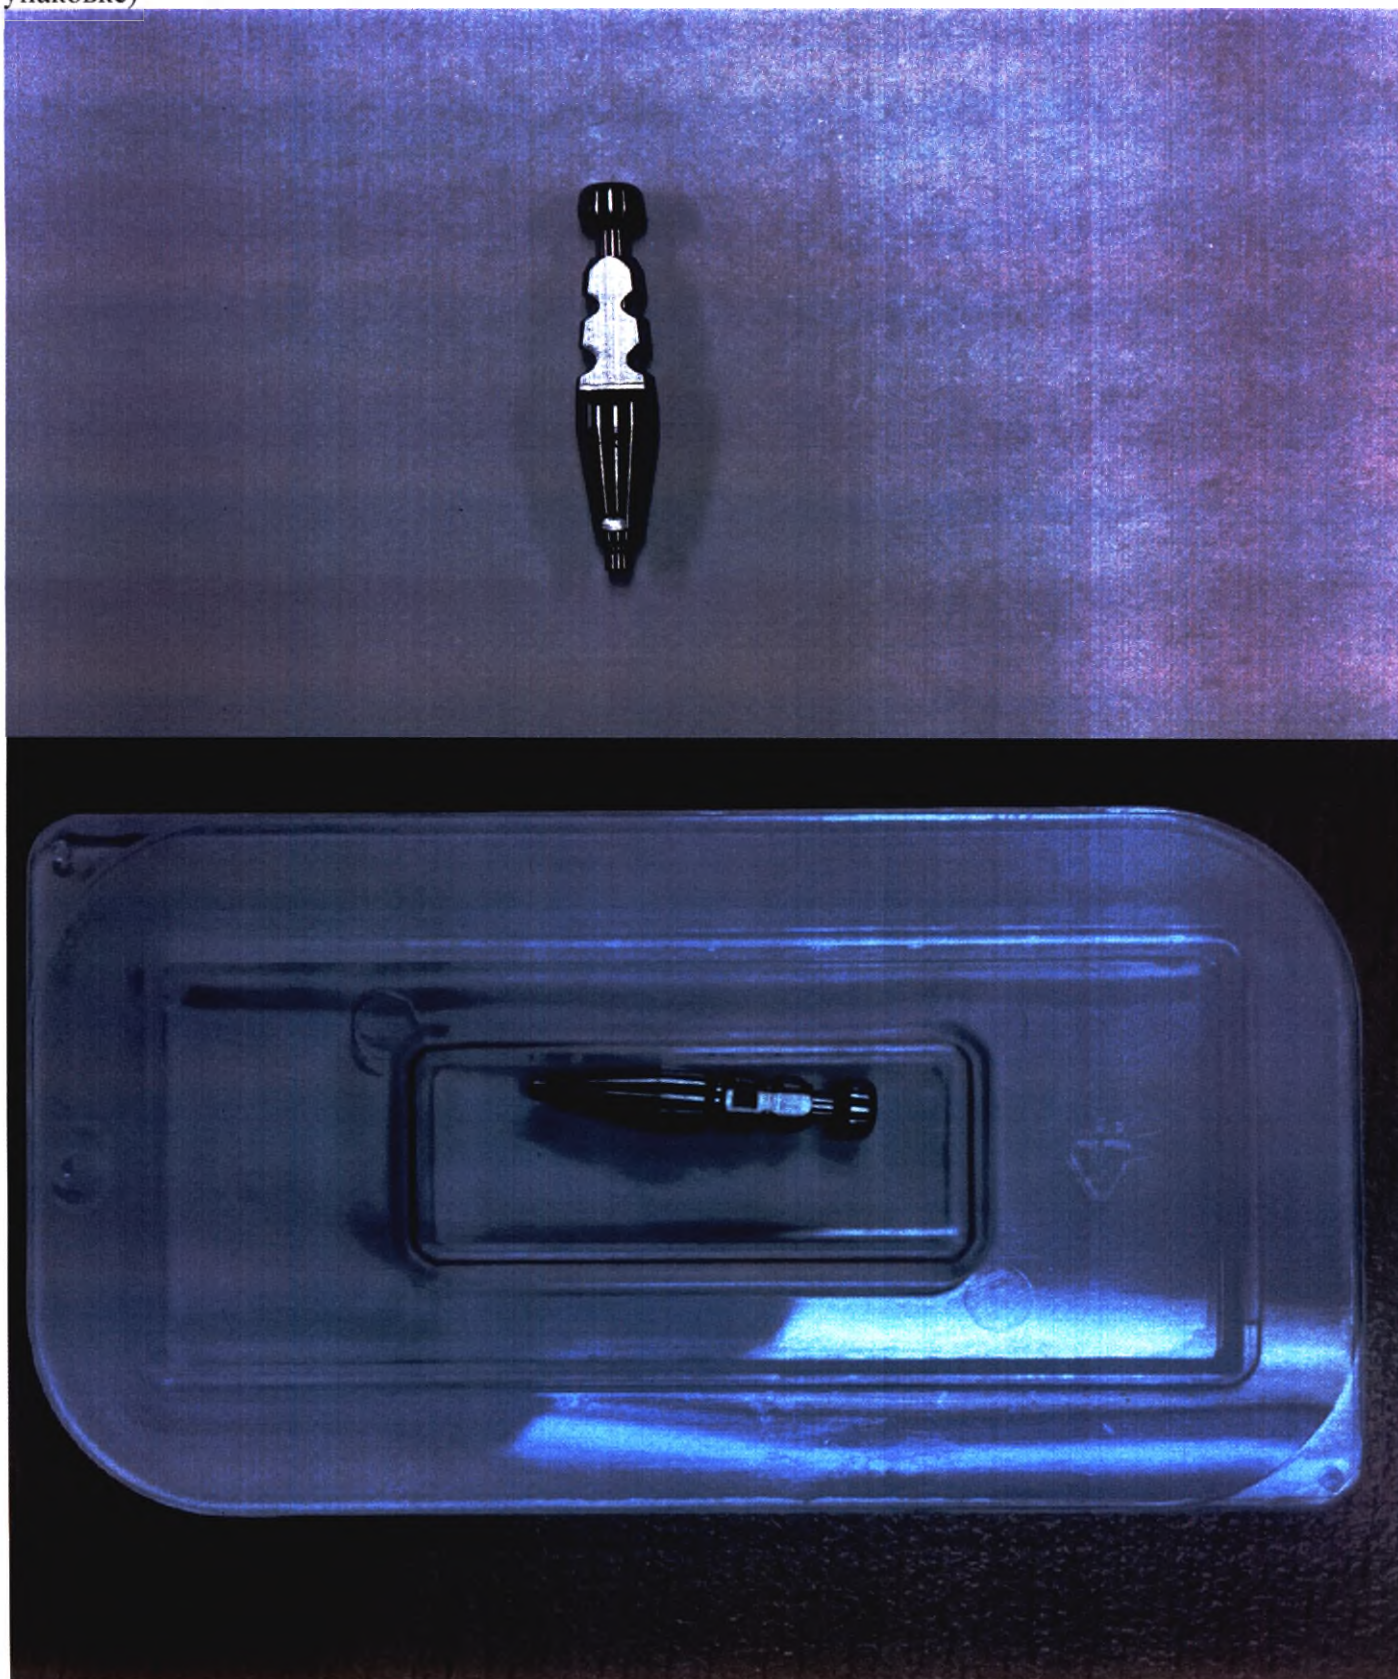

Примечание:

Слепочные модули для закрытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Transfer Impression Coping Set) (T01TIC4011TH, T01TIC4015TH, T01TIC4511TH, T01TIC5511TH, T01TIC5515TH, T01TIC6511TH, T01TIC6515TH, T01TICM4011TH, T01TICM4015TH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.



Слепочный модуль для закрытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Transfer Impression Coping Set), T01TIC4515NTH, Non-Hex / Ø4.5 / 15.0мм (H) (без упаковки и в первичной упаковке)

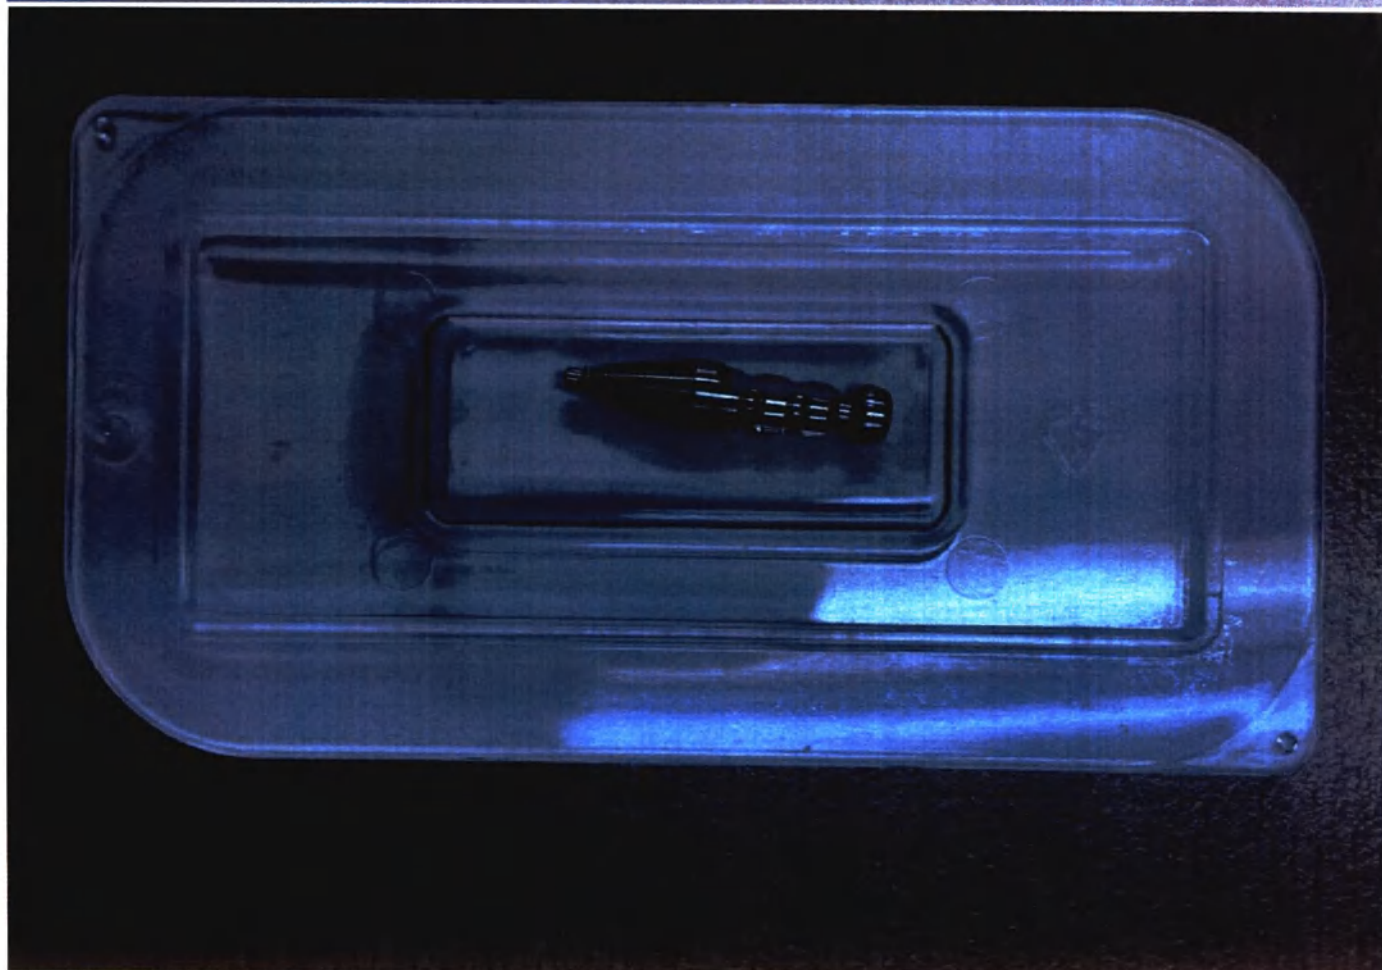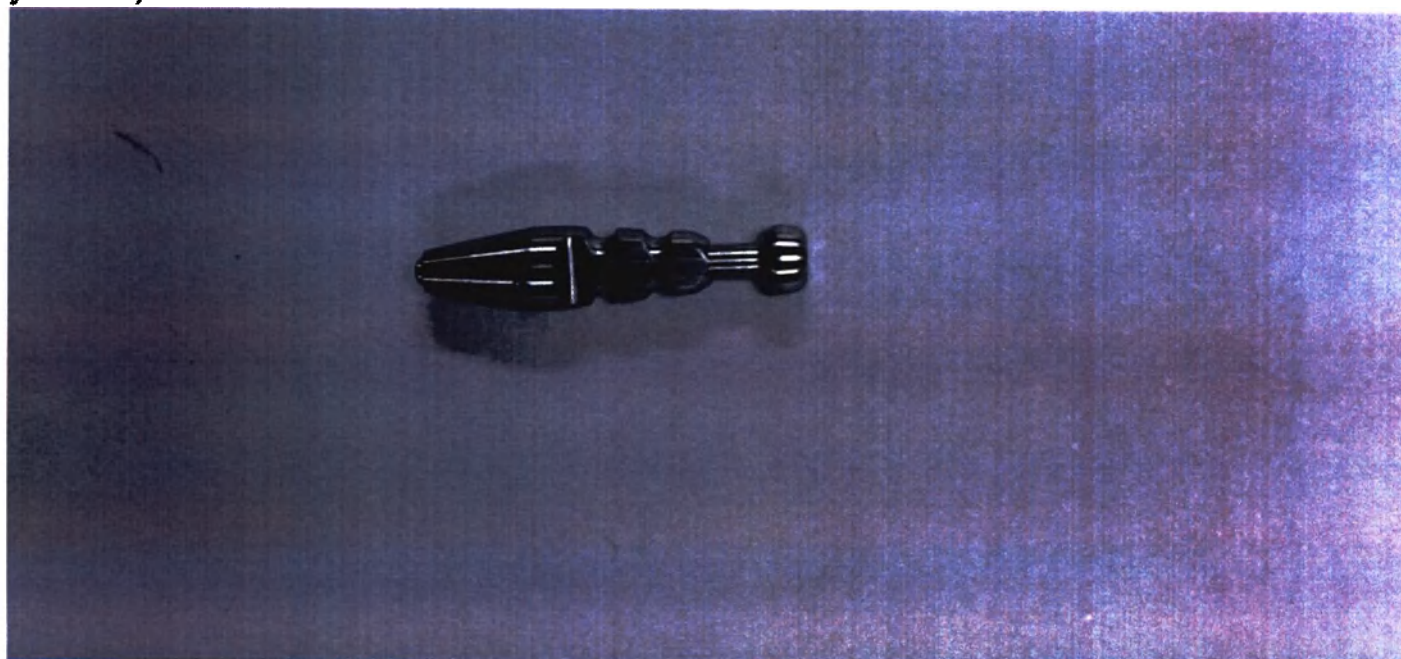

Примечание:

Слепочные модули для закрытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Transfer Impression Coping Set) (T01TIC4011NTH, T01TIC4015NTH, T01TIC4511NTH, T01TIC5511NTH, T01TIC5515NTH, T01TIC6511NTH, T01TIC6515NTH, T01TICM4011NTH, T01TICM4015NTH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.



Слепочный модуль для закрытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Transfer Impression Coping Set), T02TIC4515TH, Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 15.0мм (H) (без упаковки и в первичной упаковке)

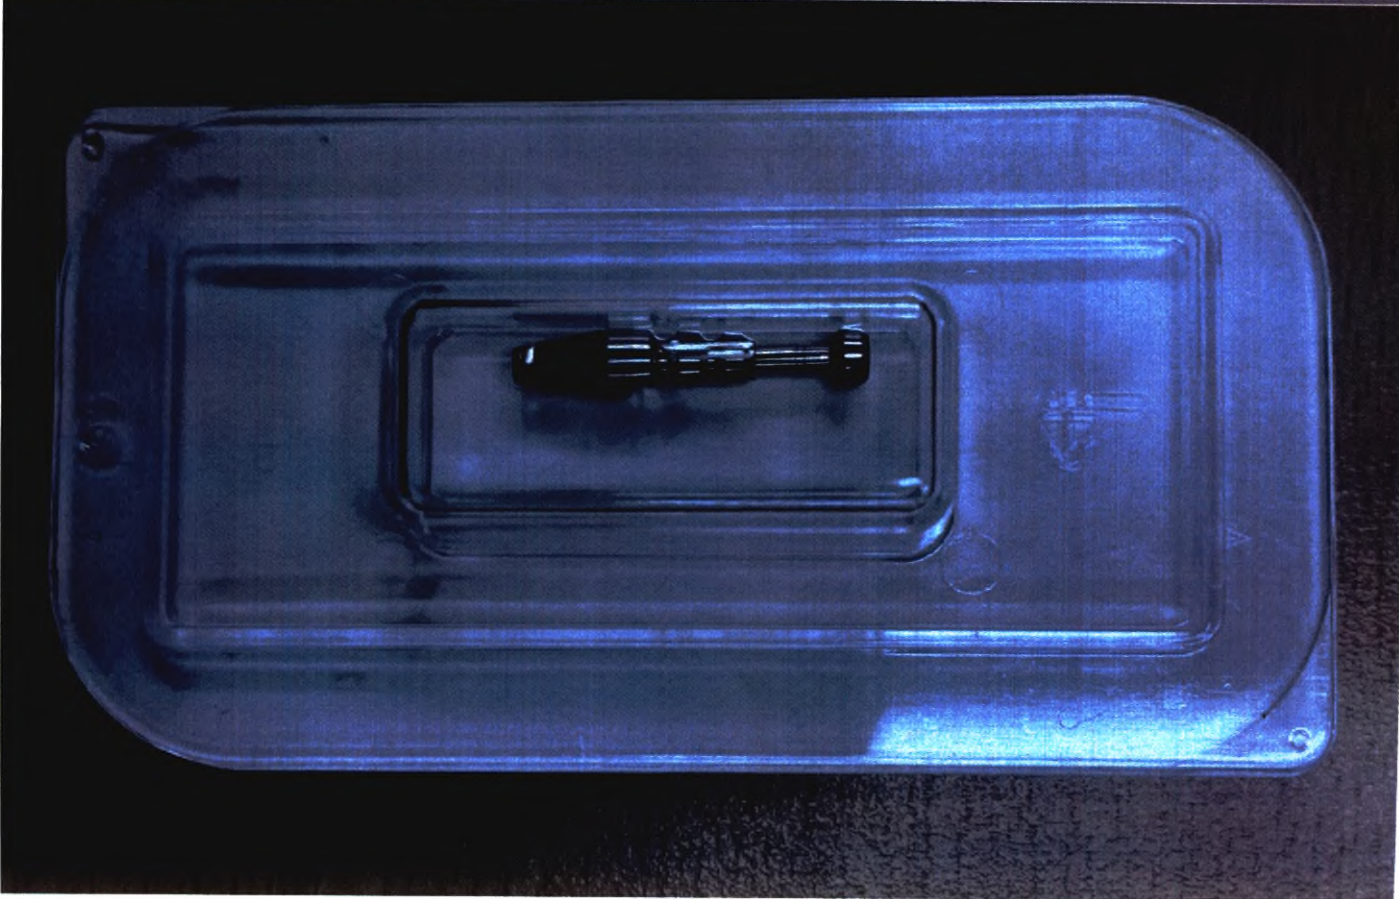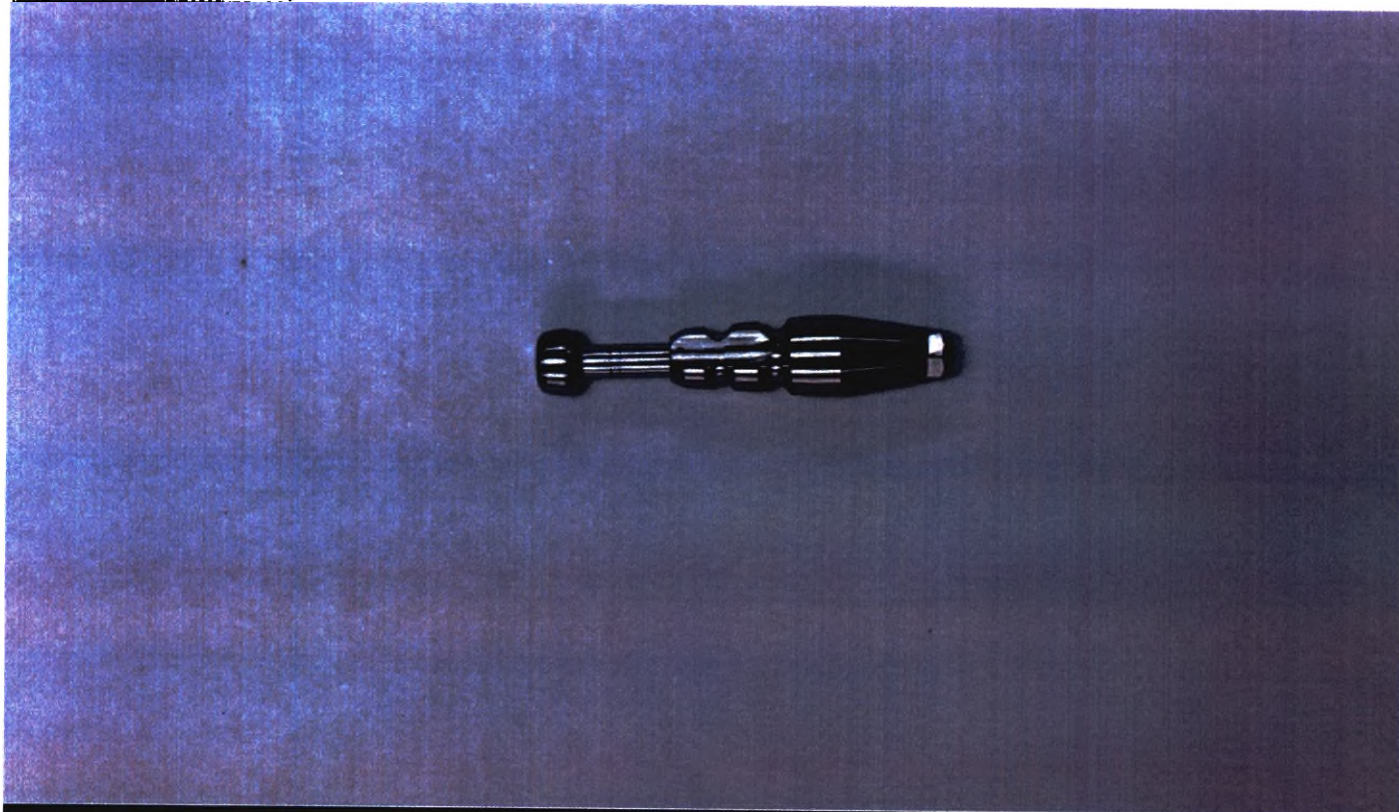

Примечание:

Слепочные модули для закрытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Transfer Impression Coping Set) (T02TIC4011TH, T02TIC4015TH, T02TIC4511TH, T02TIC5511TH, T02TIC5515TH, T02TIC6511TH, T02TIC6515TH, T02TICM4011TH, T02TICM4015TH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.


Слепочный модуль для закрытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Transfer Impression Coping Set), T02TIC4515NTH, Non-Hex / 1.2Hex / Ø4.5 / 15.0мм (H) (без упаковки и в первичной упаковке)

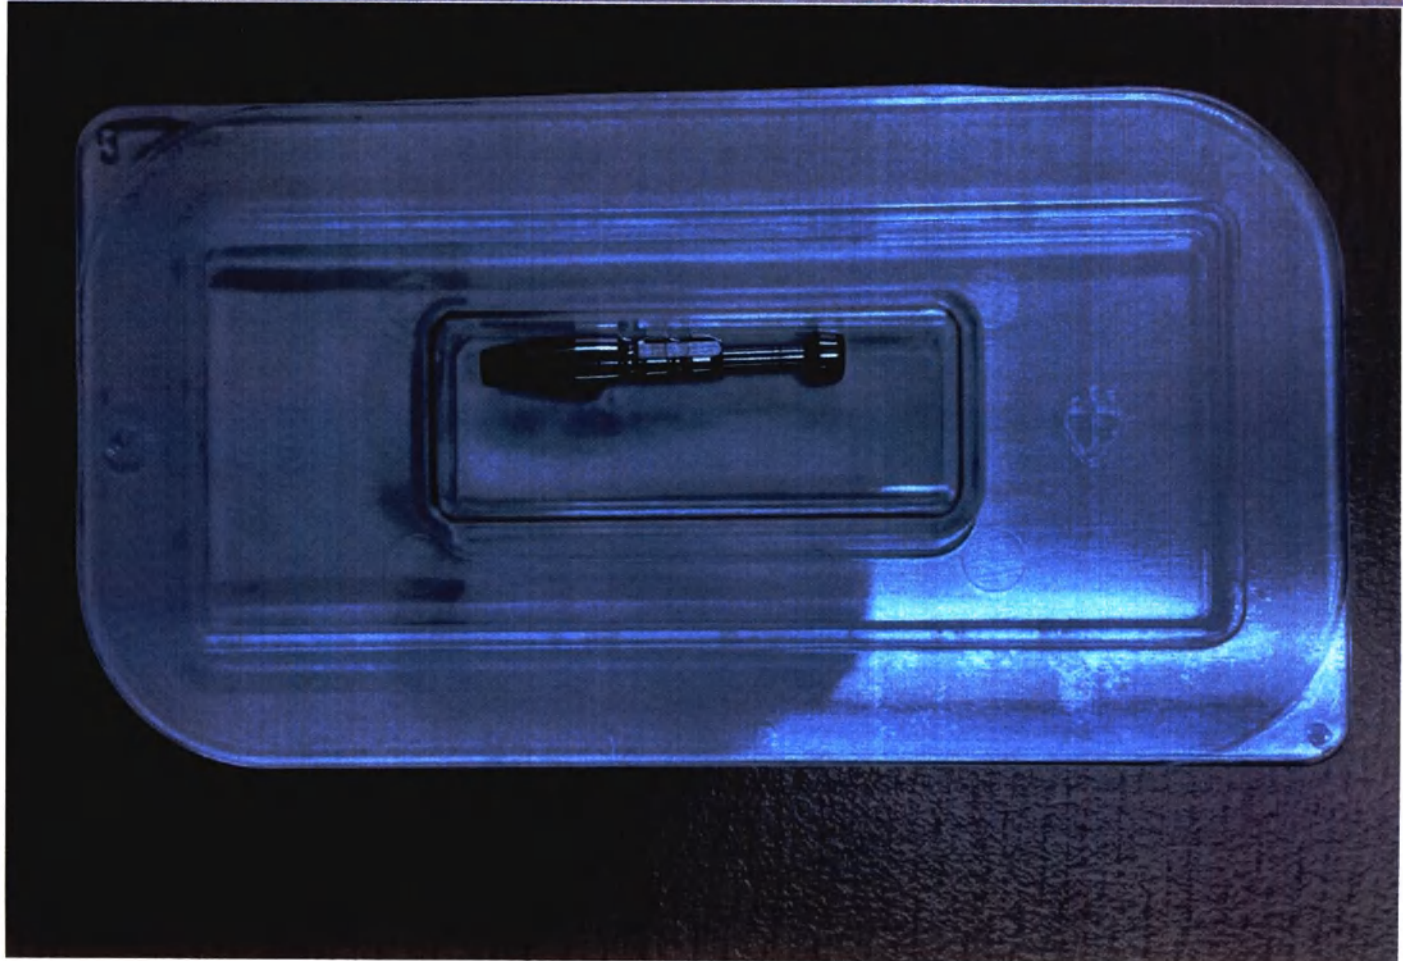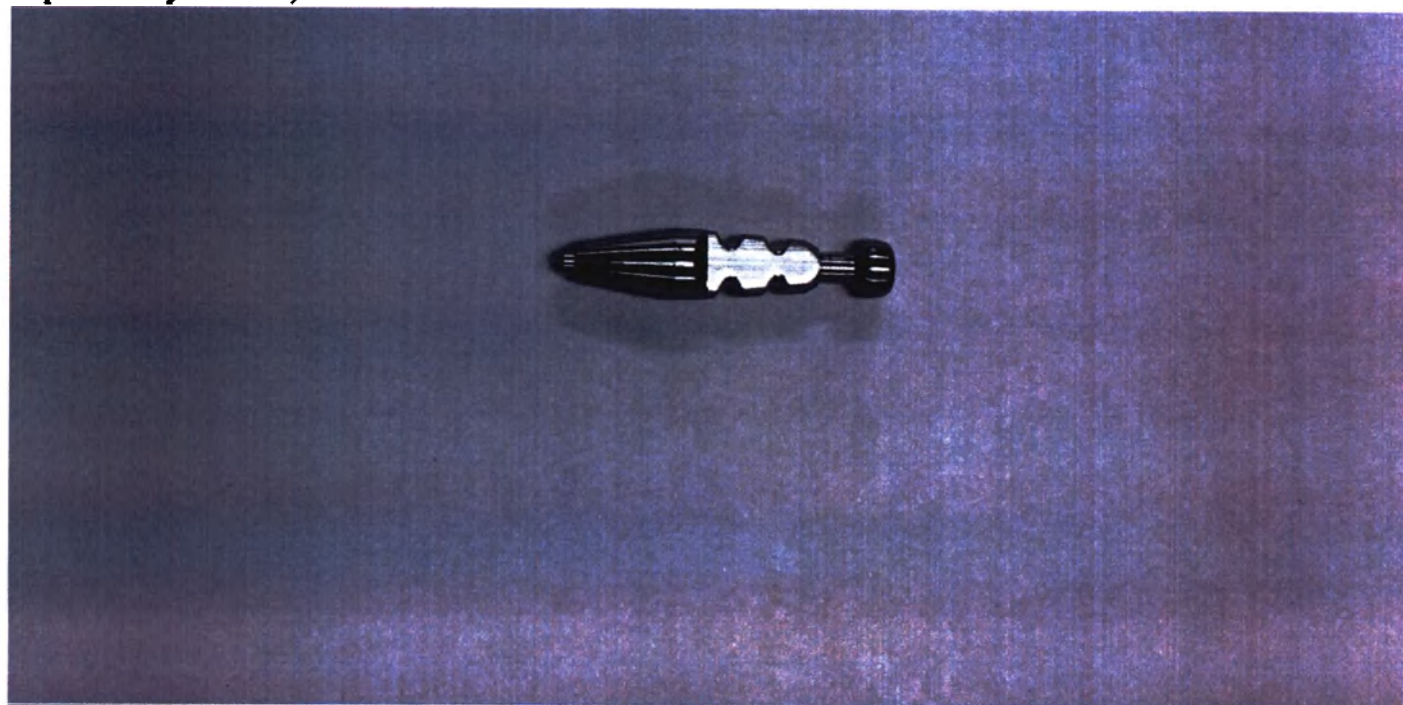

Примечание:

Слепочные модули для закрытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Transfer Impression Coping Set) (T02TIC4011NTH, T02TIC4015NTH, T02TIC4511NTH, T02TIC5511NTH, T02TIC5515NTH, T02TIC6511NTH, T02TIC6515NTH, T02TICM4011NTH, T02TICM4015NTH) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.



Лабораторный аналог (Lab Analog), T01LA, Ø4.5 /12.0мм (Н) (без упаковки и в первичной упаковке)

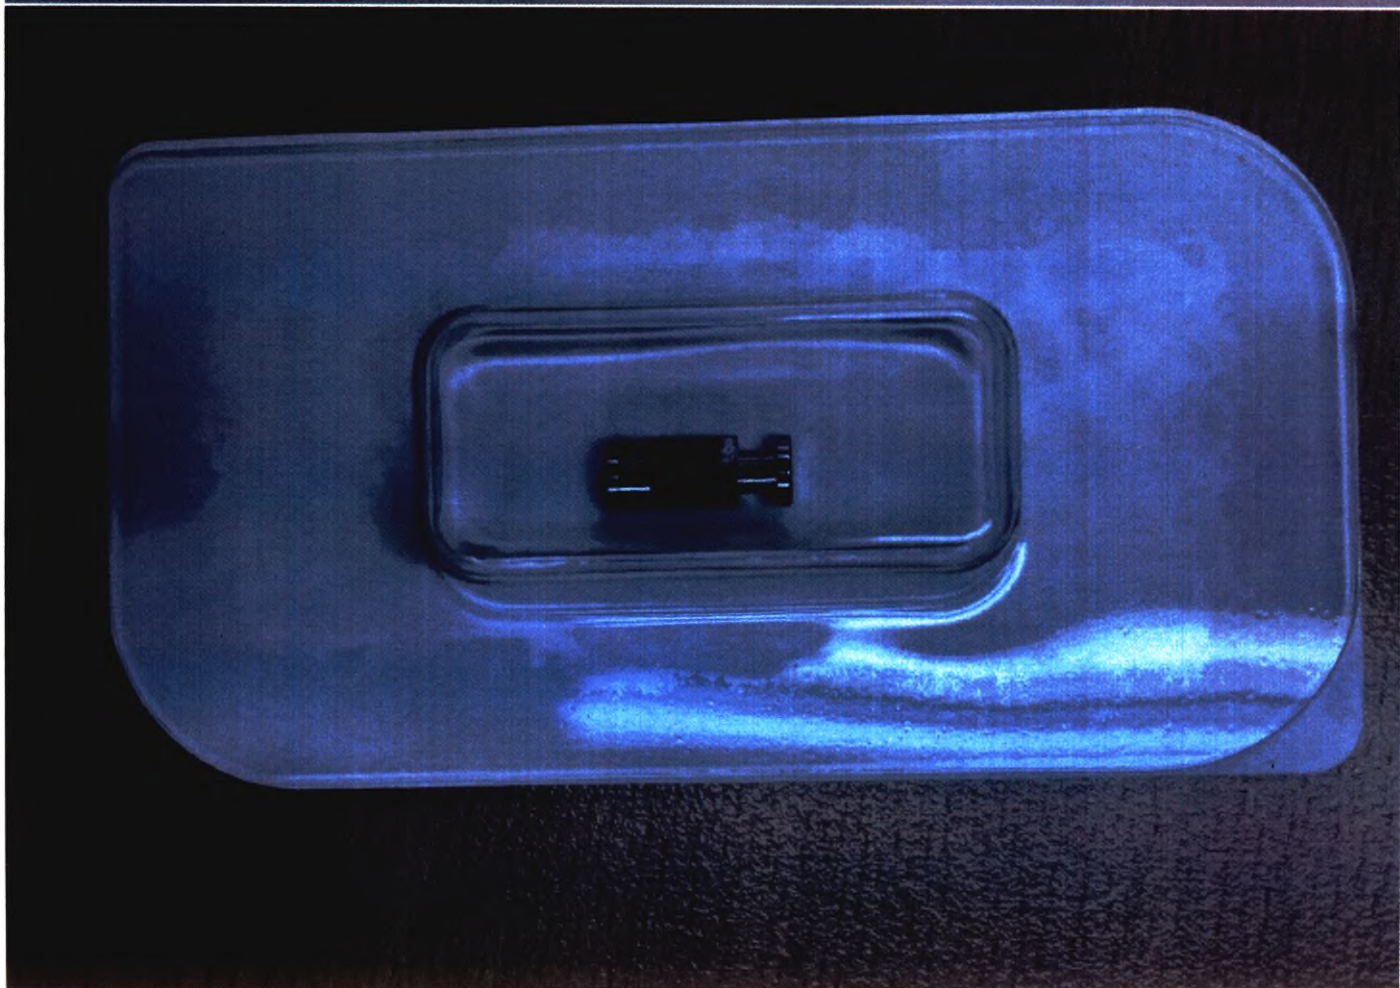

Примечание:

Лабораторные аналог (Lab.Analog) (T01LAM) имеет похожий внешний вид, отличие в размерах.


Лабораторный аналог на уровне абатмента T01 (T01 Abutment Level Lab Analog), T01ALLA45S, Short / Ø4.5 (без упаковки и в упаковке)

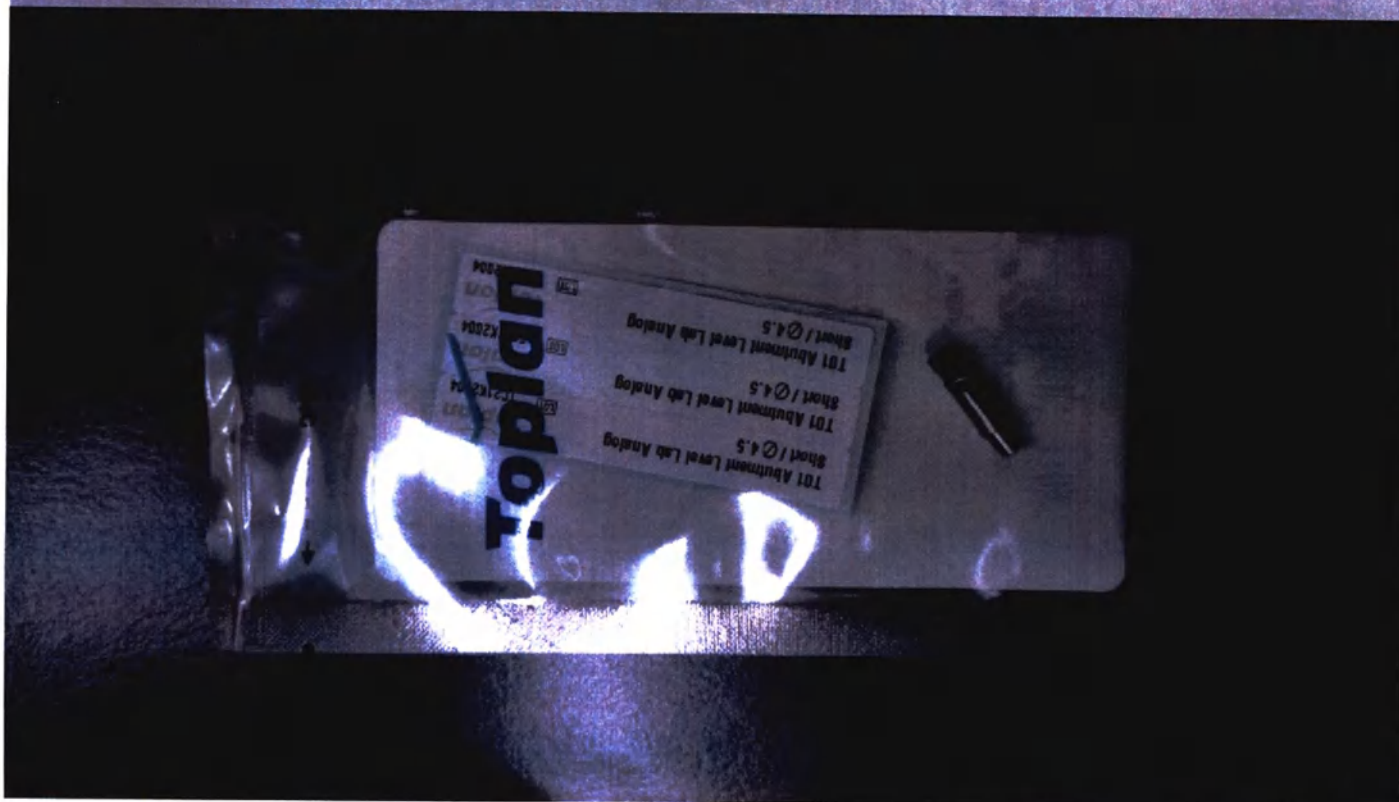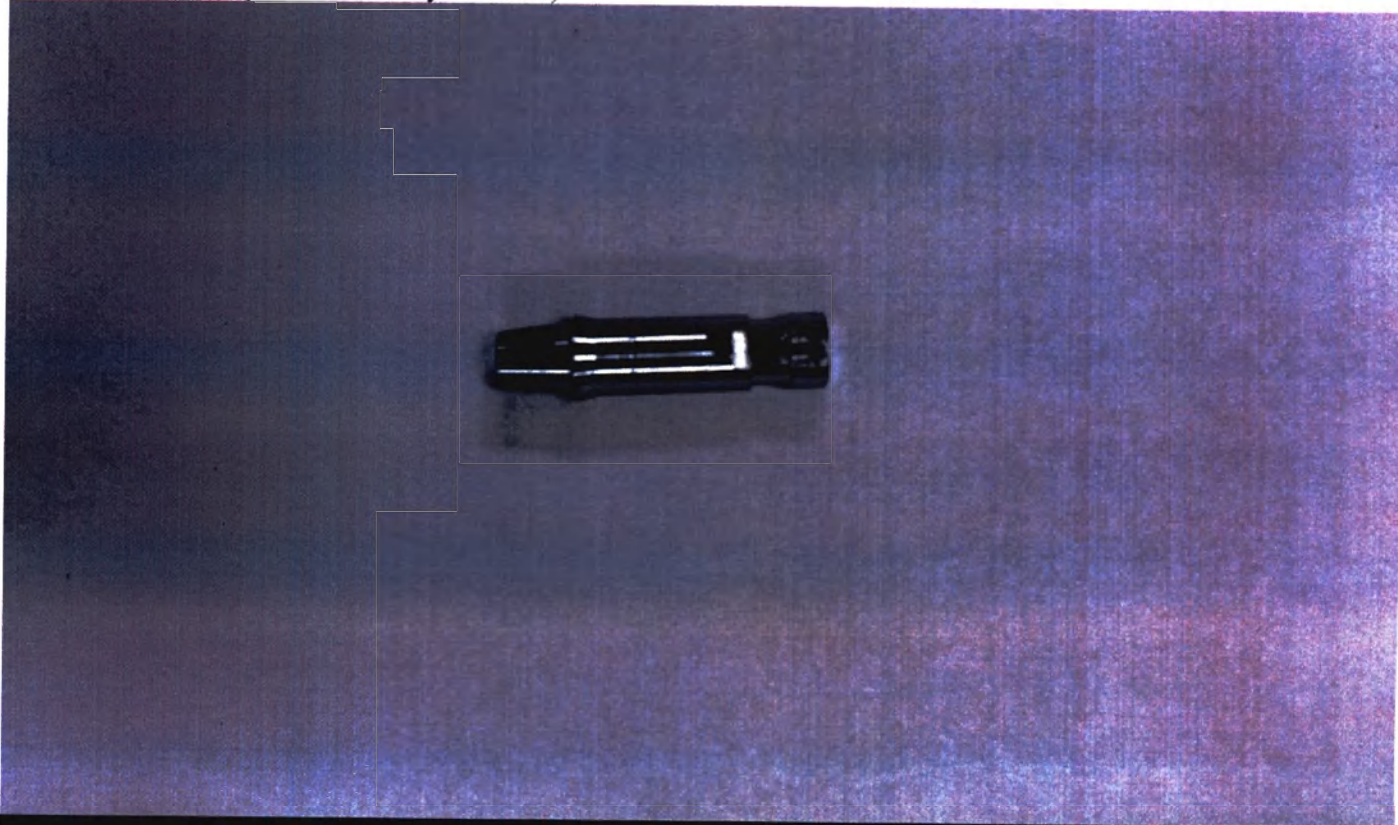

Примечание:

Лабораторные аналоги на уровне абатмента T01 (T01 Abutment Level Lab Analog) (T01ALLA40S, T01ALLA55S, T01ALLA65S) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.



Лабораторный аналог на уровне абатмента T01 (T01 Abutment Level Lab Analog), T01ALLA45M, Middle / Ø4.5 (без упаковки и в упаковке)

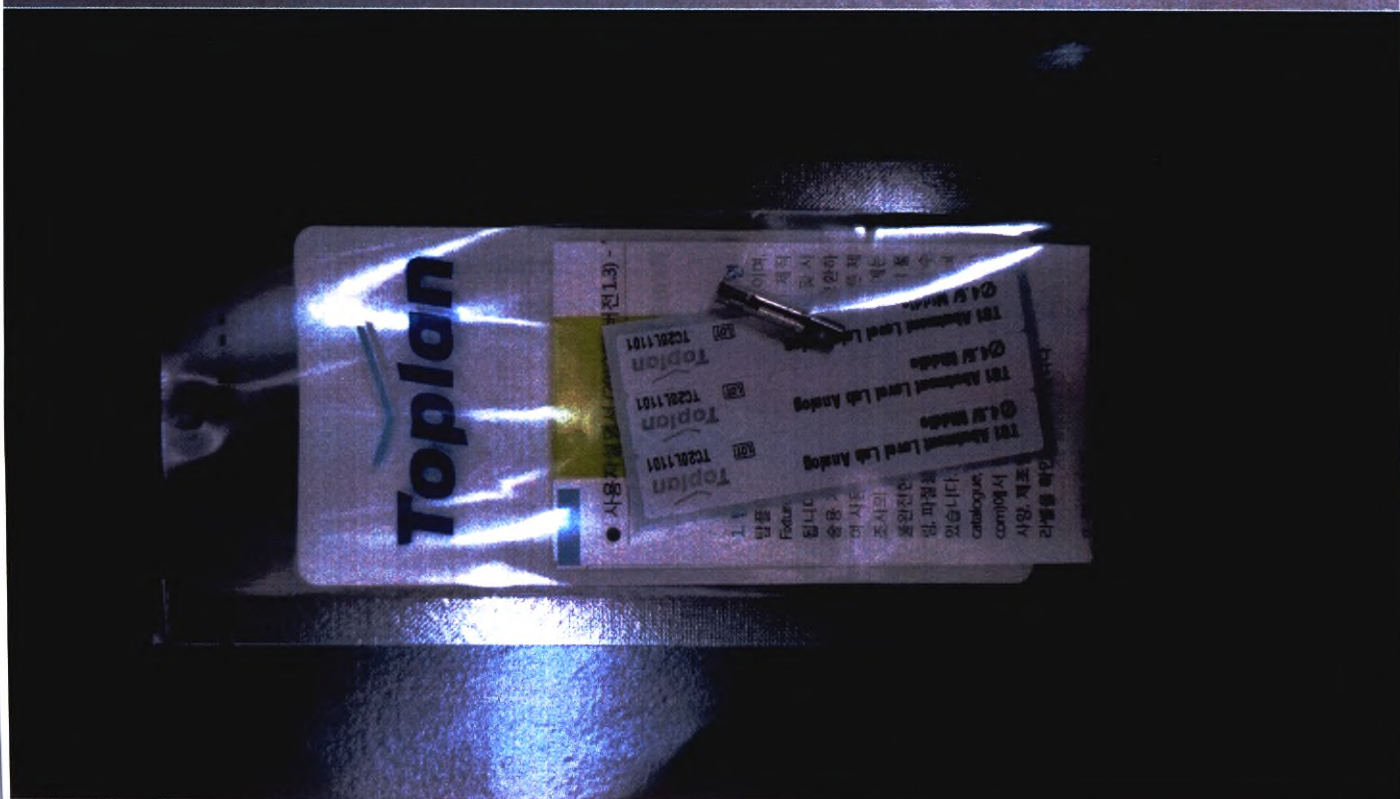

Примечание:

Лабораторные аналоги на уровне абатмента T01 (T01 Abutment Level Lab Analog) (T01ALLA40M, T01ALLA55M, T01ALLA65M) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.



Лабораторный аналог на уровне абатмента T01 (T01 Abutment Level Lab Analog), T01ALLA45L, Long / Ø4.5 (без упаковки и в упаковке)

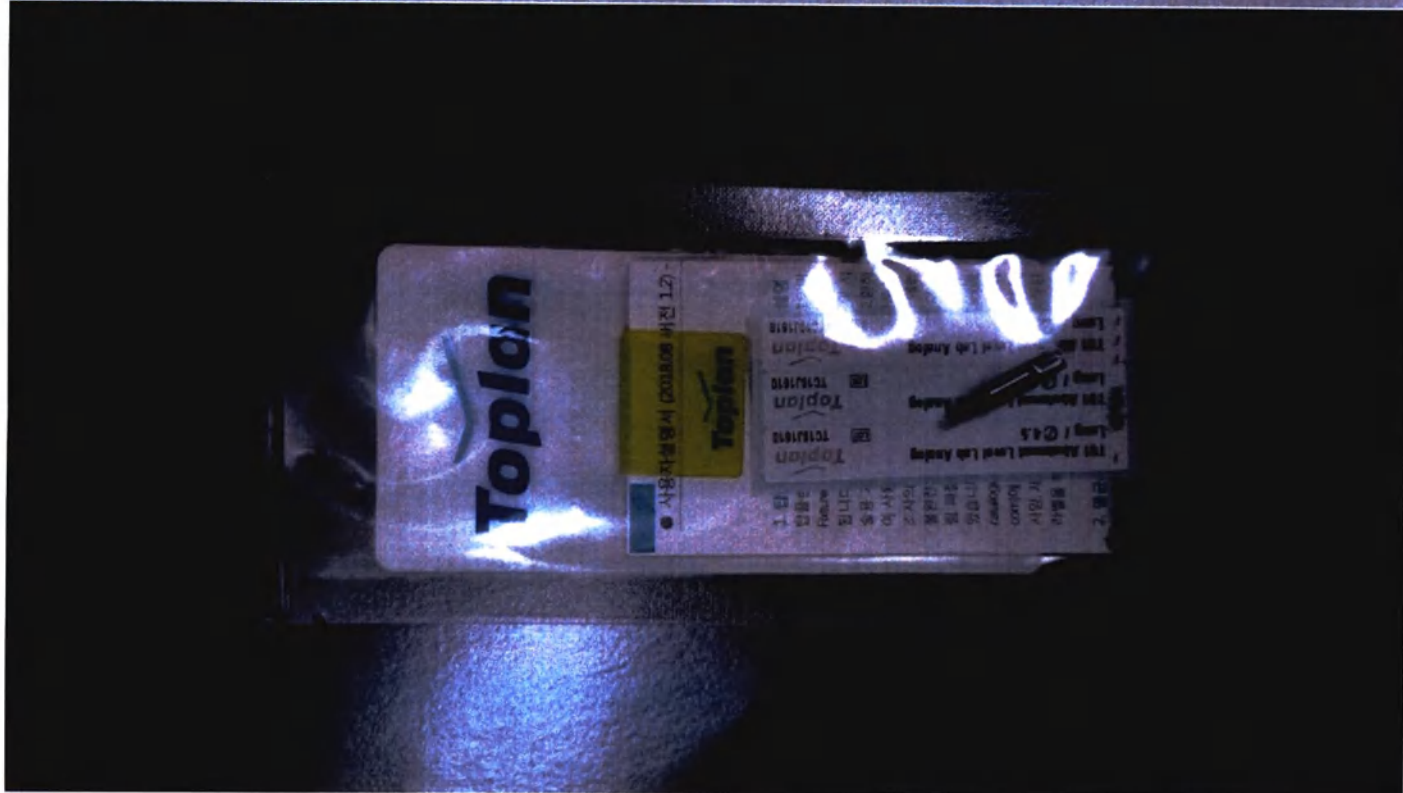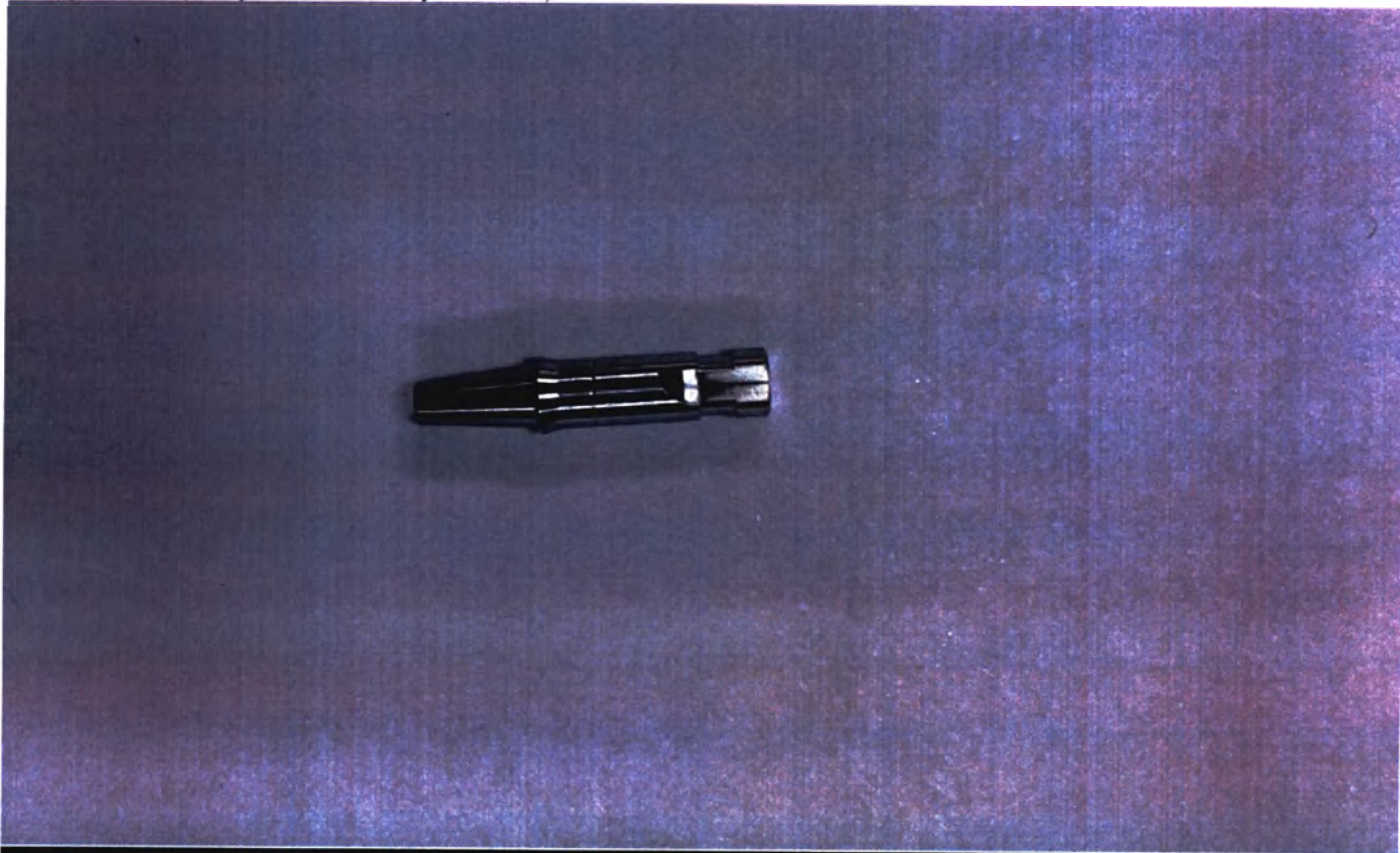

Примечание:

Лабораторный аналог на уровне абатмента T01 (T01 Abutment Level Lab Analog) (T01ALLA55L) имеет похожий внешний вид, отличие в размерах.

Лабораторный аналог Port (T01 Port Component Lab Analog), T01PTCLA40, Ø4.0 / 10.0мм (H)
(без упаковки и в первичной упаковке)

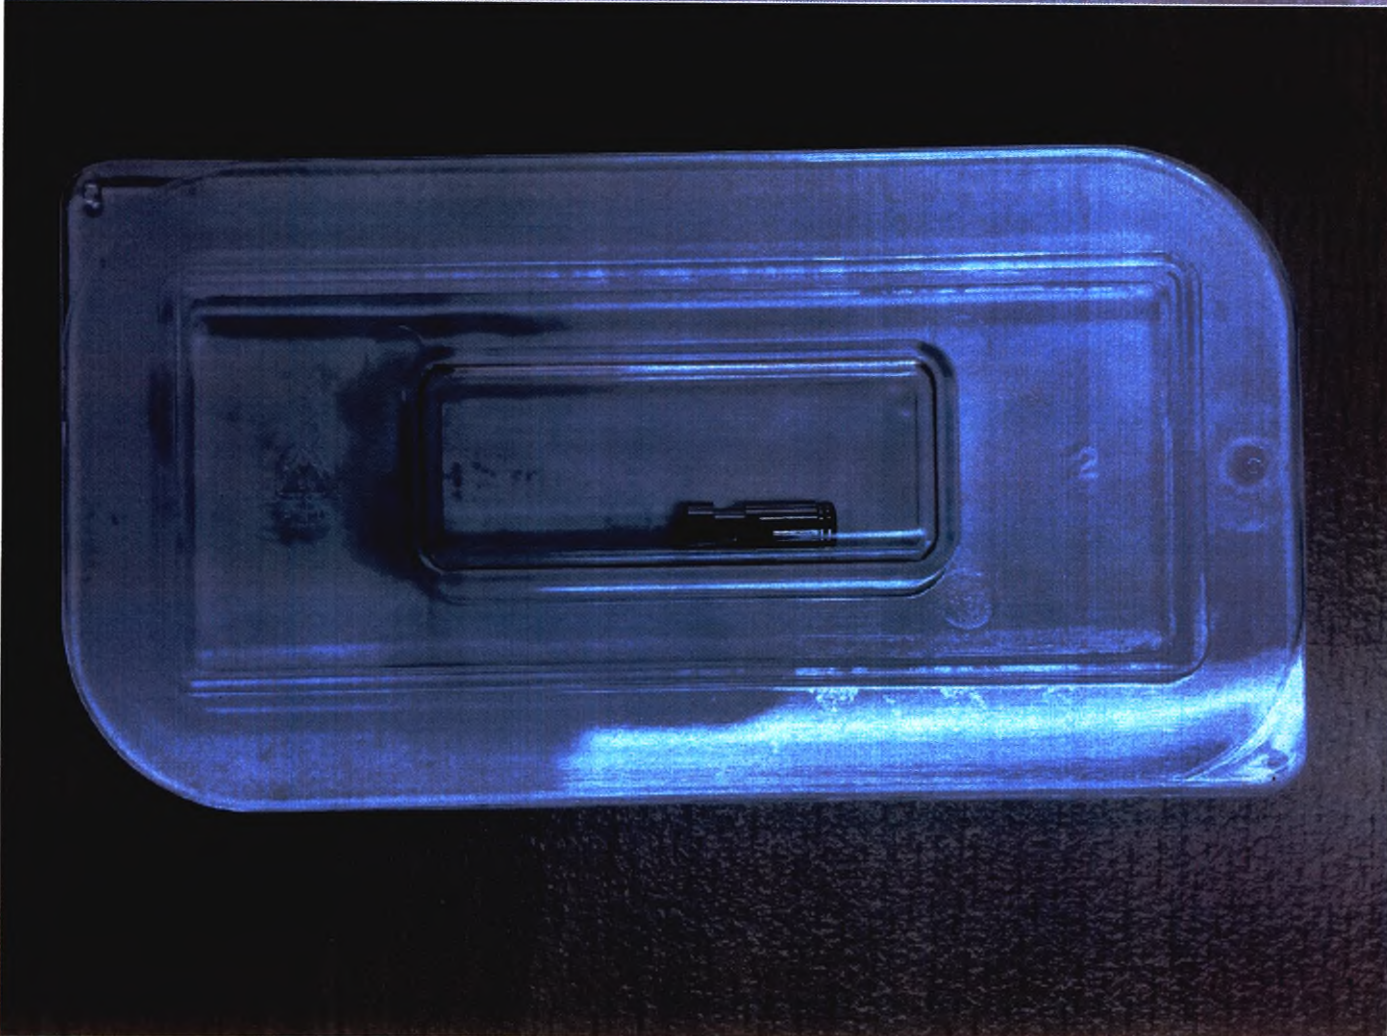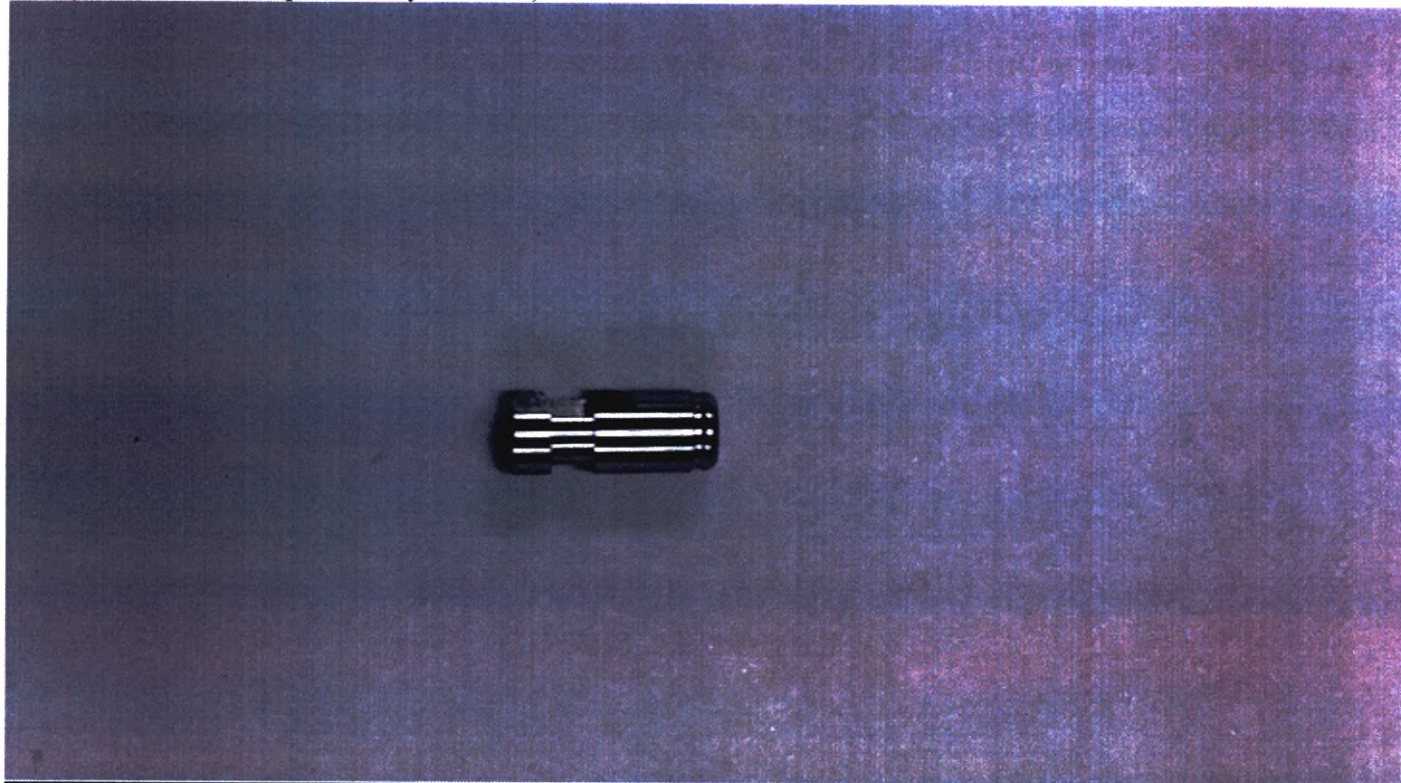


Примечание:

Лабораторный аналог Port (T01 Port Component Lab Analog) (T01PTCLA50) имеют похожий внешний вид, отличие в размерах.


Упаковка слепочного модуля для оттиска на уровне абатмента (T01 Abutment Level Impression Coping), лабораторного аналога на уровне абатмента T01 (T01 Abutment Level Lab Analog)

- на примере Слепочного модуля для оттиска на уровне абатмента (T01 Abutment Level Impression Coping), T01ALIC45, White / Ø4.5

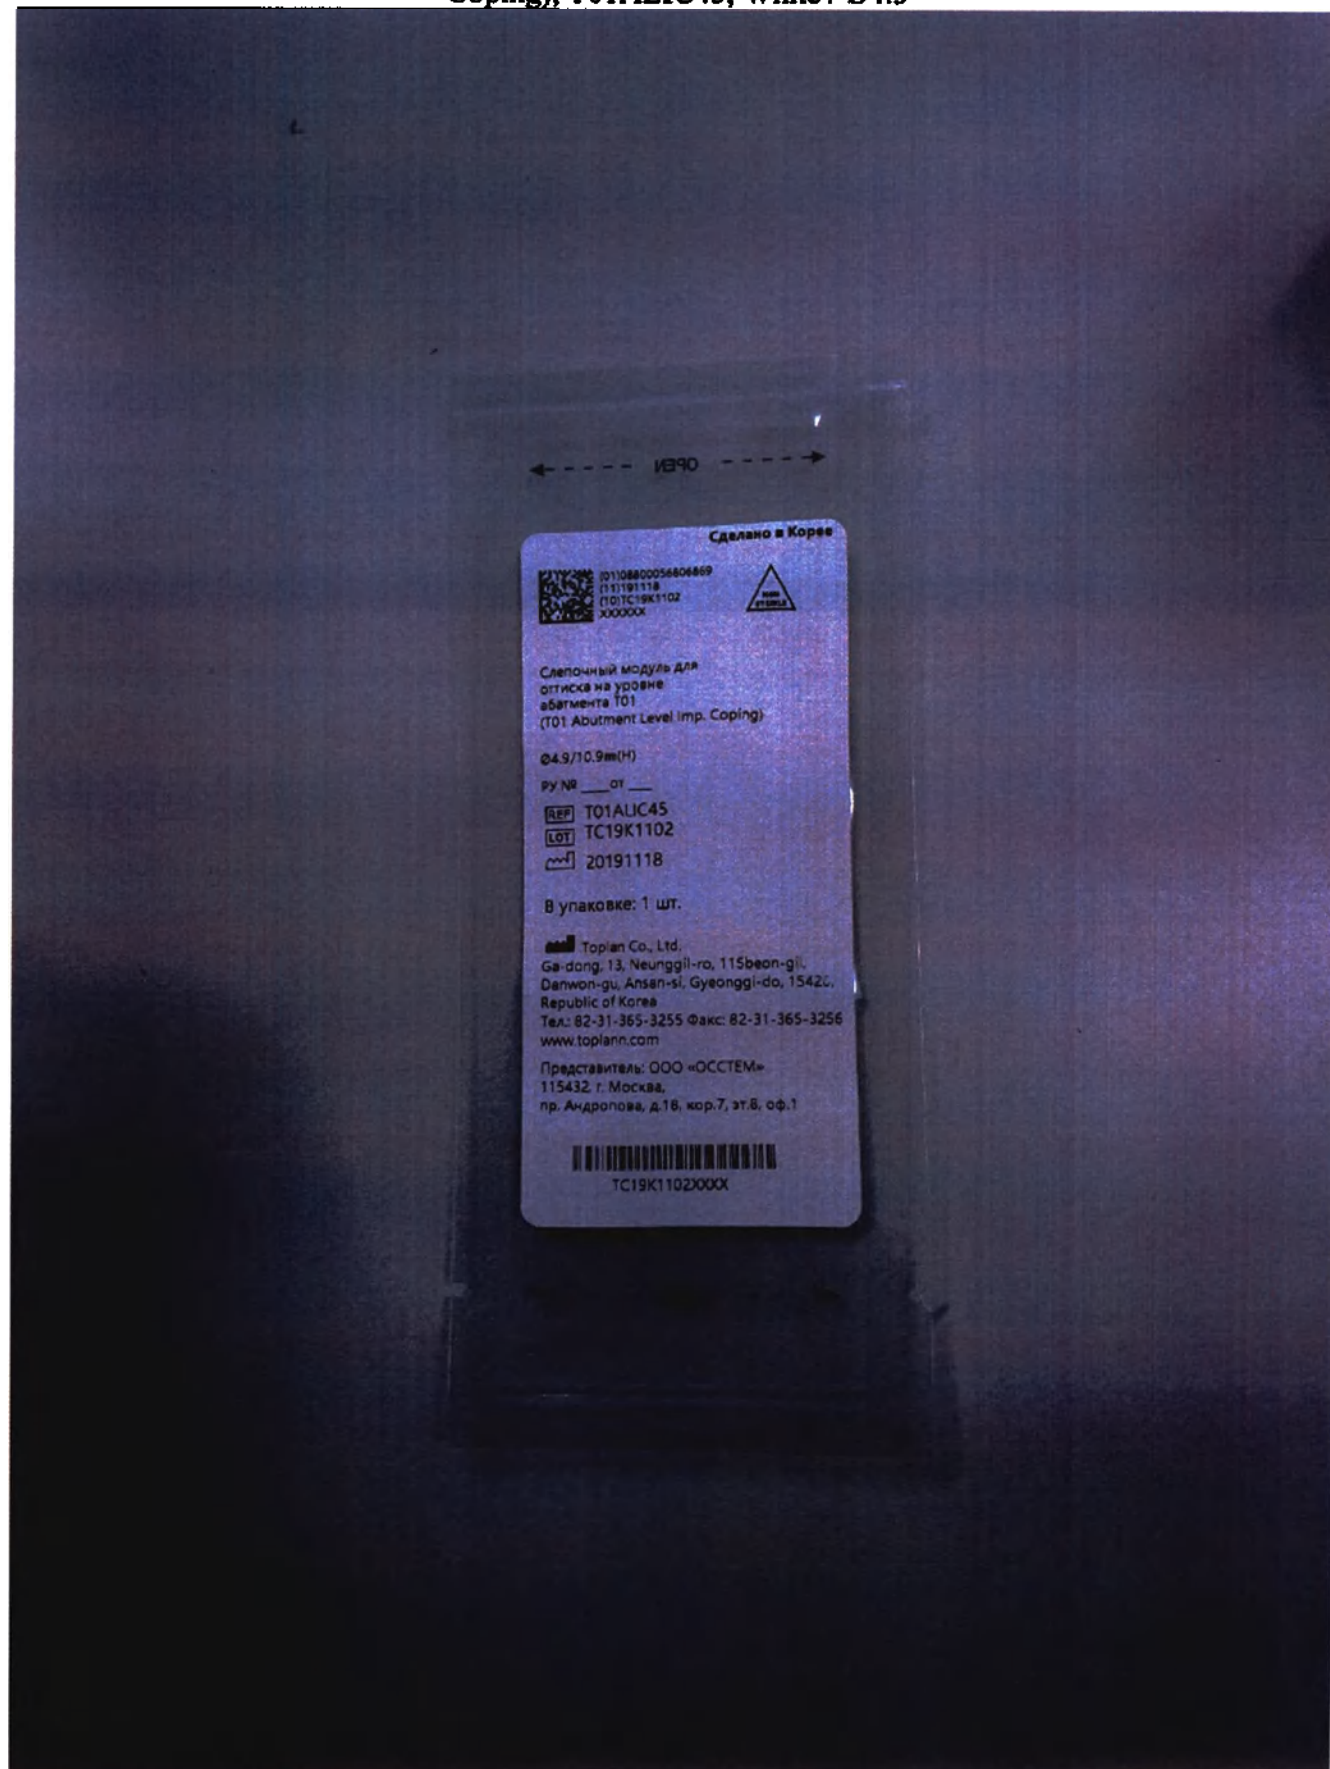

Упаковки направляющего пина для слепочного модуля для открытой ложки T01 (T01 Pick up Impression Coping Guide Pin), направляющего пина для слепочного модуля для открытой ложки T02 (T02 Pick up Impression Coping Guide Pin), направляющего пина для слепочного модуля для закрытой ложки T01 (T01 Transfer Impression Coping Guide Pin), направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T02 (T02 Transfer Impression Coping Guide Pin), слепочного модуля для открытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Pick up Impression Coping Set), слепочного модуля для открытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Pick up Impression Coping Set), слепочного модуля для закрытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Transfer Impression Coping Set), слепочного модуля для закрытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Transfer Impression Coping Set), лабораторного аналога (Lab Analog), лабораторного аналога Port (T01 Port Component Lab Analog)

- на примере направляющего пина для слепочного модуля для открытой ложки T01 (T01 Pick up Impression Coping Guide Pin), T01PICGS, Short / 11.0мм (L)

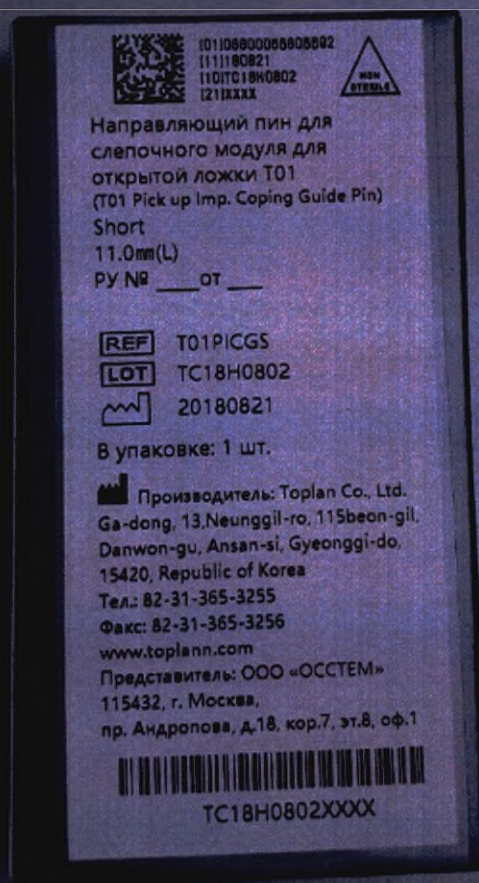

Маркировка на русском языке

- Слепочный модуль для оттиска на уровне абатмента (T01 Abutment Level Impression Coping)
- Лабораторный аналог (Lab Analog)
- Лабораторный аналог на уровне абатмента T01 (T01 Abutment Level Lab Analog)
- Лабораторный аналог Port (T01 Port Component Lab Analog)
- Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T01 (T01 Pick up Impression Coping Guide Pin)
- Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T01 (T01 Transfer Impression Coping Guide Pin)
- Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T02 (T02 Pick up Impression Coping Guide Pin)
- Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T02 (T02 Transfer Impression Coping Guide Pin)
- Слепочный модуль для открытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Pick up Impression Coping Set)
- Слепочный модуль для закрытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Transfer Impression Coping Set)
- Слепочный модуль для открытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Pick up Impression Coping Set)
- Слепочный модуль для закрытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Transfer Impression Coping Set)

Маркировка на русском языке

Слепочный модуль для оттиска на уровне абатмента	Лабораторный аналог	Лабораторный аналог на уровне абатмента T01	Лабораторный аналог Port
← OPEN → Сделано в Корее  ID1098000056800363 (11)181207 (17)201210 (10)T18-2008 (21)0005  Слепочный модуль для оттиска на уровне абатмента (T01 Abutment Level Impression Coping) White Ø3.0 Ø4.0 Р/У № _____ от _____ REF T01ALIC40 LOT TC21L2103 20211214 В упаковке: 1 шт. Toplan Co., Ltd., Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Тел.: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1  TC21L2103XXXX ← OPEN →	HSN Lab Analog Ø4.5/12.0mm(H)  ID1098000056800363 (11)181207 (17)201210 (10)T18-2008 (21)0005  Лабораторный аналог Ø4.5/12.0mm(H) Р/У № _____ от _____ REF T01LA LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Тел.: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1  TA19H0201XXXX Lab Analog Ø4.5/12.0mm(H)	← OPEN → Сделано в Корее  ID1098000056800363 (11)181207 (17)201210 (10)T18-2008 (21)0005  Лабораторный аналог на уровне абатмента T01 (T01 Abutment Level Lab Analog) Middle / Ø4.5 Р/У № _____ от _____ REF T01ALLA45M LOT TC21L2103 20211214 В упаковке: 1 шт. Toplan Co., Ltd., Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Тел.: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, к ор. 7, эт. 8, оф. 1  TC21L2103XXXX ← OPEN →	HSN Port Component Lab Analog Ø4.0/10.0mm(H)  ID1098000056800363 (11)181207 (17)201210 (10)T18-2008 (21)0005  Лабораторный аналог Port Ø4.0/10.0mm(H) Р/У № _____ от _____ REF T01PTCLA40 LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Тел.: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1  TA19H0201XXXX Port Component Lab Analog Ø4.0/10.0mm(H)

Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T01	Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T01	Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T02	Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T02
HSN# T01 Pick up Imp. Coping Guide Pin 15.0mm(L)  Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T01 (T01 Pick up Impression Coping Guide Pin) Long/15.0mm(L) ПУ № _____ от _____ REF T01PICGL LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel. 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 TA19H0201XXXX T01 Pick up Imp. Coping Guide Pin 15.0mm(L)	HSN# T01 Transfer Imp. Coping Guide Pin 15.0mm(L)  Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T01 (T01 Transfer Impression Coping Guide Pin) Long/15.0mm(L) ПУ № _____ от _____ REF T01TICGL LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel. 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 TA19H0201XXXX T01 Transfer Imp. Coping Guide Pin 15.0mm(L)	HSN# T02 Pick up Imp. Coping Guide Pin 15.0mm(L)/1.2Hex  Направляющий пин для слепочного модуля для открытой ложки T02 (T02 Pick up Impression Coping Guide Pin) Long/15.0mm(L)/1.2Hex ПУ № _____ от _____ REF T02PICGL12 LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel. 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 TA19H0201XXXX T02 Pick up Imp. Coping Guide Pin 15.0mm(L)/1.2Hex	HSN# T02 Transfer Imp. Coping Guide Pin 15.0mm(L)/1.2Hex  Направляющий пин для слепочного модуля для закрытой ложки T02 (T02 Transfer Impression Coping Guide Pin) Long/15.0mm(L)/1.2Hex ПУ № _____ от _____ REF T02TICGL12 LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel. 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 TA19H0201XXXX T02 Transfer Imp. Coping Guide Pin 15.0mm(L)/1.2Hex

Слепочный модуль для открытой ложки T01 с направляющим пином T01	Слепочный модуль для закрытой ложки T01 с направляющим пином T01	Слепочный модуль для открытой ложки T01 с направляющим пином T02	Слепочный модуль для закрытой ложки T01 с направляющим пином T02
HSNд T01 Pick up Imp. Coping Set Ø4.0/11.0mm(L)  Слепочный модуль для открытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Pick up Impression Coping Set) Hex Long/15.0mm(L) ПУ № _____ от _____ REF T01PIC4011TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 TA19H0201XXXX T01 Pick up Imp. Coping Set Ø4.0/11.0mm(L)	HSNд T01 Transfer Imp. Coping Set Ø4.0/11.0mm(L)  Слепочный модуль для закрытой ложки T01 с направляющим пином T01 (T01 Transfer Impression Coping Set) Hex Long/15.0mm(L) ПУ № _____ от _____ REF T01TIC4011TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 TA19H0201XXXX T01 Transfer Imp. Coping Set Ø4.0/11.0mm(L)	HSNд T02 Pick up Imp. Coping Set Ø4.0/11.0mm(L)/1.2Hex  Слепочный модуль для открытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Pick up Impression Coping Set) Hex Long/15.0mm(L)/1.2Hex ПУ № _____ от _____ REF T02PIC4011TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 TA19H0201XXXX T02 Pick up Imp. Coping Set Ø4.0/11.0mm(L)/1.2Hex	HSNд T02 Transfer Imp. Coping Set Ø4.0/11.0mm(L)/1.2Hex  Слепочный модуль для закрытой ложки T01 с направляющим пином T02 (T02 Transfer Impression Coping Set) Hex Long/15.0mm(L)/1.2Hex ПУ № _____ от _____ REF T02TIC4011TH LOT TA19H0201 2019.08.02 В упаковке: 1 шт. Производитель: Toplan Co., Ltd. Ga-dong, 13, Neunggil-ro, 115beon-gil, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, 15420, Republic of Korea Tel: 82-31-365-3255 Факс: 82-31-365-3256 www.toplann.com Представитель: ООО «ОССТЕМ» 115432, г. Москва, пр. Андропова, д. 18, кор. 7, эт. 8, оф. 1 TA19H0201XXXX T02 Transfer Imp. Coping Set Ø4.0/11.0mm(L)/1.2Hex

Всего прошито, пронумеровано
и скреплено печатью

29 (двадцать девять) листов
цифрами прописью

Должность ген. директор

Подпись А. М. [подпись] / И. Ч. [подпись] /

« 01 » 11 20 23 г.

