



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО ТС
Д.Н. Хрипковский
«05» сентября 2024 г.



ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ
СИСТЕМА ИНФРАКРАСНАЯ ТЕРМОГРАФИЧЕСКАЯ ТВС600 (ТЕПЛОВИЗОР ТВС600)
ПО ТУ 26.60.12-002-94107649-2023



Тепловизор, модель ТВС600 (основной вид и вид со стороны разъема, с маркировкой)

ООО "Тепловизионные системы"
Система инфракрасная термографическая
ТВС600 (Тепловизор ТВС600)
по ТУ 26.60.12-002-94107649-2023



003 / 06.2023 =3...5В / 1,2 Вт /




Маркировка (шильдик) Тепловизора




Специализированный адаптер USB2.0 (внешний вид с двух сторон с маркировкой)




Кабель питания/передачи данных

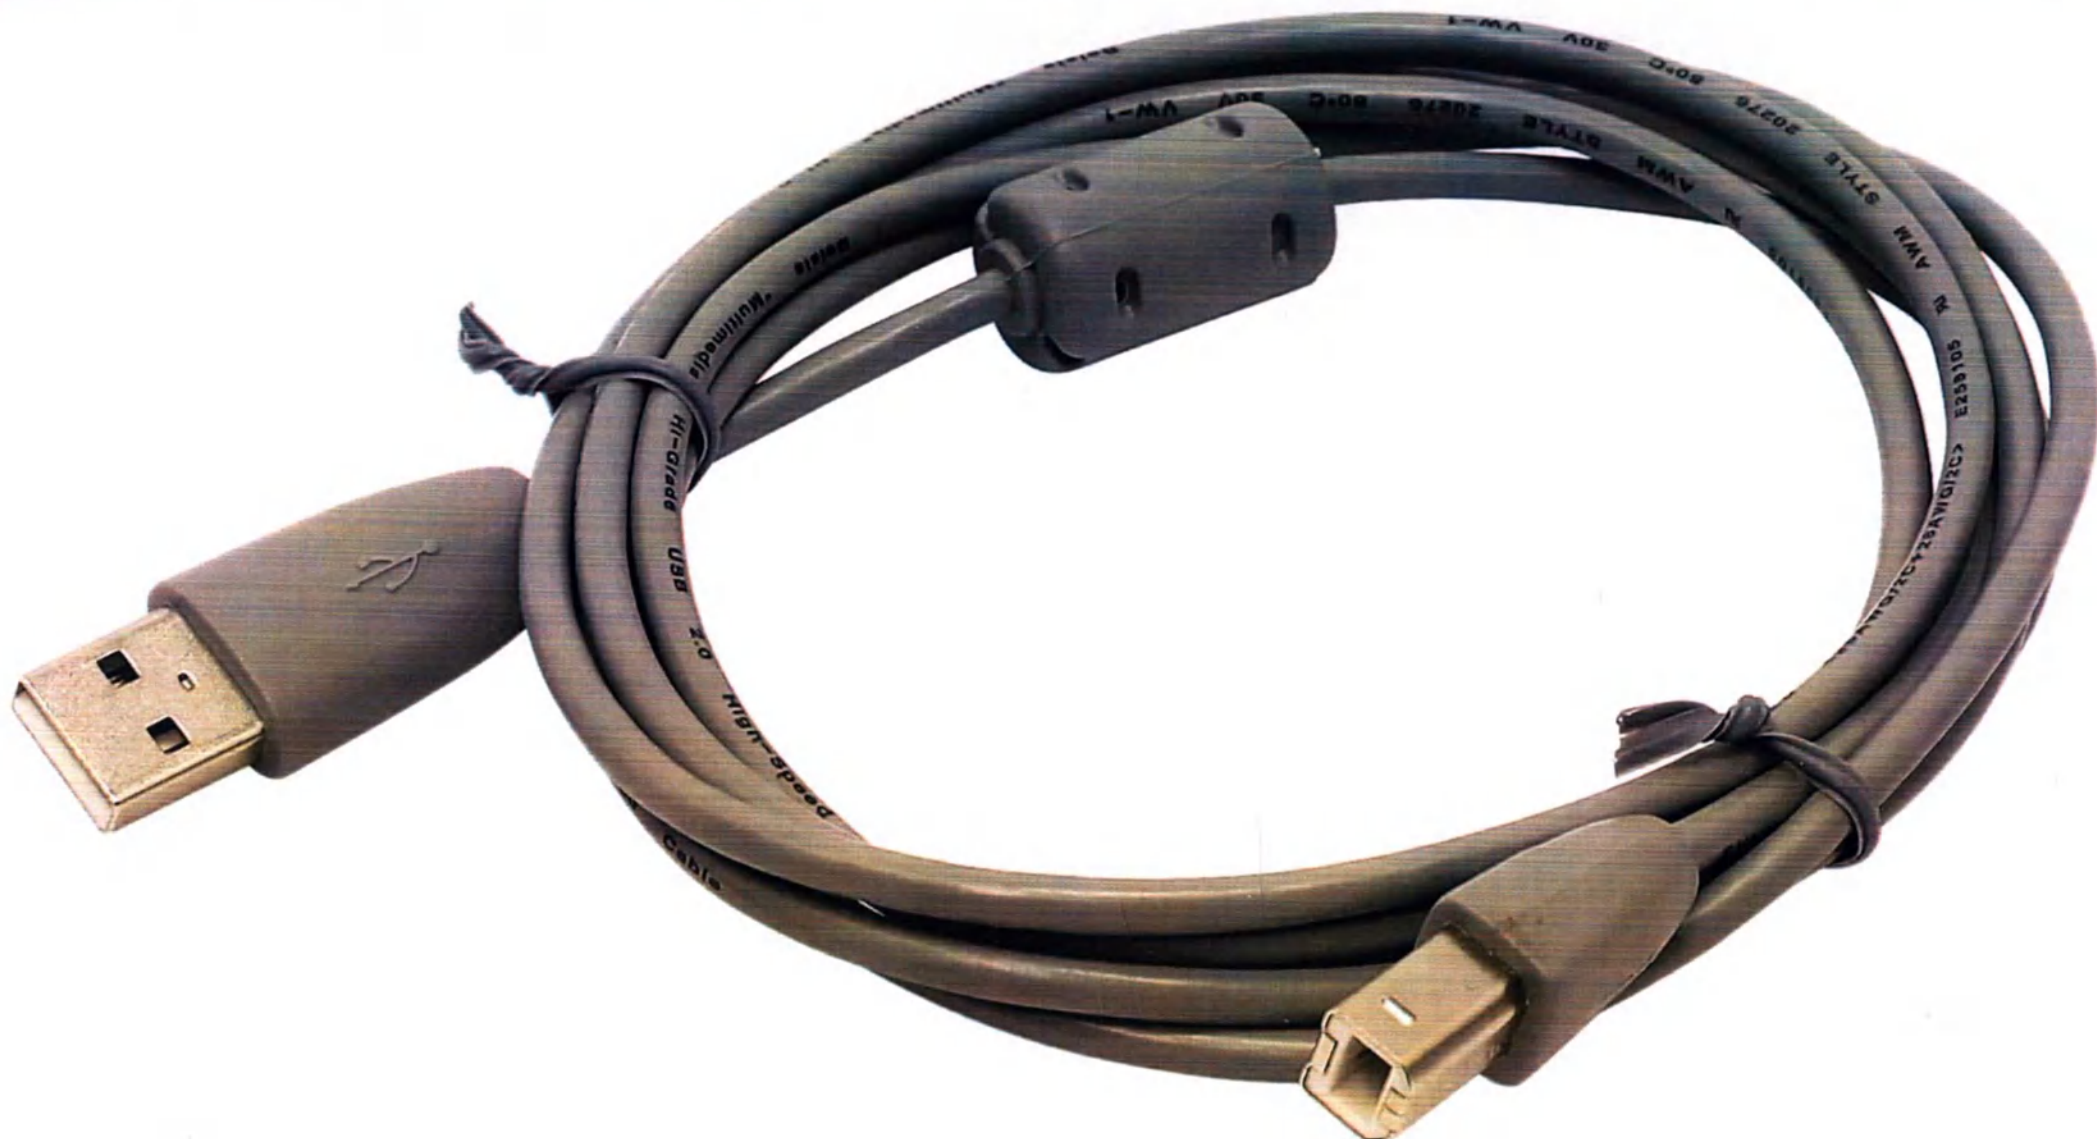

Кабель USB2.0.

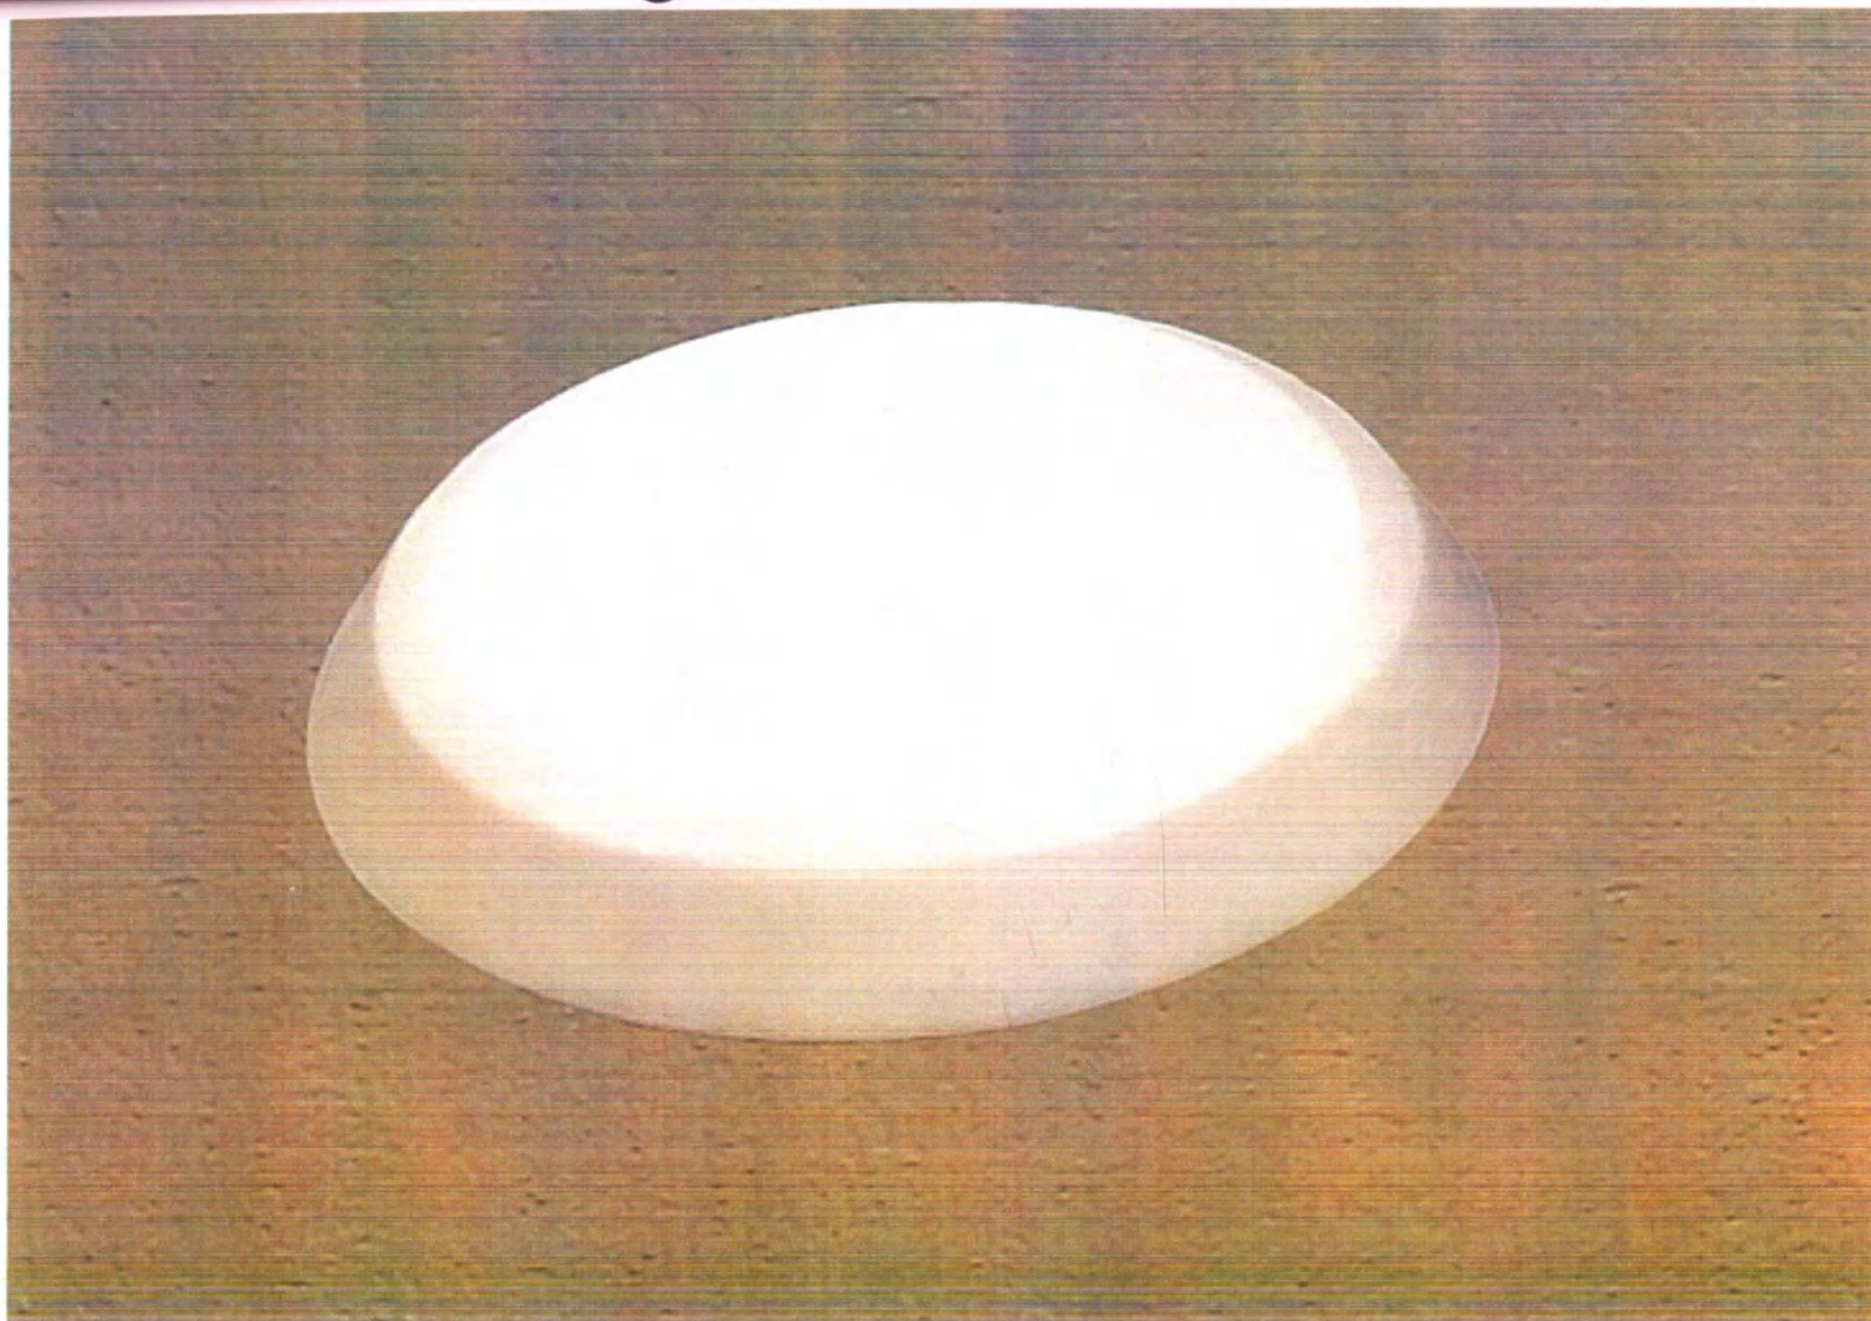

Защитная крышка объектива

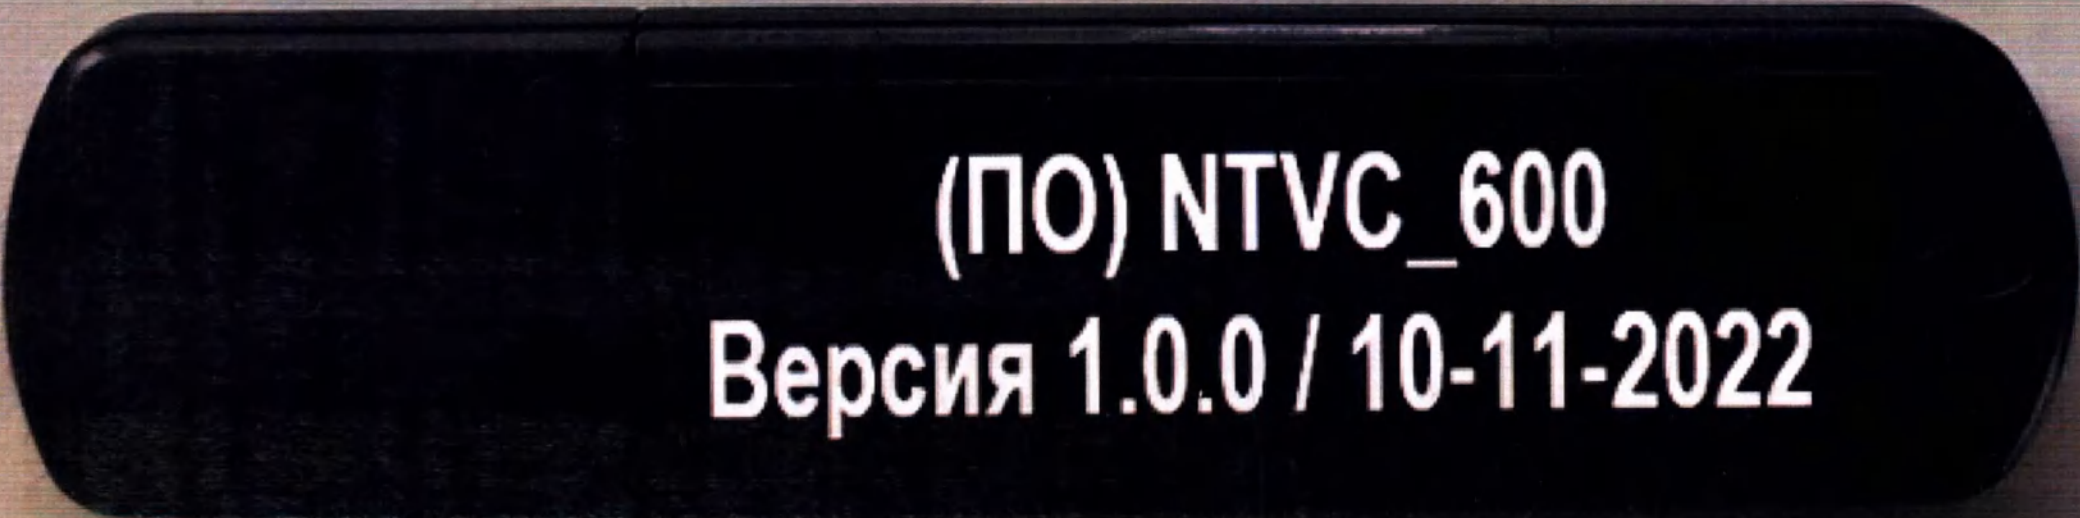

(ПО) NTVС_600
Версия 1.0.0 / 10-11-2022

Электронный носитель информации с программным обеспечением тепловизора (пример внешнего вида)

Штатив





Кейс для хранения и переноски Тепловизора



Система инфракрасная термографическая ТВС600 (Тепловизор ТВС600)
по ТУ 26.60.12-002-94107649-2023

ООО «Тепловизионные системы»

Лукинская, д.1, к.213, Москва, Россия, 119634
Тел. +7 (495) 508-06-46, e-mail: thermotest@yandex.ru www.thermography.ru

Дата упаковки: 2023.10

ТВС 600

ООО «Тепловизионные системы»

Маркировка Кейса для хранения и переноски тепловизора (проект)



Система инфракрасная термографическая ТВС600 (Тепловизор ТВС600) по ТУ 26.60.12-002-94107649-2023 в полном составе



Внешний вид транспортной тары с маркировкой

Всё прочитано, пронумеровано
и скреплено печатью 15 (Пятнадцать)
листов

Генеральный директор ООО, *И.С.*
Кричевский Д. У.

