

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие для in vitro диагностики:

«Набор реагентов для быстрого количественного определения микроальбумина (Microalbumin) иммунофлуоресцентным методом в моче на анализаторе Novatrend™ (Novatrend Fluorescence Immunoassay Microalbumin Test Kit), в вариантах исполнения»

Рисунок 1. Общий вид МИ, вариант исполнения I

2



Рисунок 2 Общий вид МИ, вариант исполнения II





Рисунок 3. Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения I



Рисунок 4 Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения II



Рисунок 5. Первичная упаковка тест-кассеты (Microalbumin Test Cassette), тест-кассета (Microalbumin Test Cassette), осушитель

Рисунок 6. Первичная упаковка тест-кассеты (Microalbumin Test Cassette)



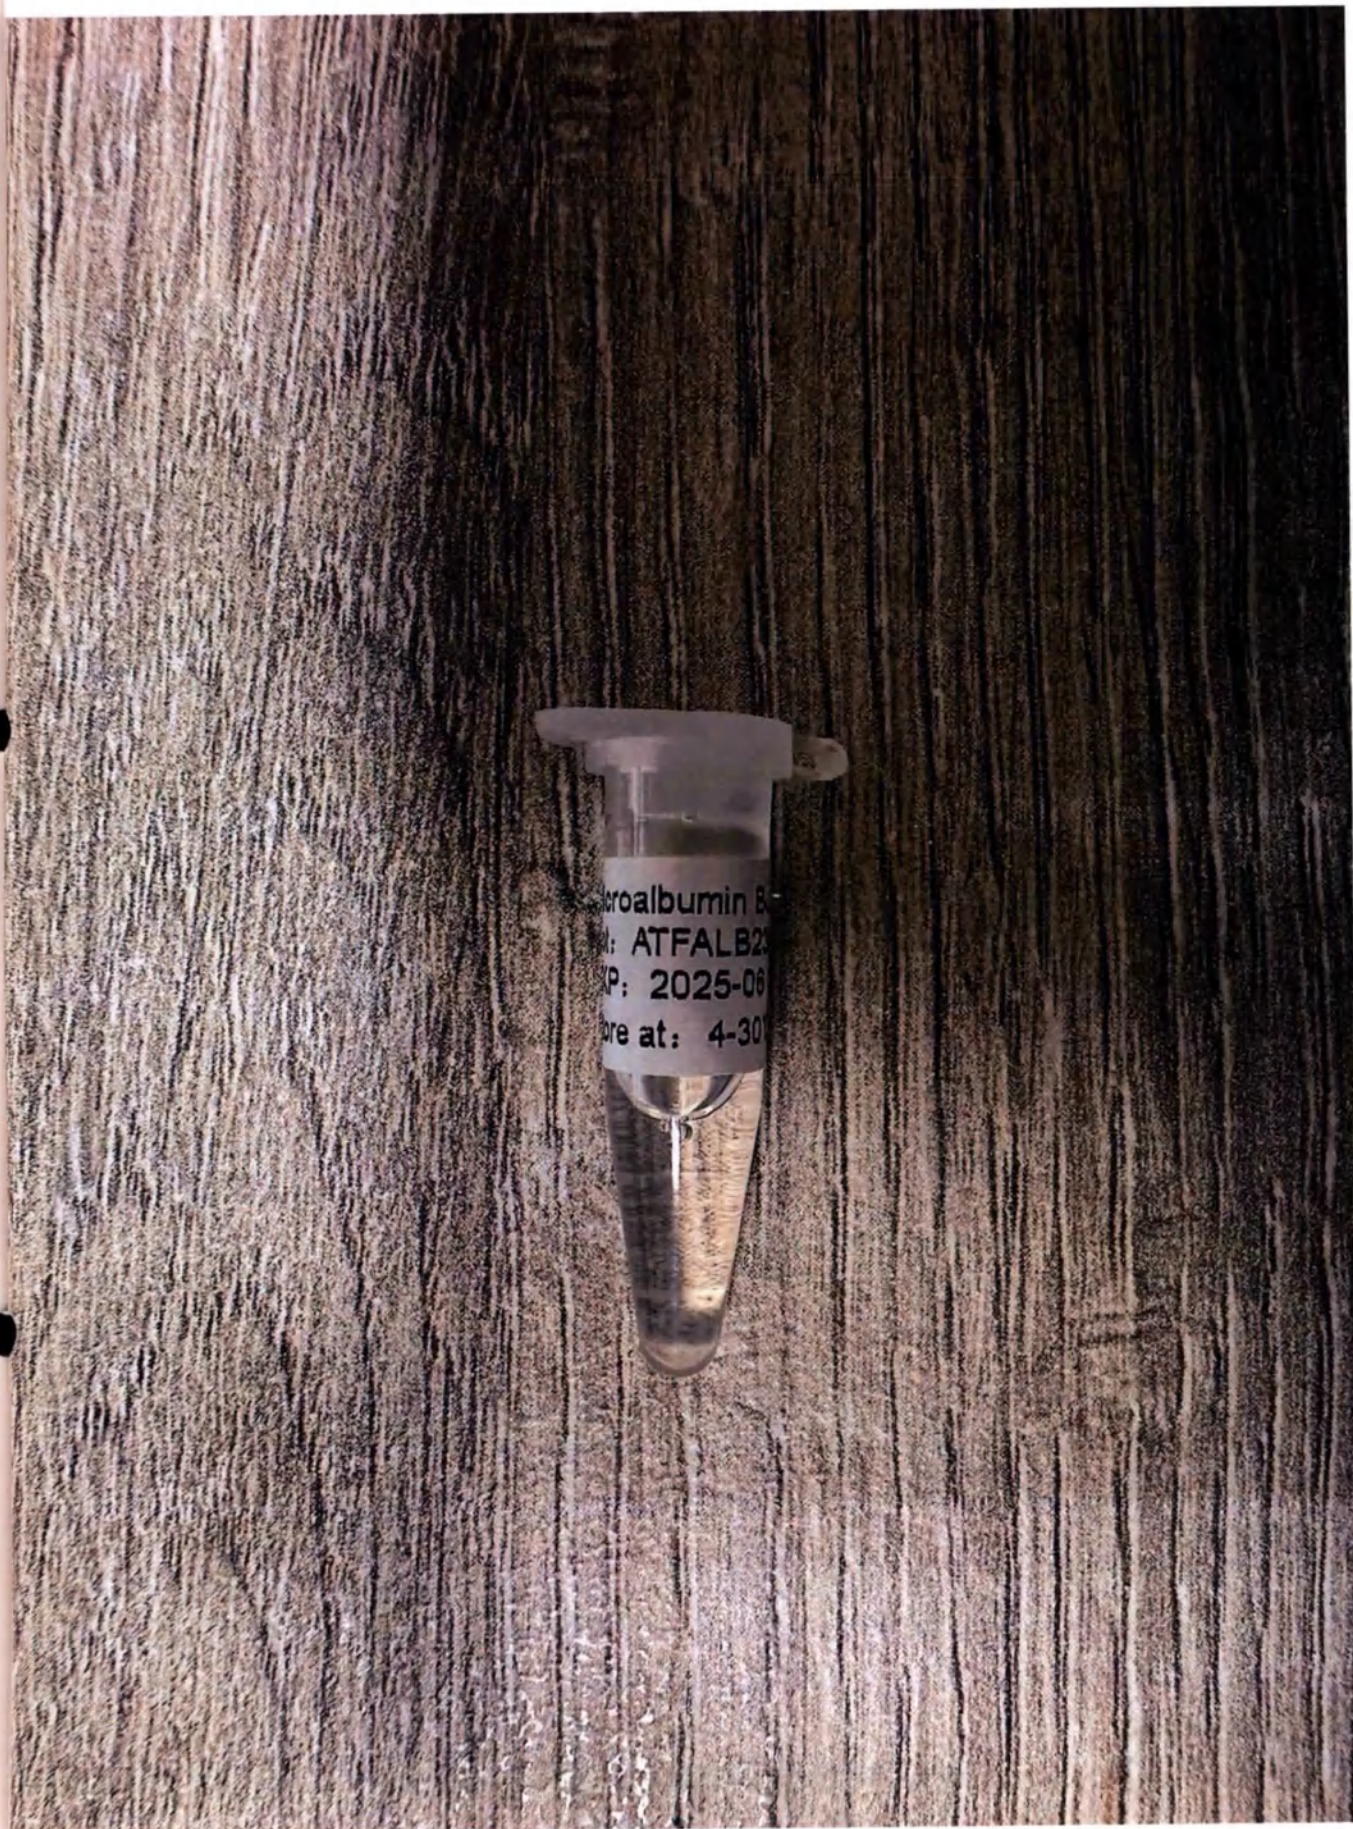


Рисунок 7. Пробирка с буфером для разведения образцов

Рисунок 8. Вторичная упаковка буфера (zip-пакет)





Рисунок 9. Идентификационная карта



Рисунок 10. Первичная упаковка идентификационной карты (zip-пакет)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ**

«Набор реагентов для быстрого количественного определения микроальбумина (Microalbumin) иммунофлуоресцентным методом в моче на анализаторе Novatrend™ (Novatrend Fluorescence Immunoassay Microalbumin Test Kit), в вариантах исполнения»

Производитель

“Ханчжоу Олвест Биотек Ко., Лтд.” (Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.), КНР

Адрес: 550#, Yinhai Street, Hangzhou Economic and Technological Development Area, 310018 Hangzhou, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

Версия: 1.0

Дата последней редакции: февраль 2024

Рисунок 9. Инструкция по применению на медицинское изделие



ГЕН. ДИРЕКТОР
КУЗНЕЦОВА Д.В.

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
12 ЛИСТОВ