

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие для in vitro диагностики:

«Набор реагентов для быстрого количественного определения β 2-микроглобулина (β 2MG) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе NovatrendTM (Novatrend Fluorescence Immunoassay β 2MG Test Kit), в вариантах исполнения»

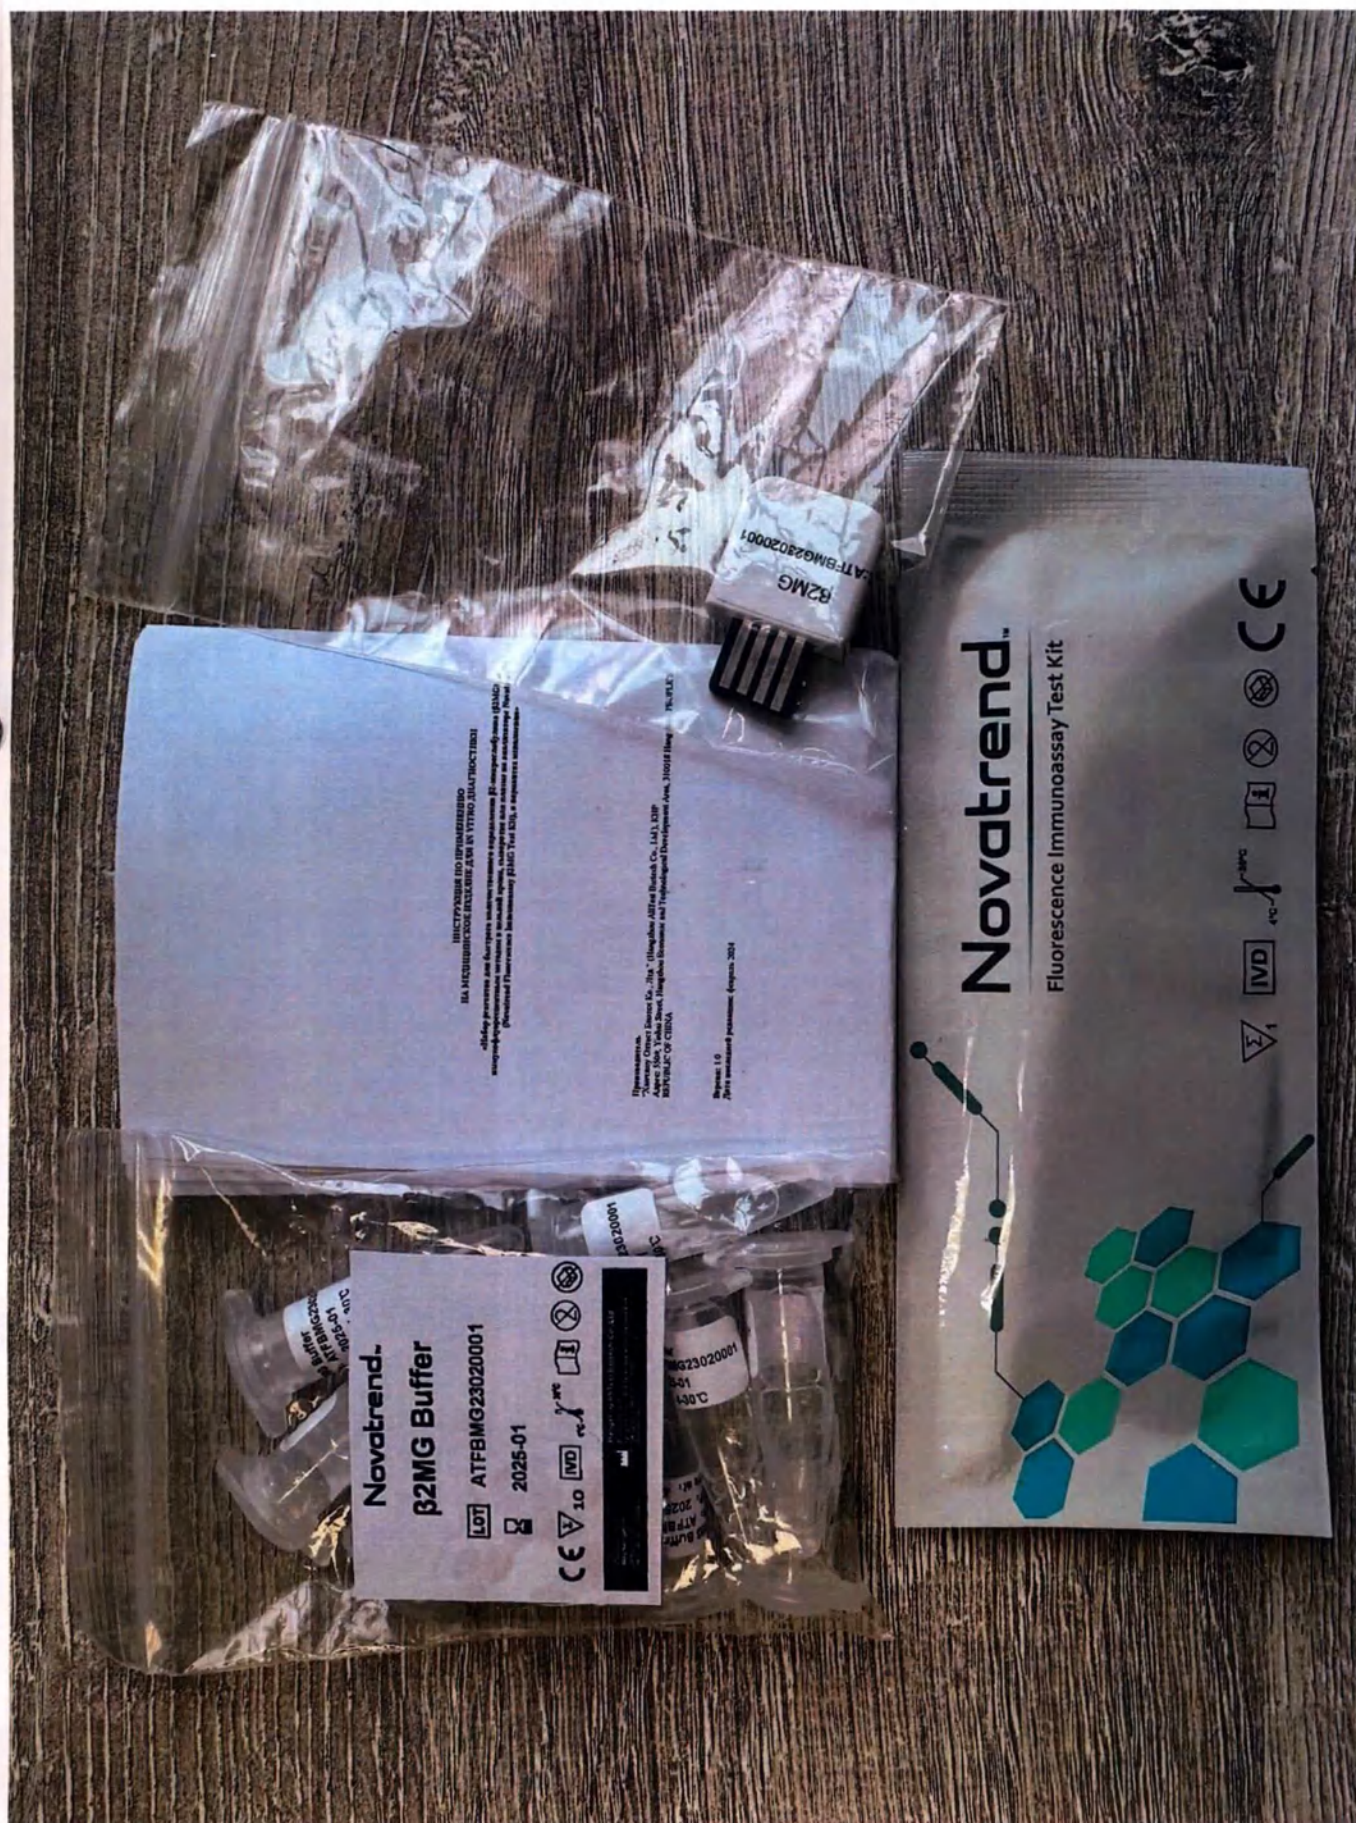


Рисунок 1. Общий вид МИ, вариант исполнения I



Рисунок 2 Общий вид МИ, вариант исполнения II

Рисунок 3. Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения I

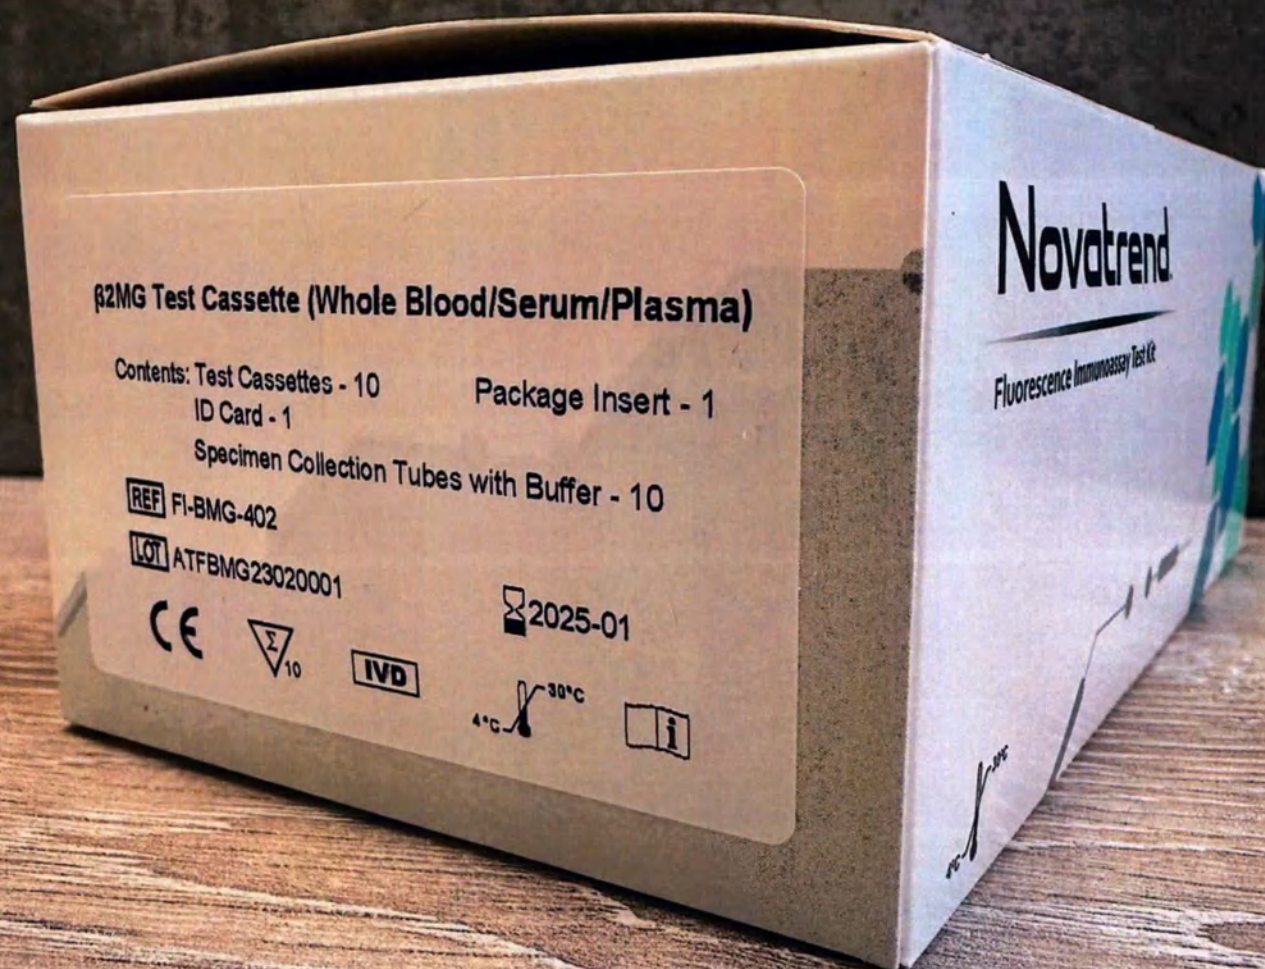
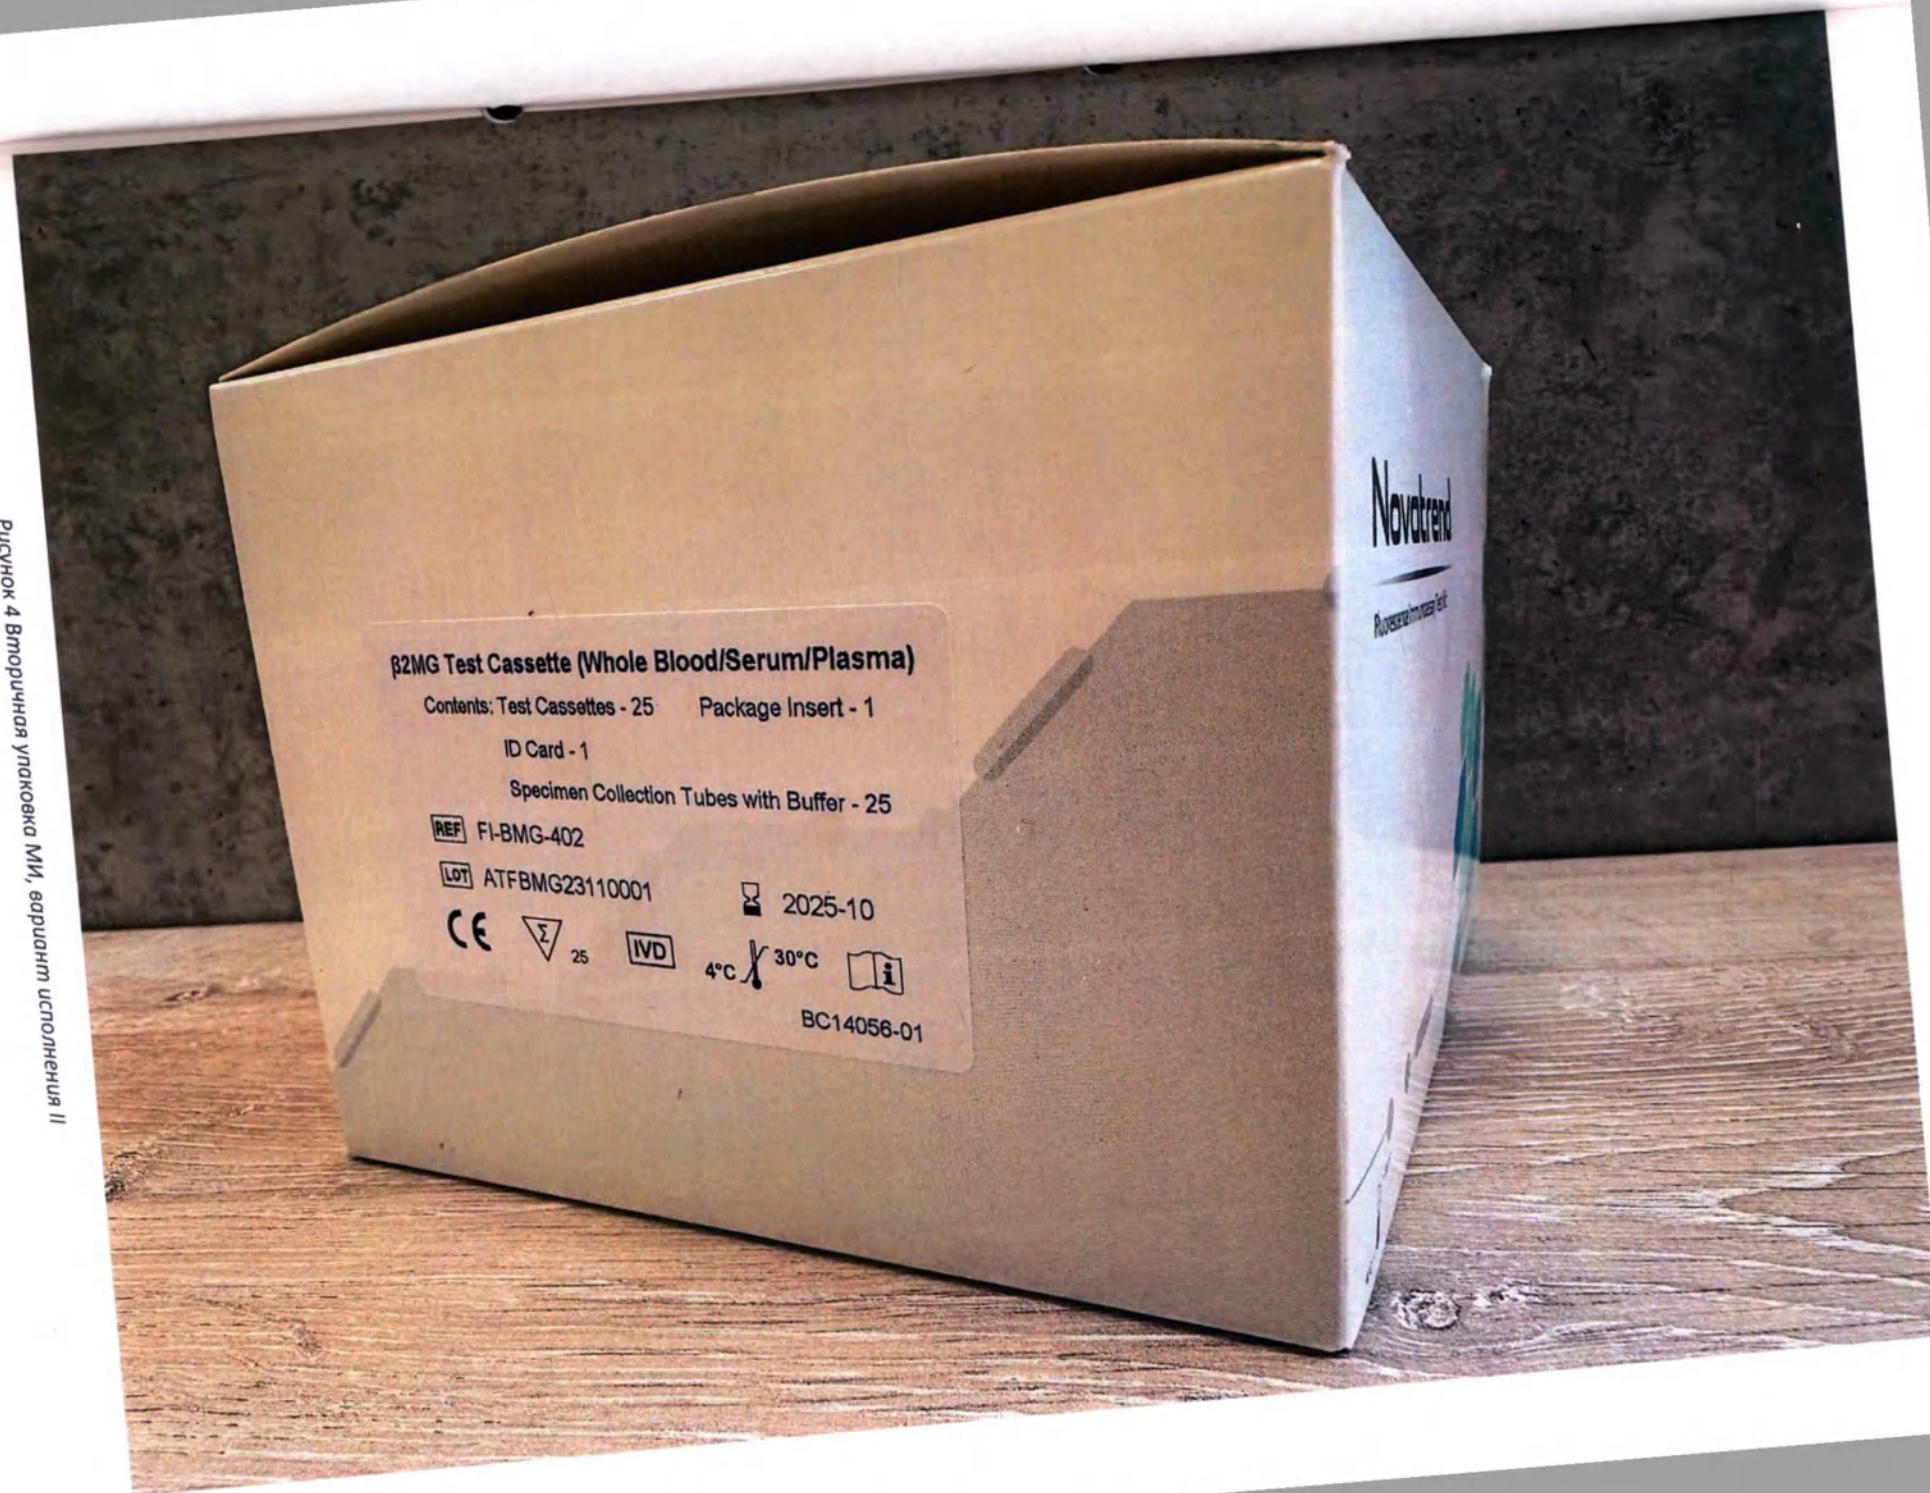


Рисунок 4 Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения II

5



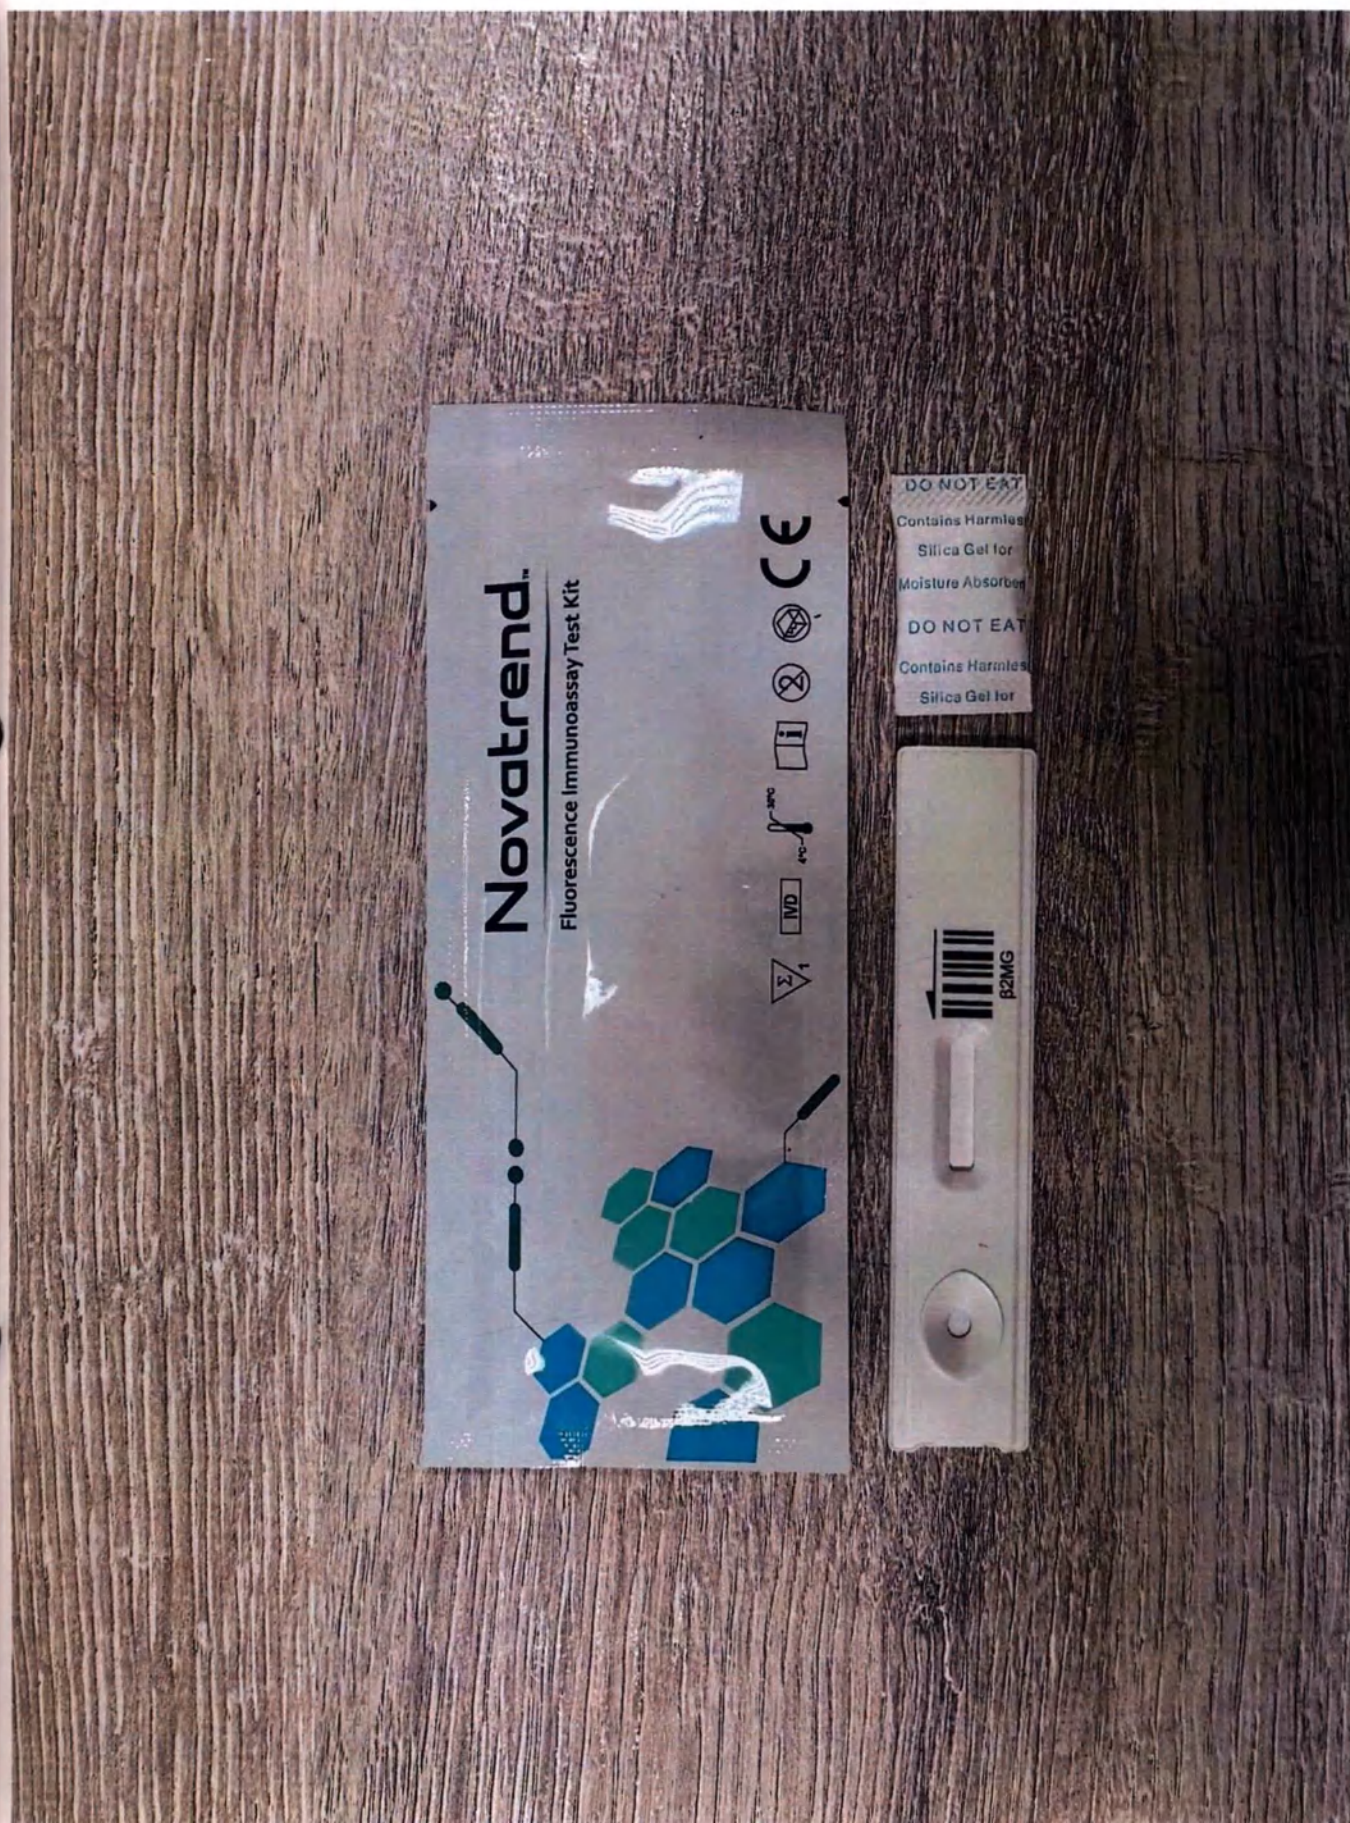


Рисунок 5. Первичная упаковка тест-кассеты (82MG Test Cassette), тест-кассета (82MG Test Cassette), осушитель

Рисунок 6. Первичная упаковка тест-кассеты (β2MG Test Cassette)





Рисунок 7. Пробирка с буфером для разведения образцов

Рисунок 8. Вторичная упаковка буфера (zip-пакет)

9

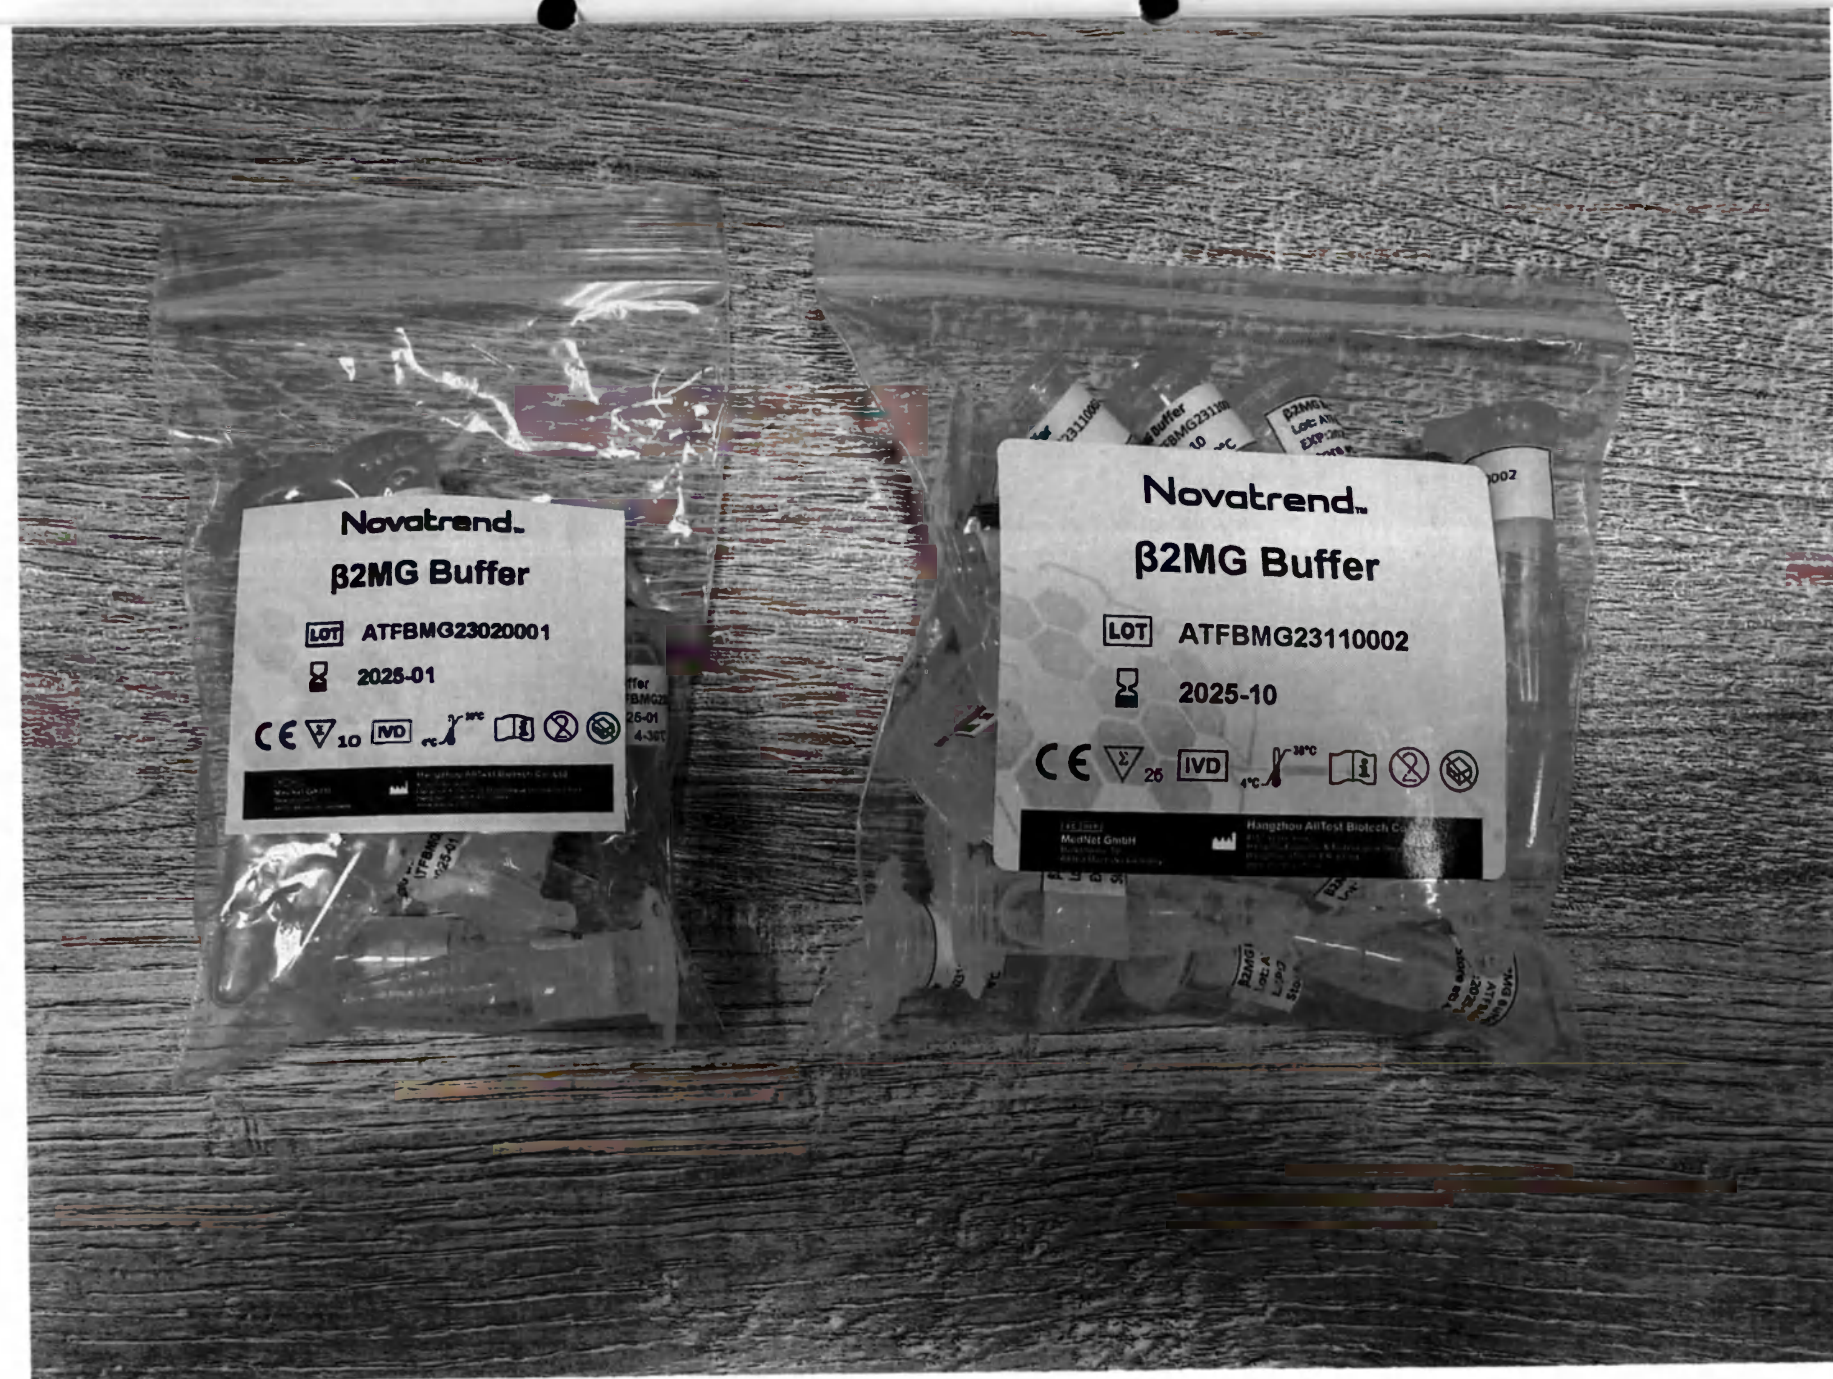




Рисунок 9. Идентификационная карта



Рисунок 10. Первичная упаковка идентификационной карты (zip-пакет)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ**

**«Набор реагентов для быстрого количественного определения β 2-микроглобулина (β 2MG)
иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе Novatrend™
(Novatrend Fluorescence Immunoassay β 2MG Test Kit), в вариантах исполнения»**

Производитель

«Ханчжоу Олтест Биотек Ко., Лтд.» (Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.), КНР
Адрес: 550#, Yinhai Street, Hangzhou Economic and Technological Development Area, 310018 Hangzhou, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

Версия: 1.0

Дата последней редакции: февраль 2024

Рисунок 9. Инструкция по применению на медицинское изделие



ГЕН. ДИРЕКТОР
КУЗНЕЦОВА Д.В.

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
12 ЛИСТОВ