

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

на медицинское изделие для in vitro диагностики:

«Набор реагентов для быстрого количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе Novatrend™ (Novatrend Fluorescence Immunoassay IL-6 Test Kit), в вариантах исполнения»



Рисунок 1. Общий вид МИ, вариант исполнения I



Рисунок 2 Общий вид МИ, вариант исполнения II

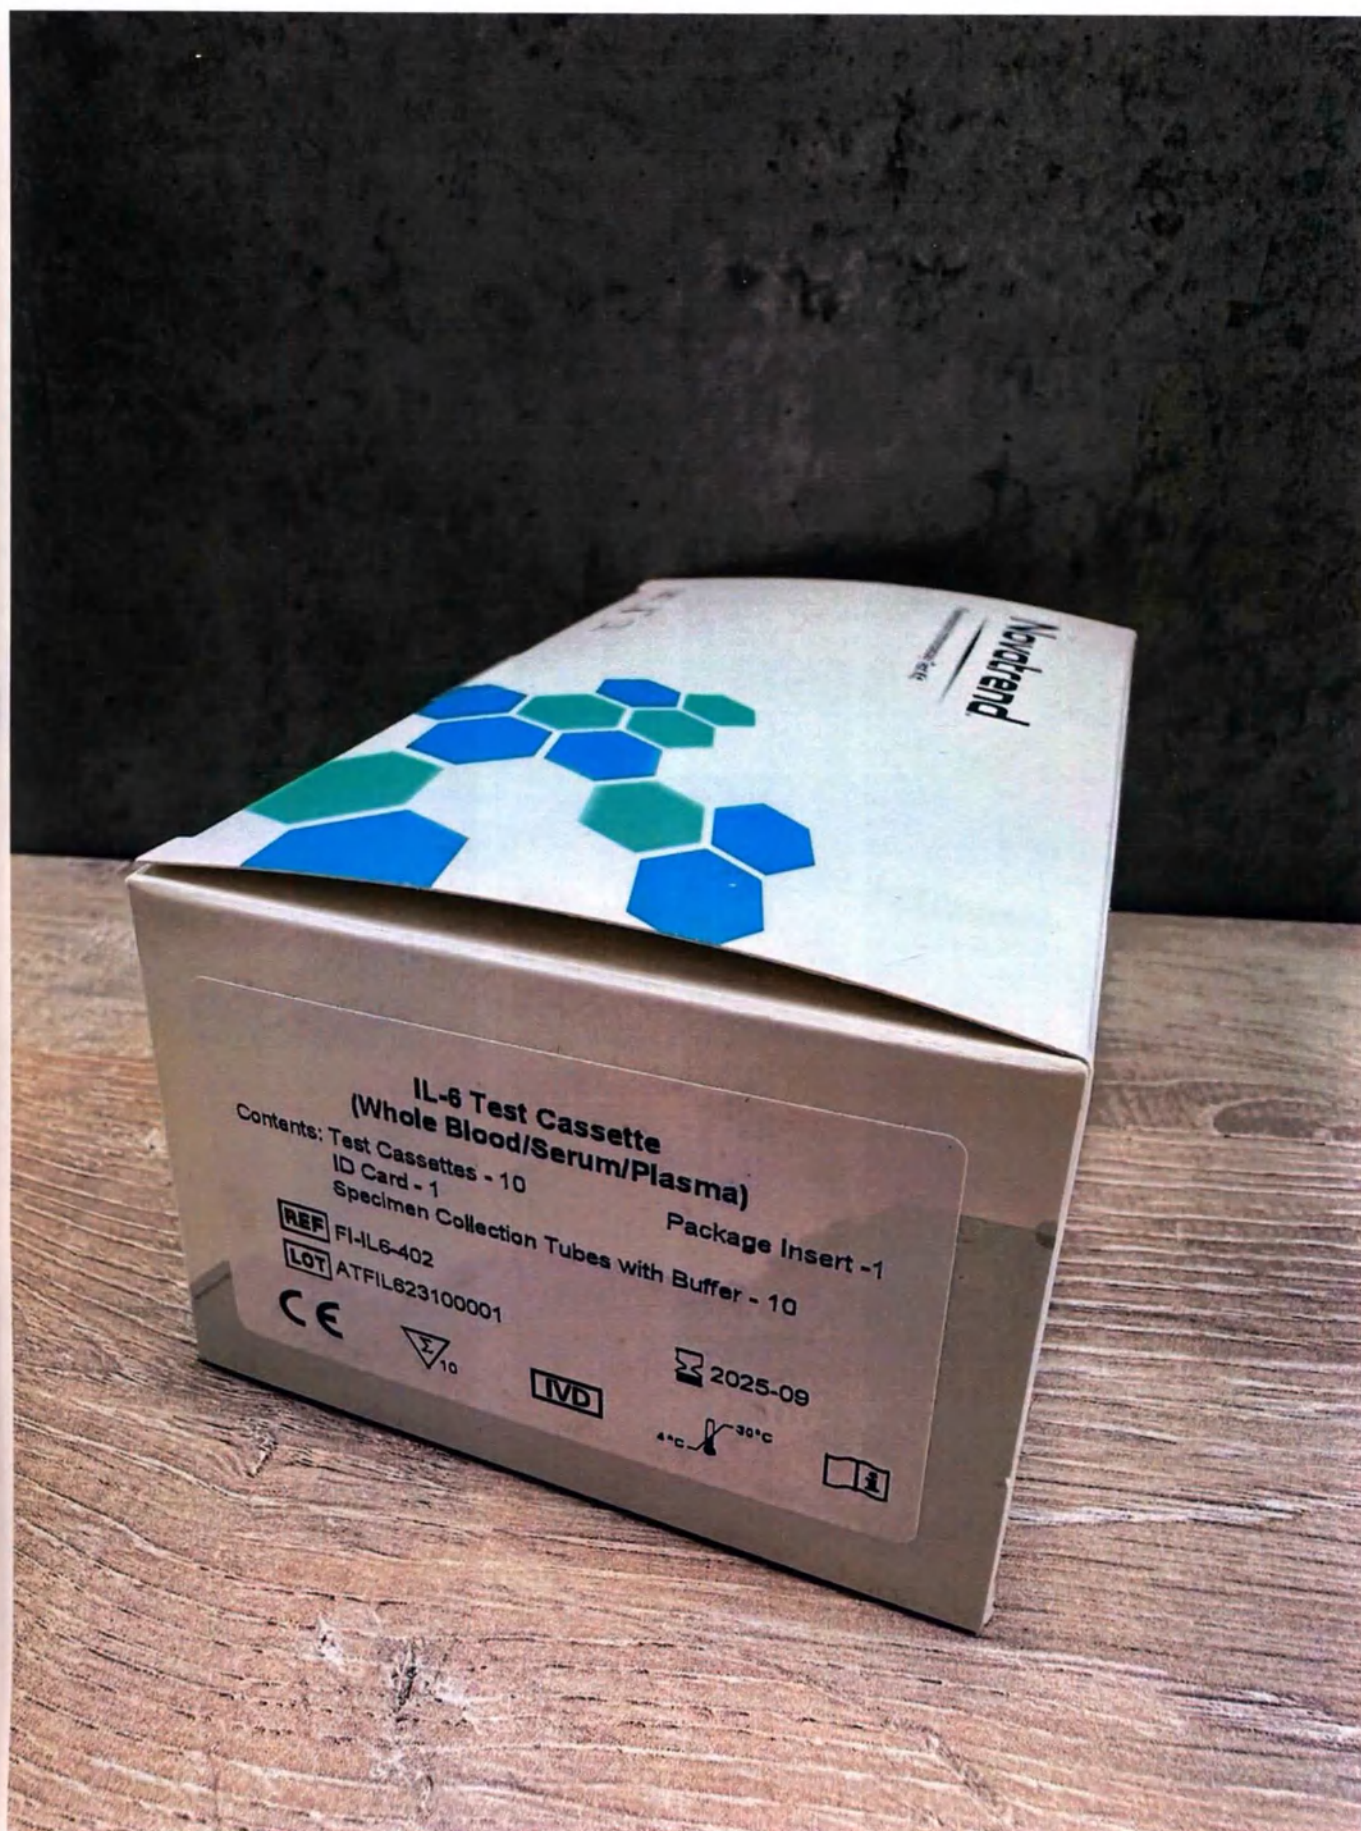


Рисунок 3. Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения I

Рисунок 4 Вторичная упаковка МИ, вариант исполнения II

5





Рисунок 5. Первичная упаковка тест-кассеты (IL-6 Test Cassette), тест-кассета (IL-6 Test Cassette), осушитель

Рисунок 6. Первичная упаковка тест-кассеты (IL-6 Test Cassette)

7





Рисунок 7. Пробирка с буфером для разведения образцов



Рисунок 8. Вторичная упаковка буфера (zip-пакет)



Рисунок 9. Идентификационная карта



Рисунок 10. Первичная упаковка идентификационной карты (zip-пакет)

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ ДЛЯ IN VITRO ДИАГНОСТИКИ**

«Набор реагентов для быстрого количественного определения интерлейкина-6 (IL-6) иммунофлуоресцентным методом в цельной крови, сыворотке или плазме на анализаторе Novatrend™ (Novatrend Fluorescence Immunoassay IL-6 Test Kit), в вариантах исполнения»

Производитель

«Ханчжоу Олтест Биотек Ко., Лтд.» (Hangzhou AllTest Biotech Co., Ltd.), KHP

Адрес: 550#, Yinhai Street, Hangzhou Economic and Technological Development Area, 310018 Hangzhou, PEOPLE'S
REPUBLIC OF CHINA

Версия: 1.0

Дата последней редакции: январь 2024

Рисунок 9. Инструкция по применению на медицинское изделие



ГЕН. ДИРЕКТОР
КУЗНЕЦОВА Д.В.

ПРОШТО И
ПРОНУМЕРОВАНО
12 ЛИСТОВ