

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПО «АБРИС+»

В.М. Марковский

20 24 г.



Макеты этикеток на медицинское изделие для диагностики *in vitro*:

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови
колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО NP АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023



Комплектация №1	стр. 2
Комплектация №2	стр. 3
Комплектация №3	стр. 4
Комплектация №4	стр. 5
Комплектация №5	стр. 6
Комплектация №6	стр. 7
Комплектация №7	стр. 8
Комплектация №8	стр. 9
Макет маркировки транспортной тары	стр. 10

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Макет этикеток



Комплектация № 1

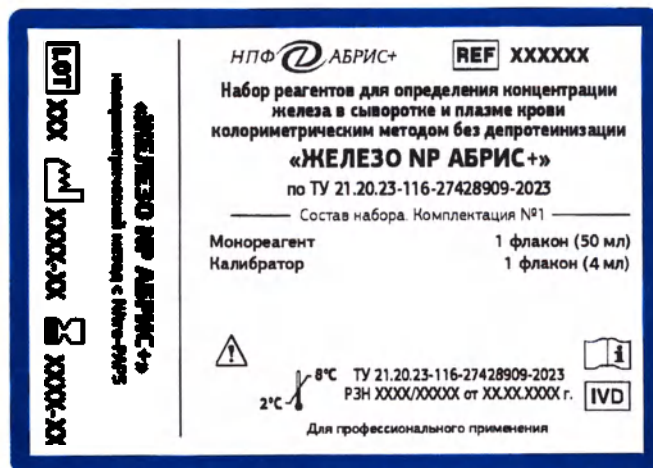

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Макет этикеток



Комплектация № 2

ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+ информационный листок с 10-го 10-го LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023 Состав набора. Комплектация №2 Монореагент 5 флаконов (по 20 мл) Калибратор 1 флакон (4 мл) ТУ 21.20.23-116-27428909-2023 РЗН XXXX/XXXXX от XXXX.XXXX г. Для профессионального применения

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» Монореагент 20 мл LOT XXX 2°C 8°C XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» Монореагент 20 мл LOT XXX 2°C 8°C XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» Монореагент 20 мл LOT XXX 2°C 8°C XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» Монореагент 20 мл LOT XXX 2°C 8°C XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» Монореагент 20 мл LOT XXX 2°C 8°C XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» Калибратор, 00,0 мкмоль/л 4 мл LOT XXX 2°C 8°C XXXX-XX IVD
--

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Макет этикеток



Комплектация № 3

LOT XXX XXX-XX XXX-XX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

информационный листок с №10-0005

НПФ АБРИС+ **REF XXXXXX**

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Состав набора. Комплектация №3

Монореагент	1 флакон (100 мл)
Калибратор	1 флакон (4 мл)

⚠

2°C 8°C

ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

РЗН XXXX/XXXXX от XXXX.XXXX г.

Для профессионального применения

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXXX**

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Монореагент

100 мл

2°C 8°C

LOT XXX

XXXX-XX

⚠

IVD

НПФ АБРИС+ **REF XXXXXX**

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Калибратор,

00,0 мкмоль/л

4 мл

2°C 8°C

LOT XXX

XXXX-XX

⚠

IVD

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Макет этикеток



Комплектация № 4

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Состав набора. Комплектация №4

Монореагент 5 флаконов (по 50 мл)
Калибратор 1 флакон (5 мл)

LOT 001 2023-11 2024-11

ТУ 21.20.23-116-27428909-2023
РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX г.

Для профессионального применения

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Монореагент

50 мл

LOT XXX

8°C

2°C

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Монореагент

50 мл

LOT XXX

8°C

2°C

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Монореагент

50 мл

LOT XXX

8°C

2°C

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Монореагент

50 мл

LOT XXX

8°C

2°C

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Монореагент

50 мл

LOT XXX

8°C

2°C

XXXX-XX

IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Калибратор,

00,0 мкмоль/л

5 мл

LOT XXX

8°C

2°C

XXXX-XX

IVD

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Макет этикеток





Комплектация № 5

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX	НПФ АБРИС+ REF XXXXXX
	Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023
	Состав набора. Комплектация №5
	Монореагент 1 флакон (250 мл) Калибратор 1 флакон (5 мл)
	8°C 2°C ТУ 21.20.23-116-27428909-2023 РЗН XXXX/XXXXX от XXX.XX.XXXX г. Для профессионального применения

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX	
«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» Монореагент 250 мл	
LOT XXX	
8°C 2°C	XXXX-XX IVD

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX	
«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» Калибратор, 00,0 мкмоль/л	
5 мл	LOT XXX
8°C 2°C	XXXX-XX IVD

Комплектация № 6

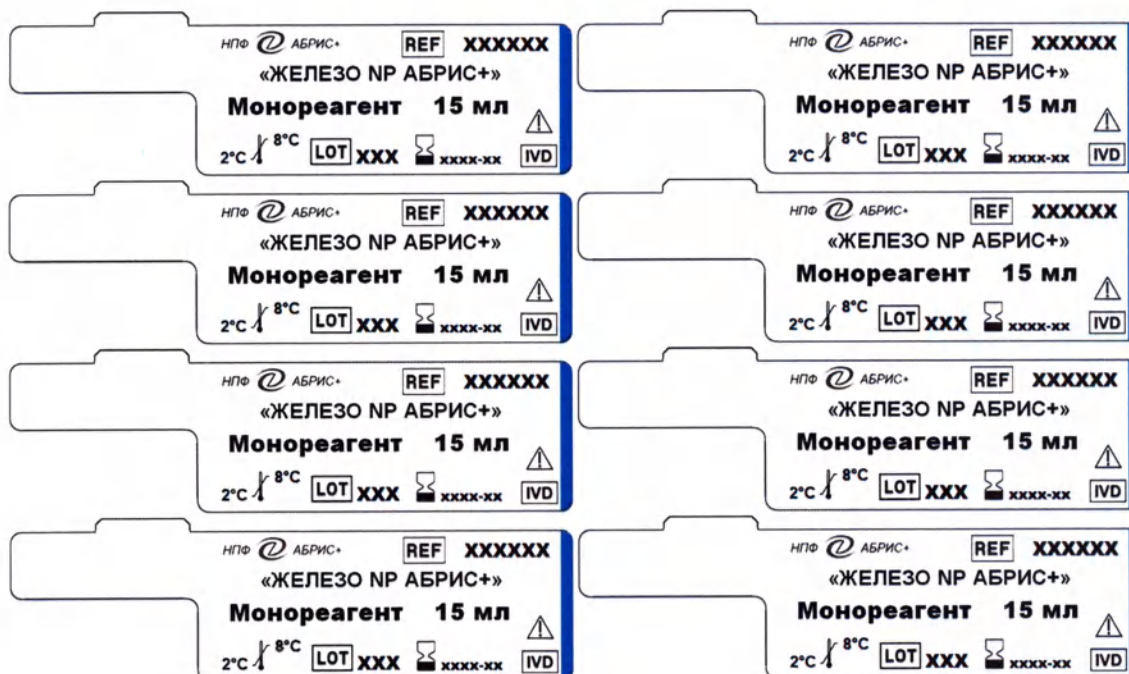



LOT

 XXX



 XXXX-XX



 XXXX-XX

НПФ  АБРИС+ REF XXXXXX

Набор реагентов для определения концентрации
железа в сыворотке и плазме крови
колориметрическим методом без депротеинизации

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Состав набора. Комплектация №7

Монореагент	2 флакона (по 60 мл)
Калибратор	1 флакон (4 мл)




IVD


 2°C


 8°C

ТУ 21.20.23-116-27428909-2023
 РЗН XXX/XXXXX от XX.XX.XXXX

Для профессионального применения



8

Комплектация № 8

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Состав набора. Комплектация №8

Монореагент 4 флакона (по 60 мл)
Калибратор 1 флакон (5 мл)

LOT XXX XXXX-XX XXXX-XX XXXX-XX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»
колориметрический метод с Nitro PAPs

ТУ 21.20.23-116-27428909-2023
РЗН XXX/XXXX от XX.XX.XXXX
Для профессионального применения

2°C 8°C

IVD

Fe

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Монореагент
60 мл

LOT XXX XXXX-XX

IVD 2°C 8°C

Fe

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Монореагент
60 мл

LOT XXX XXXX-XX

IVD 2°C 8°C

Fe

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Монореагент
60 мл

LOT XXX XXXX-XX

IVD 2°C 8°C

Fe

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Монореагент
60 мл

LOT XXX XXXX-XX

IVD 2°C 8°C

НПФ АБРИС+ REF XXXXXX

«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+»

Калибратор,
00,0 мкмоль/л

5 мл LOT XXX XXXX-XX

IVD 2°C 8°C

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»


В.М. Марковский

« 10 » 07 2024 г.

Макет маркировки транспортной тары

на медицинское изделие для диагностики *in vitro*:

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови
колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО NP АБРИС+»
по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

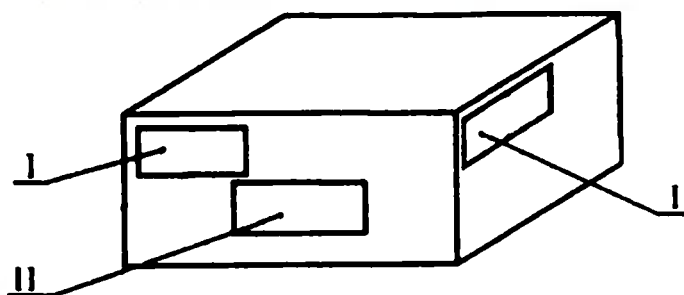

I



II



НПФ

АБРИС+

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Научно-производственная фирма «АБРИС+»

196006, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, литера М, этаж 2.
Тел./факс: (812) 740-1992, 740-1755, 740-1789. Фед. номер: 8-800-333-7324. E-mail: abris@abrisplus.ru

**Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и
плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации
«ЖЕЛЕЗО NP АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023**

LOT

xxx

Количество наборов: XX шт.



XXXX-XX

Масса нетто: XX кг



XXXX-XX

Масса брутто: XX кг



ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

РУ № РЗН xxxx/xxxx от xx.xx.xxxx

Прошито и пронумеровано

10 (десять)

лист

08

Генеральный директор

ООО «НПО «АЕ ИС+»

В.М. Марковский



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «НПФ «АБРИС+»

В.М. Марковский

20 24 г.



Фотографические изображения медицинского изделия
Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме
крови колориметрическим методом без депротеинизации
«ЖЕЛЕЗО NP АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Комплектация №1	Общий вид	лист 2
	Вид в упаковке	лист 3
Комплектация №2	Общий вид	лист 4
	Вид в упаковке	лист 5
Комплектация №3	Общий вид	лист 6
	Вид в упаковке	лист 7
Комплектация №4	Общий вид	лист 8
	Вид в упаковке	лист 9
Комплектация №5	Общий вид	лист 10
	Вид в упаковке	лист 11
Комплектация №6	Общий вид	лист 12
	Вид в упаковке	лист 13
Комплектация №7	Общий вид	лист 14
	Вид в упаковке	лист 15
Комплектация №8	Общий вид	лист 16
	Вид в упаковке	лист 17
Фотографическое изображение транспортной (групповой упаковки)		лист 18

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №1






НПО АБРИС+
 198006, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
 тел./факс: (812) 740-1992, 740-1755, 740-1789. Факс номер

ОБЩЕСТВО С ОО
 Научно-произво

ПАСПОРТ
 для определения
 метрическим

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
метод определения концентрации гемоглобина в эритроцитах и плазме крови колориметрическим методом с Nitro-PAP(S)
1010.1.100
Таблица №3
1x100 мл
1x4 мл
Nitro

НПФ  АБРИС

ОБЩЕ-
Научно-
Производственная фирма «АБРИС+»
г. Санкт-Петербург, 19116-27428909-2023

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА
и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации

НПФ «АБРИС+»

Набор реагентов для определения методом с Nitro-PAPS

Колориметрический метод №3

1x100 мл

1x4 мл

Кат. № А010.5.50

Комплектация №4

Монореагент 5x50 мл

Калибратор 1x5 мл

Рекомендуется использовать интервалы концентрации геогрифа

[illegible]

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №2



Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №3





Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №4



Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО NP АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №4



Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №5



Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО NP АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №5




ор реагентов для определения концентрации железа в
 воротке и плазме крови колориметрическим методом
 без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ
 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое
 изображение
 медицинского
 изделия общего вида



Комплектация №6

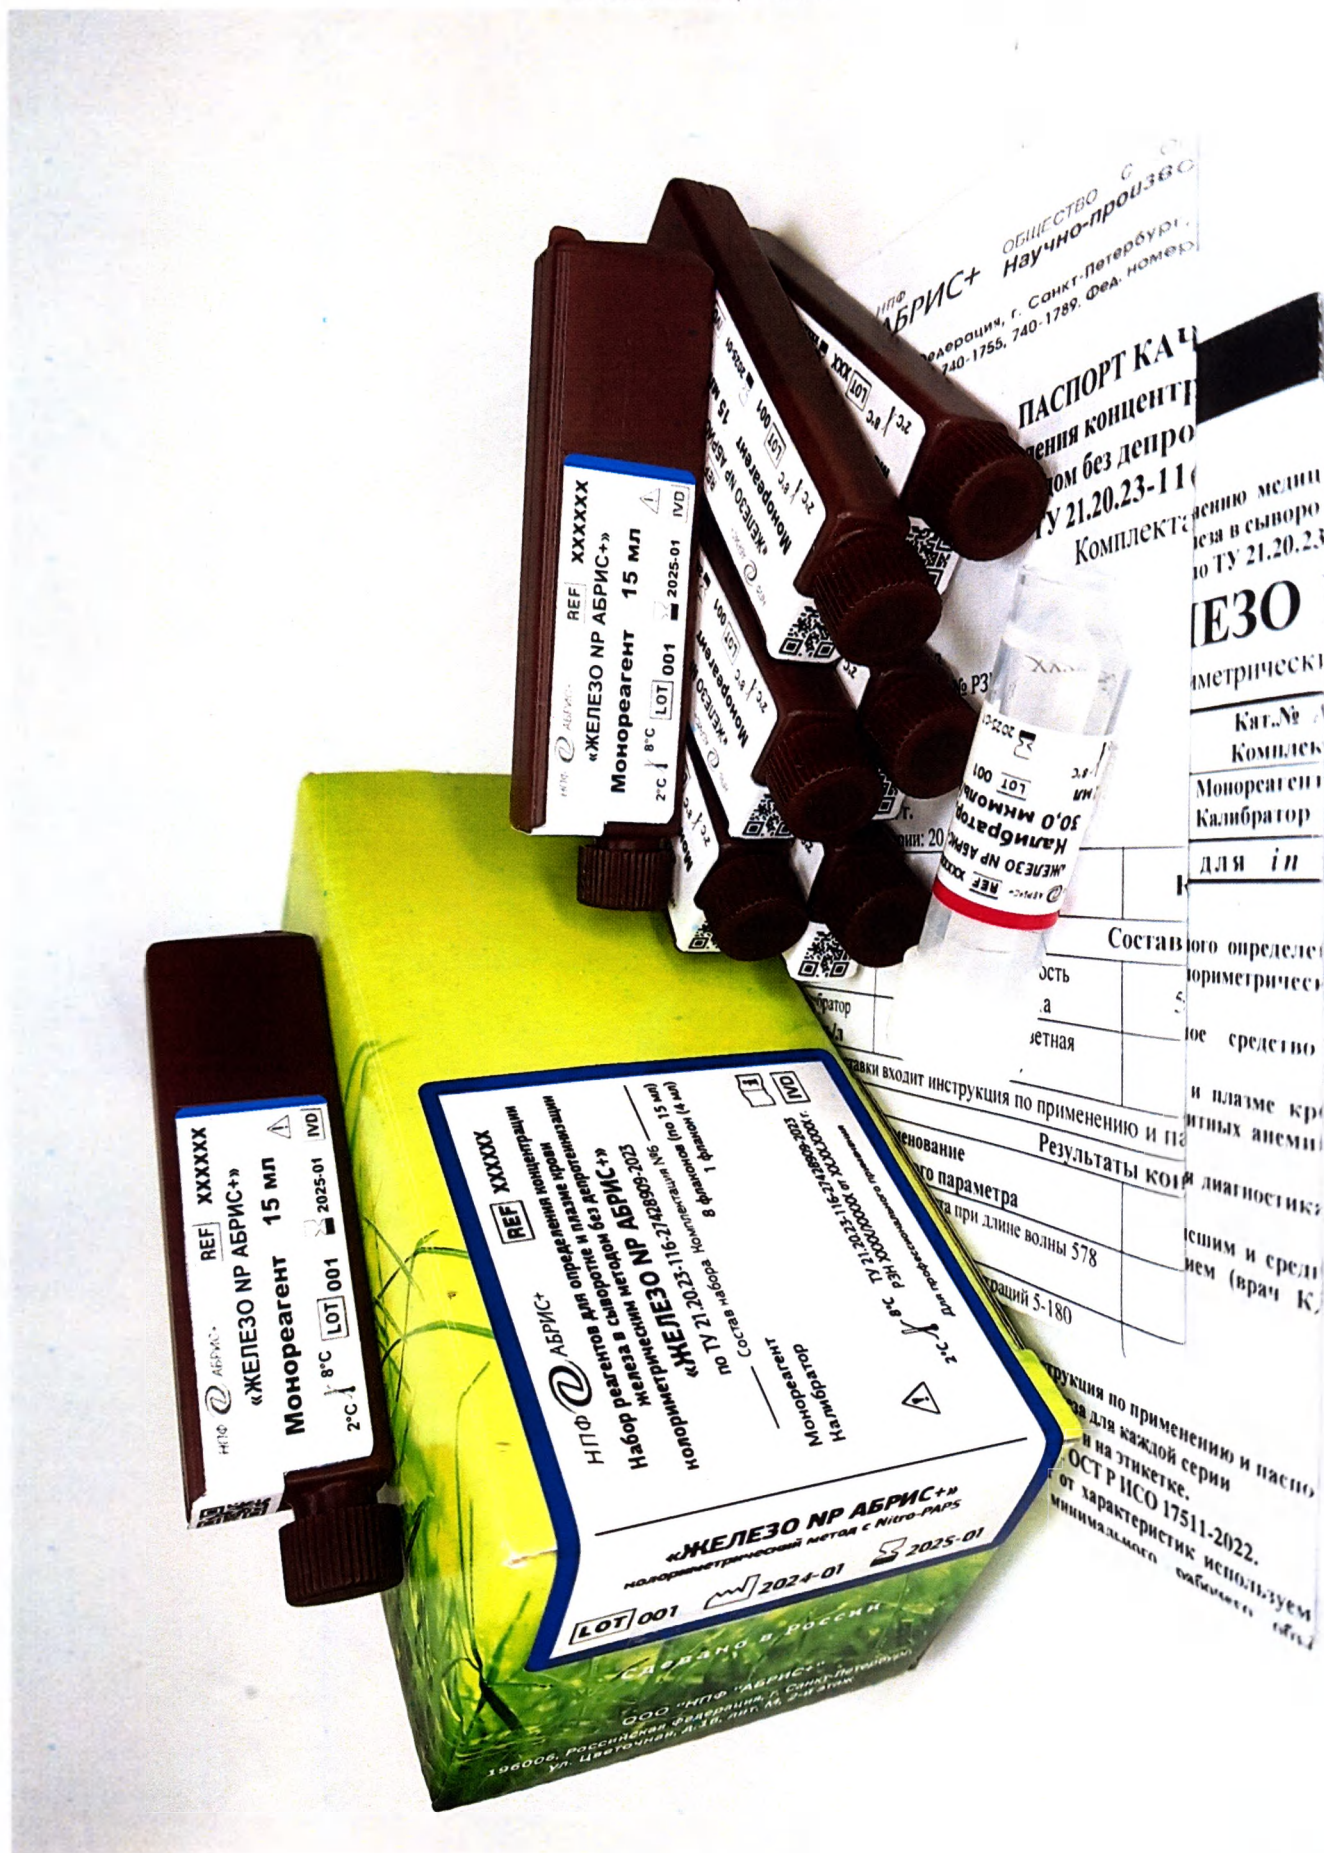


Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №6

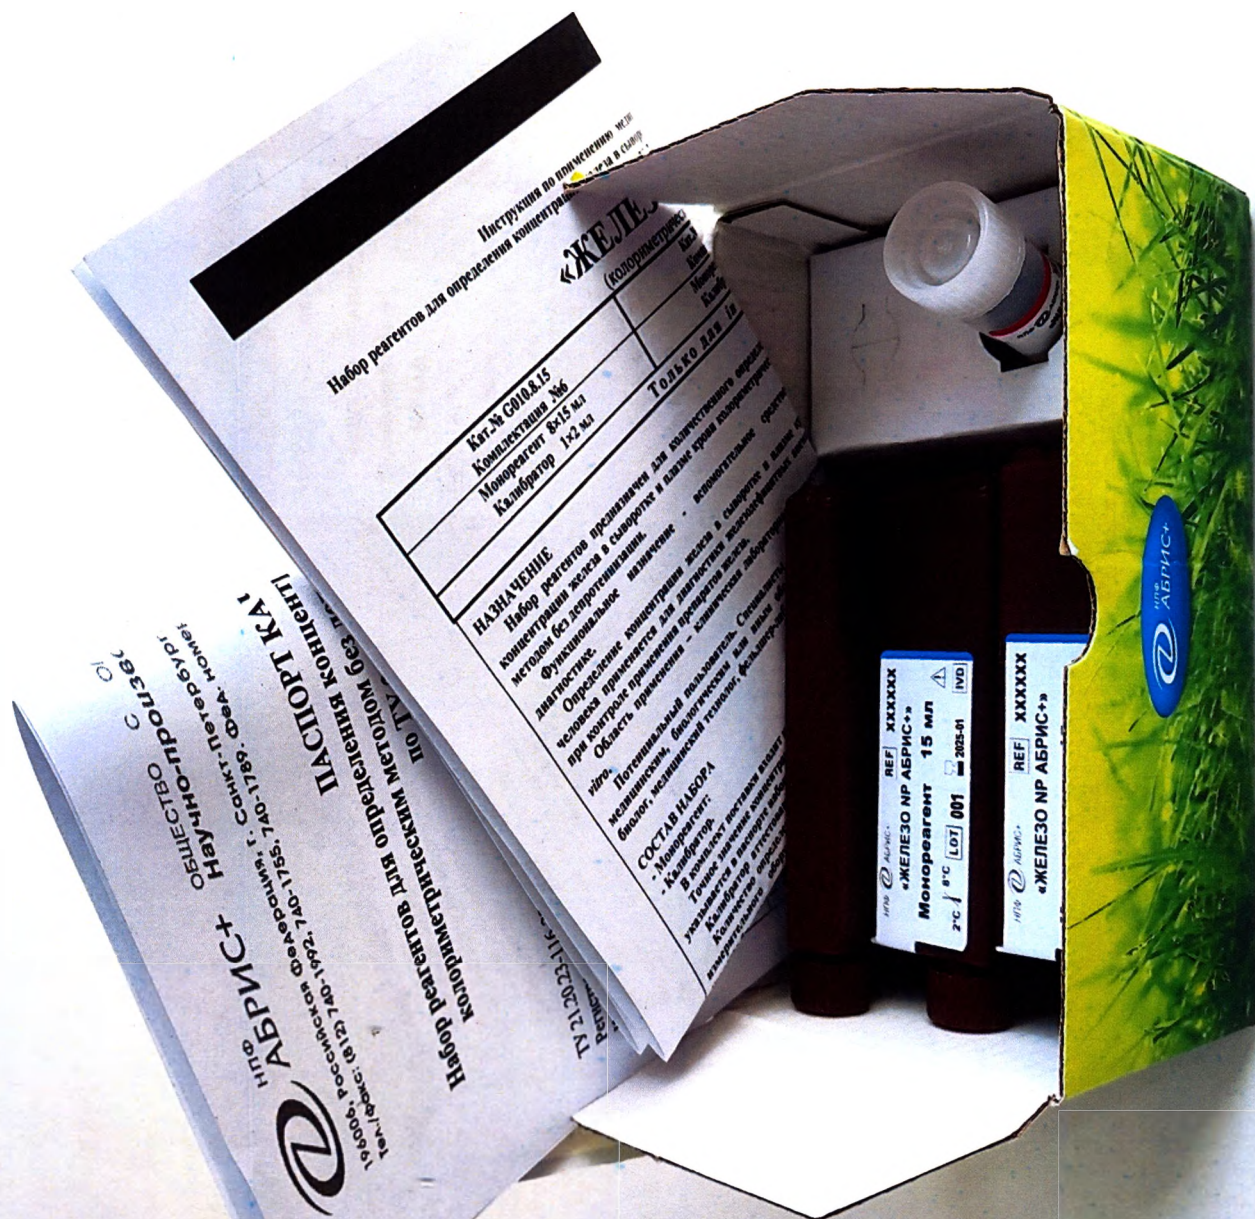



The image shows a laboratory kit for iron determination. The main components are:

- Yellow Box:** Labeled "ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+" (Iron NR ABRIS+). It specifies a colorimetric method with Nitro-PAPS, a lot number of 001, and a validity date of 2024-01 to 2025-01. It also mentions "Сделано в России" (Made in Russia) and the manufacturer "ООО 'НПФ 'АБРИС'".
- Red Bottles:** Two bottles of reagent, each labeled "Монореагент" (Monoreagent) and "60 мл" (60 ml). They also have lot numbers and validity dates.
- White Vial:** A calibration vial labeled "Калибратор" (Calibrator) with a lot number and validity date.
- Document:** A partially visible document with a table of results. The table has columns for "Вещество" (Substance), "Внешний вид и форма выпуска" (Appearance and form of release), and "Состав" (Composition). The visible rows describe the reagents and the calibration vial.



НПФ
АБРИС+

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия общего вида



Комплектация №8



Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое изображение медицинского изделия в упаковке



Комплектация №8



Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации «ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

Фотографическое изображение транспортной (групповой) упаковки



НПФ АБРИС+ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Научно-производственная фирма «АБРИС+»
194004, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Цветочная, д. 16, литера М, этаж 2
Тел./факс: (812) 740-1192, 740-1755, 740-1789. Факс, номер: 8-800-333-7324. E-mail: office@abris.ru

Набор реагентов для определения концентрации железа в сыворотке и плазме крови колориметрическим методом без депротеинизации
«ЖЕЛЕЗО НР АБРИС+» по ТУ 21.20.23-116-27428909-2023

LOT	001	Количество наборов: 27 шт.
	2024-01	Масса нетто: 5,4 кг
	2025-01	Масса брутто: 5,6 кг

8 °C
2 °C

ТУ 21.20.23-116-27428909-2023
РУ № РЗН XXXX/XXXX от XX.XX.XXXX

ТУ 21.20.23-116-27428909-2023



Прошито и пронумеровано
18 (всего 18 листов) лист 18
Генеральный директор
ООО «АБРИС+»
В.М. Марковский

